




Общий вид медицинского изделия во внешней (потребительской) упаковке



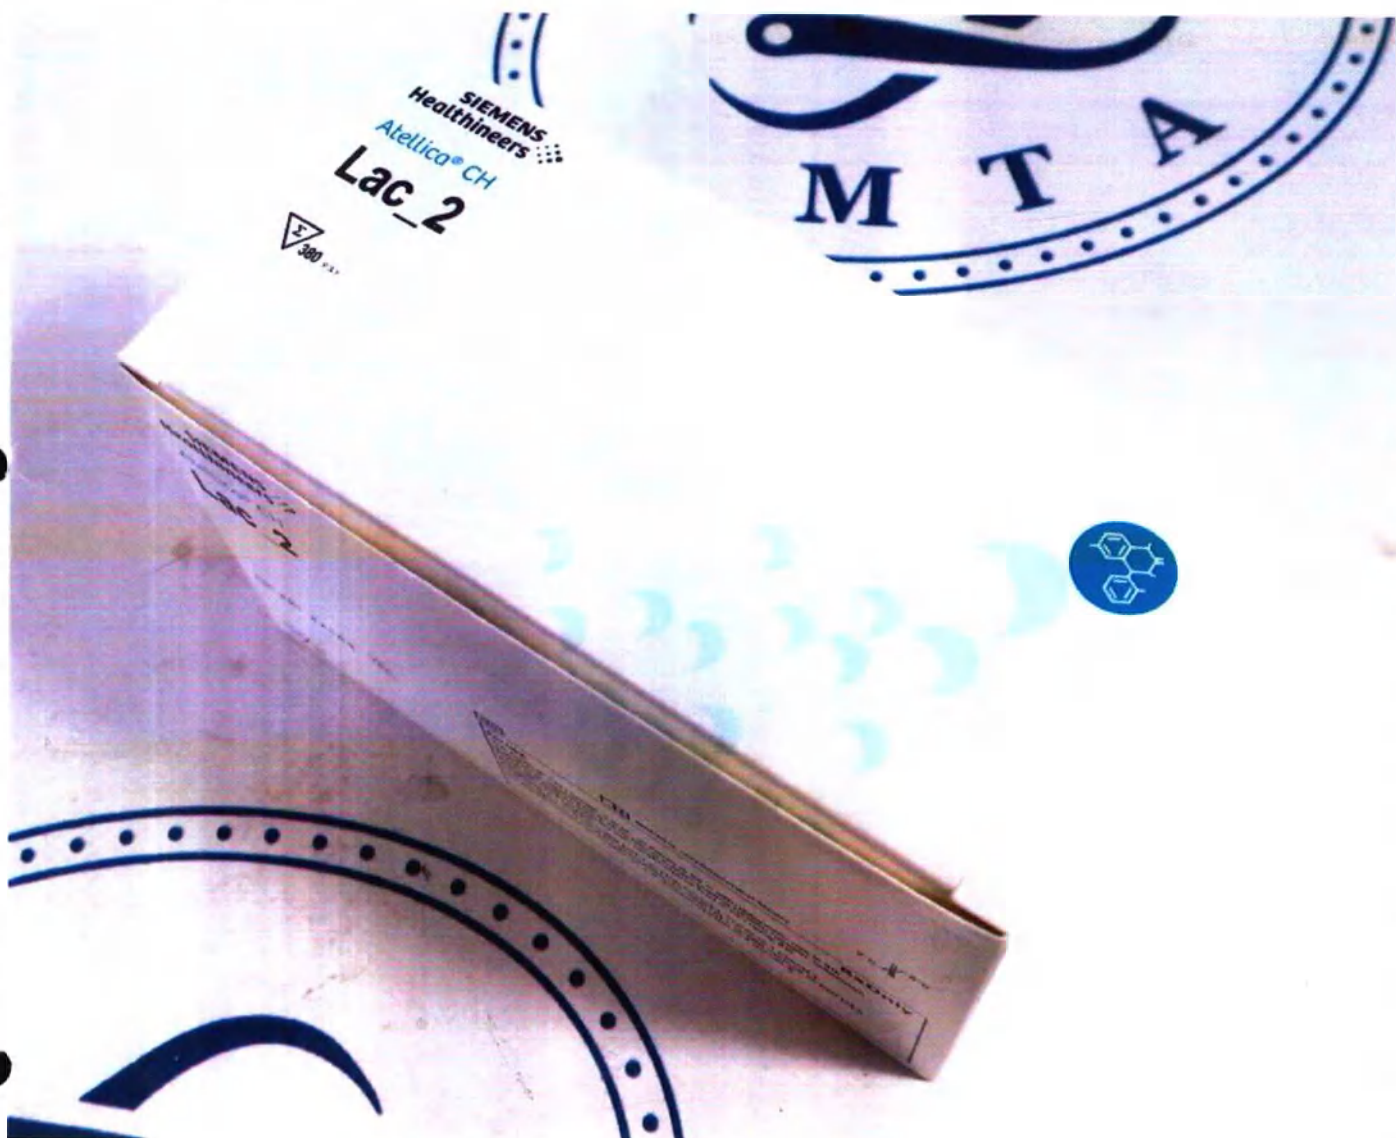

Потребительская упаковка, вид сверху.



SIEMENS
Healthineers

Atellica® CH


Lac_2



SIEMENS
Healthineers
Atellica® CH
Lac_2



Потребительская упаковка, вид спереди.

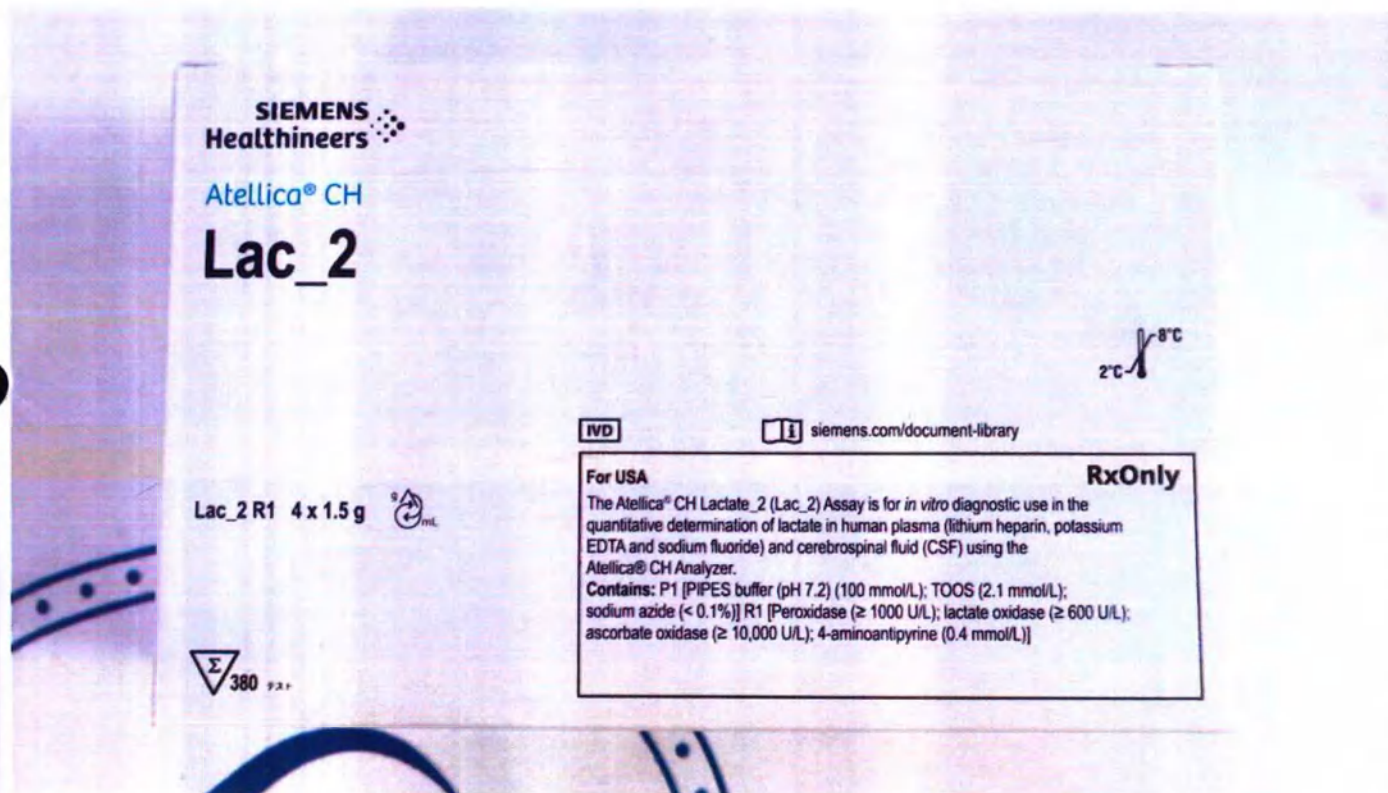




Потребительская упаковка, вид с правой стороны.





Потребительская упаковка, вид с левой стороны.

Lac_2



LOT 211460

製造番号

2022-10-01

使用期限

REF 11532568

i Rev.02



(01) 00630414287270

(10) 211460

(17) 221001

(240) 11532568

(422) 826

GTIN

BATCH/LOT

EXPIRY

SMN

ORIGIN GB

00486



Компоненты медицинского изделия






Реагент 1, Atellica CH Lac_2. Вид спереди.





Реагент 1, Atellica CH Lac_2. Вид сверху.

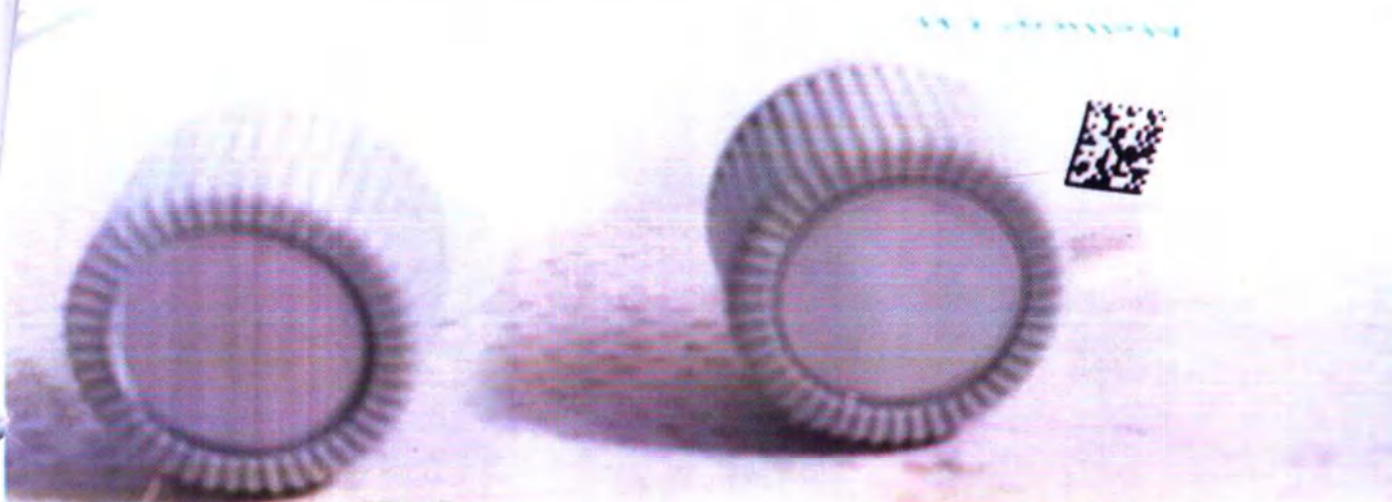




Реагент 1, Atellica CH Lac_2. Вид сзади.





Atellica CH Lac_2 R1. Маркировка.

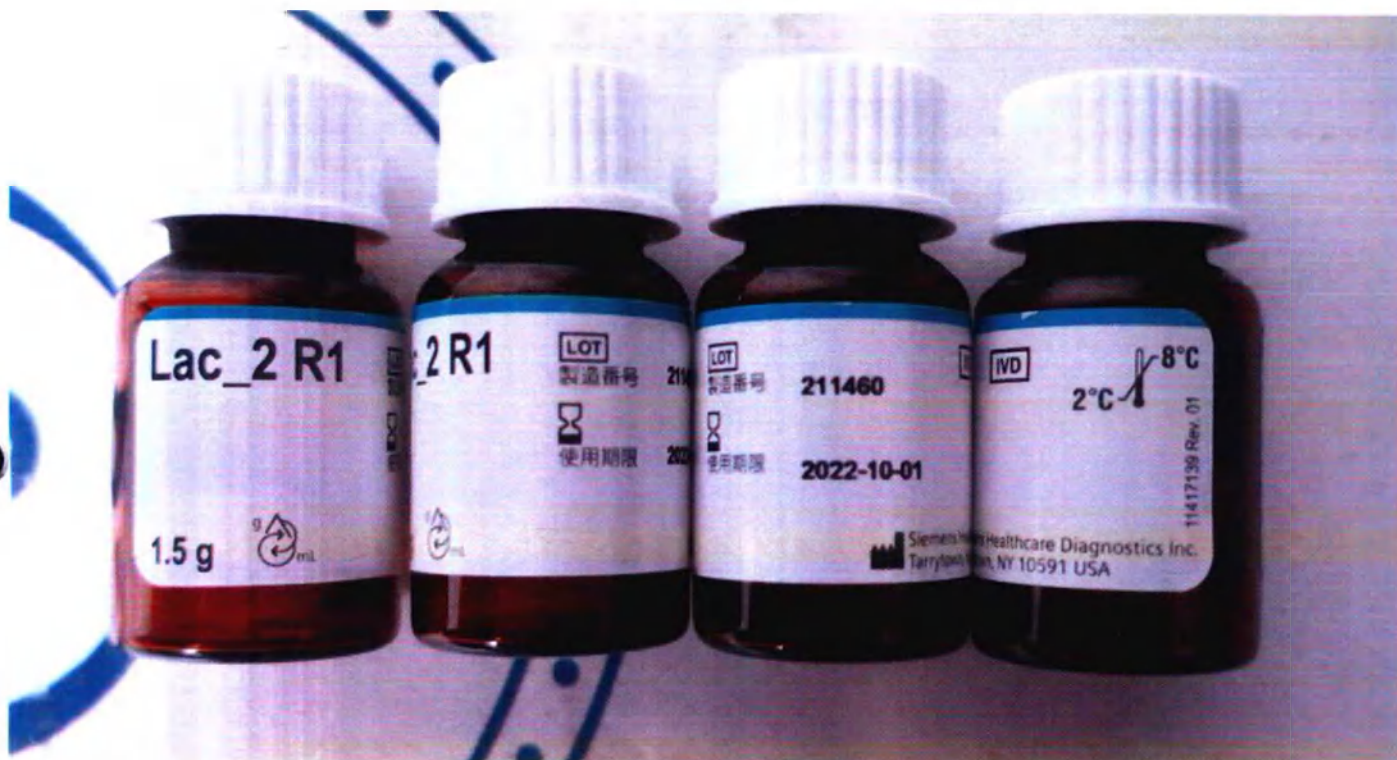

Пронумеровано, прошнуровано

и скреплено печатью 10

десять) листов

Ст Страшко С.В.



Руководитель группы регистрации

ООО «Сименс Здравоохранение»



Горшкова Н.А

«27» сентября 2021 г.

Фотографические изображения медицинского изделия для диагностики in vitro

Набор реагентов для определения лактата на анализаторах биохимических серии Atellica (Atellica CH Lactate_2 (Atellica CH Lac_2))

2021



Рисунок 1. Набор реагентов для определения лактата на анализаторах биохимических серии Atellica (Atellica CH Lactate_2 (Atellica CH Lac_2)), общий вид изделия.



Рисунок 2. Набор реагентов для определения лактата на анализаторах биохимических серии Atellica (Atellica CH Lactate_2 (Atellica CH Lac_2)), Упаковка 1 (Реагент 1, Atellica CH Lac_2) – 4 шт.



Рисунок 3. Набор реагентов для определения лактата на анализаторах биохимических серии Atellica (Atellica CH Lactate_2 (Atellica CH Lac_2)), Флаккон (Atellica CH Lac_2 R1, 1,5 г) – 4 шт.



Всего прошито и пронумеровано
4 листа (ов).

ООО «Сименс Здравоохранение»