


**Фотографические изображения и маркировка
медицинского изделия**

Аппарат для инсуффляции AirSeal i.F.S. в составе



Аппарат для инсуффляции AirSeal i.F.S общий вид

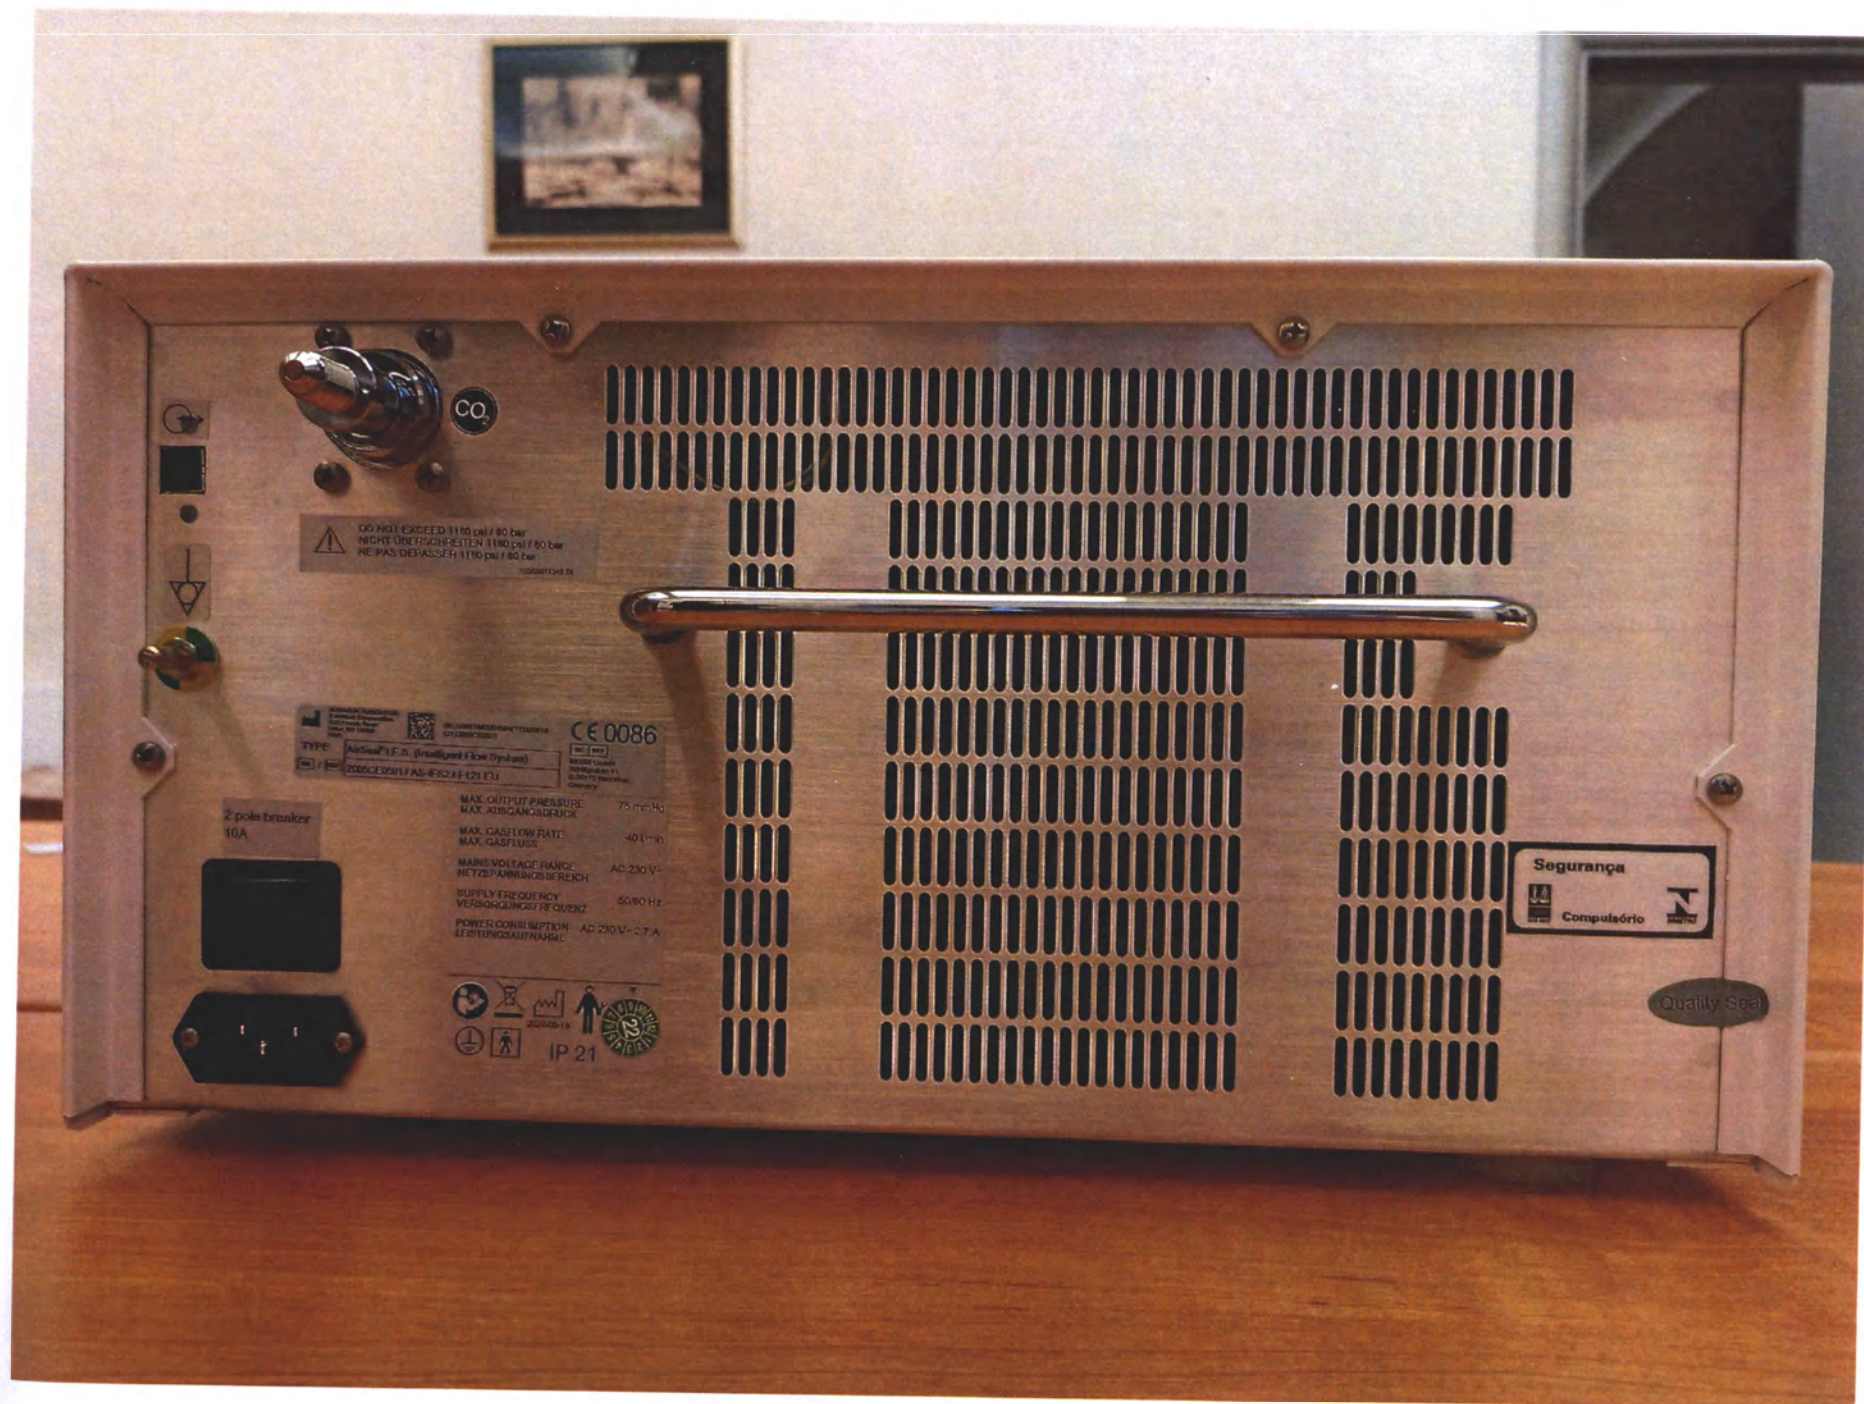

Аппарат для инфуляции AirSeal i.F.S общий вид сзади


MANUFACTURED FOR:
 ConMed Corporation
 525 French Road
 Utica, NY 13502
 USA


 (01)10851885004594(11)200519
 (21)2005CE0501

CE 0086
 EC REP

TYPE
AirSea® i.F.S. (Intelligent Flow System)

MDSS GmbH
 Schiffgraben 41
 D-30175 Hannover,
 Germany

SN / REF
 2005CE0501 / AS-iFS2 / F121 EU

2 pole breaker
10A

MAX. OUTPUT PRESSURE 75 mmHg
 MAX. AUSGANGSDRUCK
 MAX. GASFLOW RATE 40 l/min
 MAX. GASFLUSS
 MAINS VOLTAGE RANGE AC 230 V-
 NETZSPANNUNGSBEREICH
 SUPPLY FREQUENCY 50/60 Hz
 VERSORUNGSFREQUENZ
 POWER CONSUMPTION AC 230 V- 2.7 A
 LEISTUNGS-AUFNAHME






Шнур электропитания




Шнур электропитания

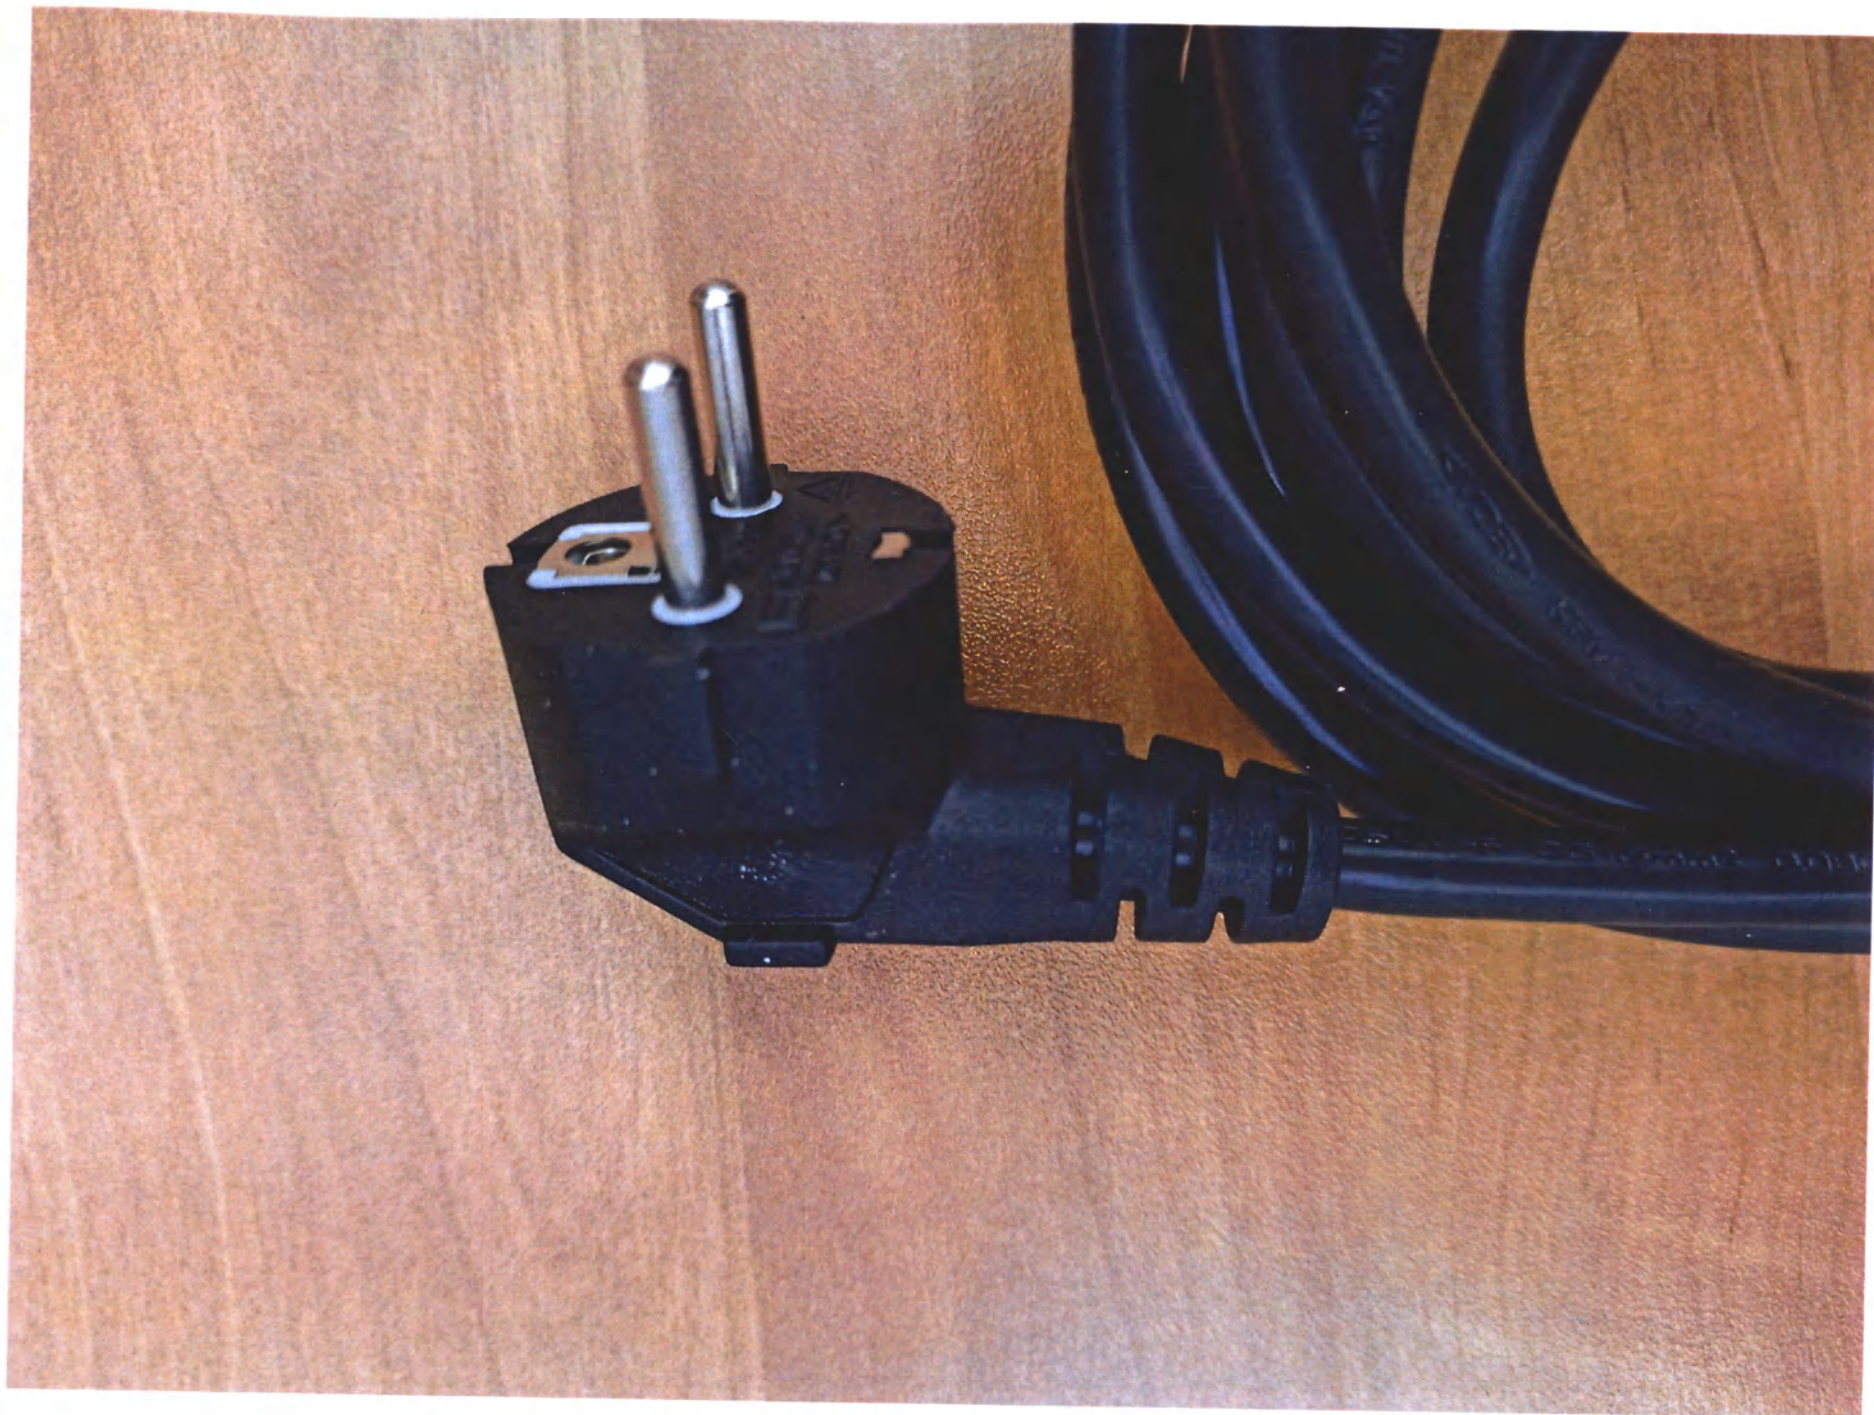


Шнур электропитания

REF	IFS-WC2		
LOT	5076511		
EXP	2019-12-05	(01)04056702000165	Regulating Agency 0101
		(11)191205(10)5076511	
ITEM EN	Gas connection CO2 house gas NIST		
ITEM DE	Gasanschluss CO2 Hausgas-NIST		
		QTY 1	
 W.O.M. WORLD OF MEDICINE GmbH Salzrufer 8, 10587 Berlin, Germany Phone: +49 30 39981-550 Fax: +49 30 39981-545 E-mail: info.berlin@womecorp.com		CE 0197 2200703 / 10000019244 00	

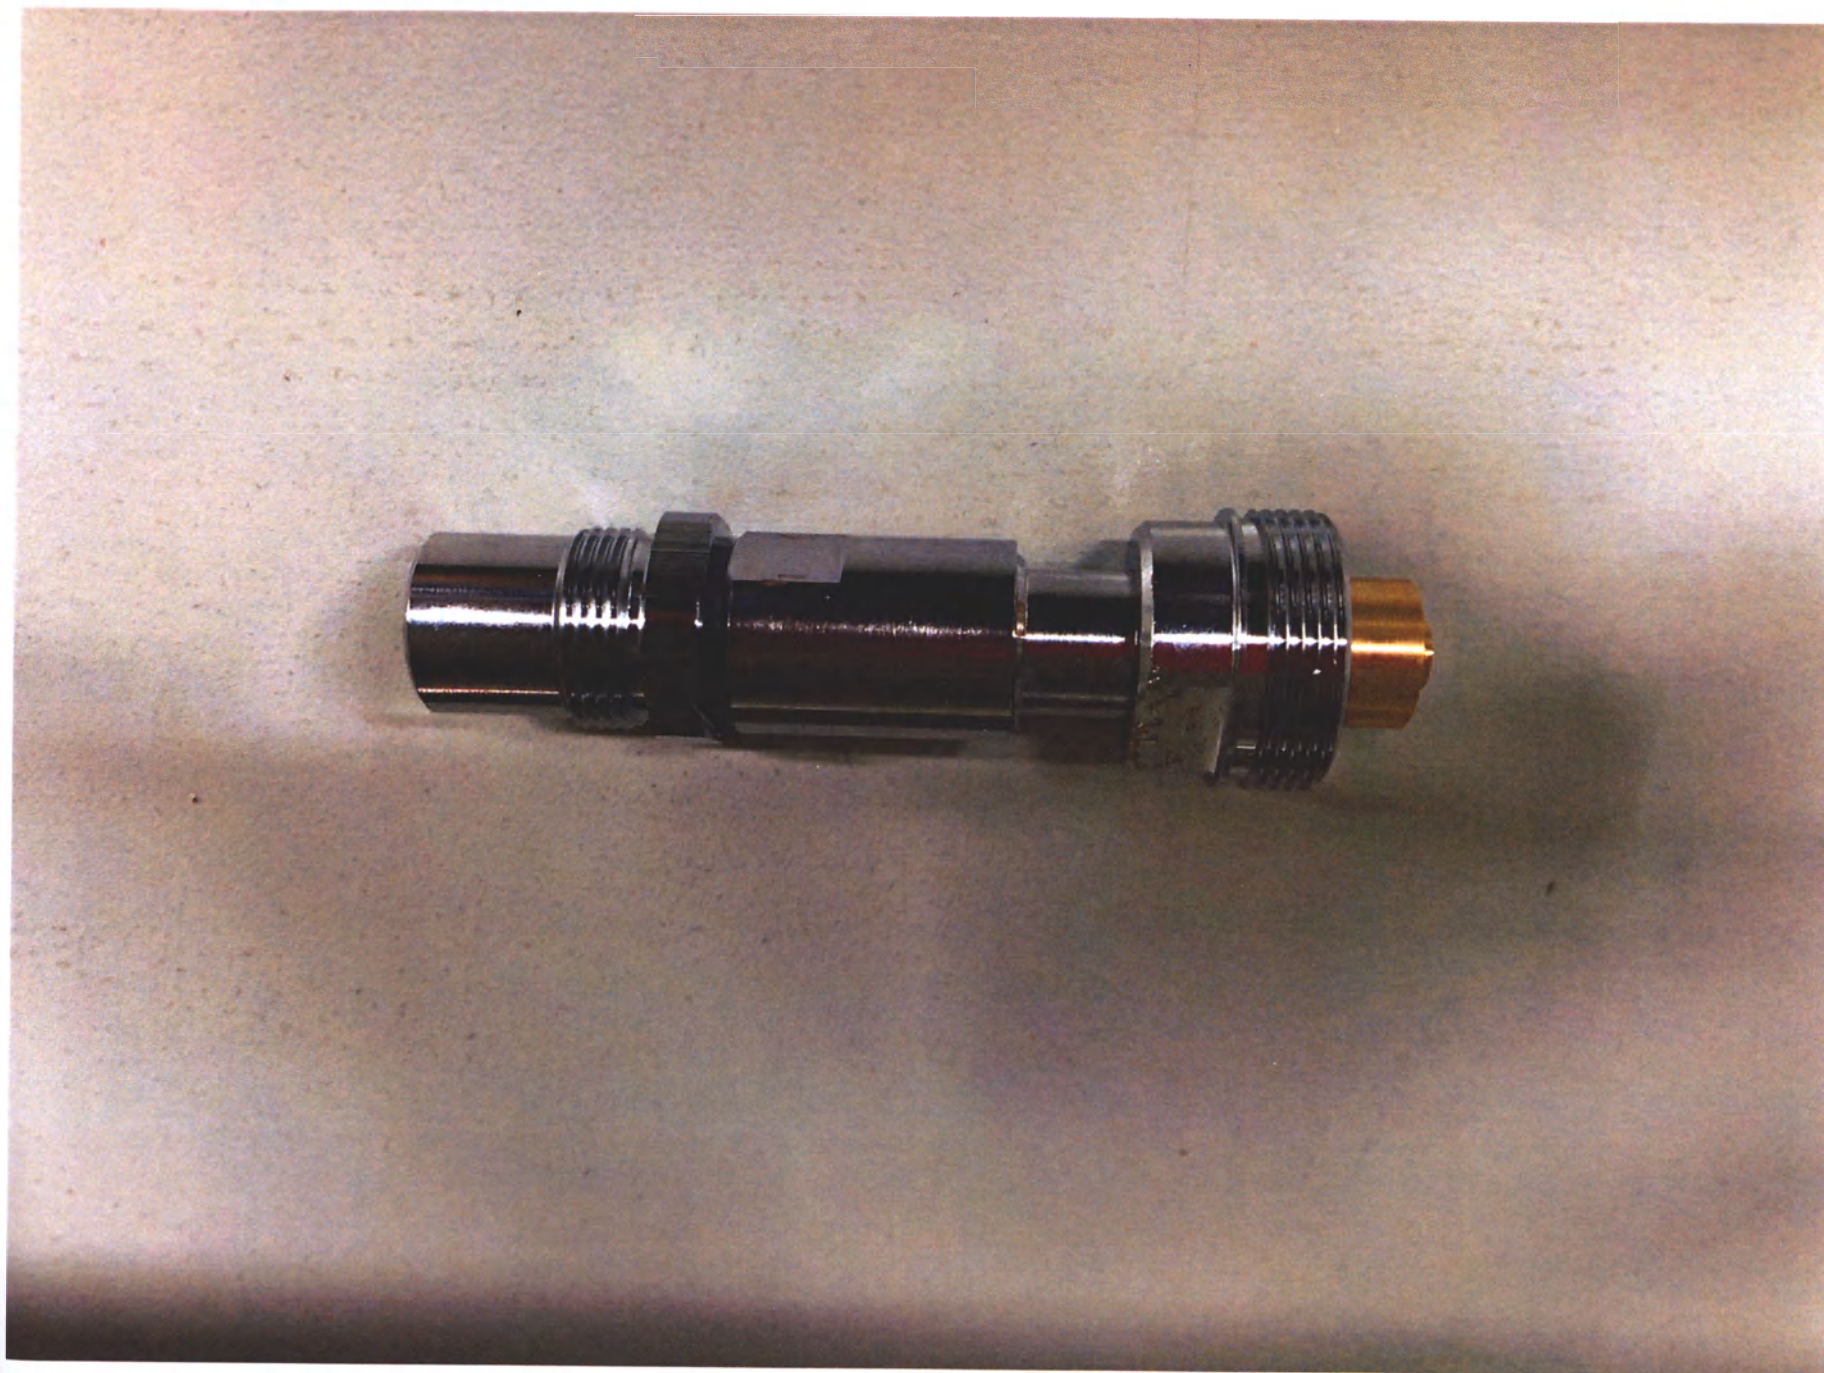


Коннектор

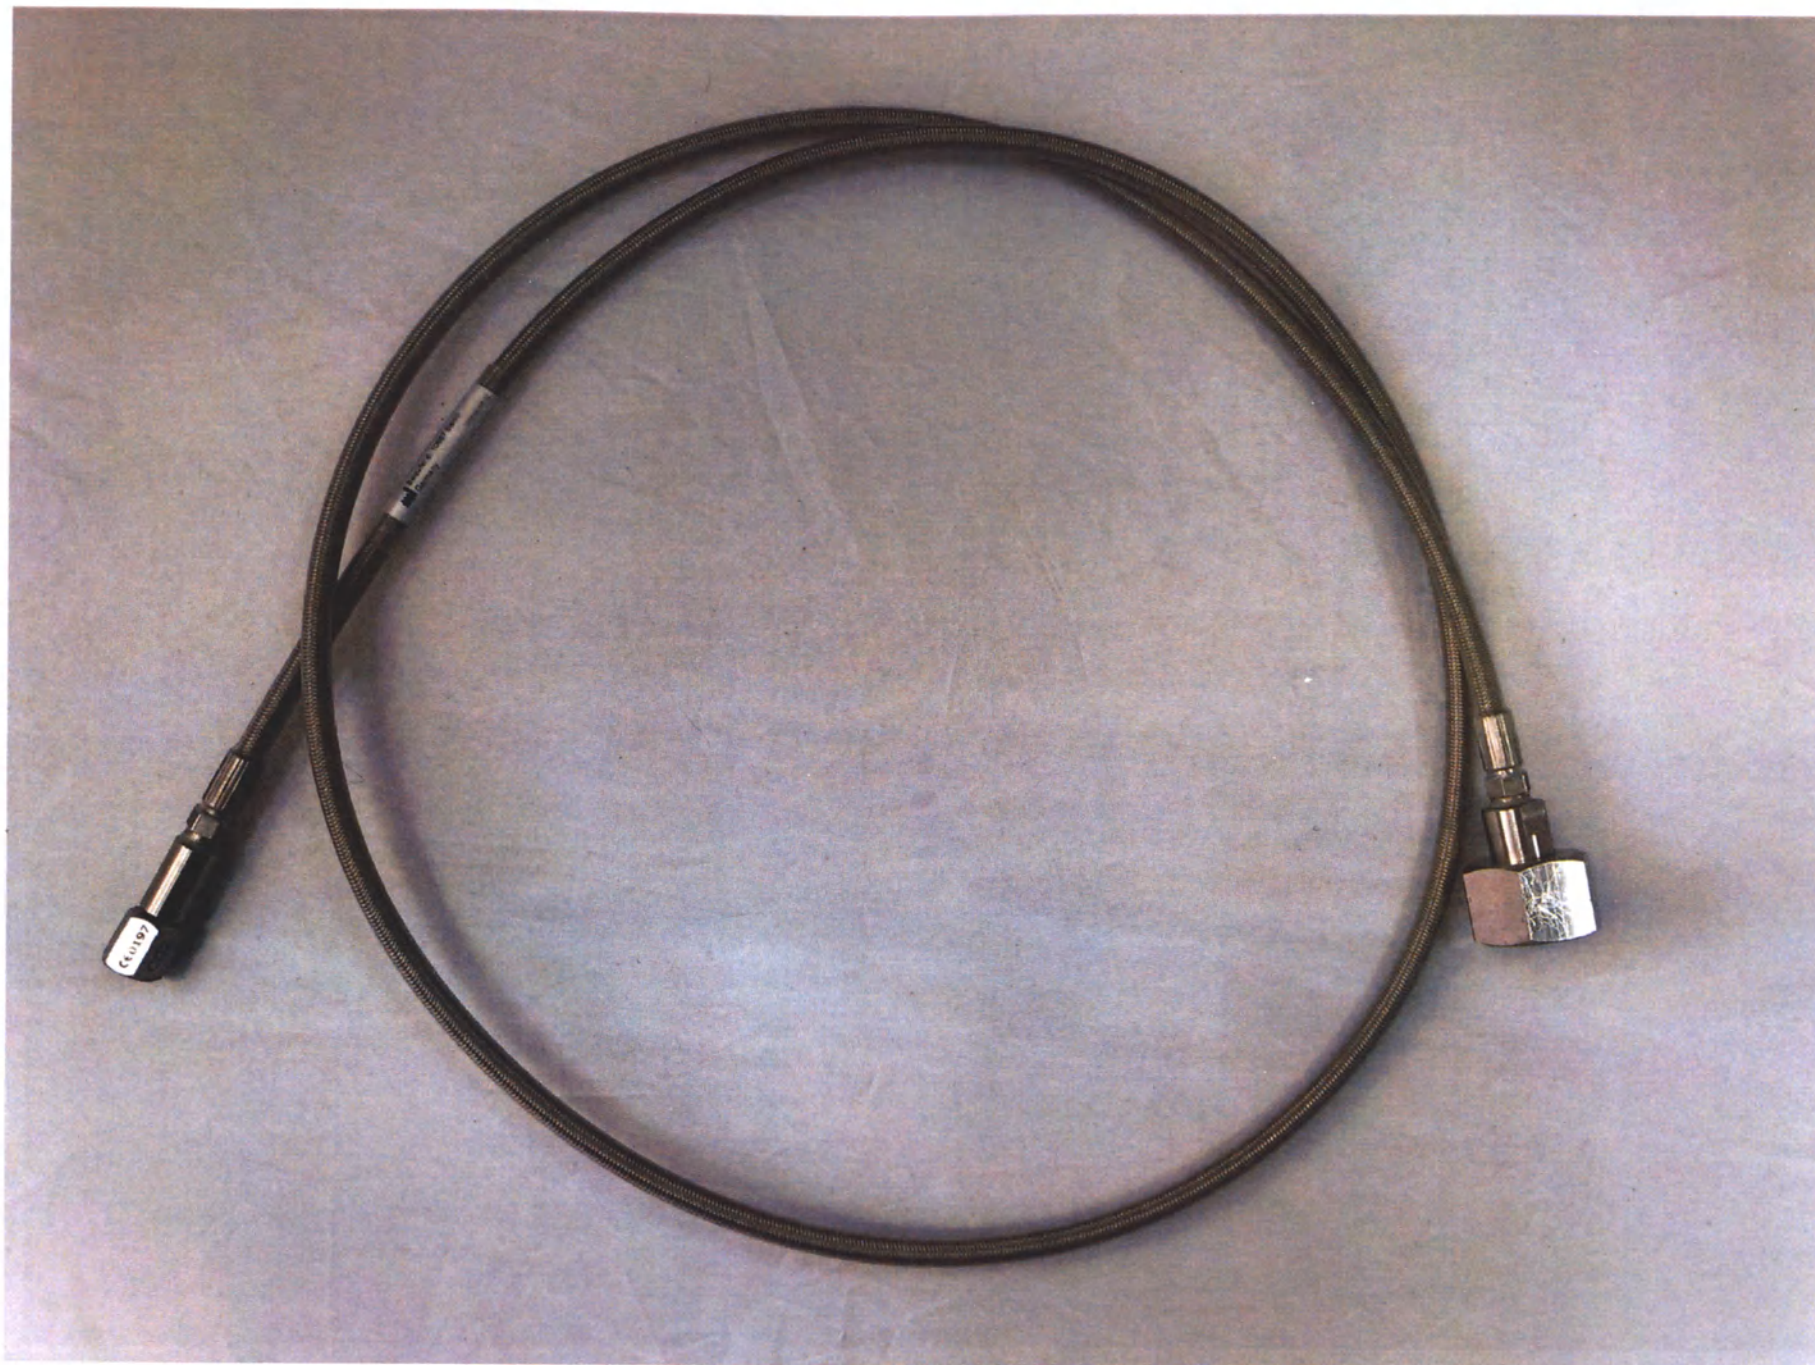

Шланг высокого давления



Шланг высокого давления

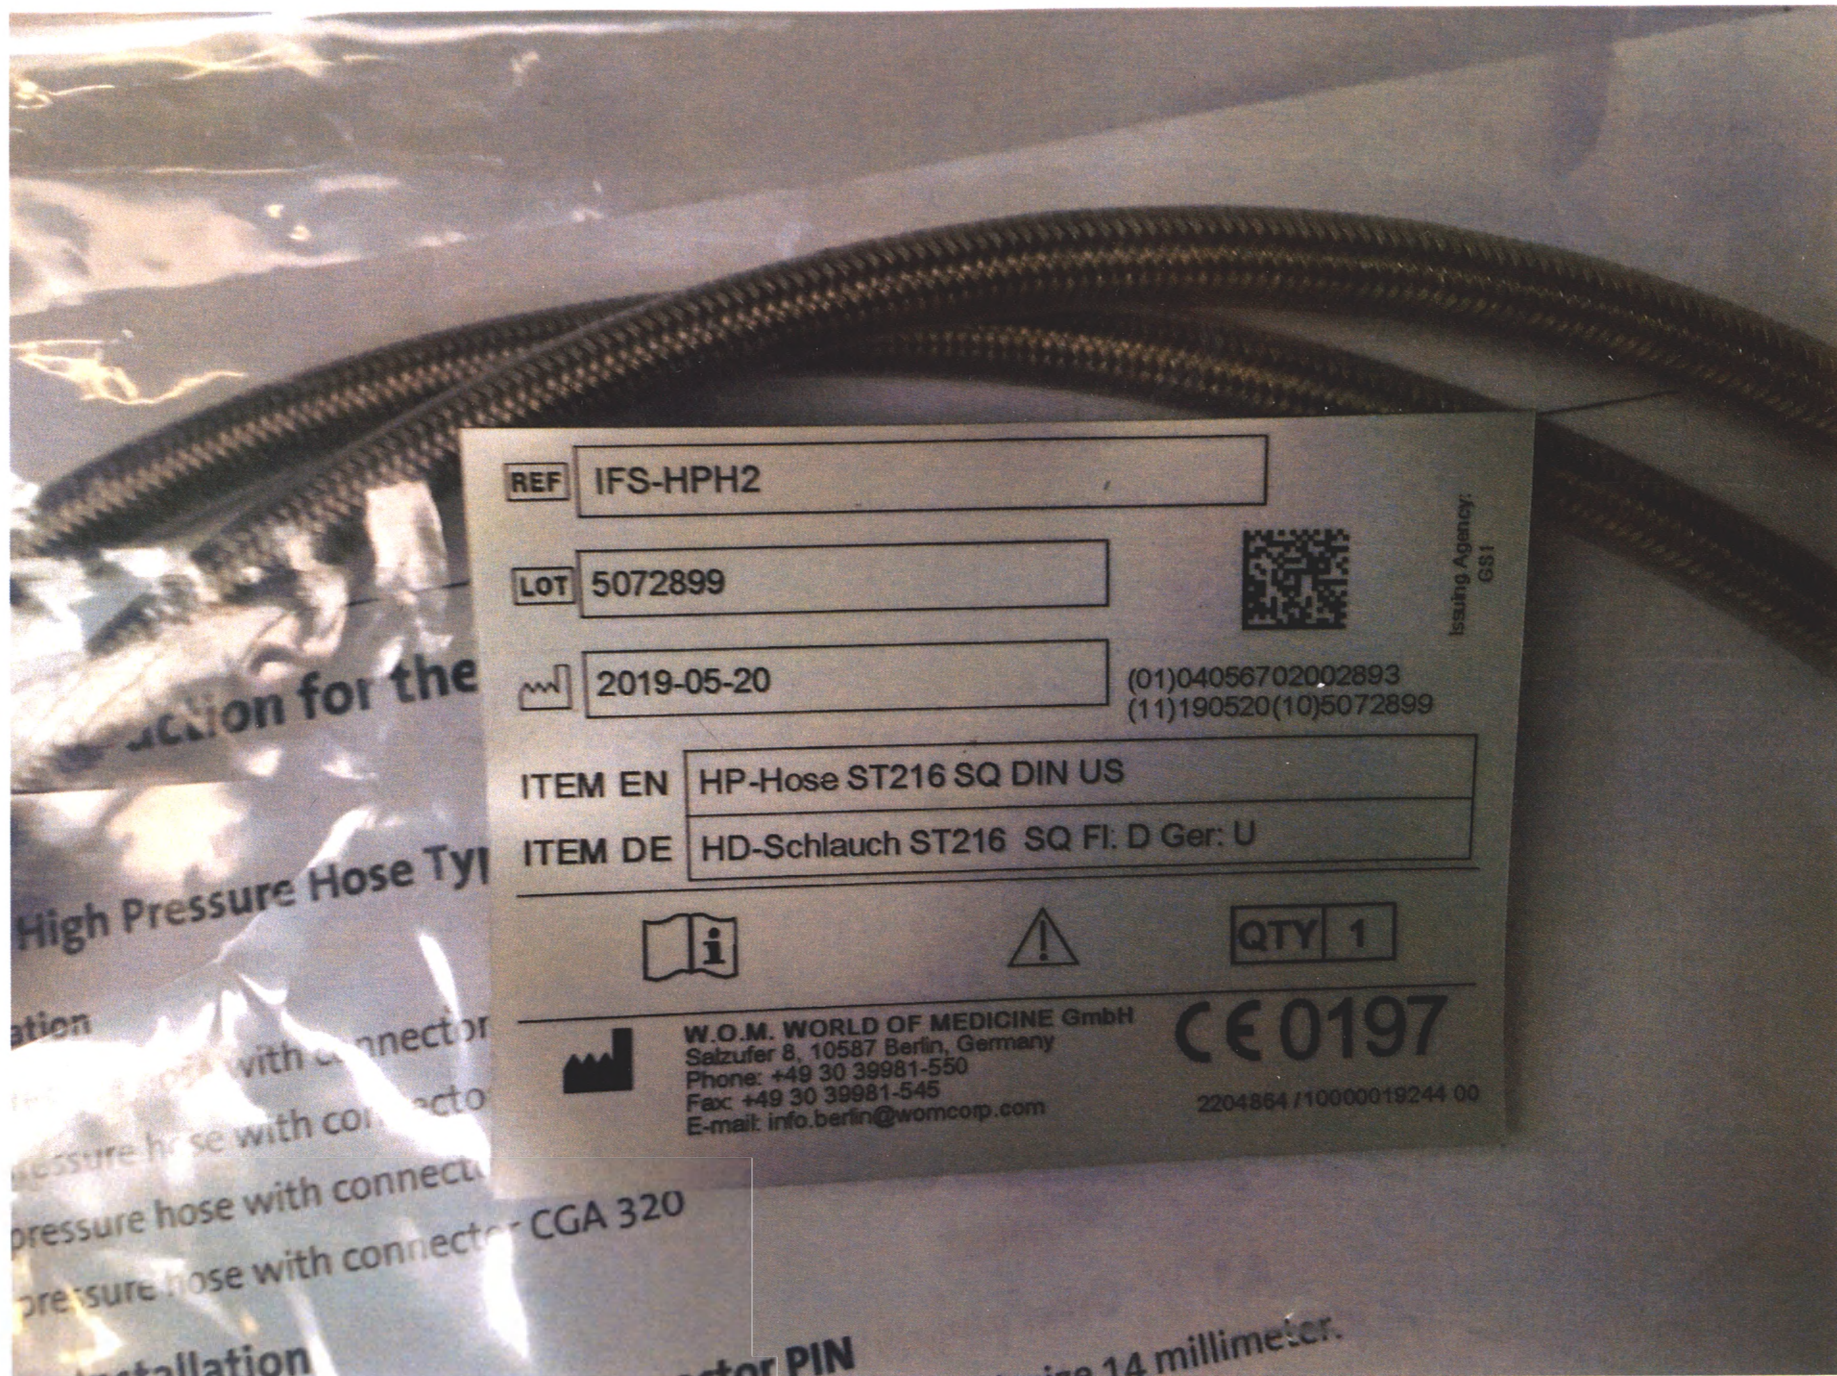

REF IFS-HPH2

LOT 5072899



Issuing Agency:
GS1

2019-05-20

(01)04056702002893
(11)190520(10)5072899

ITEM EN HP-Hose ST216 SQ DIN US

ITEM DE HD-Schlauch ST216 SQ FI: D Ger: U



QTY 1



W.O.M. WORLD OF MEDICINE GmbH
Salzufer 8, 10587 Berlin, Germany
Phone: +49 30 39981-550
Fax: +49 30 39981-545
E-mail: info.berlin@womcorp.com


CE 0197

2204864 / 10000019244 00

ector PIN


14 millimeter.

Шланг высокого давления в упаковке







Шланг низкого давления

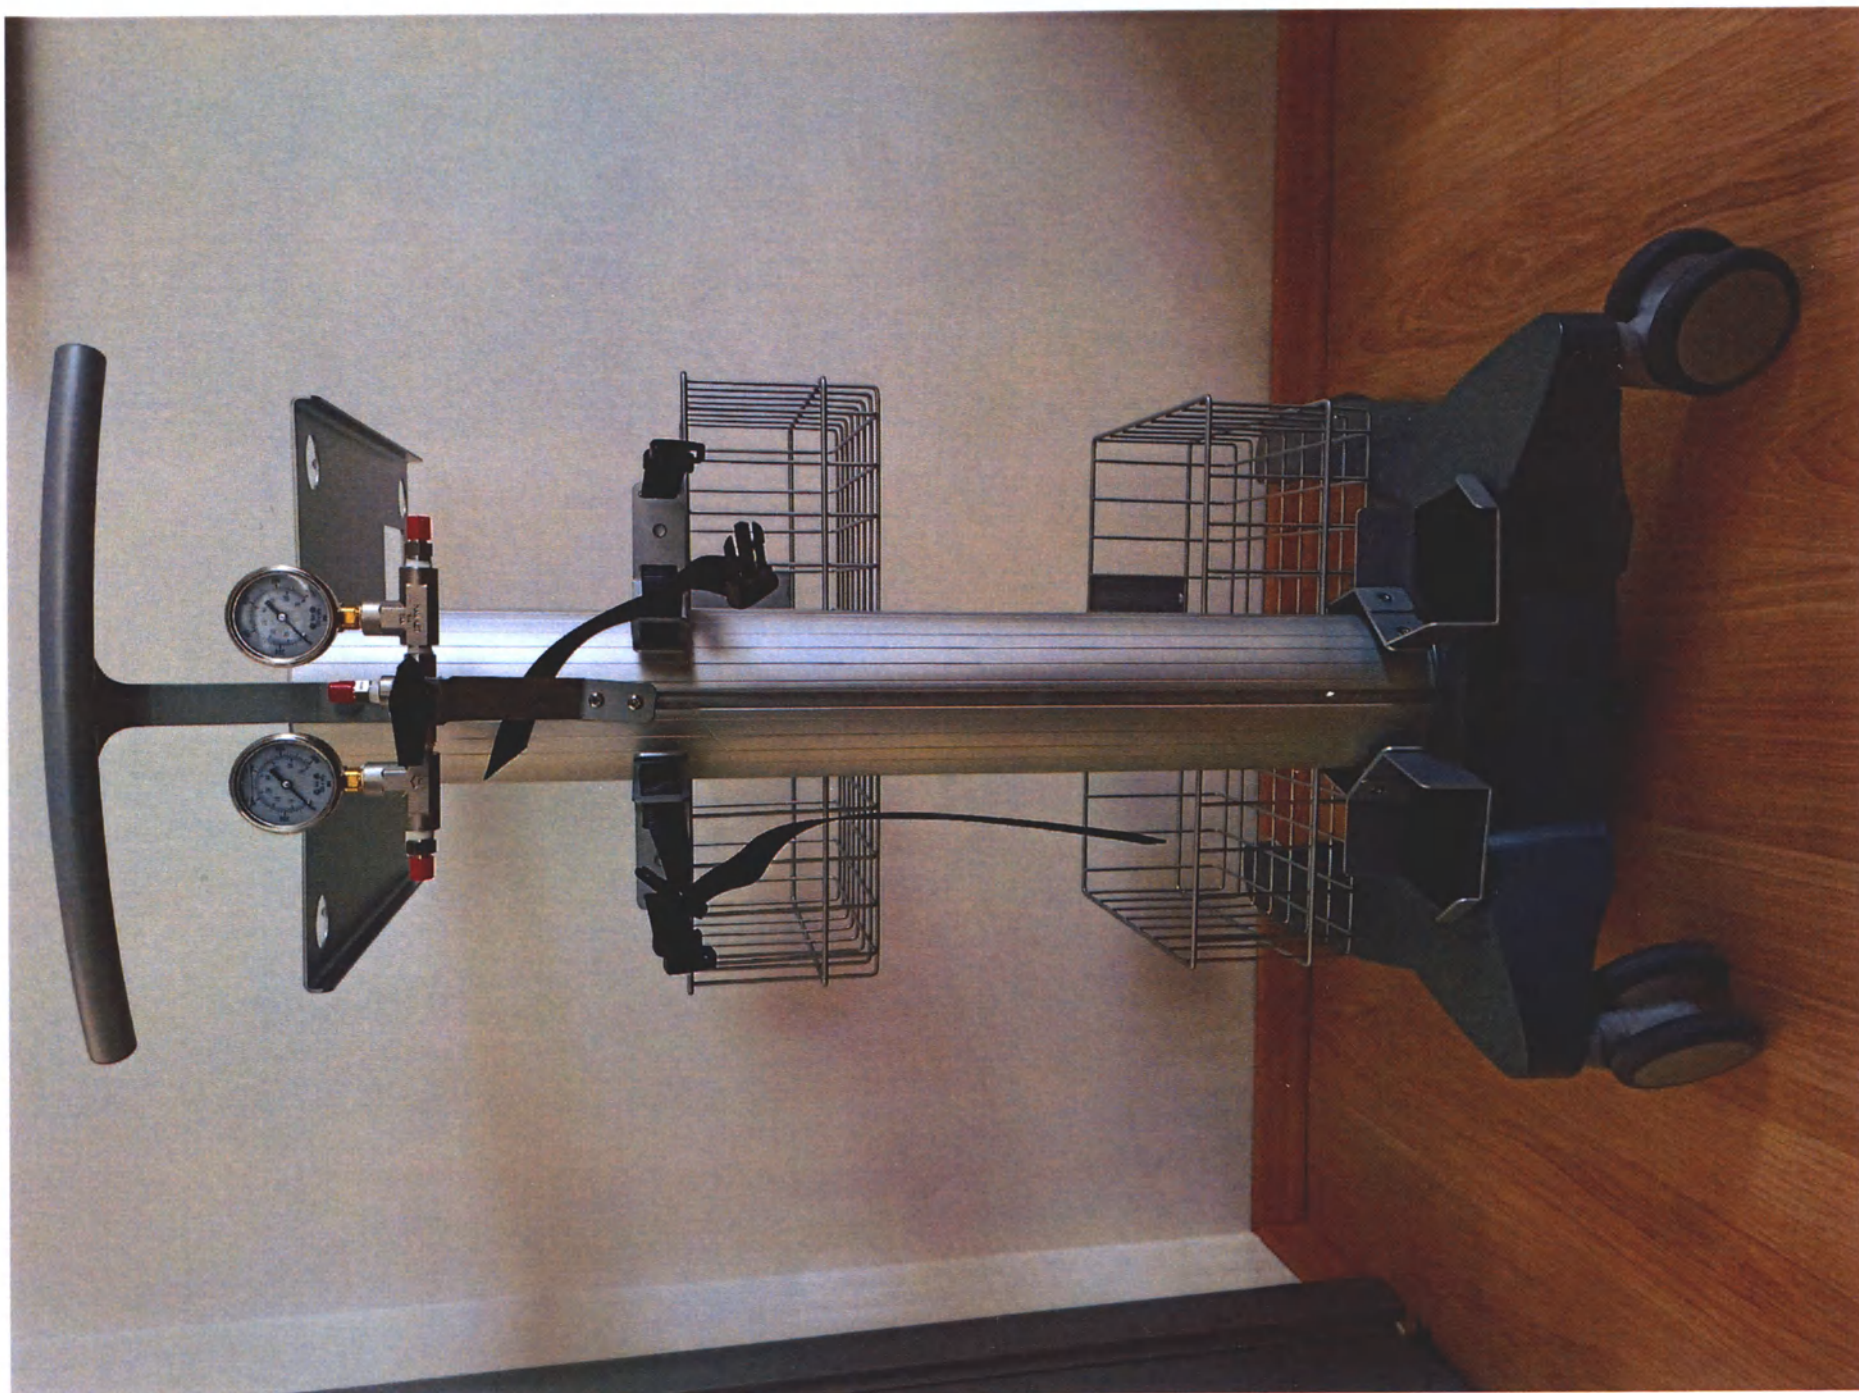


Тележка приборная

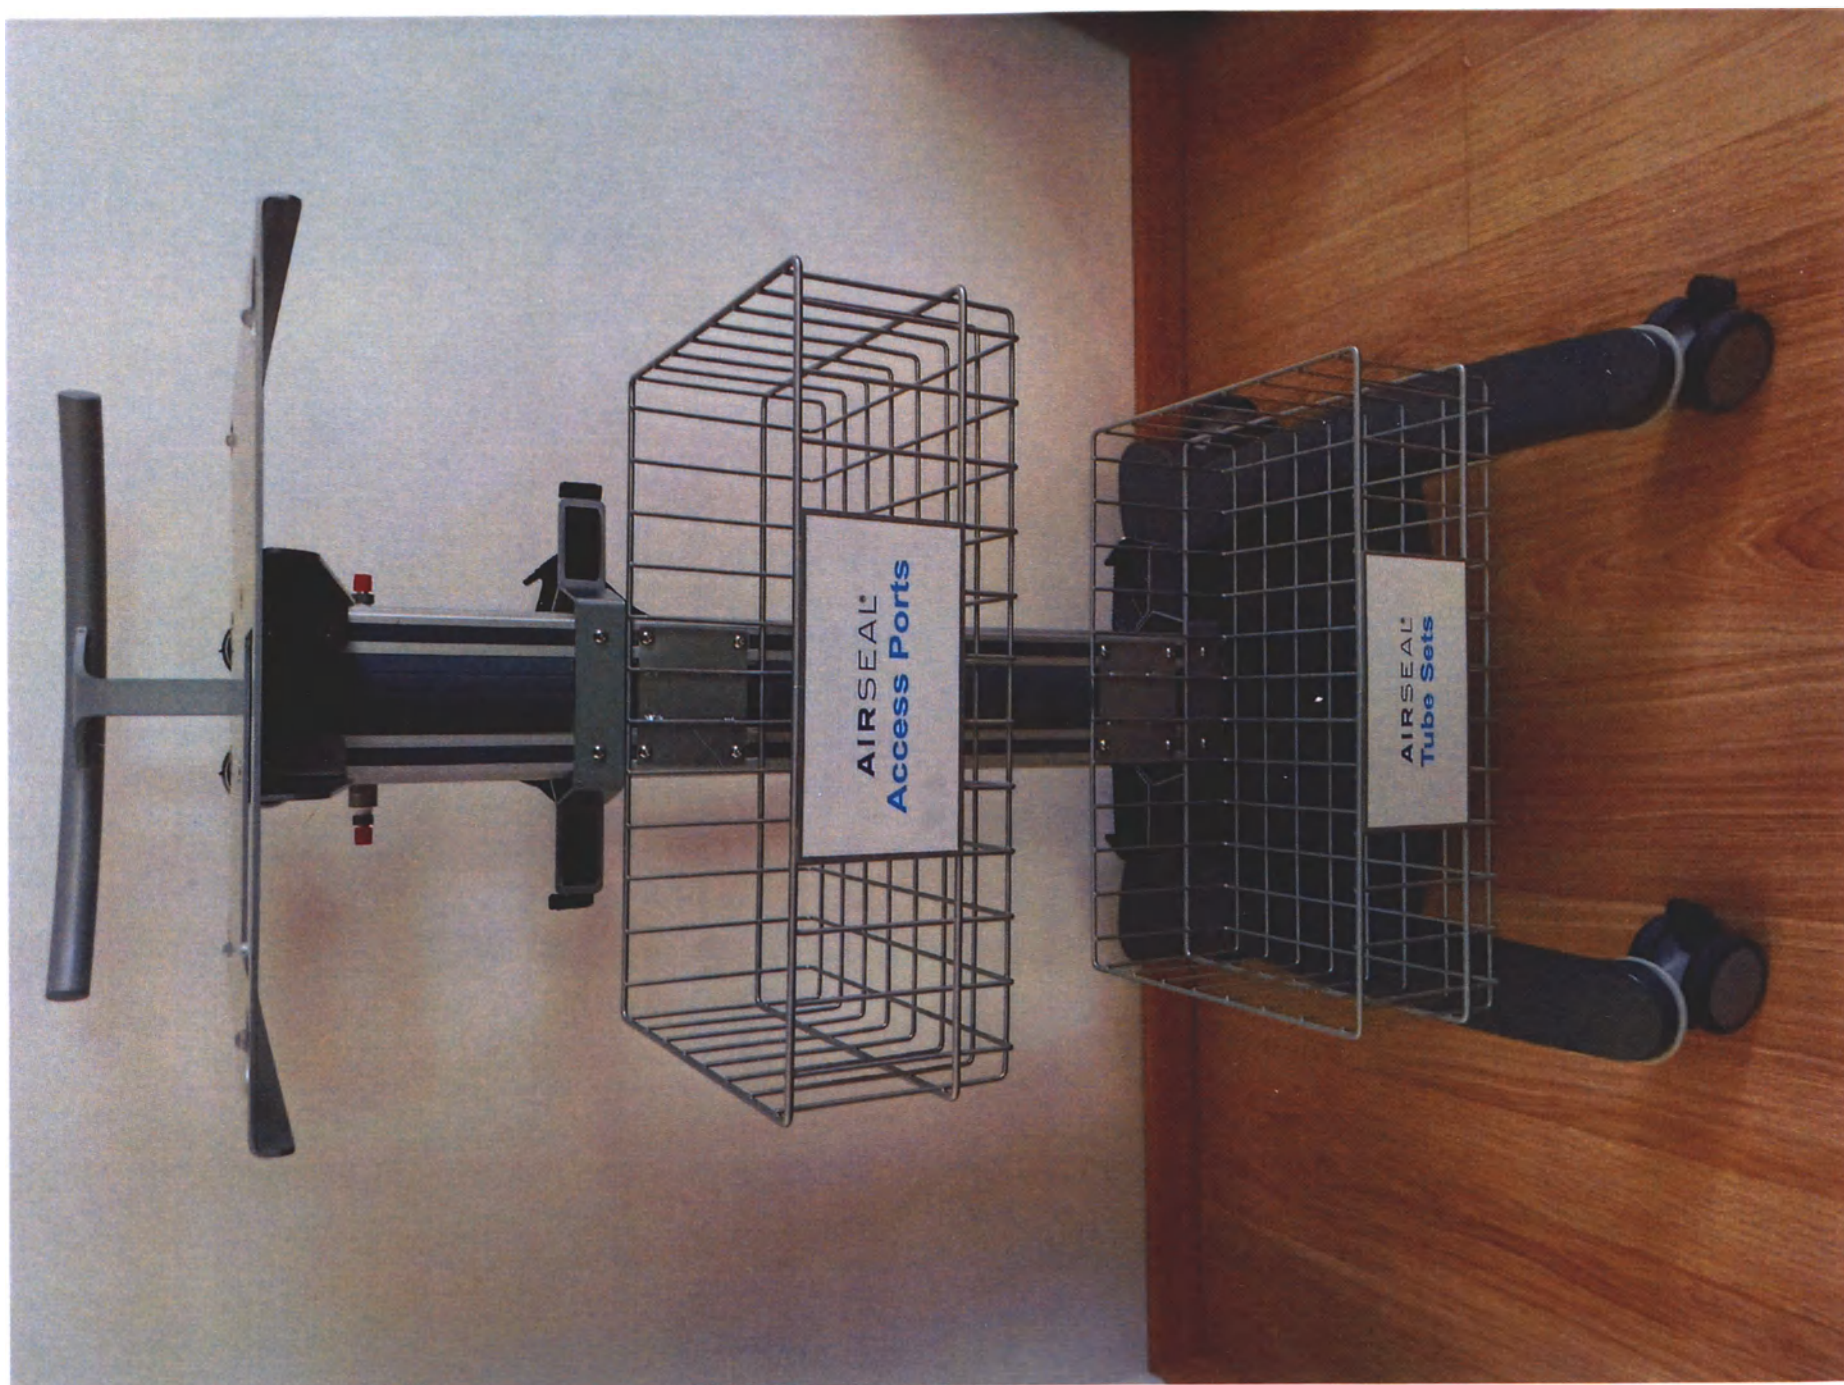

Тележка приборная

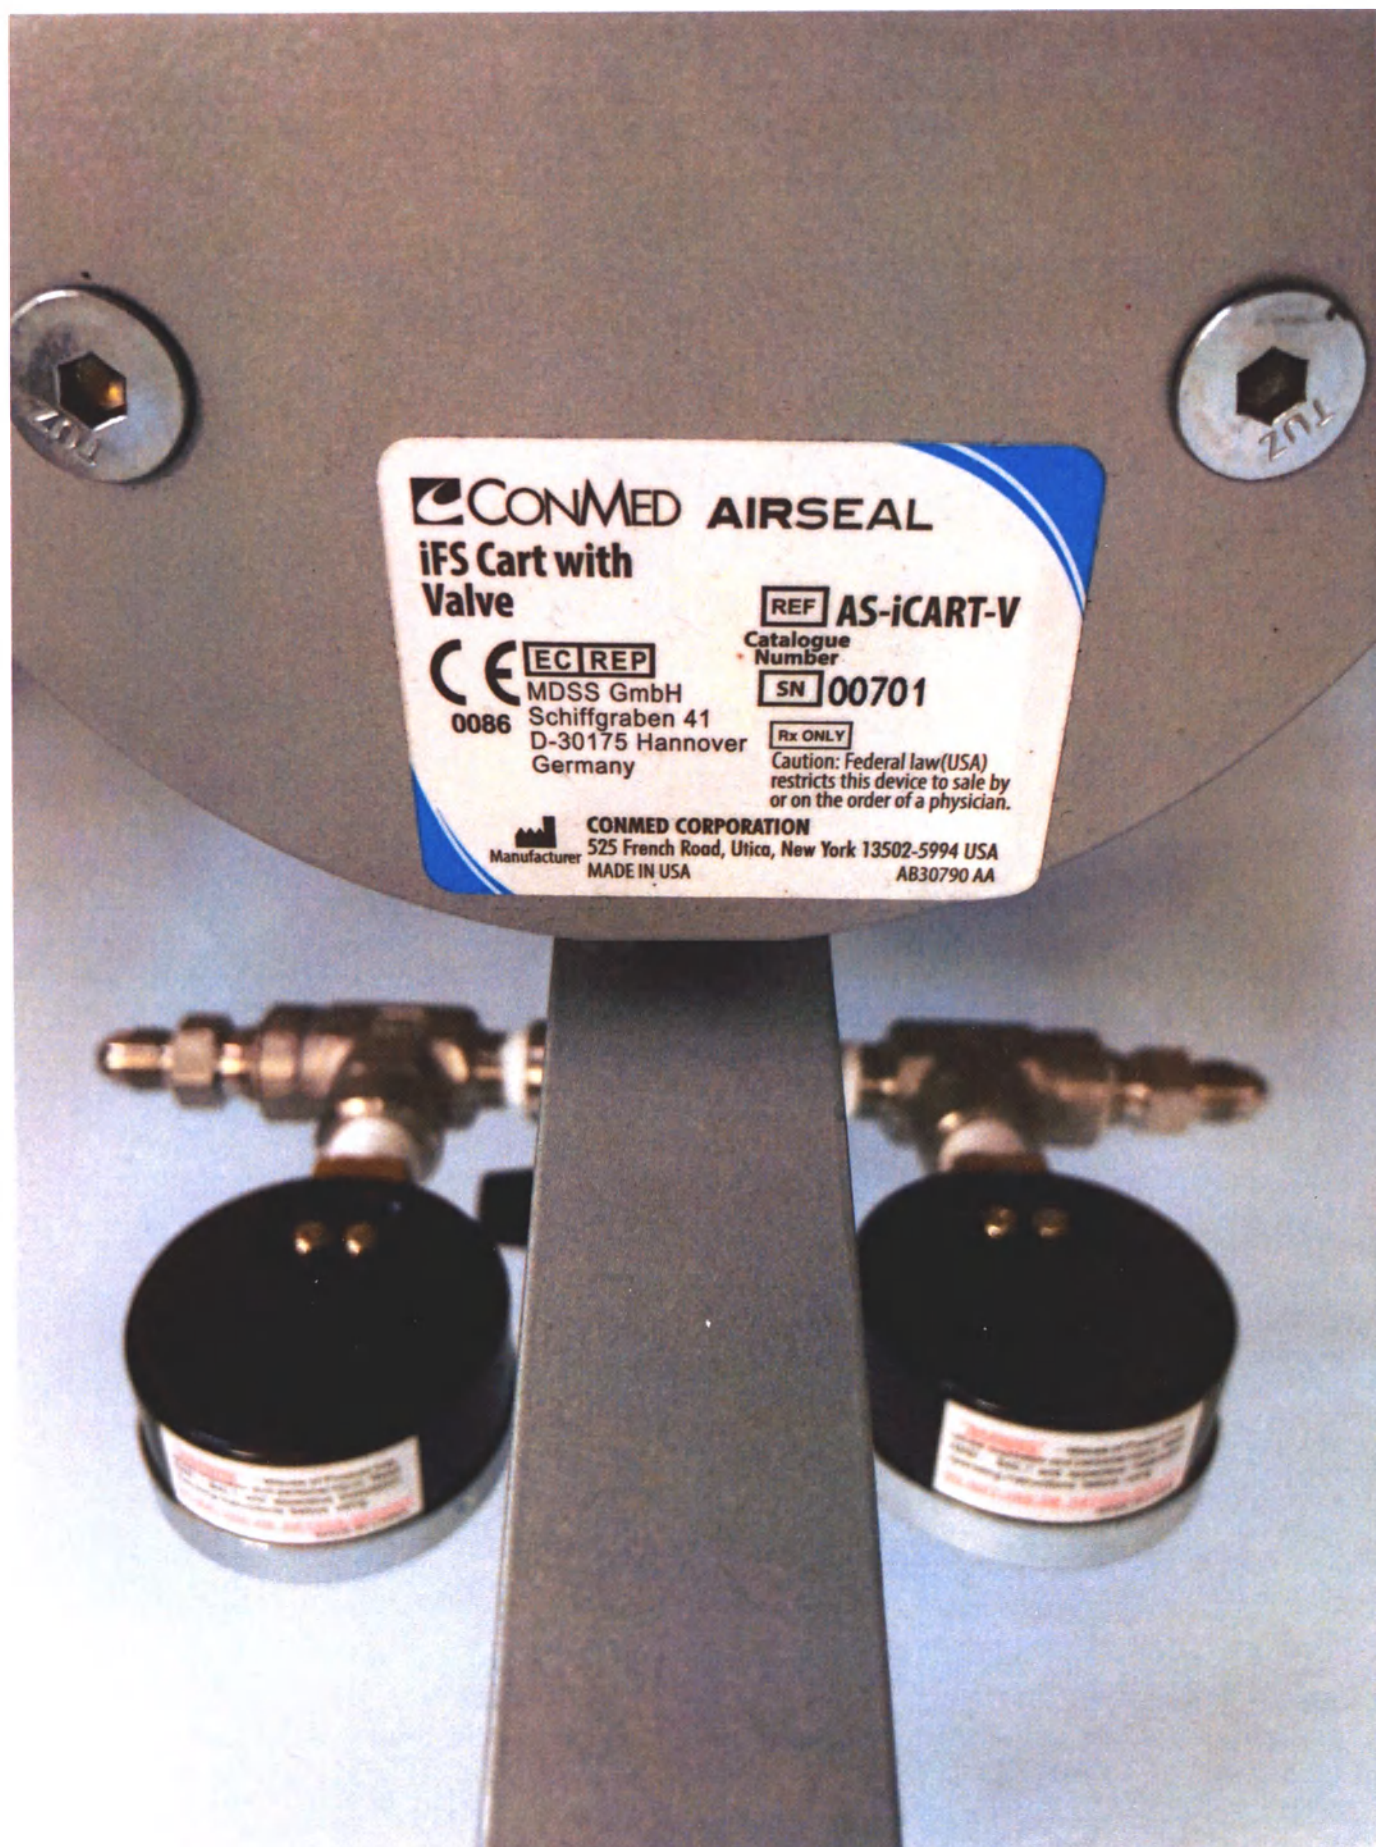



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Аппарат для инсуффляции AirSeal i.F.S. в составе с принадлежностями

Signature

Daniel S. Jonas, Esq.
Executive Vice President-Legal Affairs,
General Counsel & Secretary

[CONMED Seal]



Sworn to before me this 30th day of May, 2019.

Notary Public

TARI L. BUTTON
Notary Public, State of New York
Qualified in Madison and Oneida Counties
NO. 01BU5001694
My Commission Expires 9/14/2022

Проект маркировки для обращения на территории РФ

Наименование медицинского изделия:
Аппарат для инсуффляции AirSeal i.F.S.

Производитель:
«КонМедКорпорейшн»
ConMed Corporation
525 French Road, Utica, New York, 13502, USA

Уполномоченный представитель на территории РФ:
Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕР»
ООО «ИНТЕР»
141031, РФ, МО, Мытищинский р-н, ТПЗ «Алтуфьево», владение 7, строение 1.
Телефон: +7(495)229-38-86.

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

Прошито и пронумеровано 129/девайс0996
и скреплено печатью 129 листа/листов.
Генеральный директор ООО «Интер»
Пудовкин К.А.

(подпись) _____ М.П.
«___» _____ 20__ года

