
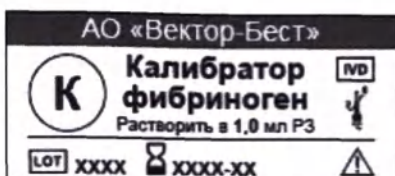
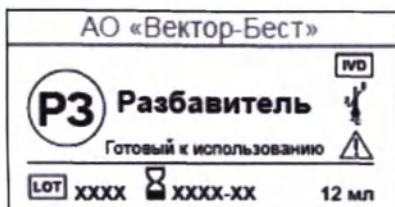
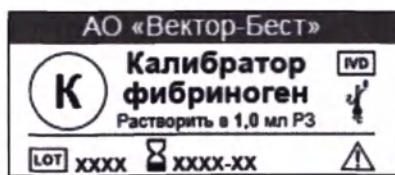


«УТВЕРЖДАЮ»
 Генеральный директор
 АО «Вектор-Бест»
 М.Д. Хусаинов
 18 2021 г.

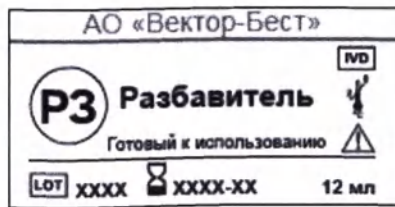

Образцы маркировки на Калибратор для определения концентрации фибриногена в плазме крови (Калибратор фибриноген)

1. Образцы этикеток на флаконы набора «Калибратор фибриноген»

Наименование компонента	Этикетка
«Калибратор фибриноген», вариант комплектации 1	
Калибратор	
Разбавитель	
«Калибратор фибриноген», вариант комплектации 2	
Калибратор	
Разбавитель	

2. Образцы этикеток на коробке набора «Калибратор фибриноген»

2.1. Верхняя этикетка.

Вариант комплектации 1	X-XXXX калибратор для определения концентрации фибриногена в плазме крови Калибратор фибриноген Состав: К (10 фл) РЗ (1×12 мл) ТУ 21.20.23-148-23548172-2021 РУ
Вариант комплектации 2	X-XXXX калибратор для определения концентрации фибриногена в плазме крови Калибратор фибриноген Состав: К (5 фл) РЗ (1×12 мл) ТУ 21.20.23-148-23548172-2021 РУ

2.2. Боковая этикетка.

Вариант комплектации 1	X-XXXX 2 2021-02 2023-02 Калибратор фибриноген Для профилактического применения Антидоты к БНП 1,2 и сыворотка антител С к FIB(А) агглютинации
-------------------------------	---

Вариант комплектации 2



Примечание. Непосредственно на коробку типографским способом наносятся следующие надписи:

1. АО «Вектор-Бест»
2. Россия, 630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, Научно-производственная зона, корпус 36, комната 211, тел/факс.: (383) 332-67-49, 332-67-52
E-mail: vbmarket@vector-best.ru

«СОГЛАСОВАНО»

Директор по производству
АО «Вектор-Бест»

В.К. Ткачев

« 02 » 08 2021 г.

Всего прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 3 листов.

Директор по технологии и качеству
АО "Вектор-Бест"



Масяго А.В.
2024 г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»



М.Д. Хусаинов
2022 г.

Образцы маркировки на Калибратор для определения концентрации фибриногена в плазме крови (Калибратор фибриноген)

1. Образцы этикеток на флаконы набора «Калибратор фибриноген»

Наименование компонента	Этикетка
«Калибратор фибриноген», вариант комплектации 1	
Калибратор	
Разбавитель	
«Калибратор фибриноген», вариант комплектации 2	
Калибратор	
Разбавитель	

2. Образцы этикеток на коробке набора «Калибратор фибриноген»

2.1. Верхняя этикетка.

Вариант комплектации 1	 X-XXXX калибратор для определения концентрации фибриногена в плазме крови Калибратор фибриноген Состав: К (10 фл) РЗ (1×12 мл) ТУ 21.20.23-148-23548172-2021 РУ
Вариант комплектации 2	 X-XXXX калибратор для определения концентрации фибриногена в плазме крови Калибратор фибриноген Состав: К (5 фл) РЗ (1×12 мл) ТУ 21.20.23-148-23548172-2021 РУ

2.2. Боковая этикетка.

Вариант комплектации 1	 X-XXXX  XXXX  XXXX-XX  XXXX-XX Калибратор фибриноген     Для профессионального применения Анализаторы с ИФА 1,2 и оптическим считывателем С и ИФА-4г оборудованы
-------------------------------	--

Вариант комплектации 2



Примечание. Непосредственно на коробку типографским способом наносятся следующие надписи:

АО «Вектор-Бест»
Россия, 630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово,
Научно-производственная зона, корпус 36, комната 211,
тел./факс: (383) 332-67-49, 332-67-52

AO Vector-Best
Koltsovo, Novosibirsk Region, 630559, Russia,
Research and Production Area, housing 36, room 211,
tel./fax: (383) 332-67-49, 332-67-52

«Вектор-Бест» АҚ
630559, Ресей, Новосибирск облысы, Кольцово ж.к.
Ғылыми-өндірістік аймақ, 36 корпус, 211 бөлме
тел./факс: (383) 332-67-49, 332-67-52

E-mail: vbmarket@vector-best.ru
www.vector-best.ru

«СОГЛАСОВАНО»

Директор по производству
АО «Вектор-Бест»


В.К. Ткачев
«21» февраля 2022 г.

Всего прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 3 листов.
Директор по технологии и качеству
АО "Вектор-Бест"

"____" _____ 2022 г. Масяго А.В.



Хусаинов М.Д.
« 03 » 03 2021 г.

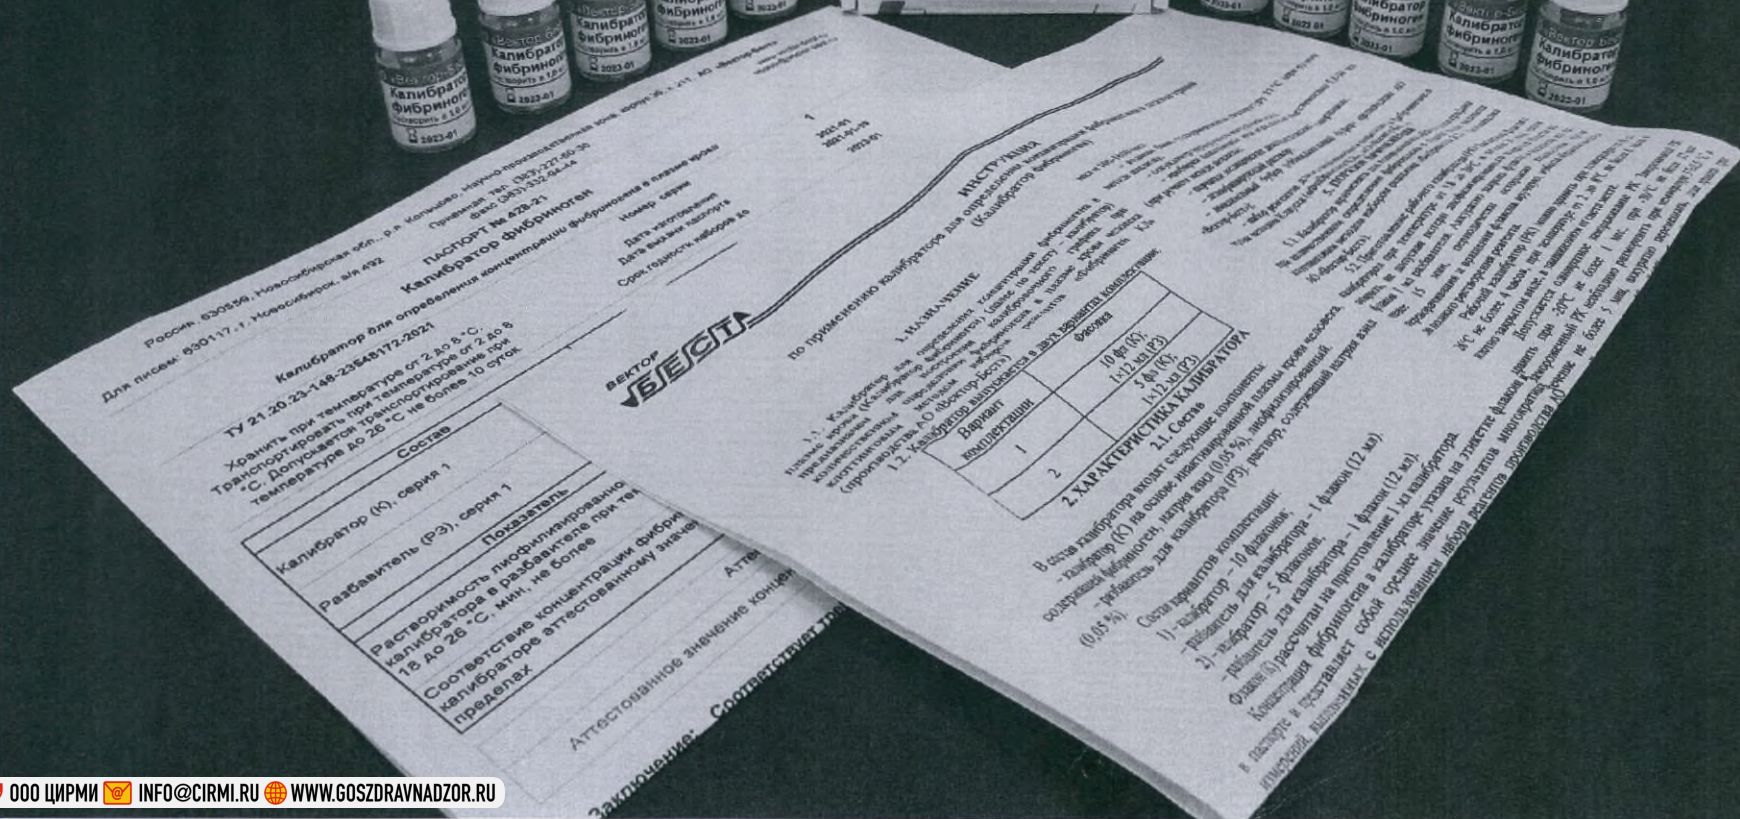


Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия
«Калибратор для определения концентрации фибриногена в плазме крови
(Калибратор фибриноген)» № 1 (вариант 1, серия 1)

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»

Хусаинов М.Д.


« 09 » 03 2021 г.

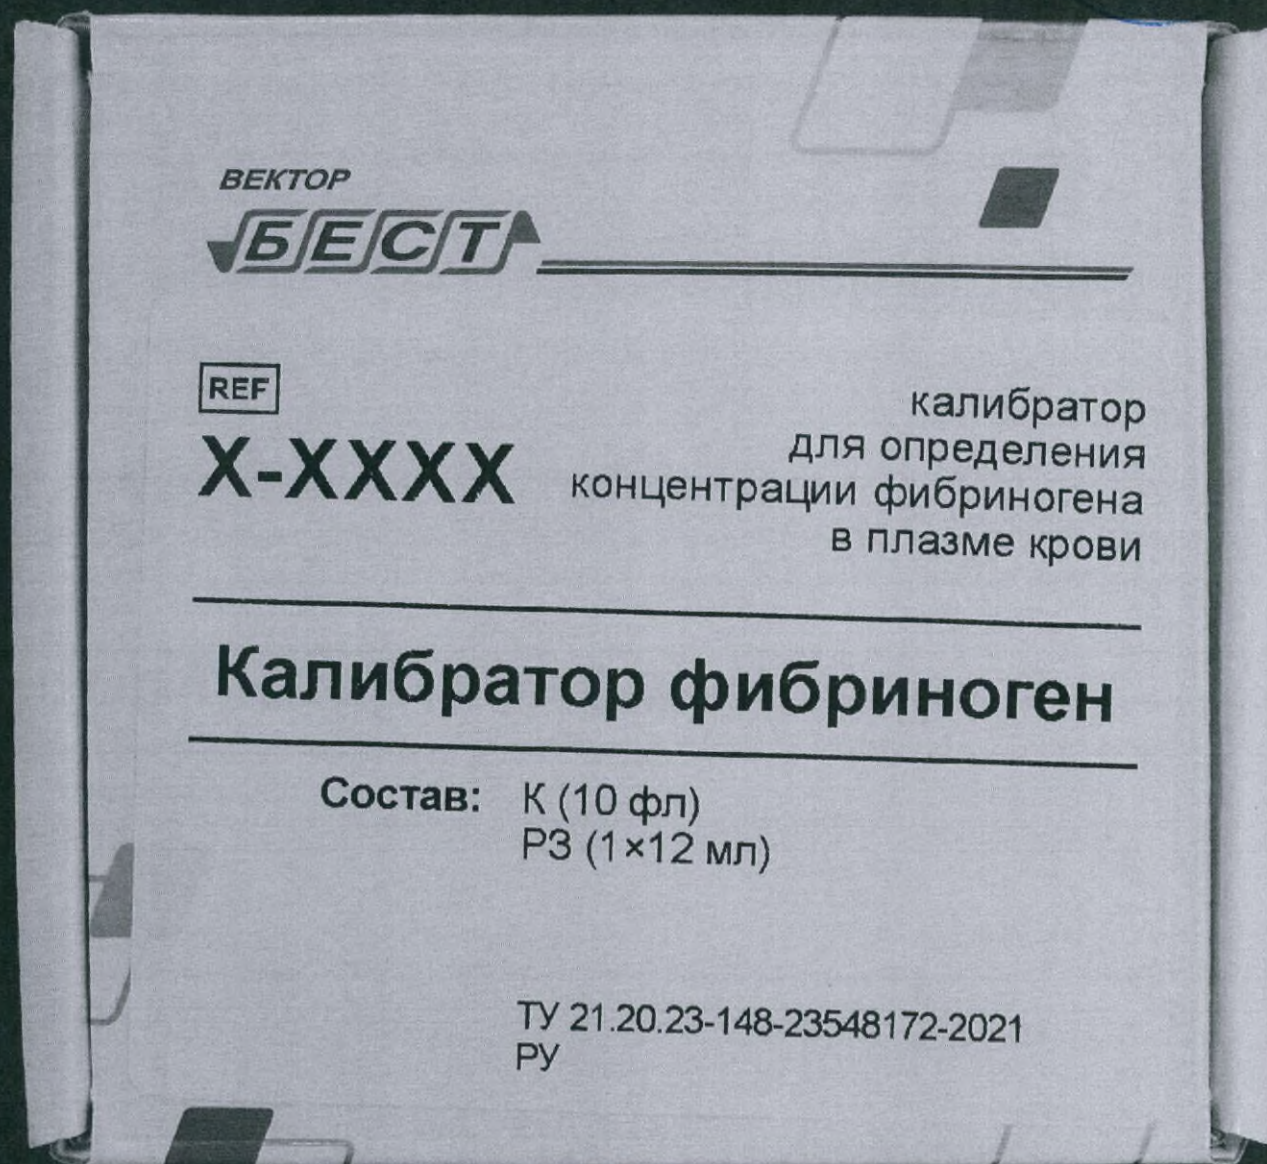

Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия
«Калибратор для определения концентрации фибриногена в плазме крови
(Калибратор фибриноген)» № 2 (вариант 1, серия 1)

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»

Хусаинов М.Д.
«04» 03 2021 г.



REF

X-XXXX

LOT

1




2021-01



2023-01

Калибратор фибриноген



XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX


IVD



Для профессионального применения
Антитела к ВИЧ 1,2 и вирусу гепатита С
и HBsAg отсутствуют

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
«Калибратор для определения концентрации фибриногена в плазме крови
(Калибратор фибриноген)» № 1 (вариант 1, серия 1)

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест» Хусаинов М.Д.
«09» 103 2021 г.

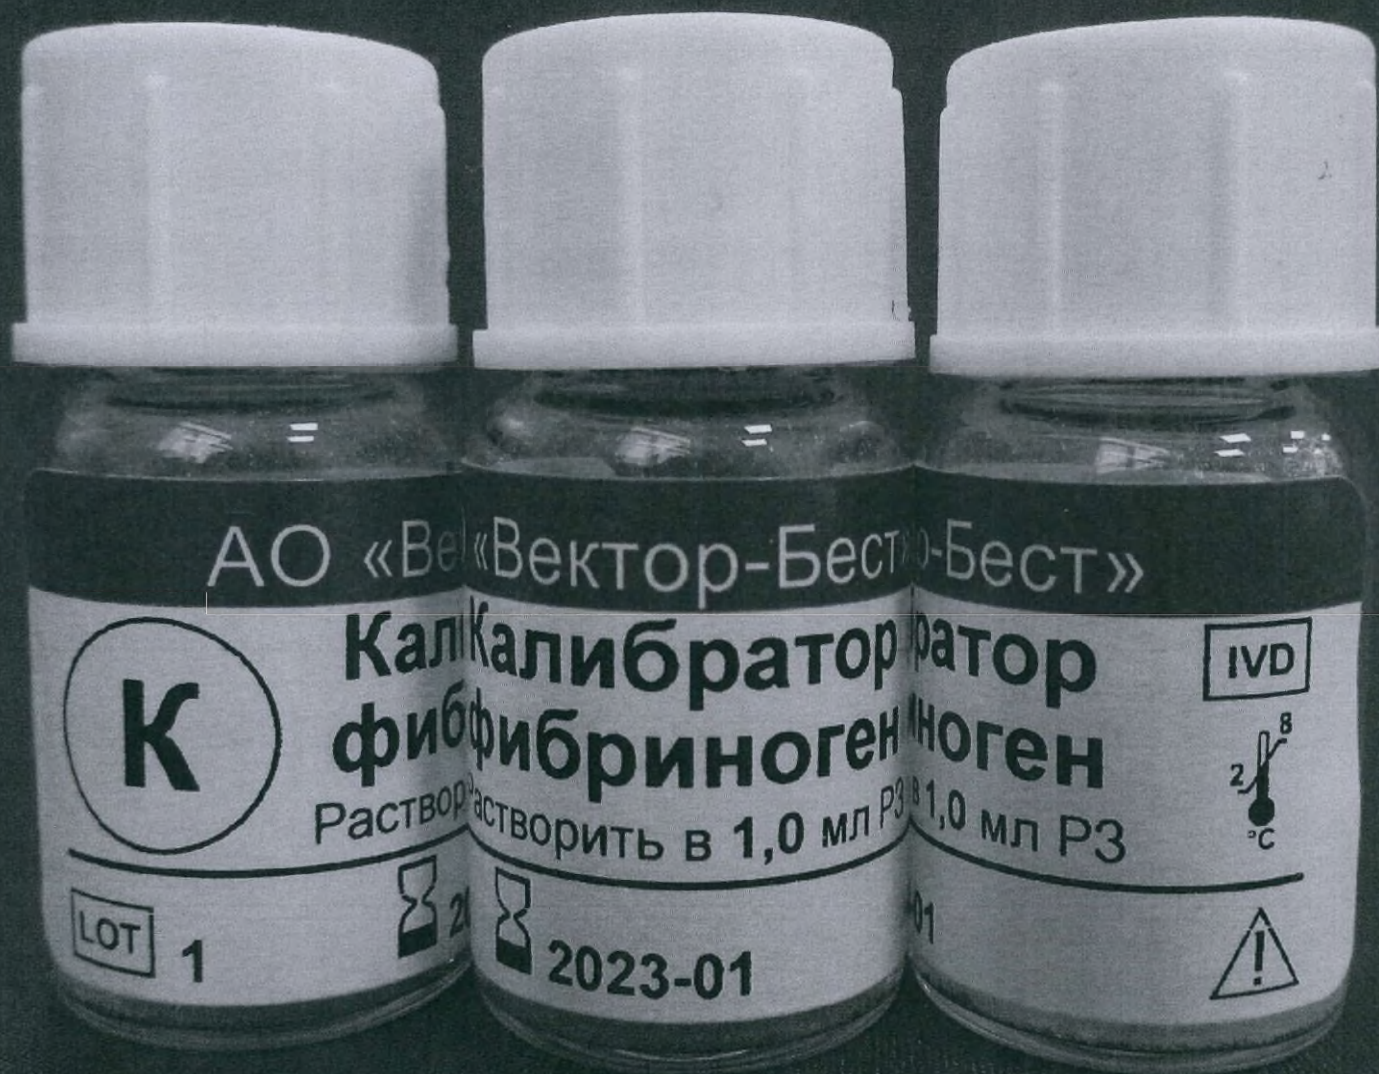


Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
«Калибратор для определения концентрации фибриногена в плазме крови
(Калибратор фибриноген)» № 2 (вариант 1, серия 1)

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест» Хусаинов М.Д.





«09» 03 2021 г.

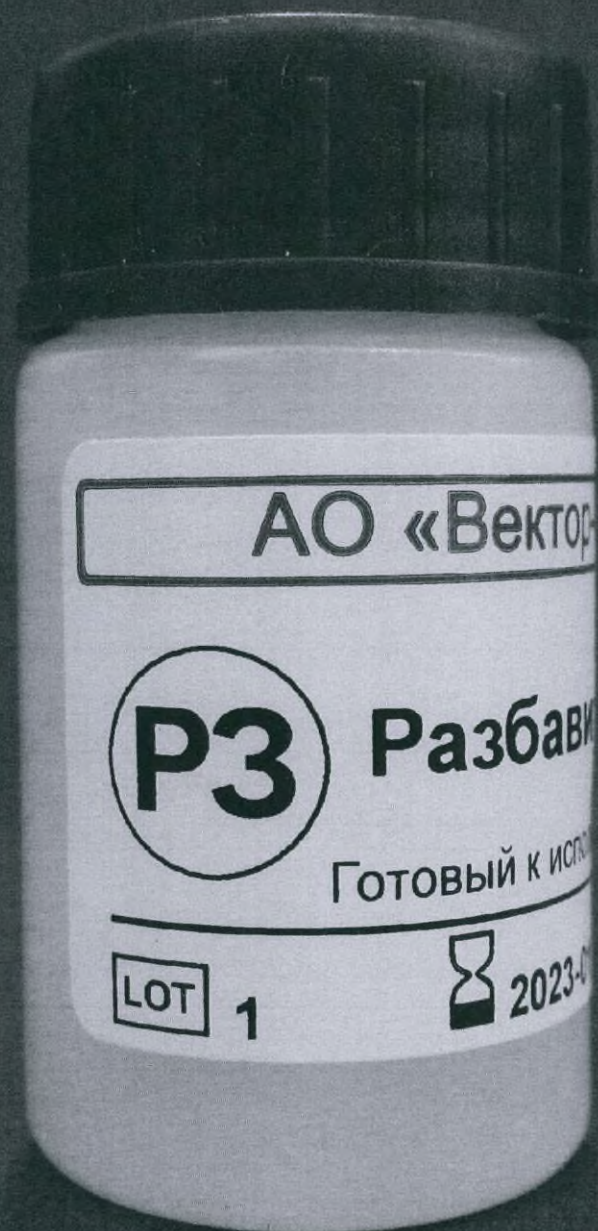


Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
«Калибратор для определения концентрации фибриногена в плазме крови
(Калибратор фибриноген)» № 3 (вариант 1, серия 1)

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест» Хусаинов М.Д.
«09» 03 2021 г.

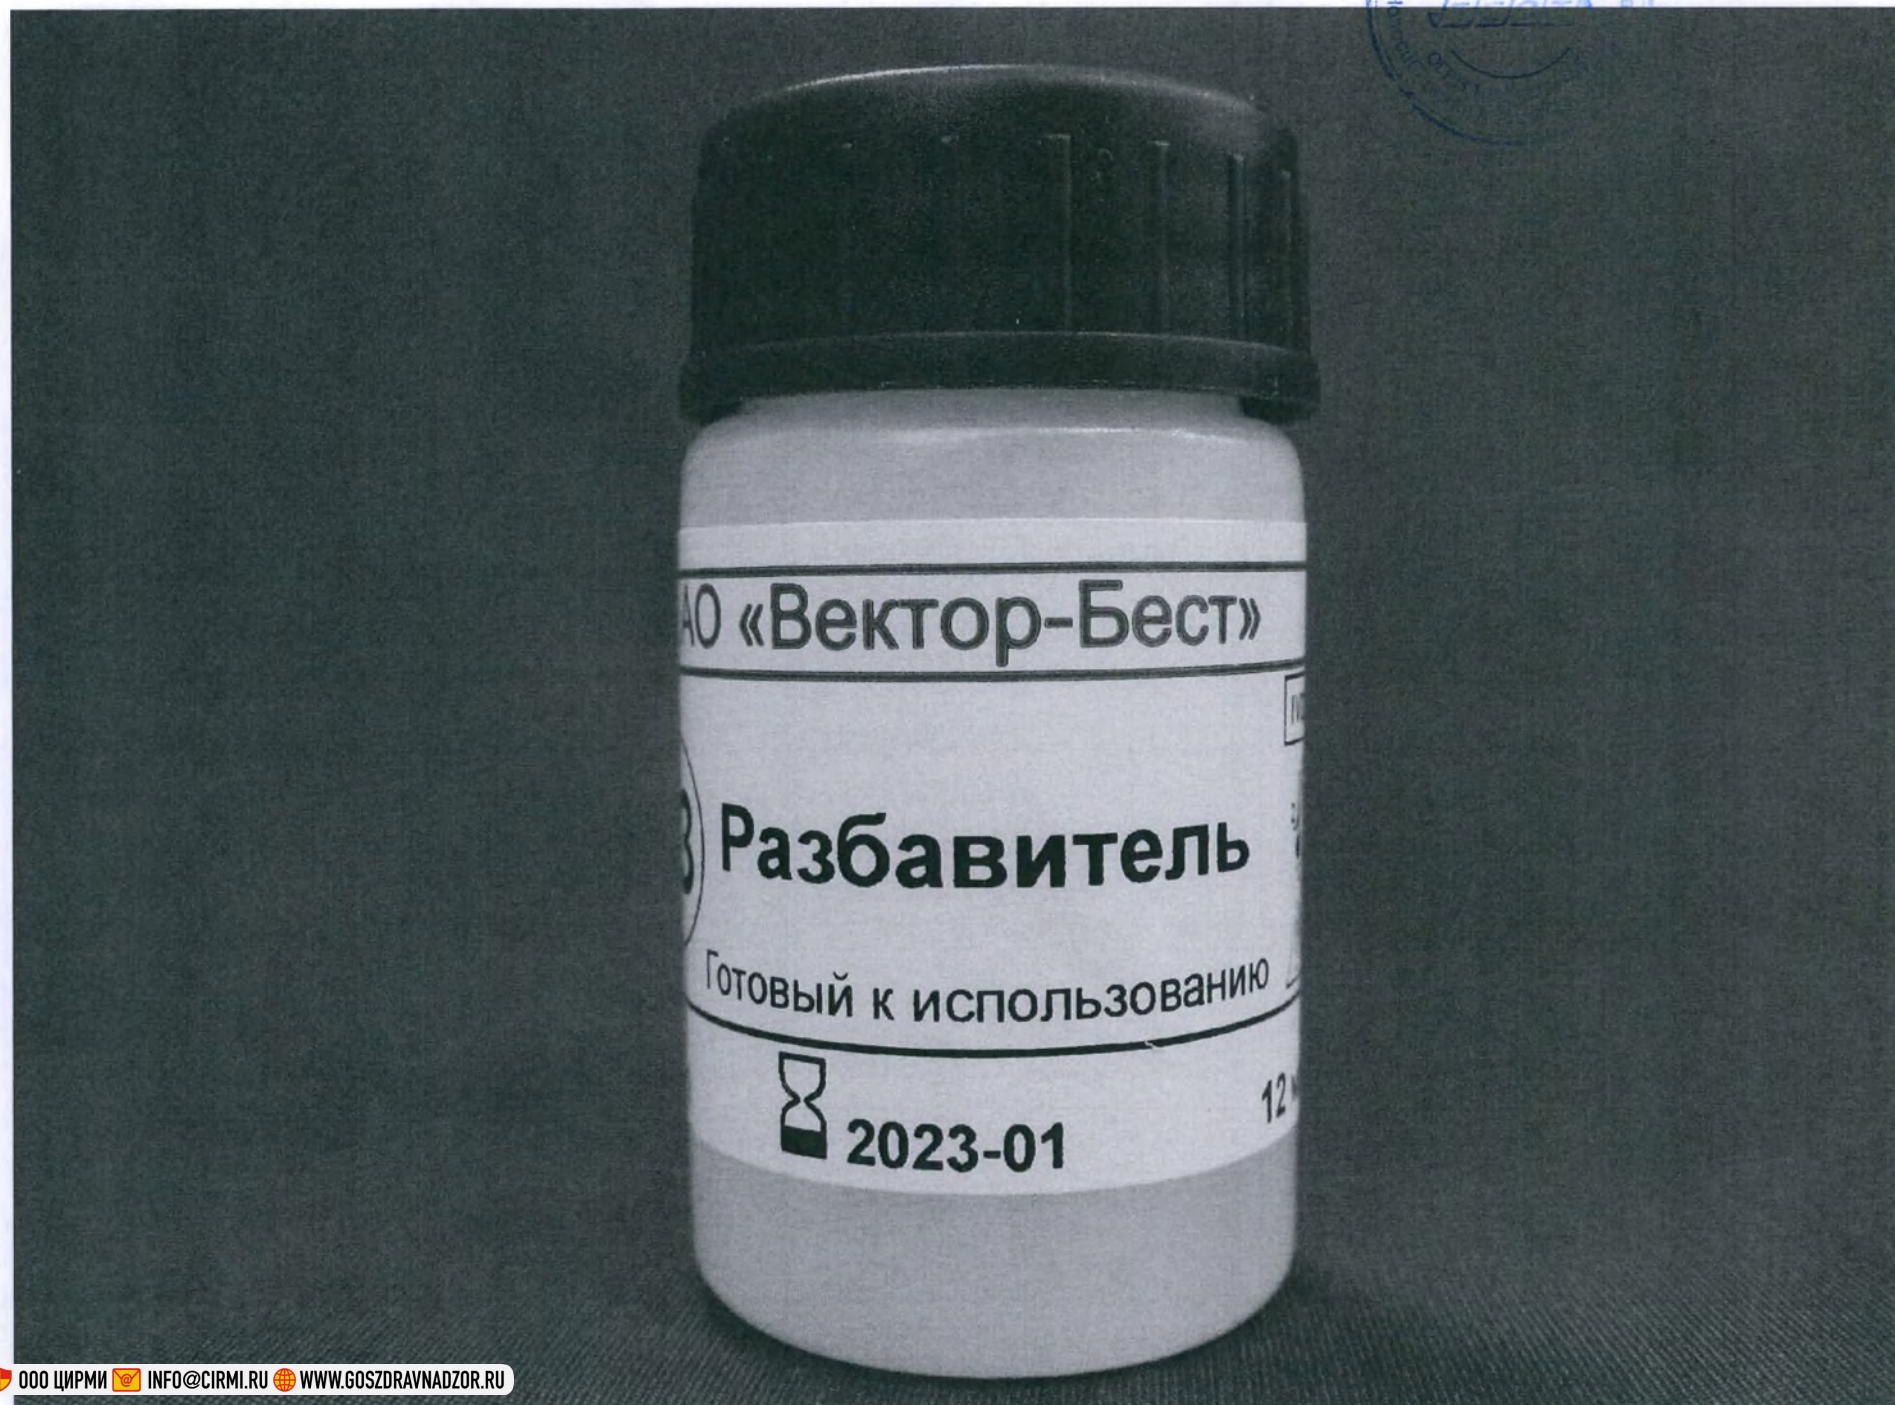

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
«Калибратор для определения концентрации фибриногена в плазме крови
(Калибратор фибриноген)» № 4 (вариант 1, серия 1)

Генеральный директор Хусаинов М.Д.
АО «Вектор-Бест» «09» / 03 2021 г.

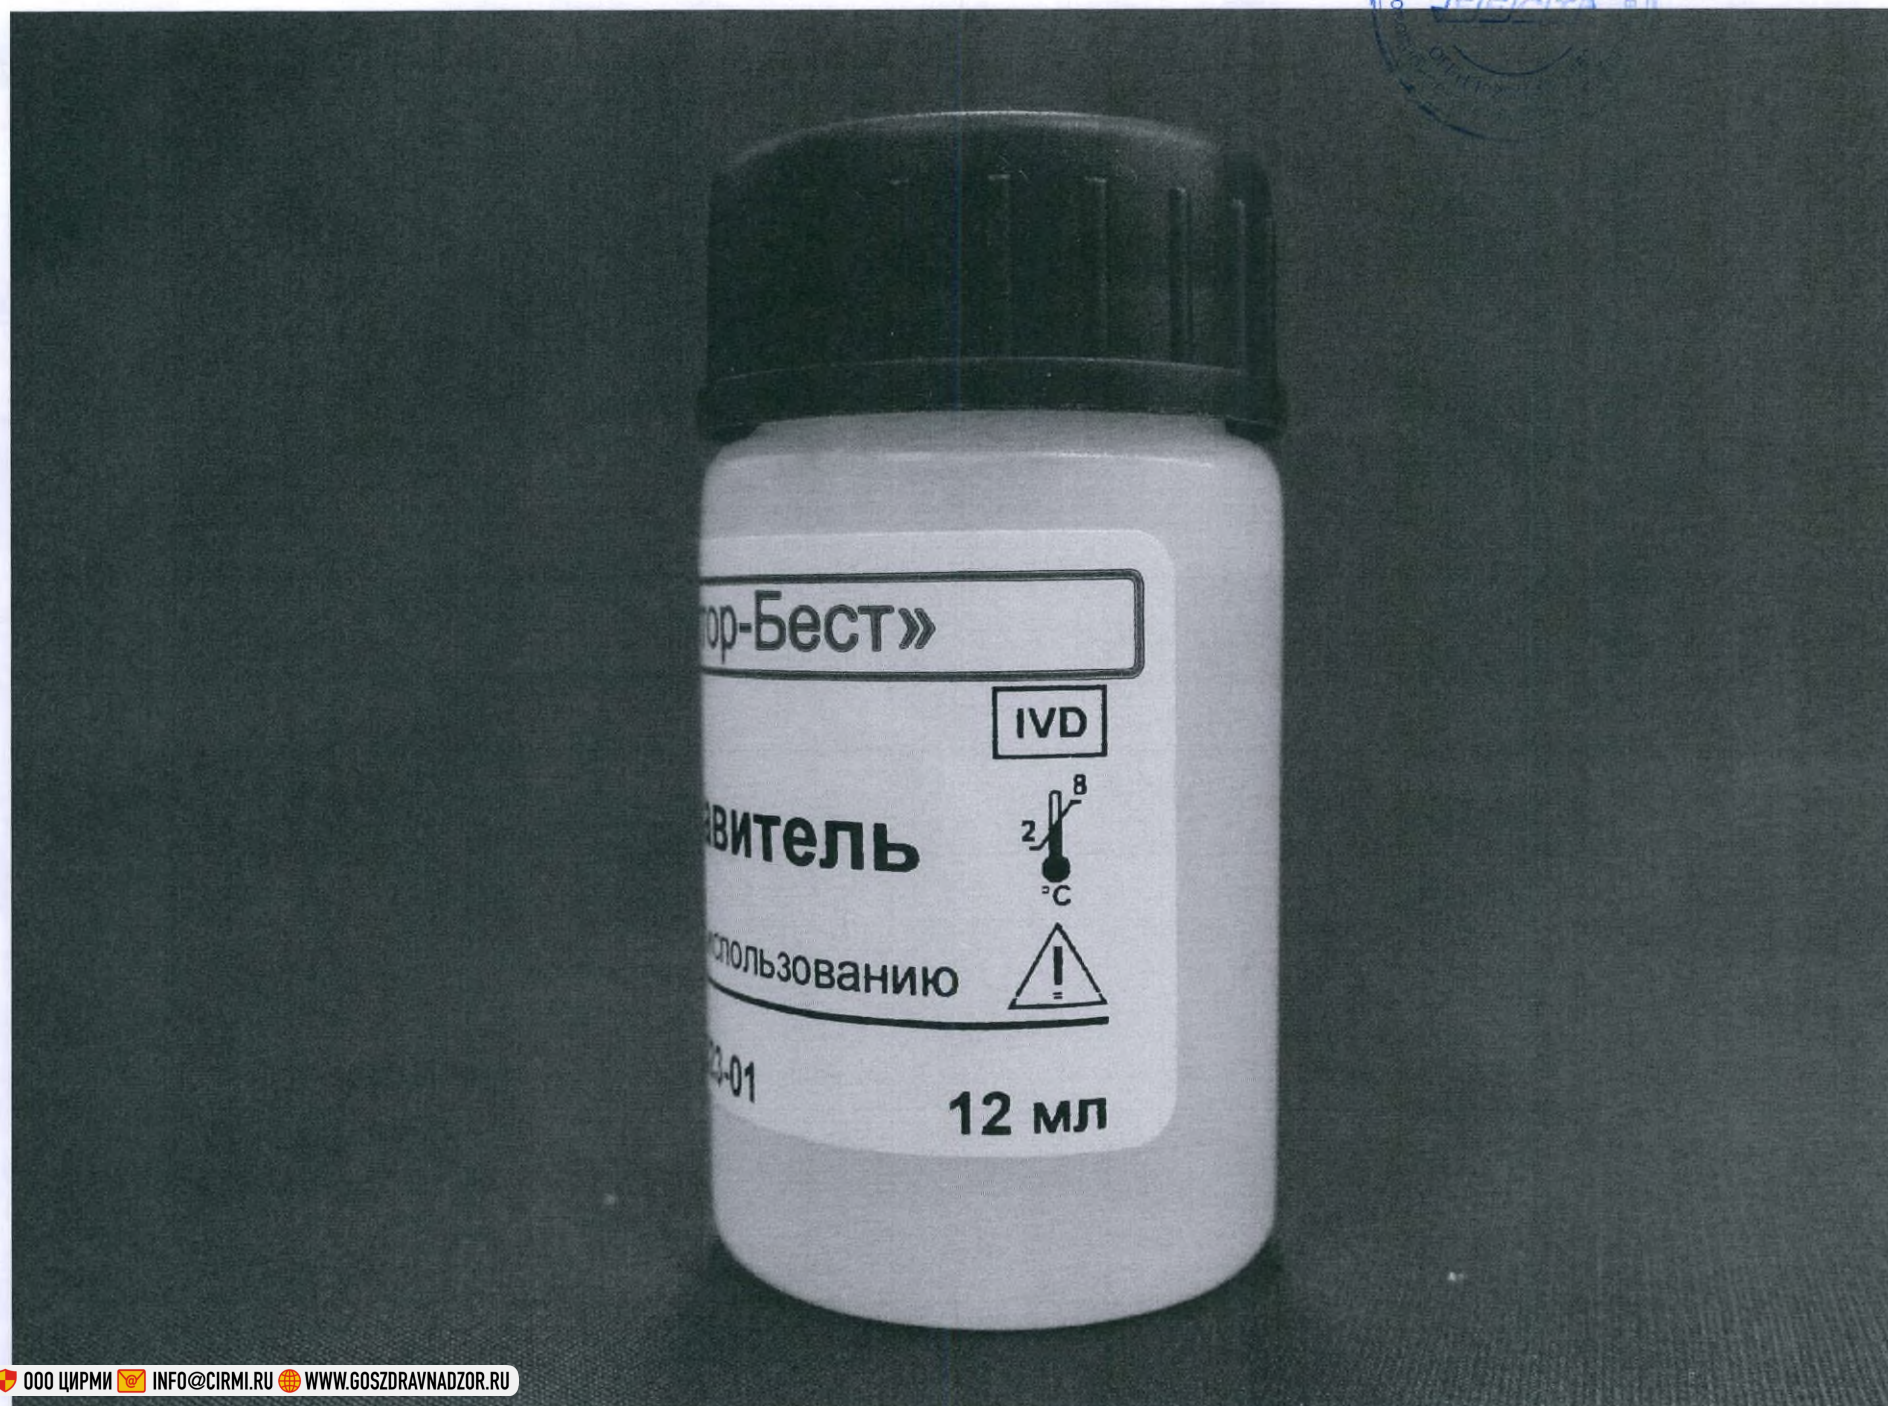

Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия
«Калибратор для определения концентрации фибриногена в плазме крови
(Калибратор фибриноген)» (вариант 1, серия 2)

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»

Хусаинов М.Д.

«08»

08

2021 г.



Российская Федерация, Новосибирская обл., г. Новосибирск, мкр. 492
Для письма: 630117, г. Новосибирск, мкр. 492

Получатель: АО «Вектор-Бест», г. Новосибирск, мкр. 492
Паспорт № 452-21

Калибратор для определения концентрации фибриногена в плазме крови
Калибратор фибриноген

Комп. серия
Дата изготовления
Дата выдачи паспорта

ТУ 21.20.23-148-23048172-2021

Хранить при температуре от 2 до 8 °С.
Транспортировать при температуре от 2 до 8 °С.
Допускается транспортирование при температуре до -20 °С.

Калибратор (К), серия
Разбавитель (РЗ), серия
Растворимость порошка калибратора в разбавителе, мин. на 1 флакон
Соответствие концентрации калибратора аттестованным пределам

Аттестованное значение
Законченное: 2021.08.08

ТУ 21.20.23-148-23048172-2021

ИНСТРУКЦИЯ
по применению калибратора для определения концентрации фибриногена в плазме крови
(Калибратор фибриноген)

1. НАЗНАЧЕНИЕ
1.1. Калибратор для определения концентрации фибриногена в плазме крови (Калибратор фибриноген) (далее по тексту – калибратор) предназначен для использования в комплекте с тест-системой «Вектор-Бест» для определения концентрации фибриногена в плазме крови.

1.2. Калибратор выпускается в двух вариантах:
Вариант 1 – калибратор для определения концентрации фибриногена в плазме крови (Калибратор фибриноген) (далее по тексту – калибратор 1).
Вариант 2 – калибратор для определения концентрации фибриногена в плазме крови (Калибратор фибриноген) (далее по тексту – калибратор 2).

2. ХАРАКТЕРИСТИКА КАЛИБРАТОРА
2.1. Состав
В состав калибратора входят следующие компоненты:
– калибратор (К) на основе мультифракционной плазмы крови человека с добавлением фибриногена (0,05%), лиофилизированный;
– разбавитель для калибратора (РЗ) раствор, содержащий воду и стабилизаторы.

2.2. Состав
Состав калибратора (К) на основе мультифракционной плазмы крови человека с добавлением фибриногена (0,05%), лиофилизированный:
1) – калибратор – 10 флаконов;
2) – разбавитель для калибратора – 5 флаконов.
Калибратор фибриногена в калибраторе хранят на плазме крови. Концентрация фибриногена в калибраторе указана на этикетке. В упаковке содержится 1 флакон (12 мл) калибратора (К) и 5 флаконов (12 мл) разбавителя (РЗ).

Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия
«Калибратор для определения концентрации фибриногена в плазме крови
(Калибратор фибриноген)» № 1 (вариант 1, серия 2)

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест» Хусаинов М.Д.
«08» 03 2021 г.



ВЕКТОР
БЕСТ

REF

X-XXXX

калибратор
для определения
концентрации фибриногена
в плазме крови

Калибратор фибриноген

Состав: К (10 фл)
РЗ (1×12 мл)

ТУ 21.20.23-148-23548172-2021
РУ

Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия
«Калибратор для определения концентрации фибриногена в плазме крови
(Калибратор фибриноген)» № 2 (вариант 1, серия 2)

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»

Хусаинов М.Д.

«03» 03 2021 г.

REF

X-XXXX

LOT

2



2021-02



2023-02

Калибратор фибриноген



XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

IVD



Для профессионального применения
Антитела к ВИЧ 1,2 и вирусу гепатита С
и HBsAg отсутствуют

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
«Калибратор для определения концентрации фибриногена в плазме крови
(Калибратор фибриноген)» № 1 (вариант 1, серия 2)

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»

Хусаинов М.Д.


«04» 103 2021 г.



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
«Калибратор для определения концентрации фибриногена в плазме крови
(Калибратор фибриноген)» № 2 (вариант 1, серия 2)

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»

«09» 03 2021 г.

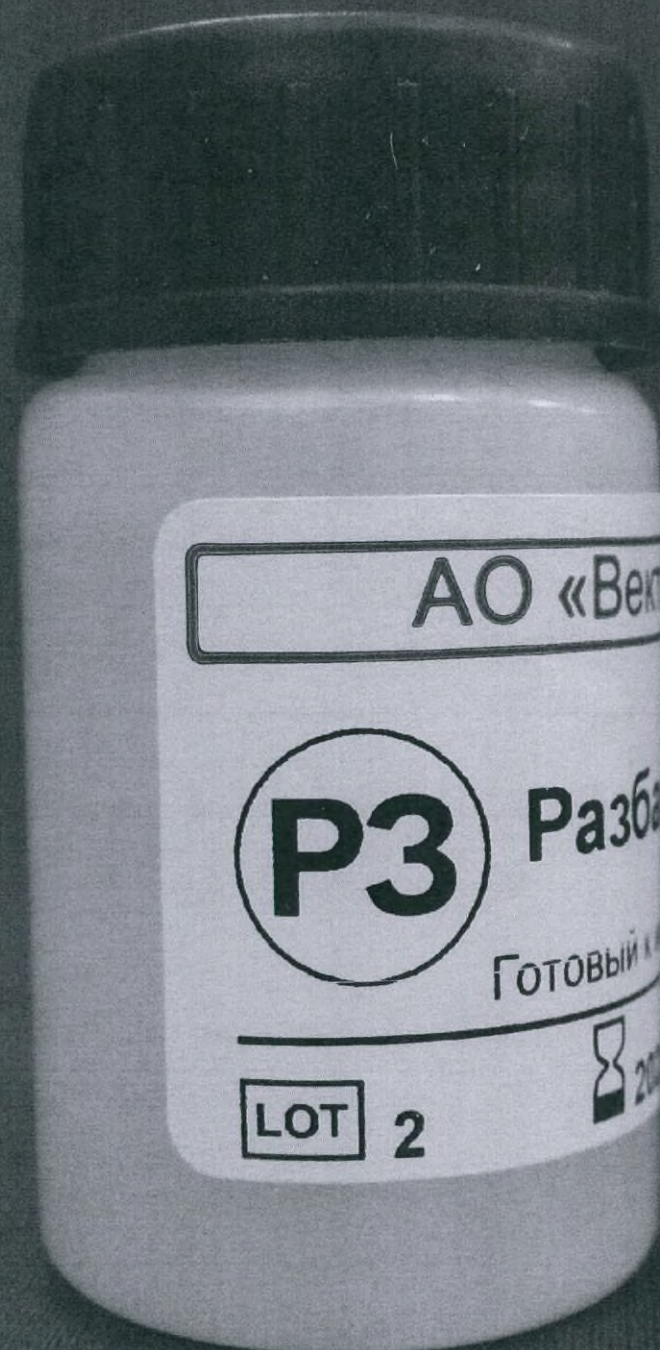


Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
«Калибратор для определения концентрации фибриногена в плазме крови
(Калибратор фибриноген)» № 3 (вариант 1, серия 2)

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»



Хусаинов М.Д.
«09» 03 2021 г.

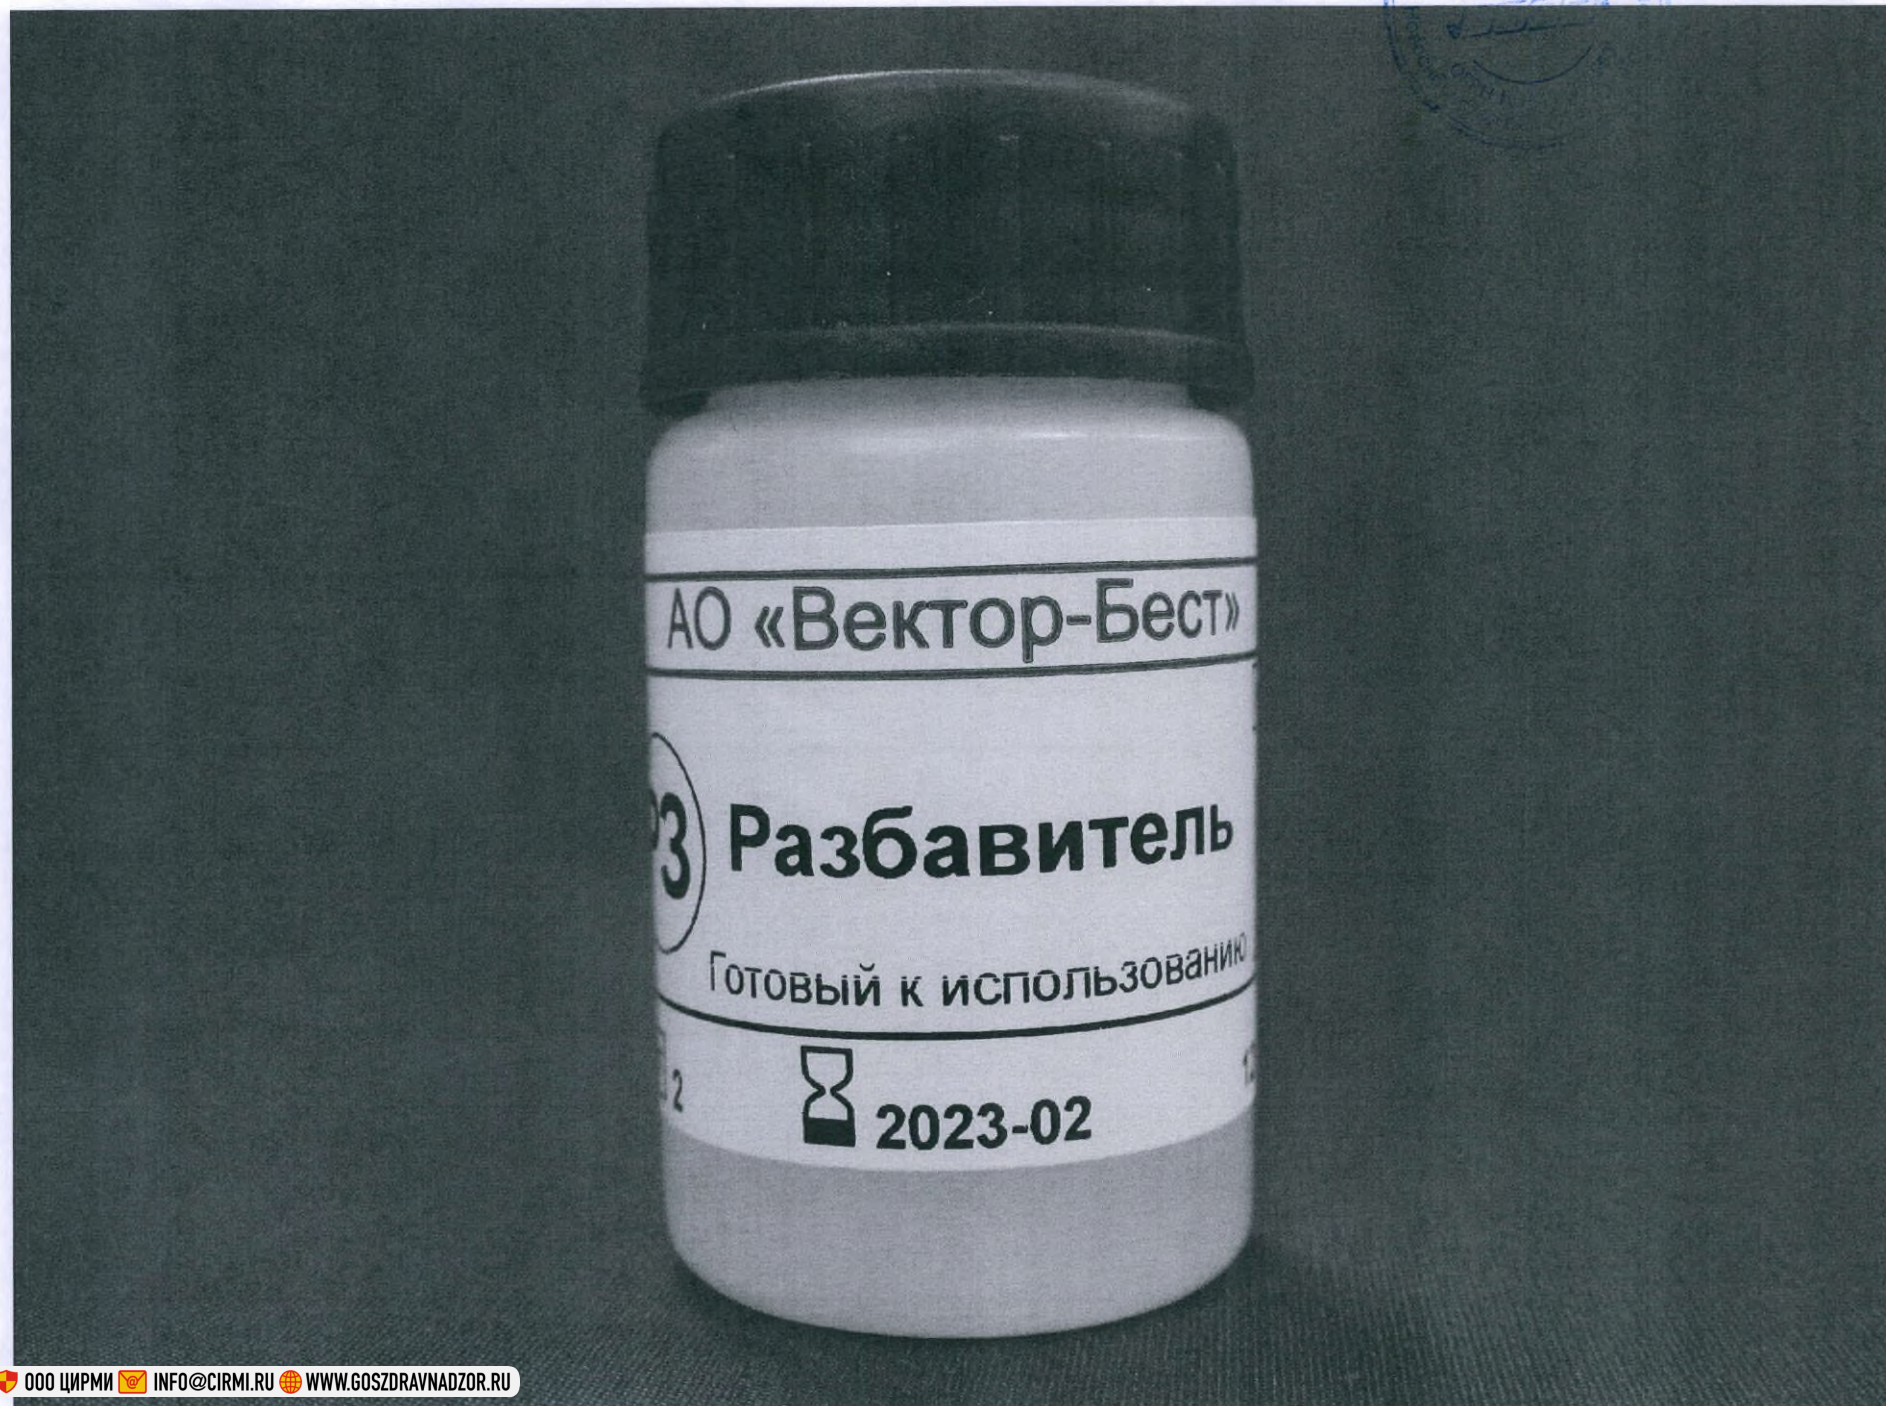

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
«Калибратор для определения концентрации фибриногена в плазме крови
(Калибратор фибриноген)» № 4 (вариант 1, серия 2)

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»


Хусаинов М.Д.

«09» 103 2021 г.



Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия
«Калибратор для определения концентрации фибриногена в плазме крови
(Калибратор фибриноген)» (вариант 2, серия 1)

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест» Хусаинов М.Д.
«03» 03 2021 г.

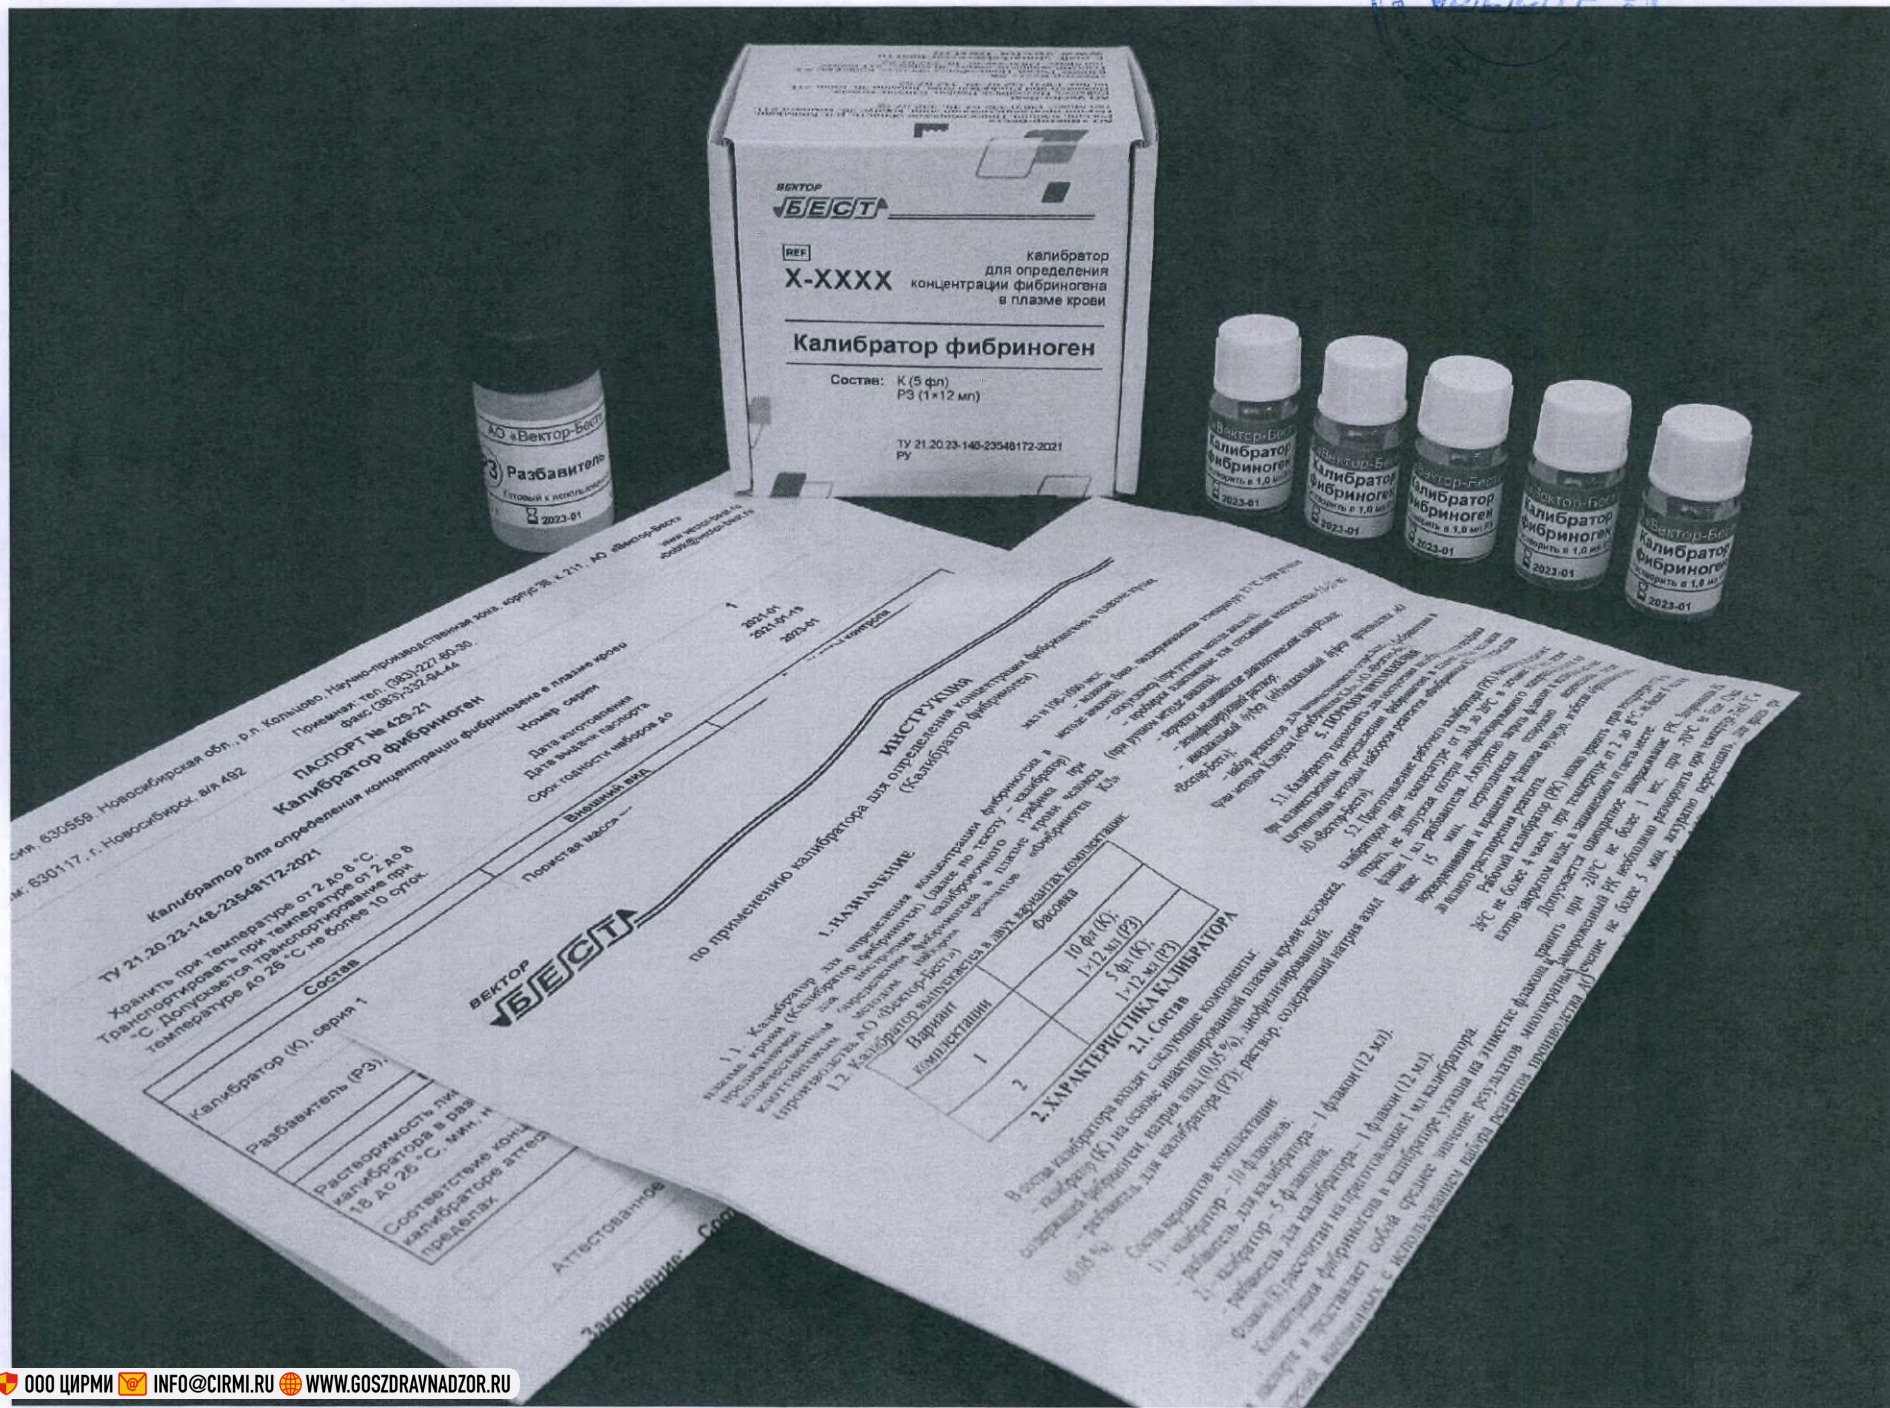

Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия
«Калибратор для определения концентрации фибриногена в плазме крови
(Калибратор фибриноген)» № 1 (вариант 2, серия 1)

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»

Хусаинов М.Д.

«09» 103 2021 г.



ВЕКТОР
БЕСТ

REF

X-XXXX

калибратор
для определения
концентрации фибриногена
в плазме крови

Калибратор фибриноген

Состав: К (5 фл)
РЗ (1×12 мл)

ТУ 21.20.23-148-23548172-2021
РУ

Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия
«Калибратор для определения концентрации фибриногена в плазме крови
(Калибратор фибриноген)» № 2 (вариант 2, серия 1)

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»

Хусаинов М.Д.

2021 г.



REF

X-XXXX

LOT

1




2021-01



2023-01

Калибратор фибриноген



XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

IVD



Для профессионального применения
Антитела к ВИЧ 1,2 и вирусу гепатита С
и HBsAg отсутствуют

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
«Калибратор для определения концентрации фибриногена в плазме крови
(Калибратор фибриноген)» № 1 (вариант 2, серия 1)

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»

Хусаинов М.Д.

«08» 03 2021 г.




Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
«Калибратор для определения концентрации фибриногена в плазме крови
(Калибратор фибриноген)» № 2 (вариант 2, серия 1)

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест» Хусаинов М.Д.




«09» 03 2021 г.

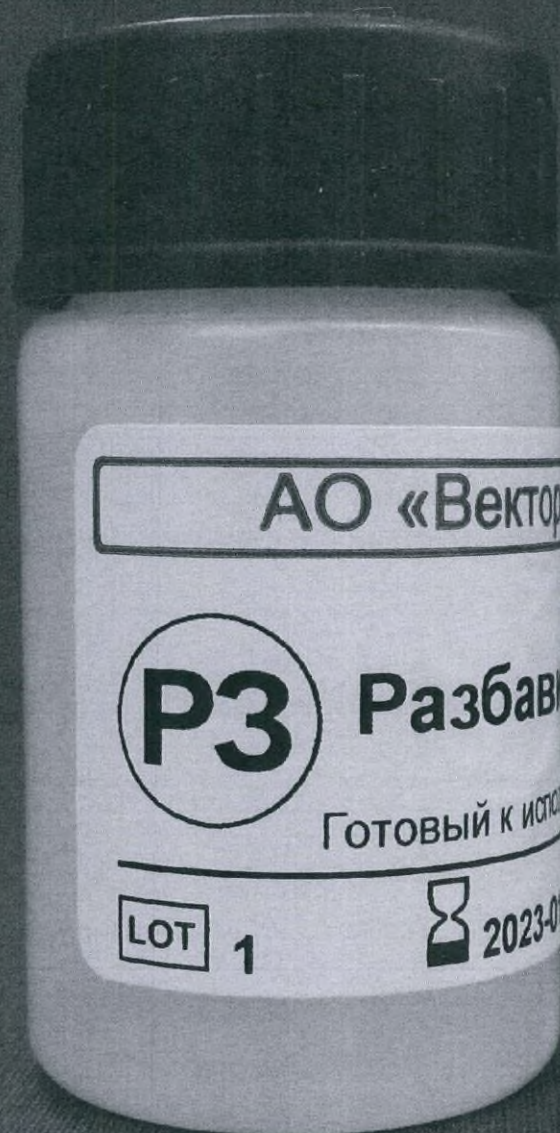

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
«Калибратор для определения концентрации фибриногена в плазме крови
(Калибратор фибриноген)» № 3 (вариант 2, серия 1)

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест» _____ Хусаинов М.Д.
«04» 103 2021 г.

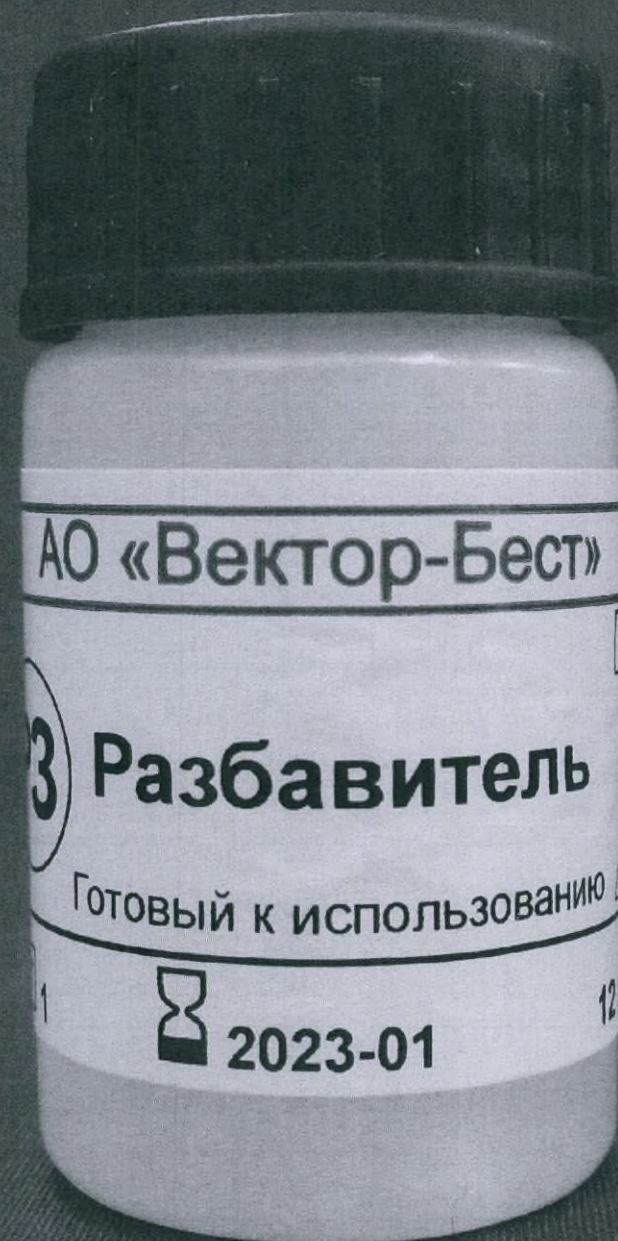

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
«Калибратор для определения концентрации фибриногена в плазме крови
(Калибратор фибриноген)» № 4 (вариант 2, серия 1)

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»


Хусаинов М.Д.

«09» 03 2021 г.



Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия
«Калибратор для определения концентрации фибриногена в плазме крови
(Калибратор фибриноген)» (вариант 2, серия 2)

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест» _____ Хусаинов М.Д.
2021 г.

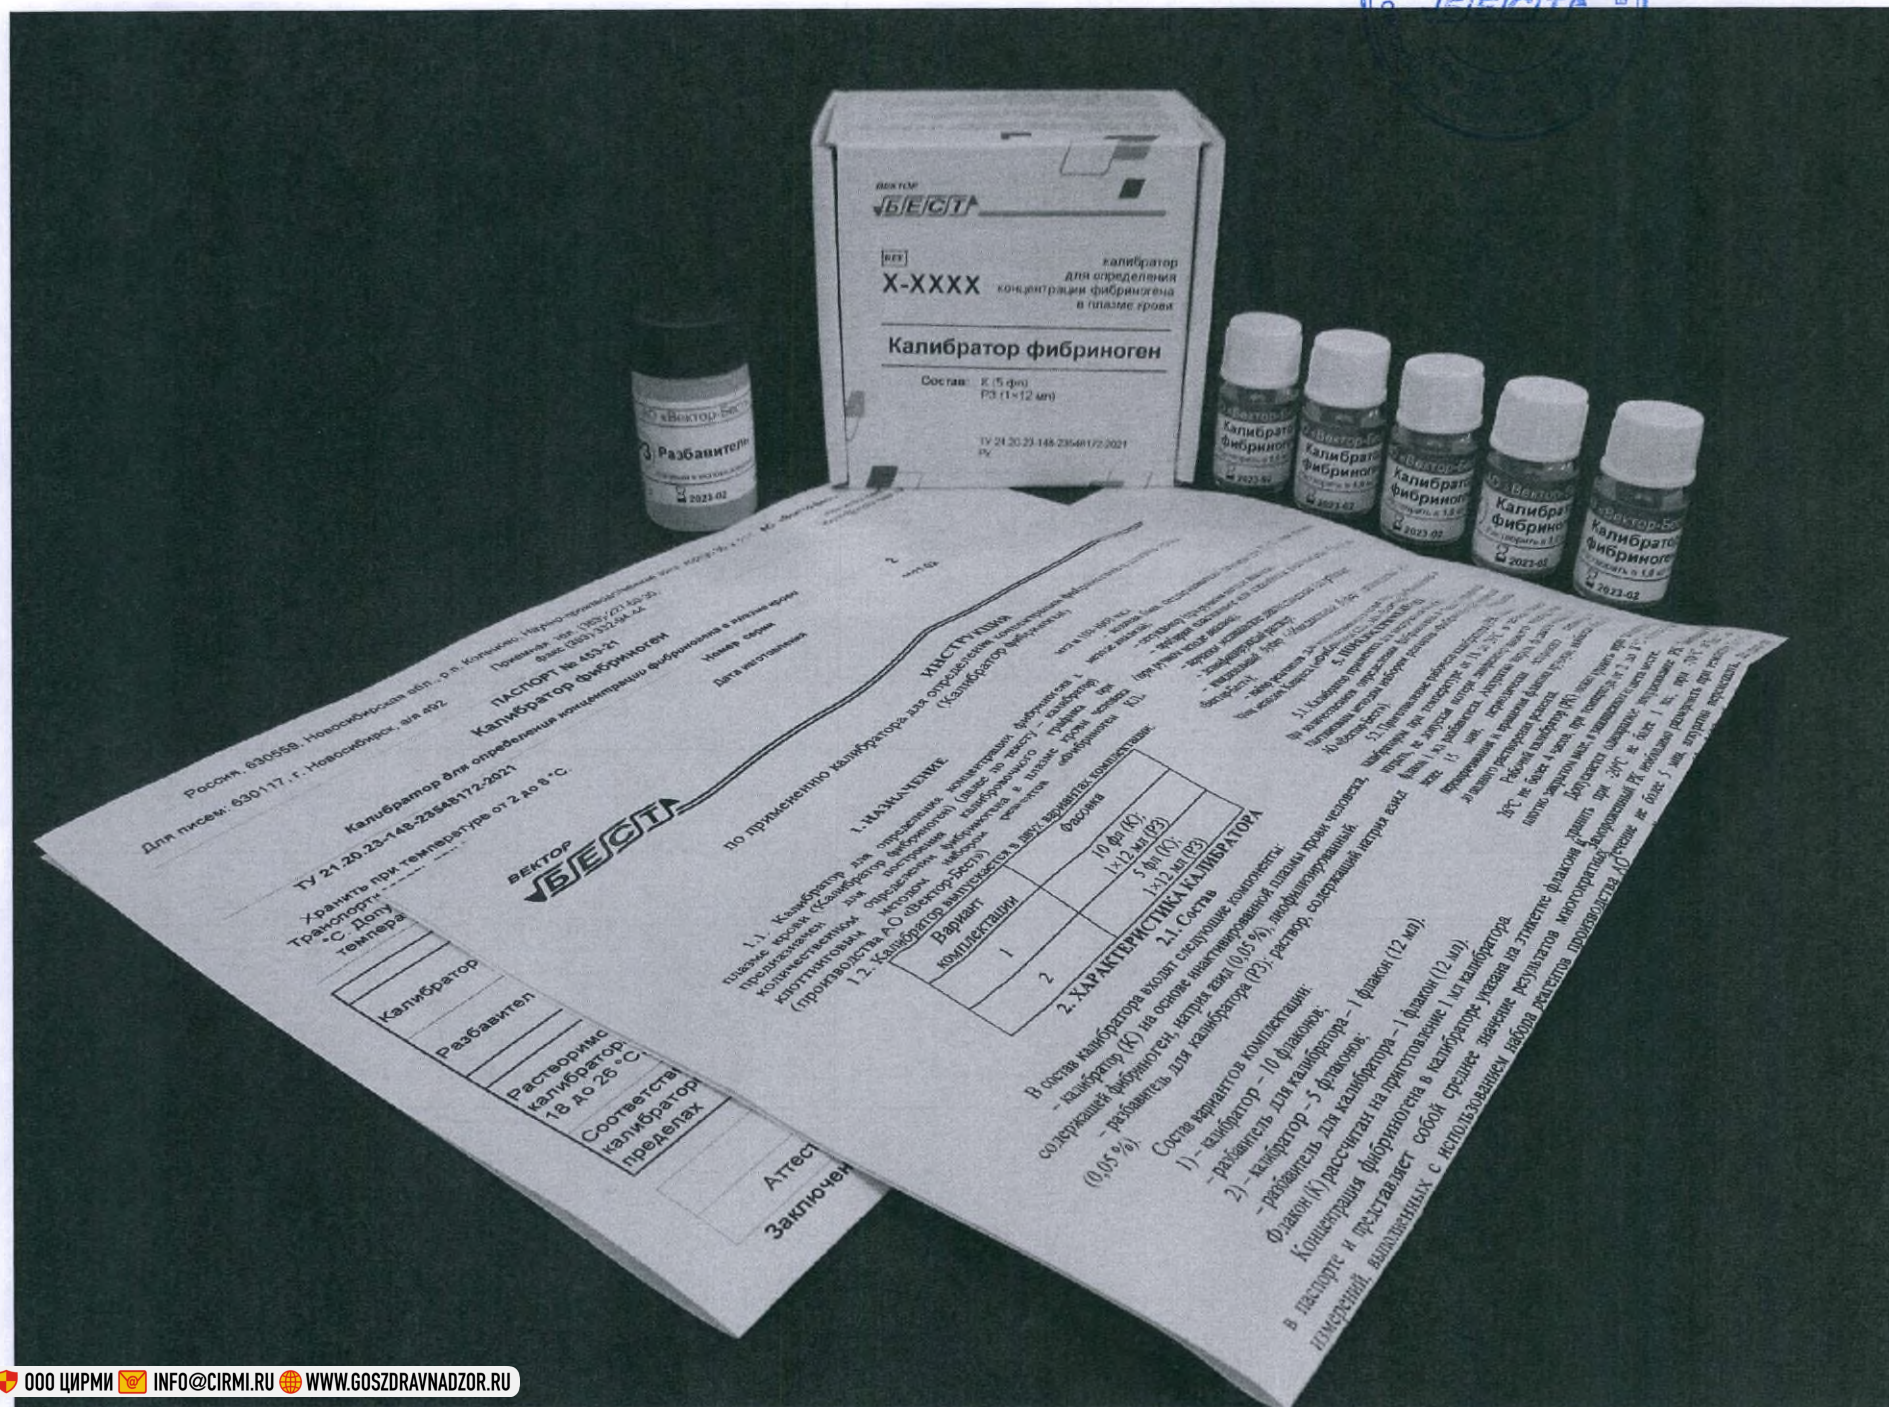

Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия
«Калибратор для определения концентрации фибриногена в плазме крови
(Калибратор фибриноген)» № 1 (вариант 2, серия 2)

Генеральный директор Хусаинов М.Д.
АО «Вектор-Бест» «09» 103 2021 г.



ВЕКТОР
БЕСТ

REF

X-XXXX

калибратор
для определения
концентрации фибриногена
в плазме крови

Калибратор фибриноген

Состав: К (5 фл)
РЗ (1×12 мл)

ТУ 21.20.23-148-23548172-2021
РУ

Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия
«Калибратор для определения концентрации фибриногена в плазме крови
(Калибратор фибриноген)» № 2 (вариант 2, серия 2)

Генеральный директор Хусаинов М.Д.
АО «Вектор-Бест» 03 2021 г.



REF

LOT

2

X-XXXX




2021-02




2023-02

Калибратор фибриноген



XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



Для профессионального применения
Антитела к ВИЧ 1,2 и вирусу гепатита С
и HBsAg отсутствуют

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
«Калибратор для определения концентрации фибриногена в плазме крови
(Калибратор фибриноген)» № 1 (вариант 2, серия 2)

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест» Хусаинов М.Д.

«Вектор-Бест» 03 2021 г.




Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
«Калибратор для определения концентрации фибриногена в плазме крови
(Калибратор фибриноген)» № 2 (вариант 2, серия 2)

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»

Хусаинов М.Д.



2021 г.

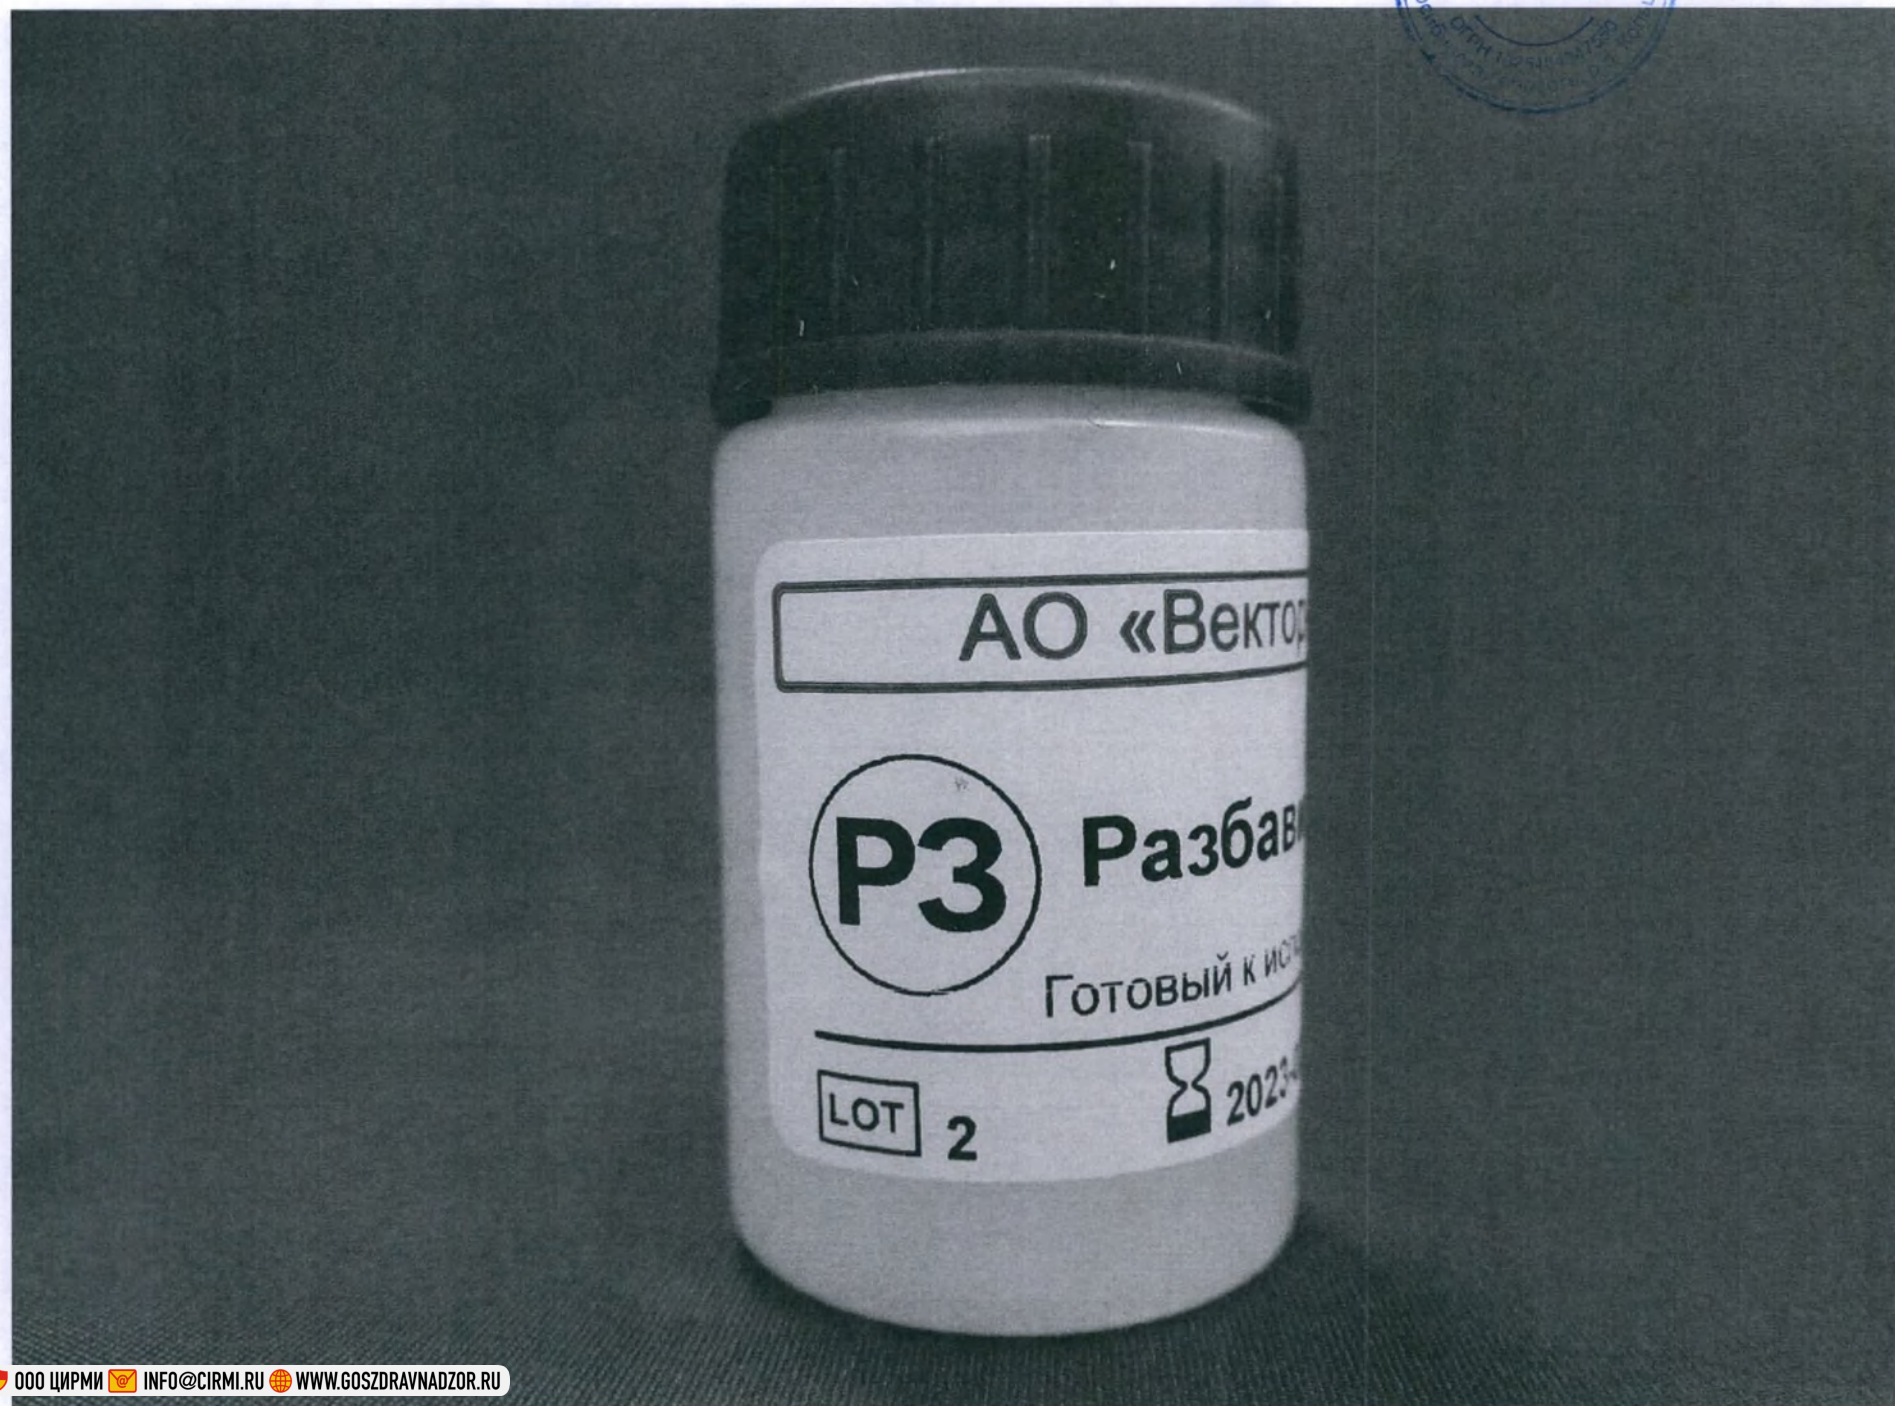


Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
«Калибратор для определения концентрации фибриногена в плазме крови
(Калибратор фибриноген)» № 3 (вариант 2, серия 2)

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»

Хусаинов М.Д.

03 2021 г.

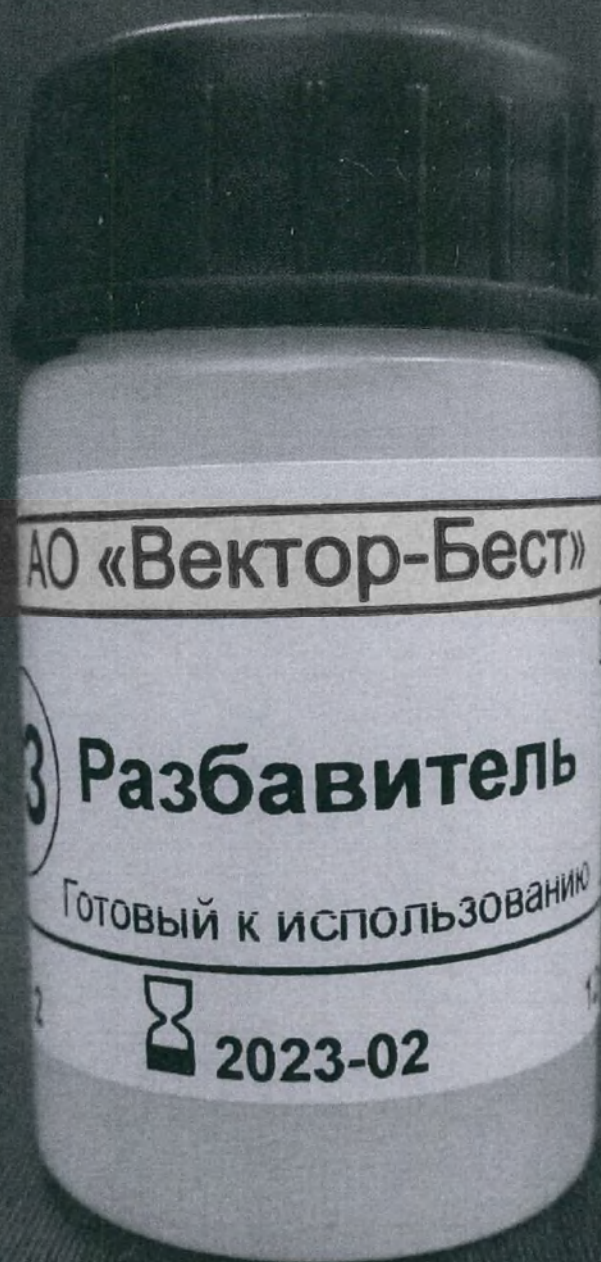

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
«Калибратор для определения концентрации фибриногена в плазме крови
(Калибратор фибриноген)» № 4 (вариант 2, серия 2)

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест» _____ Хусаинов М.Д.
«09» 03 2021 г.



Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия
«Калибратор для определения концентрации фибриногена в плазме крови
(Калибратор фибриноген)» № 3 (вариант 1, серия 1)

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»



Хусаинов М.Д.

20 dd г.



АО «Вектор-Бест»

Россия, 630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово,
Научно-производственная зона, корпус 36, комната 211,
тел./факс: (383) 332-67-49, 332-67-52

AO Vector-Best

Koltsovo, Novosibirsk Region, 630559, Russia,
Research and Production Area, housing 36, room 211,
tel./fax: (383) 332-67-49, 332-67-52

«Вектор-Бест» АҚ

630559, Ресей, Новосибирск облысы, Кольцово ж.к.
Ғылыми-өндірістік аймақ, 36 корпус, 211 бөлме
тел./факс: (383) 332-67-49, 332-67-52

E-mail: vbmarket@vector-best.ru
www.vector-best.ru

Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия
«Калибратор для определения концентрации фибриногена в плазме крови
(Калибратор фибриноген)» № 3 (вариант 1, серия 2)

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»

Хусаинов М.Д.

«21» 2022 г.



АО «Вектор-Бест»

Россия, 630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово,
Научно-производственная зона, корпус 36, комната 211,
тел./факс: (383) 332-67-49, 332-67-52

AO Vector-Best

Koltsovo, Novosibirsk Region, 630559, Russia,
Research and Production Area, housing 36, room 211,
tel./fax: (383) 332-67-49, 332-67-52

«Вектор-Бест» АҚ

630559, Ресей, Новосибирск облысы, Кольцово ж.к.
Ғылыми-өндірістік аймақ, 36 корпус, 211 бөлме
тел./факс: (383) 332-67-49, 332-67-52

**E-mail: vbmarket@vector-best.ru
www.vector-best.ru**



АО «Вектор-Бест»

Россия, 630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово,
Научно-производственная зона, корпус 36, комната 211,
тел./факс: (383) 332-67-49, 332-67-52

АО Vector-Best

Koltsovo, Novosibirsk Region, 630559, Russia,
Research and Production Area, housing 36, room 211,
tel./fax: (383) 332-67-49, 332-67-52

«Вектор-Бест» АҚ

630559, Ресей, Новосибирск облысы, Кольцово ж.к.
Ғылыми-өндірістік аймақ, 36 корпус, 211 бөлме
тел./факс: (383) 332-67-49, 332-67-52

E-mail: vbmarket@vector-best.ru
www.vector-best.ru

графическое изображение упаковки медицинского изделия
для определения концентрации фибриногена в плазме крови
(«Калибратор фибриноген») № 3 (вариант 2, серия 2)

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»



АО «Вектор-Бест»

Россия, 630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово,
Научно-производственная зона, корпус 36, комната 211,
тел./факс: (383) 332-67-49, 332-67-52

AO Vector-Best

Koltsovo, Novosibirsk Region, 630559, Russia,
Research and Production Area, housing 36, room 211,
tel./fax: (383) 332-67-49, 332-67-52

«Вектор-Бест» АҚ

630559, Ресей, Новосибирск облысы, Кольцово ж.к.
Ғылыми-өндірістік аймақ, 36 корпус, 211 бөлме
тел./факс: (383) 332-67-49, 332-67-52

E-mail: vbmarket@vector-best.ru
www.vector-best.ru