

PHILIPS

Руководитель
по нормативному регулированию ООО «ФИЛИПС»

Горкуша Д.В.



2021 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

«Система ультразвуковая 3300 с принадлежностями, в вариантах исполнения»

Система ультразвуковая 3300 с принадлежностями, в вариантах исполнения




1.1 Аппарат ультразвуковой 3300. Вид спереди.




1.2 Аппарат ультразвуковой 3300. Вид сбоку.




2. Датчик с конвексной матрицей C6-2.

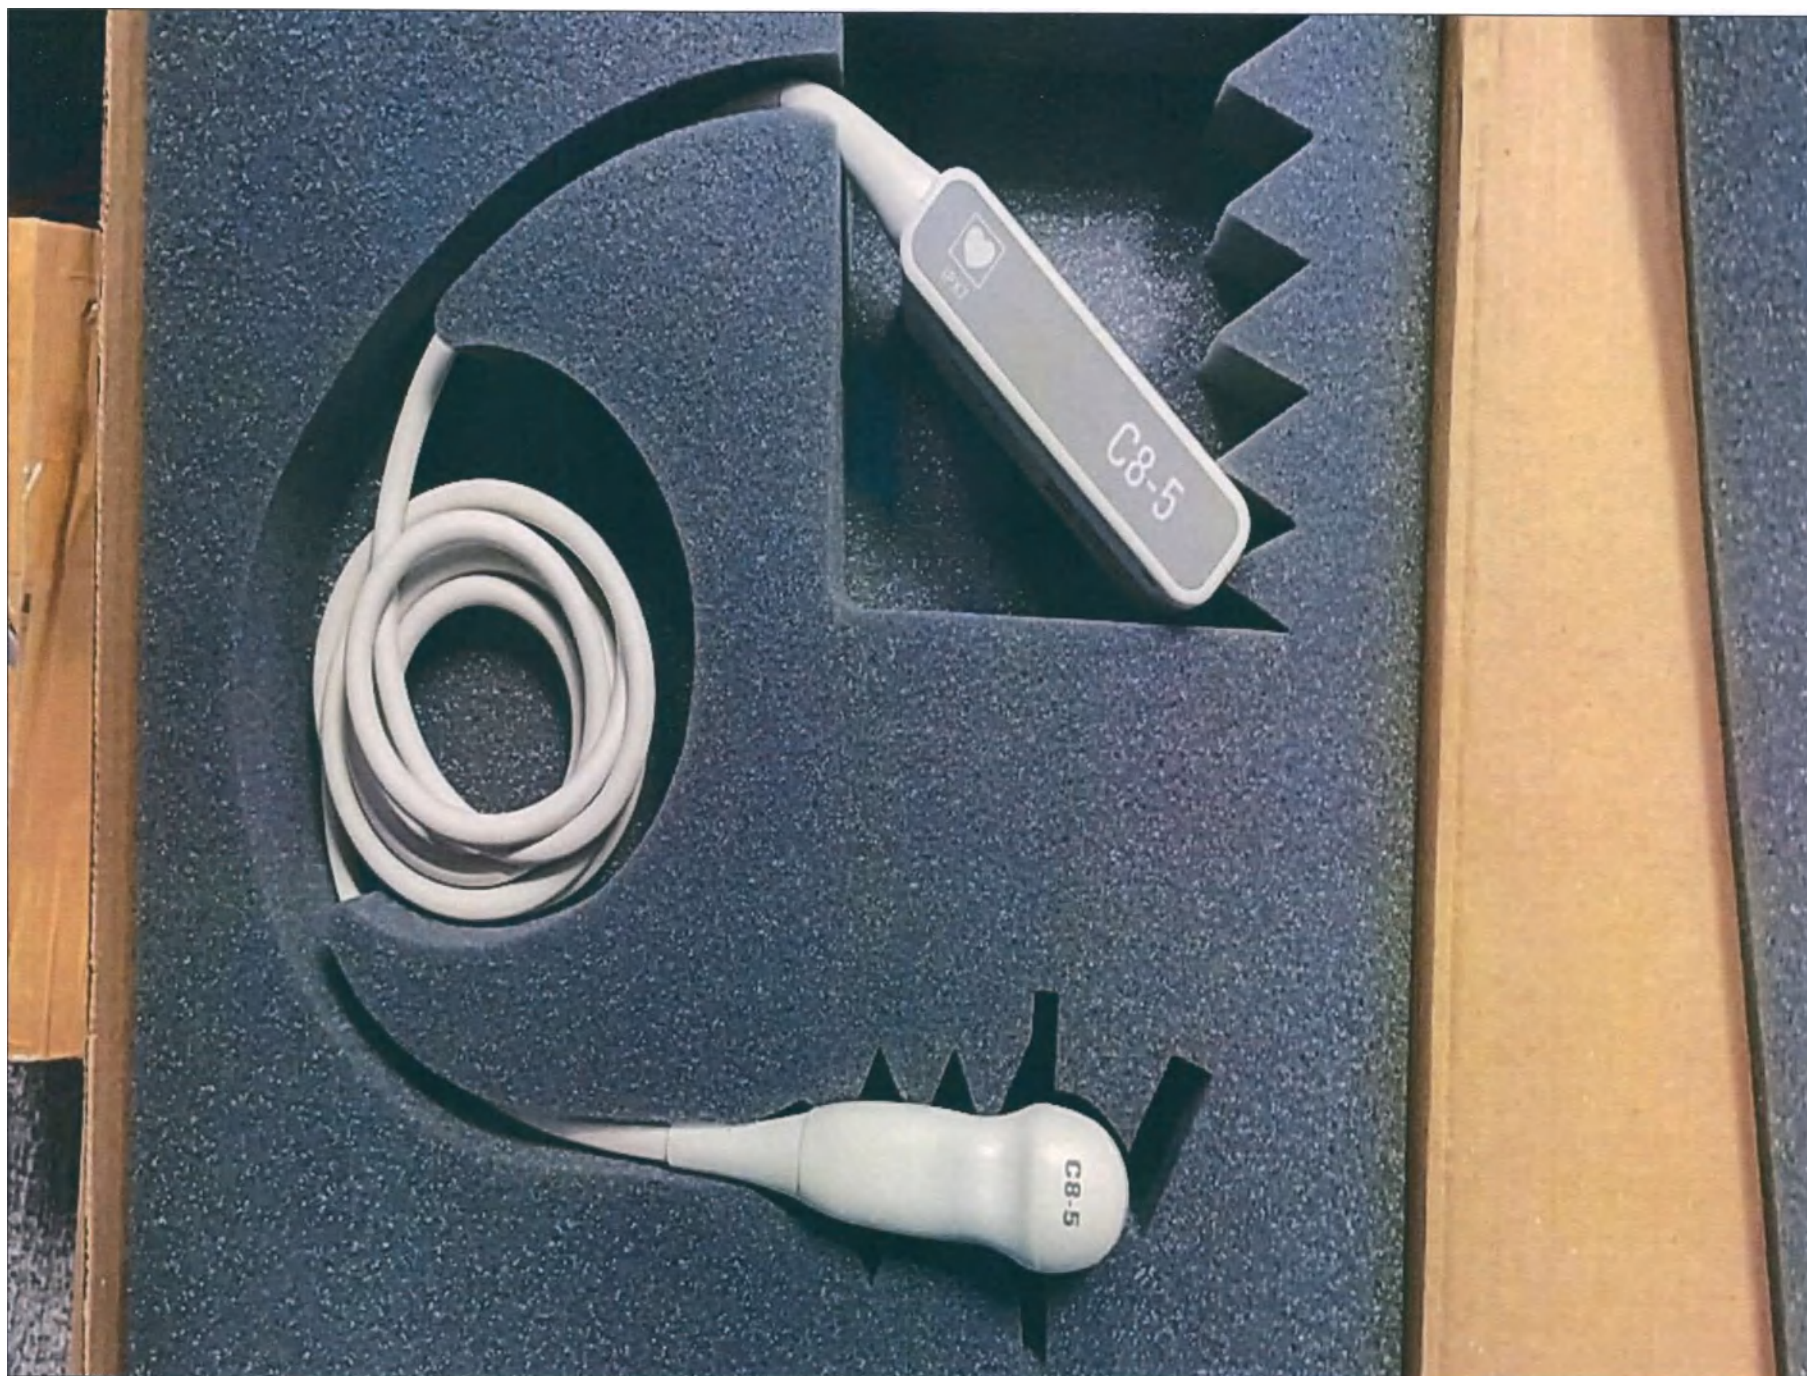


3. Датчик с конвексной матрицей C8-5.

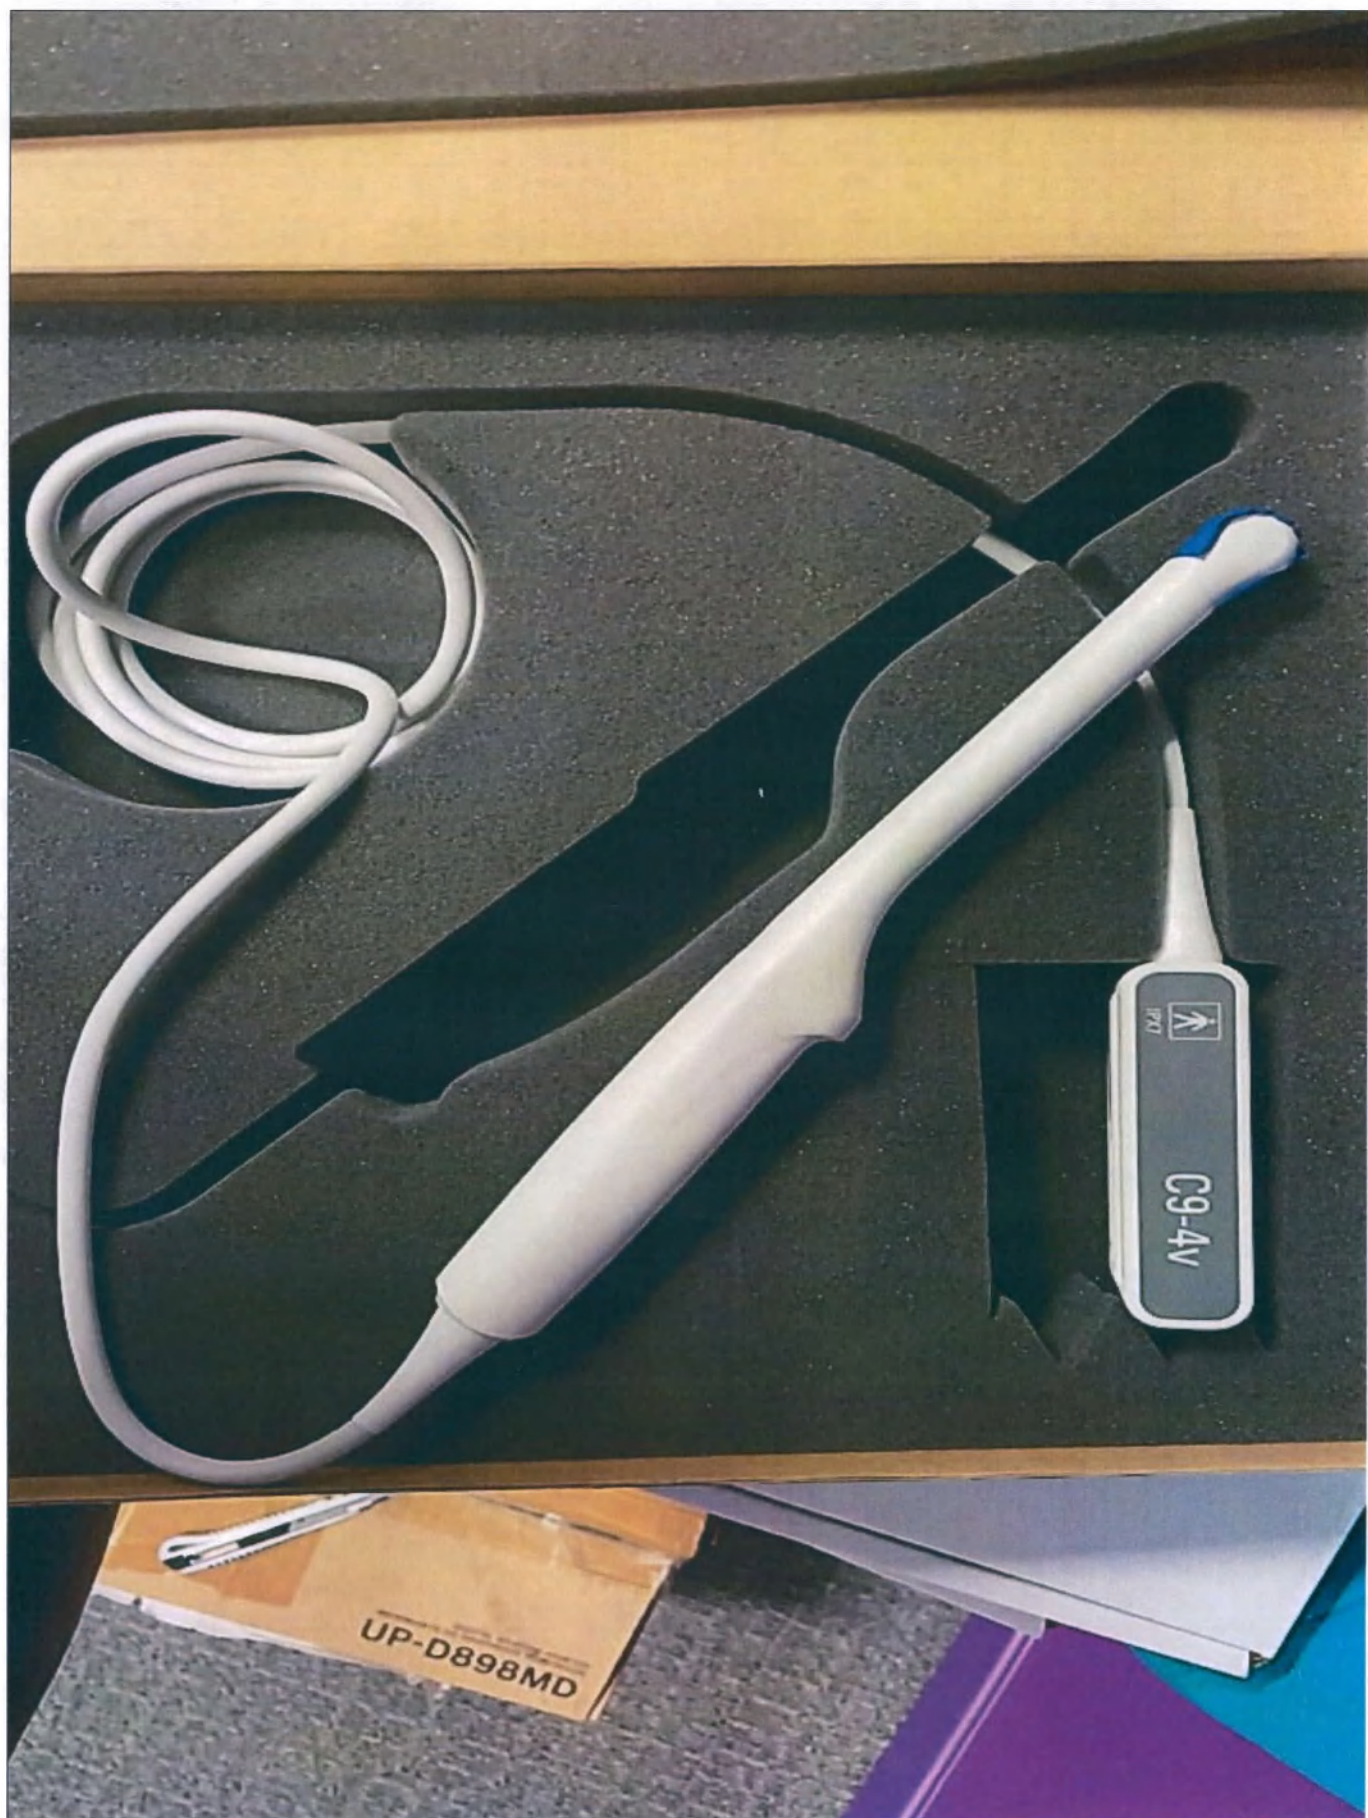


4. Датчик с конвексной матрицей C9-4v.

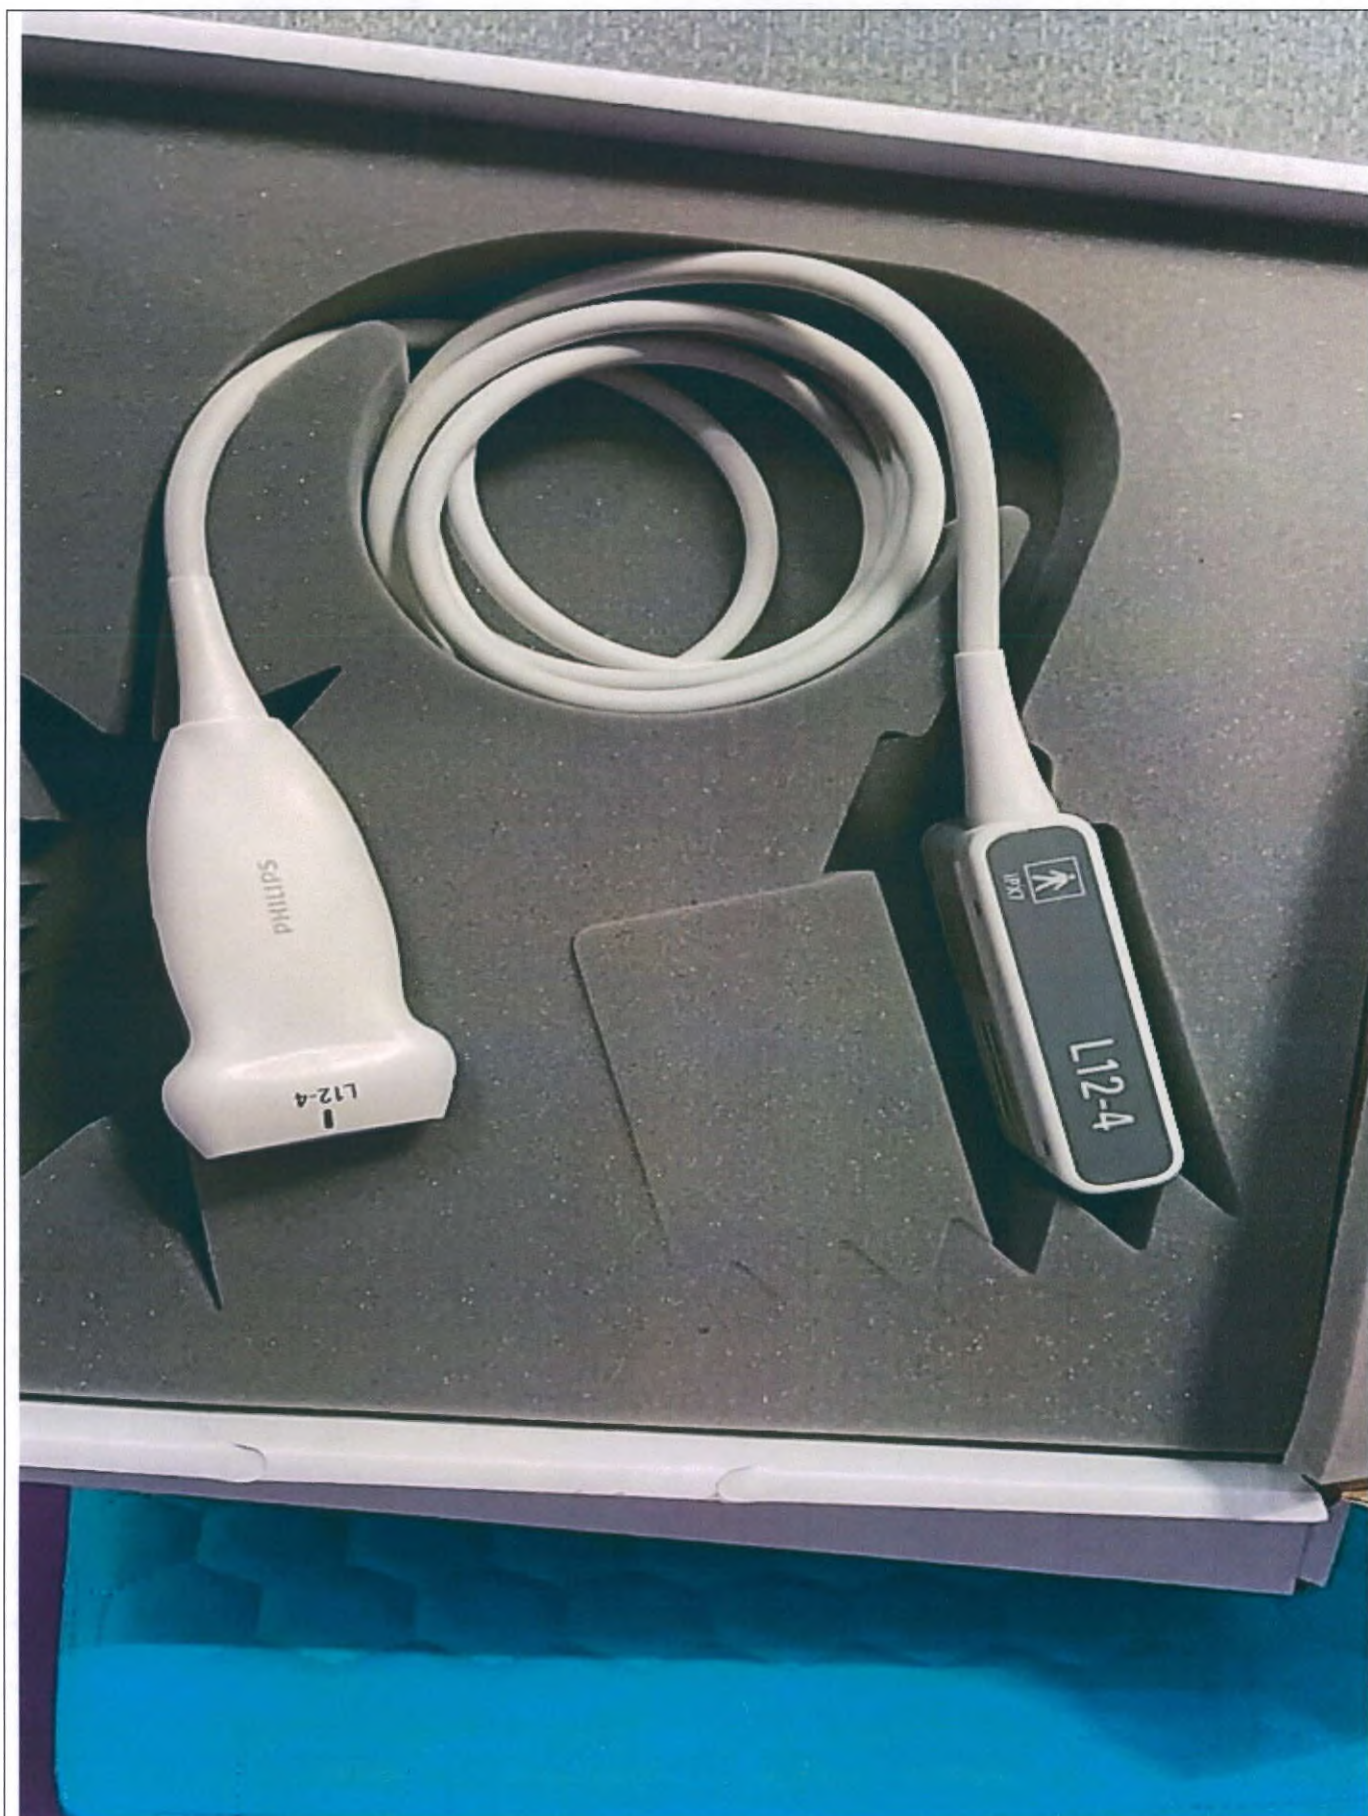

5. Датчик с линейной матрицей L12-4.

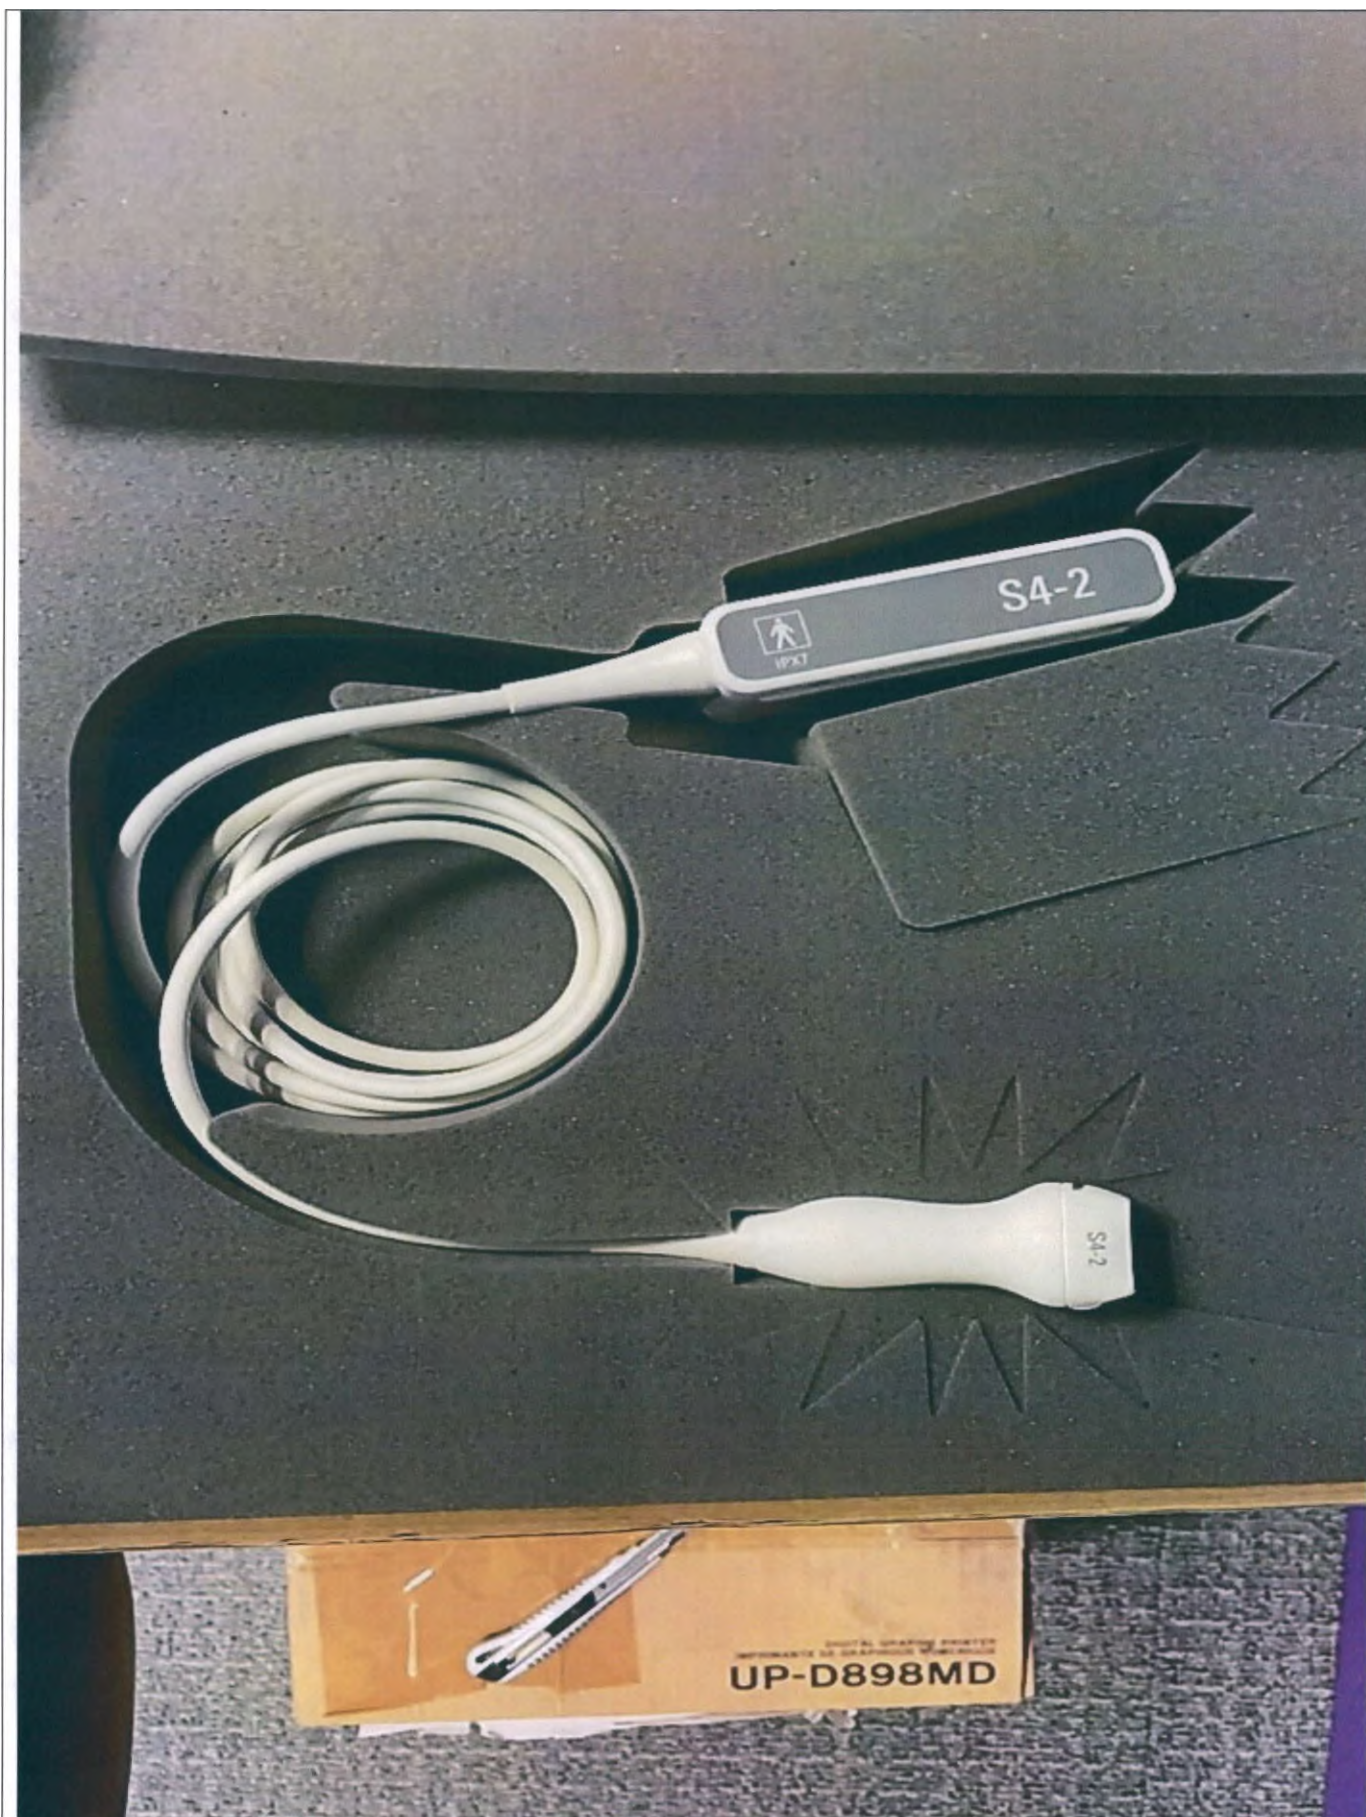


6. Датчик с фазированной (секторной) матрицей S4-2.

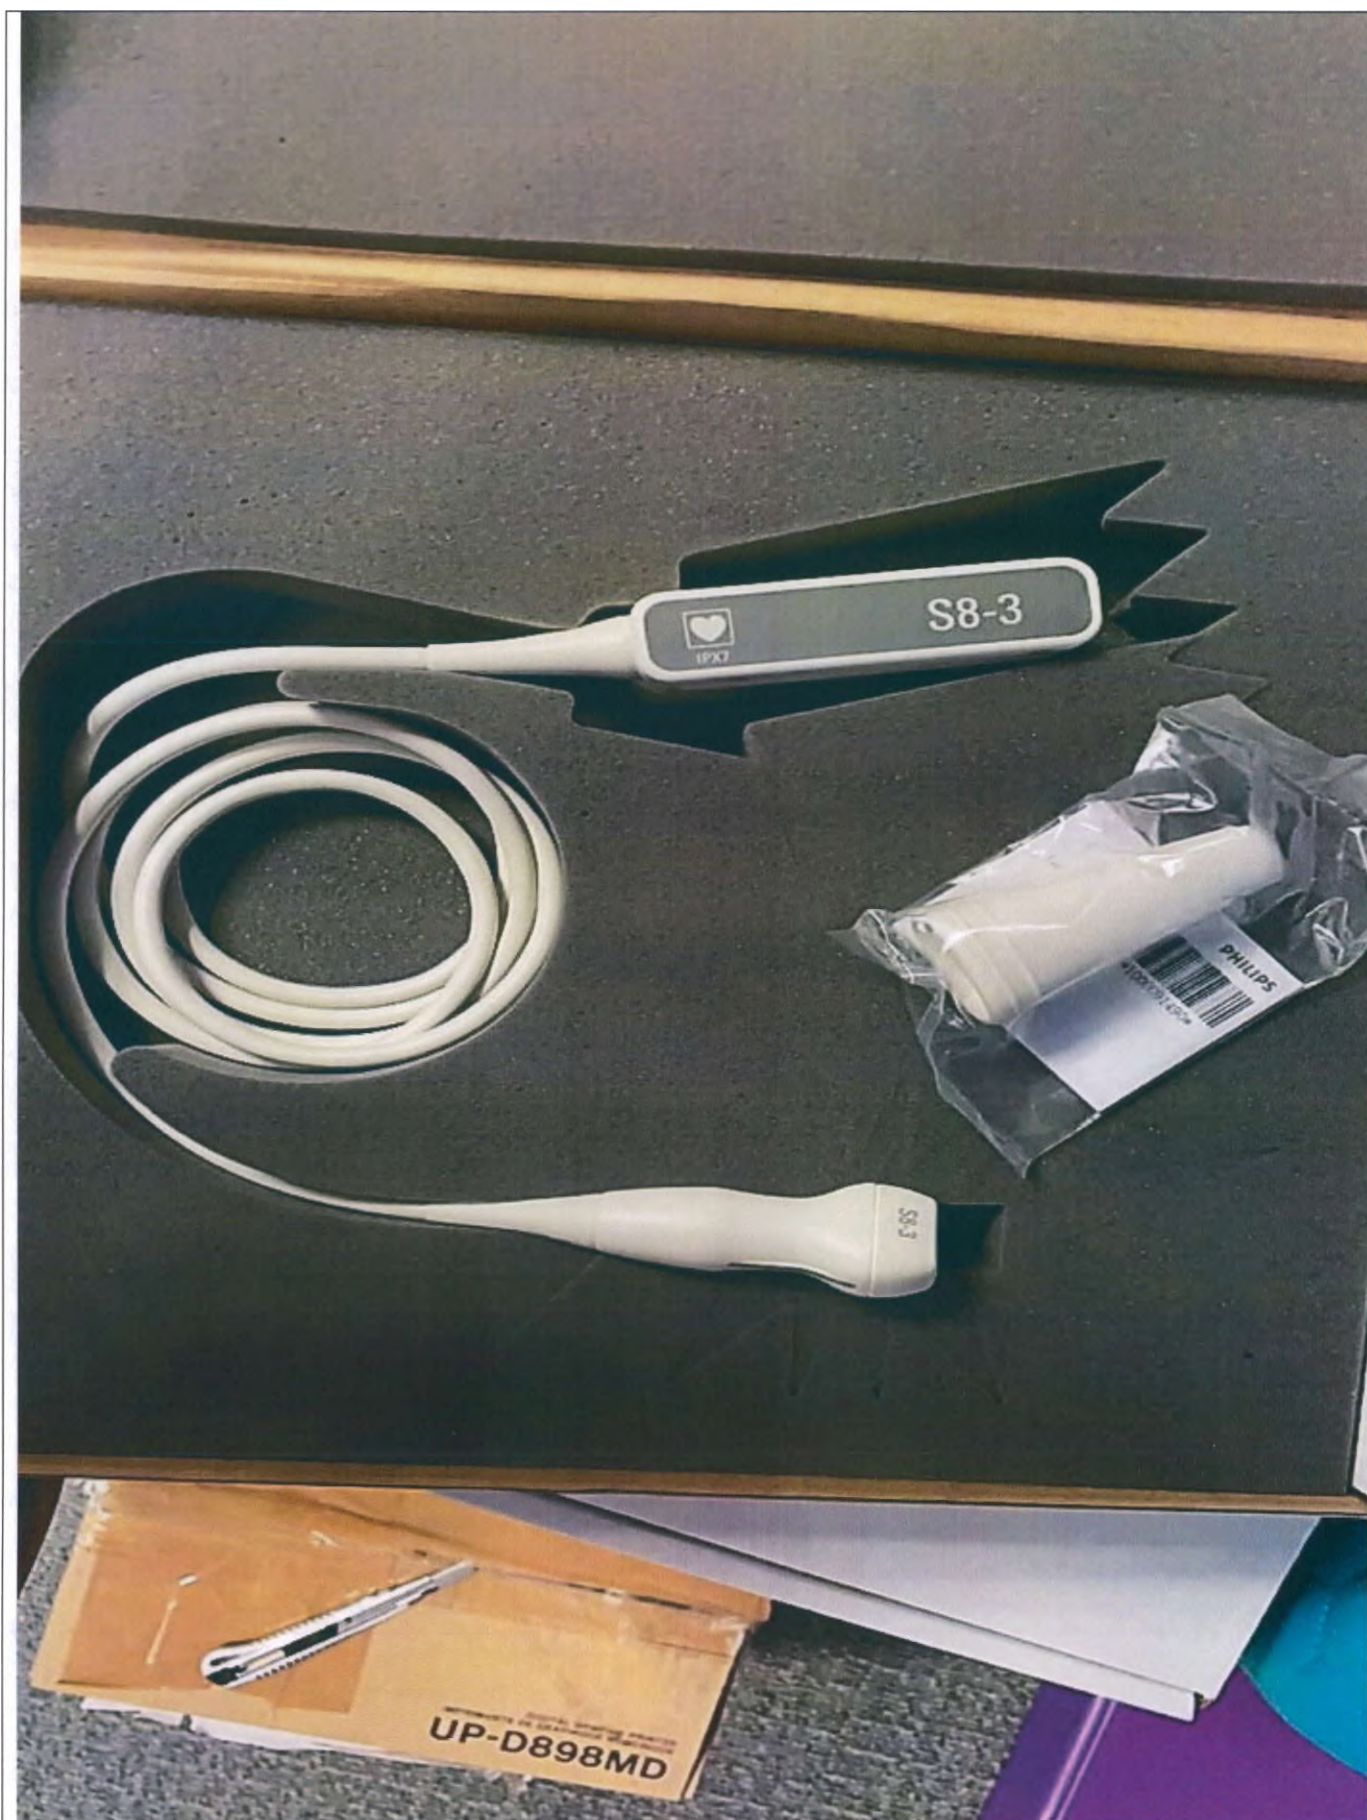

7. Датчик с фазированной (секторной) матрицей S8-3.



8. Датчик с конвексной матрицей V6-2.

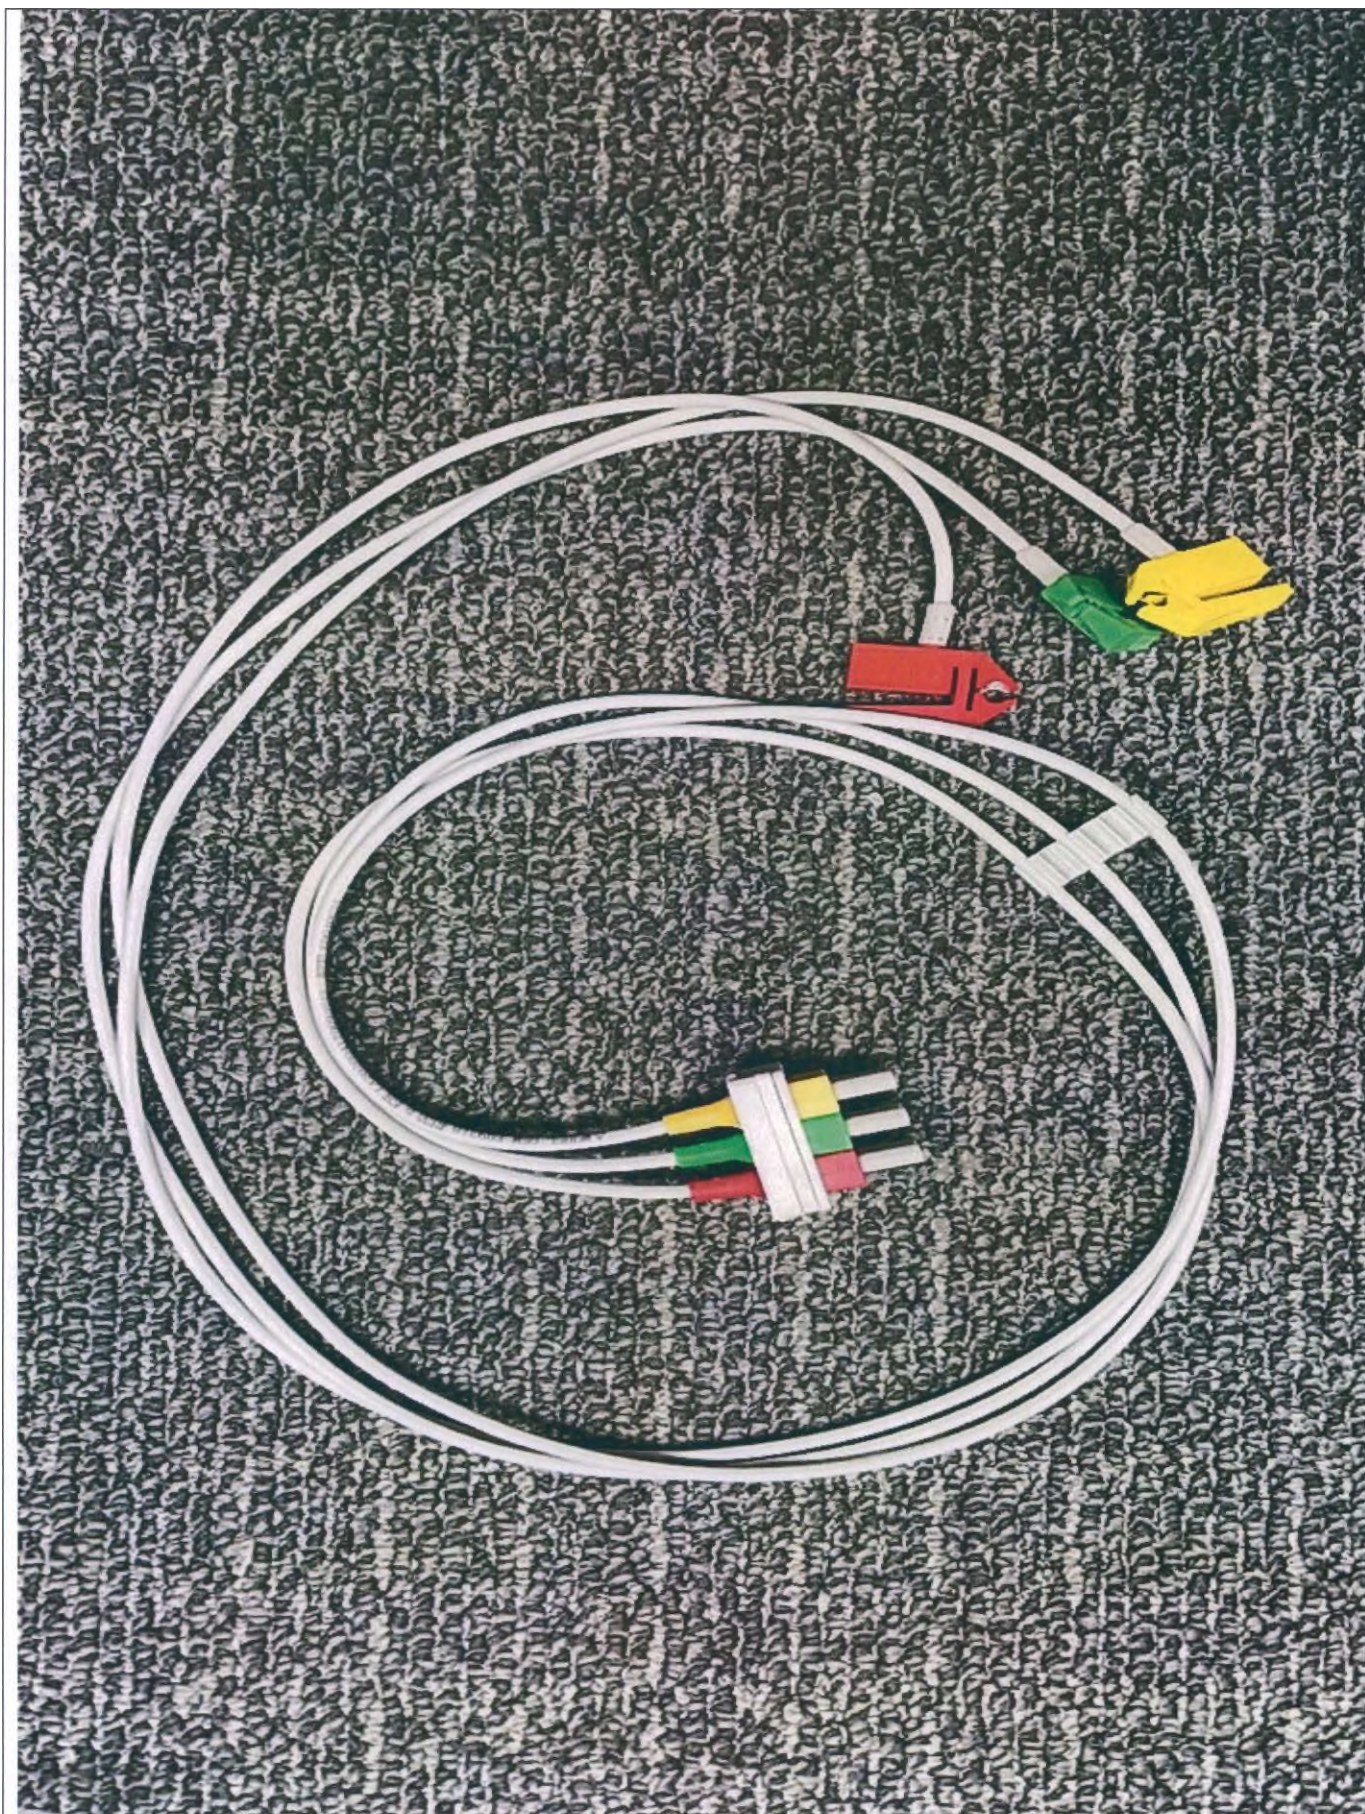

10. Отделение ЭКГ для взрослых (ЛЕС).



11.1 Специальное медицинское программное обеспечение на съемных или виртуальных носителях.



11.2 Специальное медицинское программное обеспечение на съемных или виртуальных носителях.



12. Кабель питания.

PHILIPS

Ультразвуковая система 3300

3300 G/3300 W/3300 C

Руководство по эксплуатации изделия



10350121

NPS-US-0505, ред. А

13.1 Руководства пользователя на бумажных и/или электронных носителях.

Ультразвуковая система 3300

3300 G/3300 W/3300 C

Руководство пользователя

NPD-US-1240 Ред. А

10339721

Май 2020 г.




© Koninklijke Philips N.V., 2020. Все права защищены. Опубликовано в США.

PHILIPS

13.2 Руководства пользователя на бумажных и/или электронных носителях.

Принадлежности:

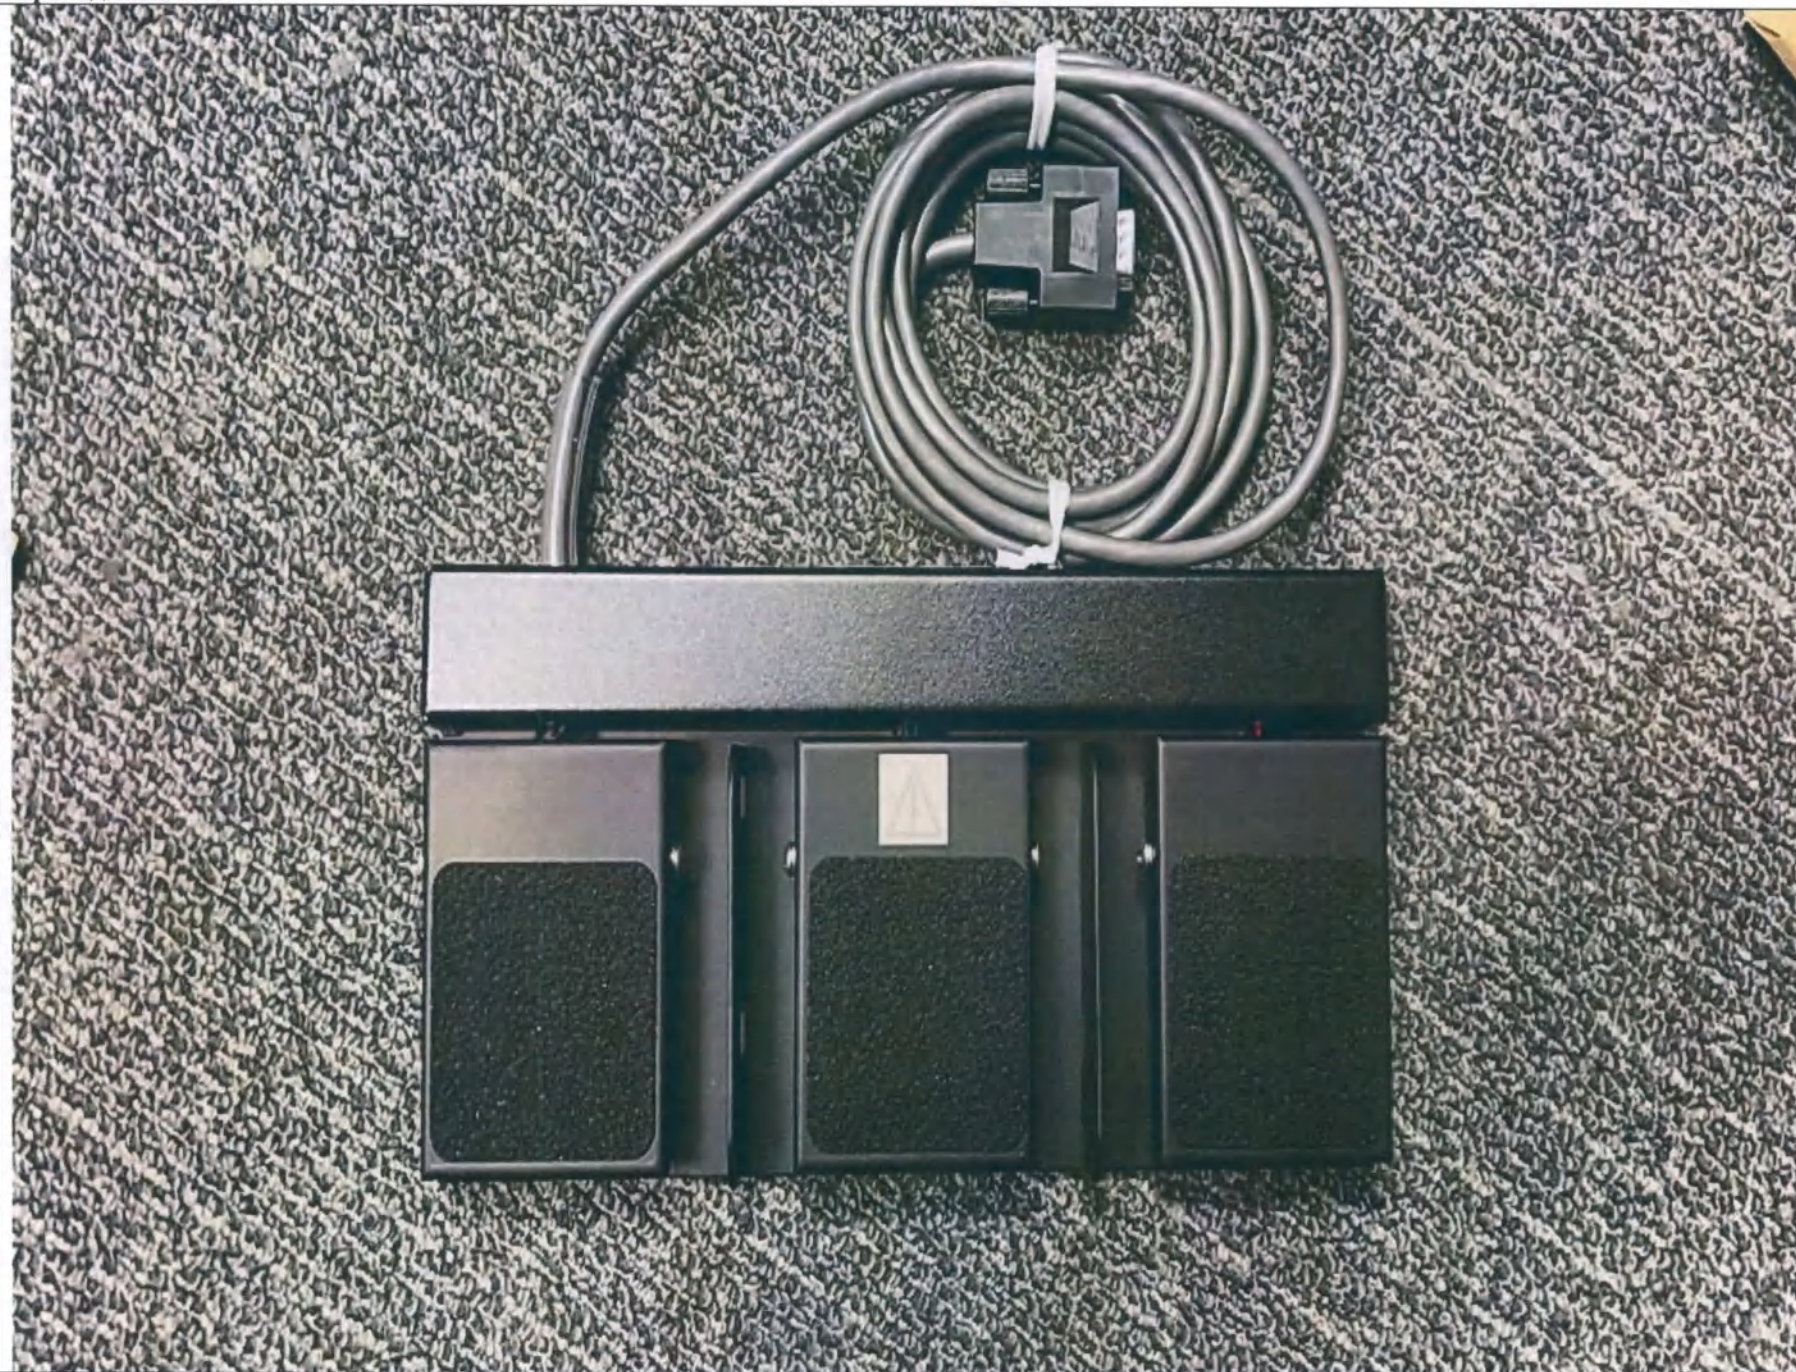

1. Переключатель ножной.



2. Принтер черно-белый UP-D898MD, производства компании Sony.



3. Термическая бумажная лента для принтера, производства компании Sony.




4.1 Устройство подключения к беспроводной сети NETGEAR A6210.



4.2 Устройство подключения к беспроводной сети EDiMAX N150.



5. Кабель сетевой, 4 м.

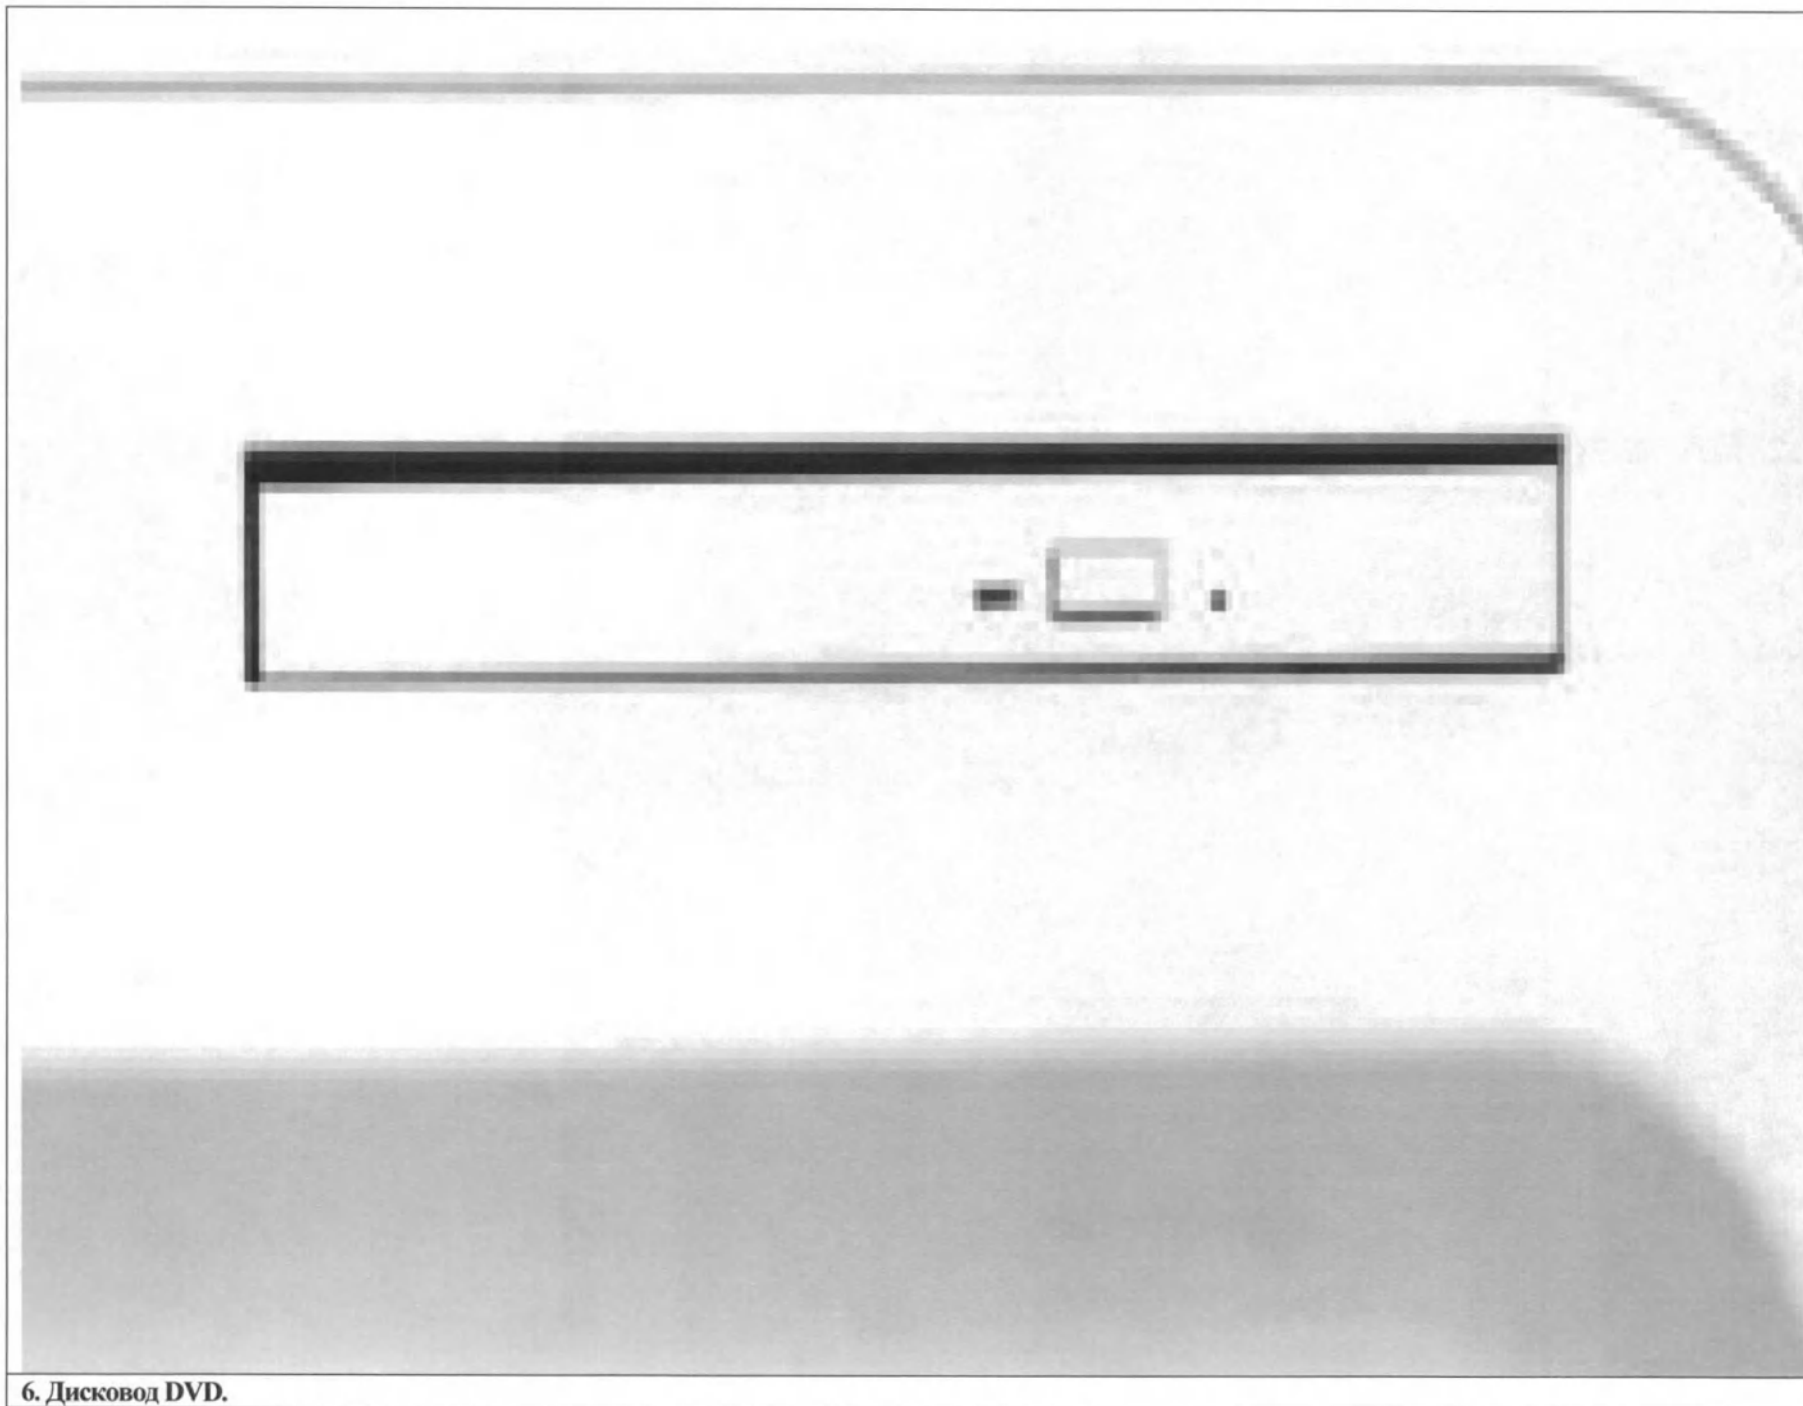

6. Дисковод DVD.



7.1 Адаптер видеосигнала с кабелями в составе: 1) Адаптер видеосигнала. 2) 7.2. Кабели адаптера видеосигнала.




7.2 Адаптер видеосигнала с кабелями в составе: 1) Адаптер видеосигнала. 2) Кабели адаптера видеосигнала.



8. Адаптер кабеля.



9. Подогреватель геля.

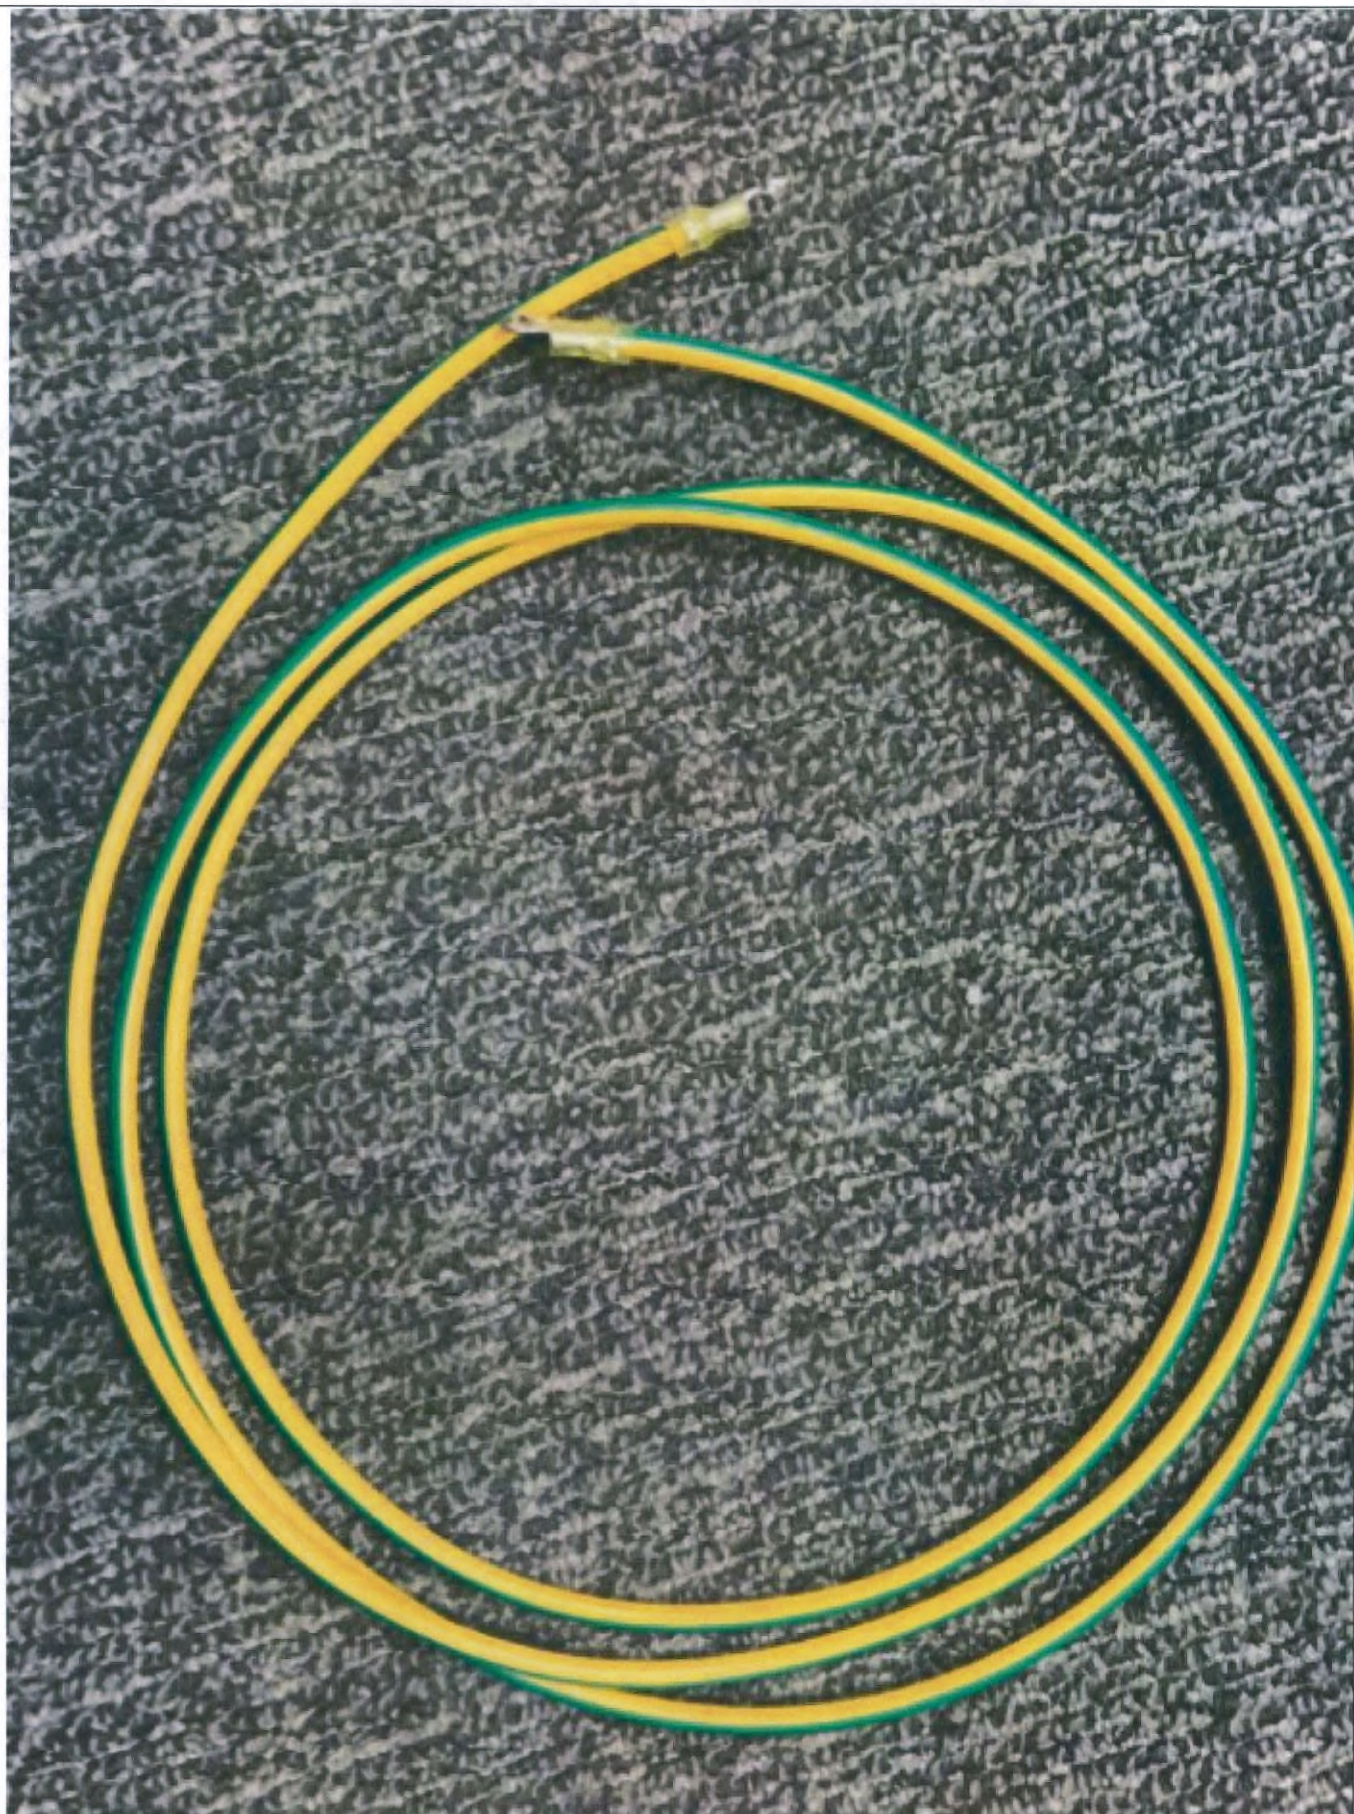

10. Кабель заземления.


Упаковка:



1.1 Упаковка ультразвуковой системы 3300.



1.2 Упаковка ультразвуковой системы 3300.

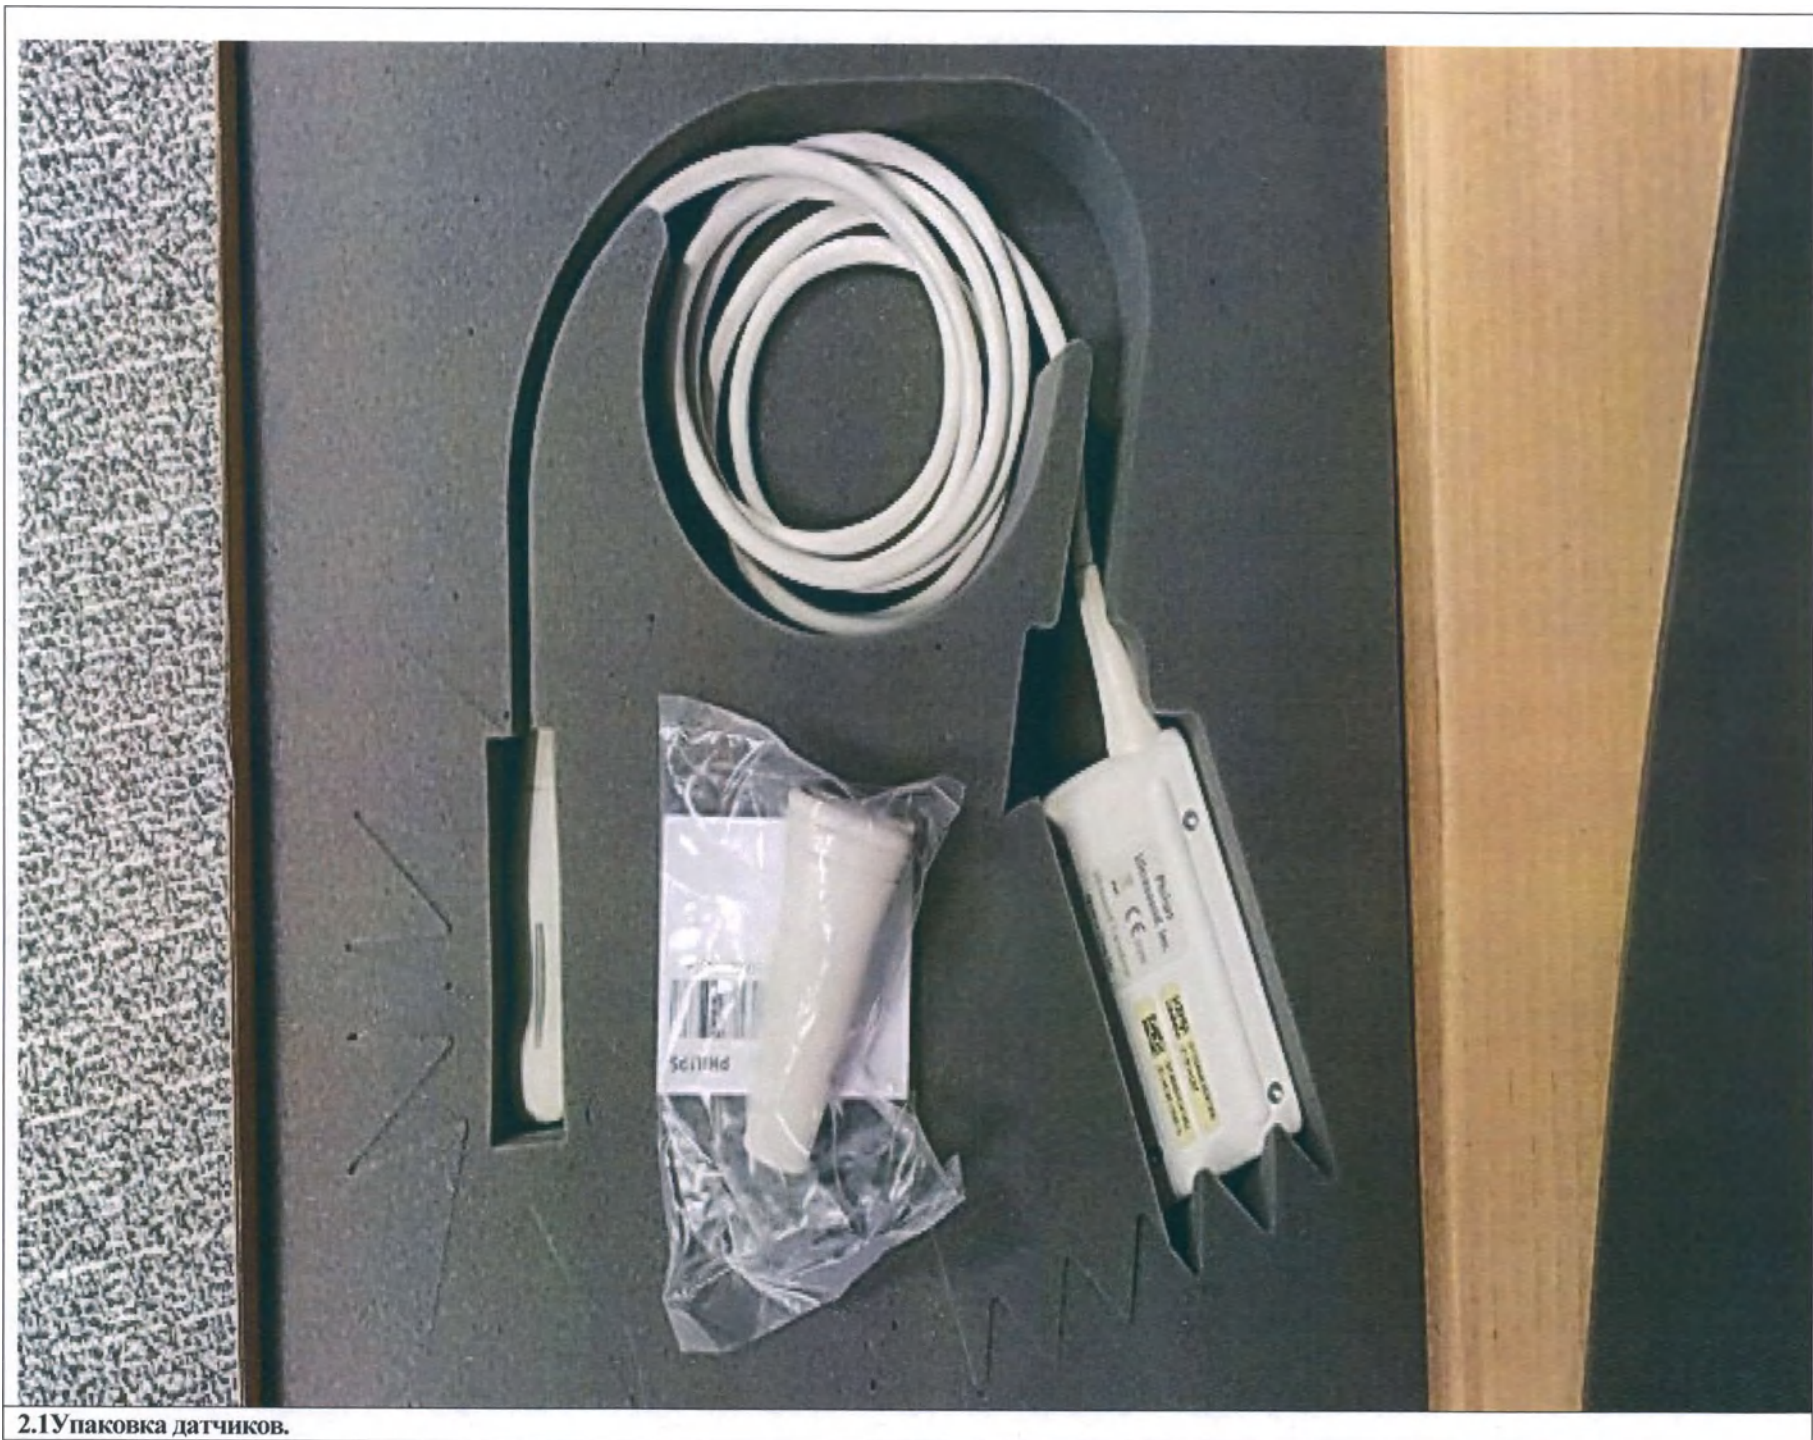

2.1 Упаковка датчиков.



2.2 Упаковка датчиков.

Производитель

«Ньюсофт Медикал Системс Ко., Лтд», Китай,
Neusoft Medical Systems Co., Ltd., No. 177-1
Chuangxin Road, Chuangxin Road, Hunnan District,
Shenyang 110167, Liaoning, China

Место производства

Neusoft Medical Systems Co., Ltd., No. 177-1
Chuangxin Road, Chuangxin Road, Hunnan District,
Shenyang 110167, Liaoning, China

Медицинское изделие

Система ультразвуковая 3300

Модель

3300 G

Предупреждения и знаки опасности

См.



Номинальный режим работы

Информация доступна на основном лейбле

Серийный номер

Информация доступна на основном лейбле

Дата производства

Информация доступна на основном лейбле

Регистрационное удостоверение

[В соответствии с Регистрационным
Удостоверением]

Label P/N: XXXXXXXXXXXXX



Макет маркировки системы ультразвуковой 3300 на русском языке, вариант исполнения 3300 G.

Всего пронумеровано,
прошнуровано и
скреплено печатью

34 листа (ов)

