



Фотографические изображения медицинского изделия

**«Анализатор портативный клеточный BD FACSPresto для подсчета CD4-лимфоцитов методом флуоресцентной фотомикроскопии в образцах цельной крови человека
(BD FACSPresto™ Near-Patient CD4 Counter), с принадлежностями»**

Производитель: Becton, Dickinson and Company, BD Biosciences
(«Бектон, Дикинсон энд Компани, БД Байосайенсиз»), США

Специалист по регистрации
медицинских изделий
ООО «Бектон Дикинсон Восток»



Вилкова Д.И.

Анализатор портативный клеточный BD FACSPresto (BD FACSPresto™ Near-Patient CD4 Counter).
Общий вид.



анализатор портативный клеточный BD FACSPresto (BD FACSPresto™ Near-Patient CD4 Counter).
Заводская маркировка прибора BD FACSPresto (пример).

Model:  **BD FACSPresto™**
Near-Patient CD4 Counter

REF

651000

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. This Class A digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference Causing Equipment Regulations.

Cet appareil numérique de classe A respecte toutes les exigences de Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.



2022-12-08

SN:

R65100050973

VDC:

18 V=

3.3 A

Power:

60 W




elfu.bd.com




 Becton, Dickinson and Company, BD Biosciences, 2350 Quire Drive San Jose, California 95131 USA
 Becton Dickinson Ireland Ltd., Donore Road, Drogheda, Co. Louth, A92 YW26, Ireland
 BD Switzerland Sàrl, Terre Bonne Park – A4, Route de Crassler 17, 1262 Eysins, Switzerland
BD, the BD Logo and FACSPresto are trademarks of Becton, Dickinson and Company or its affiliates. © 2022 BD. All rights reserved.

Made in USA
23-23890-00

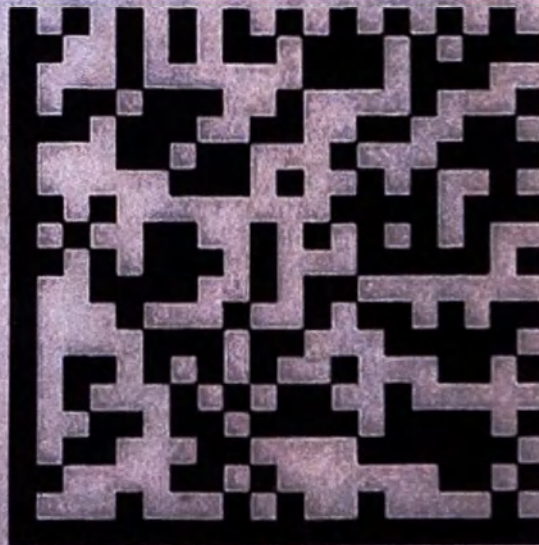

(01)00382906510006(11)221208(21)R65100050973



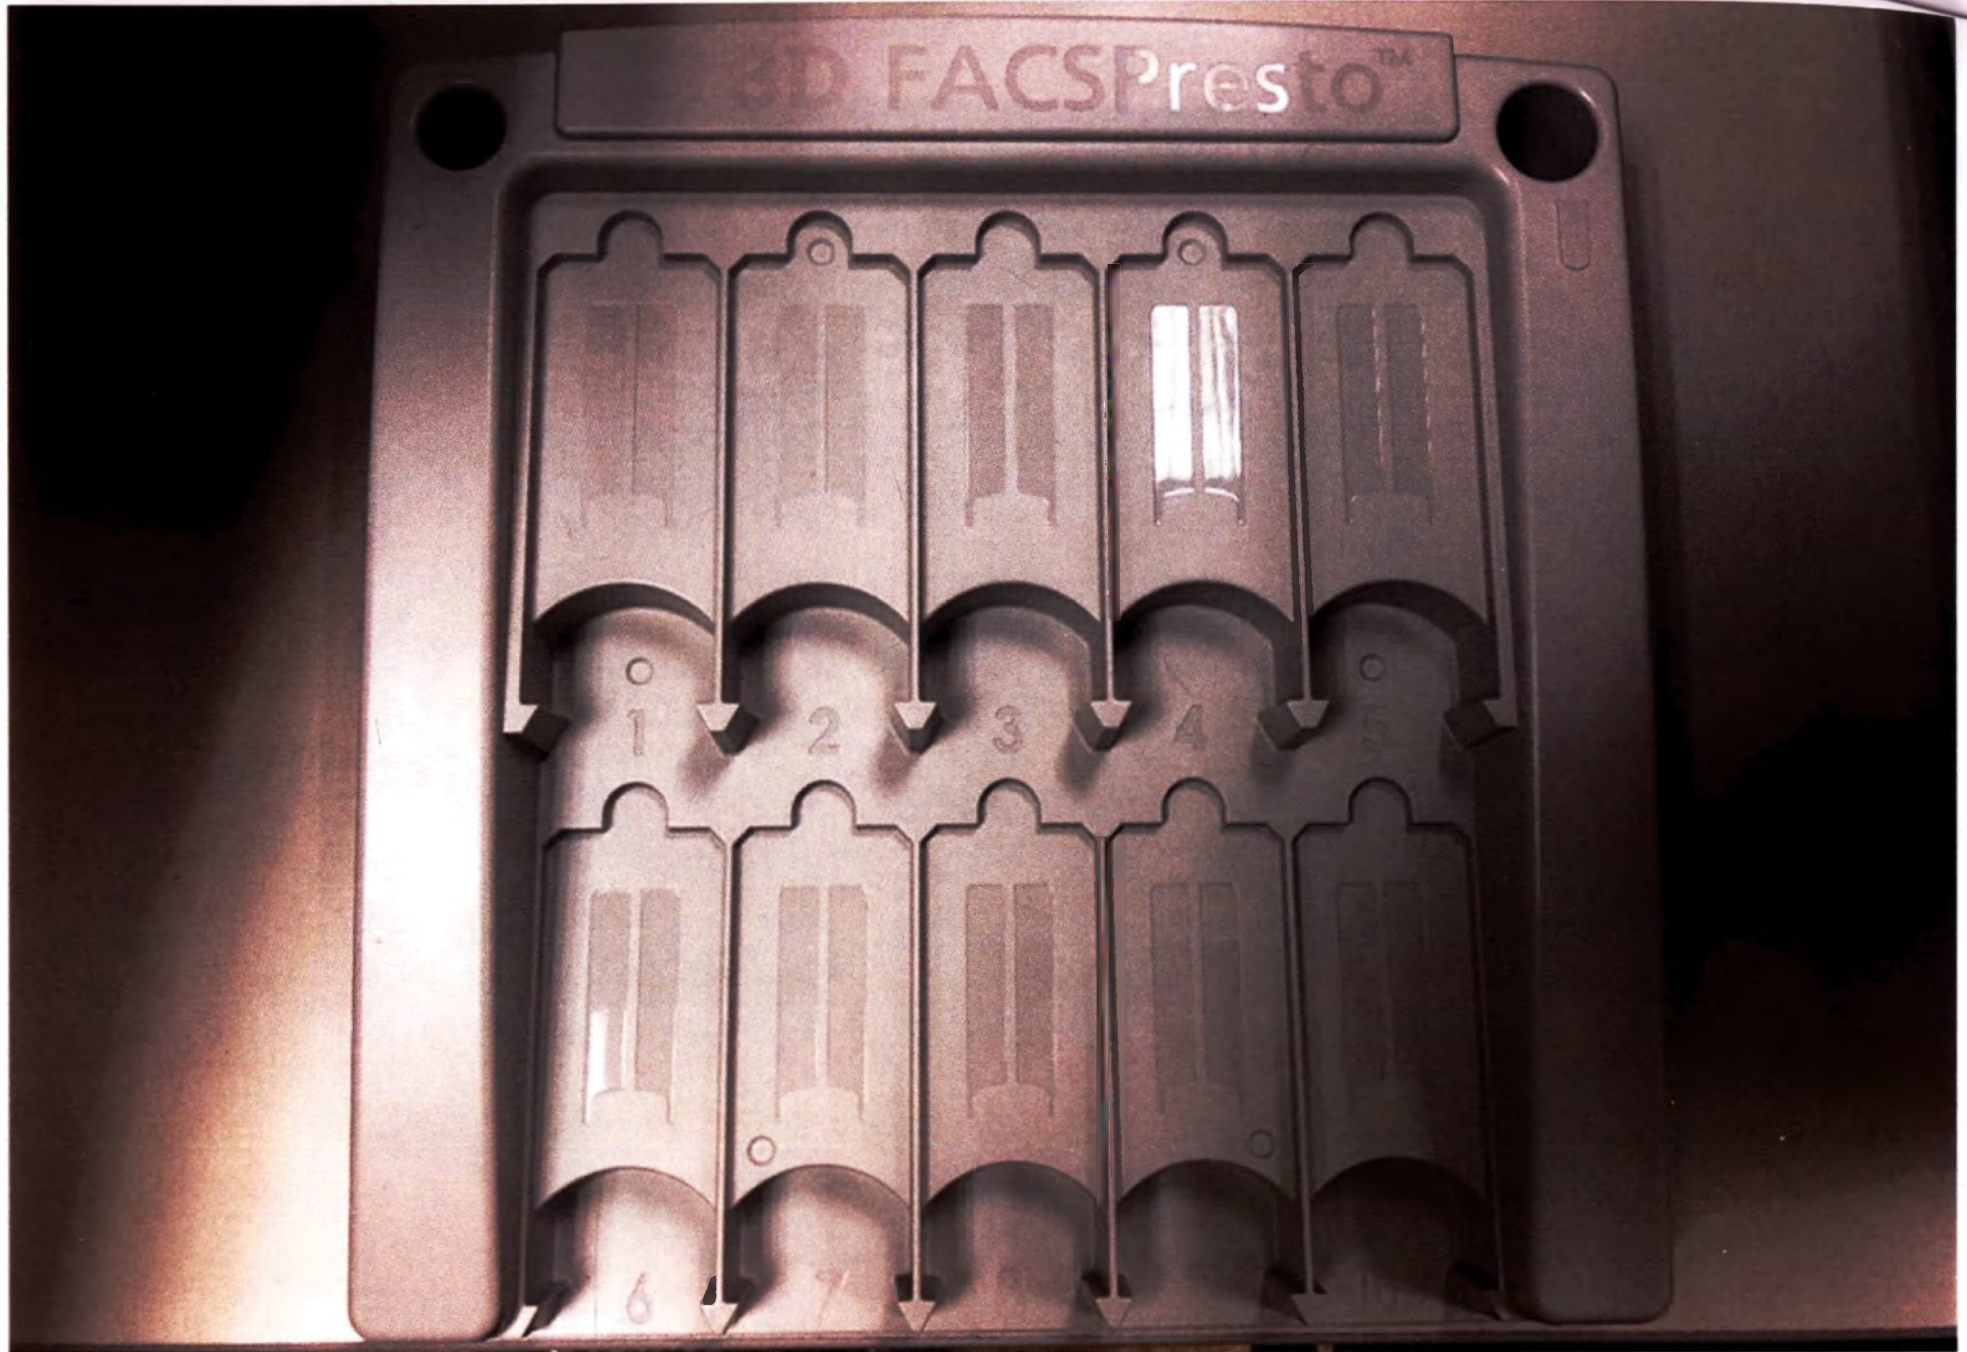



Кабели питания: Кабель питания, европейский (EU) стандарт, 250V 2.5A




Анализатор портативный клеточный BD FACSPresto для подсчета CD4-лимфоцитов методом флуоресцентной фотомикроскопии в образцах цельной крови человека (BD FACSPresto™ Near-Patient CD4 Counter).

Кабели питания: Кабель питания, индийский (India) стандарт, 250V 2.5A; Кабель питания, английский (UK) стандарт, 250V 2.5A; Кабель питания, американский (US) стандарт, 125V 7A



Анализатор портативный клеточный BD FACSPresto для подсчета CD4-лимфоцитов методом флуоресцентной фотомикроскопии в образцах цельной крови человека (BD FACSPresto™ Near-Patient CD4 Counter). Адаптер питания SL POWER / AULT, 18V 3.4A

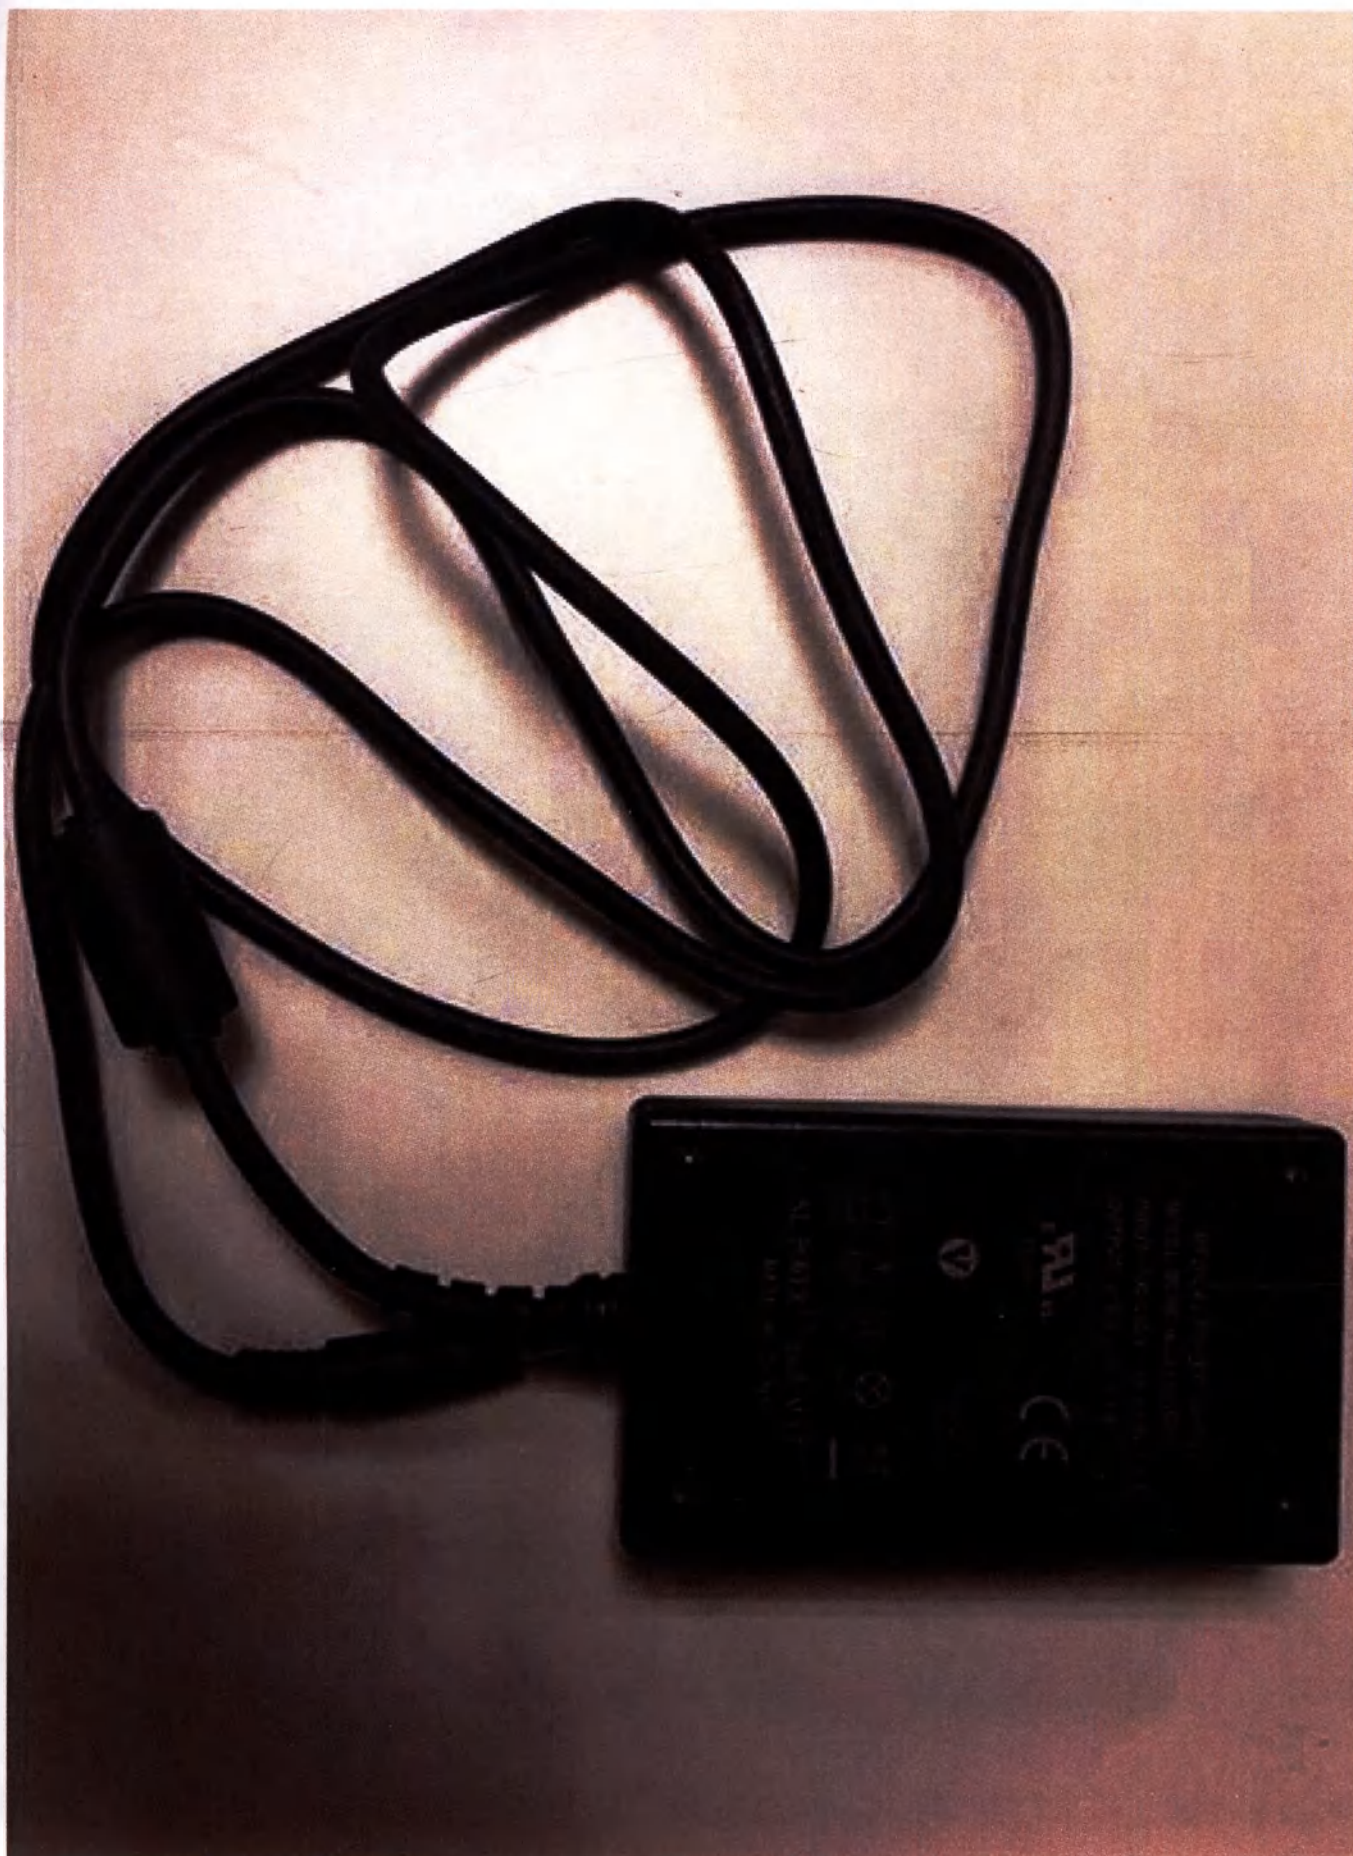

Анализатор портативный клеточный BD FACSPresto для подсчета CD4-лимфоцитов методом флуоресцентной фотомикроскопии в образцах цельной крови человека (BD FACSPresto™ Near-Patient CD4 Counter). USB-накопитель BD, 1 Гб



Анализатор портативный клеточный BD FACSPresto для подсчета CD4-лимфоцитов методом флуоресцентной фотомикроскопии в образцах цельной крови человека (BD FACSPresto™ Near-Patient CD4 Counter).
Термобумага для принтера 25 м x 58 мм (1 шт.)



Термобумага для принтера, 25 м x 58 мм (5 шт/уп)







Макет дополнительной маркировки на русском языке

Анализатор портативный клеточный BD FACSPresto для подсчета CD4-лимфоцитов методом флуоресцентной фотомикроскопии в образцах цельной крови человека (BD FACSPresto™ Near-Patient CD4 Counter), с принадлежностями (Страна происхождения - США)

Анализатор портативный клеточный BD FACSPresto для подсчета CD4-лимфоцитов методом флуоресцентной фотомикроскопии в образцах цельной крови человека (BD FACSPresto™ Near-Patient CD4 Counter), с принадлежностями

Производитель:

Becton, Dickinson and Company, BD Biosciences
(«Бектон, Дикинсон энд Компани, БД Байосайенсиз»)
2350 Qume Drive, San Jose, California, 95131
(2350 Кьюм Драйв, Сан-Хосе, Калифорния, 95131), США

Страна происхождения:

Сделано в США

Номер по каталогу **REF**: см. на заводской маркировке

Серийный номер **SN**: см. на заводской маркировке

Условия эксплуатации:

Температура от +10°C до +40°C,
влажность от 10%-95% (без конденсации).

Не допускайте эксплуатацию прибора рядом с работающим
вortexом, центрифугой или микроцентрифугой.

Условия хранения без эксплуатации:

Температура от 0°C до +50°C,
влажность от 10%-95% (без конденсации).



Входные параметры электропитания: 3.3 А, 18,5 В ±1 В (пост.ток)

Потребляемая мощность прибора: 60 Вт

Уполномоченный представитель производителя:

ООО «Бектон Дикинсон Восток»
127051 Российская Федерация, Москва, ул. Садовая-Самотечная, 24/27,
2 этаж, помещение I, комната 18
Тел.: +7 (495) 775-85-82; e-mail: complaints_CIS@bd.com

Регистрационное Удостоверение № _____ от ДД.ММ.ГГГГ

Информацию на русскоязычном стикере просим считать приоритетной при поставке в РФ

XXXXXX

EAC XXXXXX
XXXX&XXXX

Макет дополнительной маркировки на русском языке

Анализатор портативный клеточный BD FACSPresto для подсчета CD4-лимфоцитов методом флуоресцентной фотомикроскопии в образцах цельной крови человека (BD FACSPresto™ Near-Patient CD4 Counter), с принадлежностями (Страна происхождения - Сингапур)

Анализатор портативный клеточный BD FACSPresto для подсчета CD4-лимфоцитов методом флуоресцентной фотомикроскопии в образцах цельной крови человека (BD FACSPresto™ Near-Patient CD4 Counter), с принадлежностями

Производитель:

Becton, Dickinson and Company, BD Biosciences
(«Бектон, Дикинсон энд Компани, БД Байосайенсиз»)
2350 Qume Drive, San Jose, California, 95131
(2350 Кьюм Драйв, Сан-Хосе, Калифорния, 95131), США

Страна происхождения:

Сделано в Сингапуре

Номер по каталогу **REF** : см. на заводской маркировке

Серийный номер **SN** : см. на заводской маркировке

Условия эксплуатации:

Температура от +10°C до +40°C,
влажность от 10%-95% (без конденсации).
Не допускайте эксплуатацию прибора рядом с работающим
вortexом, центрифугой или микроцентрифугой.

Условия хранения без эксплуатации:

Температура от 0°C до +50°C,
влажность от 10%-95% (без конденсации).



Входные параметры электропитания: 3.3 А, 18,5 В ±1 В (пост.ток)

Потребляемая мощность прибора: 60 Вт

Уполномоченный представитель производителя:

ООО «Бектон Дикинсон Восток»
127051 Российская Федерация, Москва, ул. Садовая-Самотечная, 24/27,
2 этаж, помещение I, комната 18
Тел.: +7 (495)775-85-82; e-mail: complaints_CIS@bd.com

Регистрационное Удостоверение № _____ от ДД.ММ.ГГГГ

Информацию на русскоязычном стикере просим считать приоритетной при поставке в РФ

XXXXXX

EAC XXXXXX
XXXX&XXXX