

**Фотографические изображения медицинского изделия
«Система потолочная медицинская «Ambia» с
принадлежностями»**

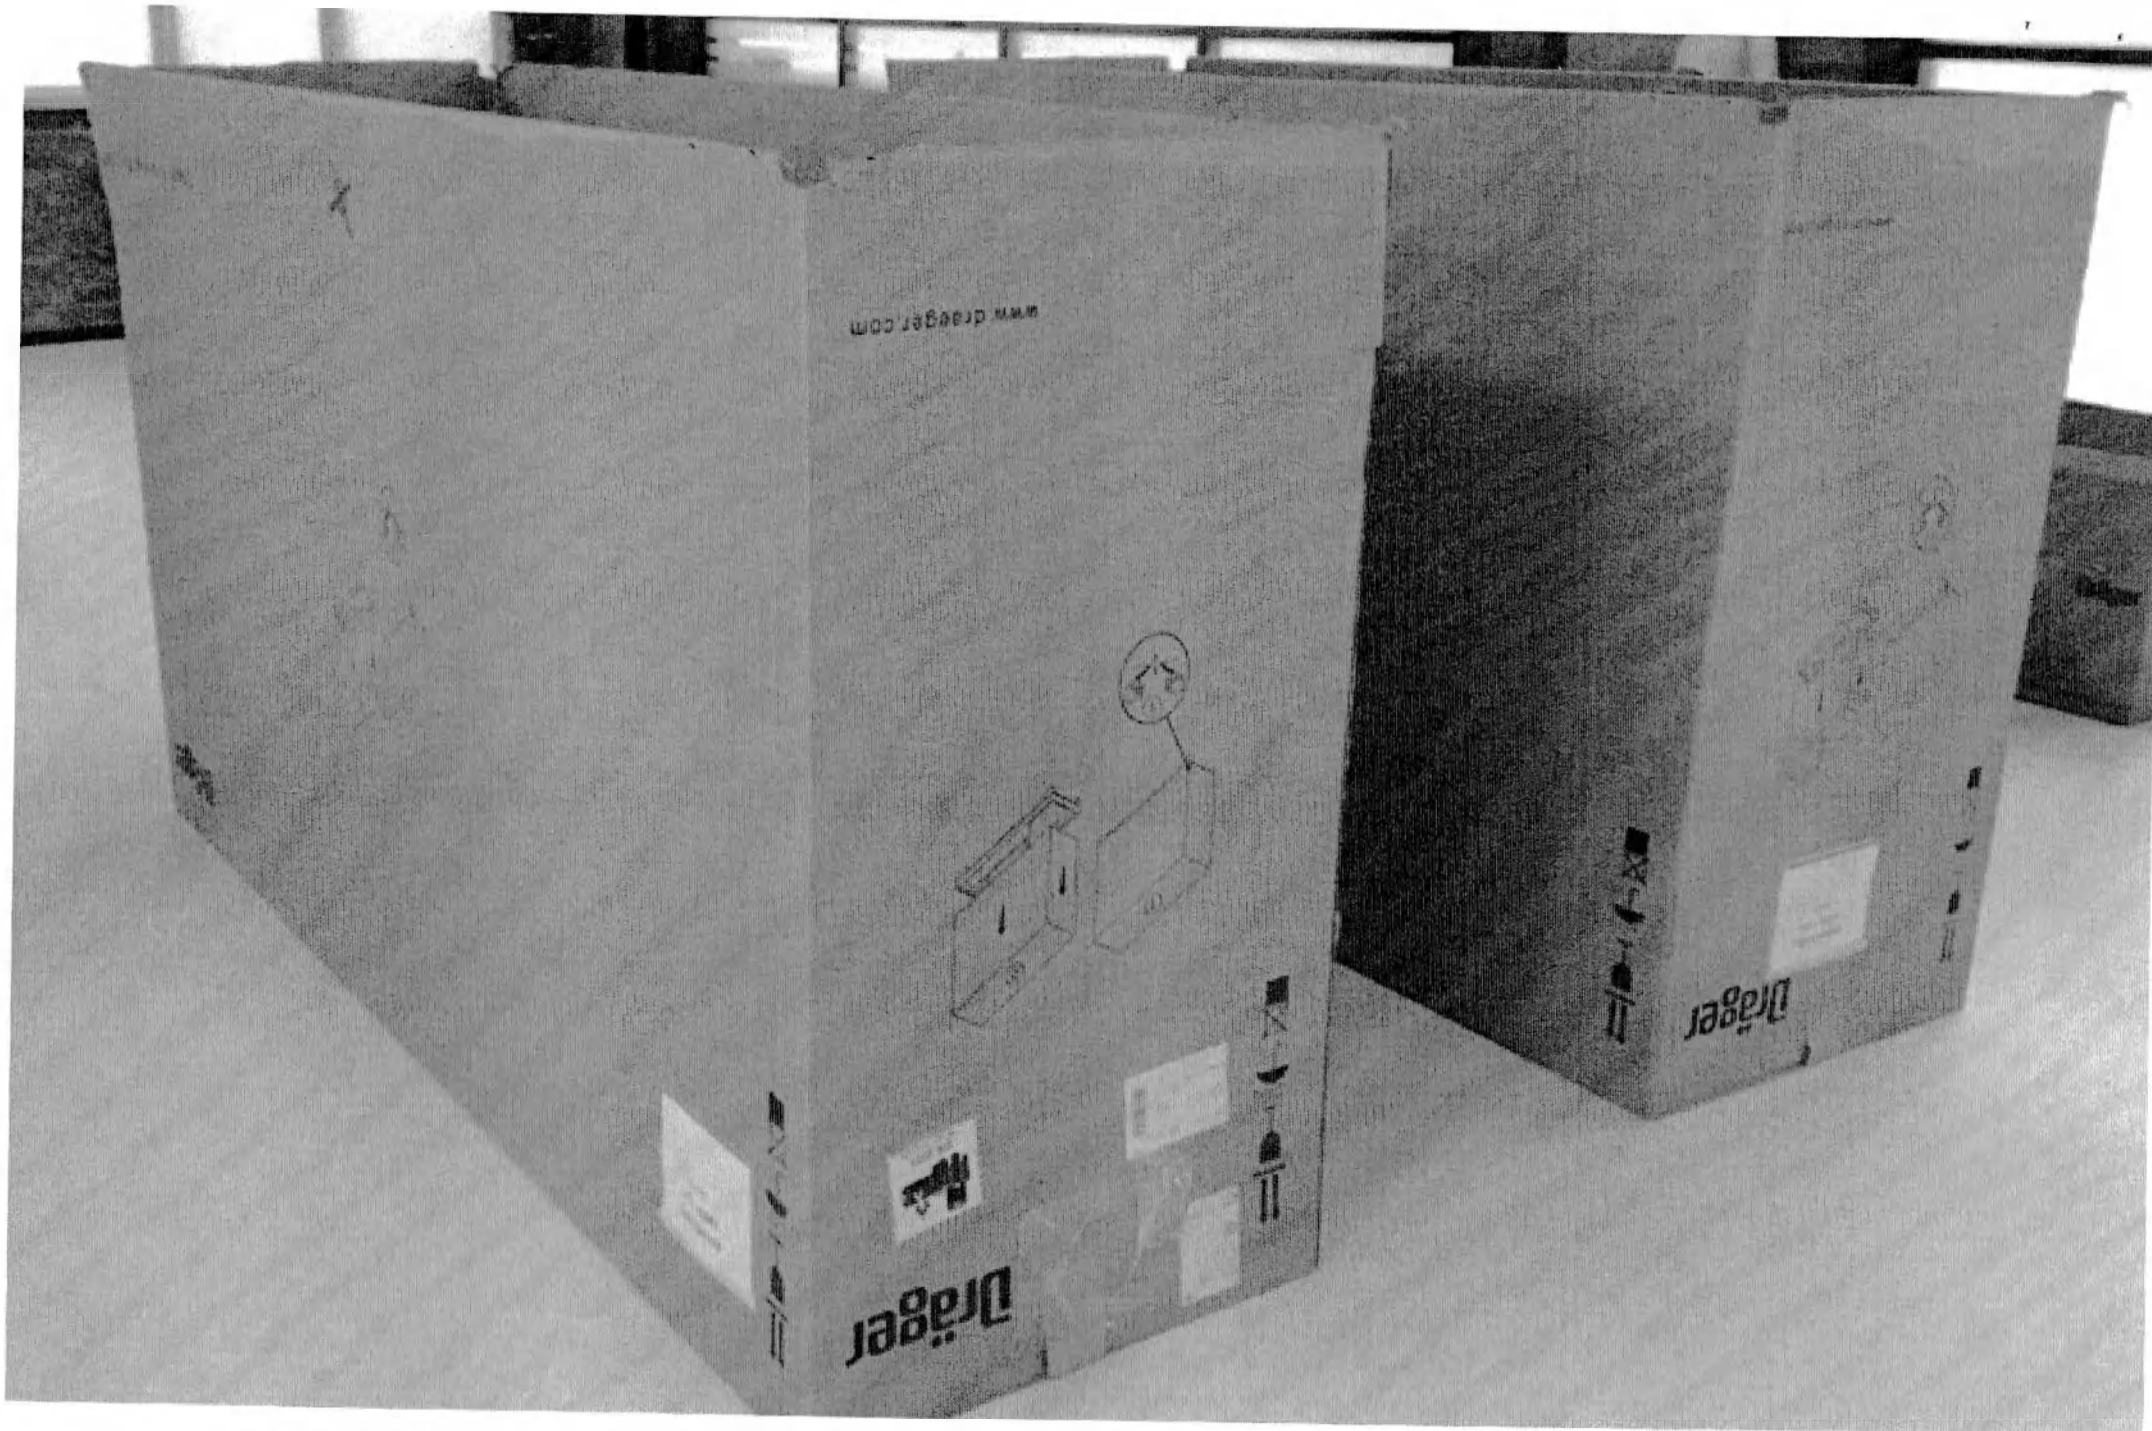


Рисунок 1. Общий вид упаковки на медицинское изделие «Система потолочная медицинская «Ambia» с принадлежностями»

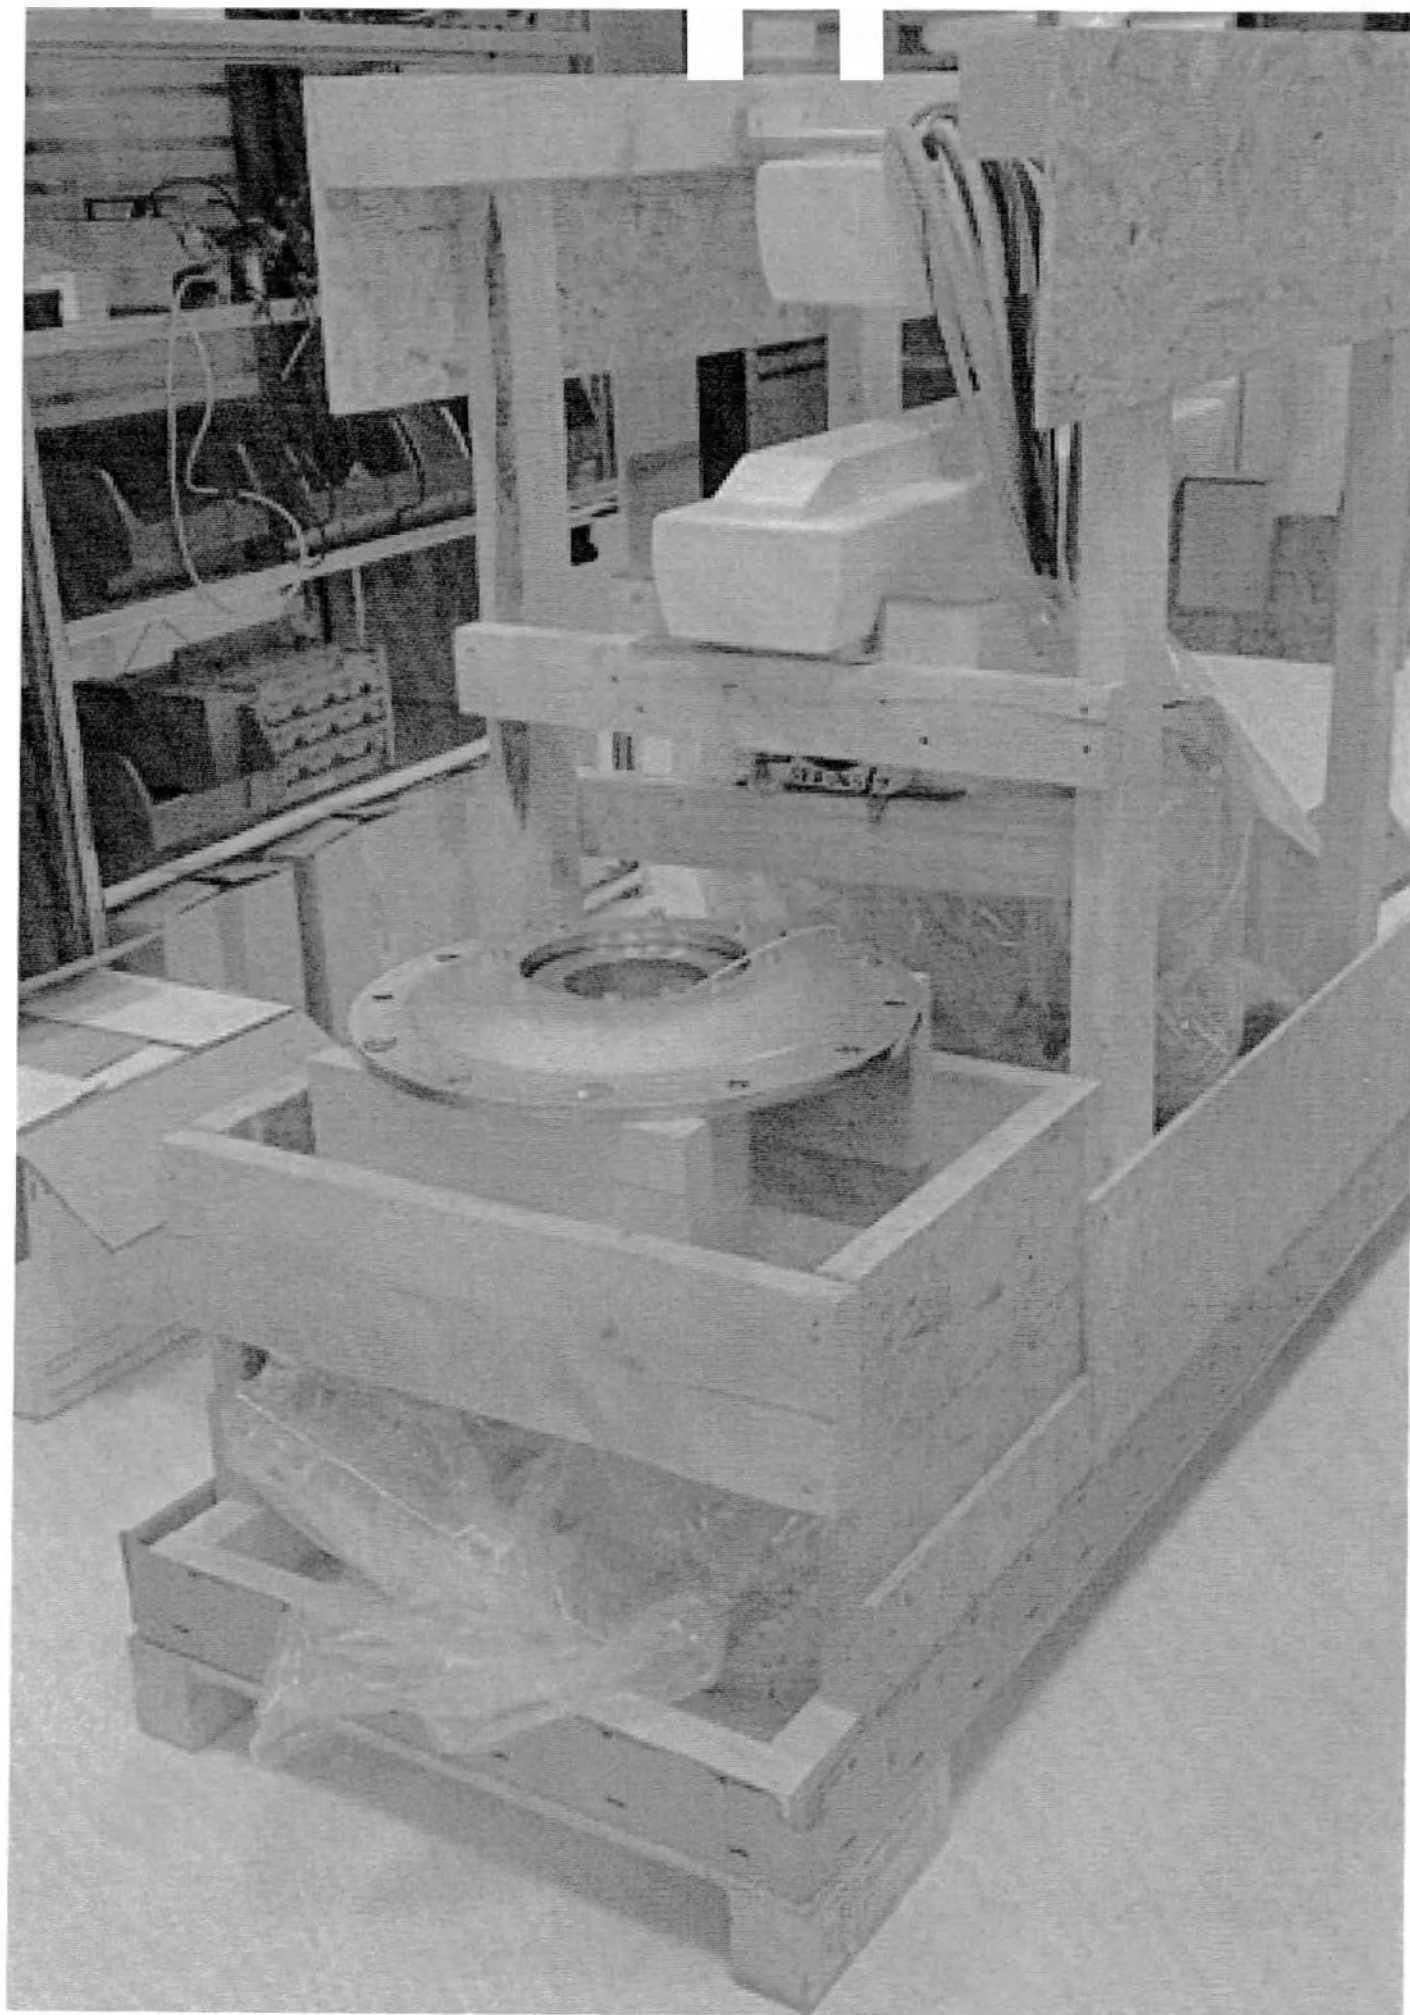


Рисунок 2. Общий вид упакованного медицинского изделия (без коробки)

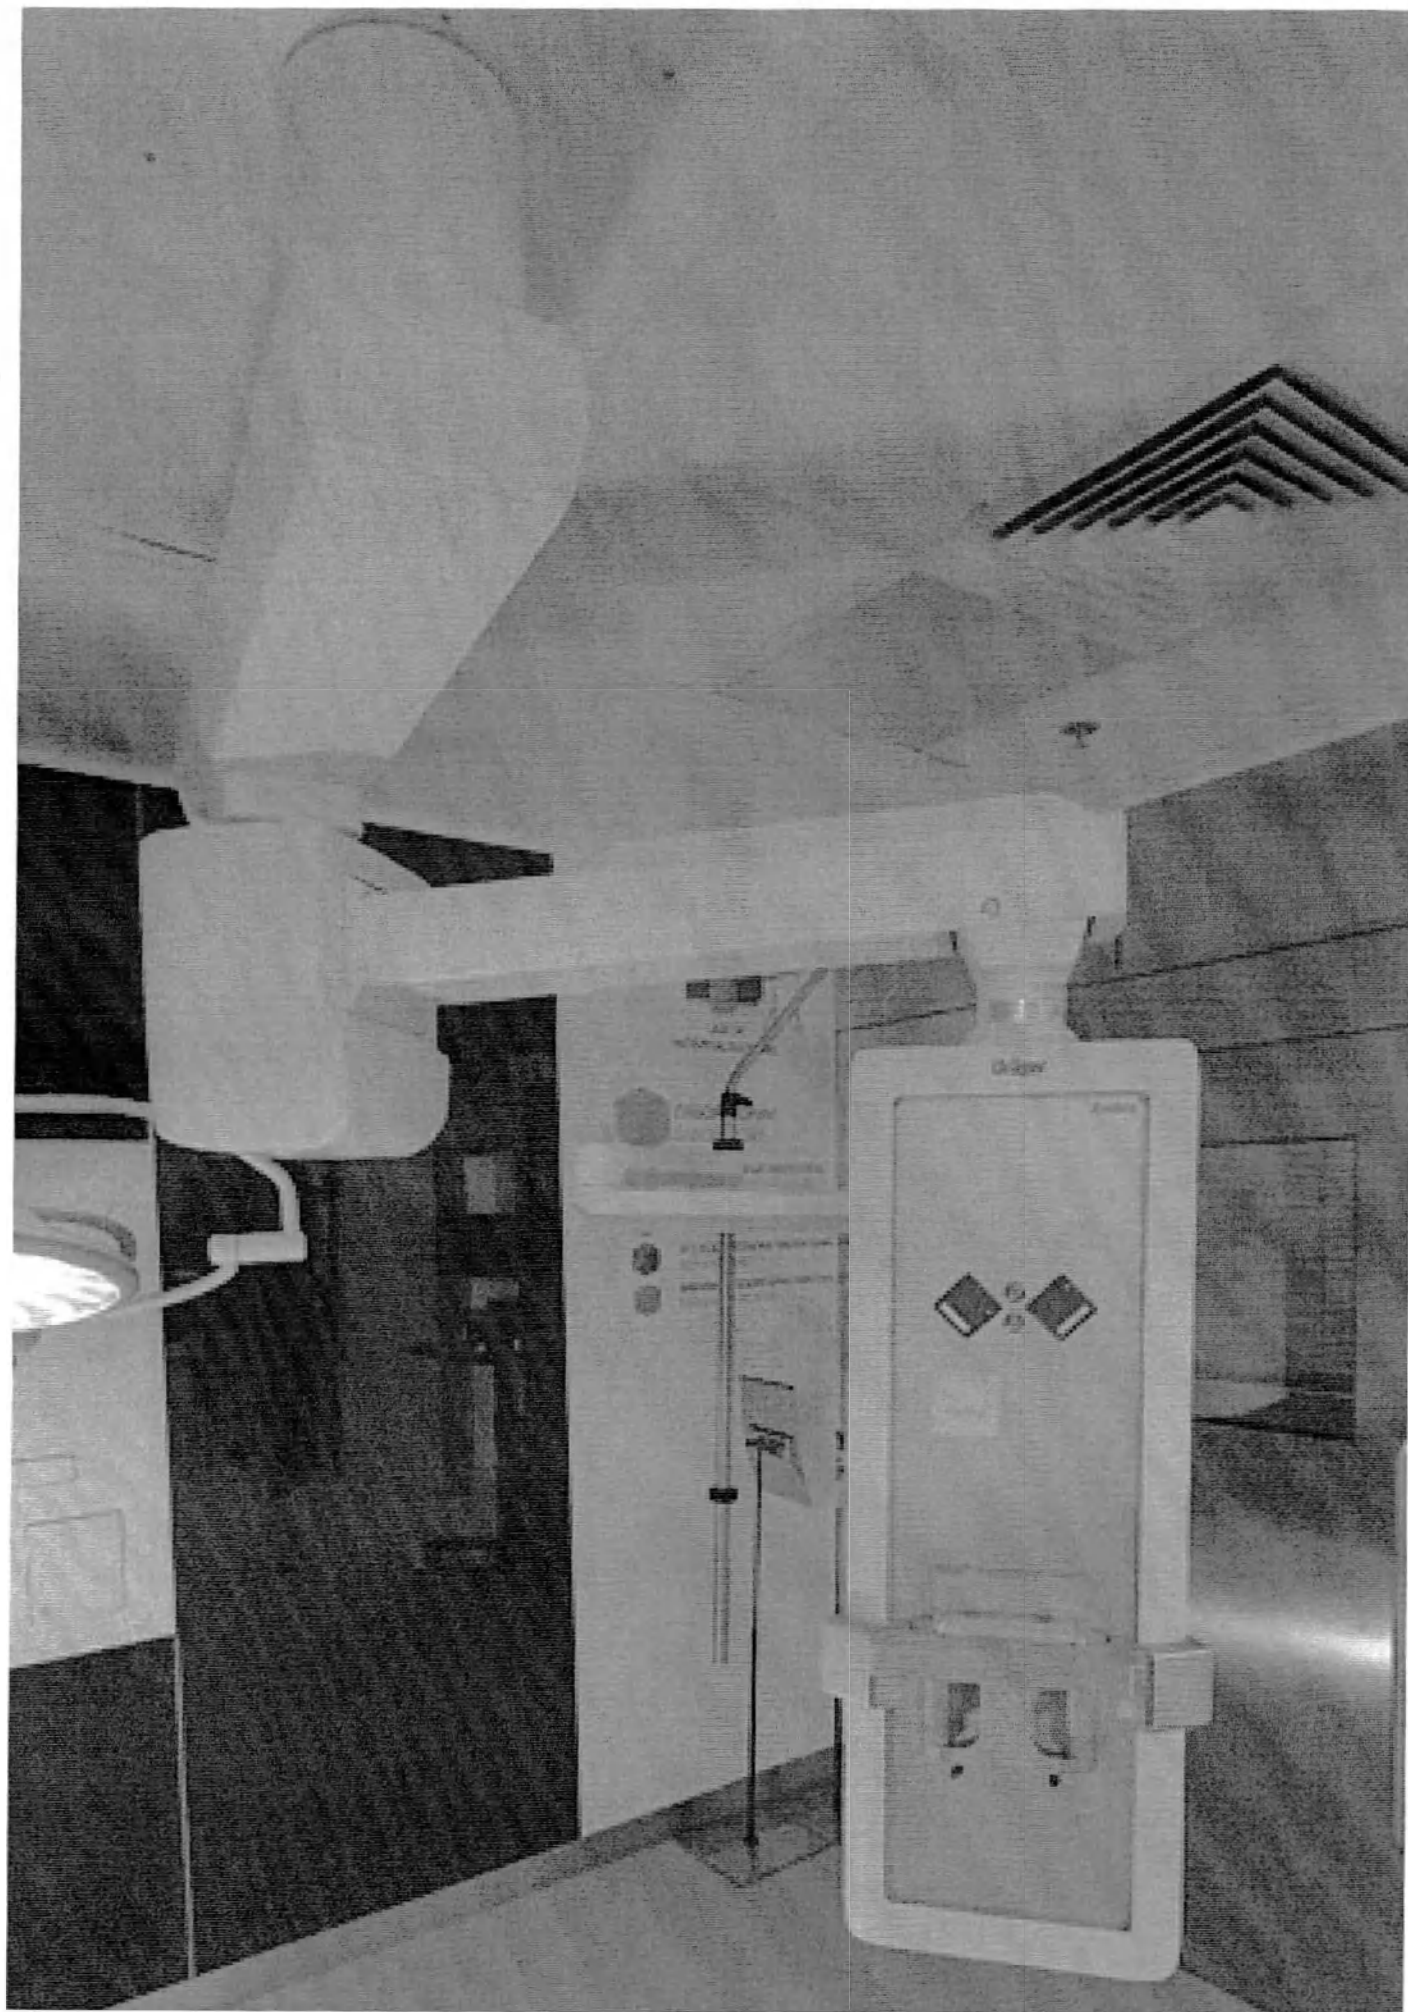


Рисунок 3. Общий вид изделия



Рисунок 4. Общий вид изделия с боковой стороны

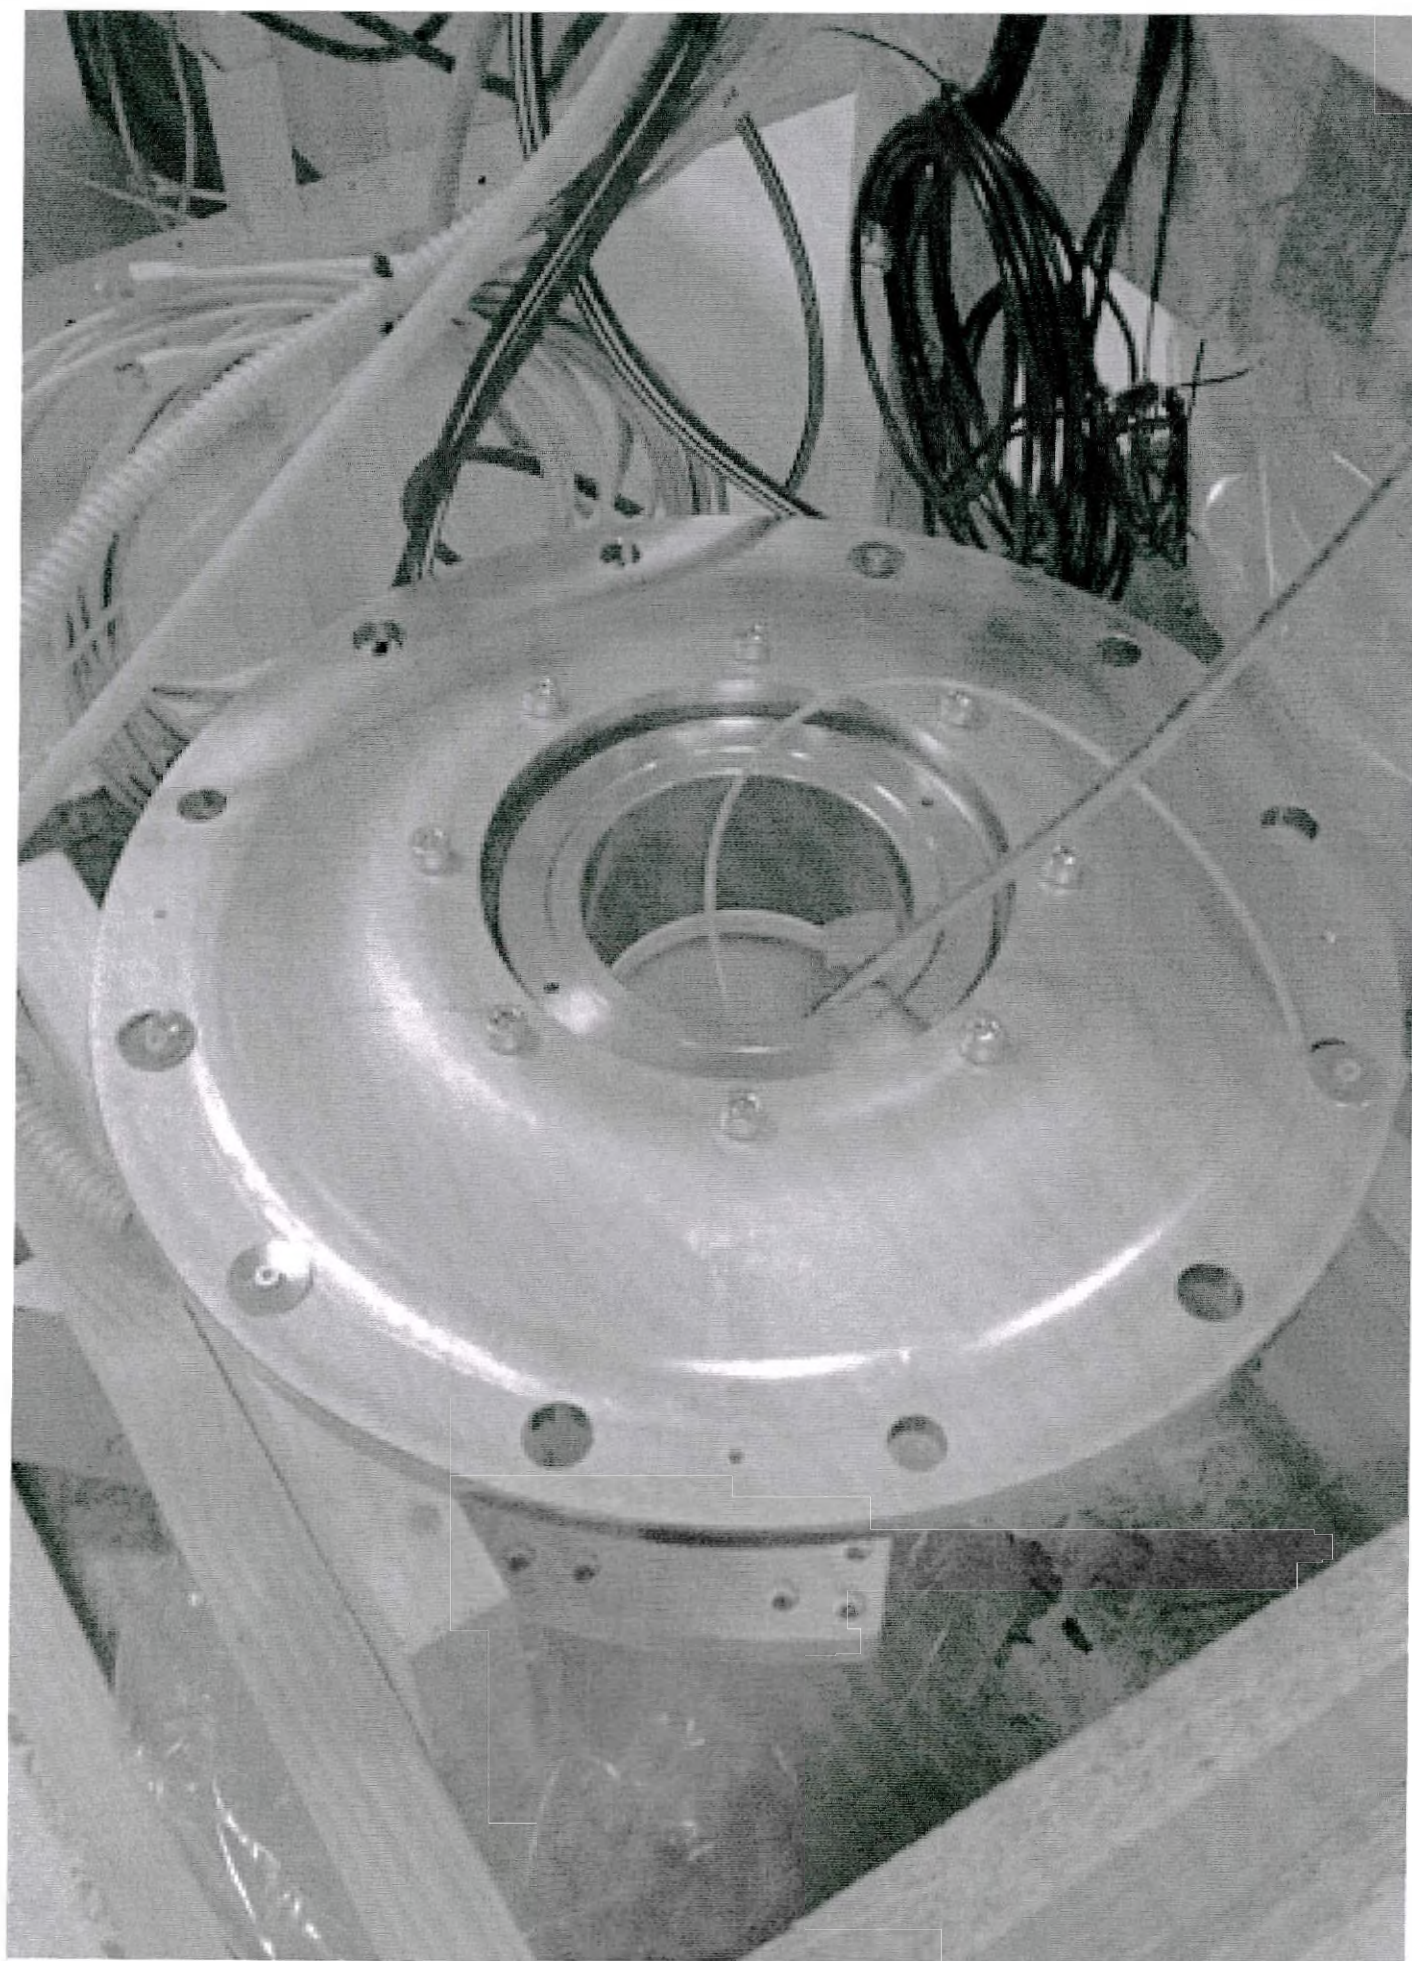


Рисунок 5. Крепление потолочное

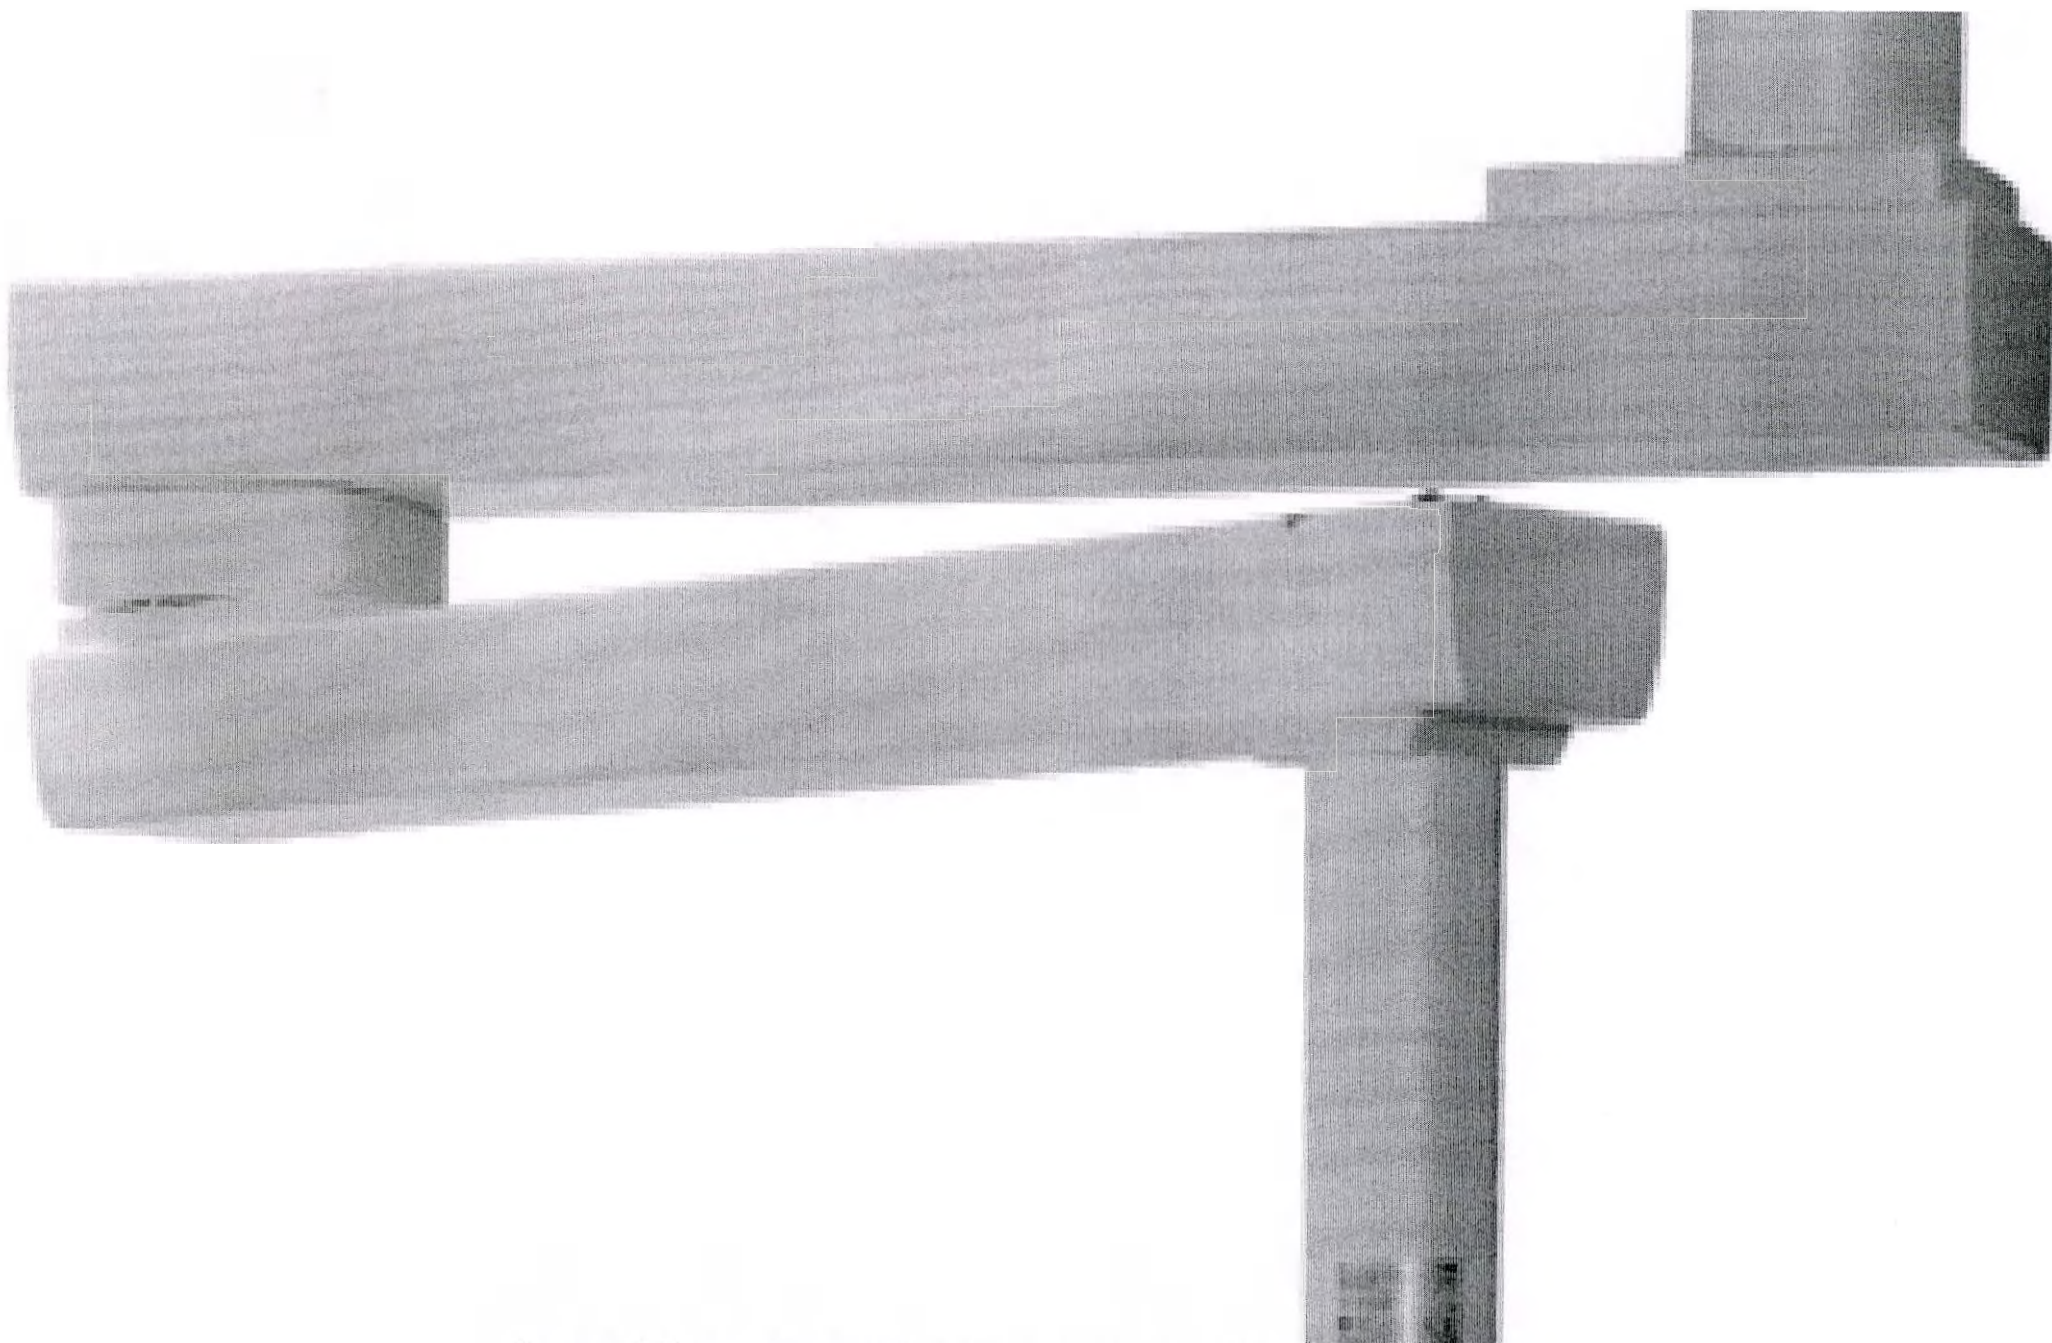


Рисунок 6. Несущий кронштейн на примере двойного несущего кронштейна

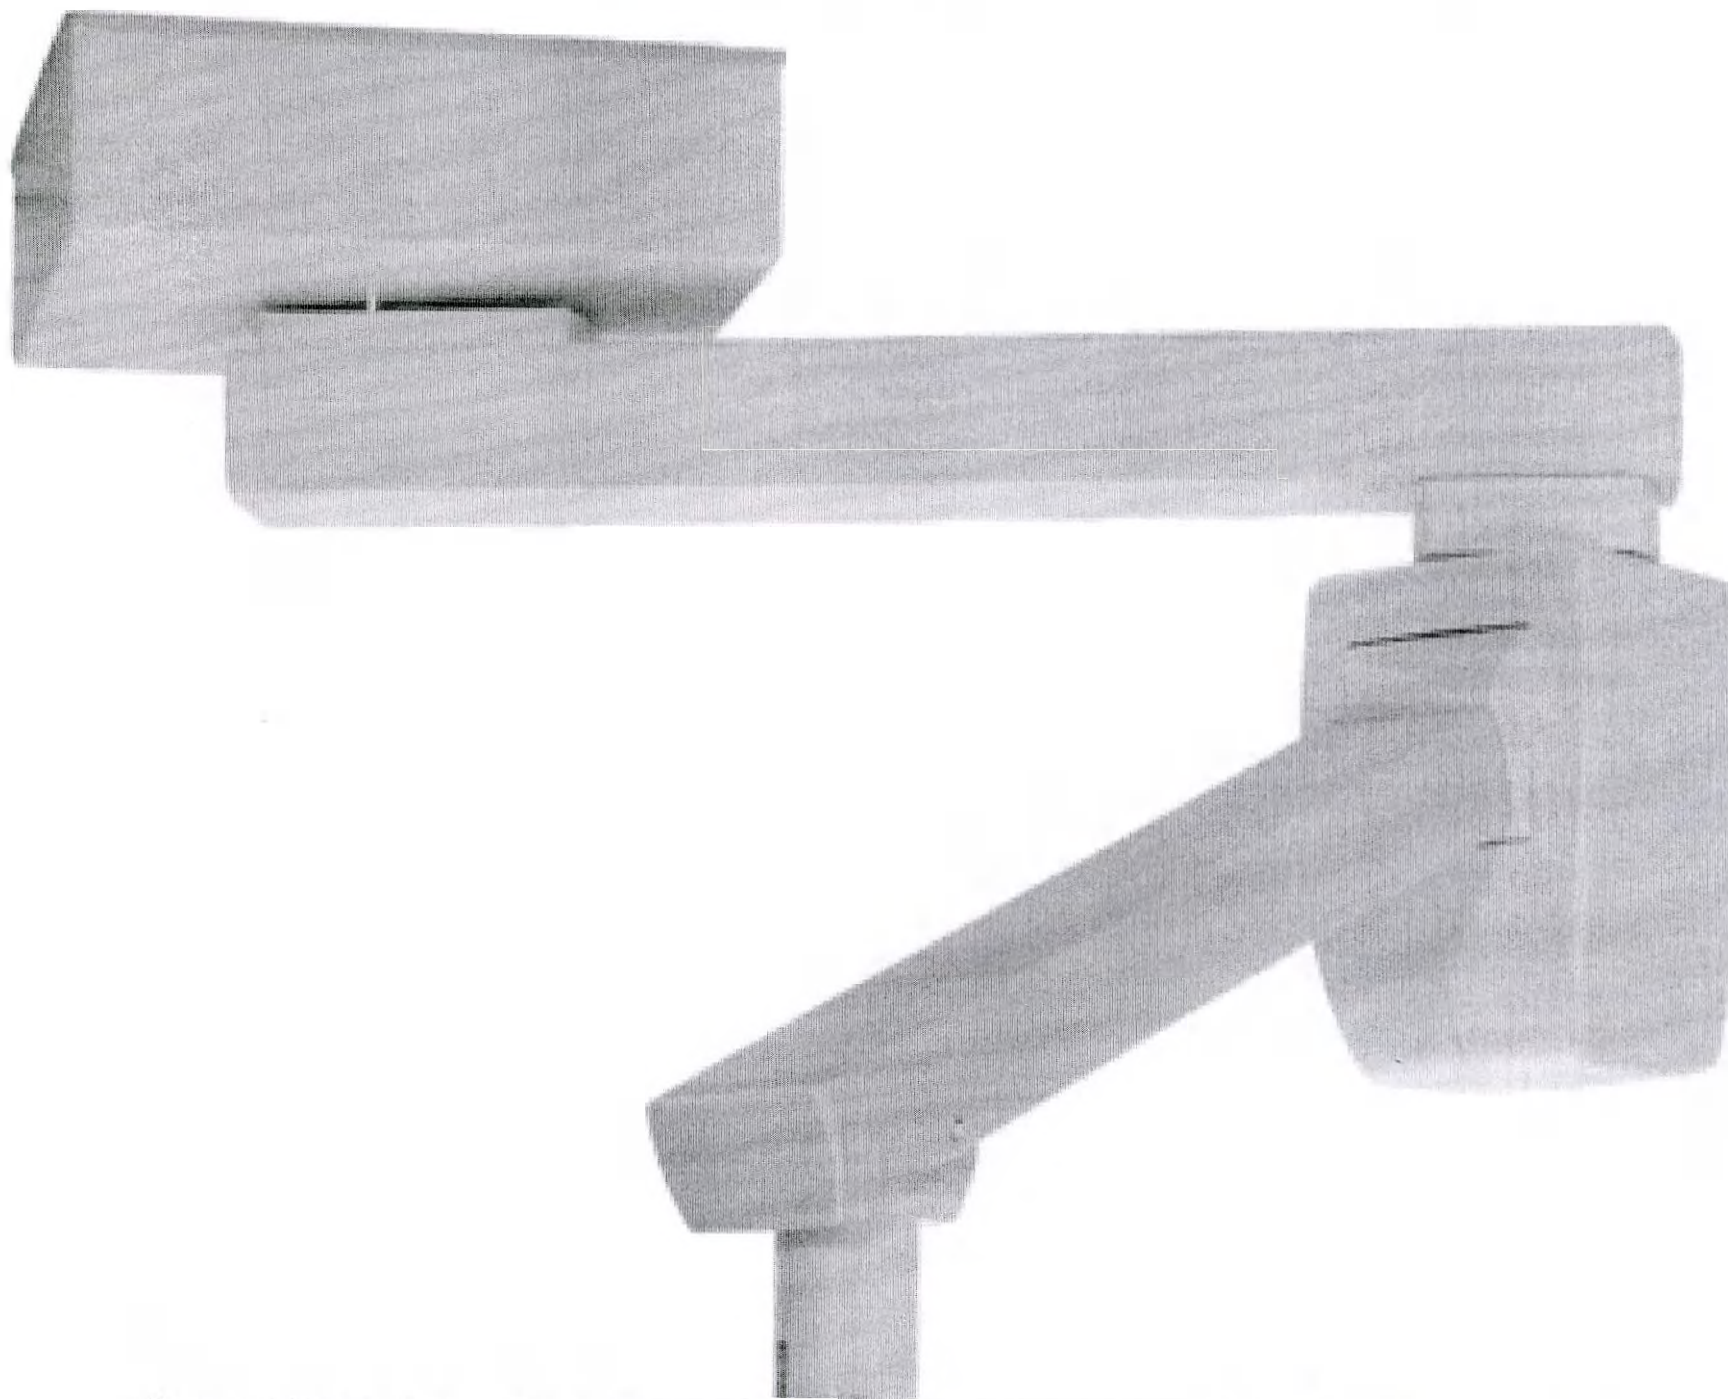


Рисунок 7. Несущий кронштейн с электрической регулировкой высоты на примере двойного несущего кронштейна

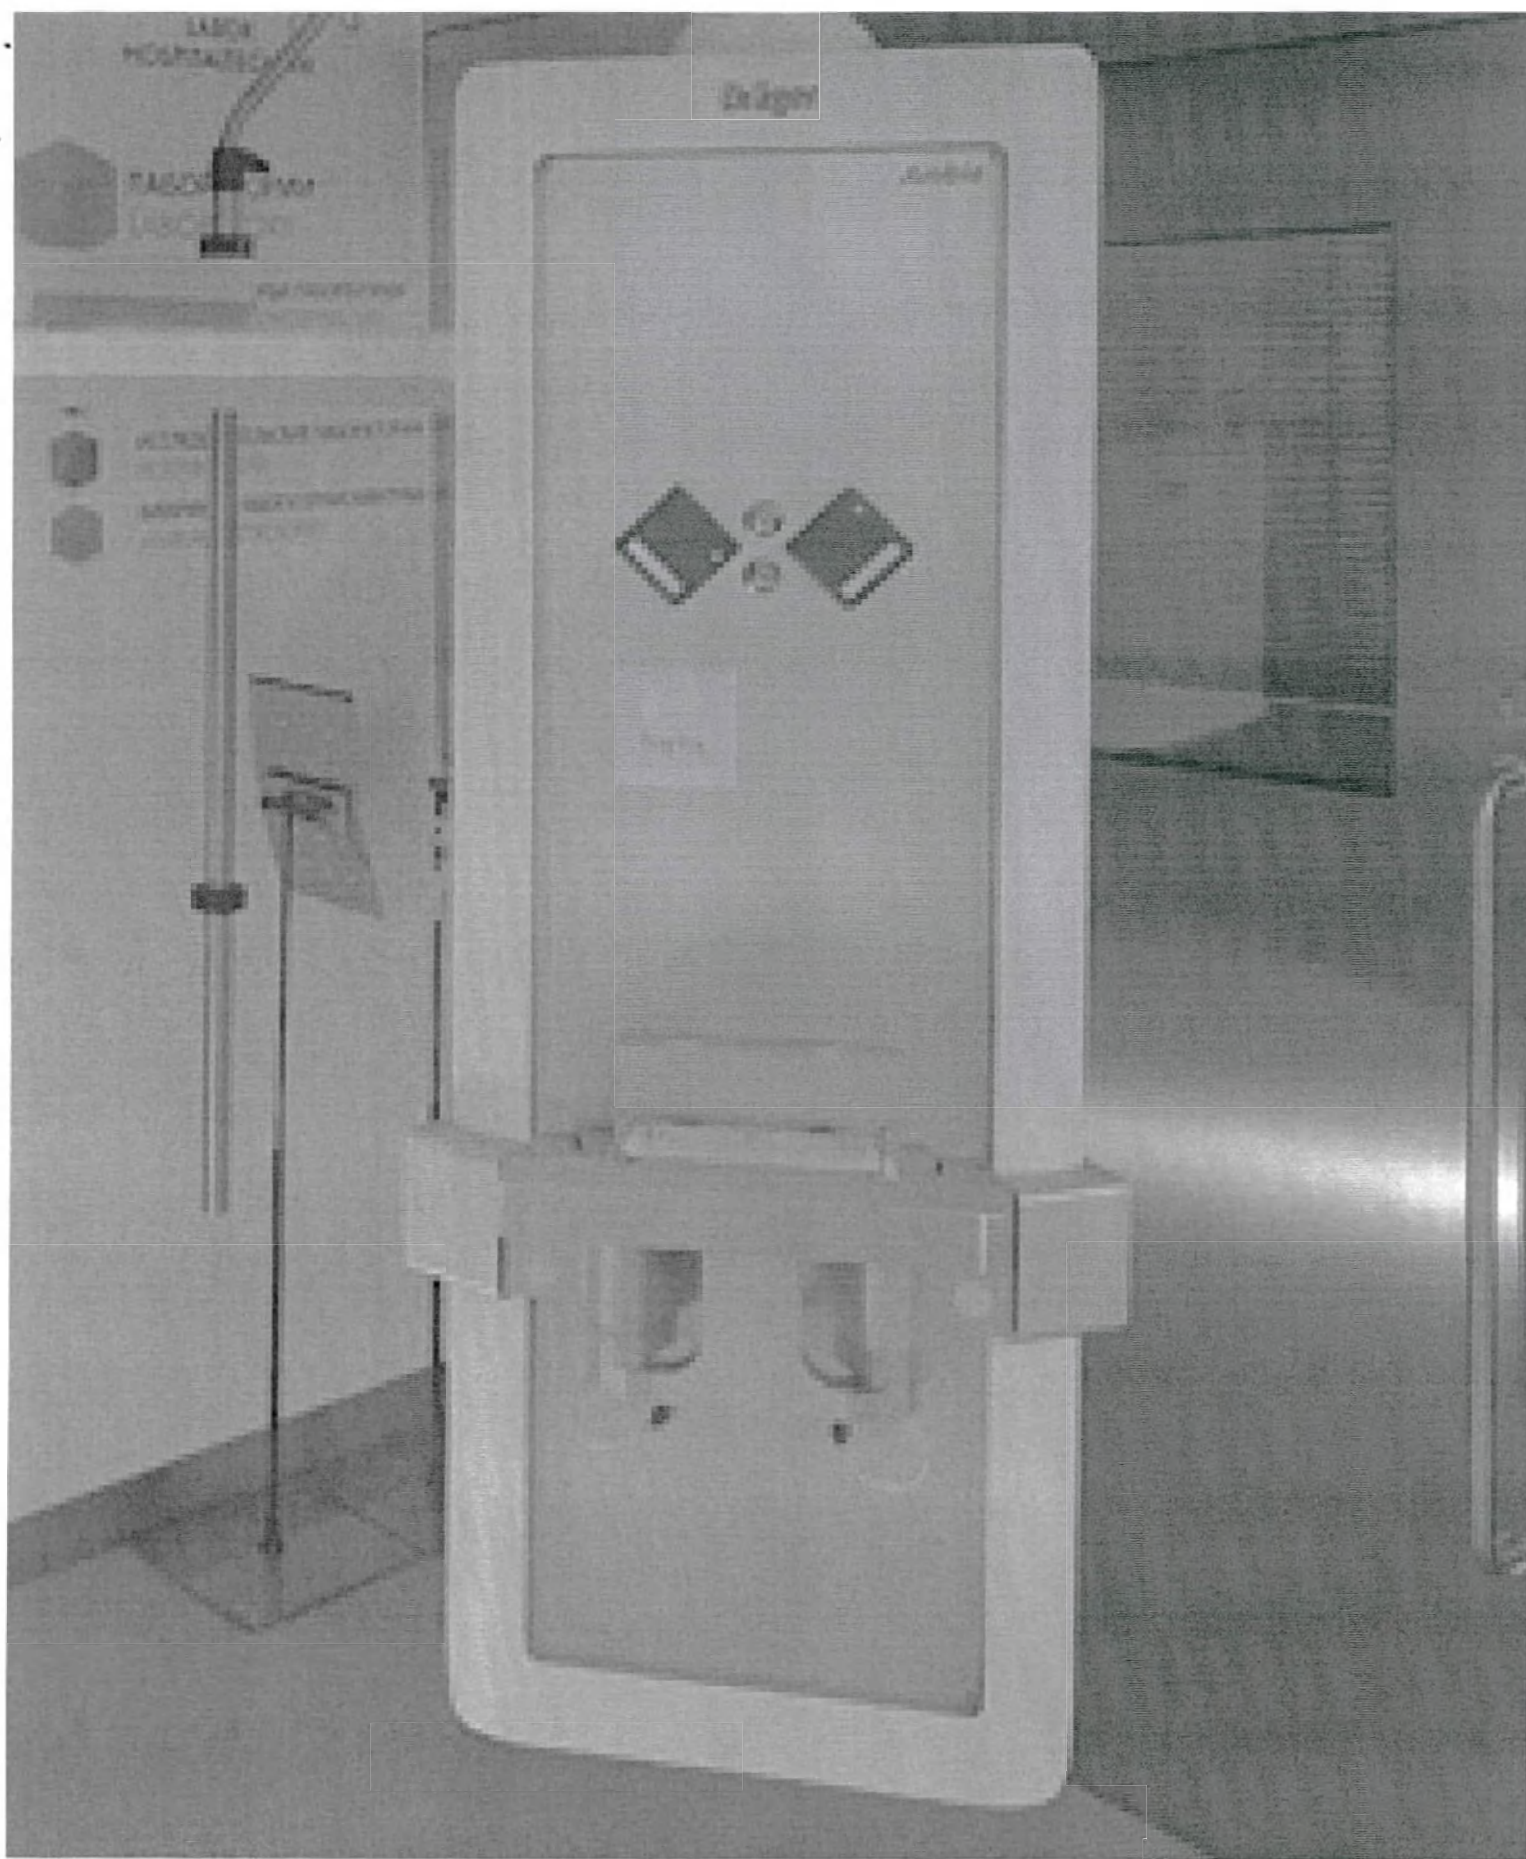


Рисунок 8. Подвесной блок для подключения рабочих сред и размещения принадлежностей, вертикальный на примере размера L



Рисунок 9. Подвесной блок для подключения рабочих сред и размещения принадлежностей, горизонтальный на примере размера L

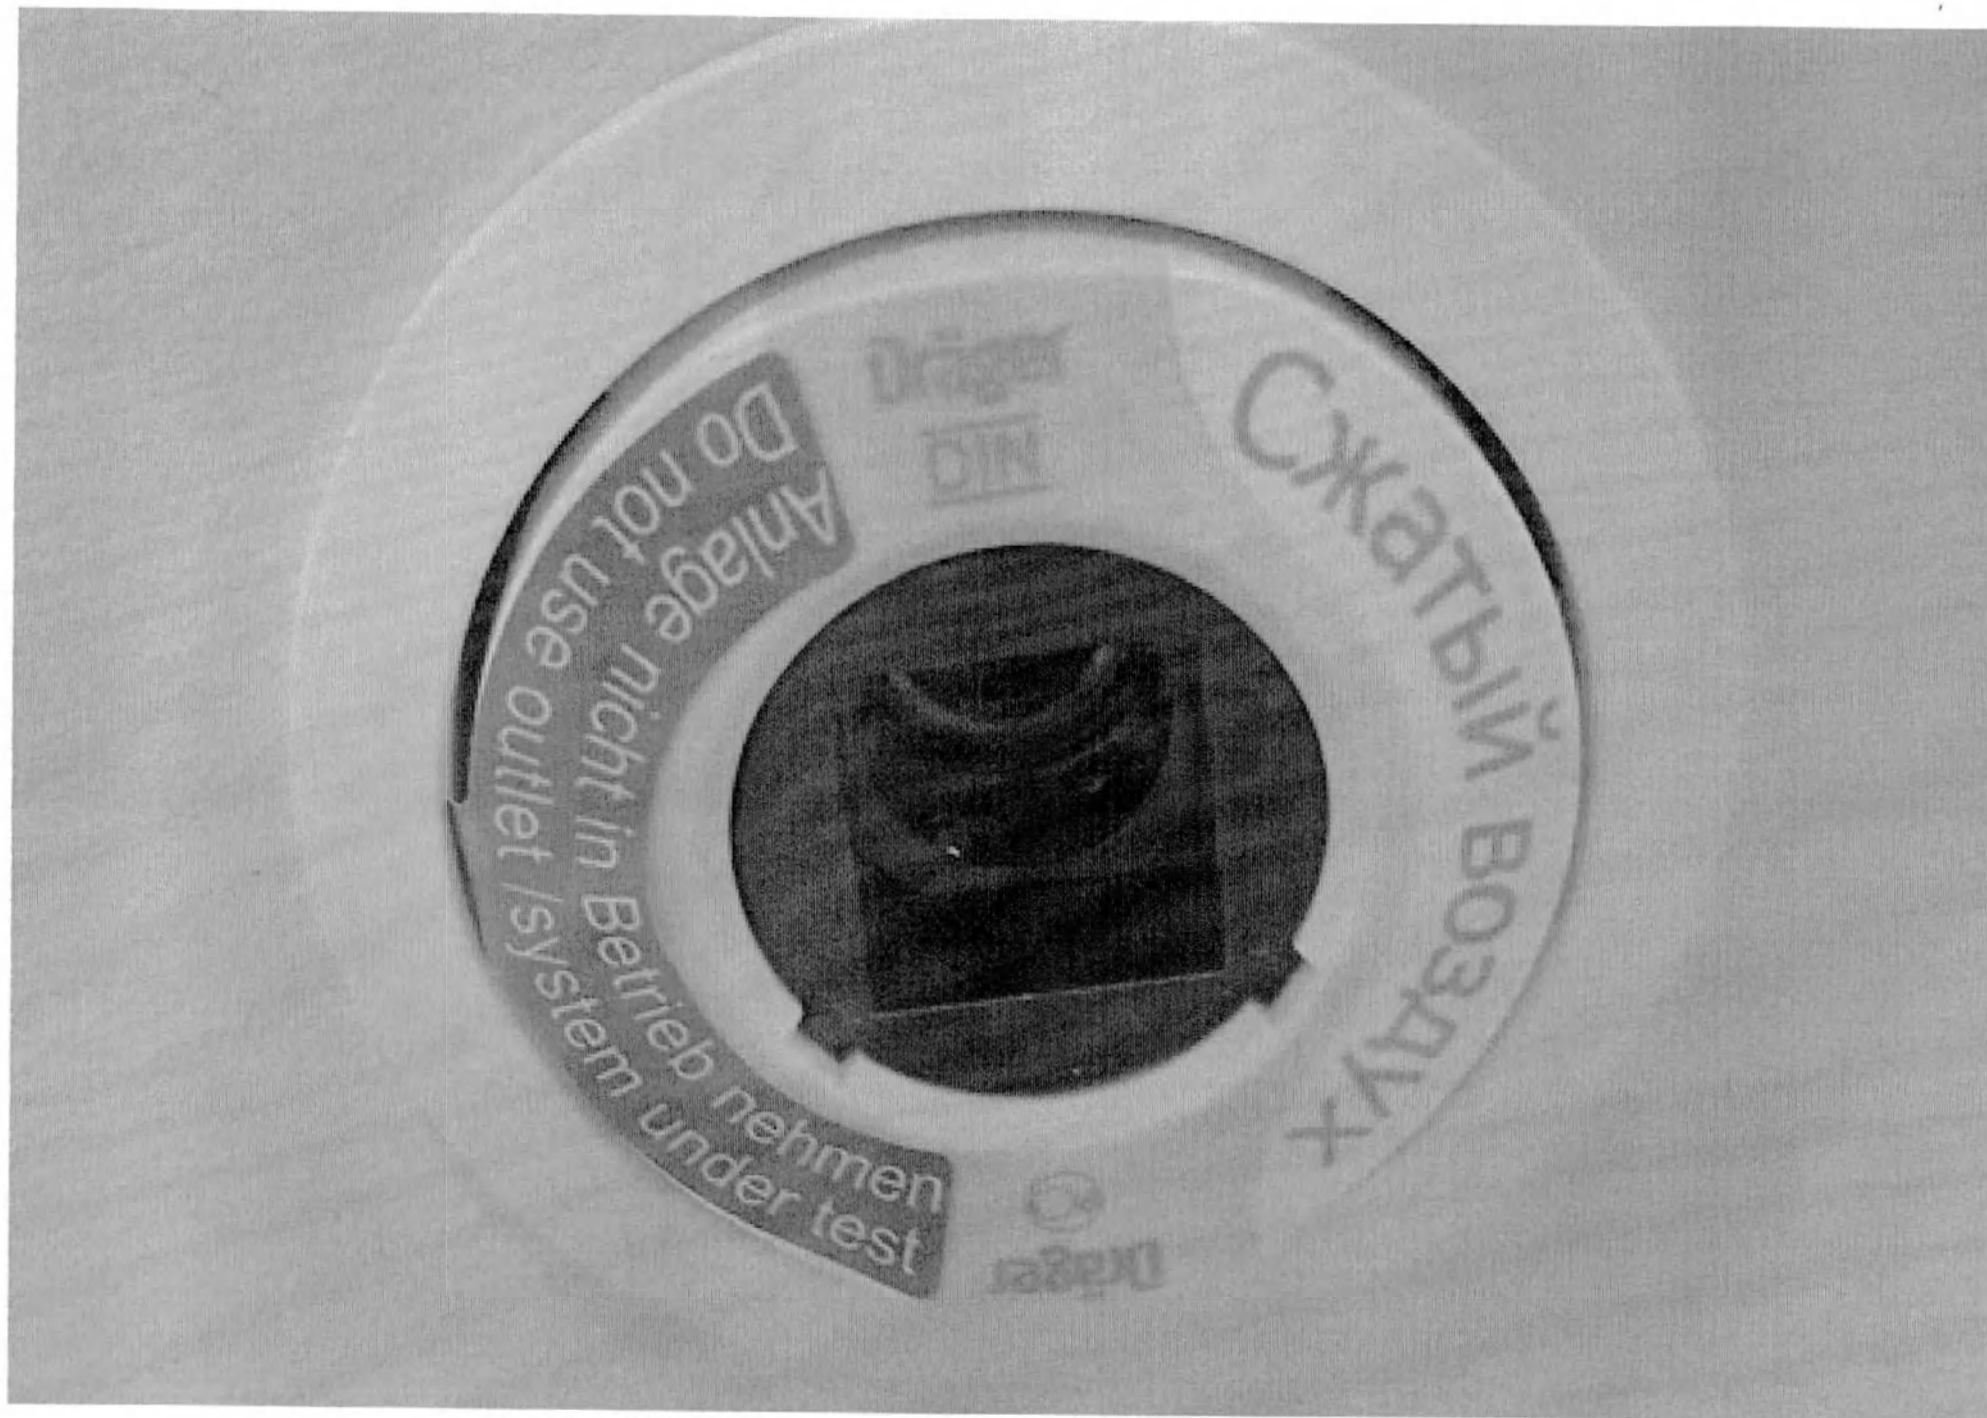


Рисунок 10. Газовый разъем для подачи медицинского газа: сжатый воздух



Рисунок 11. Газовый разъем для подачи медицинского газа: кислород



Рисунок 12. Газовый разъем для подачи медицинского газа: закись азота

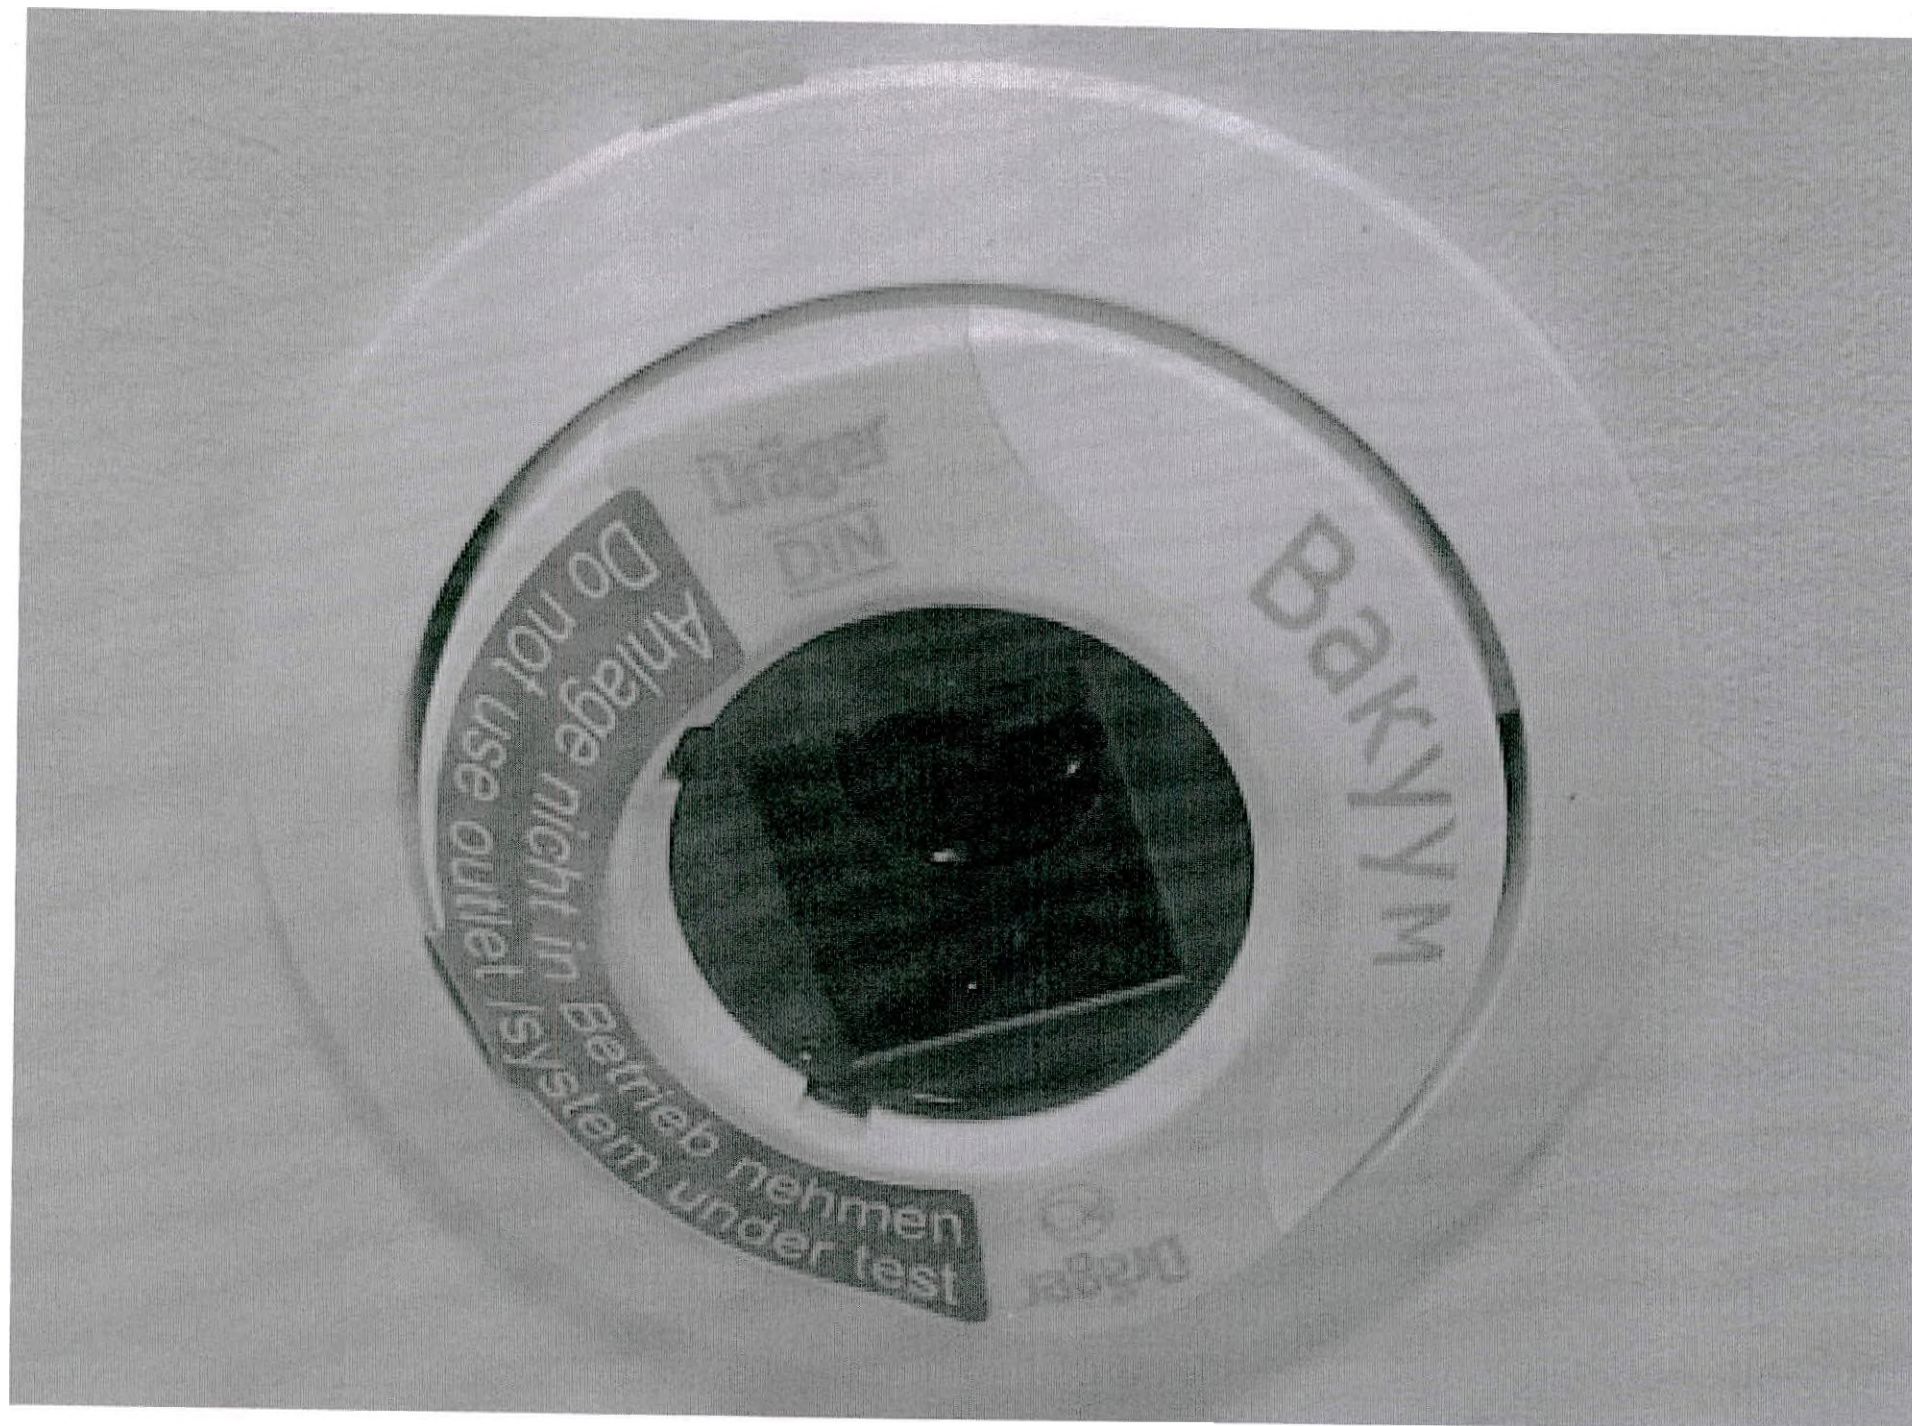


Рисунок 13. Газовый разъем для подачи вакуума



Рисунок 14. Газовый разъем для подачи медицинского газа: диоксид углерода

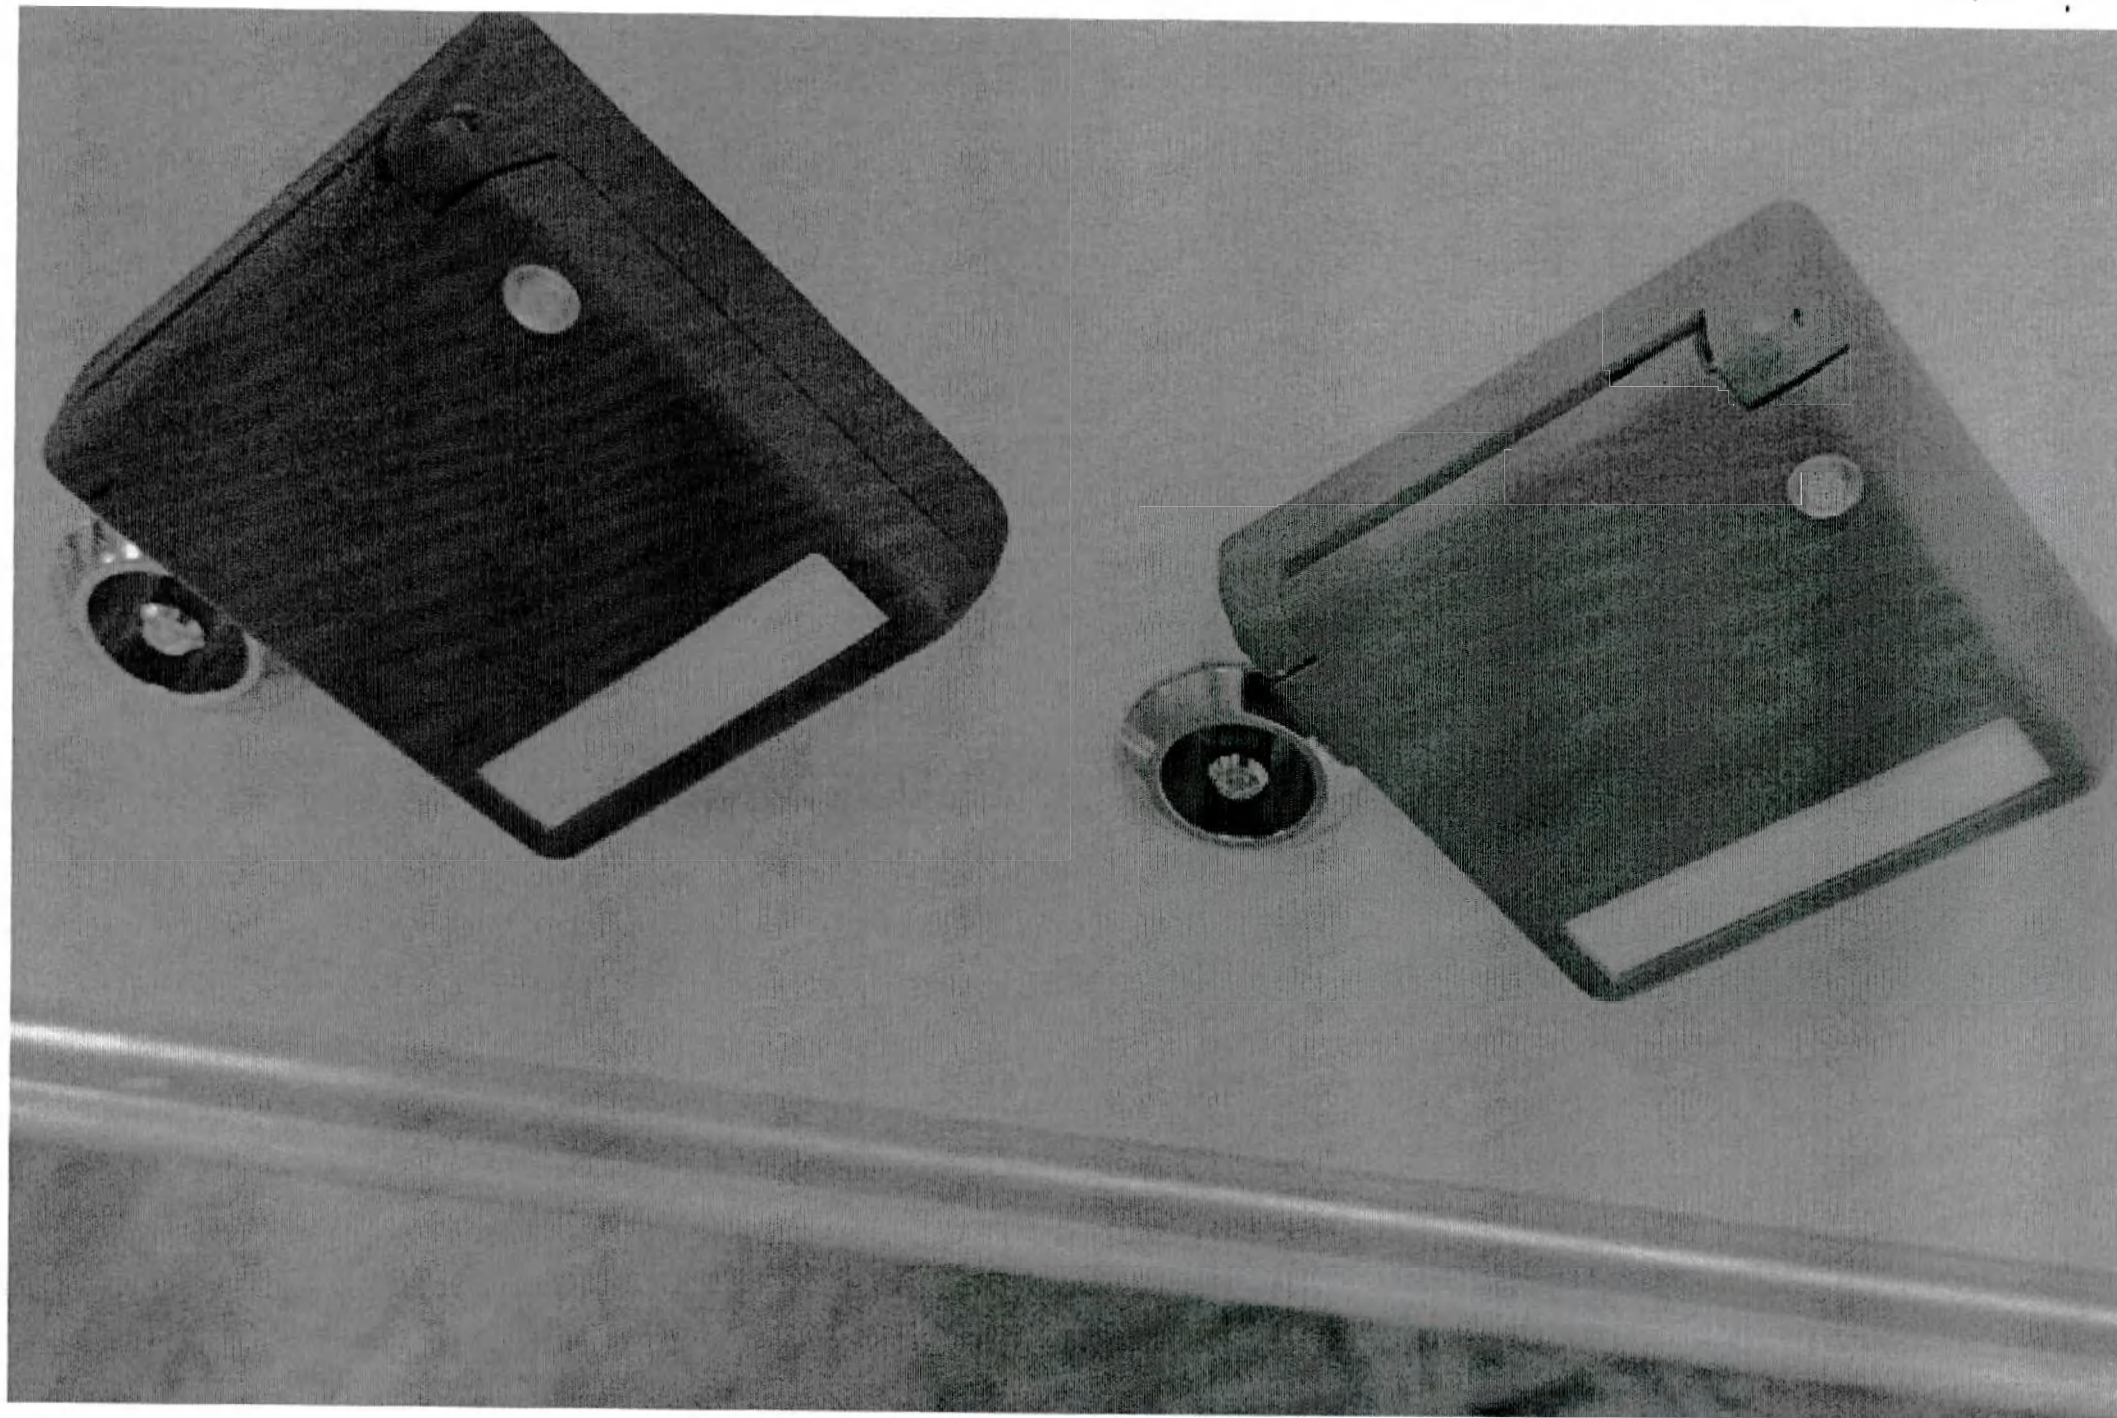


Рисунок 15. Примеры электрических разъемов 220 В

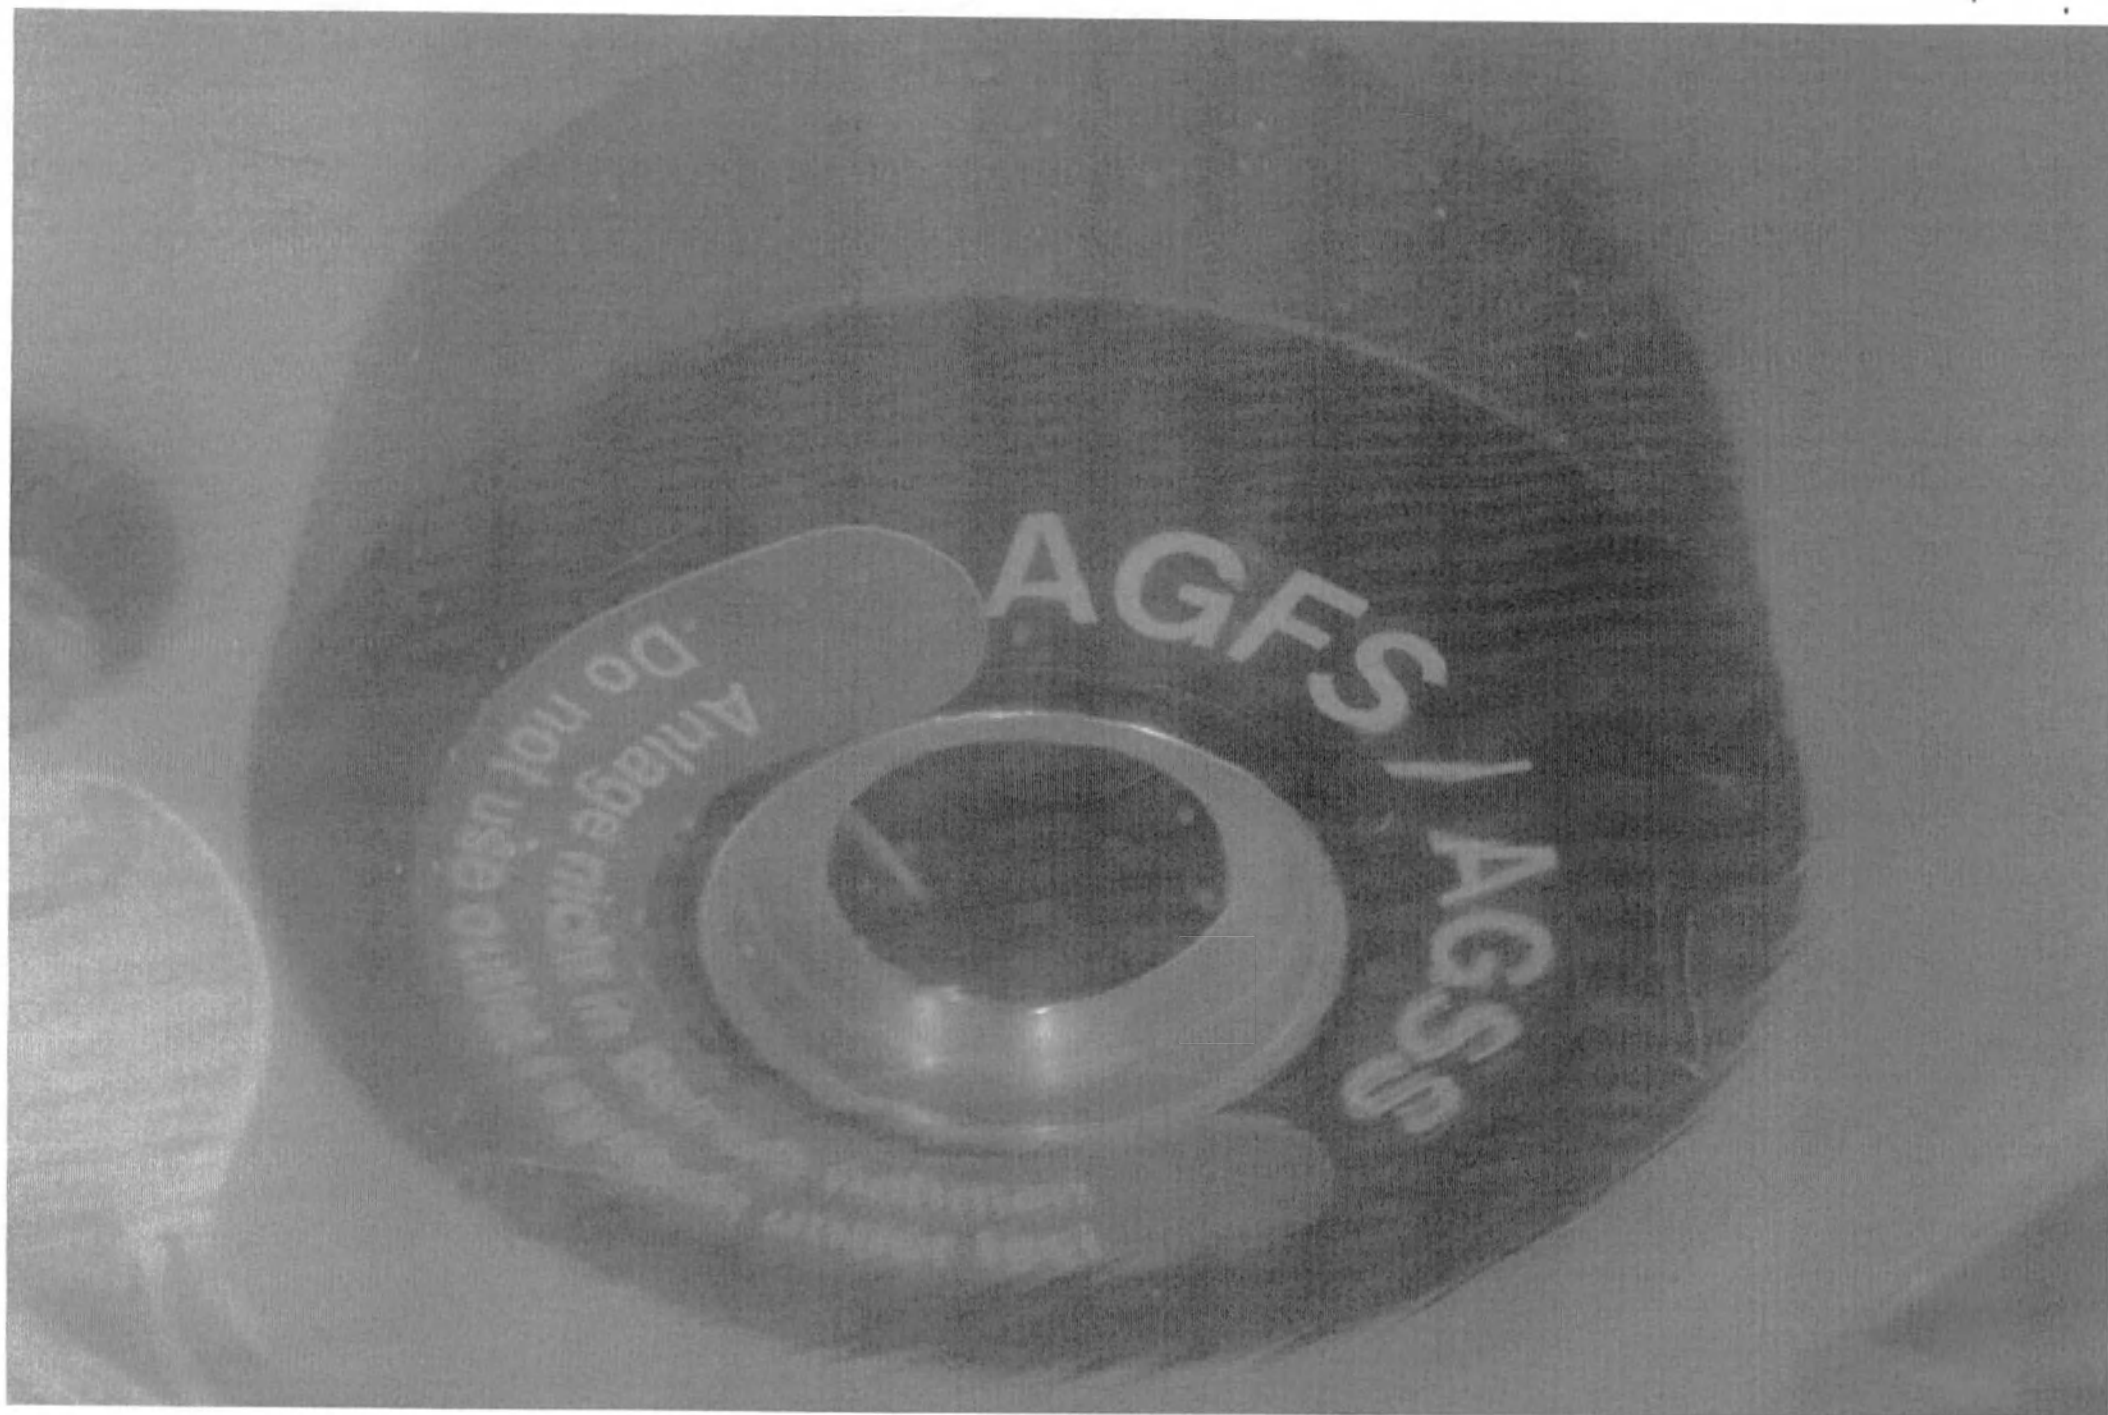


Рисунок 16. Разъем AGFS/AGSS для удаления наркозных газов



AIR-Motor
Dräger CE

Рисунок 17. Разъем Air-Motor для пневматического инструмента

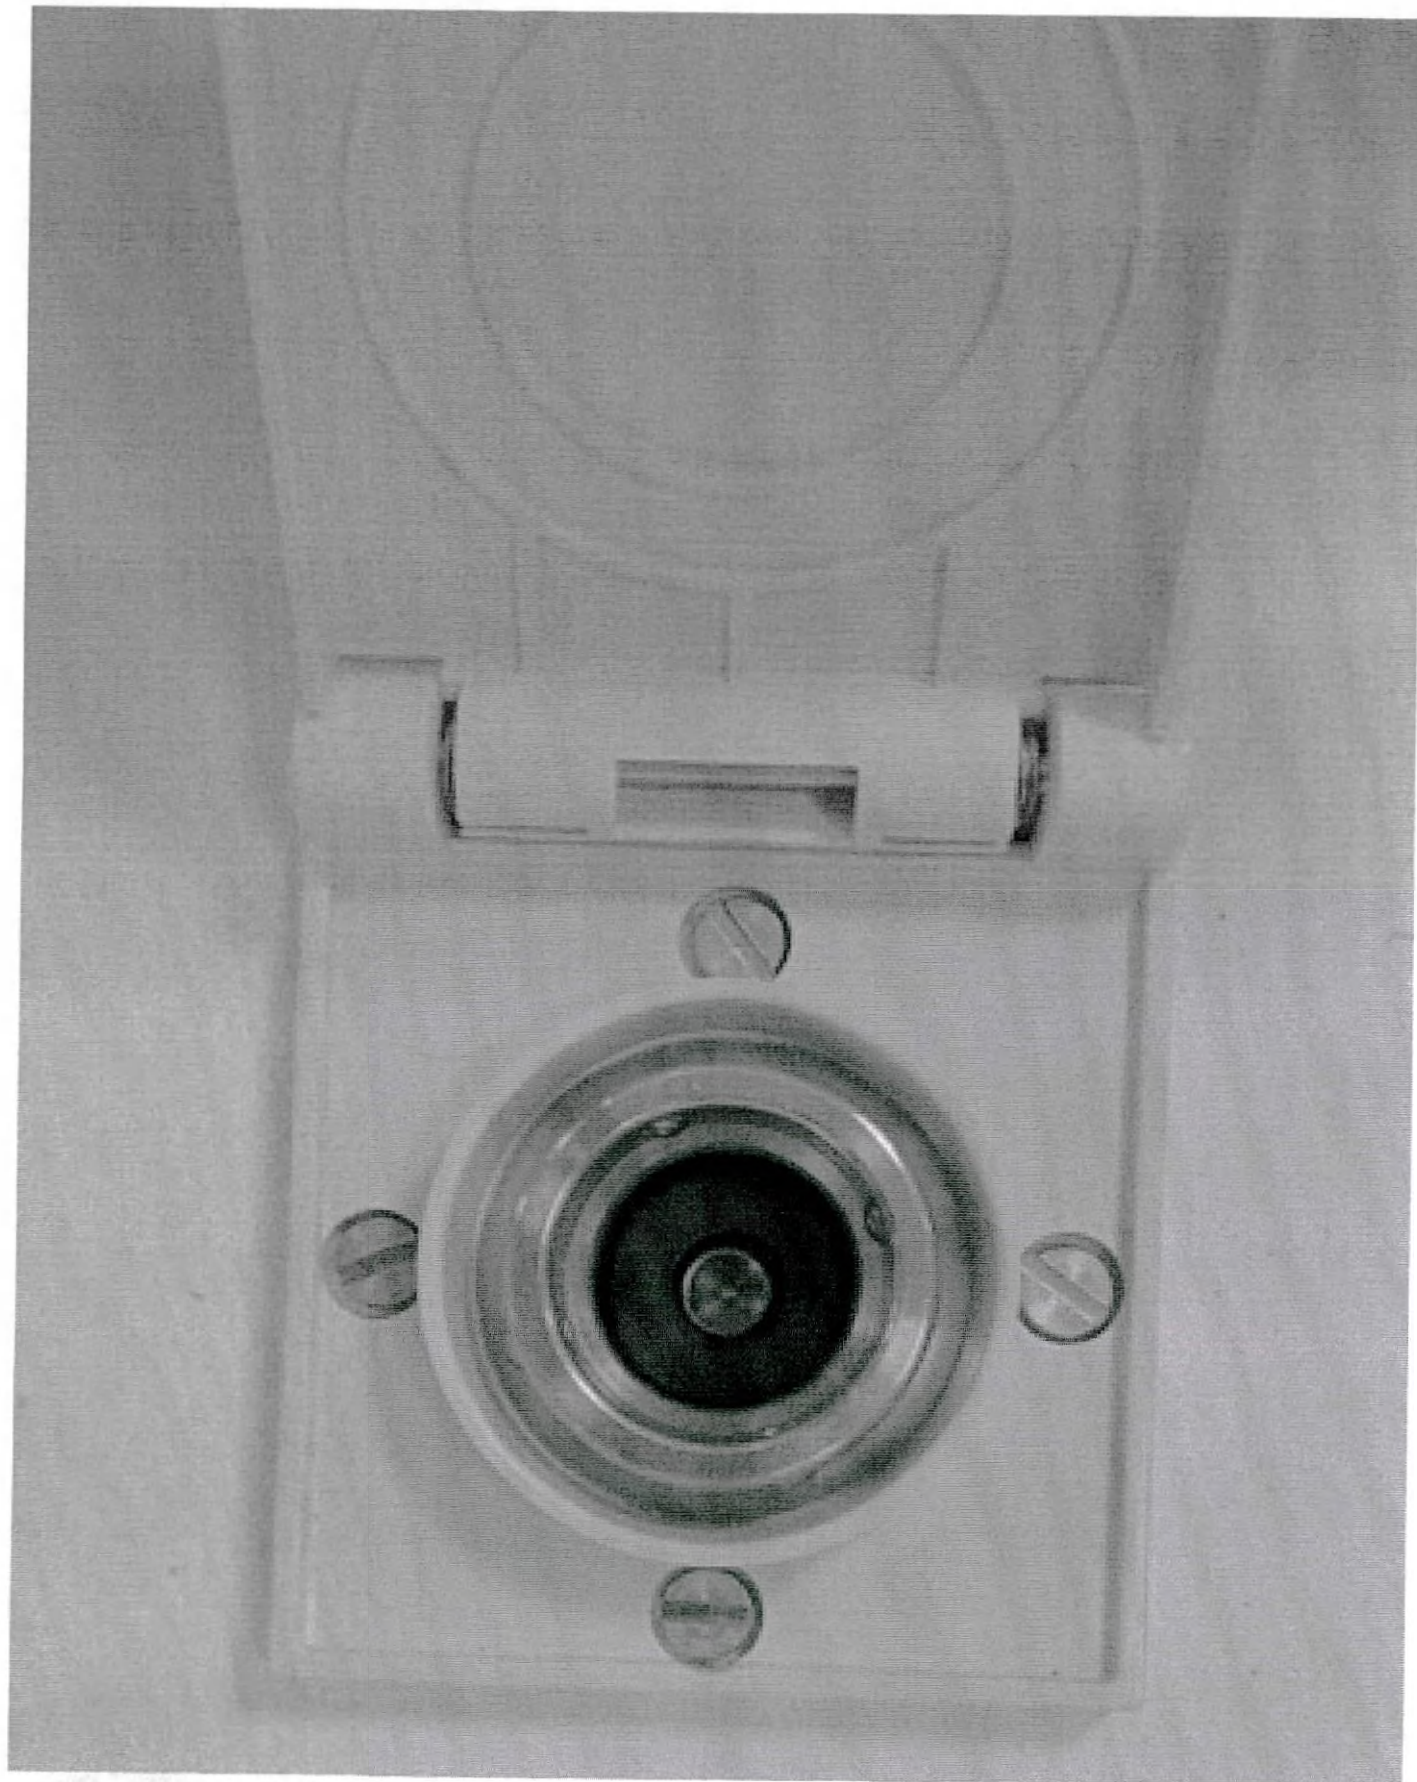


Рисунок 18. Разъем Air-Motor для пневматического инструмента в открытом виде

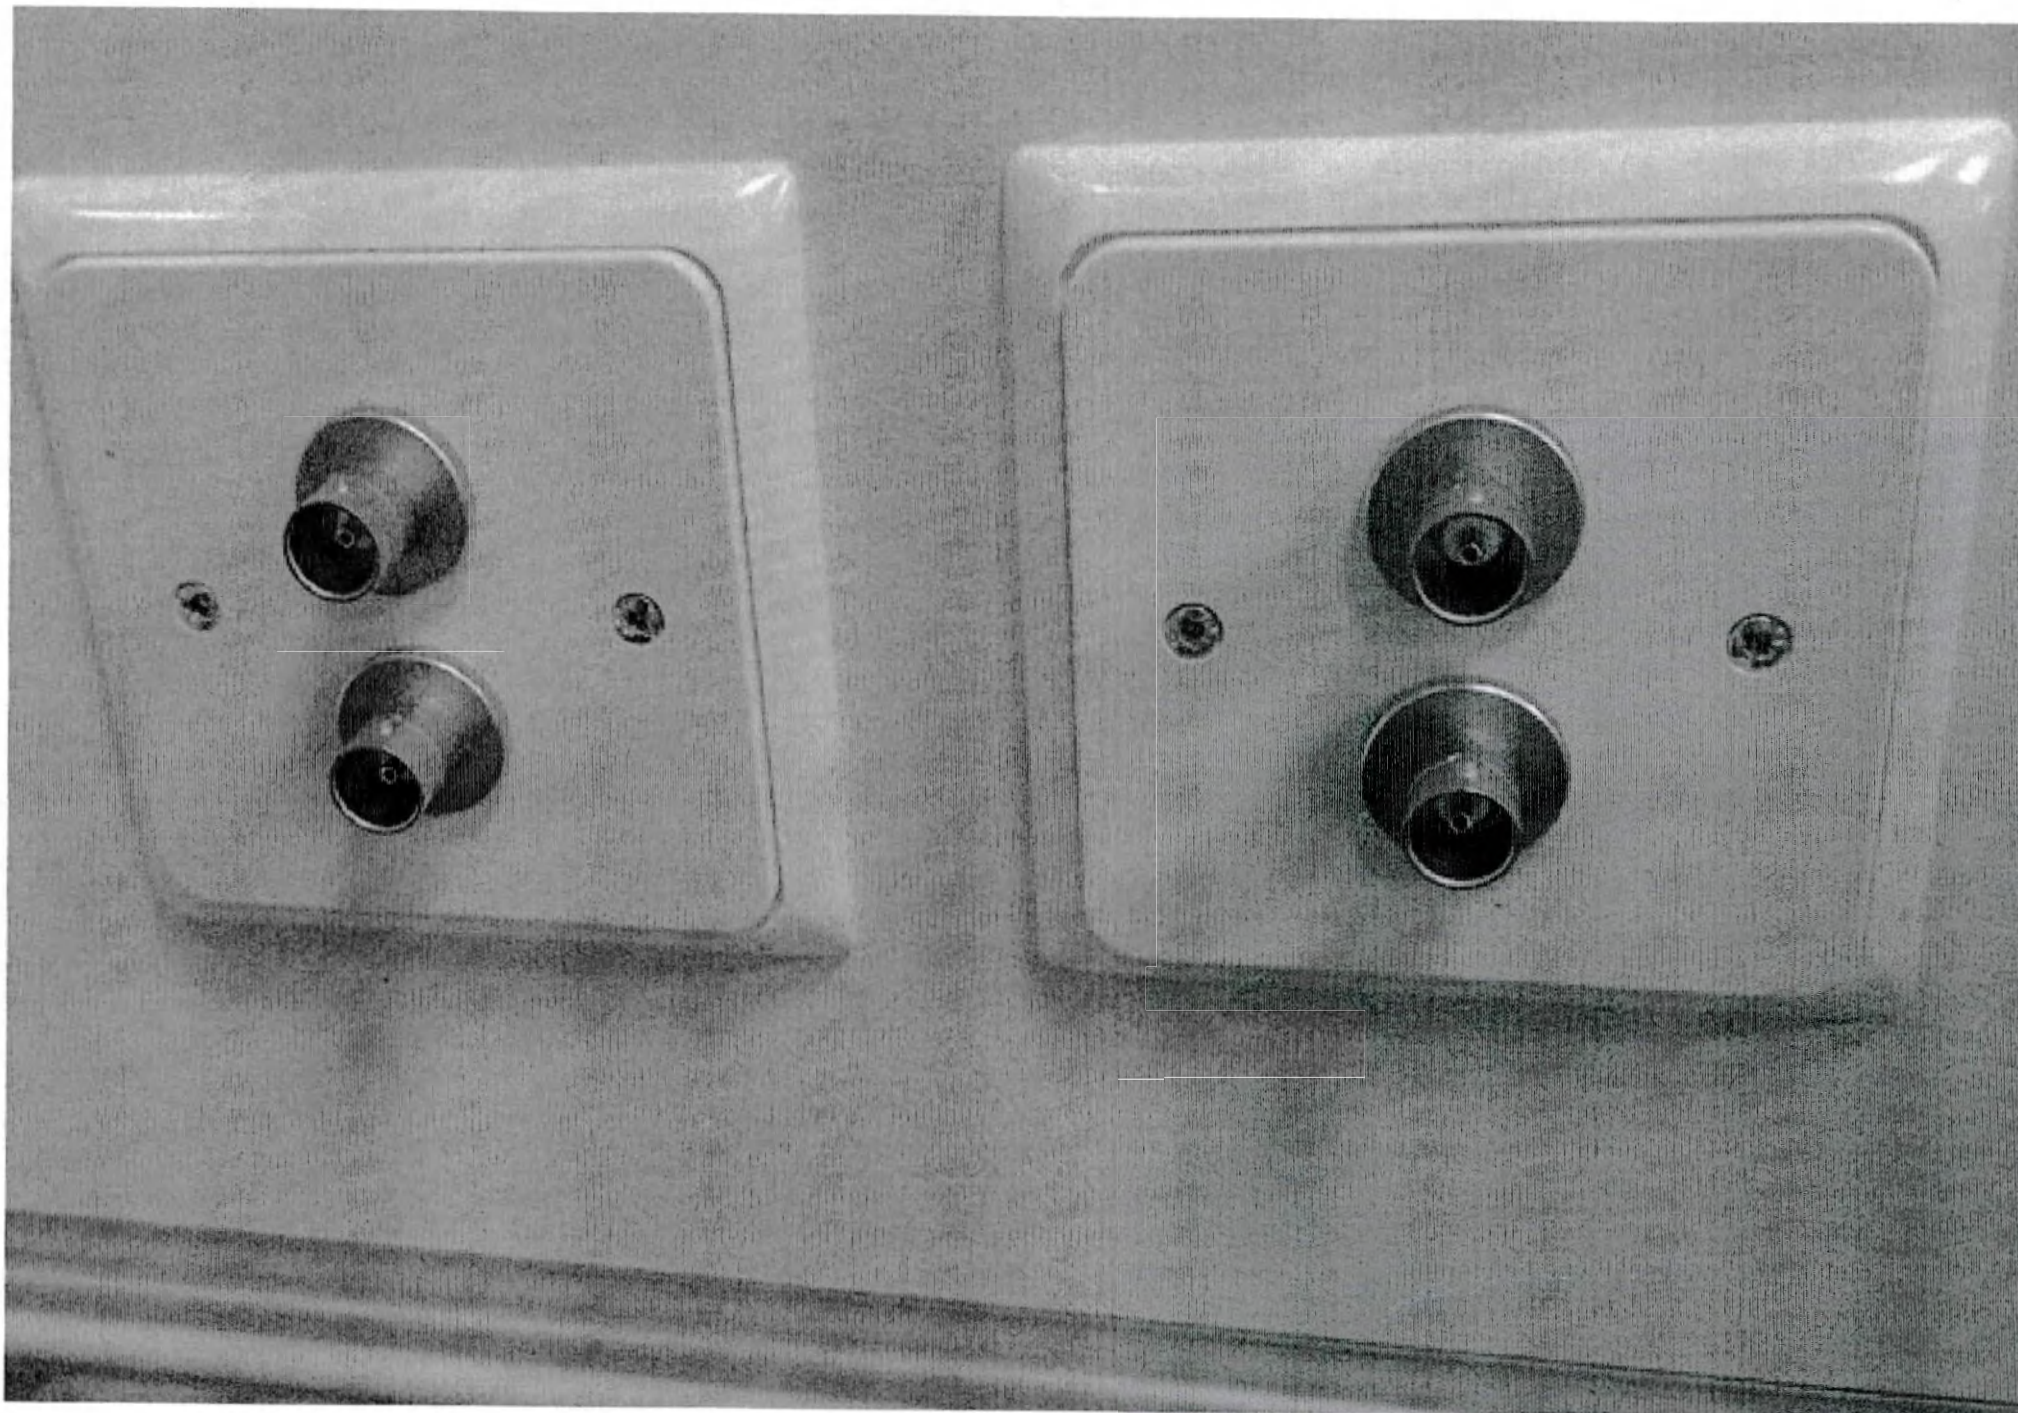


Рисунок 19. Двойной разъем BNC

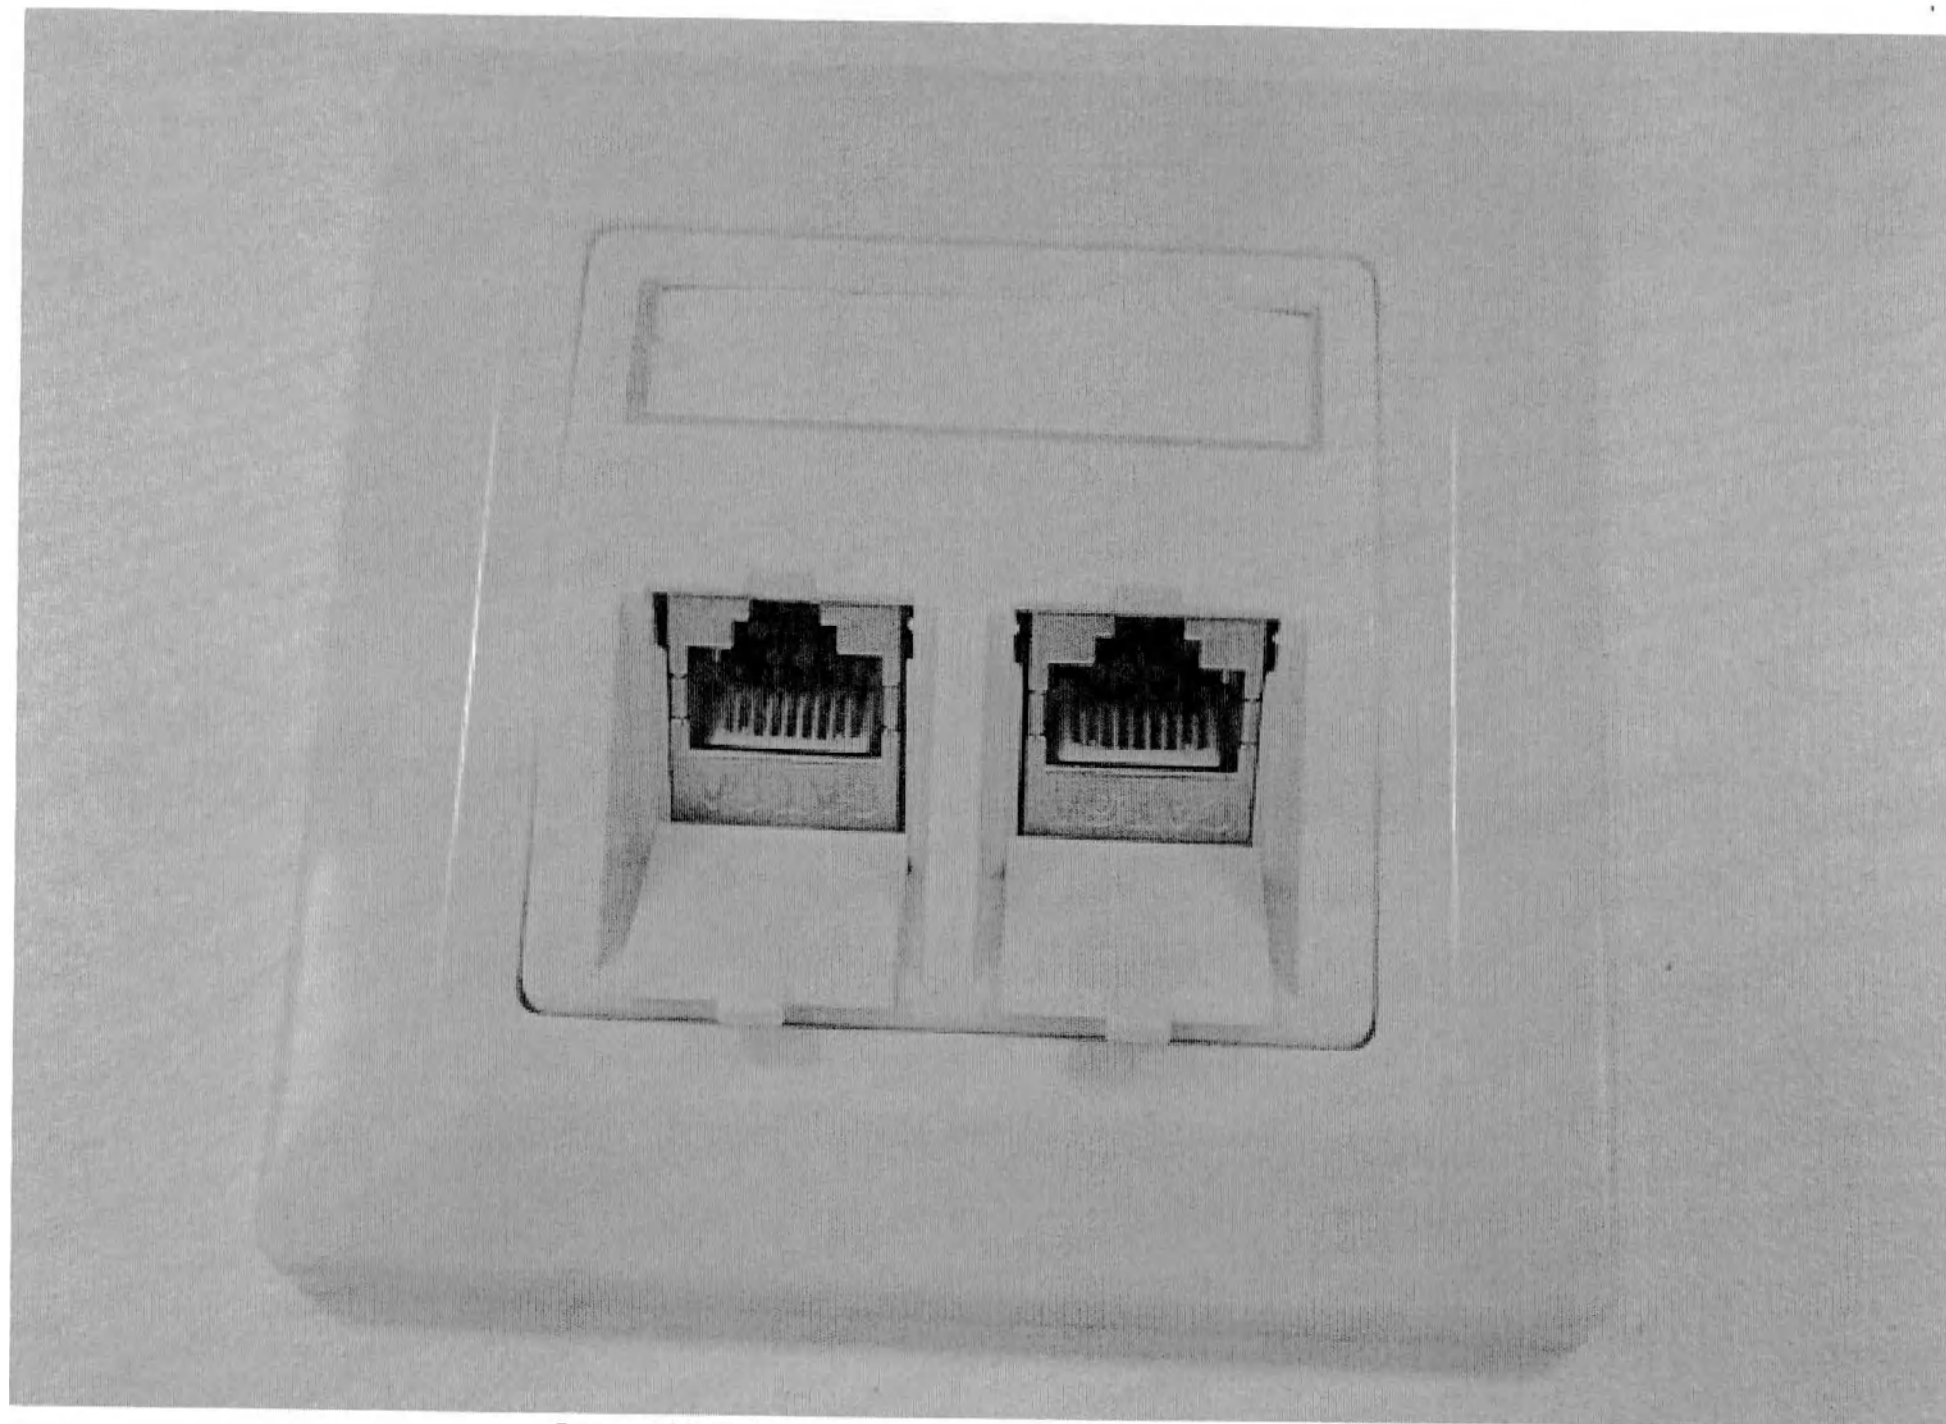


Рисунок 20. Информационный разъем, тип RJ45, в подвесном блоке

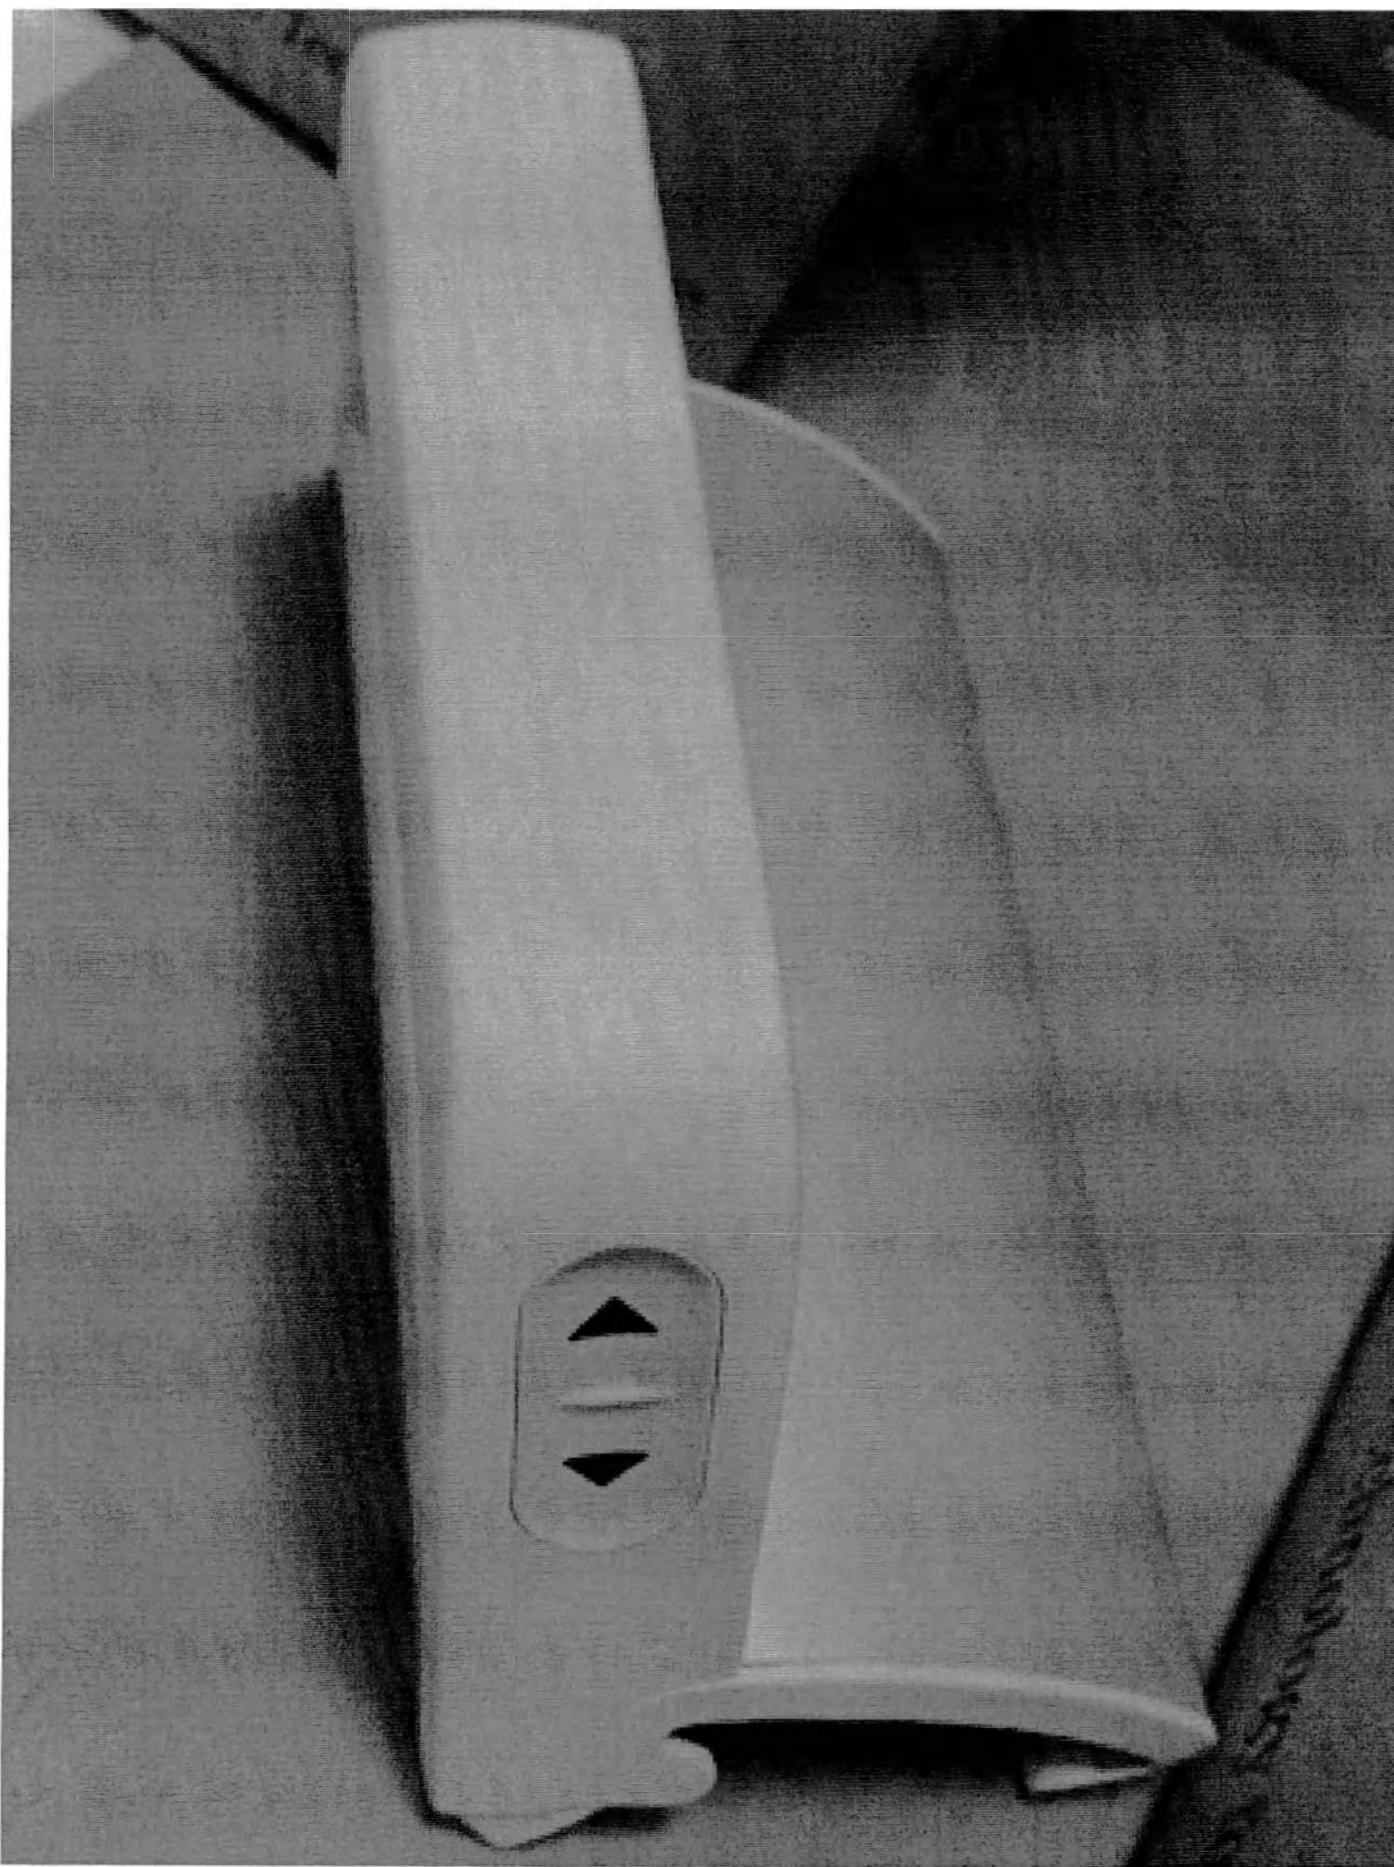


Рисунок 21. Ручка с электро-механической кнопкой включения/отключения пневматических тормозов при подъеме/спуске



Рисунок 22. Ручка без электро-механической кнопки включения/отключения пневматических тормозов при подъеме/спуске



Рисунок 23. Дополнительный несущий кронштейн на примере дополнительного двойного кронштейна для размещения оборудования

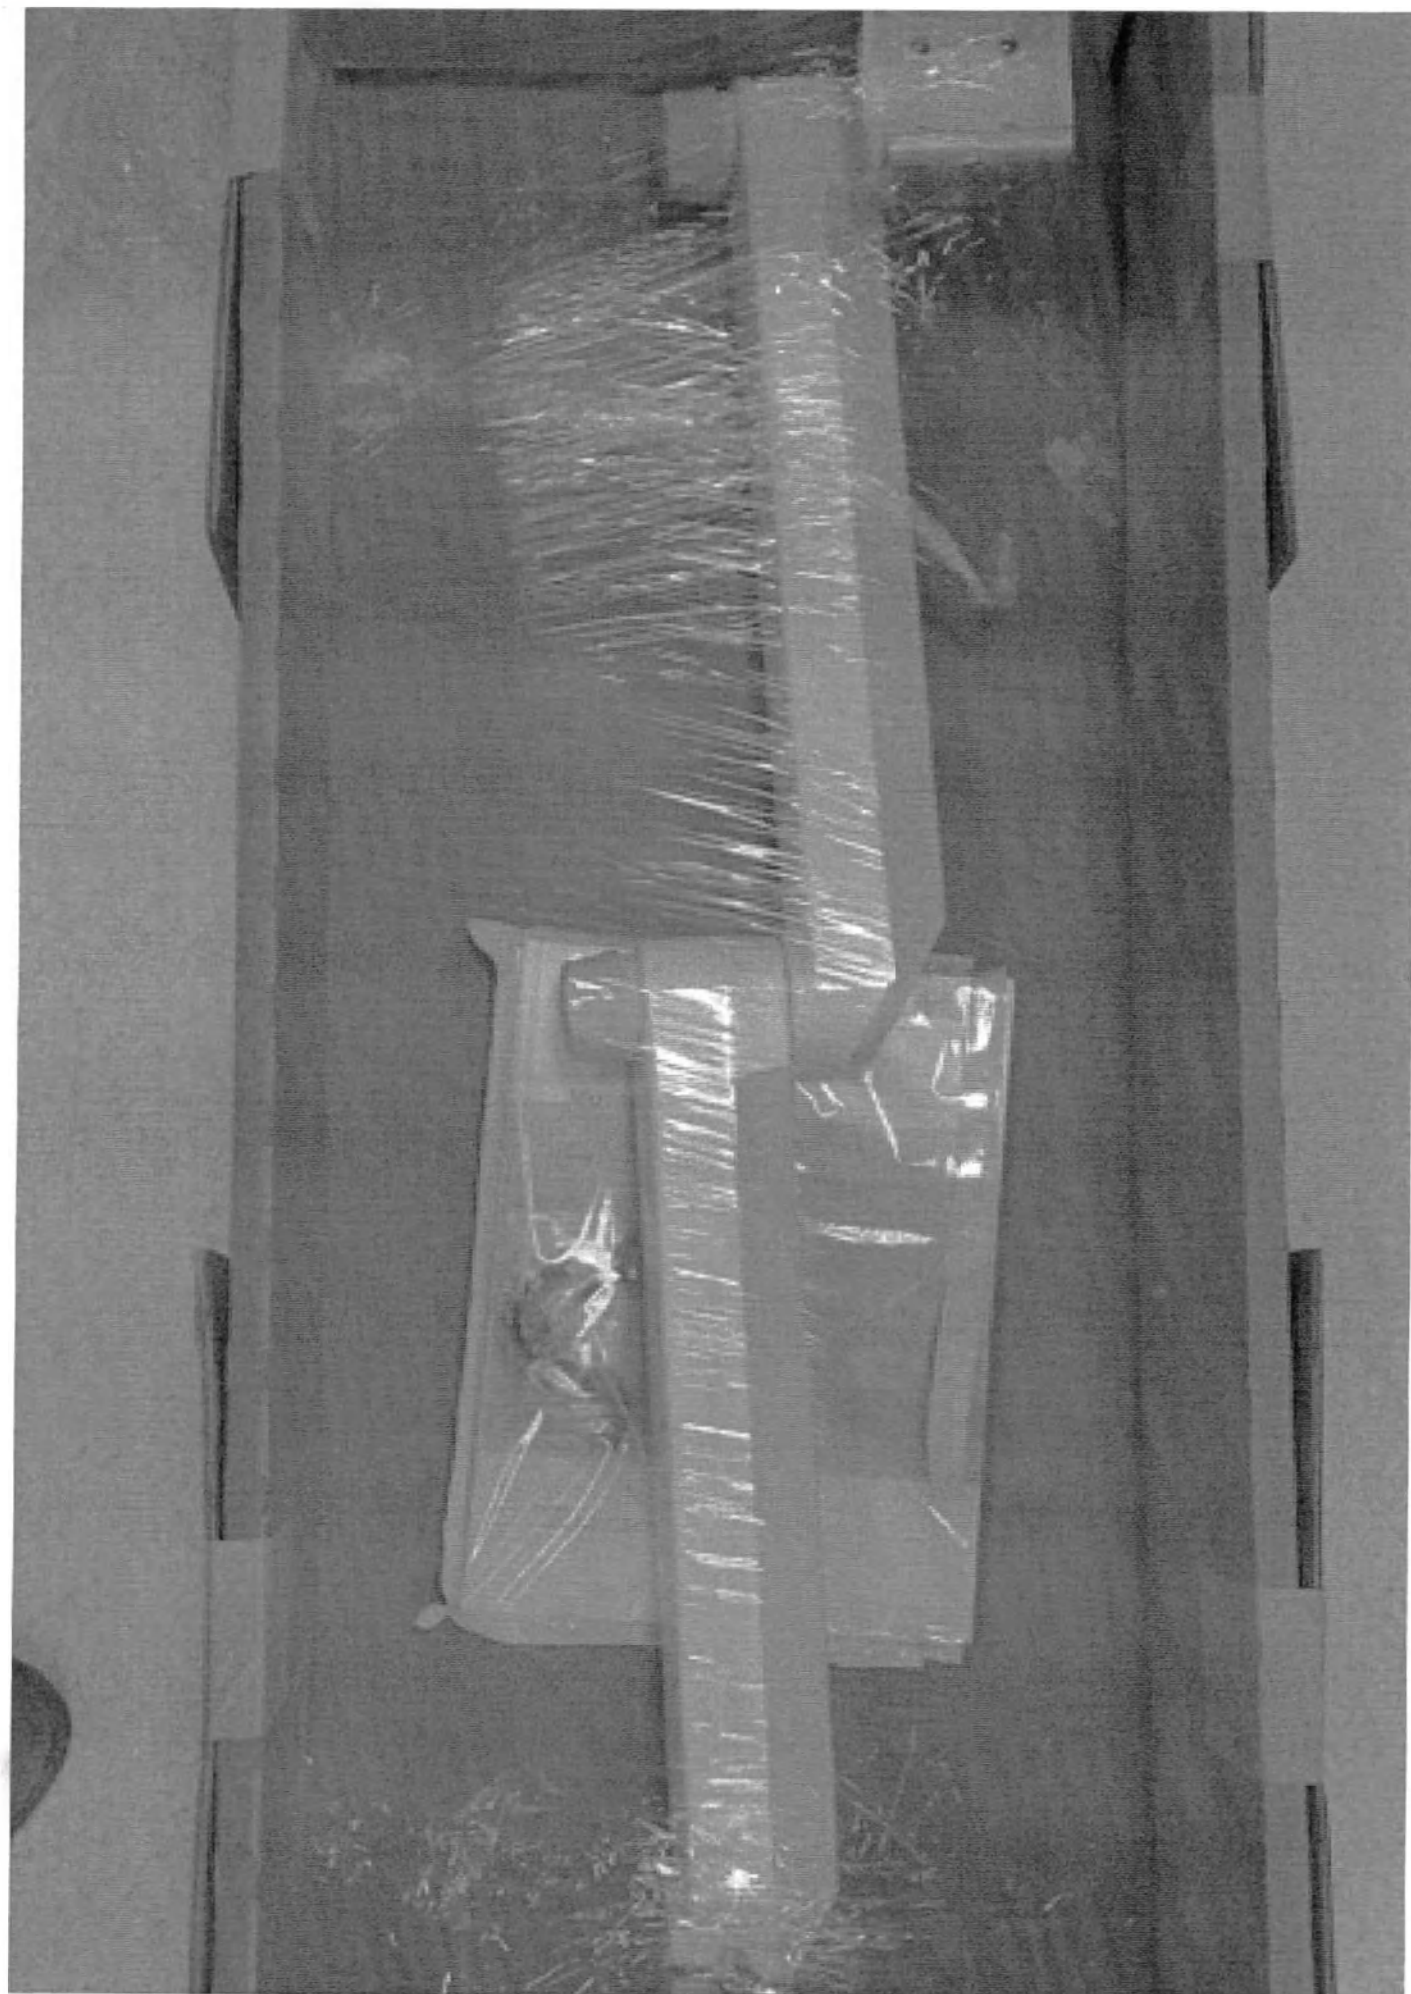


Рисунок 24. Дополнительный двойной кронштейн для размещения оборудования

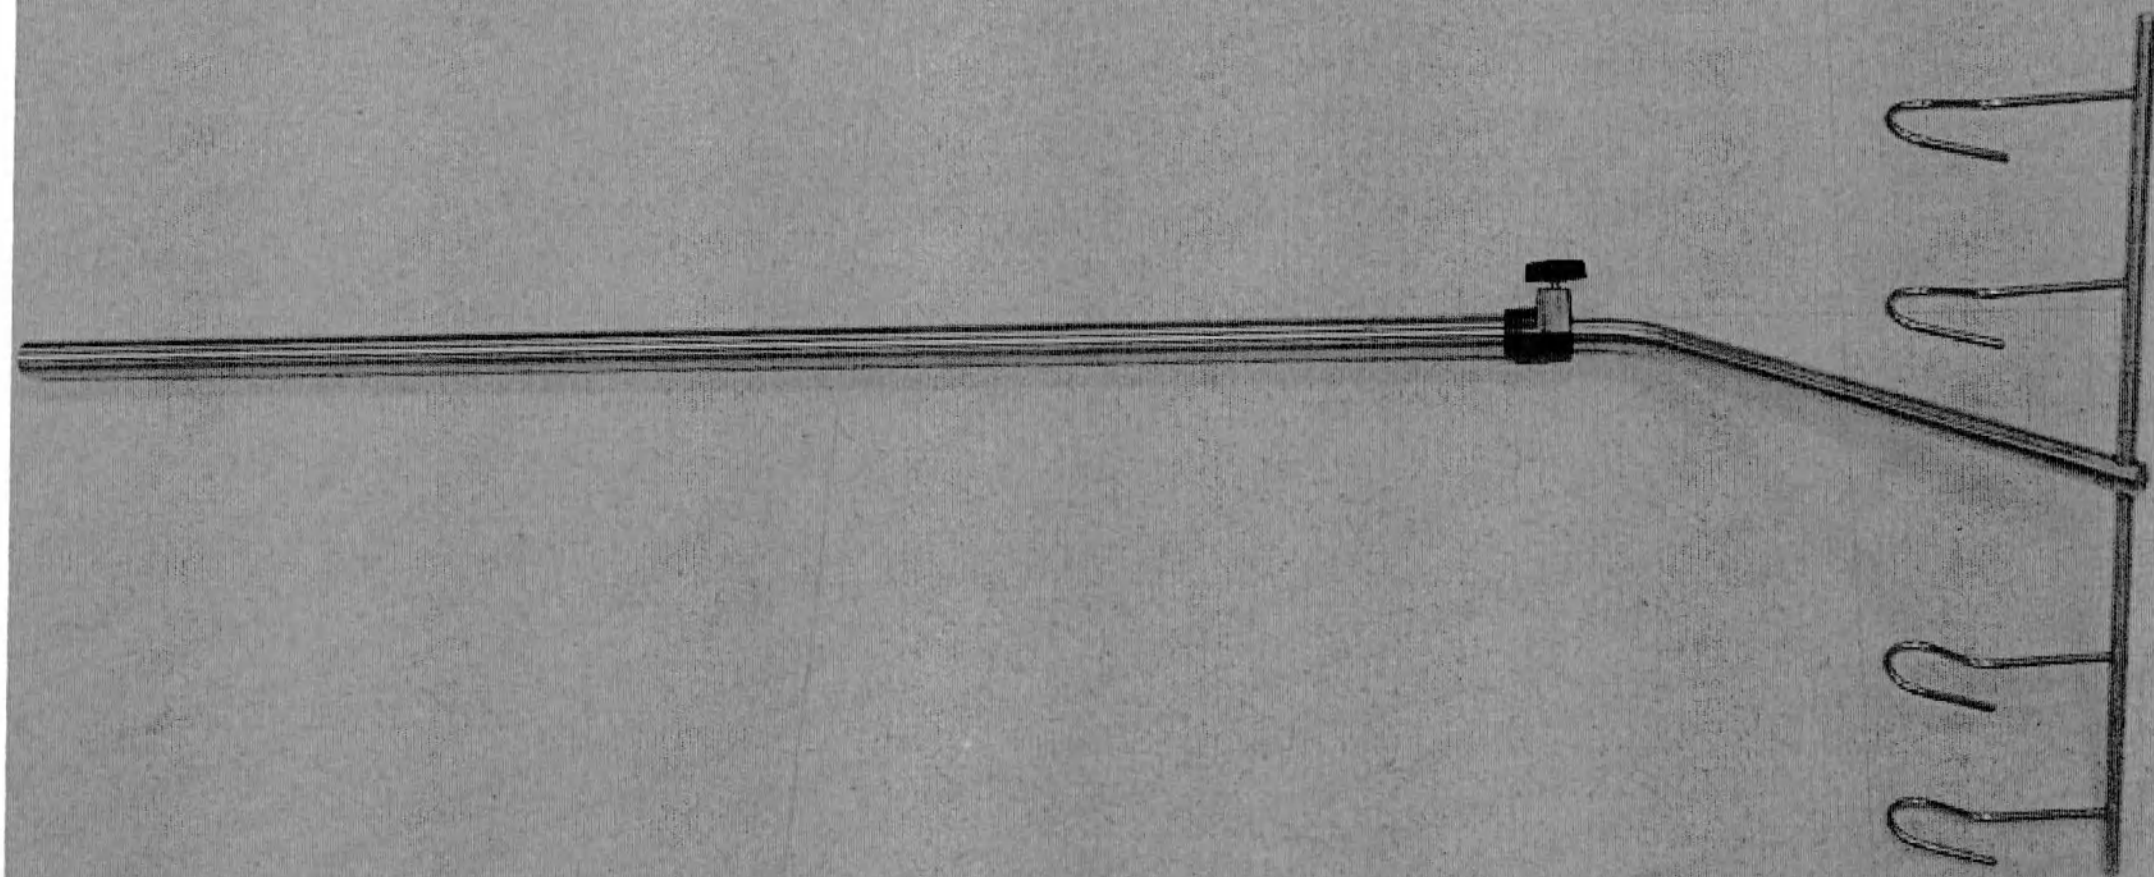


Рисунок 25. Инфузионная стойка с изгибом, с траверсой для флаконов, 4 крючка и штанга для дополнительного оборудования

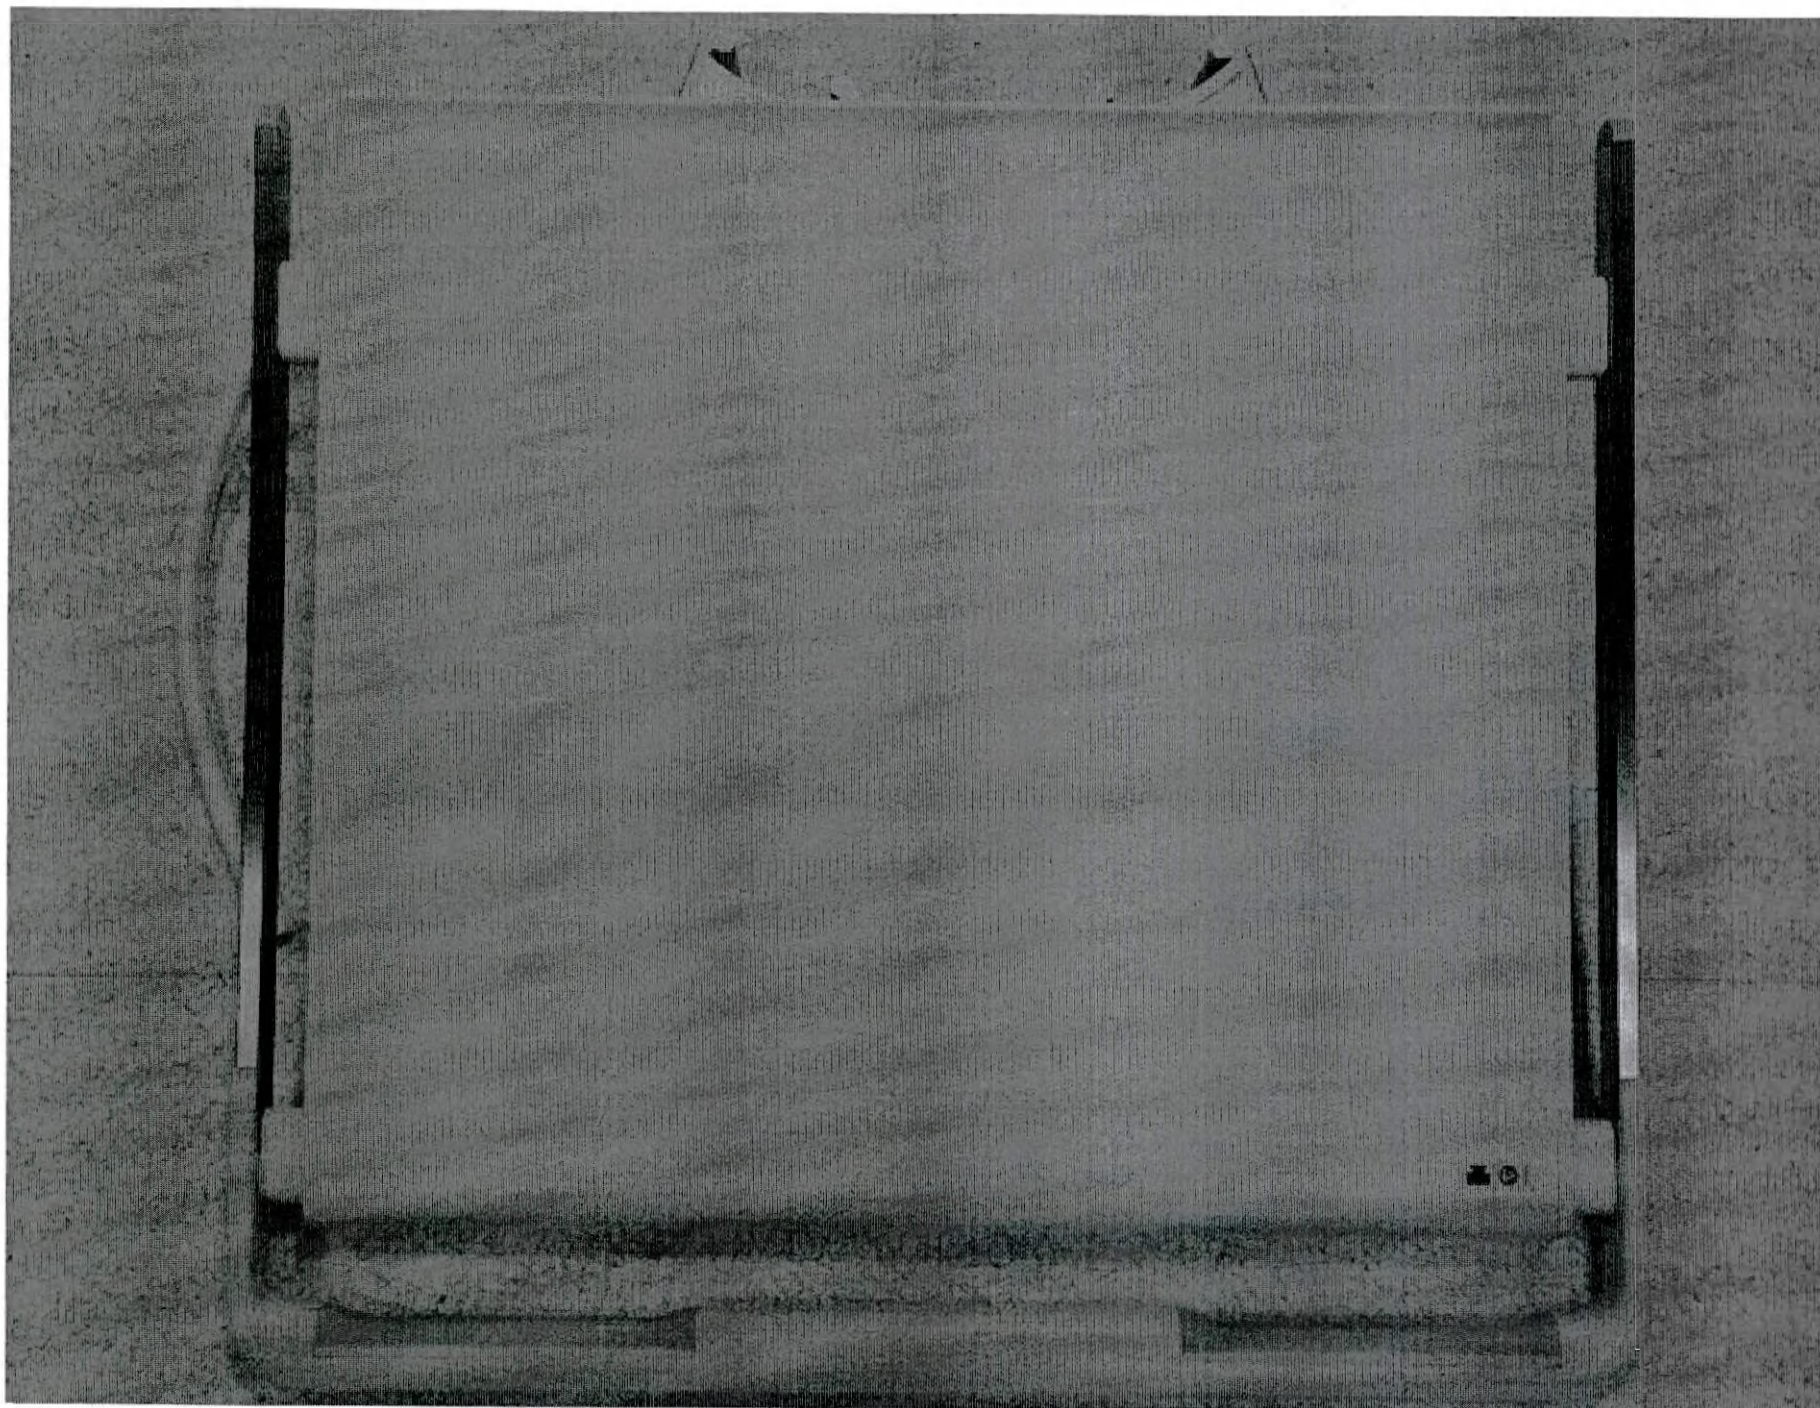


Рисунок 26. Полка для дополнительного оборудования

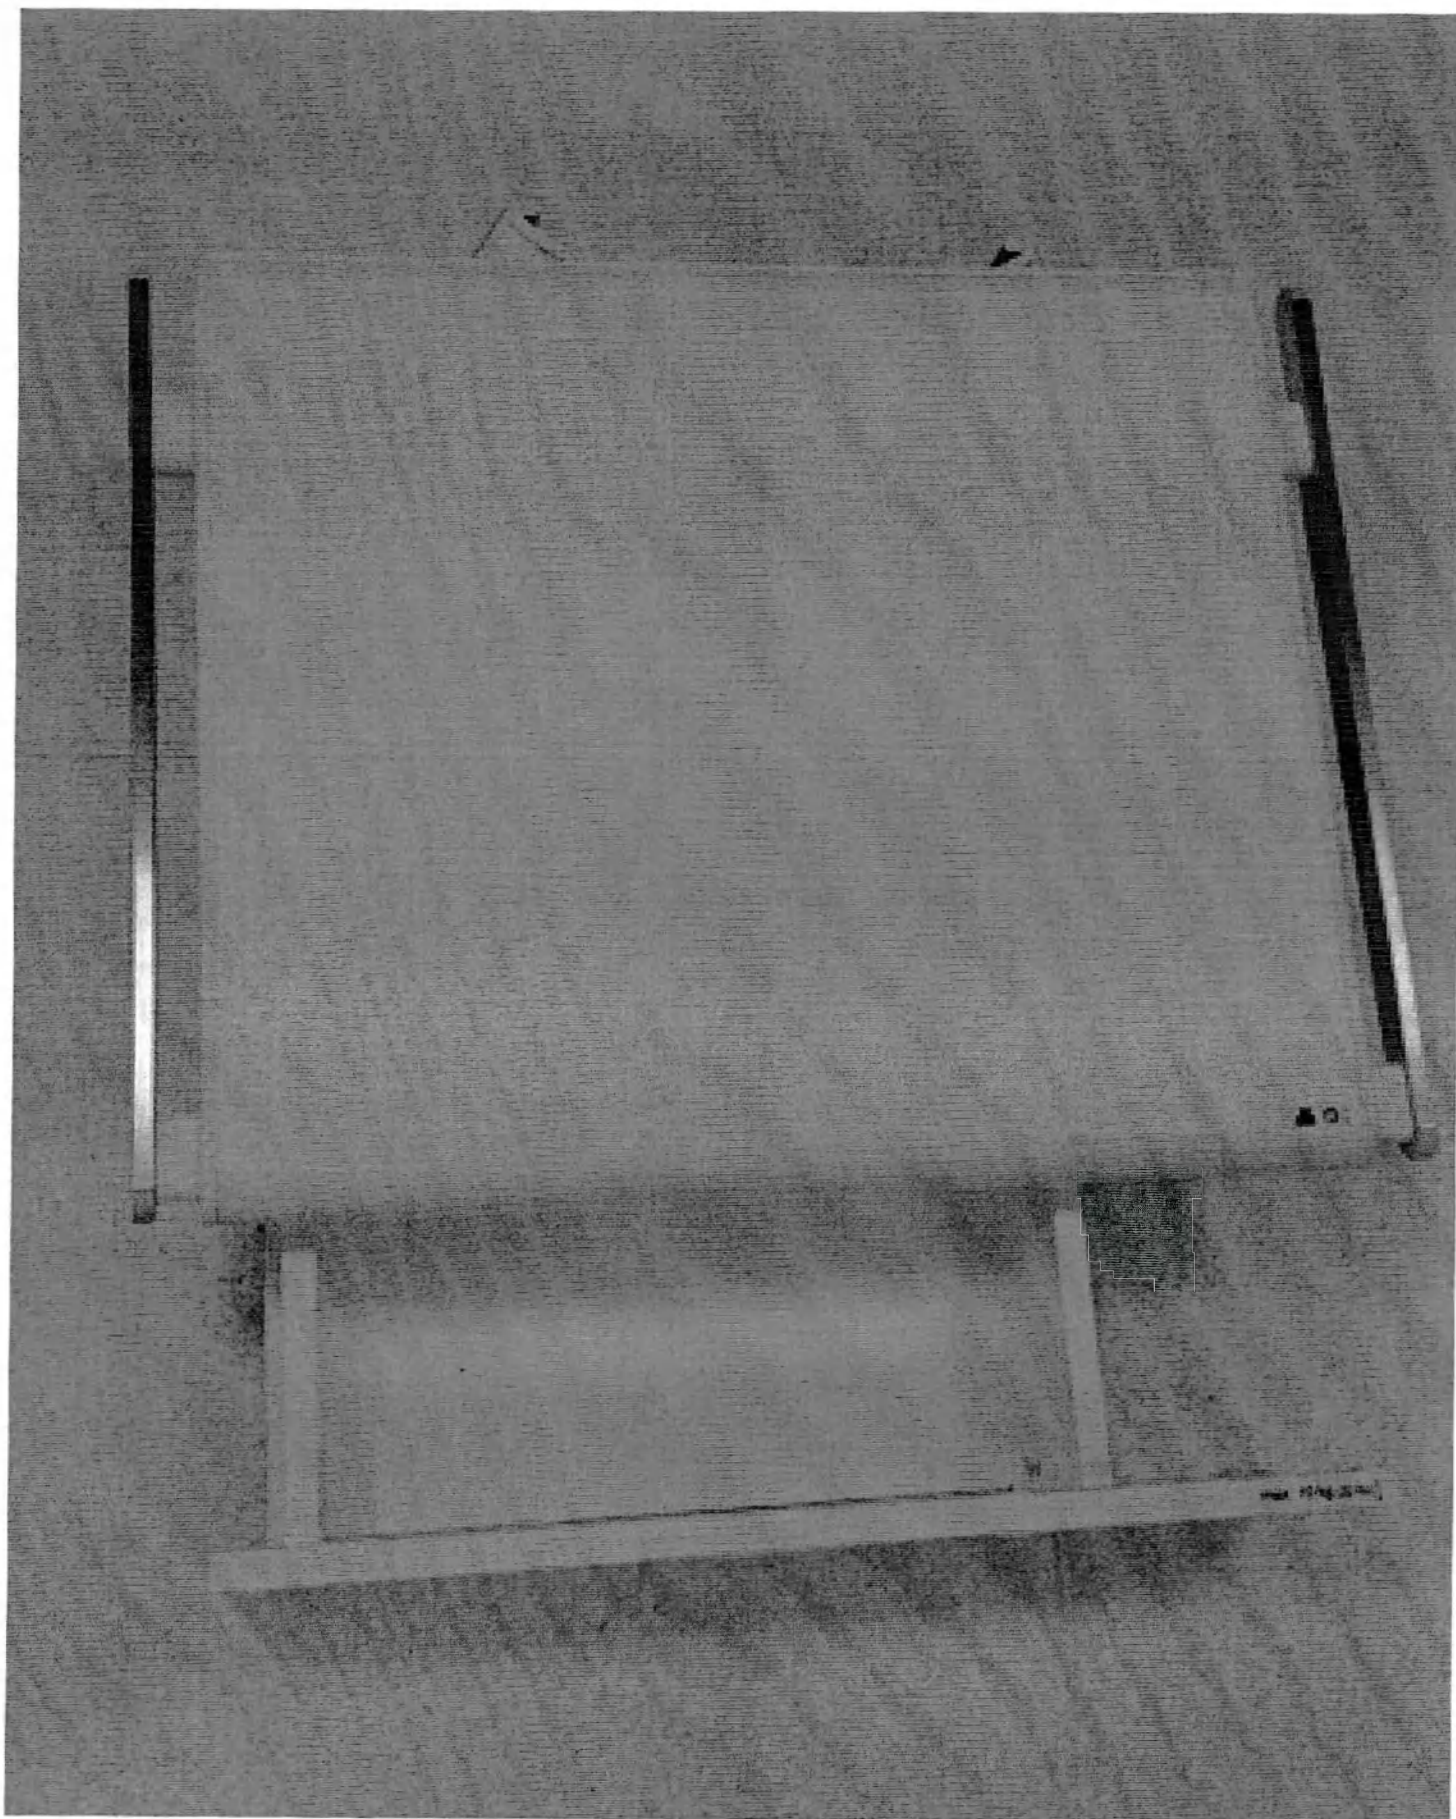


Рисунок 27. Полка с ящиком для дополнительного оборудования



Рисунок 28. Крепежная панель для аппарата ИВЛ



Рисунок 29. Крепежная панель для наркозного аппарата

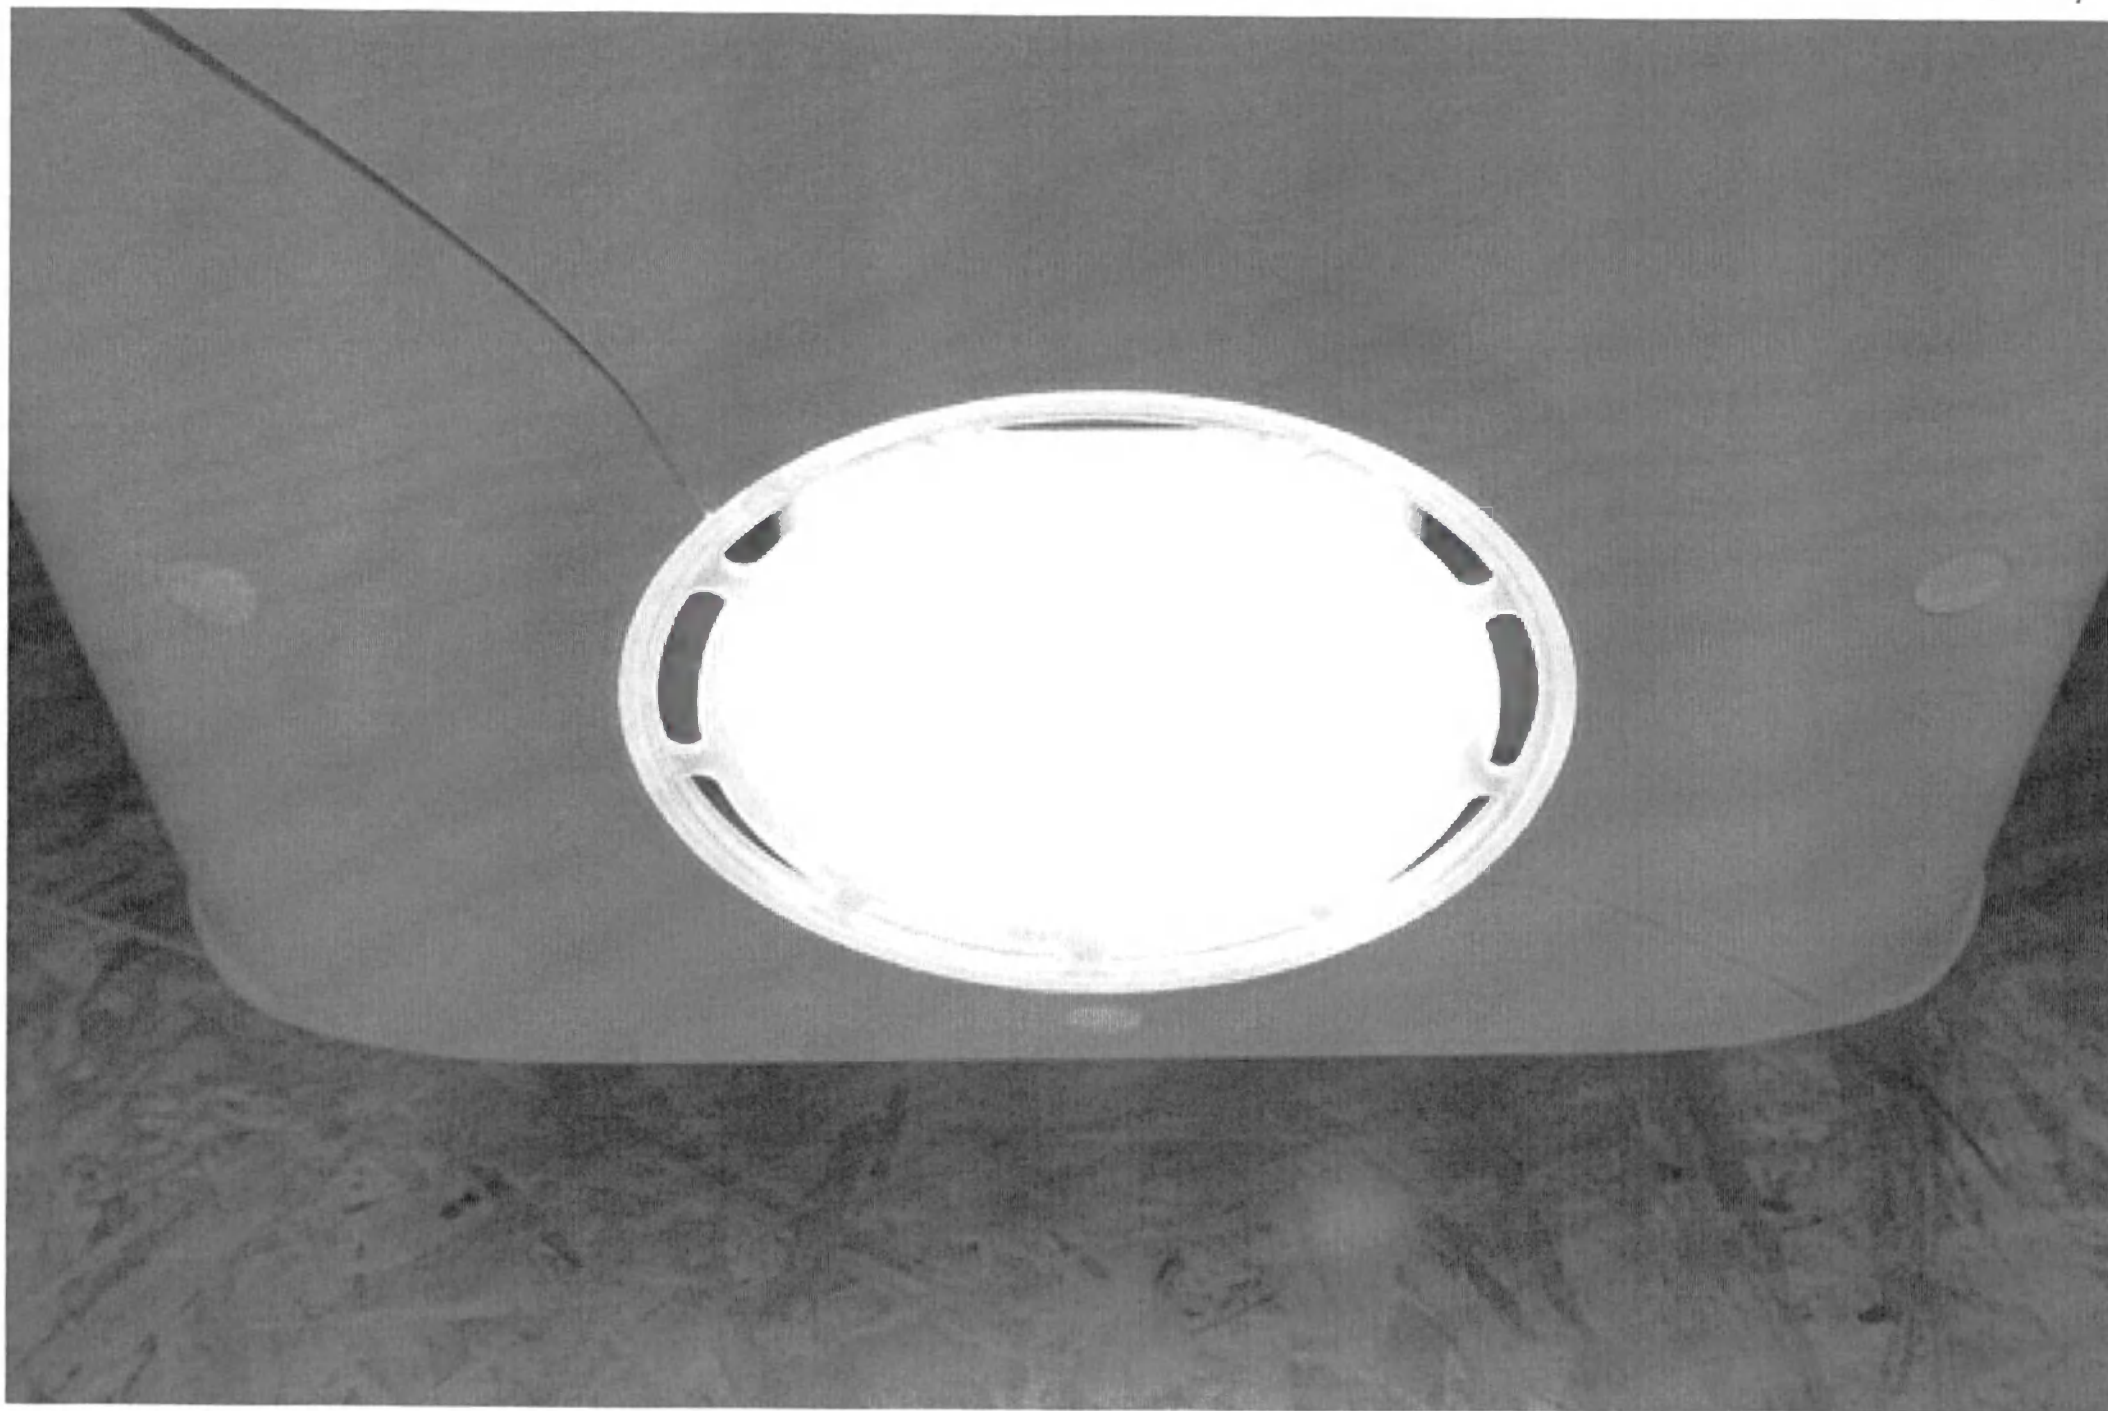


Рисунок 30. Освещение на примере нижнего освещения для вертикального подвесного блока

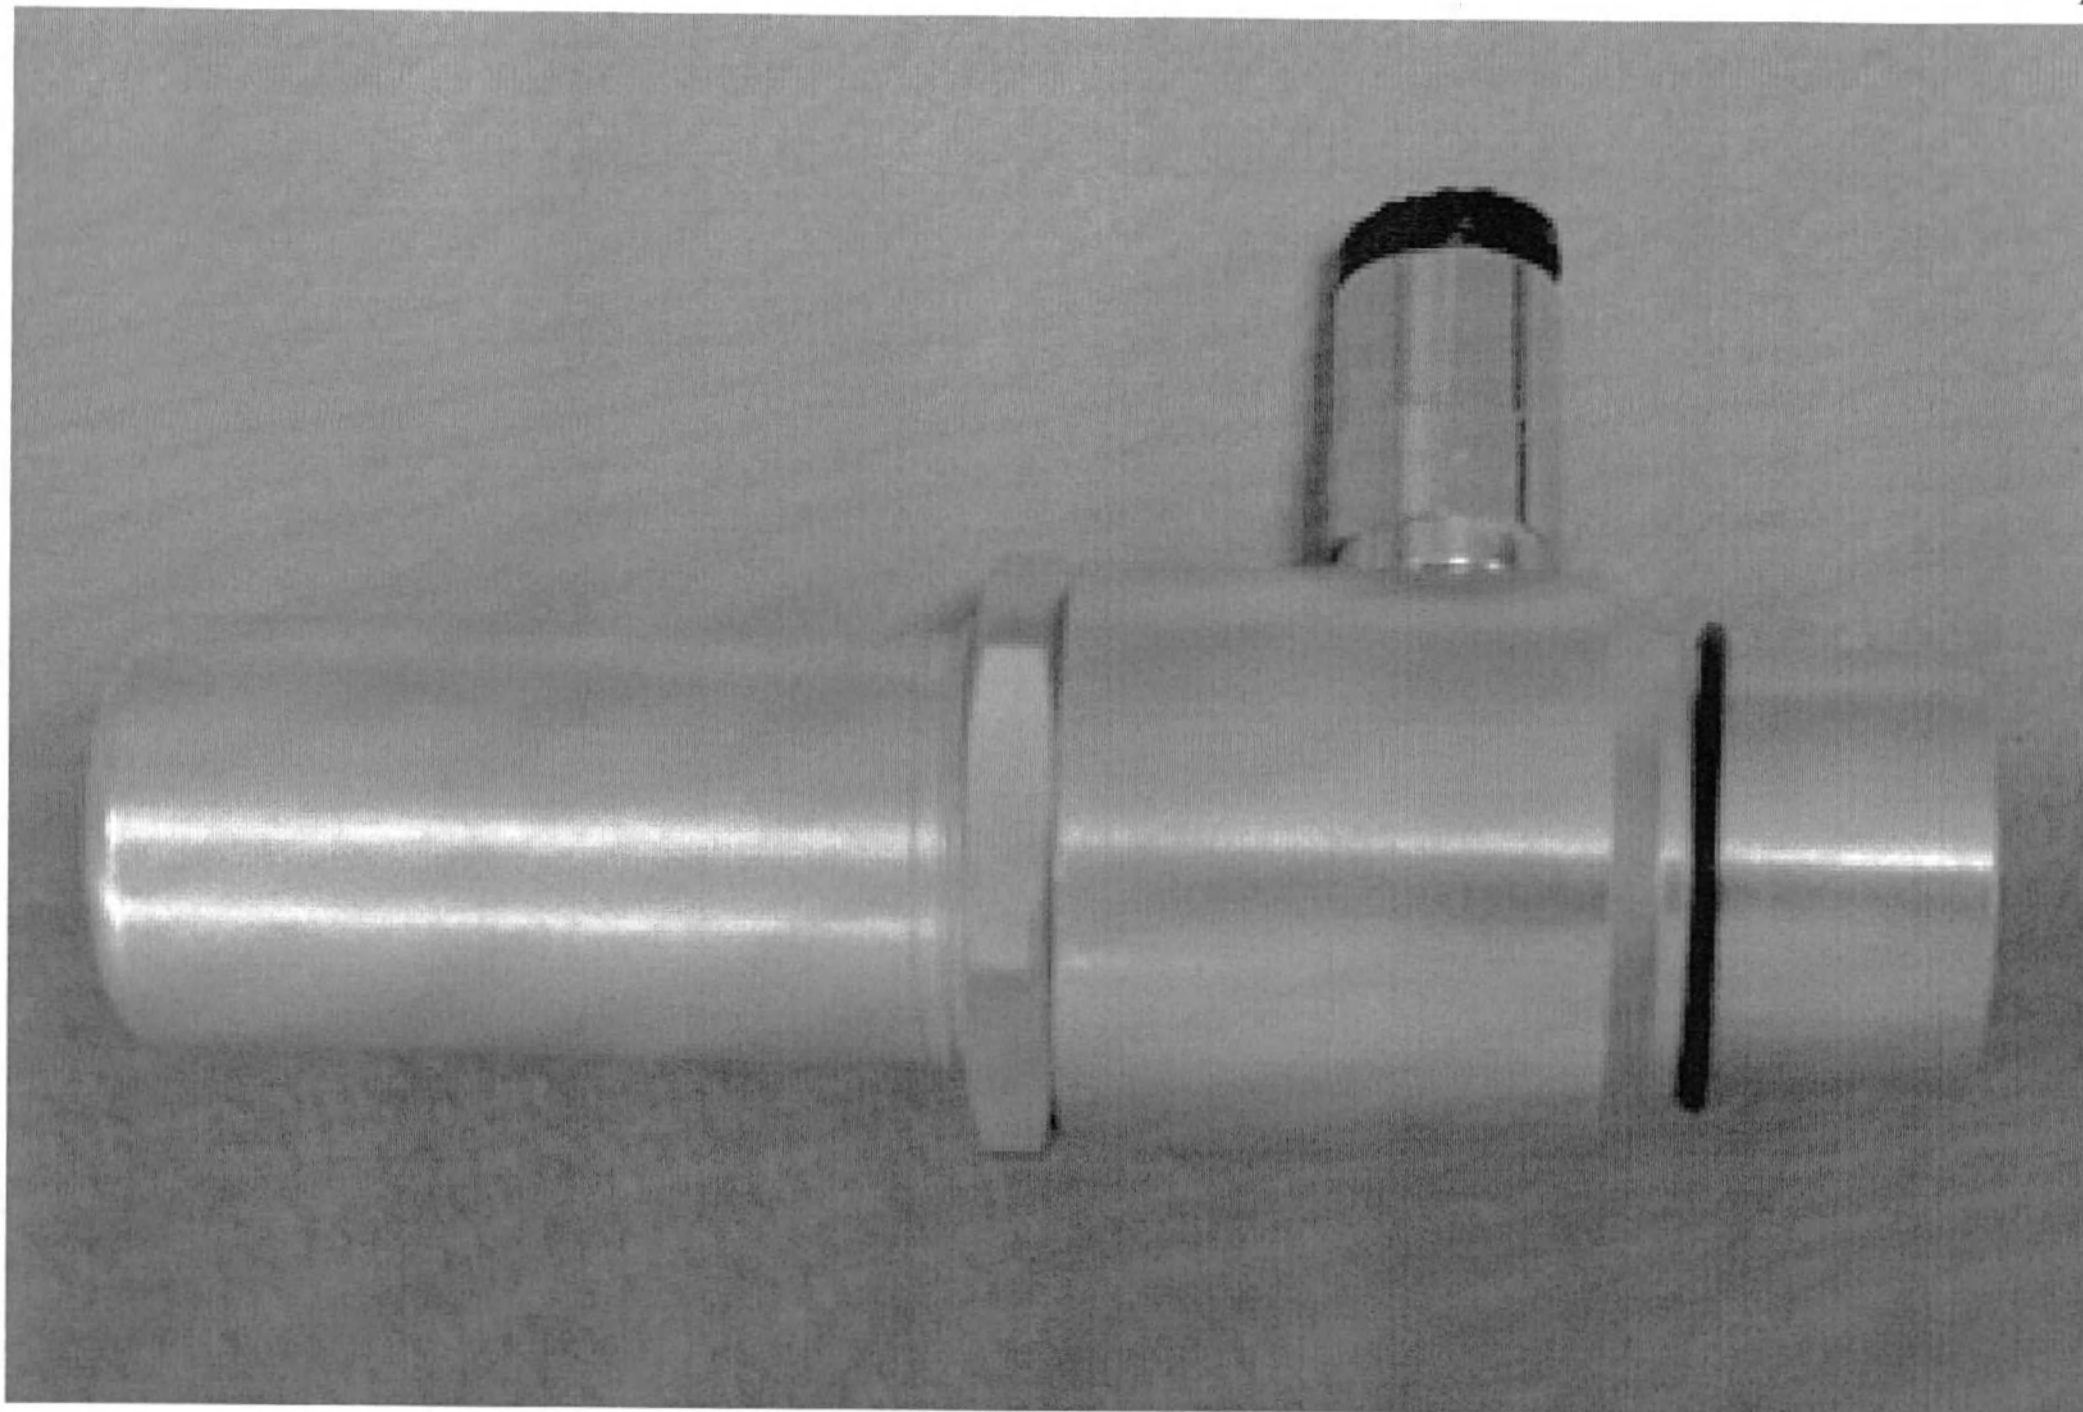


Рисунок 31. Эжектор для удаления наркозных газов

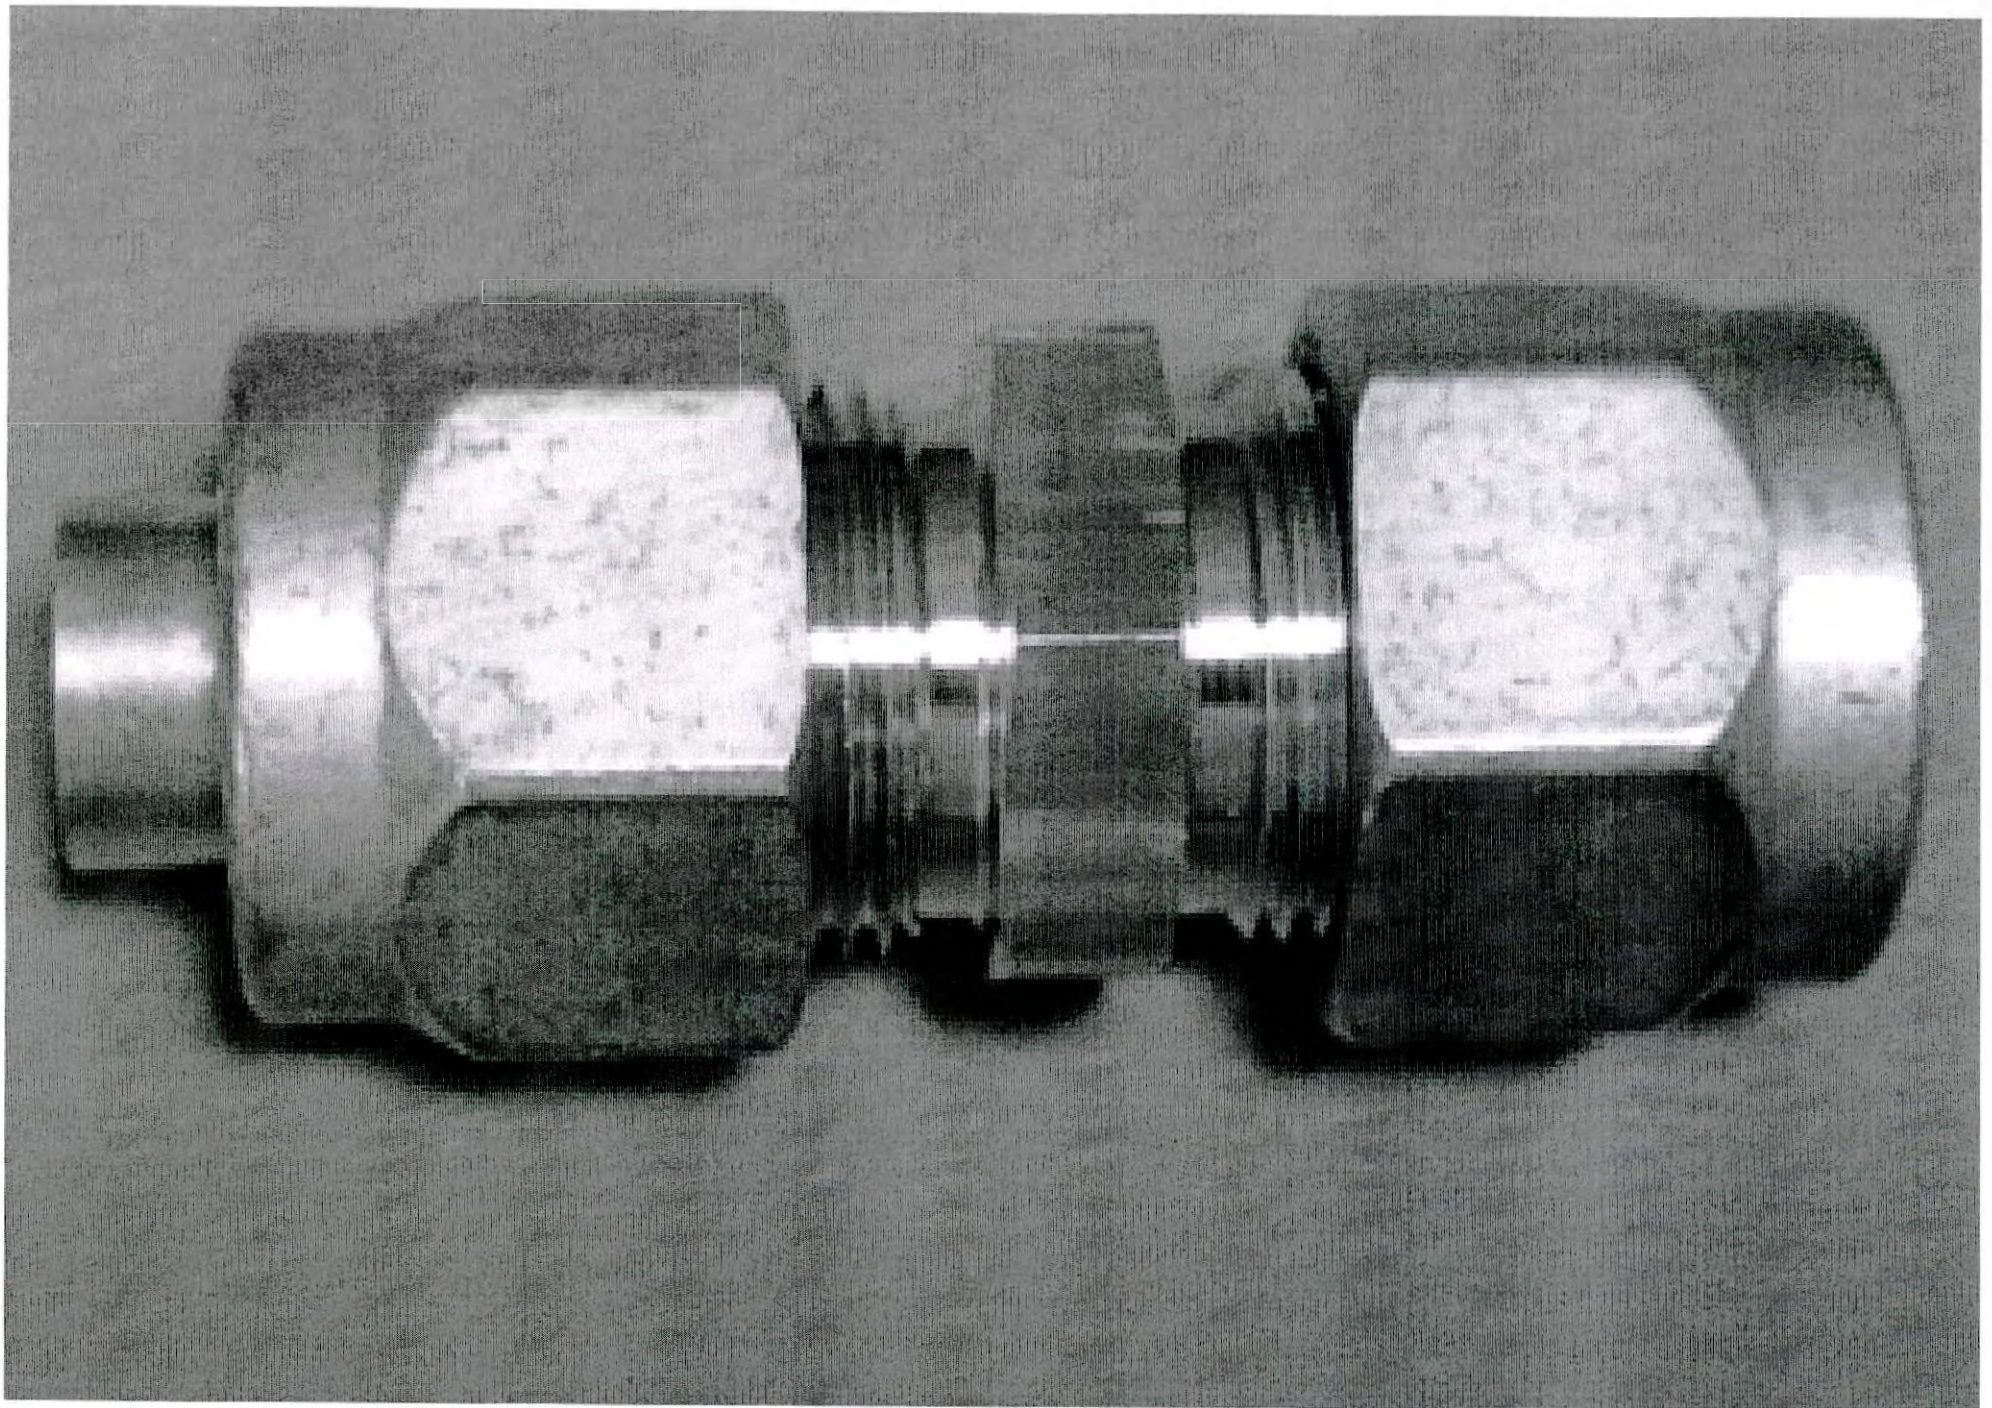


Рисунок 32. Соединительный набор для подключения эжектора