


ПОДТВЕРЖДАЮ
точность, достоверность
и правильность
ООО «Миндрей Медикал Рус»
Генеральный директор Сюн Вей


(подпись, М.П.)
ПО ДОВЕРЕННОСТИ ОТ 11.05.21г
СЫСОВА Н.В.

Фотографические изображения медицинского изделия

Система ультразвуковой визуализации универсальная серии Z с принадлежностями, варианты исполнения:

Z60, Z60T, Z60S, Z60W, Z60 Pro, Z60 Expert.



Основной блок Z60



Основной блок Z60S




Основной блок Z60W



Основной блок Z60 Pto




Основной блок Z60 Expert

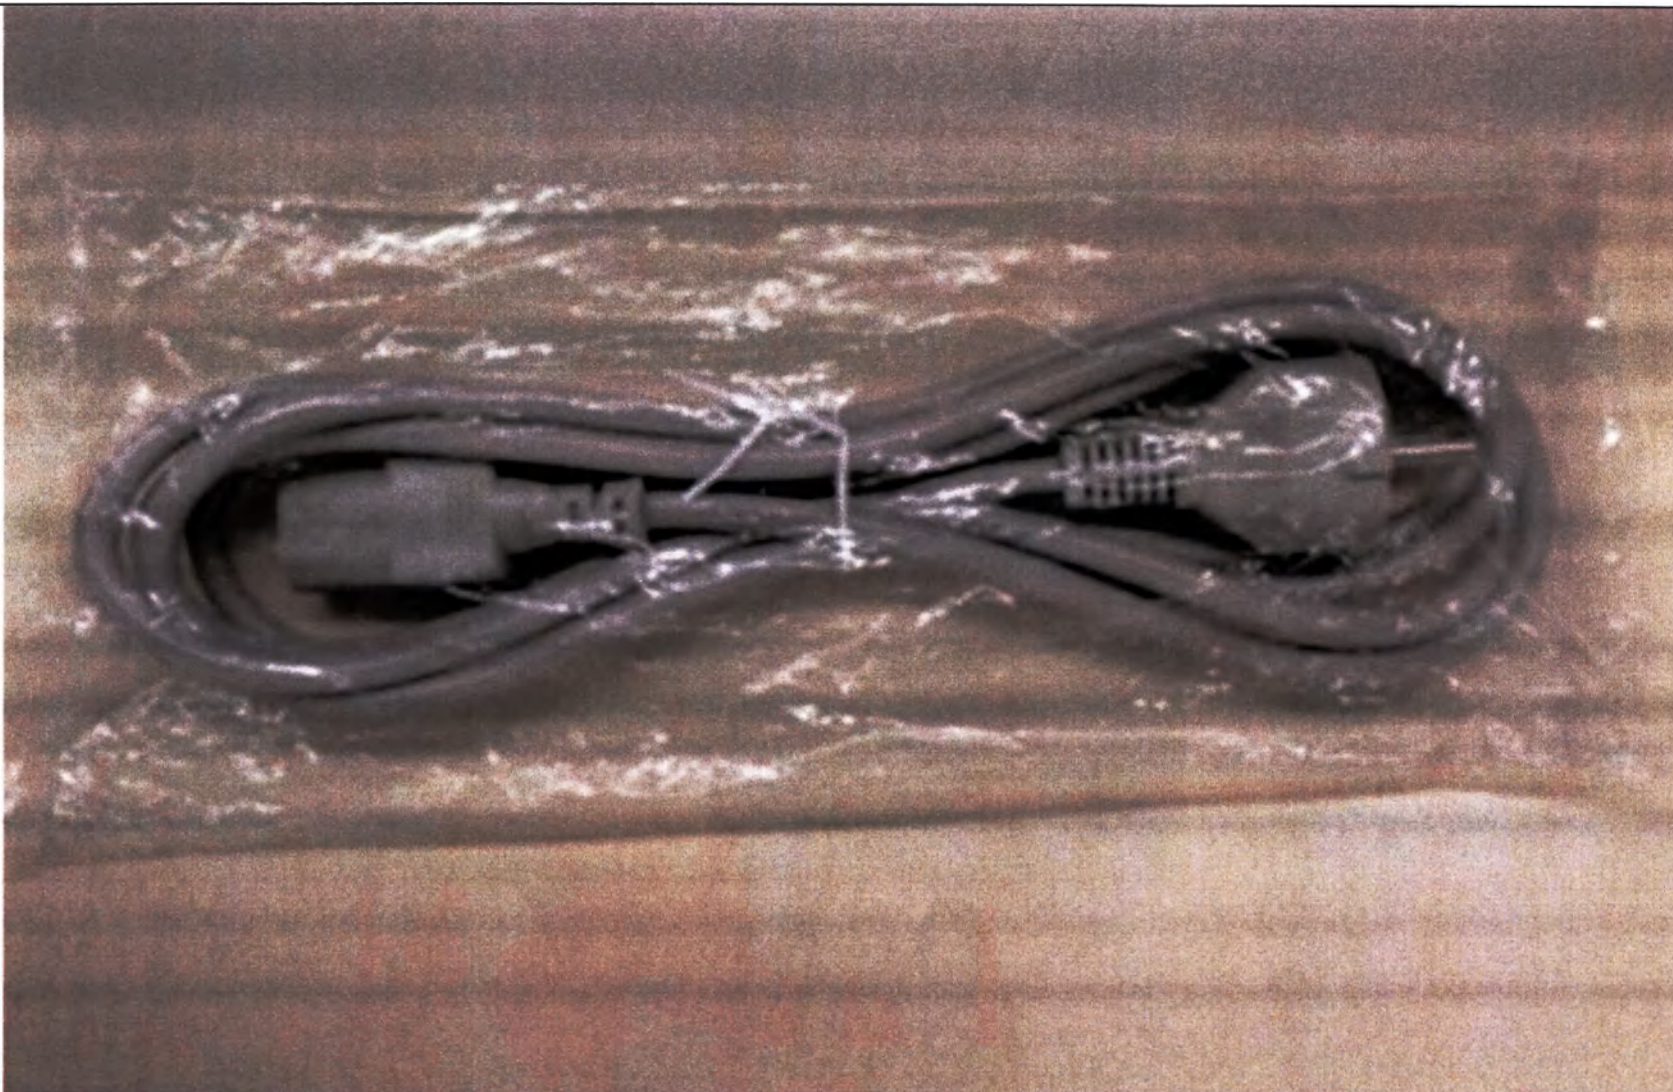


Кабель питания




Руководство по эксплуатации

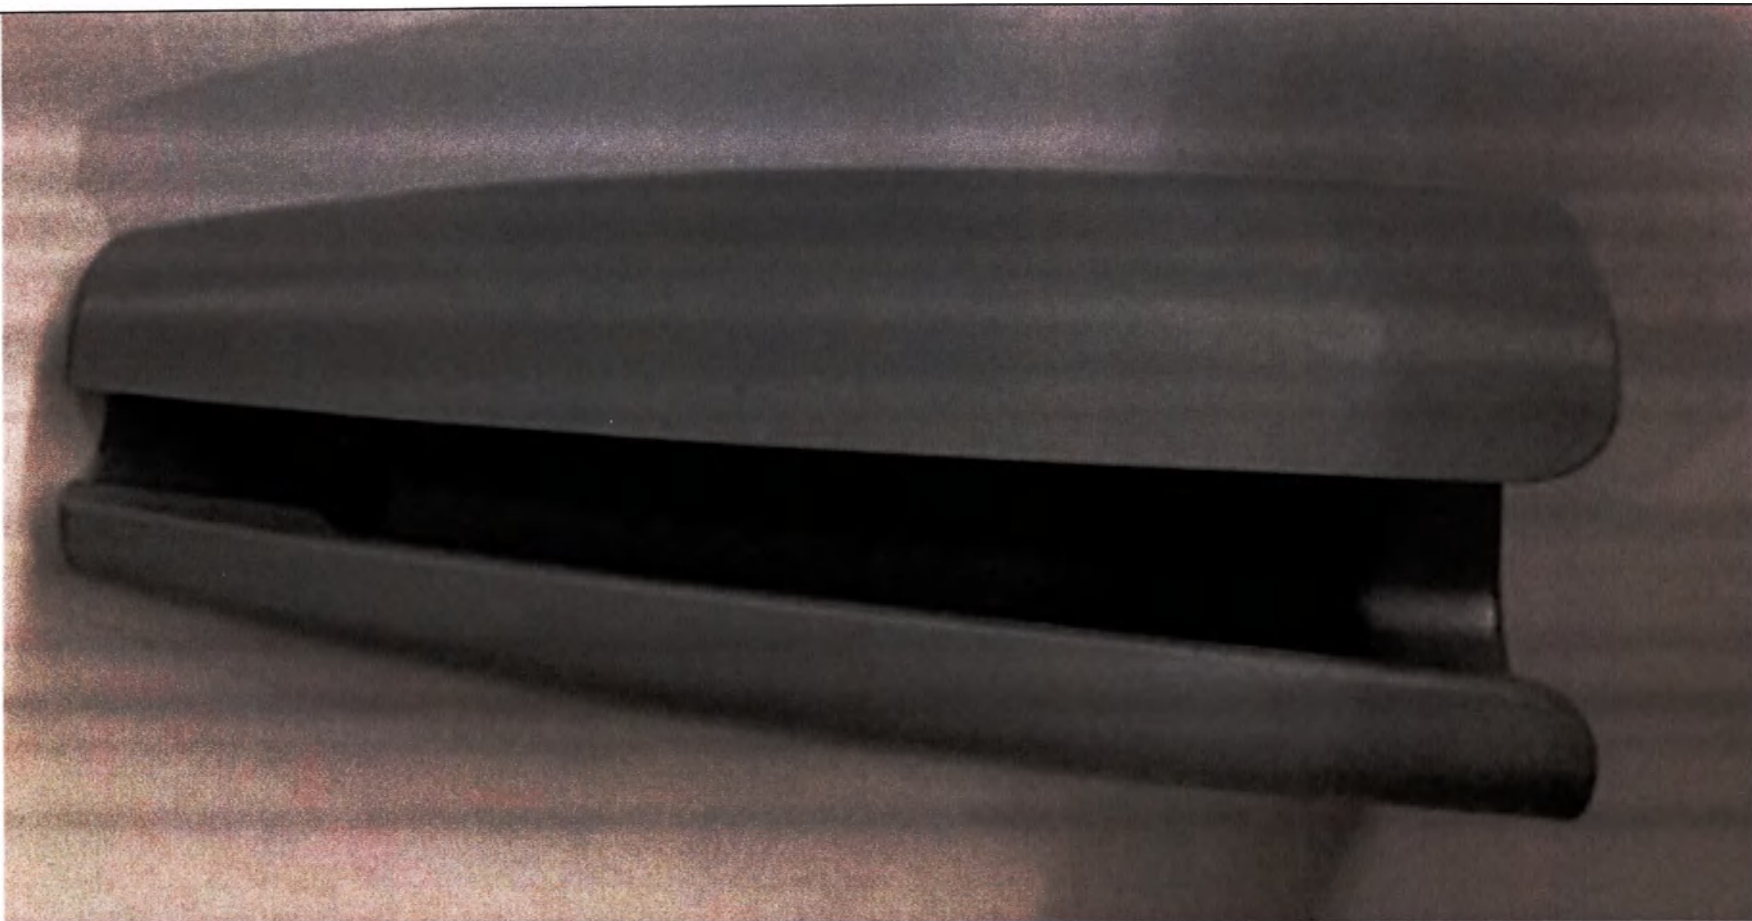

Держатель для датчика большой

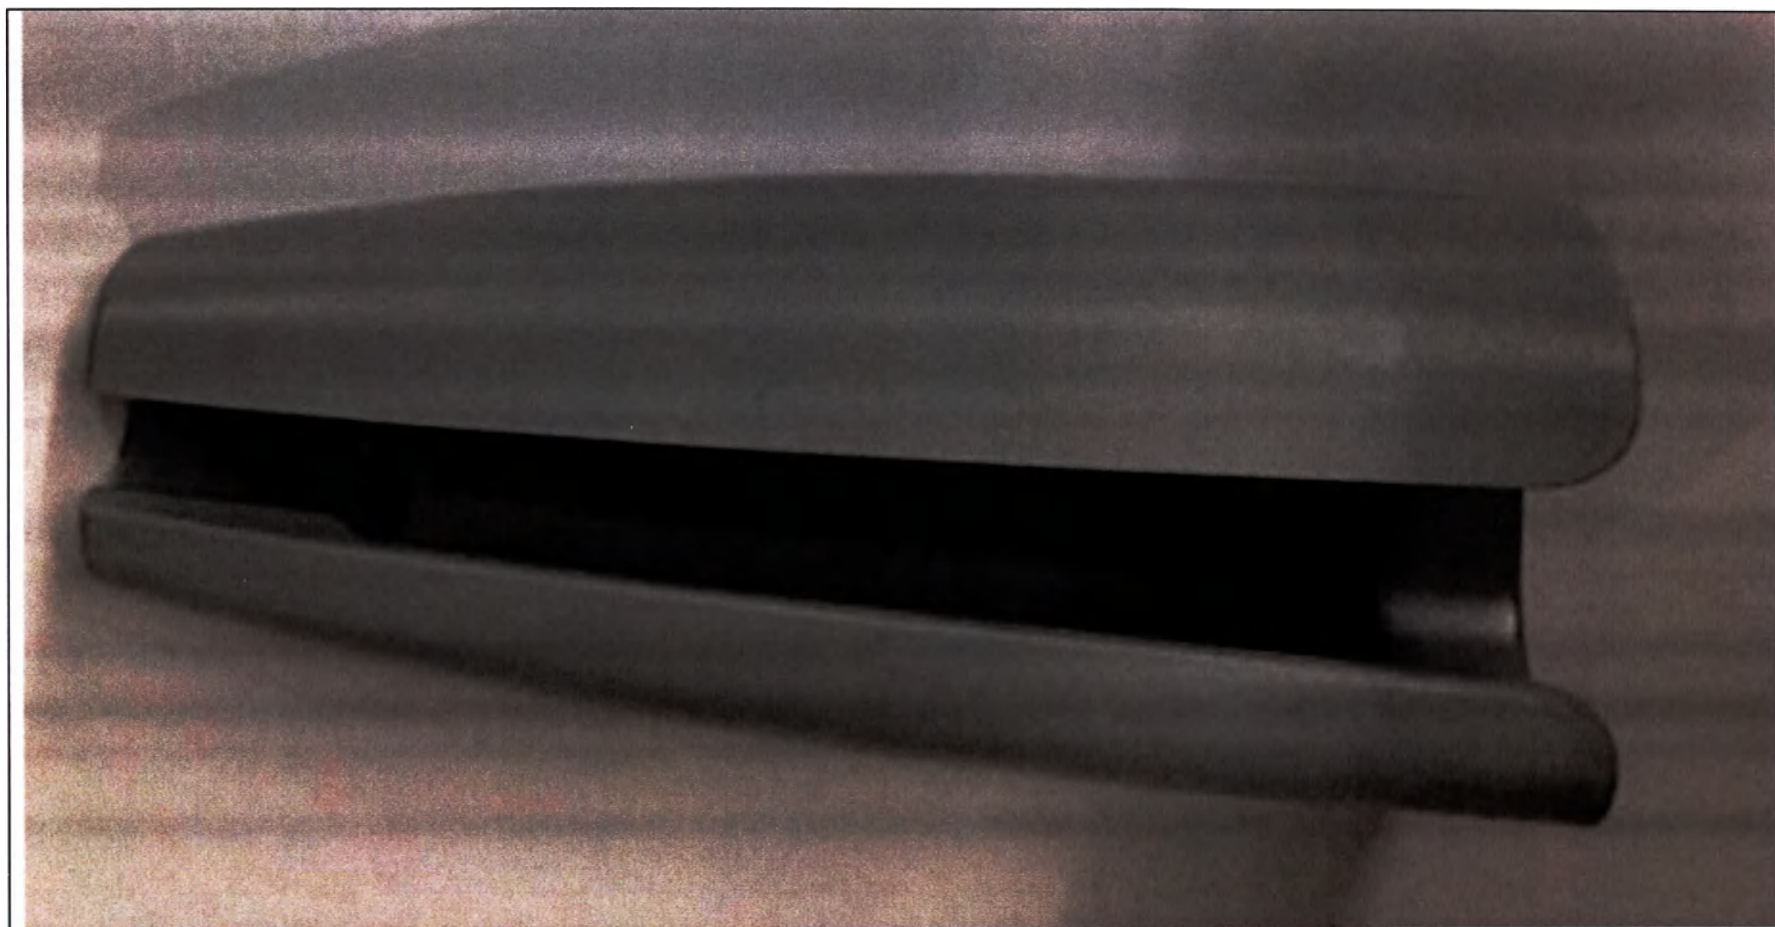


Держатель для датчика большой

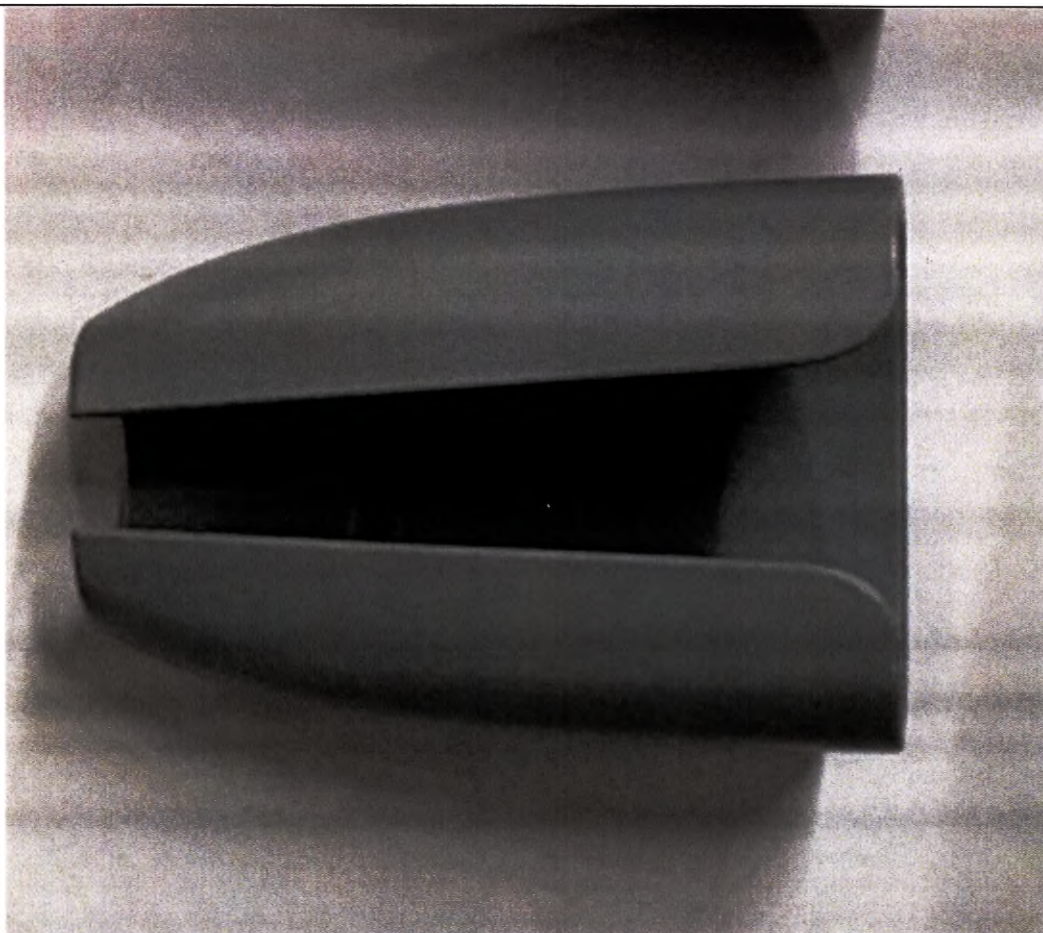


Держатель для датчика малый



Кабель заземления

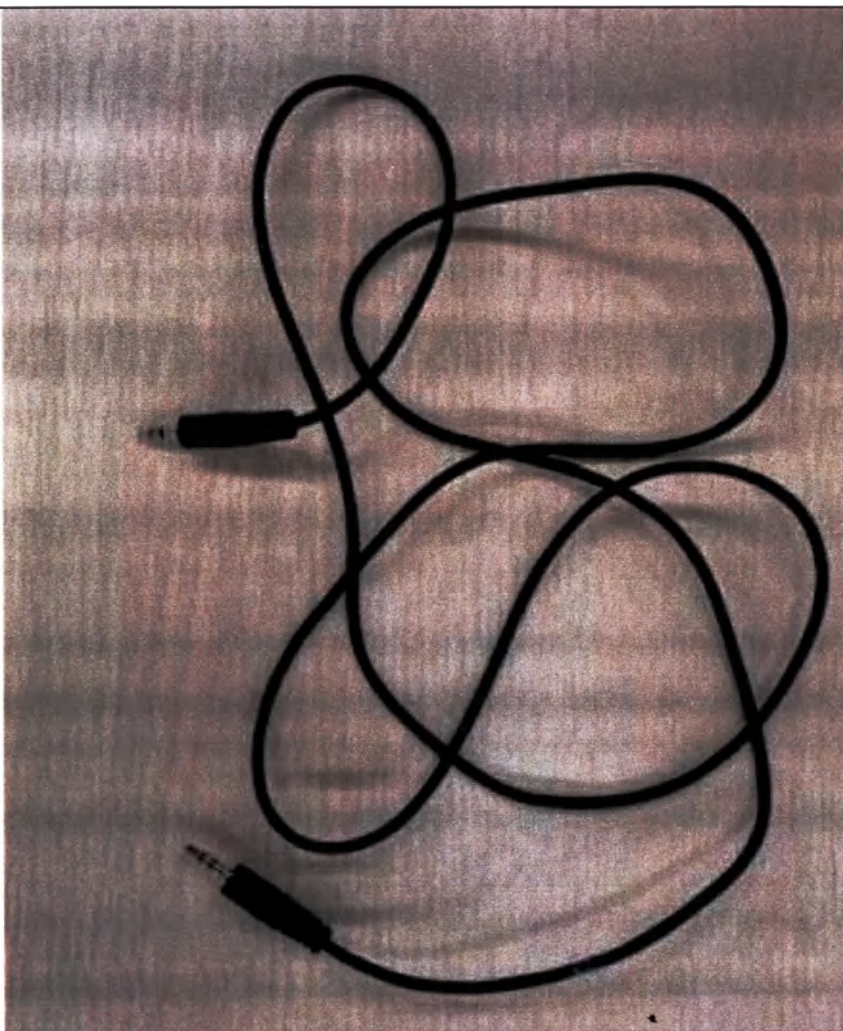


Кабель управления видеопринтером

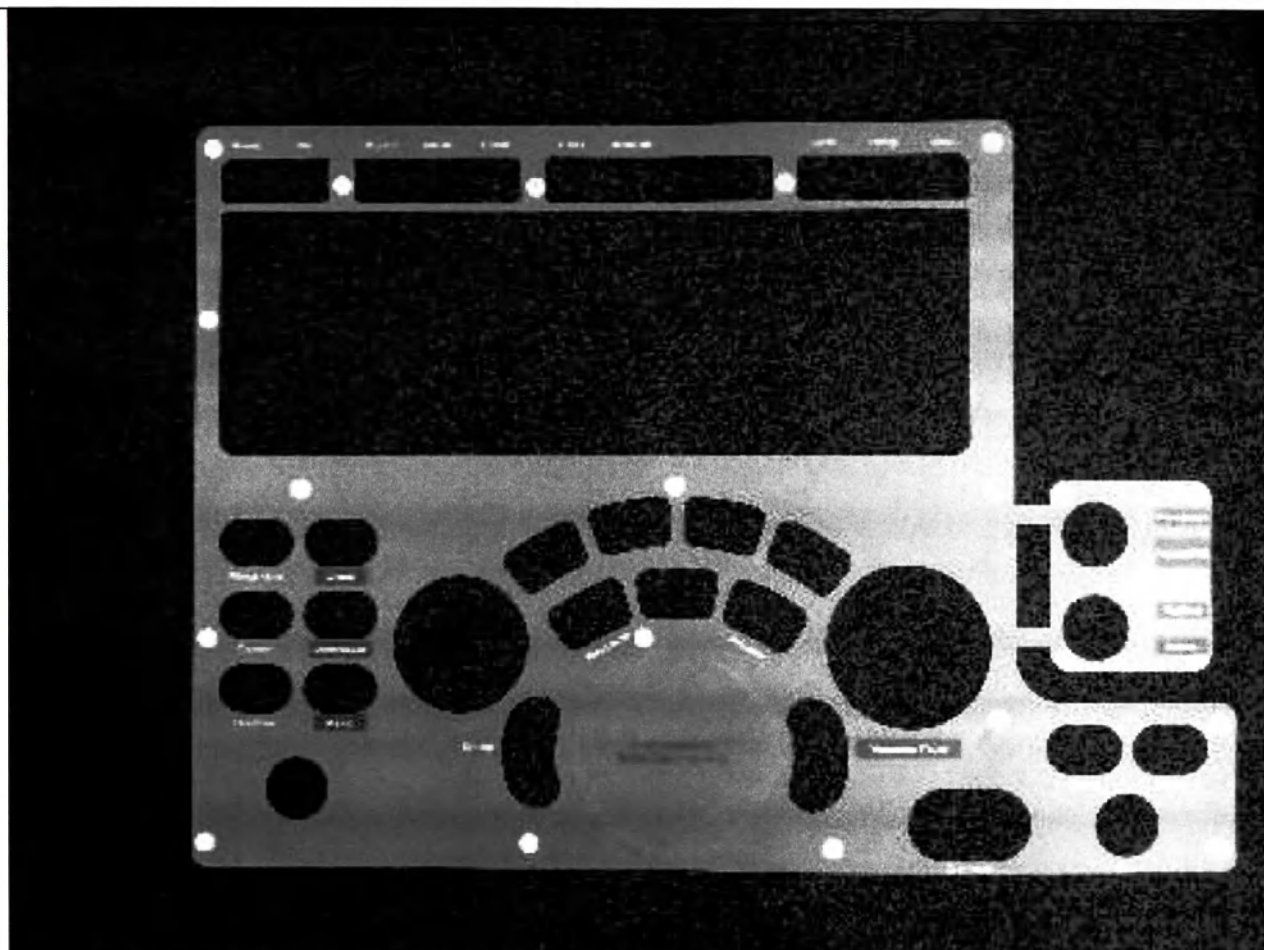

Накладка на панель управления (руссифицированная)



Внешний DVD-привод с интерфейсом USB

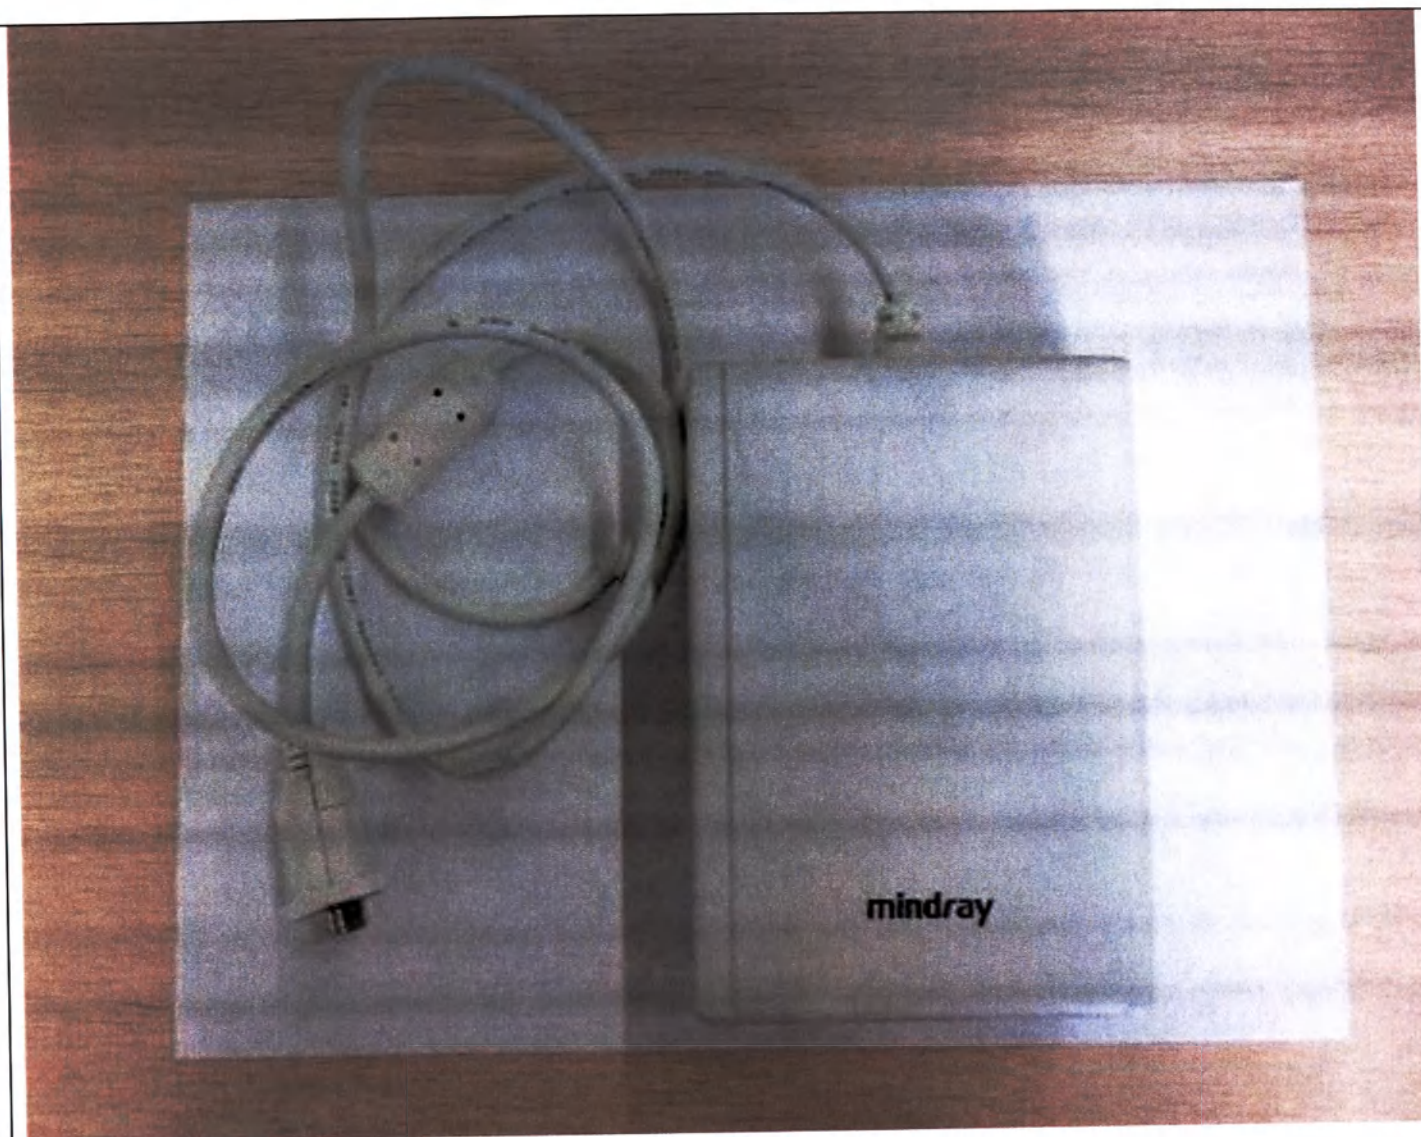

Модуль ЭКГ



Кабель ЭКГ на 5 отведений



Кабель ЭКГ на 3 отведения взр/пед, стандарт IEC



Литий-ионная батарея LI34I002A




Комплект сетевого адаптера LPA11 для подключения принтера, составе: Блок LPA11; Внешний адаптер питания для блока LPA11; Кабель питания для LPA11; Сетевой кабель для LPA11.



Ножной переключатель, 2 клавиши



Ножной переключатель, 3 клавиши

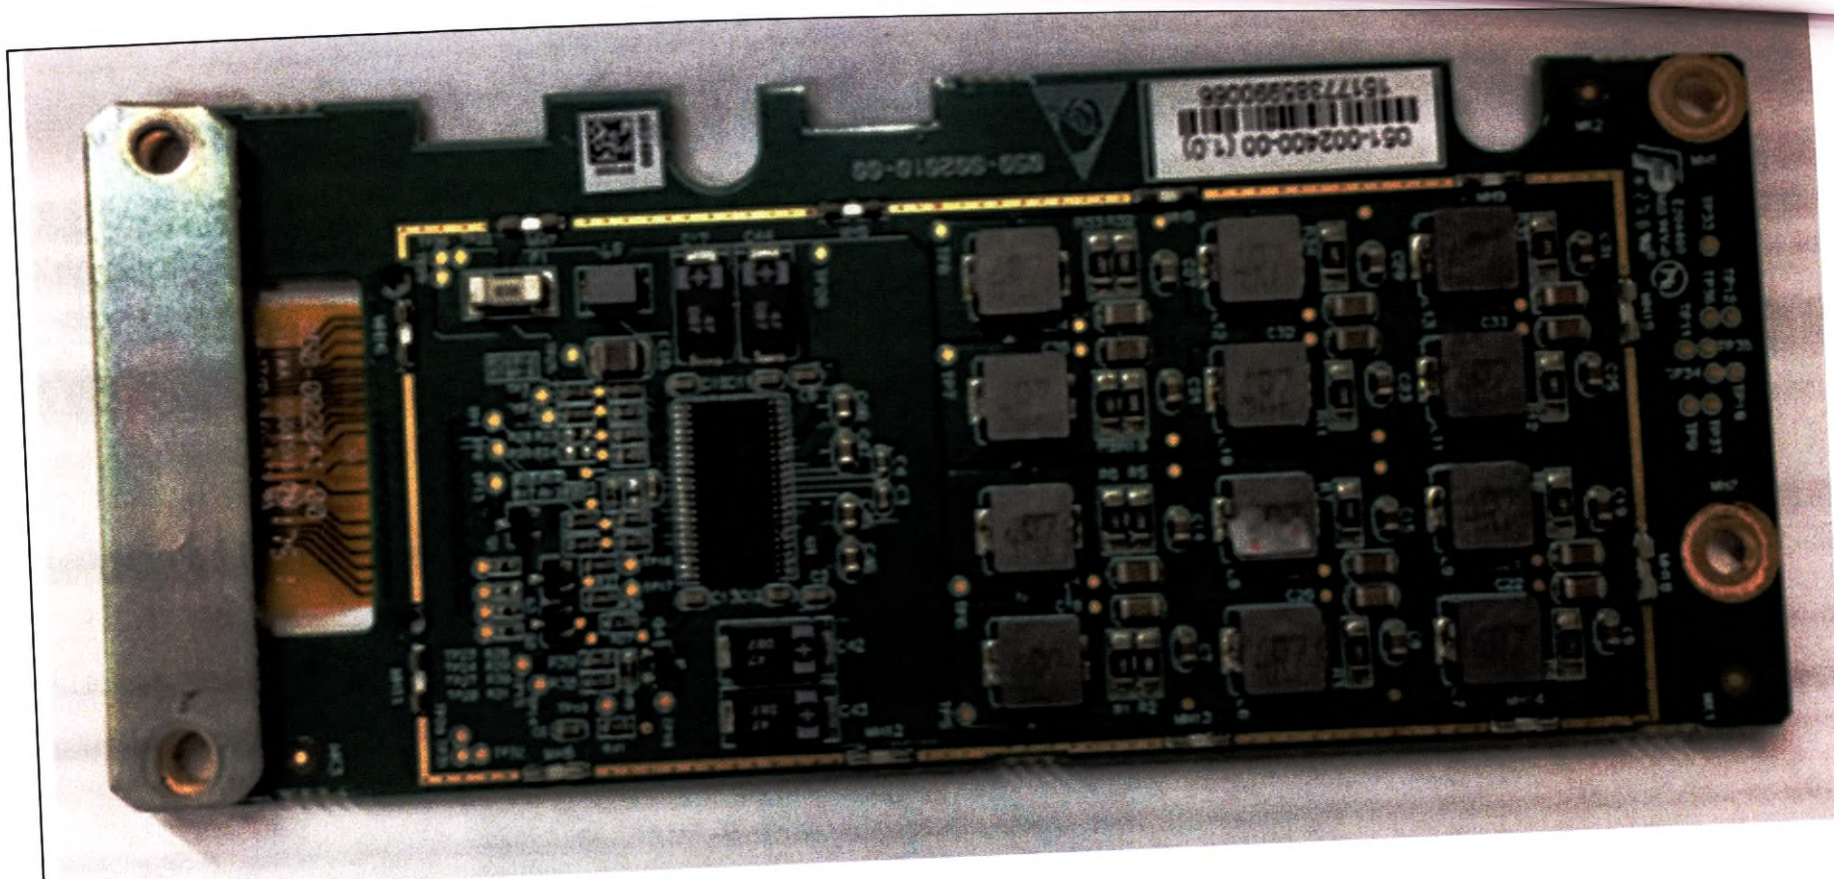


Комплект 4D модуля (Плата 4D модуля)

Сумка



Датчики ультразвуковые:

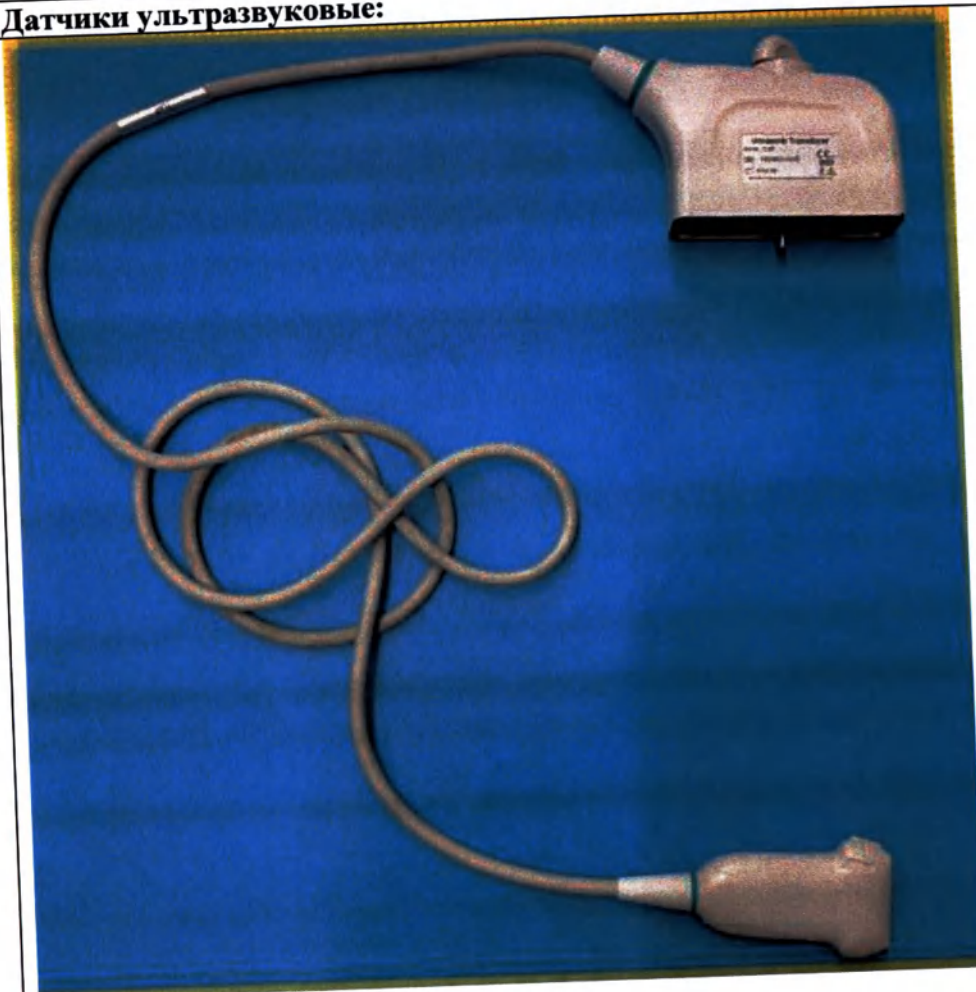

Линейный 7L4P




Линейный 7L5P



Линейный L14-6P



Линейный 75L38P

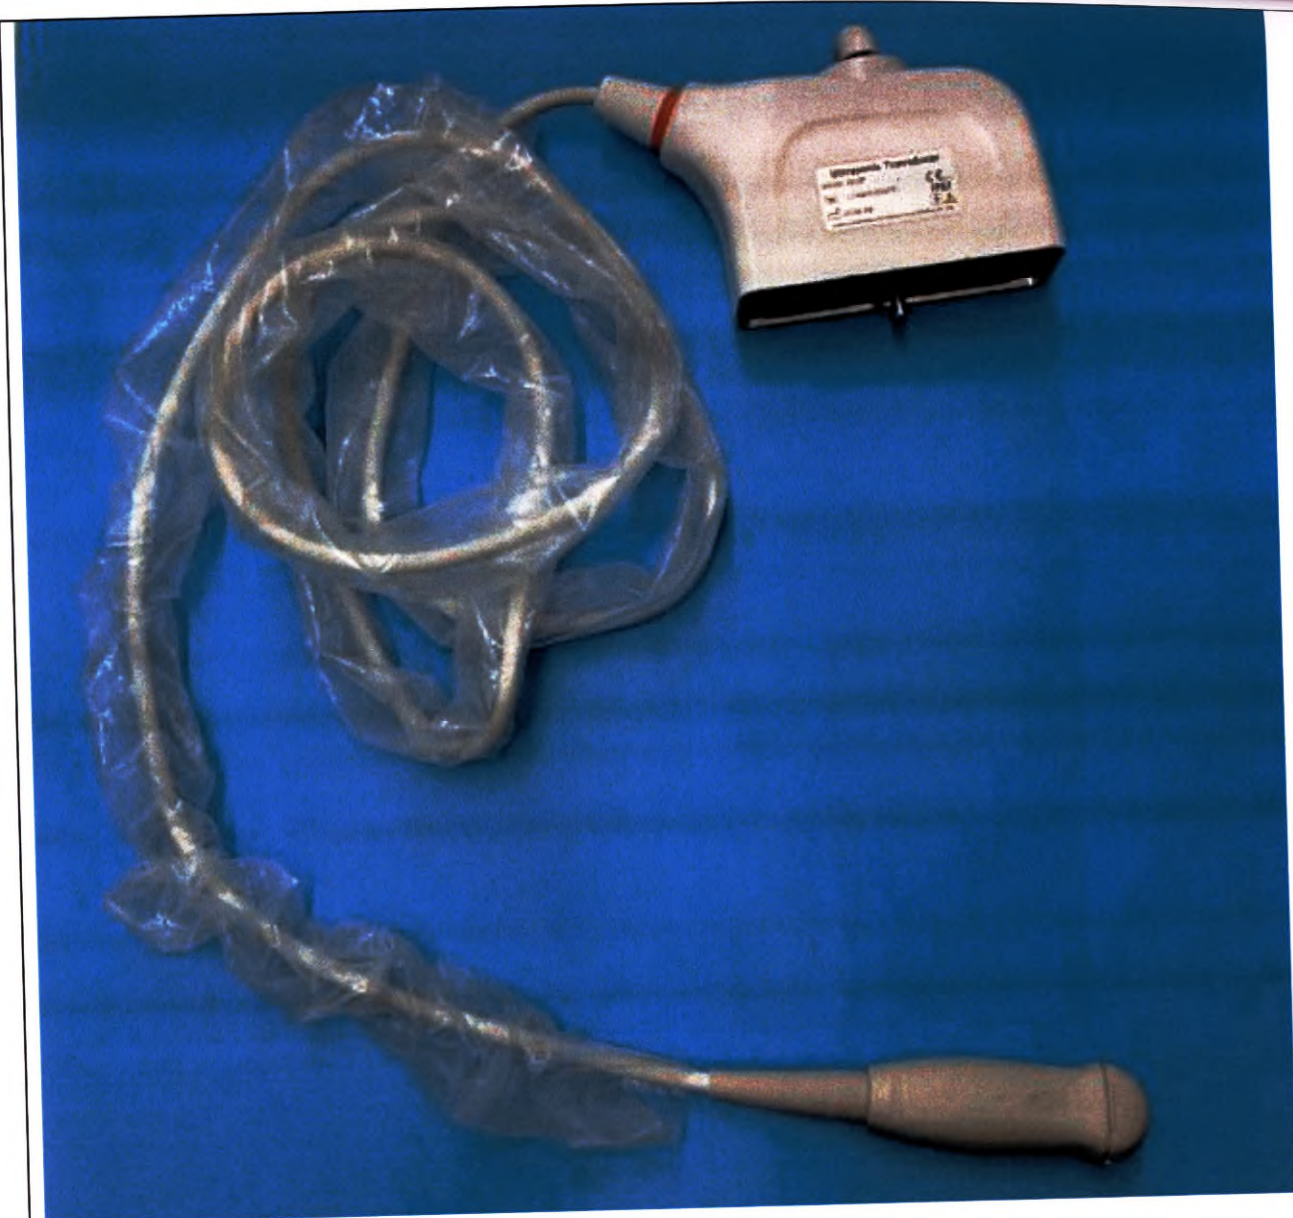

Микроконвексный 6C2P



Объемный конвексный D6-2P



Конвексный ЗС5Р



Конвексный конвексный 35C50P




Конвексный С6-2Р



Внутриполостной 6CV1P



Внутриполостной V10-4BP

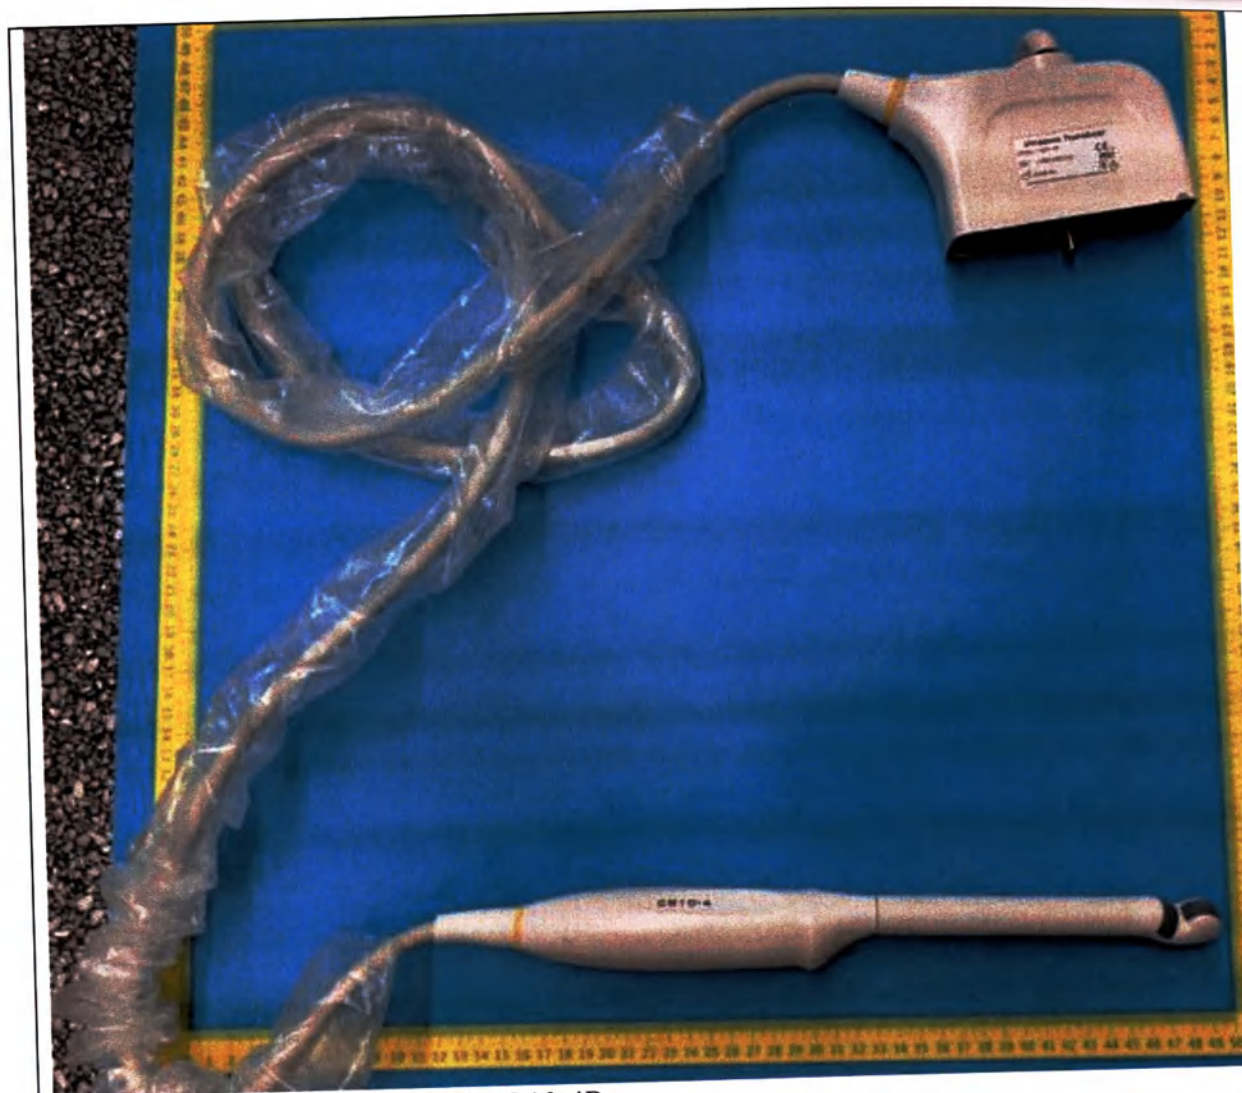

Внутриполостной биплановый CB10-4P



Внутриполостной биплановый 6LE7P



Секторный фазированный 2P2P



Секторный фазированный Р7-3Р

Насадки биопсийные:



Металлическая, со съемной направляющей для игл NGB-001



Металлическая, с несъемной направляющей для игл NGB-001



Металлическая, с несъемной направляющей для игл NGB-002




Металлическая, с несъемной направляющей для игл NGB-004



Металлическая, с несъемной направляющей для игл NGB-005




Металлическая, со съемной направляющей для игл NGB-006

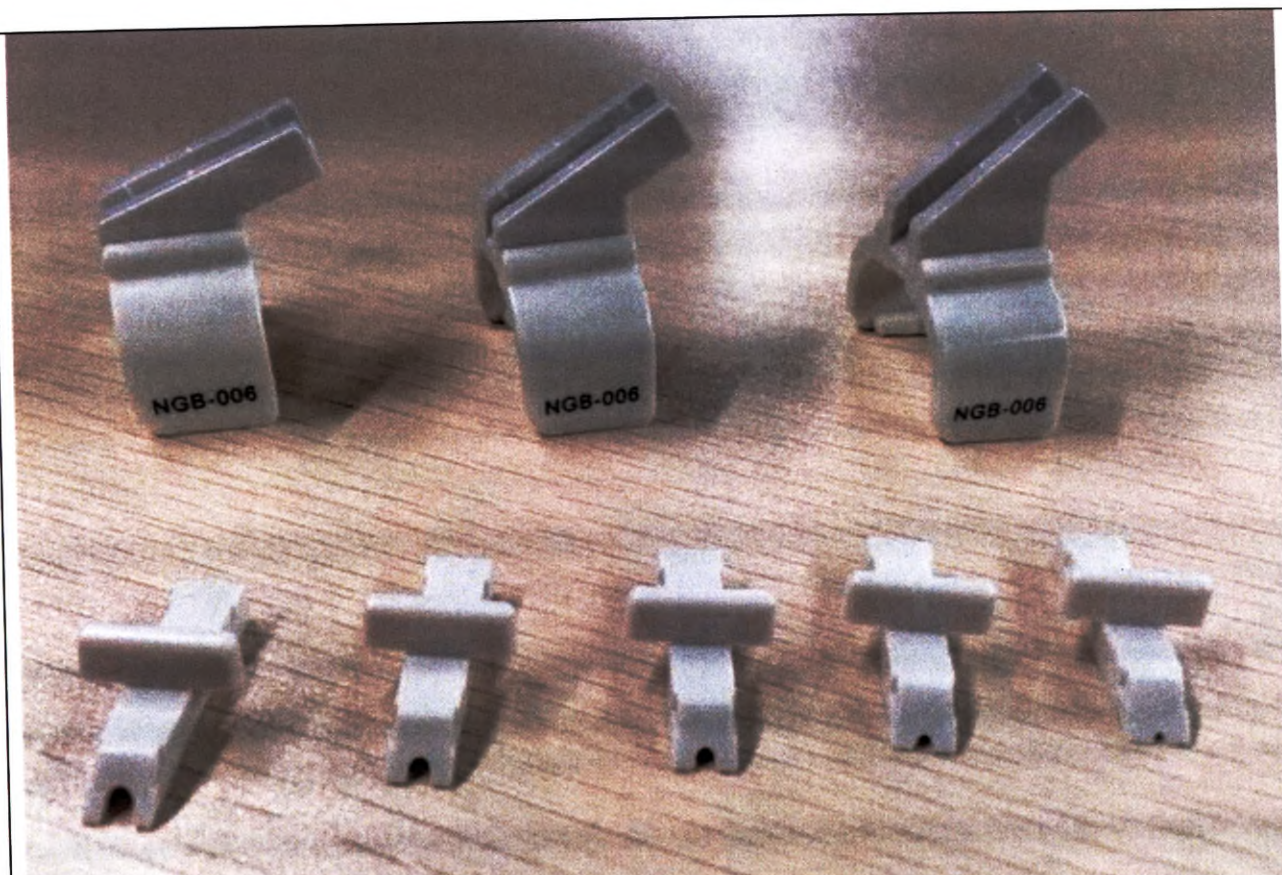


Пластиковая, с несъемной направляющей для игл NGB-006




Металлическая, со съемной направляющей для игл NGB-007

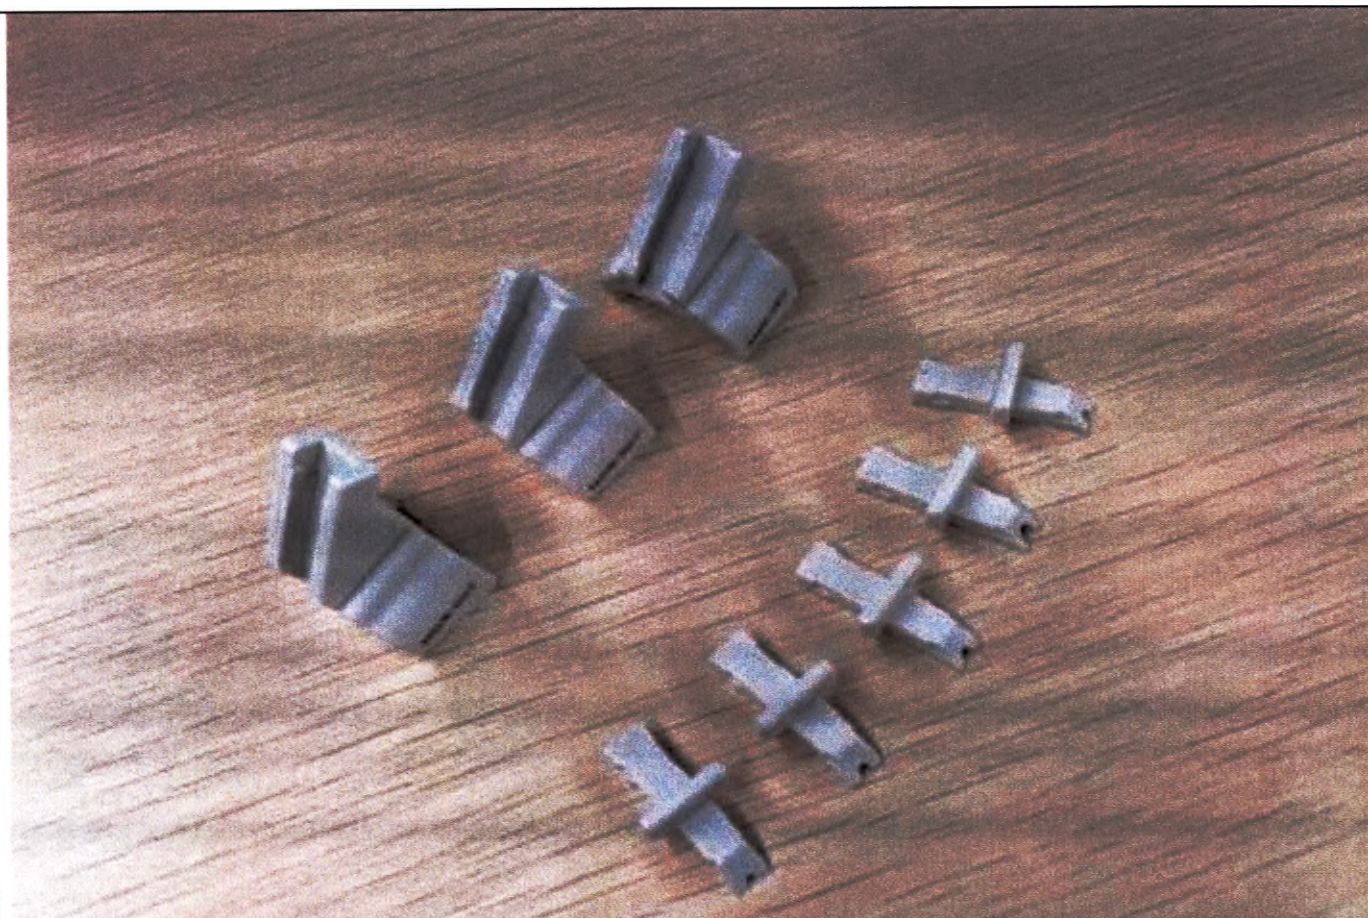


Пластиковая, с несъемной направляющей для игл NGB-007

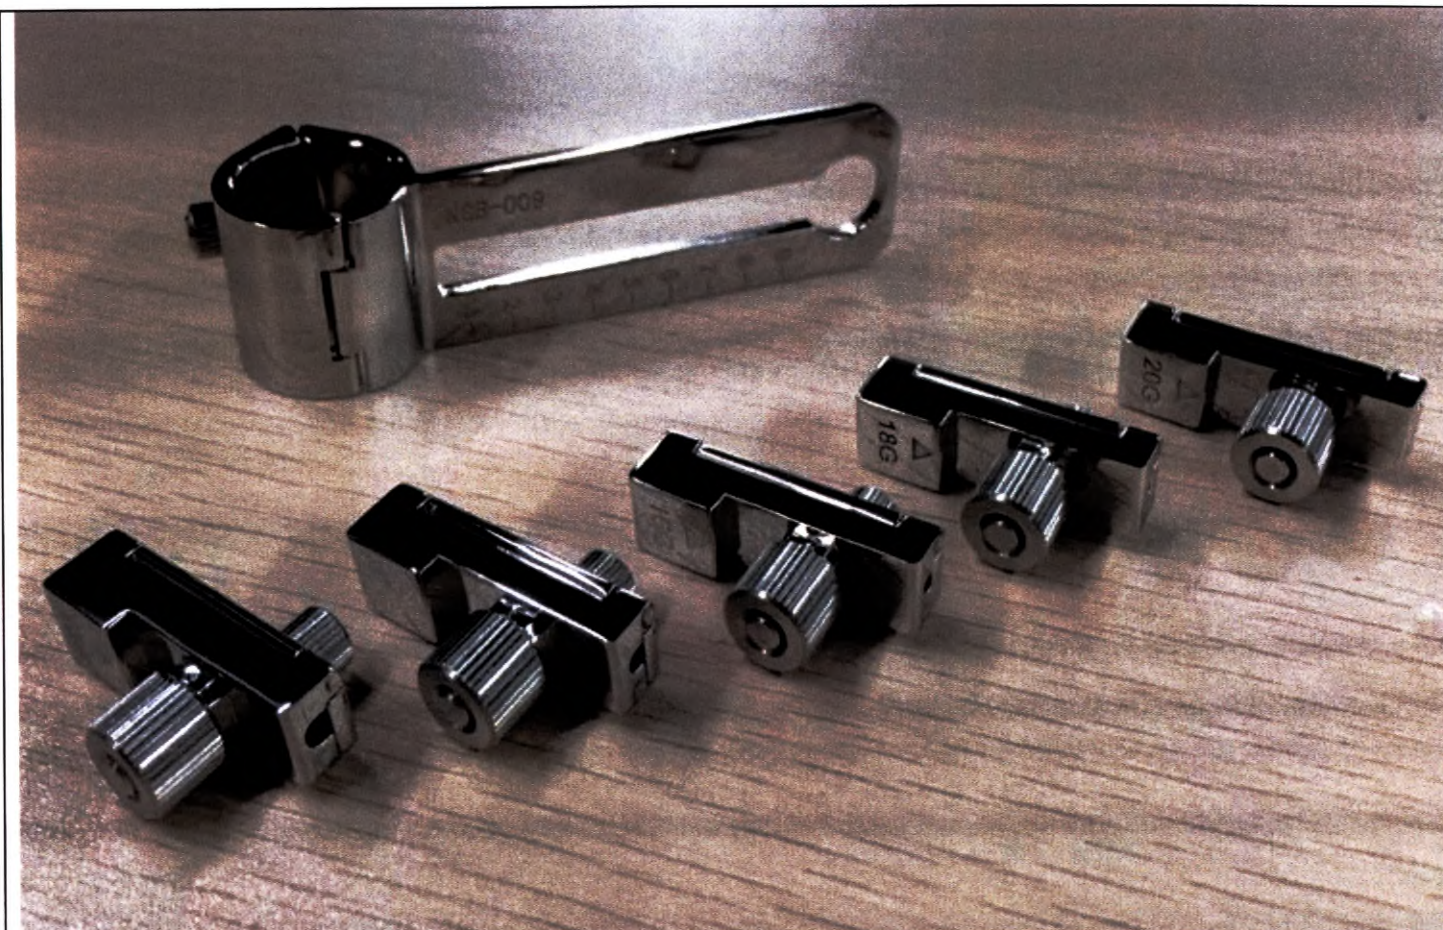

Металлическая, со съемной направляющей для игл NGB-009

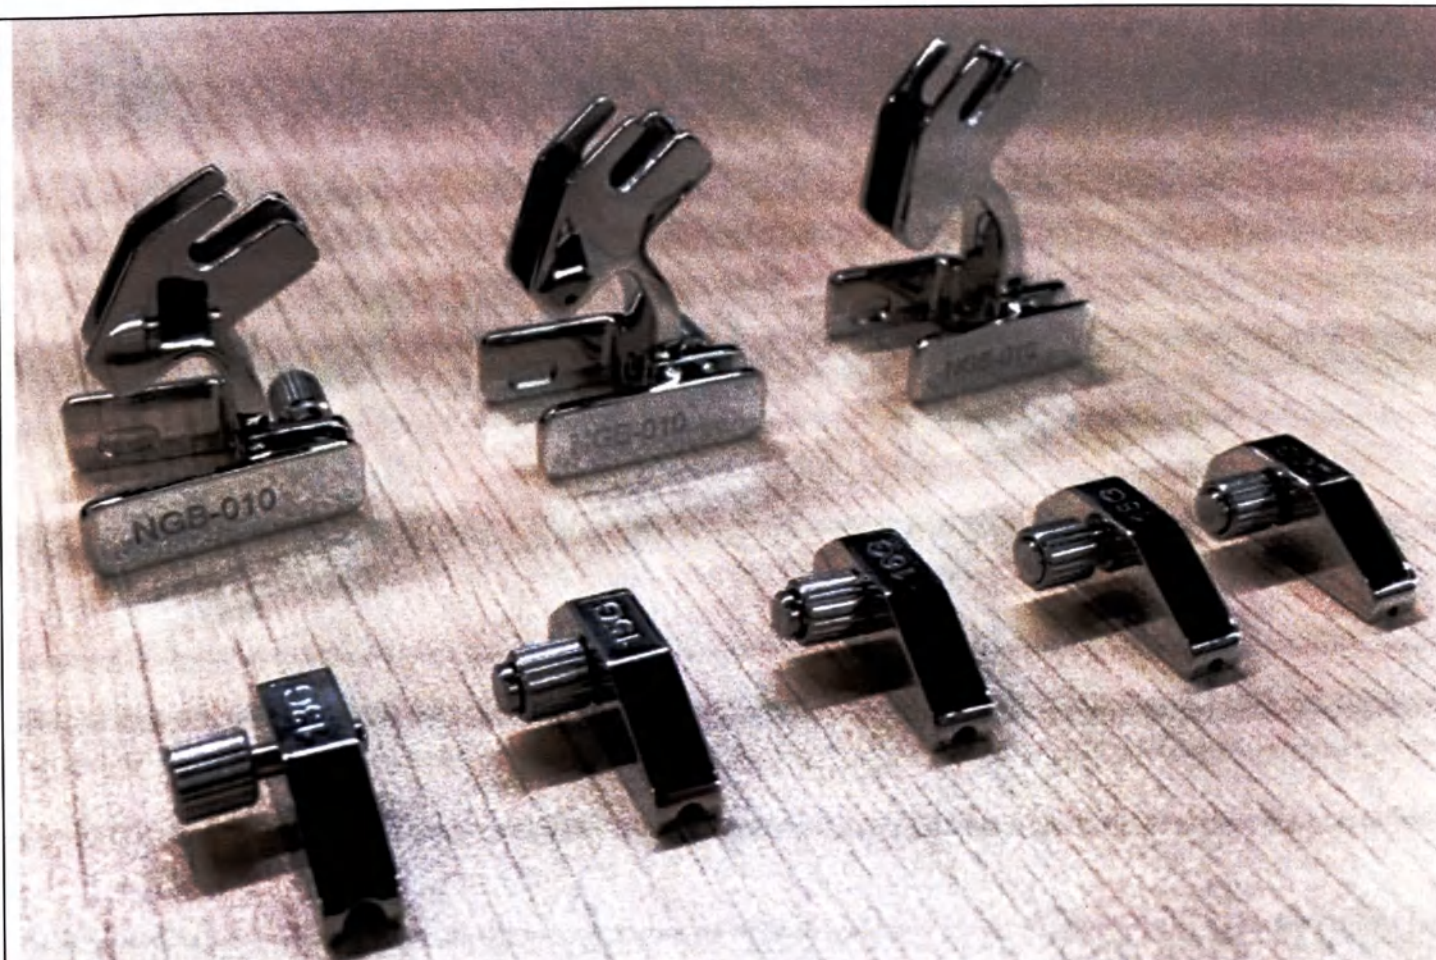

Металлическая, со съемной направляющей для игл NGB-010

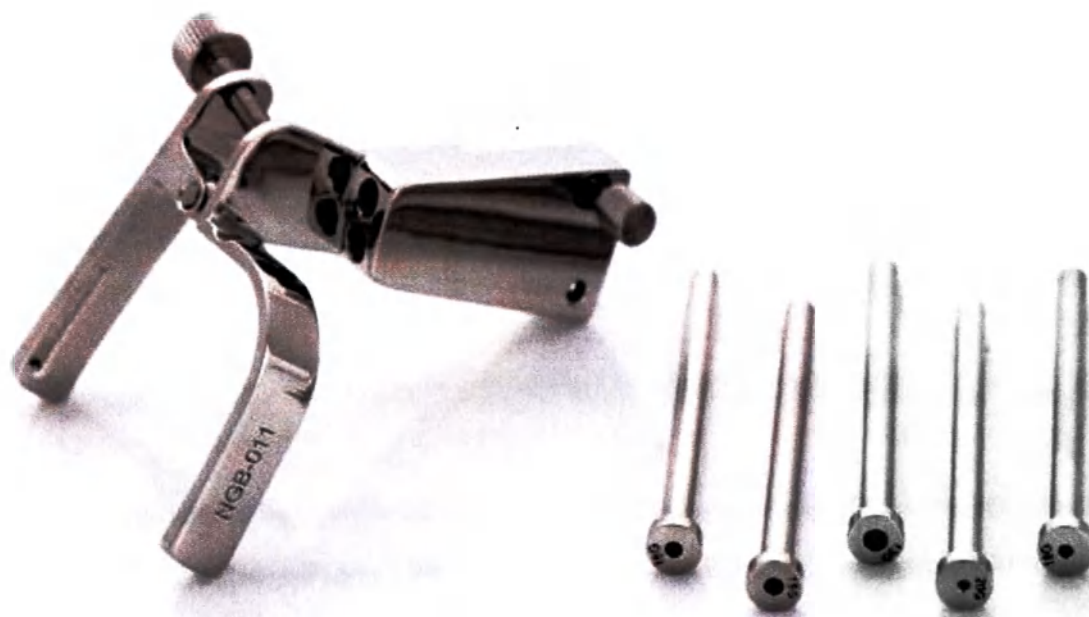

Металлическая, с несъемной направляющей для игл NGB-011




Металлическая, со съемной направляющей для игл NGB-016



Металлическая, со съемной направляющей для игл NGB-022


Программное обеспечение:

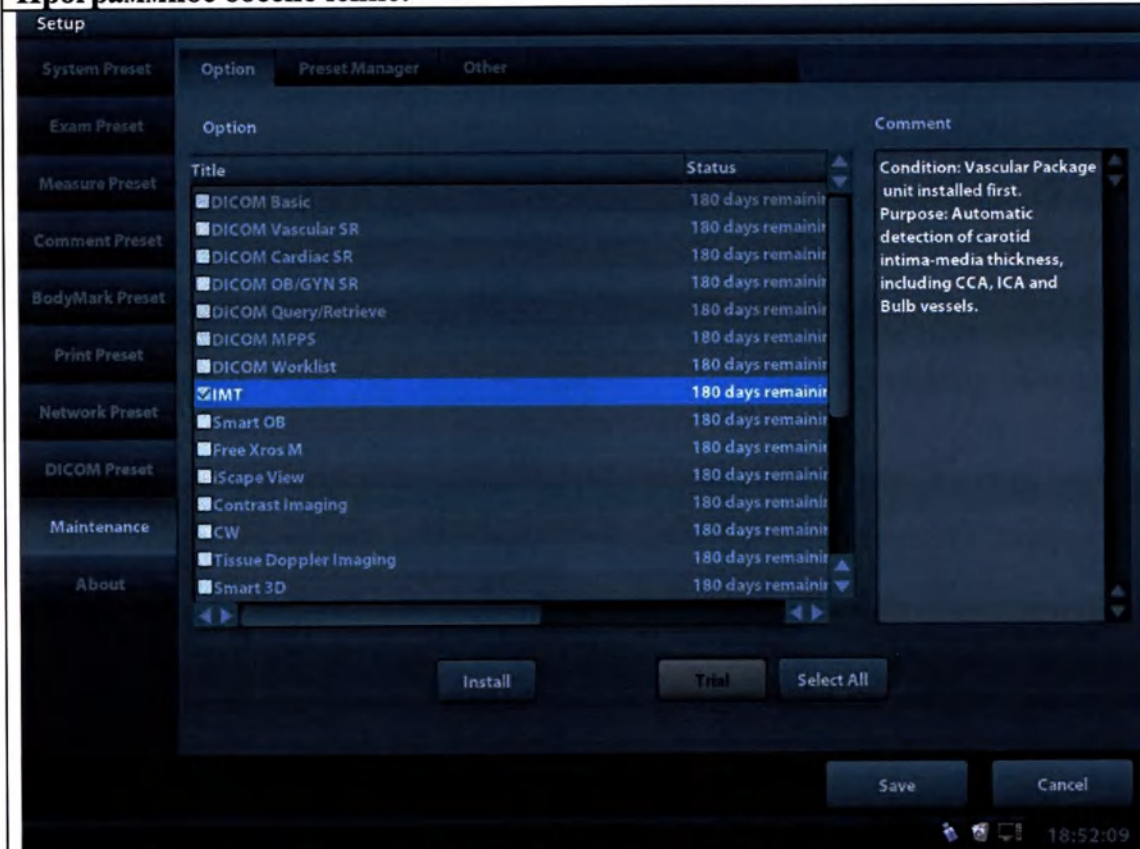


Для интеграции в больничную сеть DICOM: Базовый набор опций DICOM (DICOM Basic)



Для интеграции в больничную сеть DICOM: Загрузка списка задач с DICOM-сервера (DICOM Worklist)

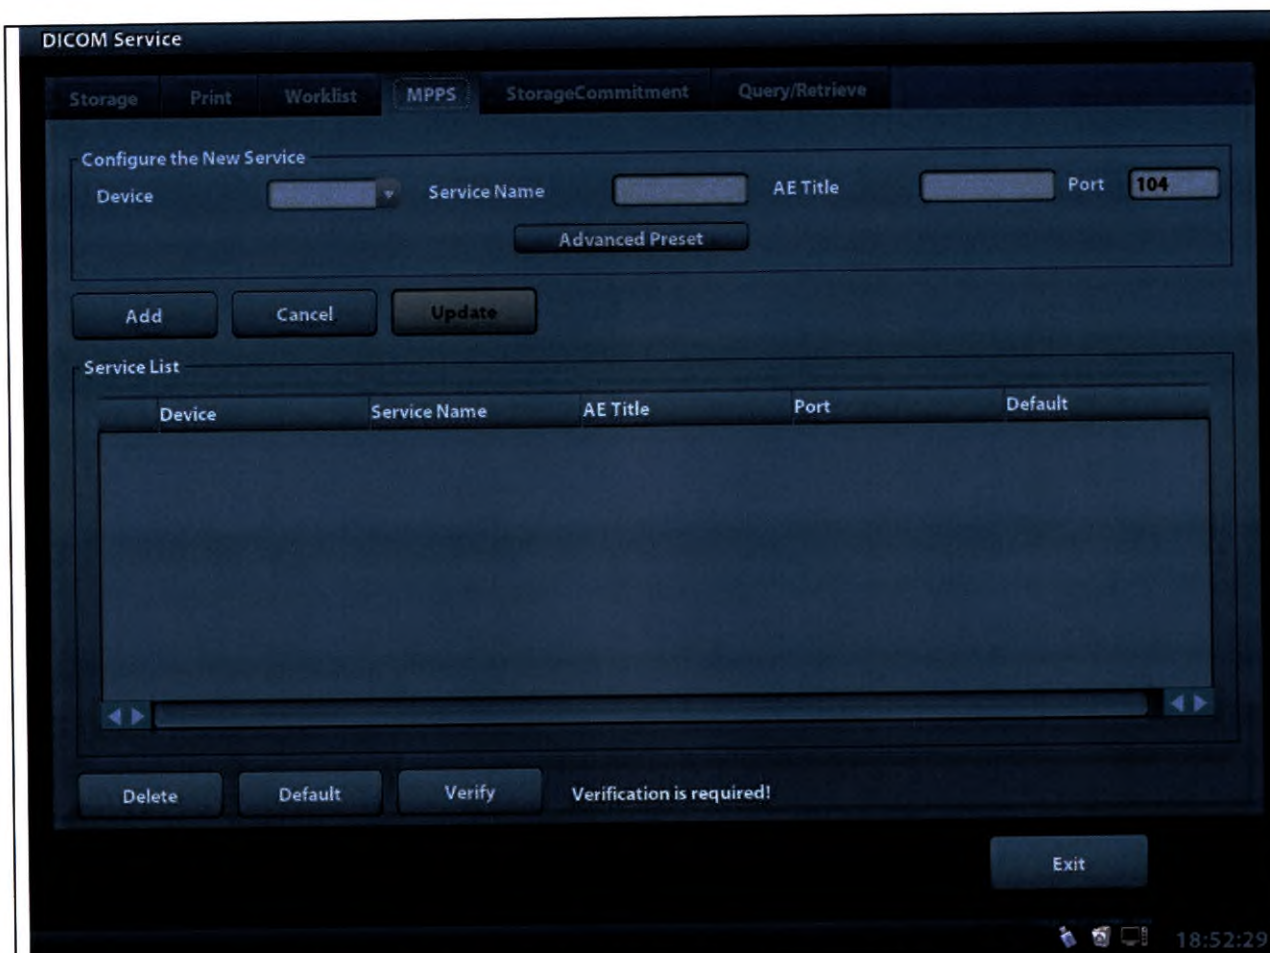

Для интеграции в больничную сеть DICOM: Загрузка на сервер DICOM дополнительной информации об условиях проведения обследования (DICOM MPPS)

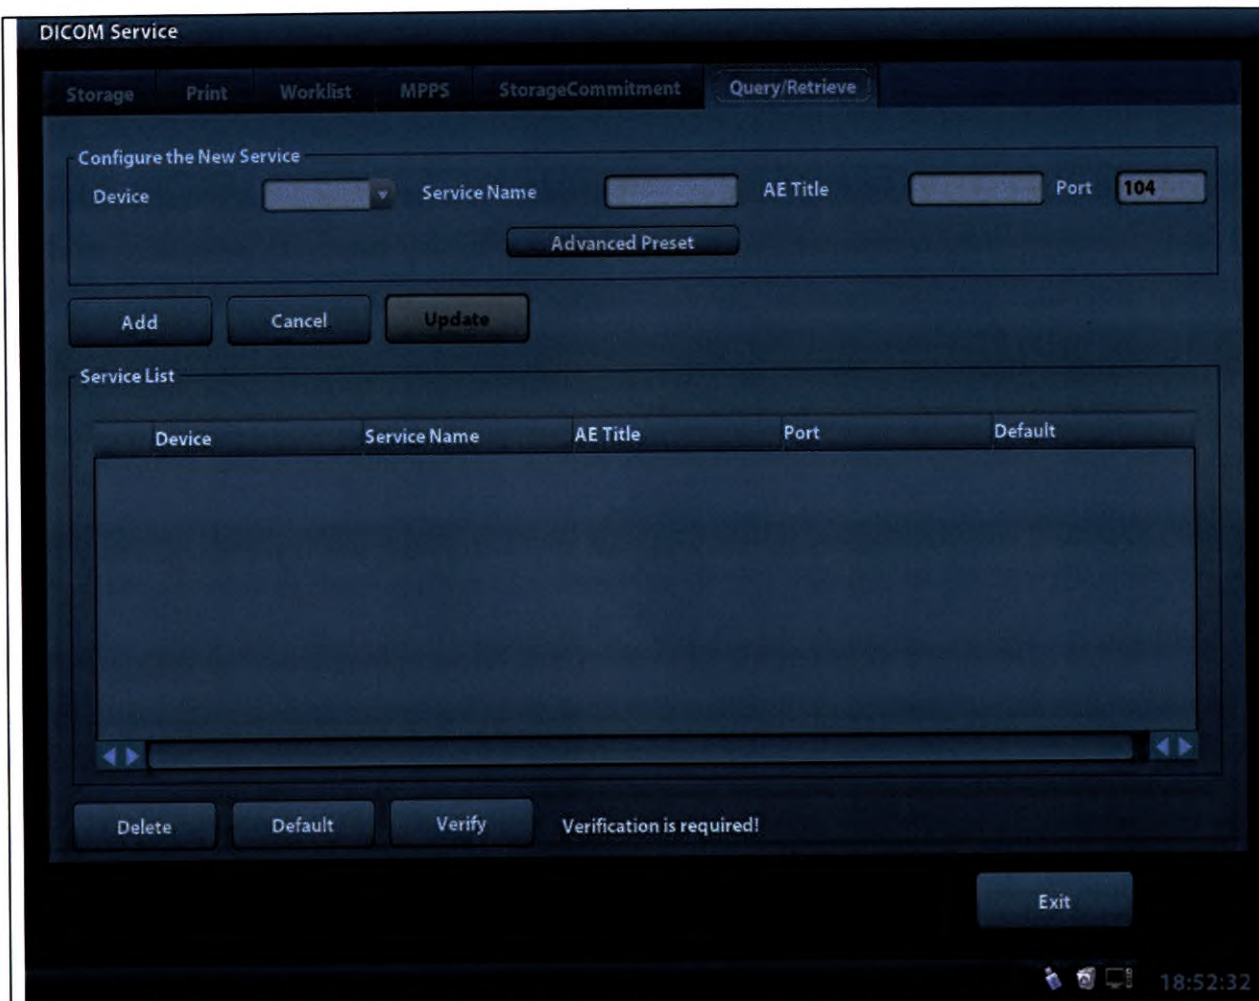


Для интеграции в больничную сеть DICOM: Запрос и получение данных пациента и изображений с сервера DICOM (DICOM Query/Retrieve)



Для интеграции в больничную сеть DICOM: Структурированный отчет для акушерских и гинекологических исследований в формате DICOM (DICOM OB/GYN SR)



Для интеграции в больничную сеть DICOM: Структурированный отчет для сосудистых исследований в формате DICOM (DICOM Vascular SR)

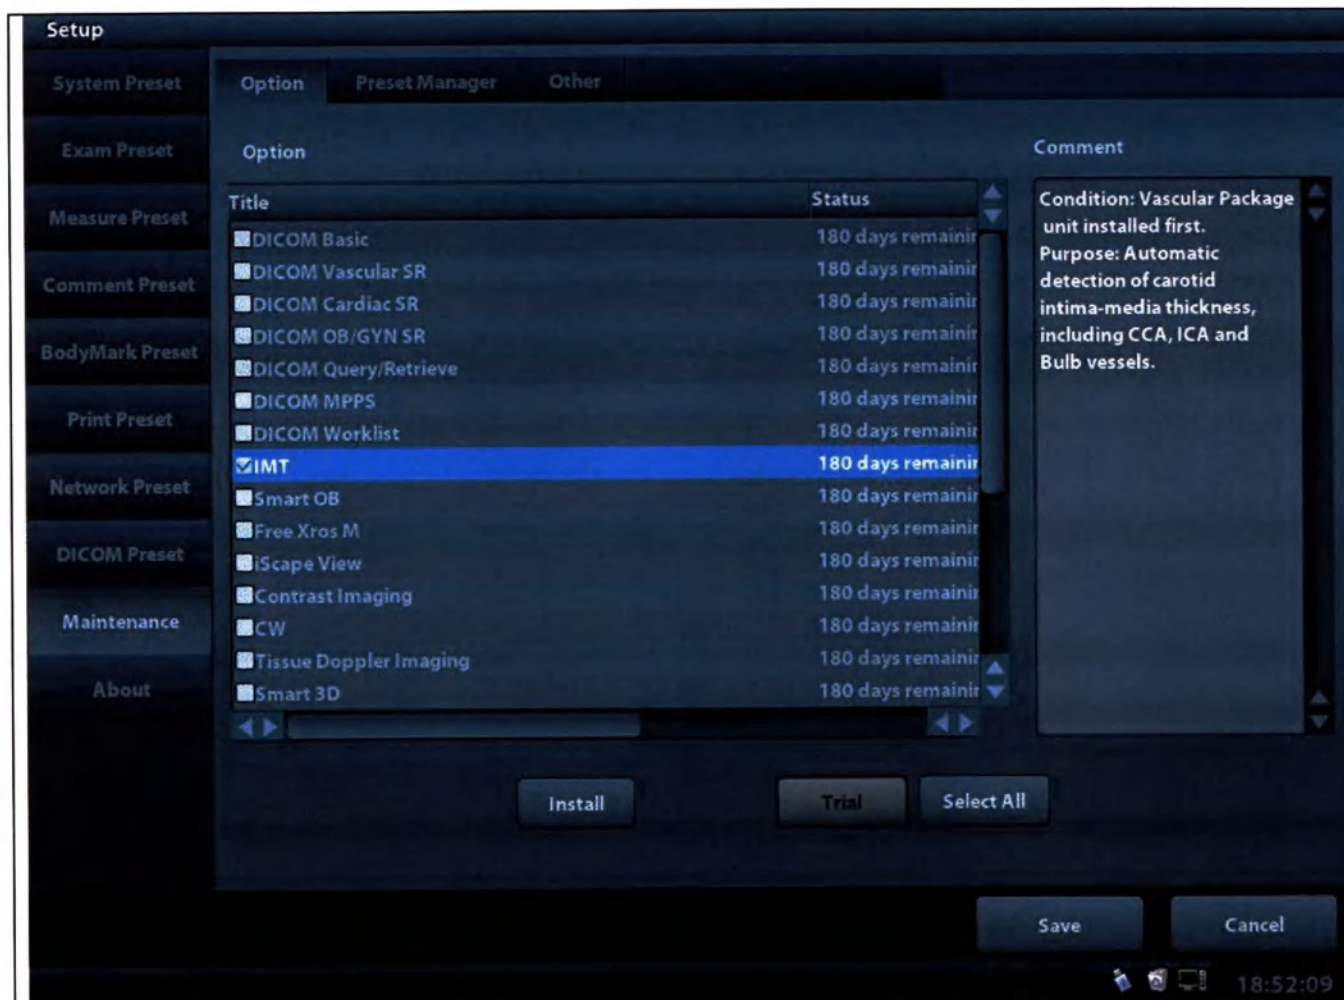

Для интеграции в больничную сеть DICOM: Структурированный отчет для кардиологических исследований в формате DICOM (DICOM Cardiac SR)

Fetal Biometry

mindray

20191028-202105-089F

28-10-2019 20:20:37

BPD

Dist

AP 95.8% MI 0.8 TIS 0.1

OFD

Dist

HC

Auto

AC

Ellipse

FL

Dist

HUM

Dist

PL Thickness

NT

TCD

CM

Return

Result

On

1

37/37

1 HC 26.29 cm

GA 28w4d

Z60

D6-2P

OB2/3

B

F H5.0M

D 14.8

G45

FR 25

DR 140

iClear 3

20:21:05


Для автоматического измерения акушерских параметров (Smart OB)




Для автоматического измерения толщины комплекса интима-медиа (IMT)




Для построения 3D изображения при помощи 2D датчиков (Smart 3D)

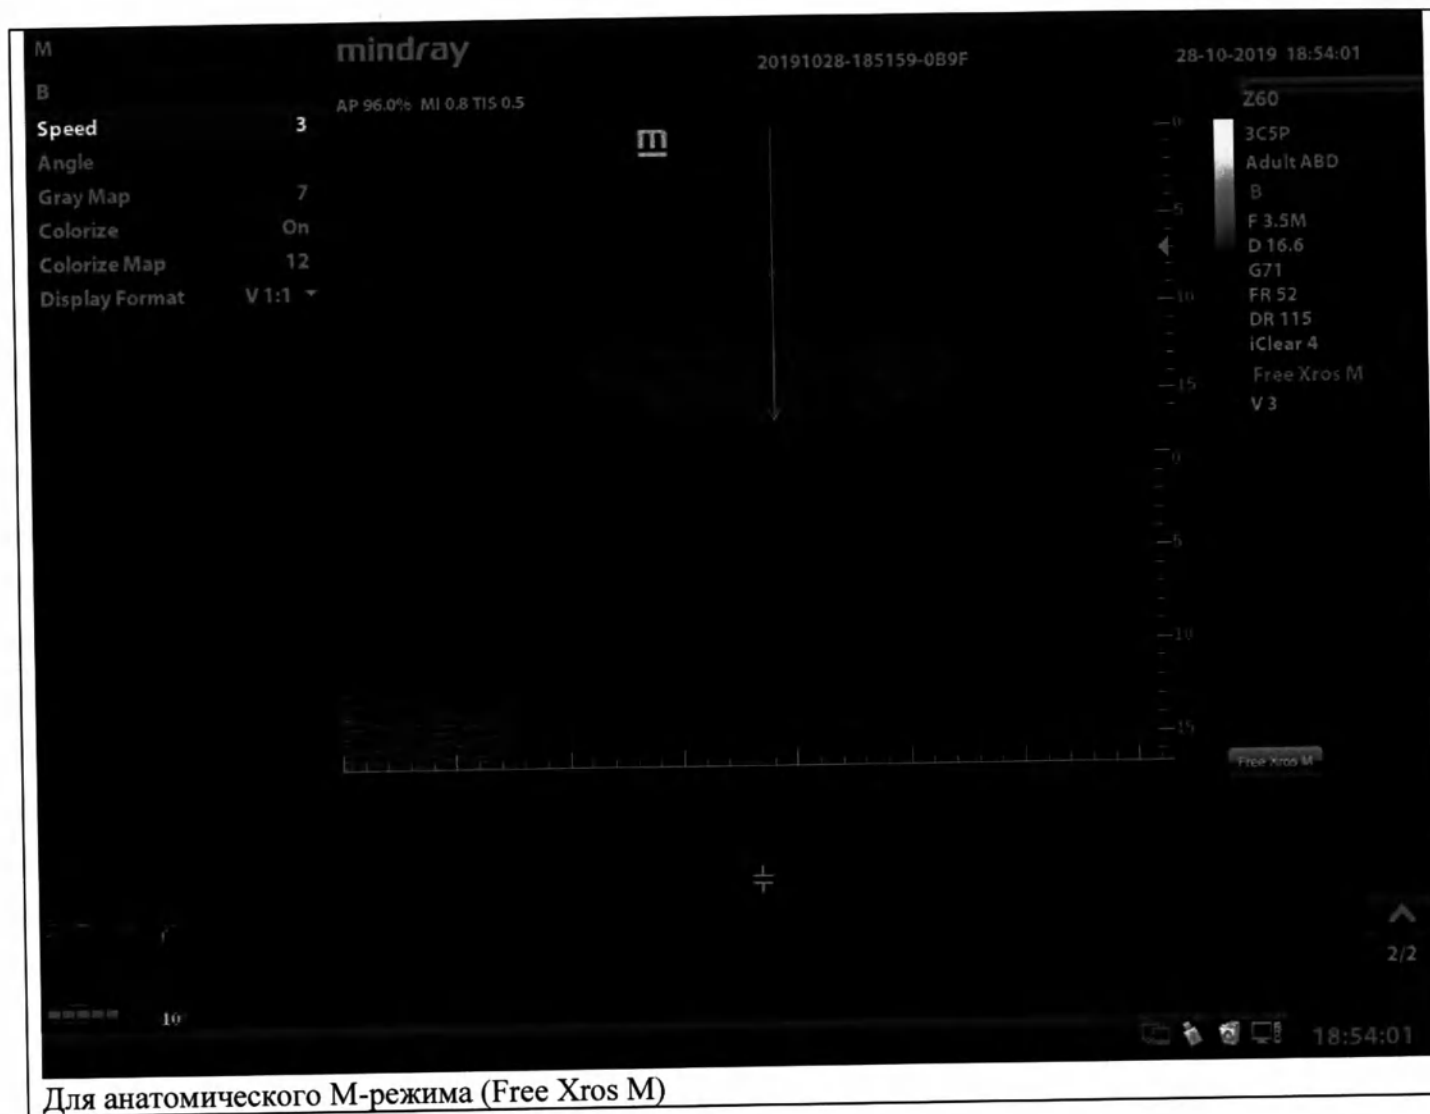


Для анатомического М-режима (Free Xros M)

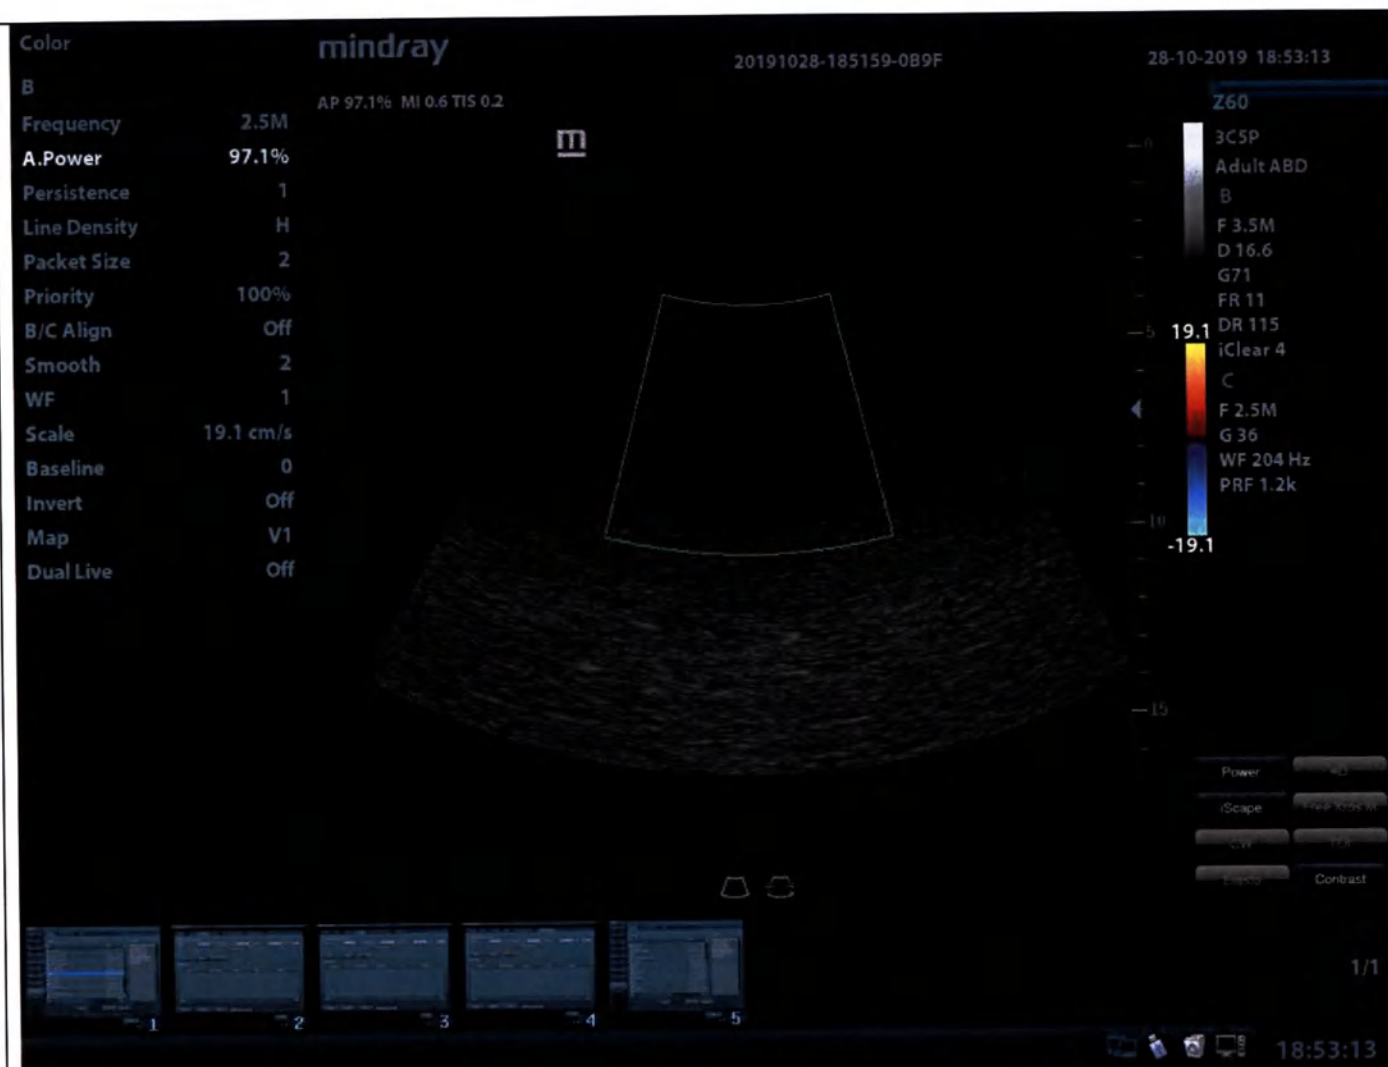


Для режима ЦДК/энергетического доплера (Color/Power)

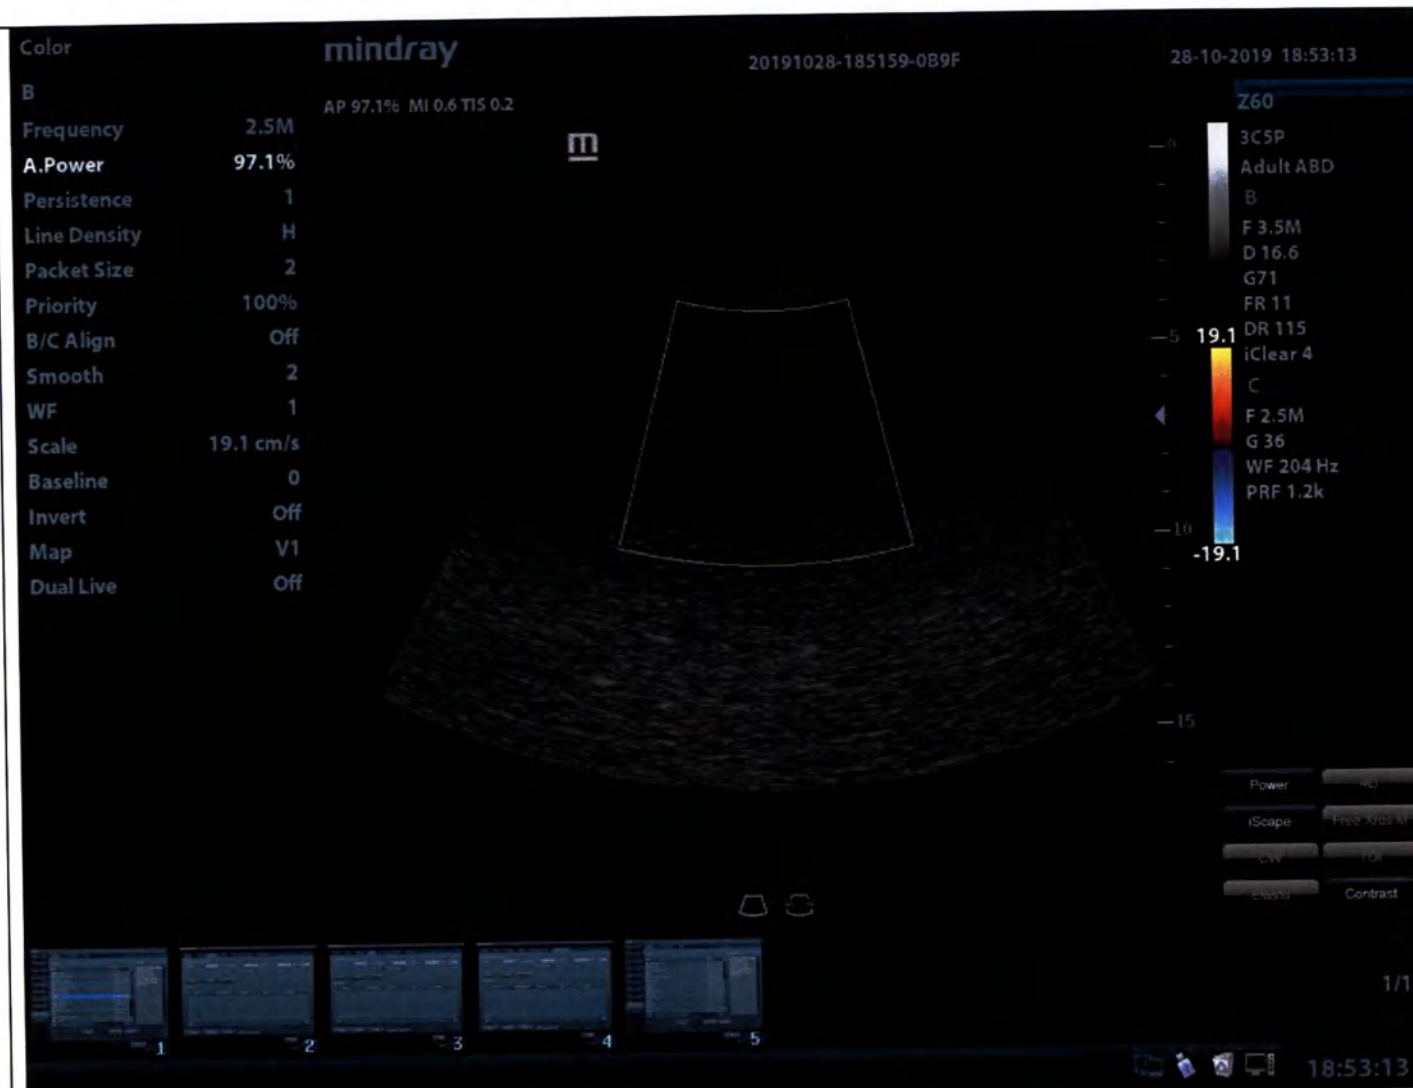


Для режима импульсно-волнового доплера (PW)

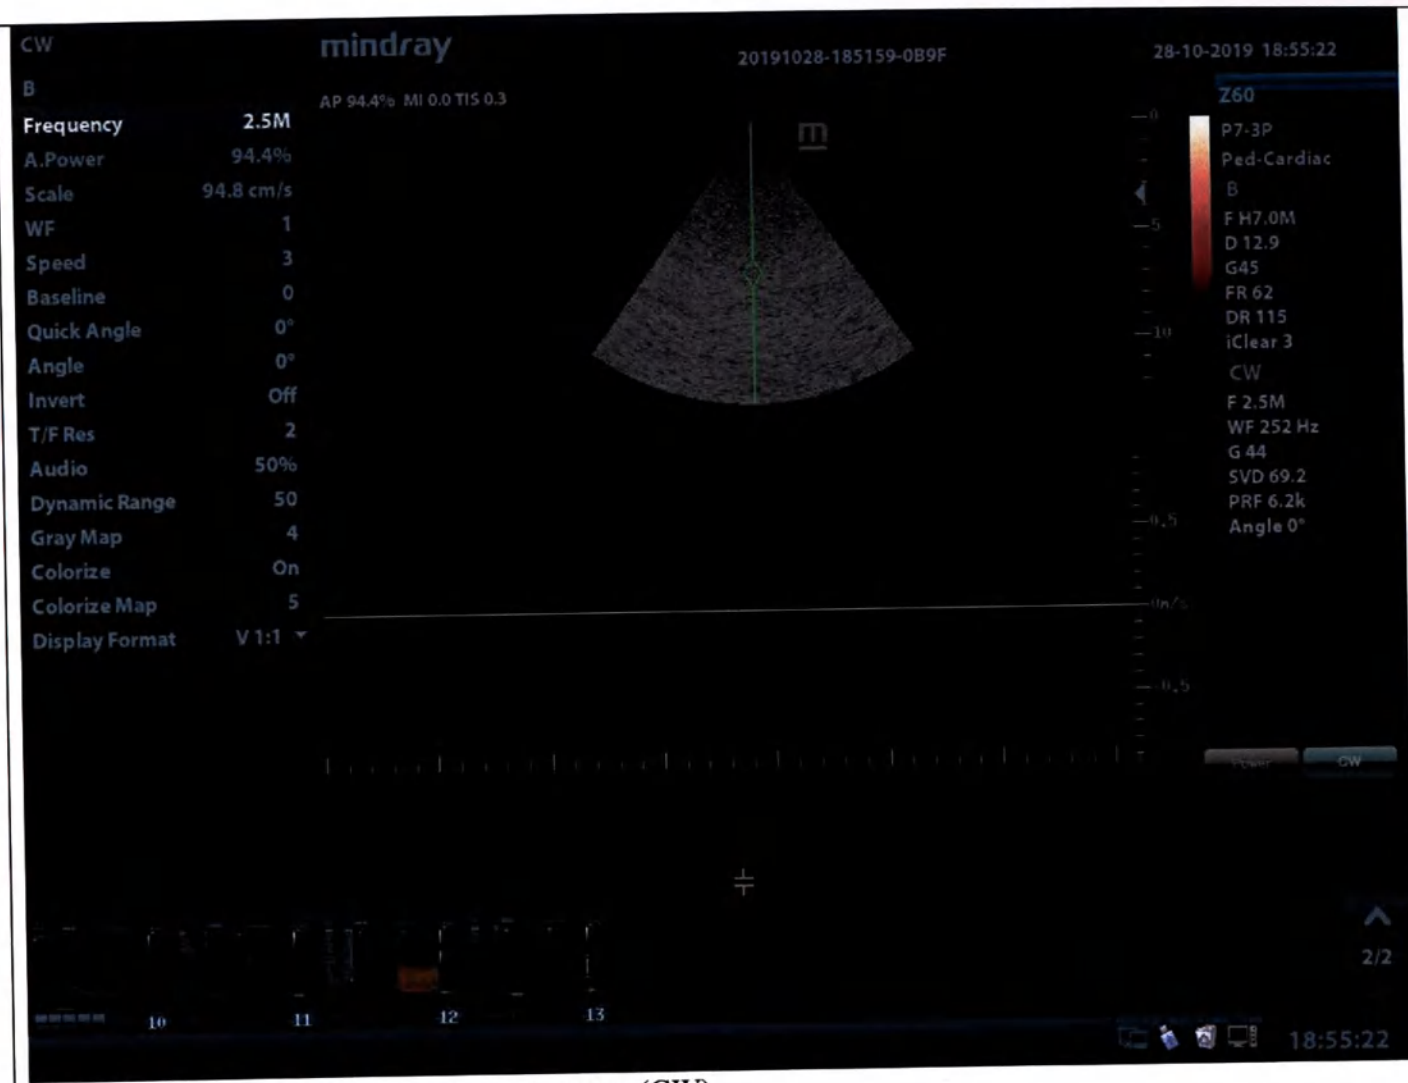

Для режима постоянно-волнового доплера (CW)

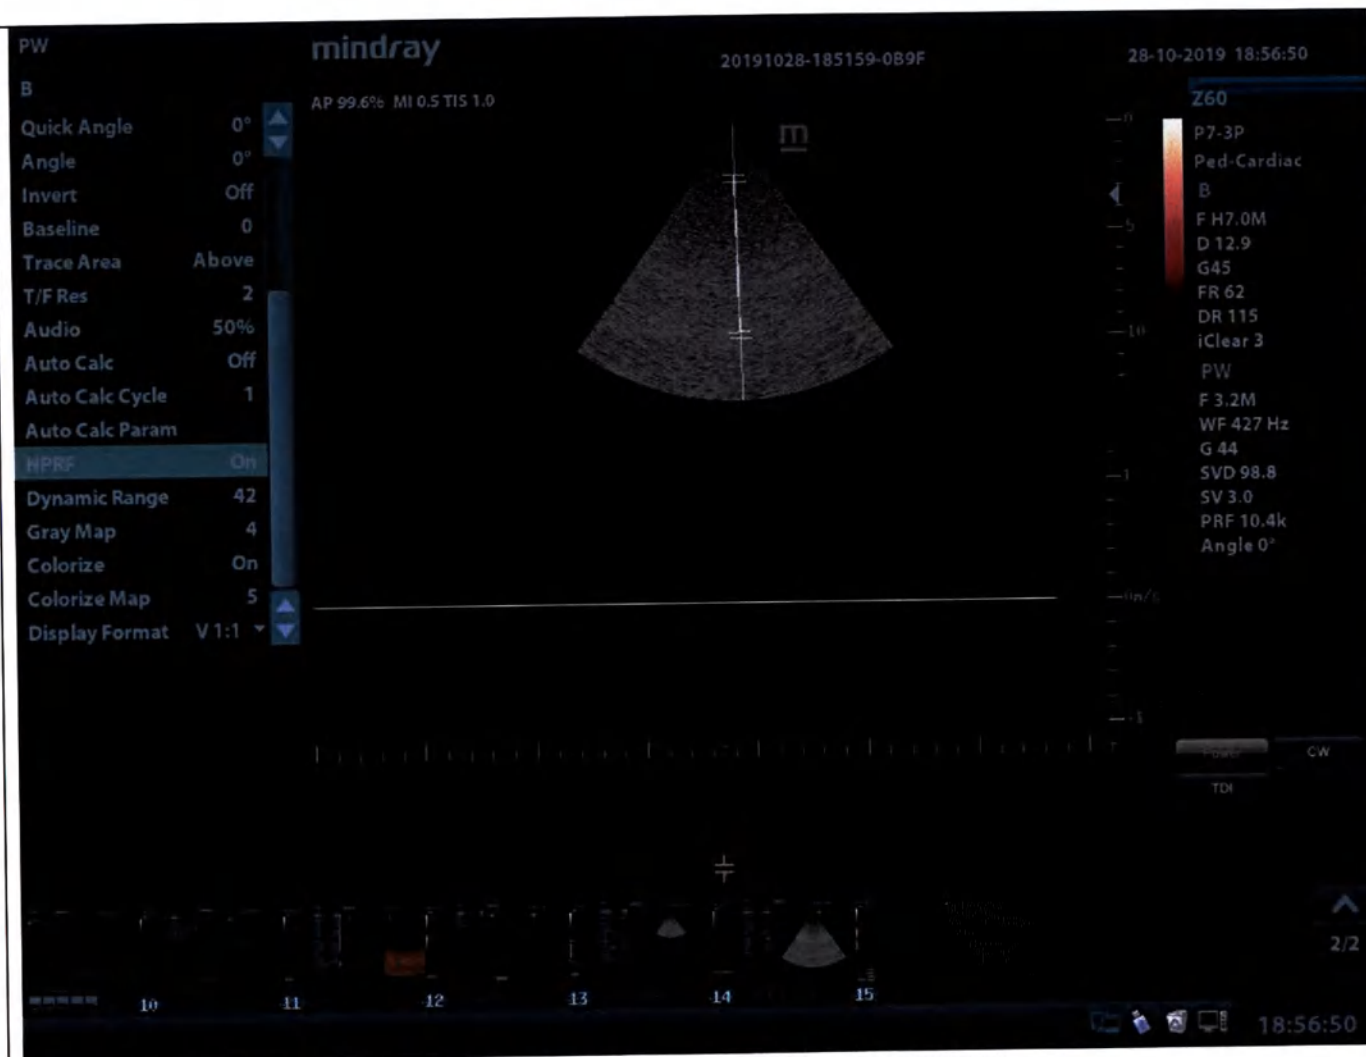


Для режима высокой частоты повторения импульсов излучения (HPRF)

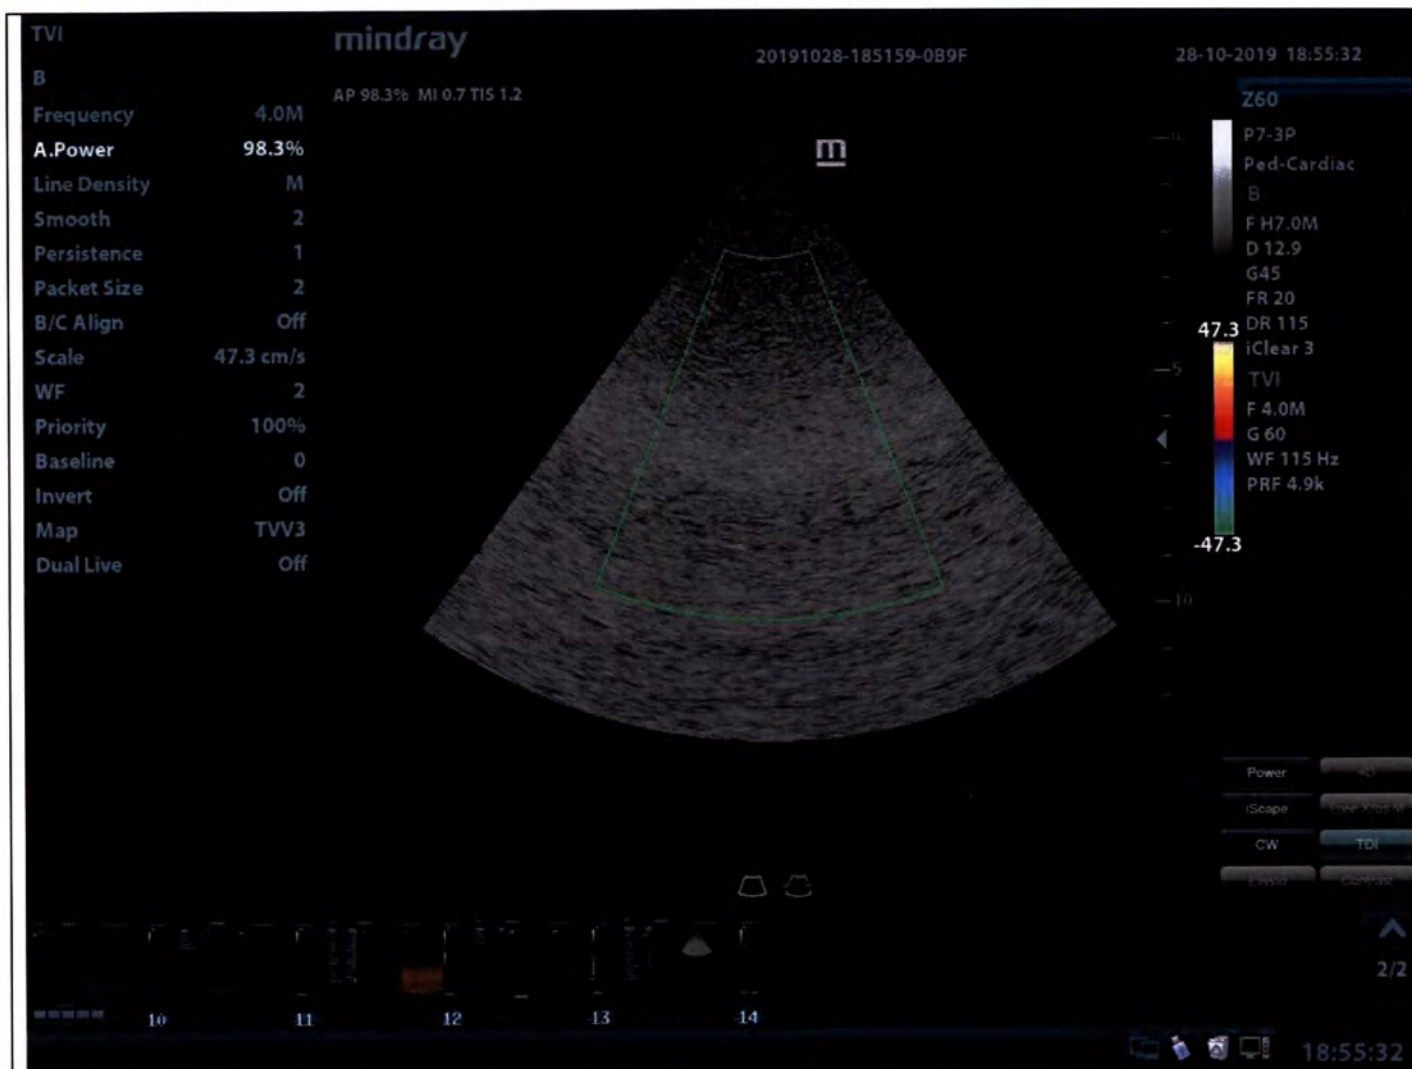


Для режима тканевого доплера (Tissue Doppler Imaging)




Для обработки объемного изображения с применением технологии виртуальной подстветки плода (iLive)

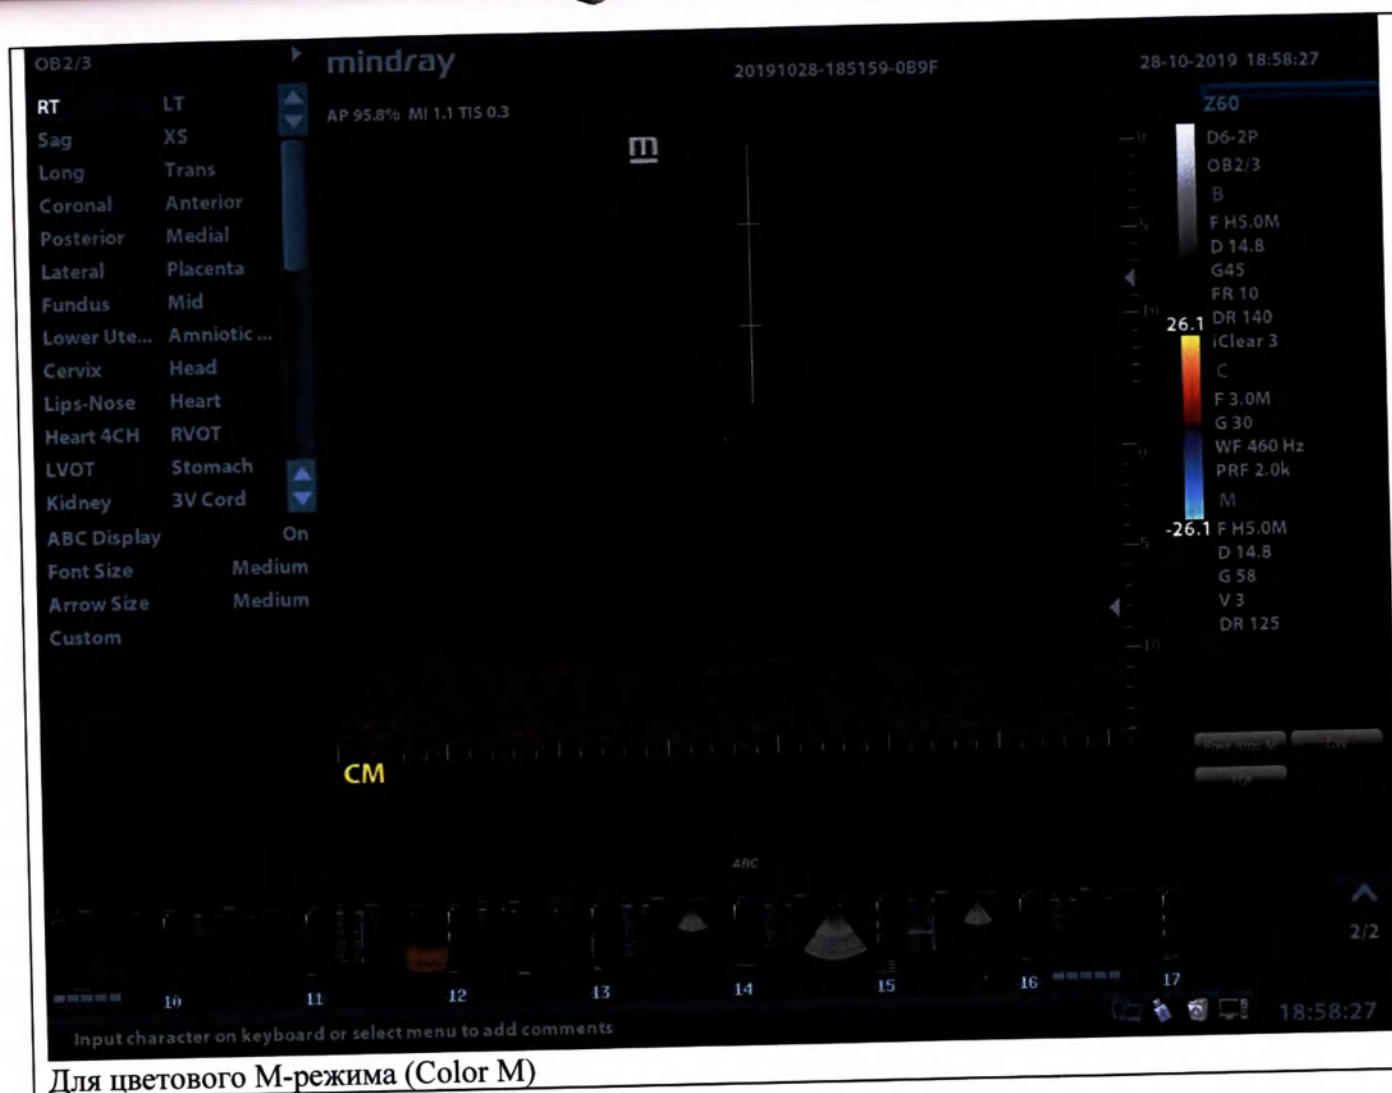


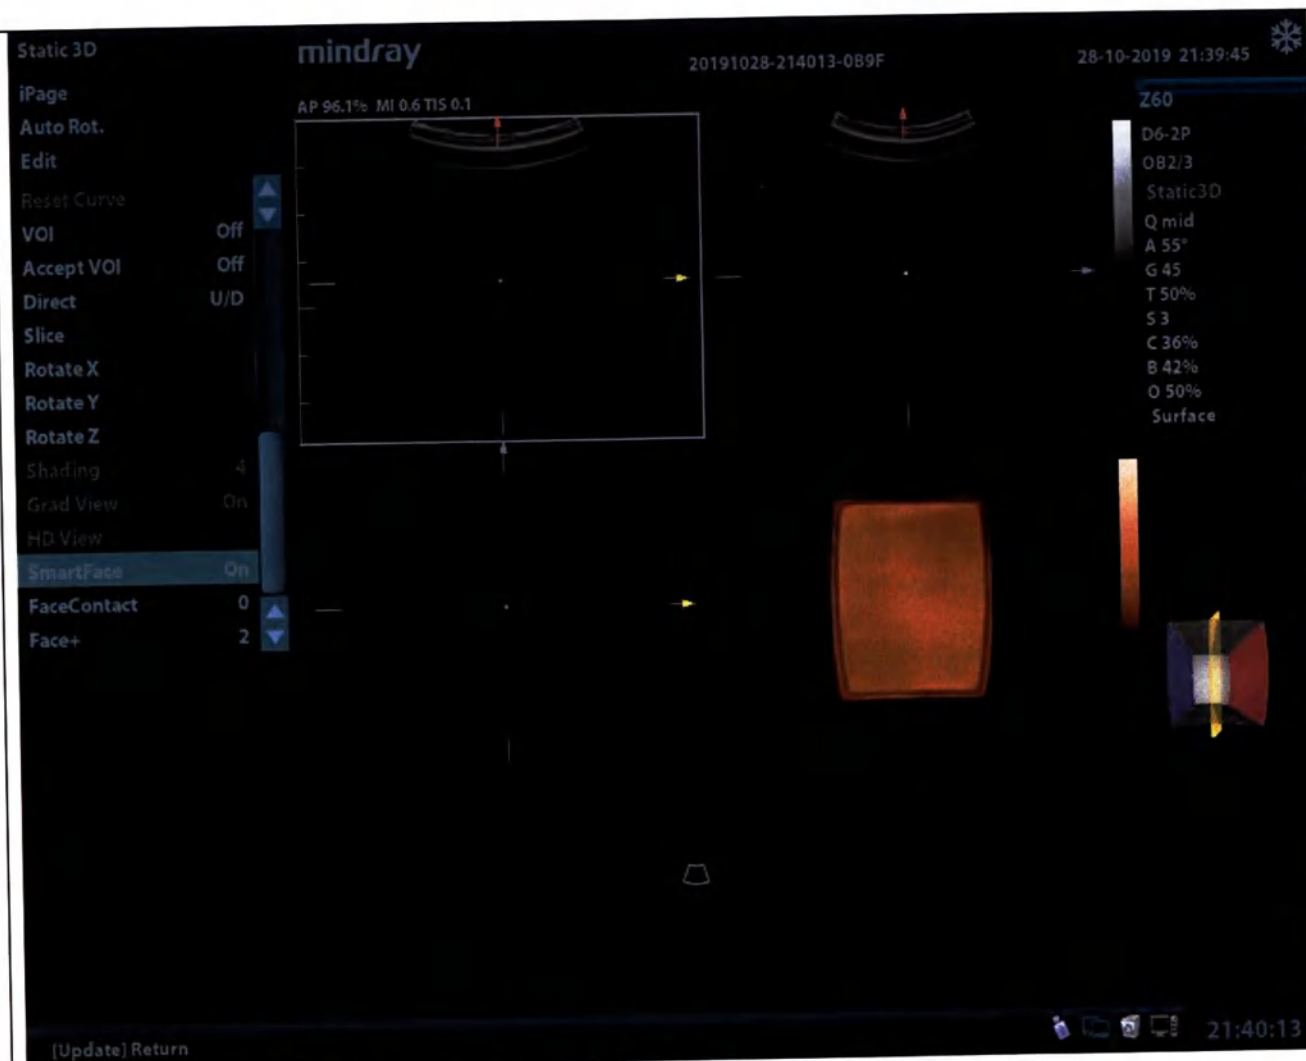

Для удаления артефактов и улучшения визуализации лица плода (Smart Face)

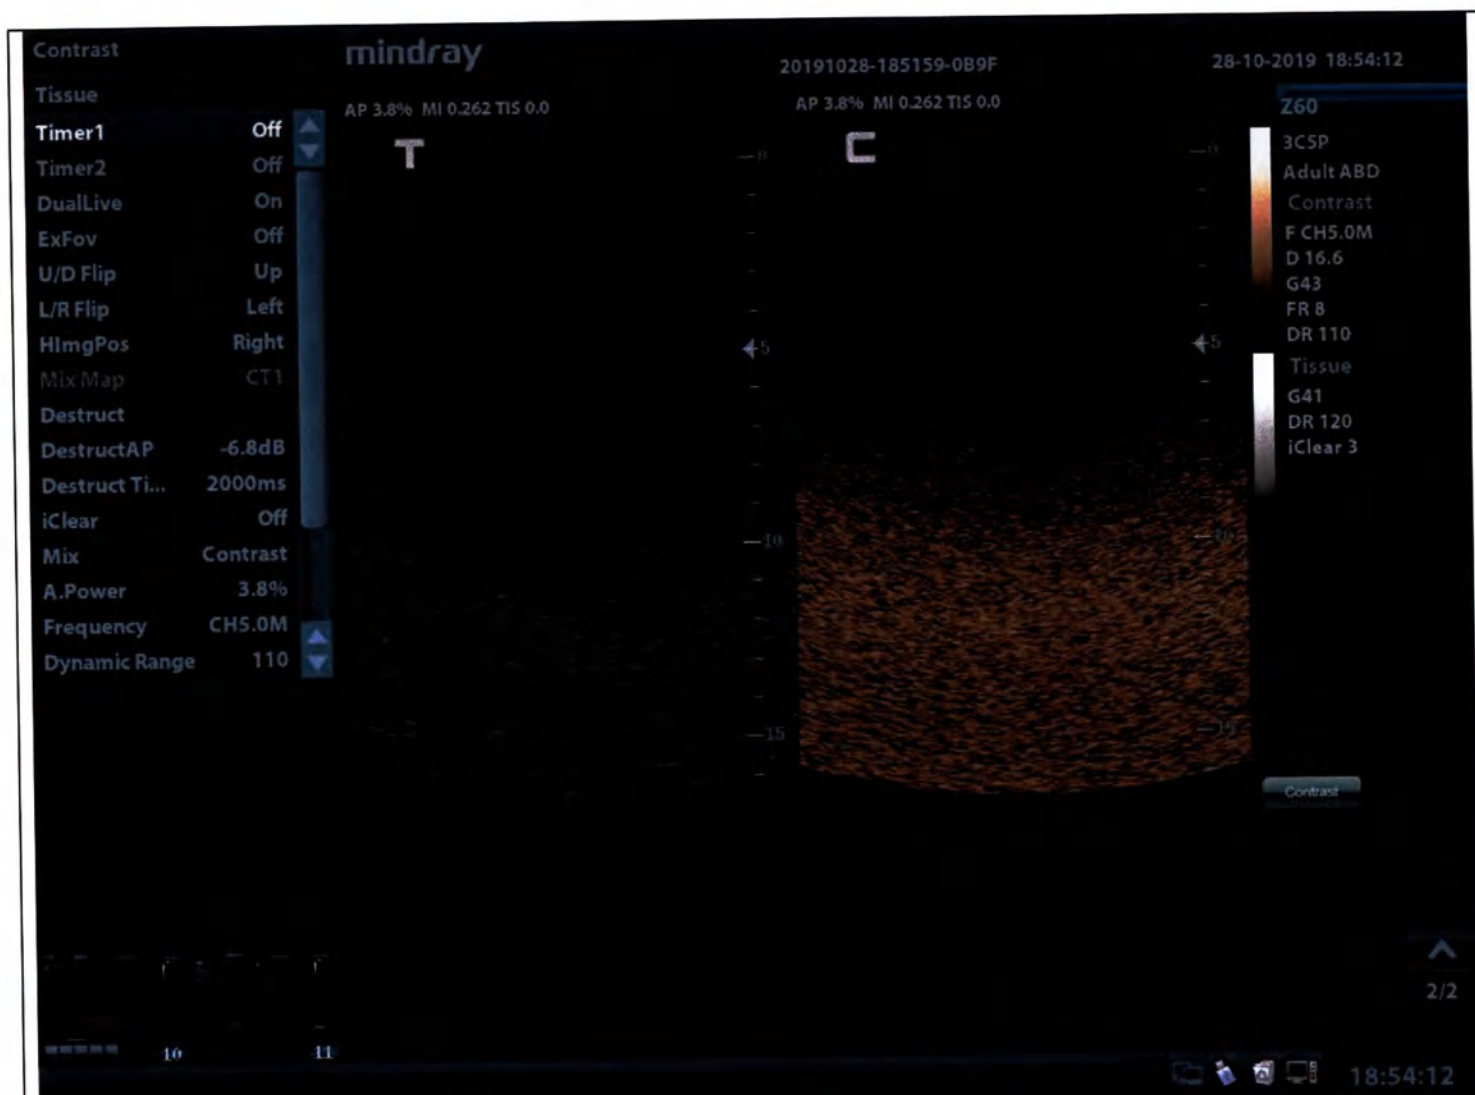

Для исследований с контрастным усилением (Contrast Imaging)

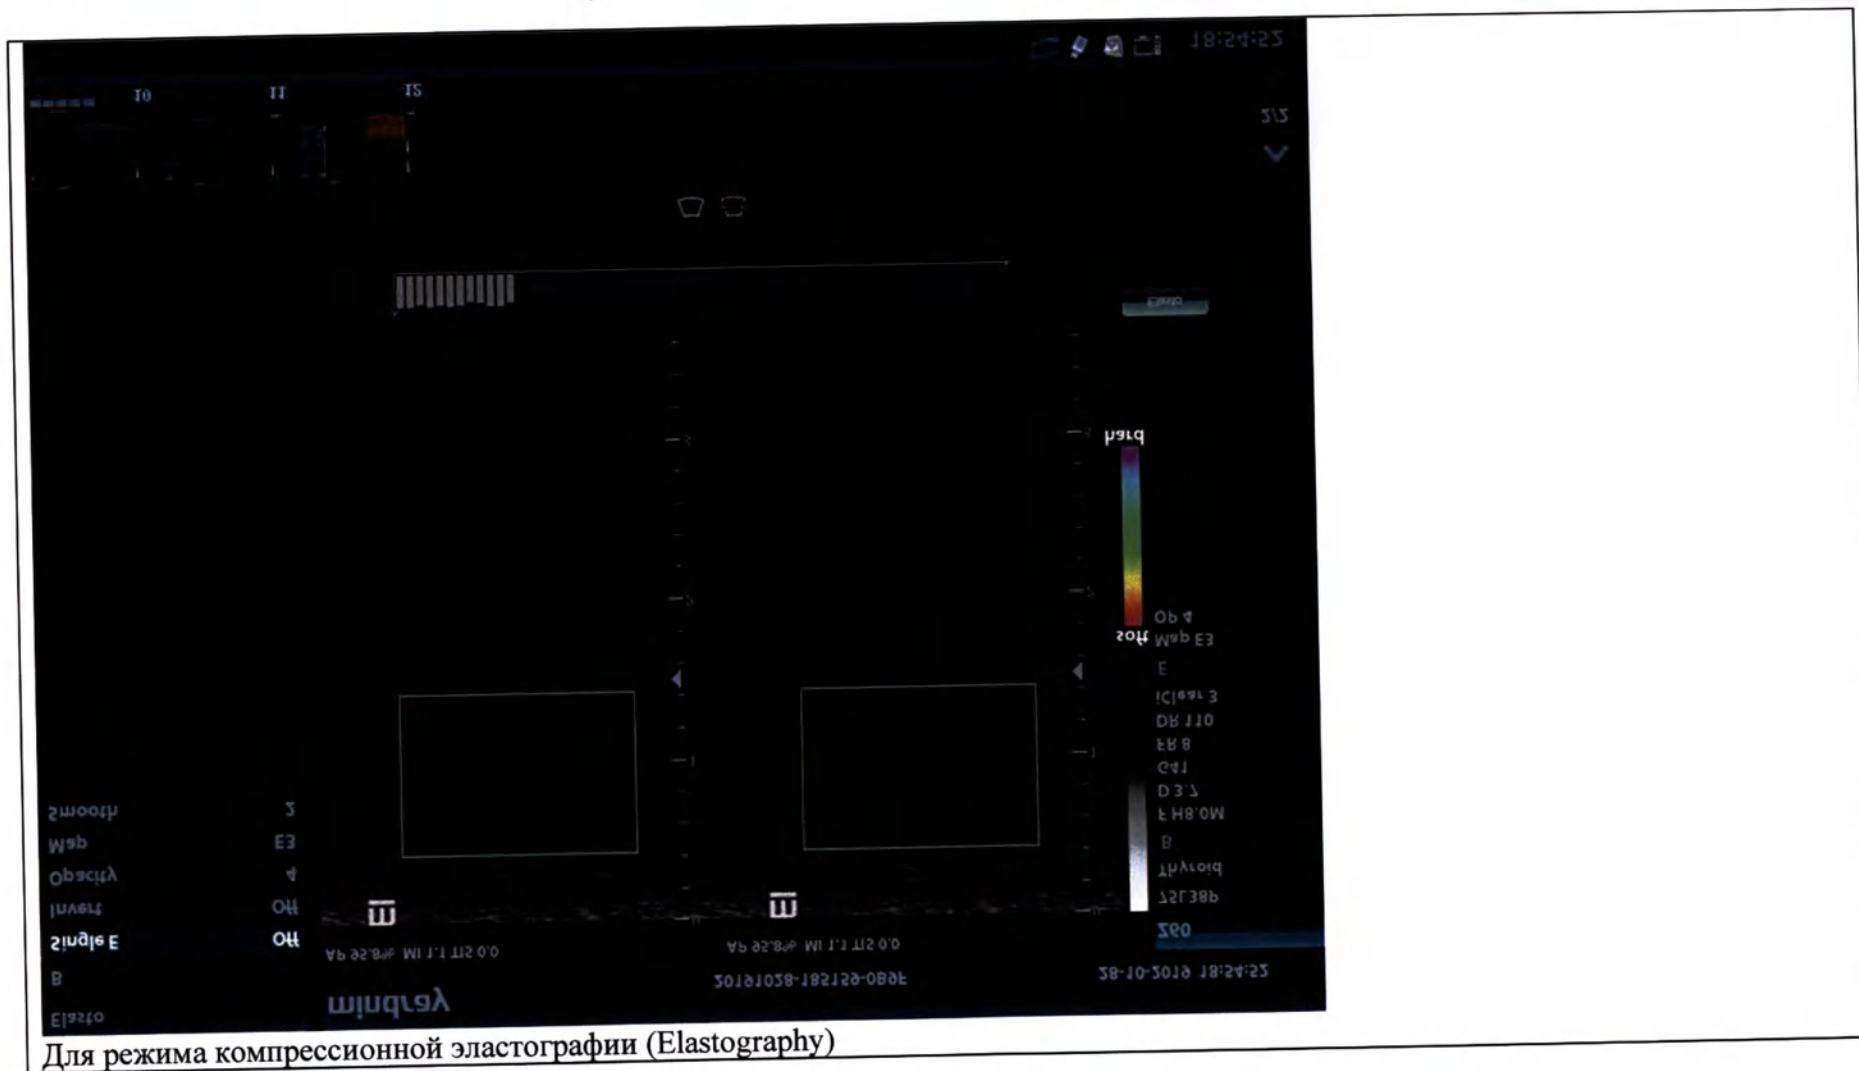



Для улучшения визуализации биопсийной иглы (iNeedle



Для автоматизированных рабочих протоколов (iWorks)



Тележка мобильная UMT-150



Тележка мобильная UMT-160



Тележка мобильная UMT-170

mindray

Diagnostic Ultrasound System

Model: XXXXXX

SN



XXX-XXXXXXXX



XXXX-XX-XX

CE 0123



047-030861-00(1.0)

100-240V ~ 50/60Hz 1.5-0.8A



SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.

Mindray Building, Keji 12th Road South, High-Tech Industrial Park,
Nanshan, Shenzhen, 518057, P. R. China

EC REP

Shanghai International Holding Corp. GmbH(Europe)
Eiffestraße 80, 20537 Hamburg, Germany

Этикетка основного блока Системы ультразвуковой визуализации универсальной серии Z, варианты исполнения: Z60, Z60T, Z60S, Z60W, Z60 Pro, Z60 Expert

Diagnostic Ultrasound System

mindray

Model: XX-XX

Qty.: 1

Size: 530mmx425mmx590mm

N.W.: 8.3 kg G.W.:

Ordering No.:



XX-XXXXXXXXXX

W#



XX-XXXXXXXXXX

P/N:



XX-XXXXXXXXXX

SN



XX-XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX



XXXX-XX-XX





047-020764-9W1.01



SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.
Mindray Building, Keji 12th Road South, High-Tech Industrial Park,
Nanshan, Shenzhen, 518057, P. R. China
Tel :+86-755-81888998 Fax :+86-755-26582880



Shanghai International Holding Corp. GmbH(Europe)
Eiffelstraße 80, 20537 Hamburg, Germany



Маркировка упаковки основного блока Системы ультразвуковой визуализации универсальной серии Z, варианты исполнения: Z60, Z60T, Z60S, Z60W, Z60 Pro, Z60 Expert

Маркировка датчиков

Ultrasonic Transducer

MODEL: XXXXXXXXXXXX

SN XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

CE⁰¹²³
IPX7



SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.

Ultrasonic Transducer

MODEL: XXXXXXXXXXXX

SN XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

CE⁰¹²³ IPX7



SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.

mindray Mobile Trolley

Model :

SN



047-028743-00(1.0)
N.W.:21kg
Max.W.(Loaded):45kg



SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.
Mindray Building, Keji 12th Road South, High-Tech Industrial Park,
Nanshan, Shenzhen, 518057, P. R. China

EC REP

Shanghai International Holding Corp. GmbH(Europe)
Eiffestraße 80, 20537 Hamburg, Germany

Маркировка тележки

Ultrasonic Transducer

mindray

Model: XX-XX

Qty.: 1

Size: XXXXmmxXXXXmmxXXXXmm

N.W.: XXX kg G.W.: XXX kg

Ordering No.:



XX-XXXXXXXXXX

W#



XX-XXXXXXXXXX

P/N:



XX-XXXXXXXXXX

SN



XX-XXXXXXXXXX



XXXX-XX-XX




SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.


Mindray Building, Keji 12th Road South, High-Tech Industrial Park,

Nanshan, Shenzhen, 518057, P. R. China

Tel :+86-755-81888998 Fax :+86-755-26582680




0123




Shanghai International Holding Corp. GmbH(Europe)

Eiffestraße 80, 20537 Hamburg, Germany




XX°C

XX°C



XX%

XX%



XXX.XkPa

XX.XkPa



047-027962-00(1.0)

Пример маркировки упаковки компонентов: Маркировка упаковки датчика

Ultrasonic Transducer

mindray

Model: XX-XX

Qty.: 1

Size: XXXXmmxXXXXmmxXXXXmm

N.W.: XXX kg G.W.: XXX kg

Ordering No.:



XX-XXXXXXXXXX

W#



XX-XXXXXXXXXX

P/N:



XX-XXXXXXXXXX

SN



XX-XXXXXXXXXX




XXXX-XX-XX



SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.
Mindray Building, Keji 12th Road South, High-Tech Industrial Park,
Nanshan, Shenzhen, 518057, P. R. China
Tel :+86-755-81888998 Fax :+86-755-26582680




Shanghai International Holding Corp. GmbH(Europe)
Eiffelstraße 80, 20537 Hamburg, Germany




XX°C



XX%

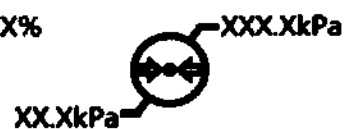

XX.XkPa



XXX.XkPa



047-627962-80(1.0)

Пример маркировки упаковки компонентов: Маркировка упаковки датчика

Система ультразвуковой визуализации универсальная
серии Z, вариант исполнения: XXX

Модель: XXX

Регистрационное удостоверение: № РЗН XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX года

«Шэньчжэнь Майндрэй Био-Медикал Электроникс Ко., Лтд.», КНР
 Mindray Building, Keji 12th Road South, High-Tech Industrial Park,
Nanshan, Shenzhen, 518057, P. R. China

Уполномоченный представитель производителя в России:

ООО «Миндрей Медикал Рус»

Адрес: 129090, г. Москва, Олимпийский проспект, д.16, стр.5,
антресоль 4, помещение I, ком.7, 11А

Тел.: (499) 553-60-36, факс: (499) 553-60-39 E-mail: info.ru@mindray.com

EAC




Пример упаковки :

пенопласт 1 нижний пенопласт упаковочная пленка пенопласт слева



пенопласт 2 пенопласт справа

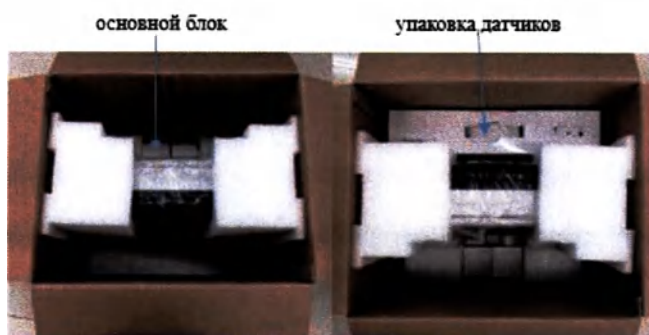


основной блок

упаковка датчиков




упаковка компонентов

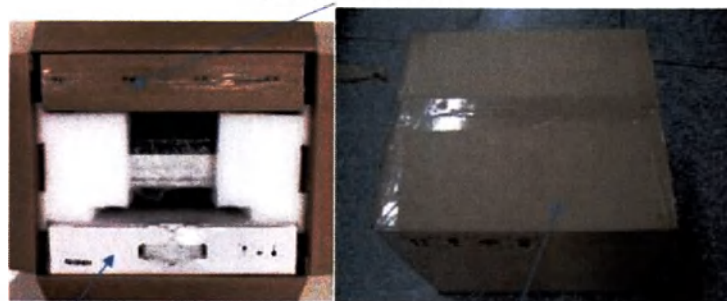

упаковка датчиков


внешний вид коробки

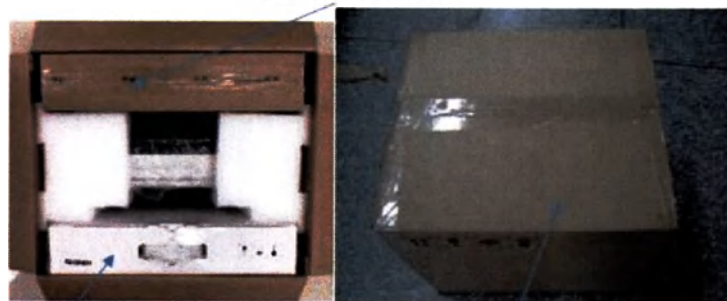



Упаковка датчиков

Упаковка литий-ионной батареи

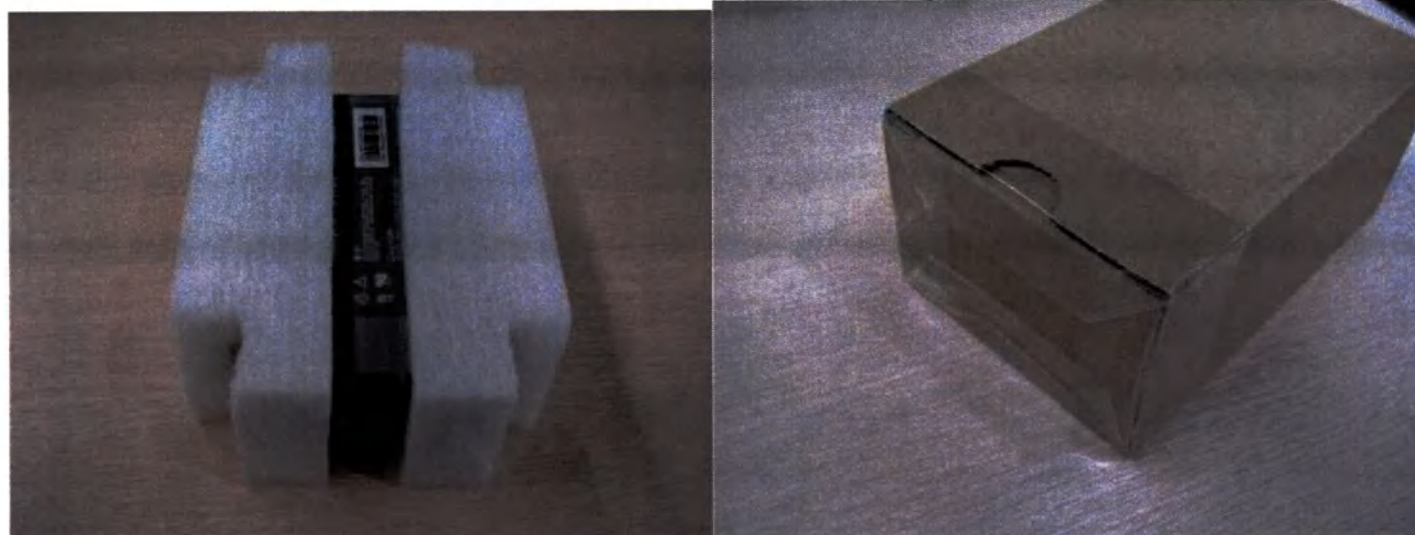

Упаковка Комплекта сетевого адаптера LPA11 для подключения принтера



Упаковка остальных компонентов (включая держатели для датчиков, кабели, диск и сумку):




Упаковка тележек
UMT-150



UMT-160



UMT-170

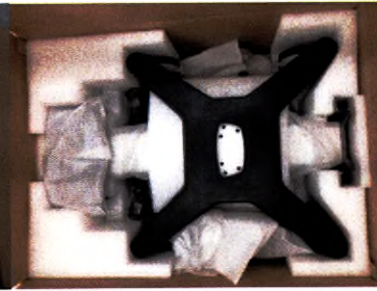

Генеральный директор
ООО «Миндрей Медикал Рус»

МП

Сюн Вей

Прошито 90 лист 06
Генеральный директор
ООО "Миндрей Медикал Рус"
Сисоев Сюн Вэй



по д. 20.03.2014 г. № 211
Сисоев С. В.