

«УТВЕРЖДАЮ»

**Директор
ООО «МитакаМед»**

Васильева Л. С.




**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

«Микроскоп хирургический Mitaka, в вариантах исполнения»

Mitaka Kohki Co., Ltd., (Митака Кокки Ко., Лтд.), Япония


1-18-8 Nozaki Mitaka-shi, Tokyo 181-0014, JAPAN.

Хирургический микроскоп MM90/SON

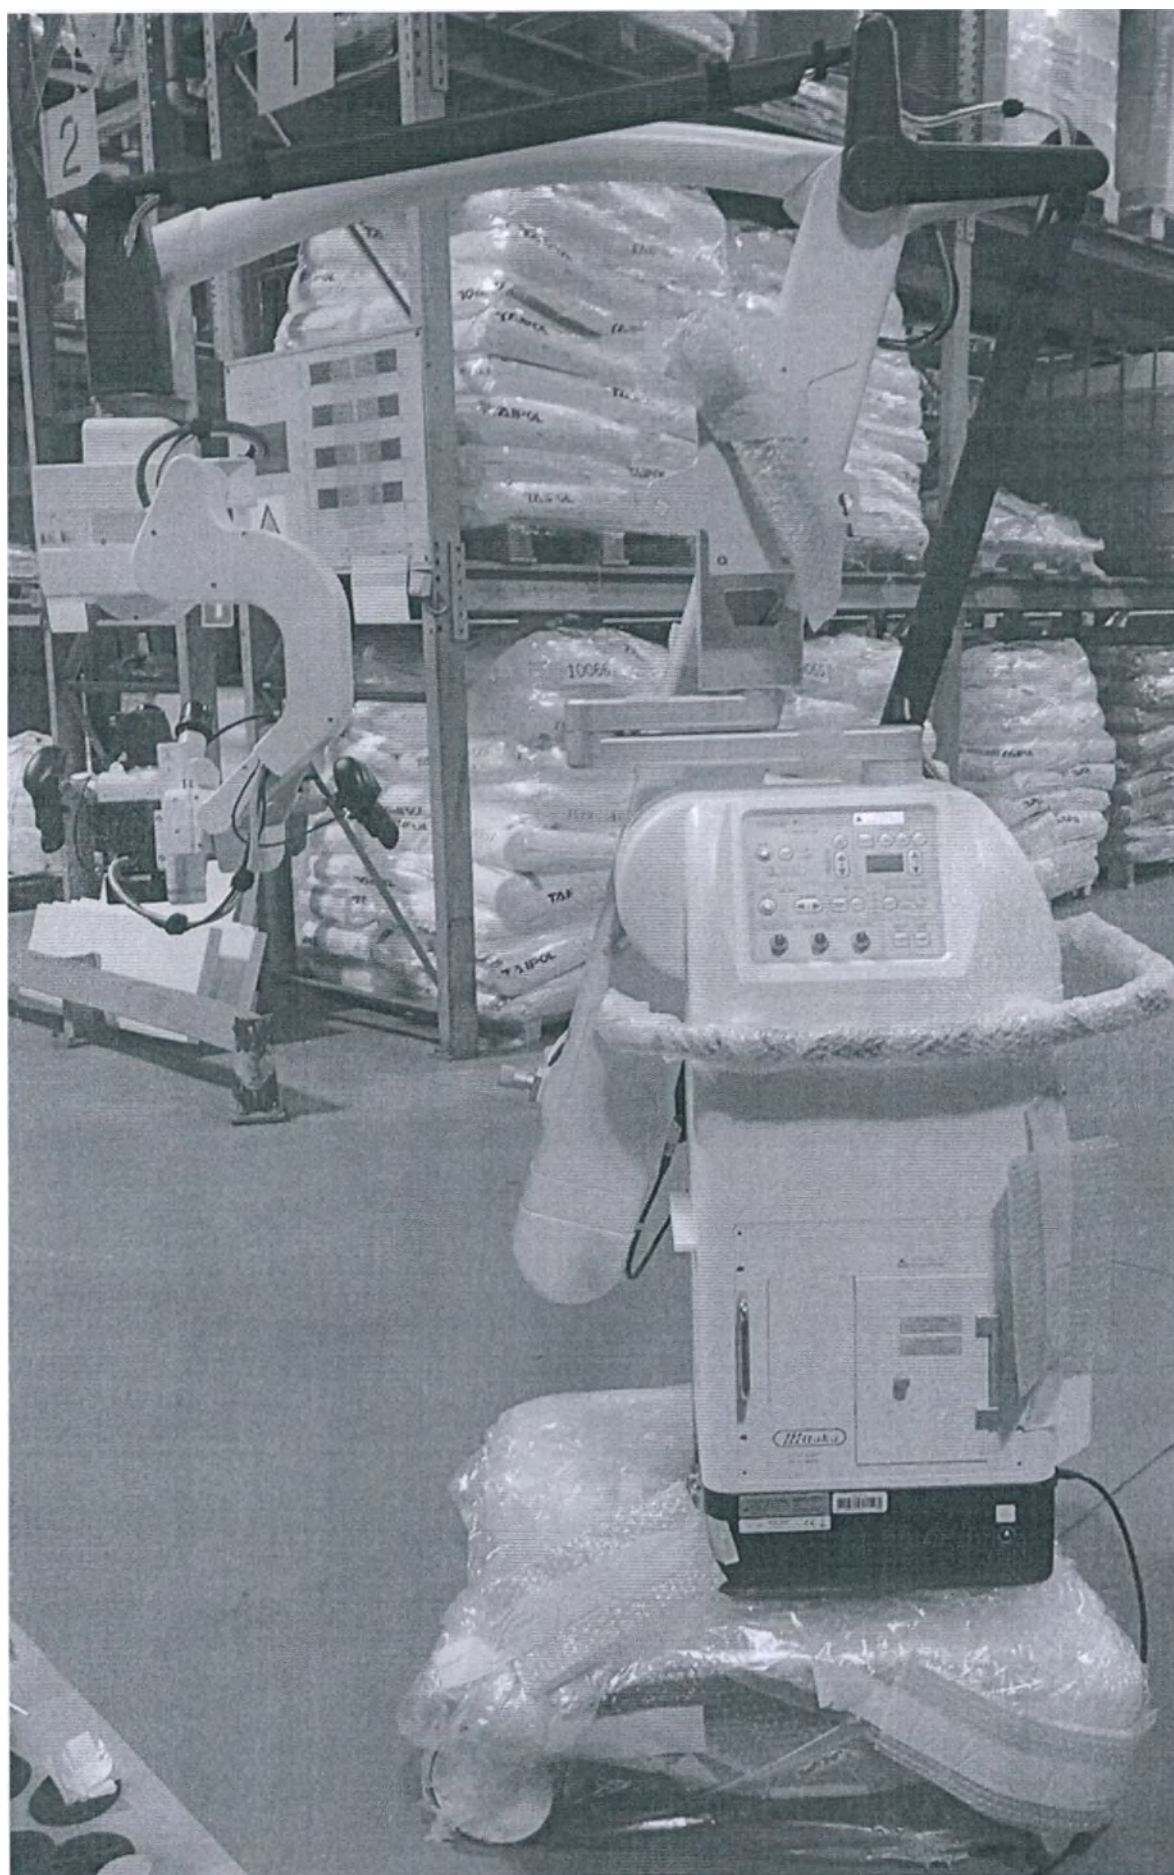

Общий вид изделия в сборке.

Хирургический микроскоп MM90/SOH

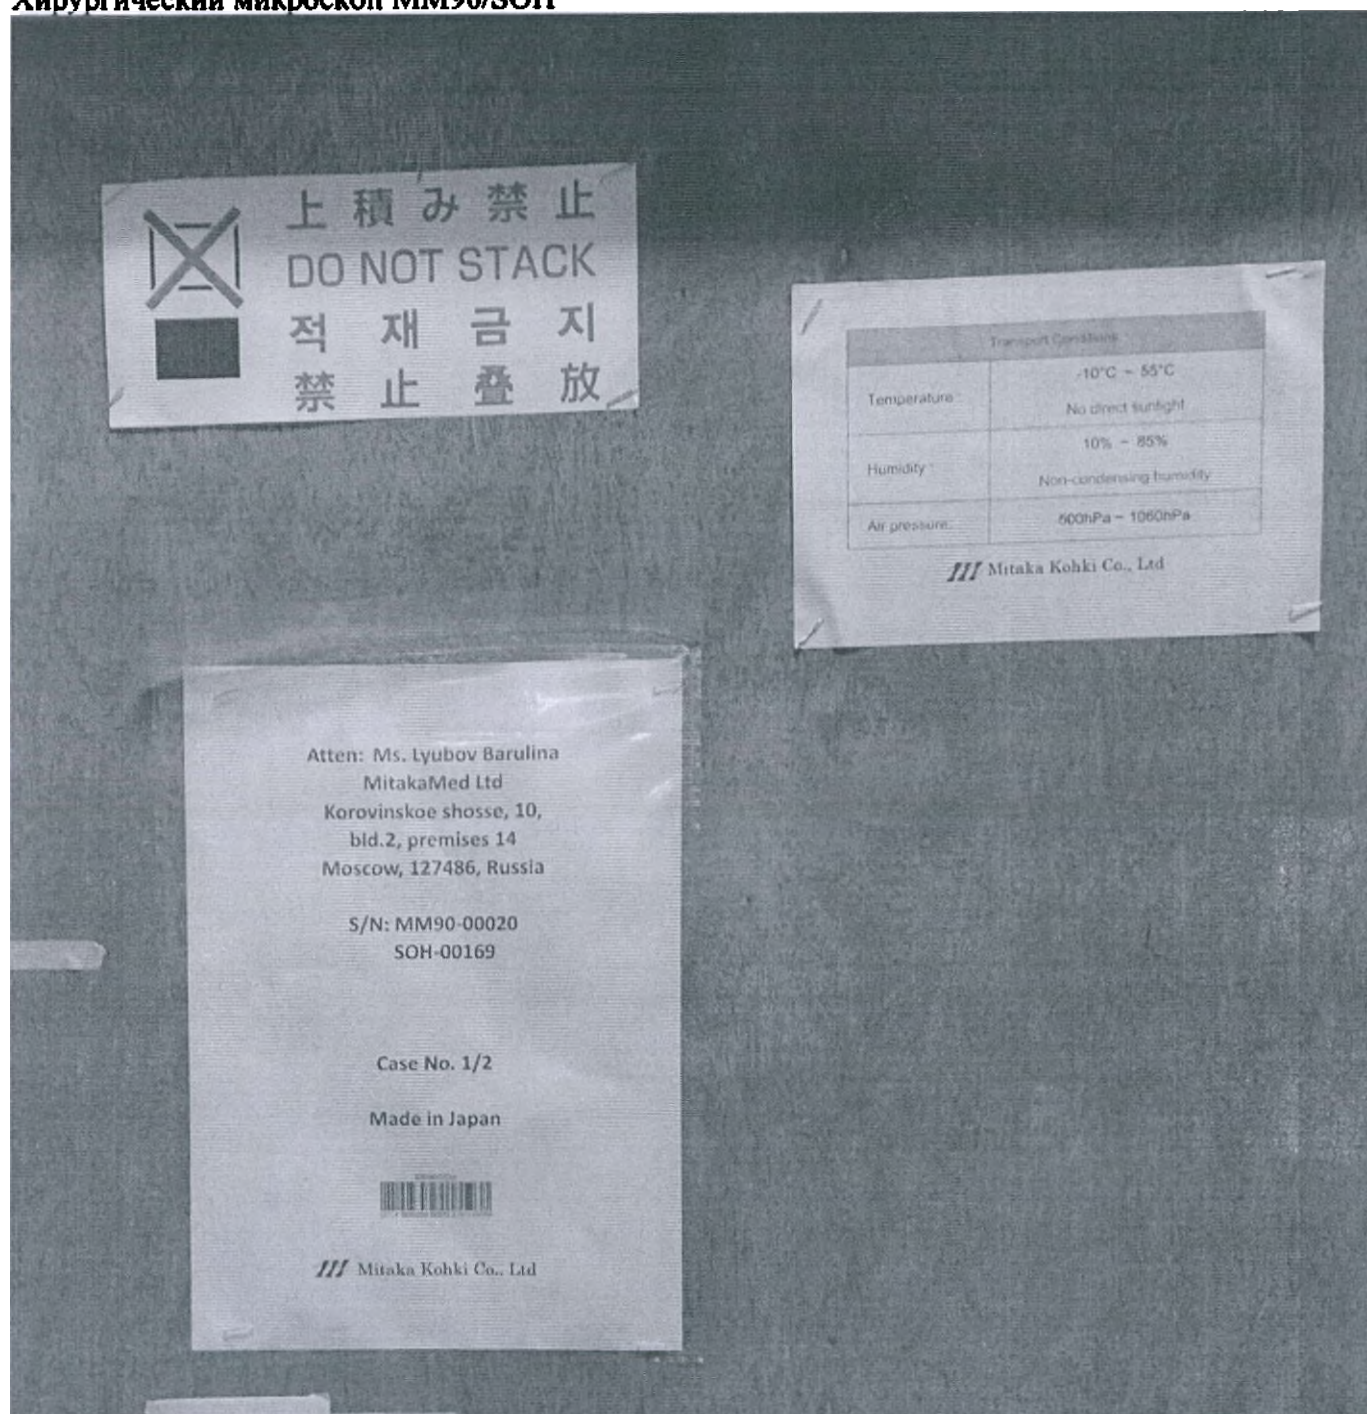

Маркировка на транспортной упаковке

Mitaka

PAT. No. 5528417

PAT. No. 6050530

Surgical Microscope MM90/SOH
MITAKA KOHKI CO.,LTD. SN 00169
1-18-8 Nozaki, Mitaka-shi,
Tokyo Japan
MADE IN JAPAN

MM90/SOH
(01) 4 5896984 50572 2 (21) 00169

EC REP MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hannover, Germany
CE

⚠ Grounding reliability can
only be achieved when
EQUIPMENT is connected to
equivalent receptacle marked
"Hospital" or "Hospital Grade"

INPUT
~ 220V


POWER

FUSE


AC INPUT
~220/230/240V 50/60Hz 1.2kVA CLASS1
FUSE No. 1-2 PRIM. 2x T8 AH 250V
No. 3-4 PRIM. 2x T3.15 AH 250V
No. 5-6 PRIM. 2x T3.15 AH 250V

Маркировка на изделии

Микроскоп ММ90

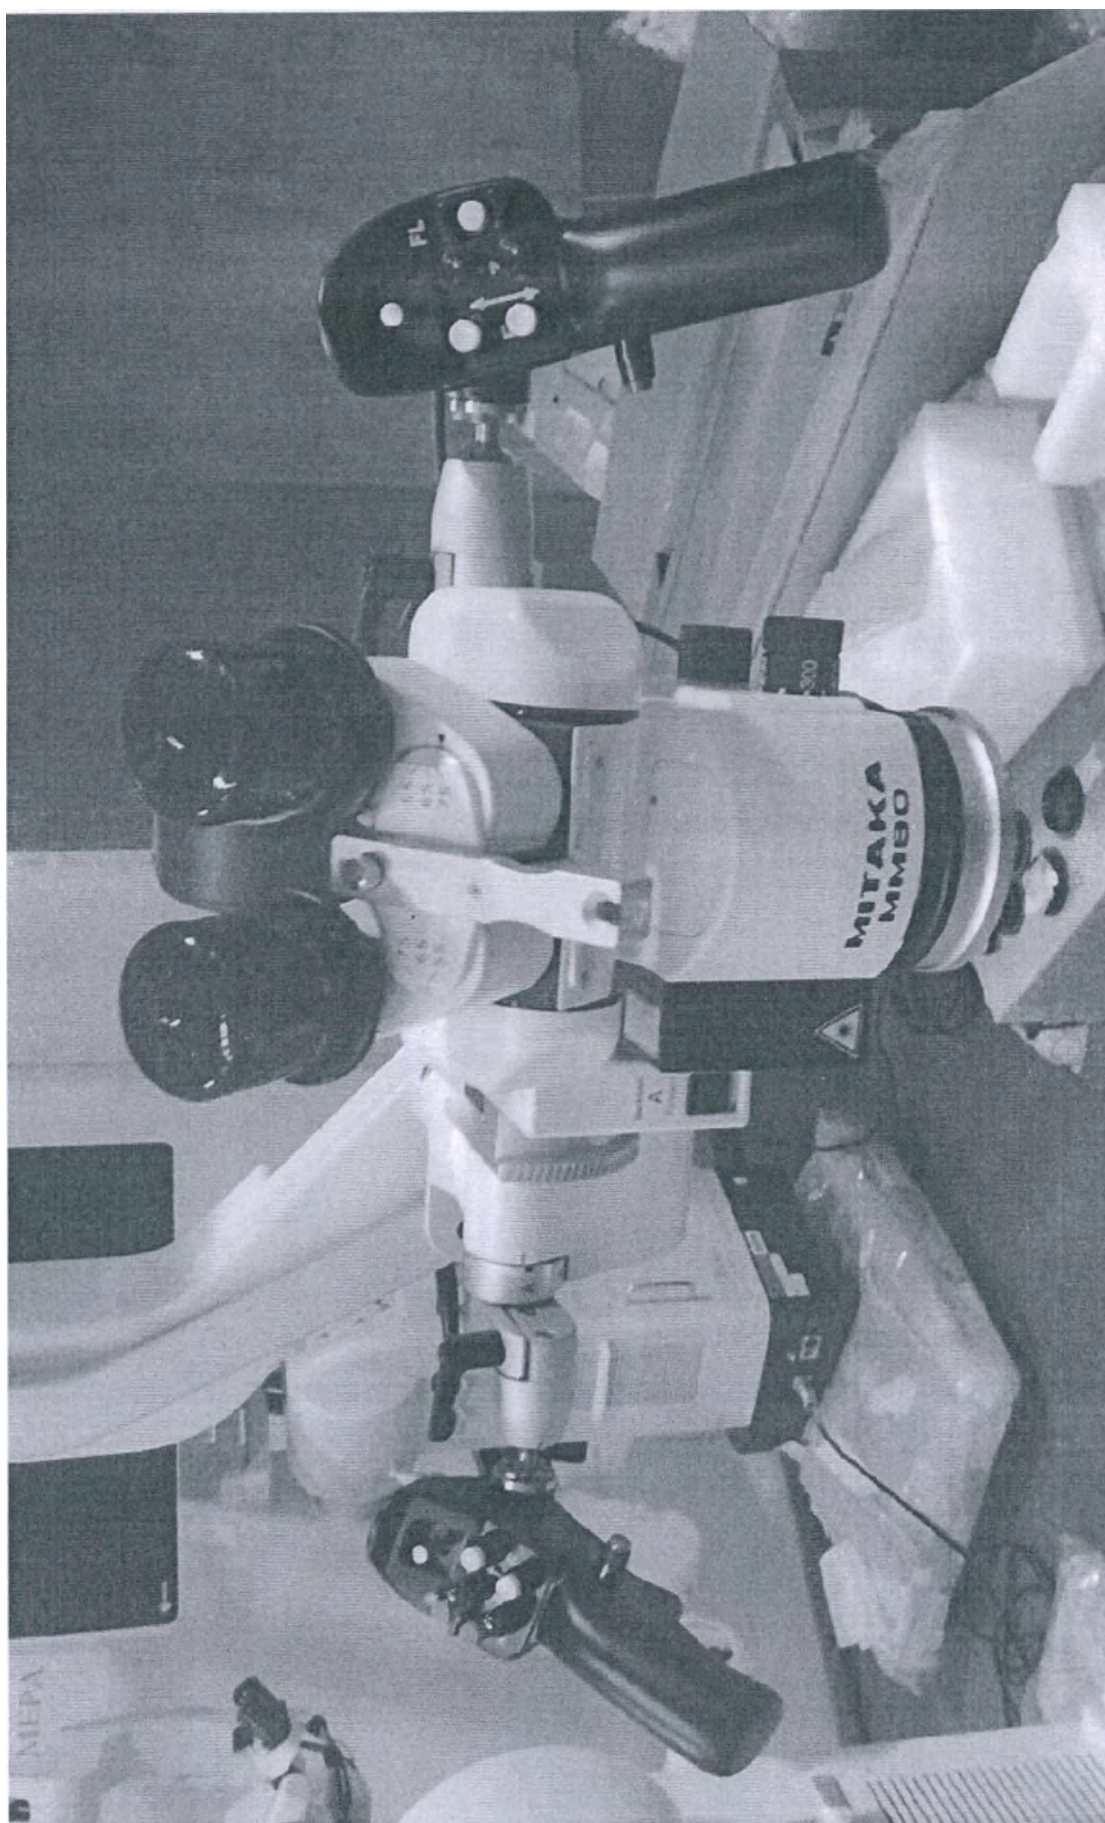


Общий вид изделия

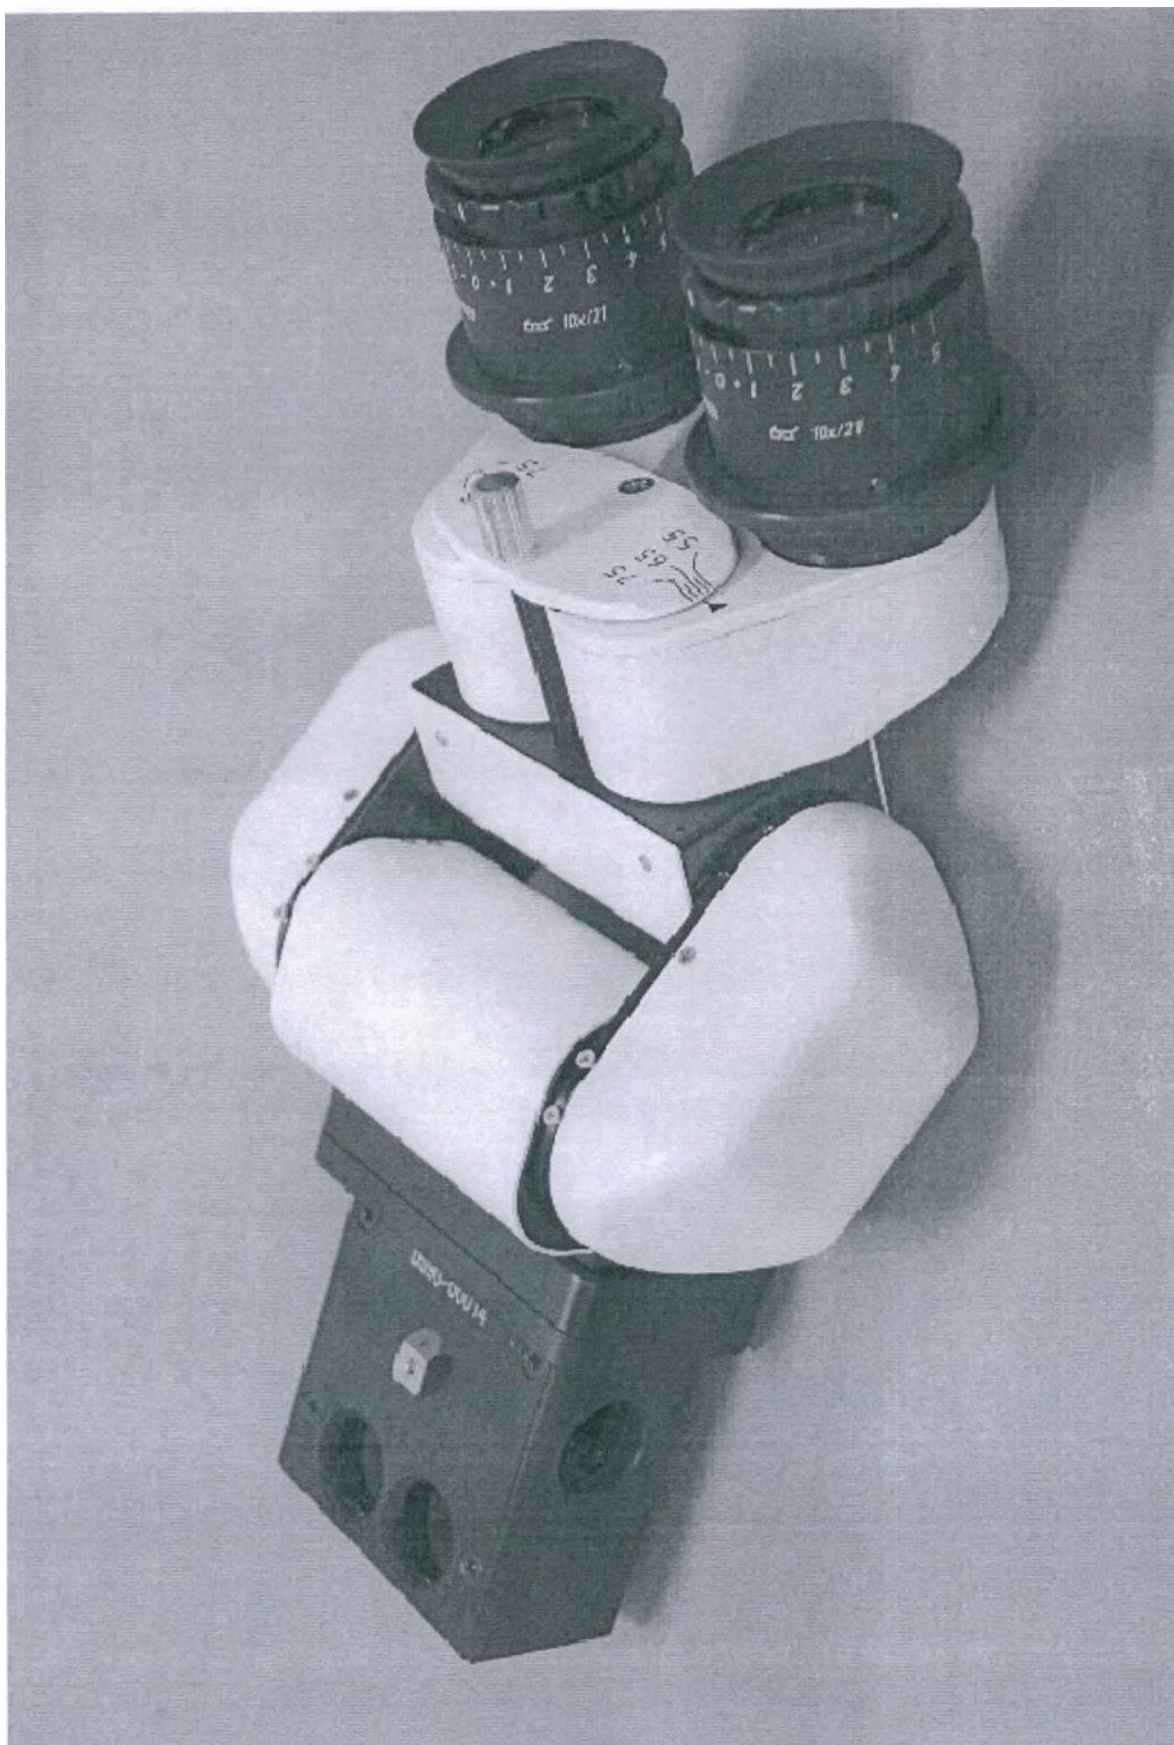

Общий вид изделия

Тубус для совмещения с цветной камерой 3D Mitaka

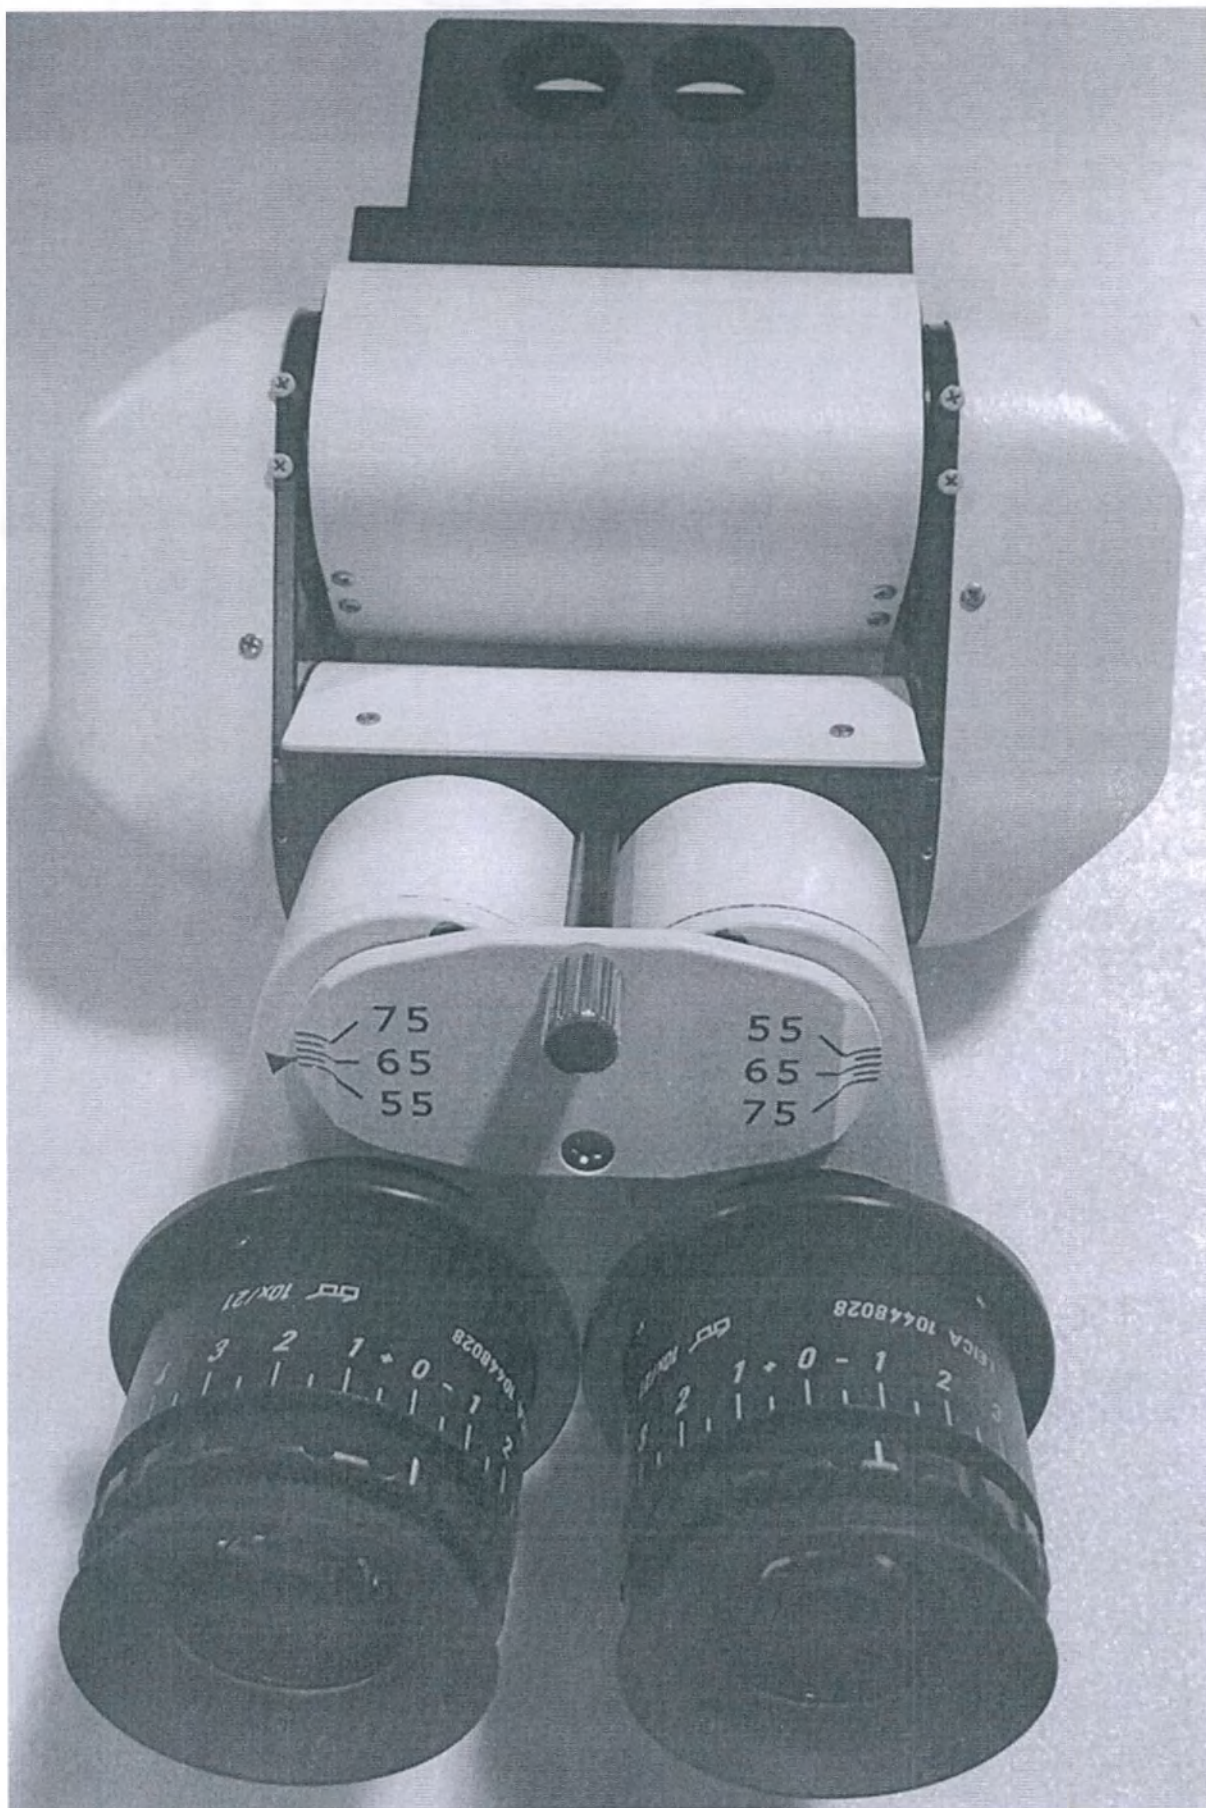


Общий вид

Тубус для совмещения с цветной камерой 3D Mitaka




Маркировка на изделии

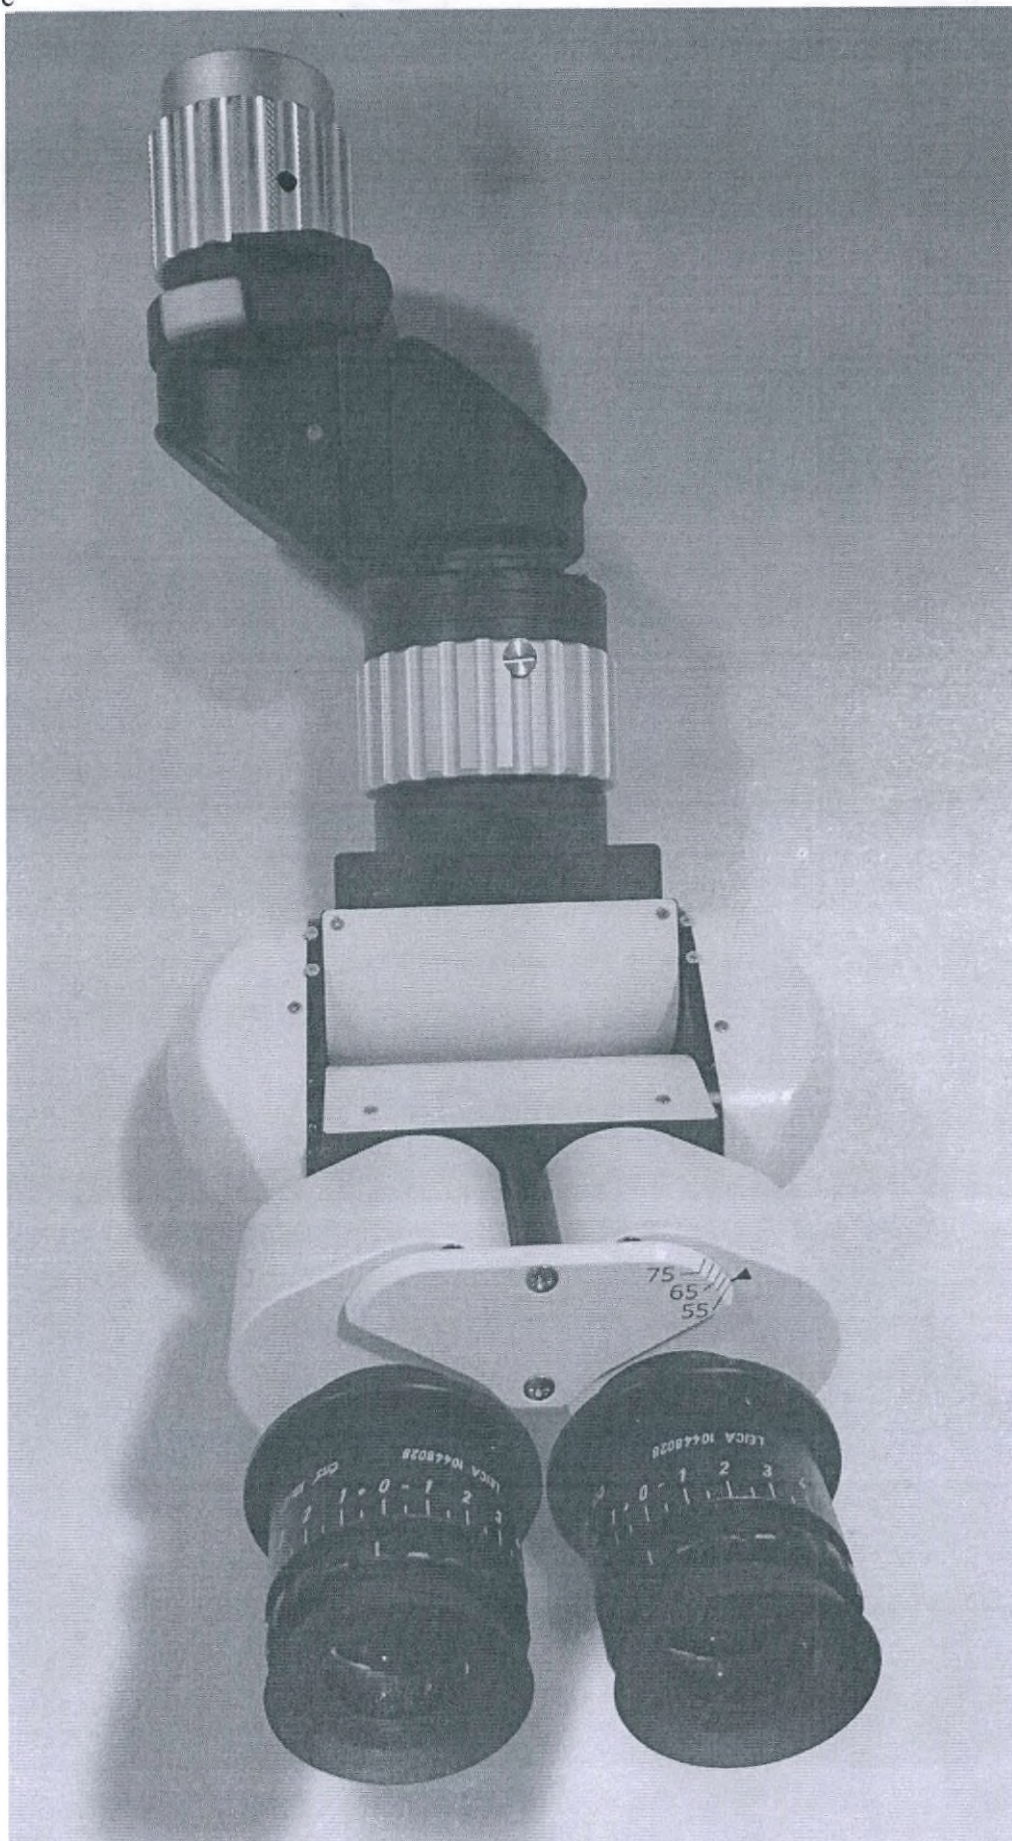


Общий вид изделия

Боковой тубус

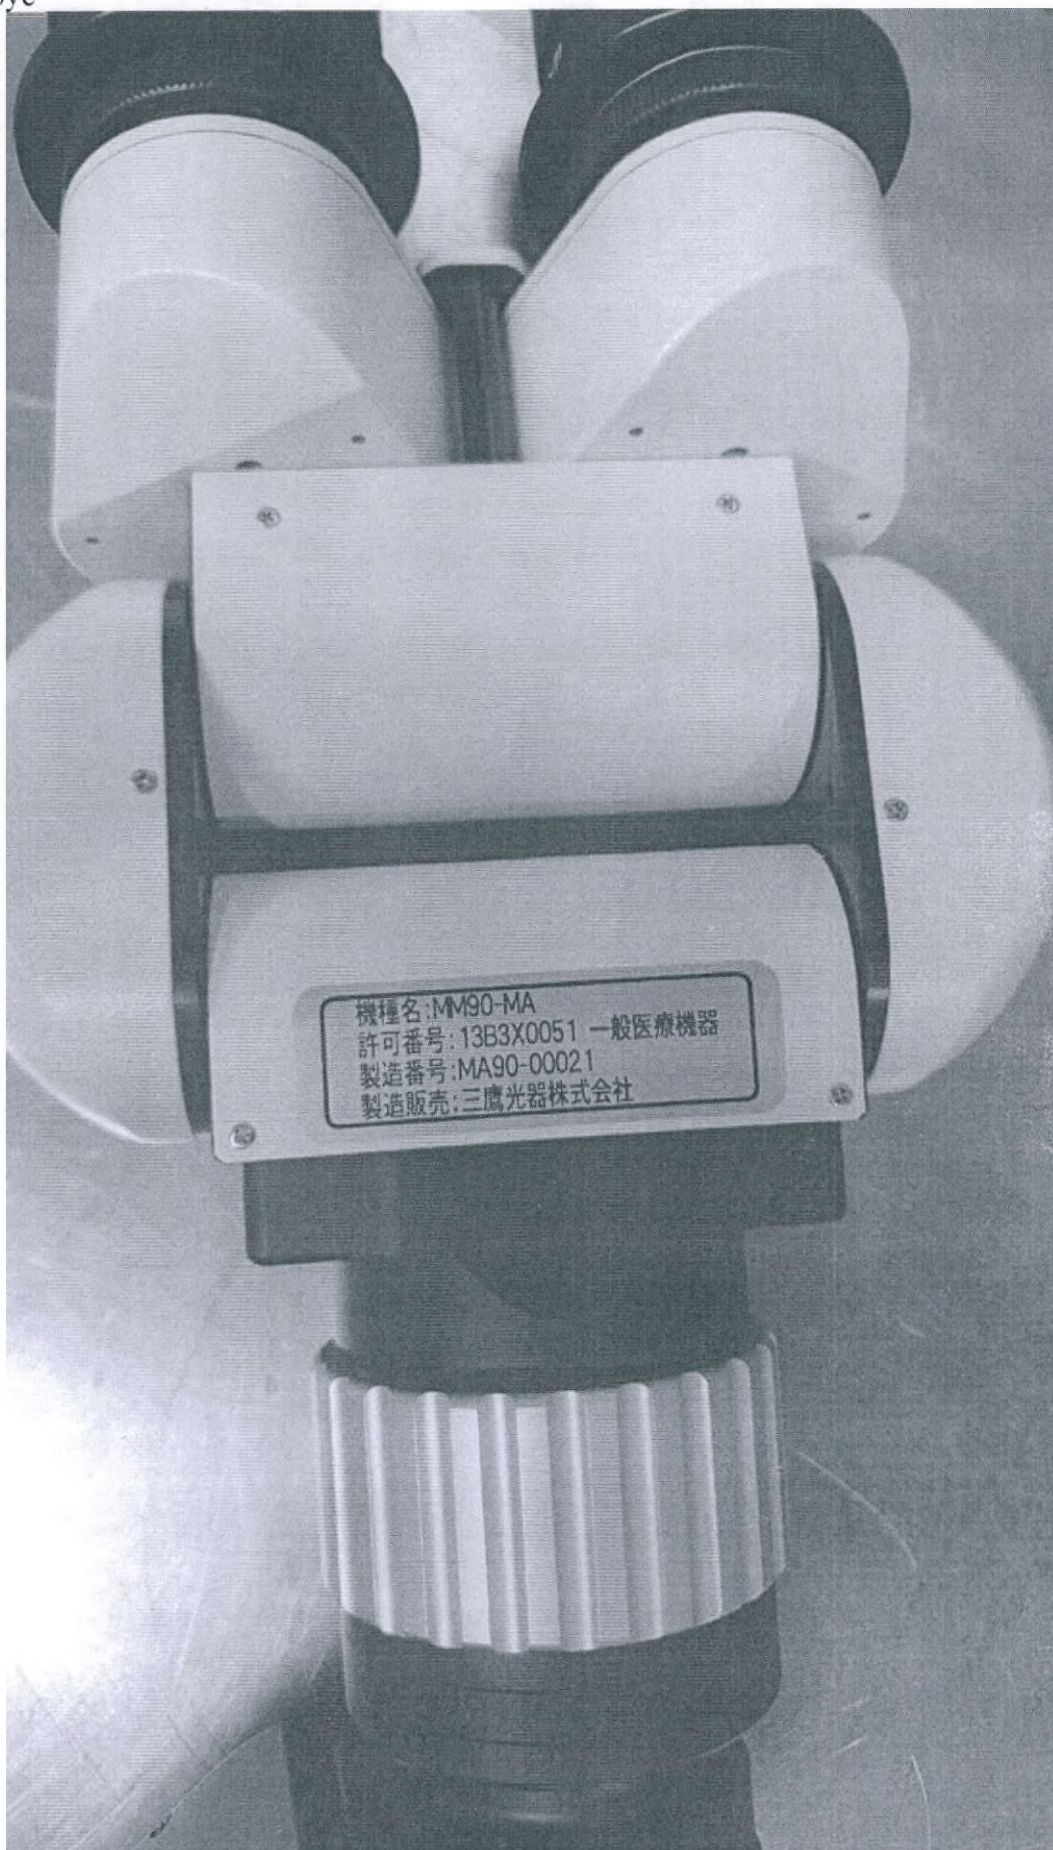


Маркировка на изделии

Адаптер камеры однокомпонентный

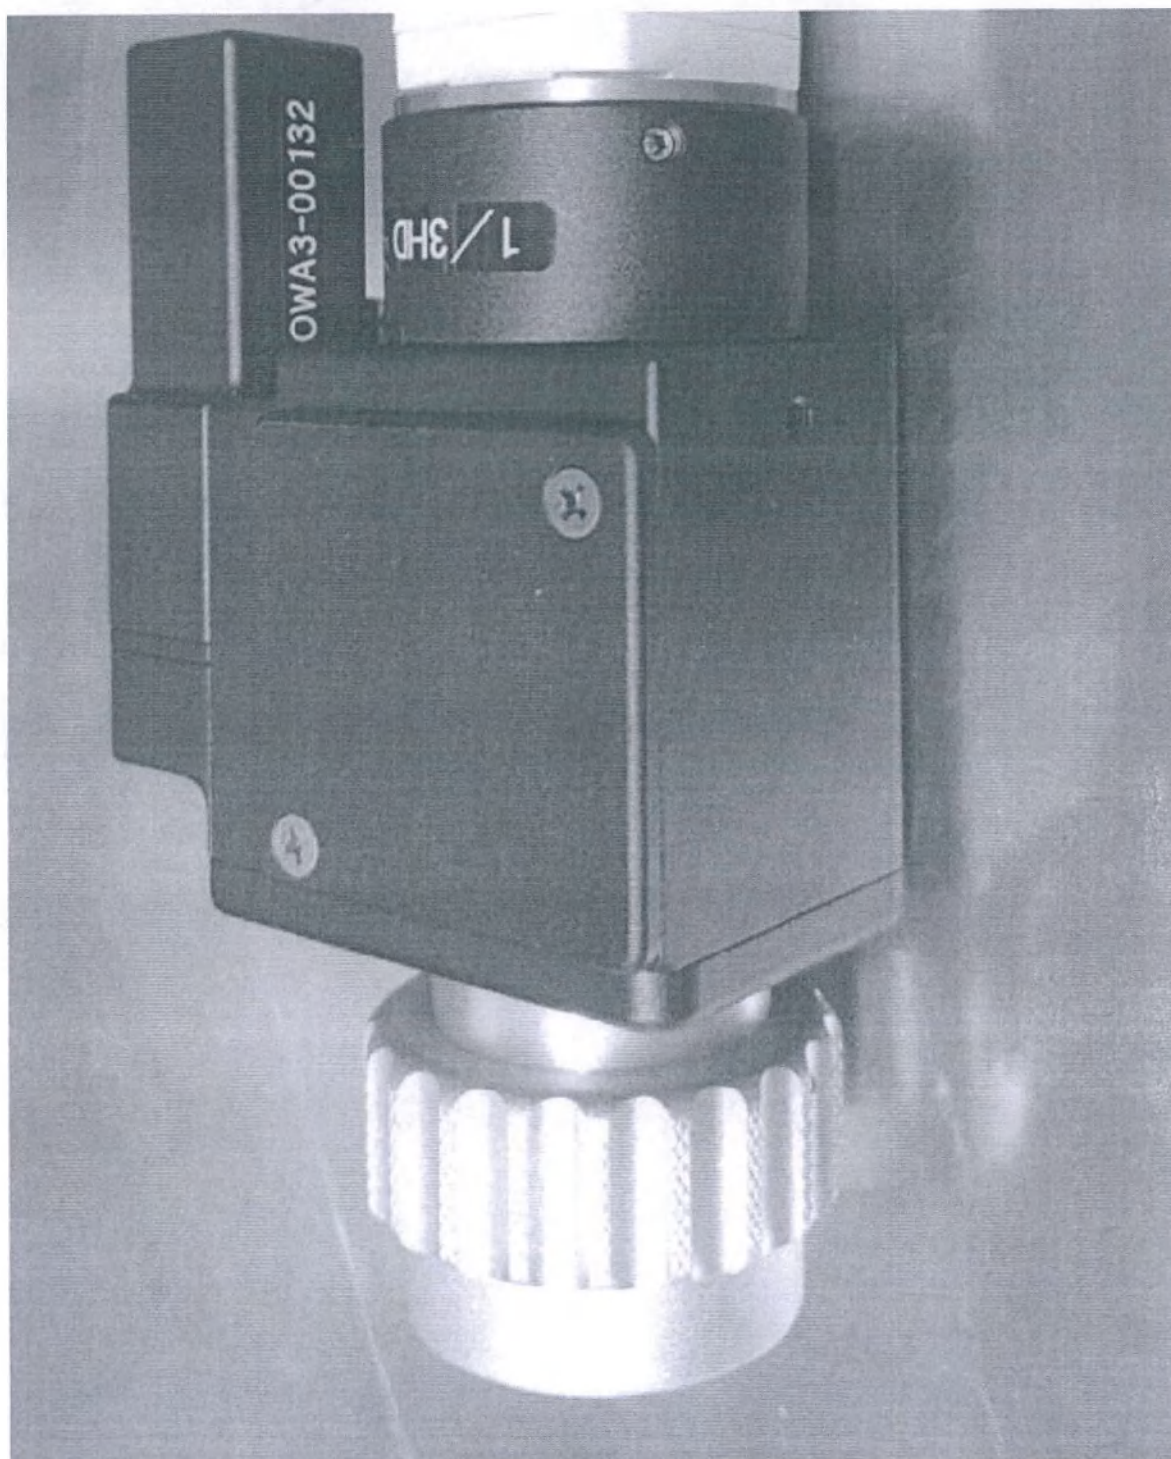


Общий вид изделия

Контроллер фокусировки камеры

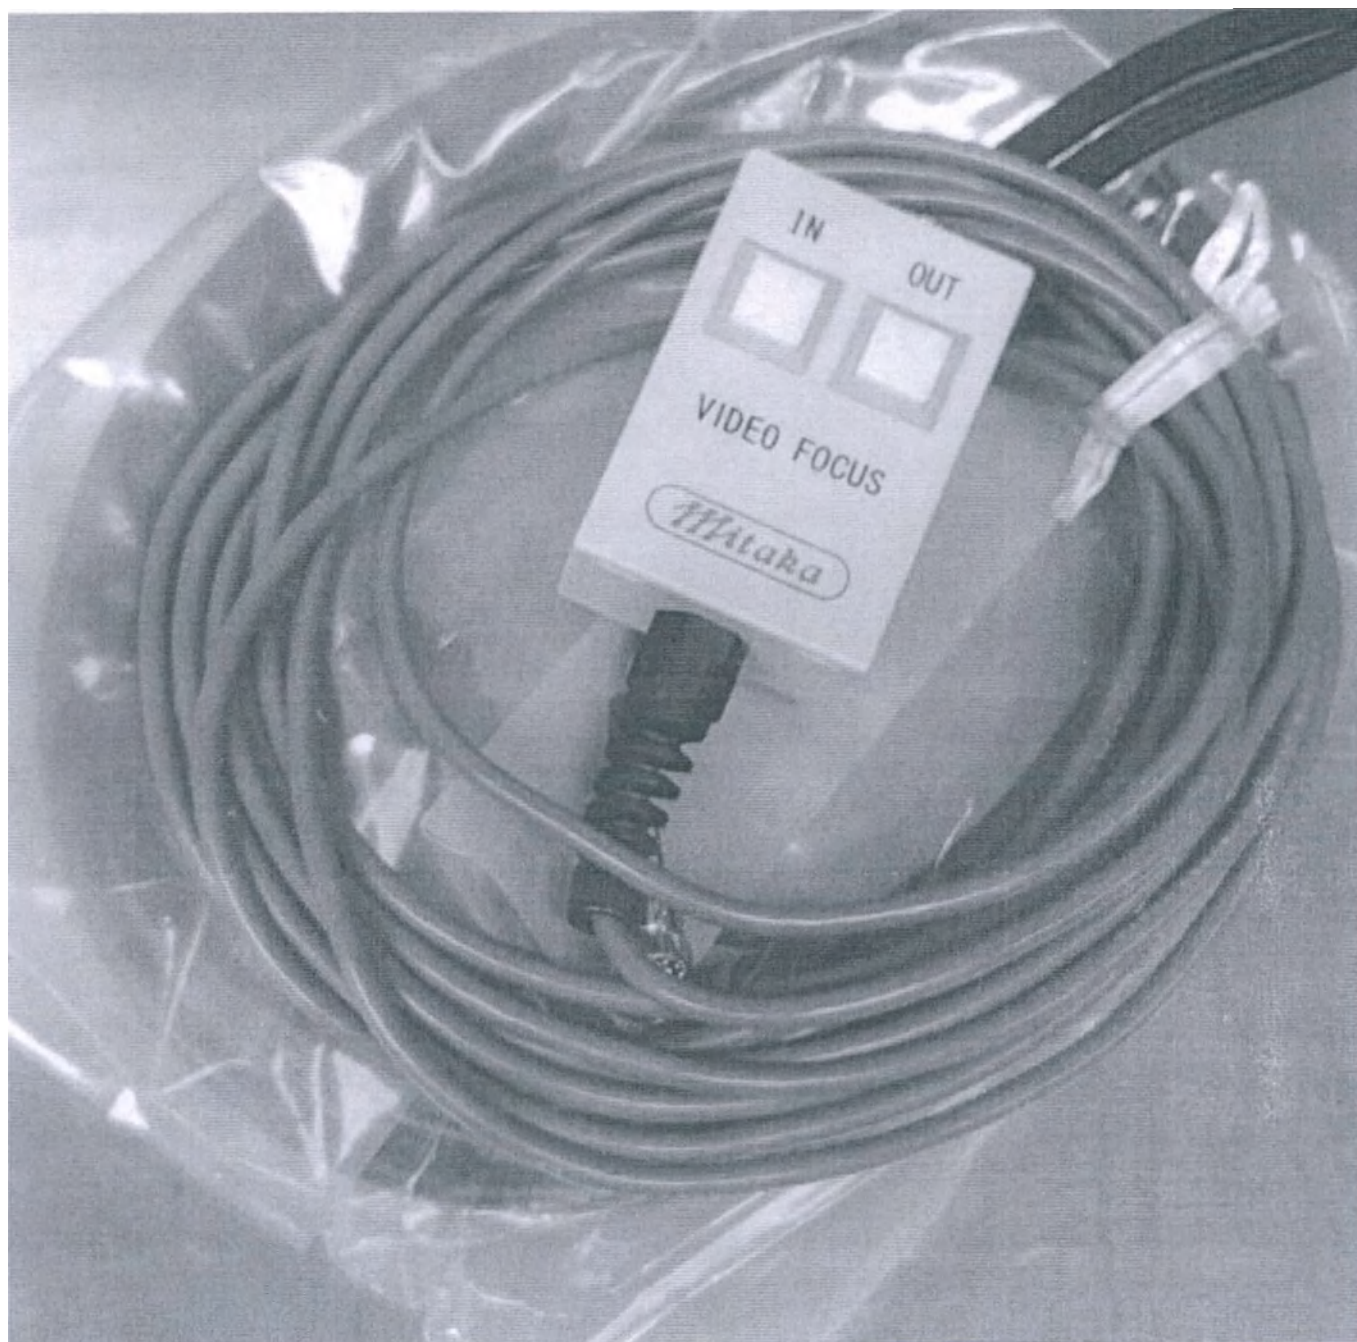


Общий вид изделия

Защитное стекло на объектив.

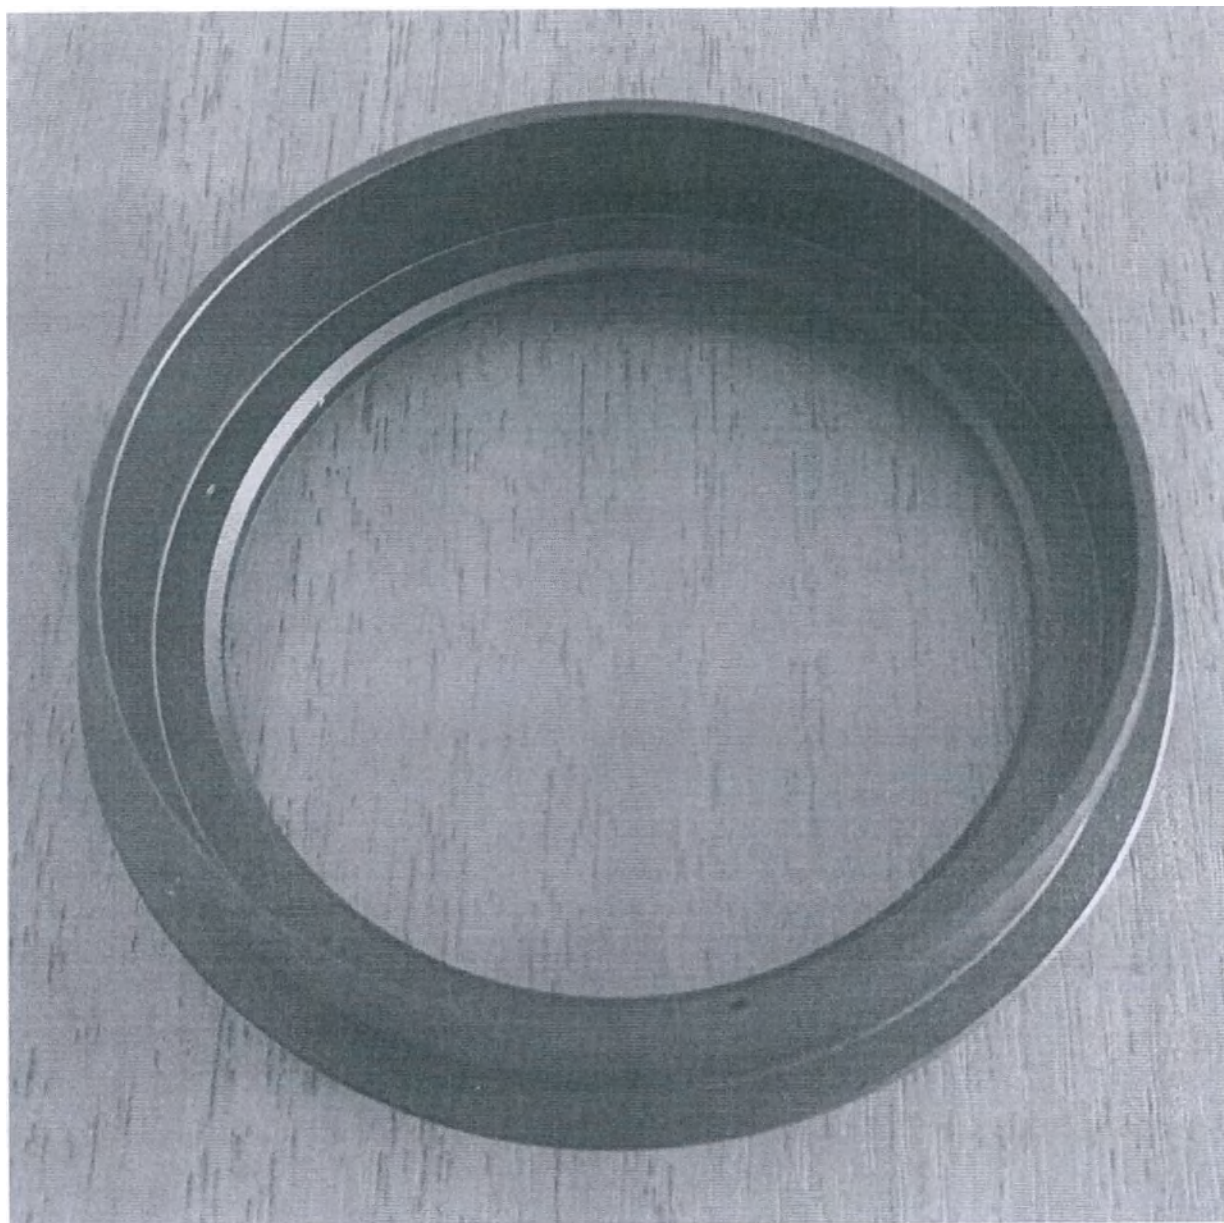


Общий вид изделия

Штатив SOH

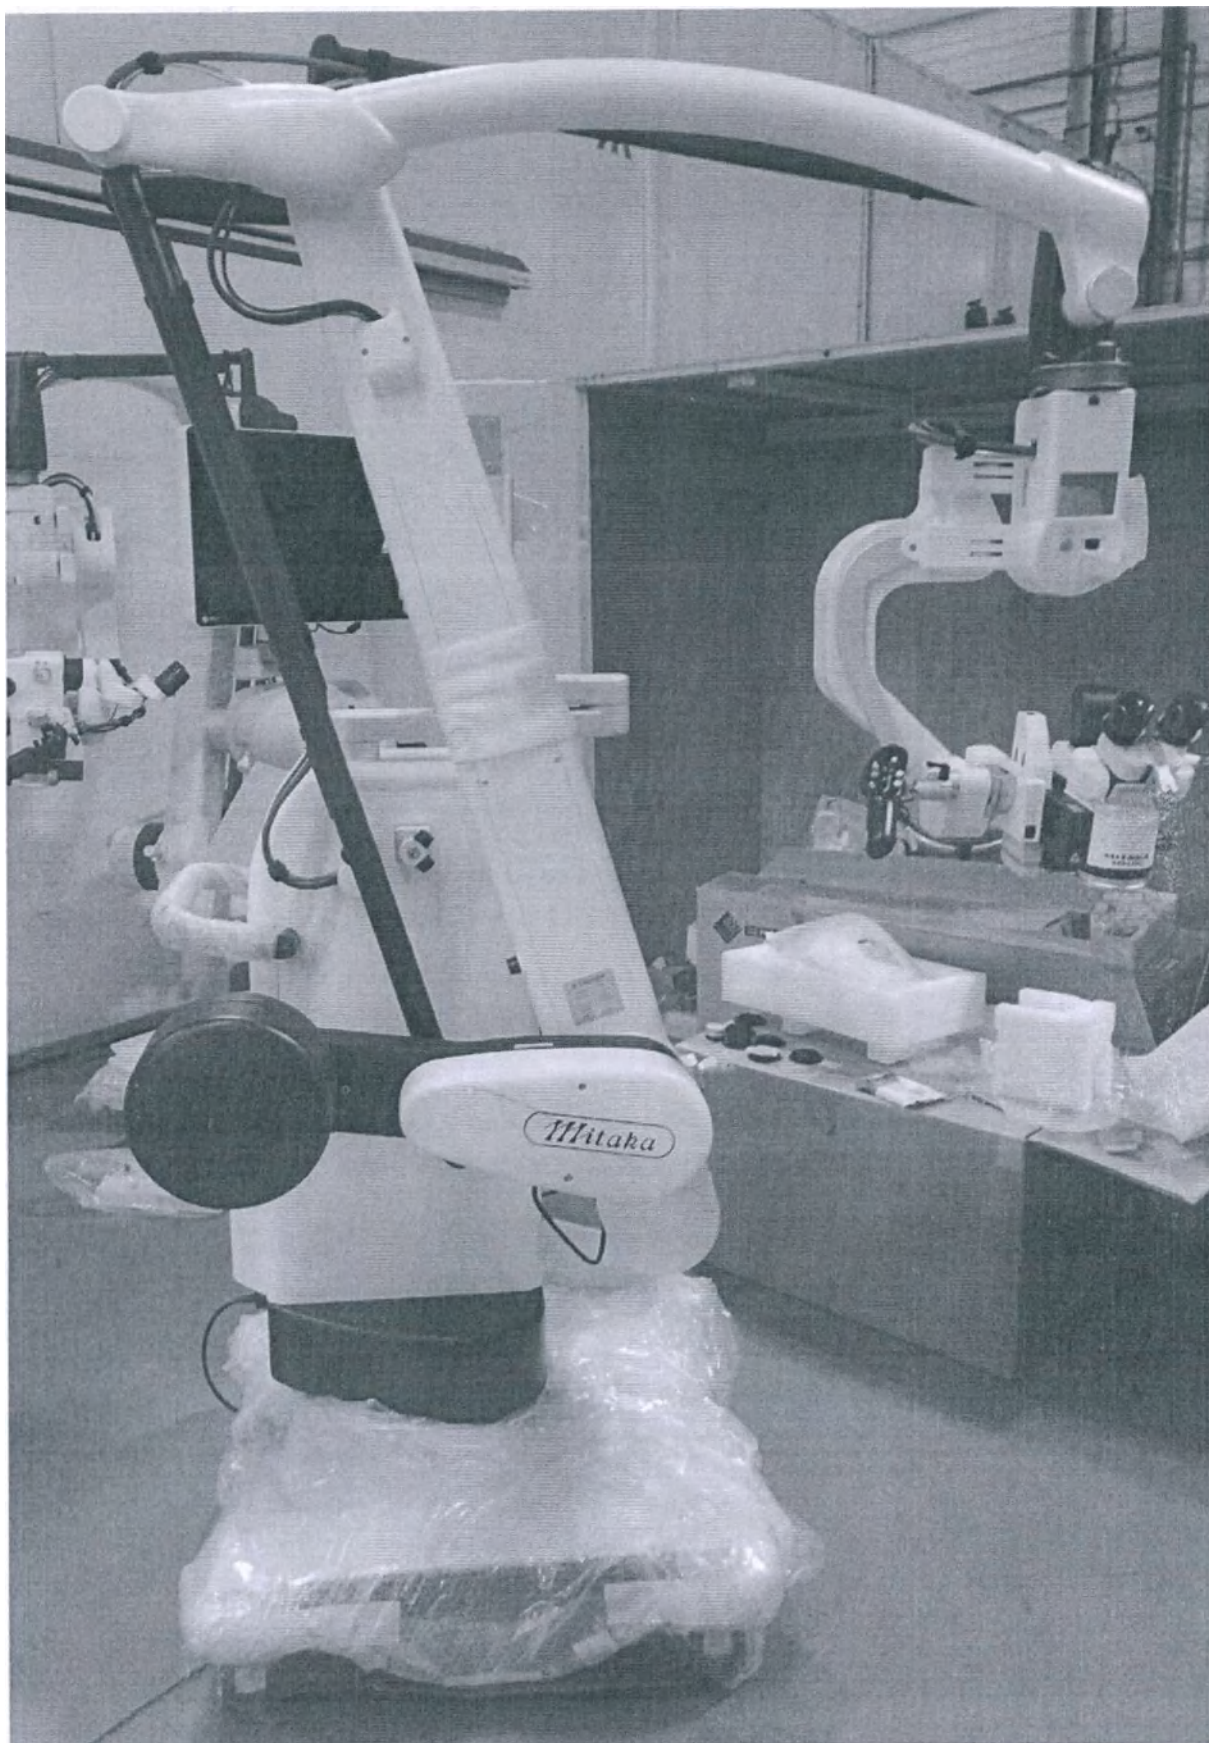


Общий вид изделия (в сборе с микроскопом MM90)

Держатель для монитора

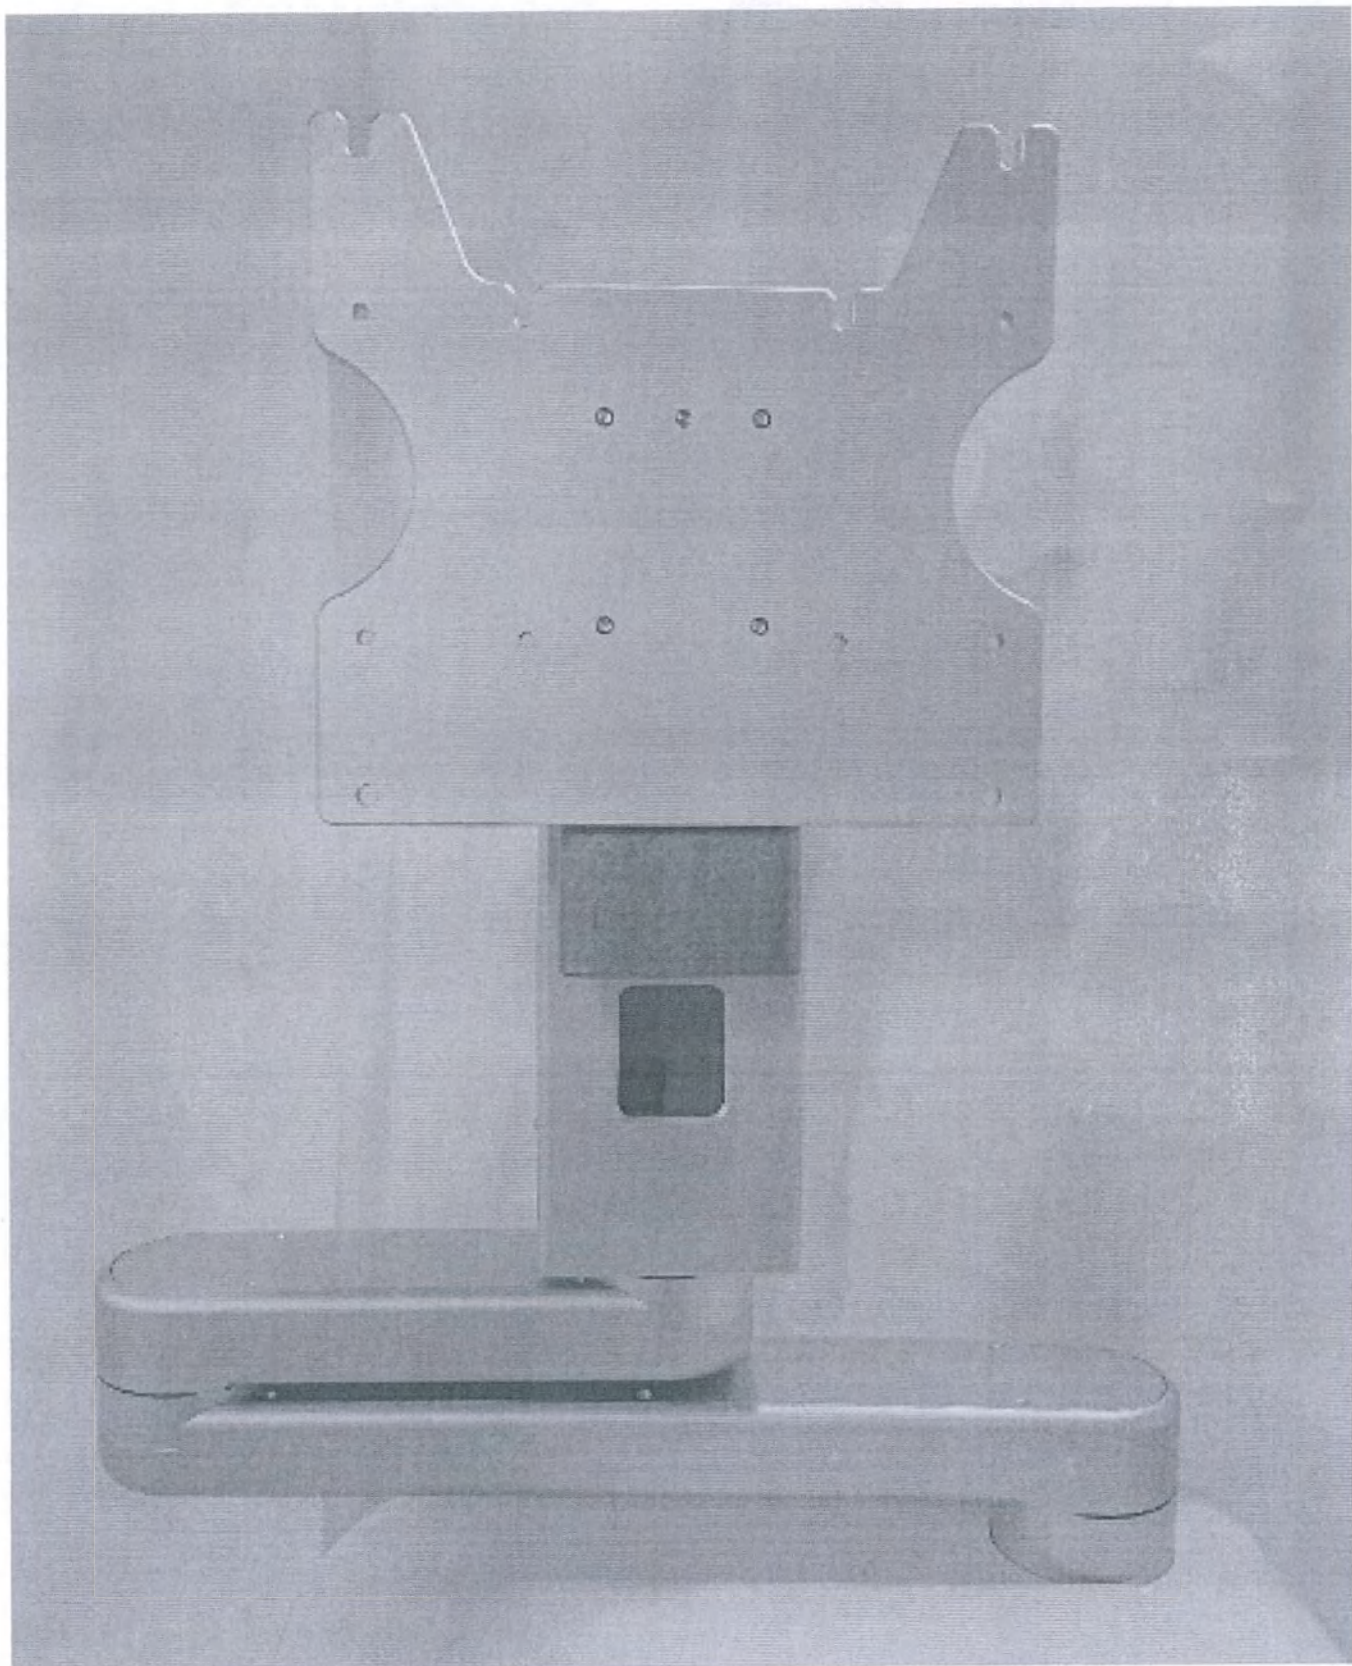

Общий вид изделия


Ножной переключатель

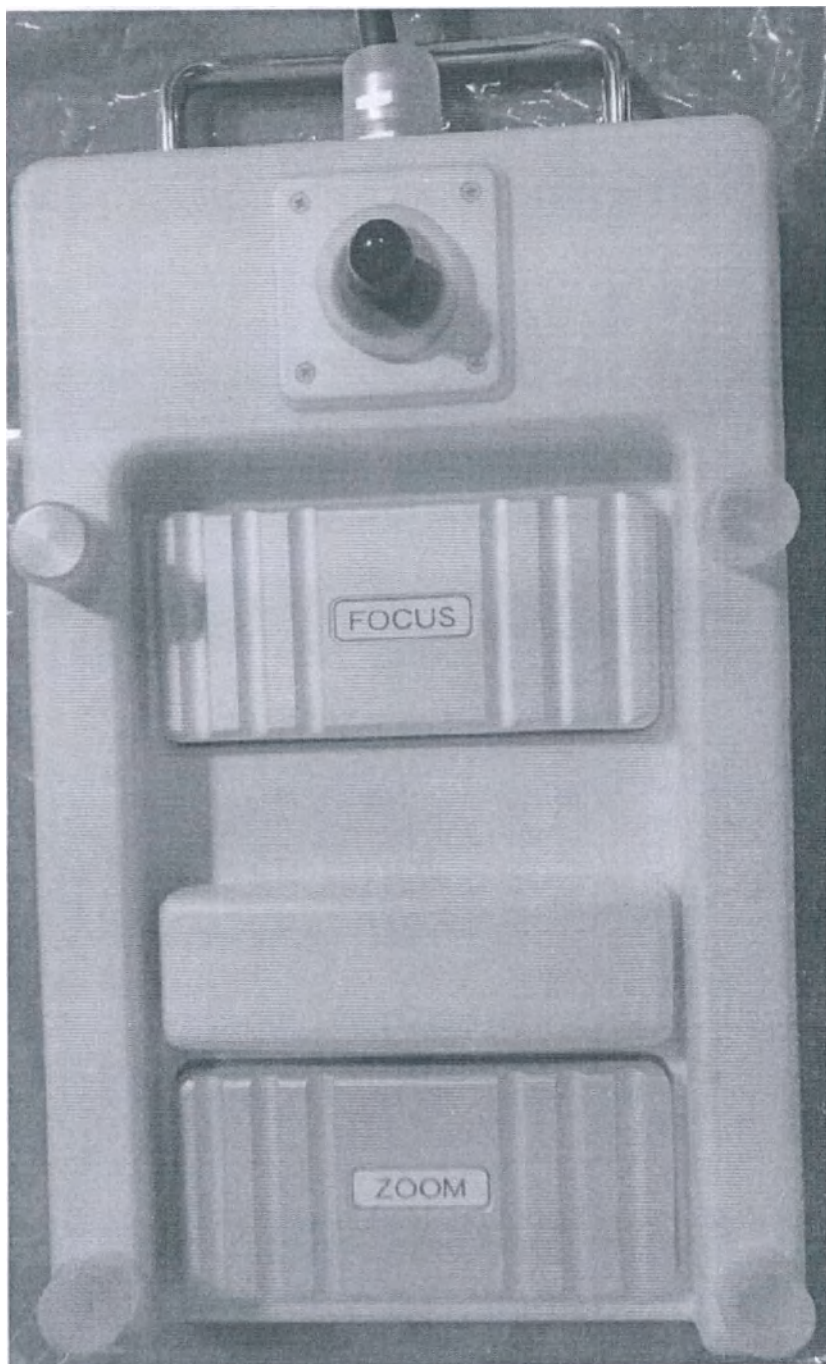

Общий вид изделия




Маркировка на изделии

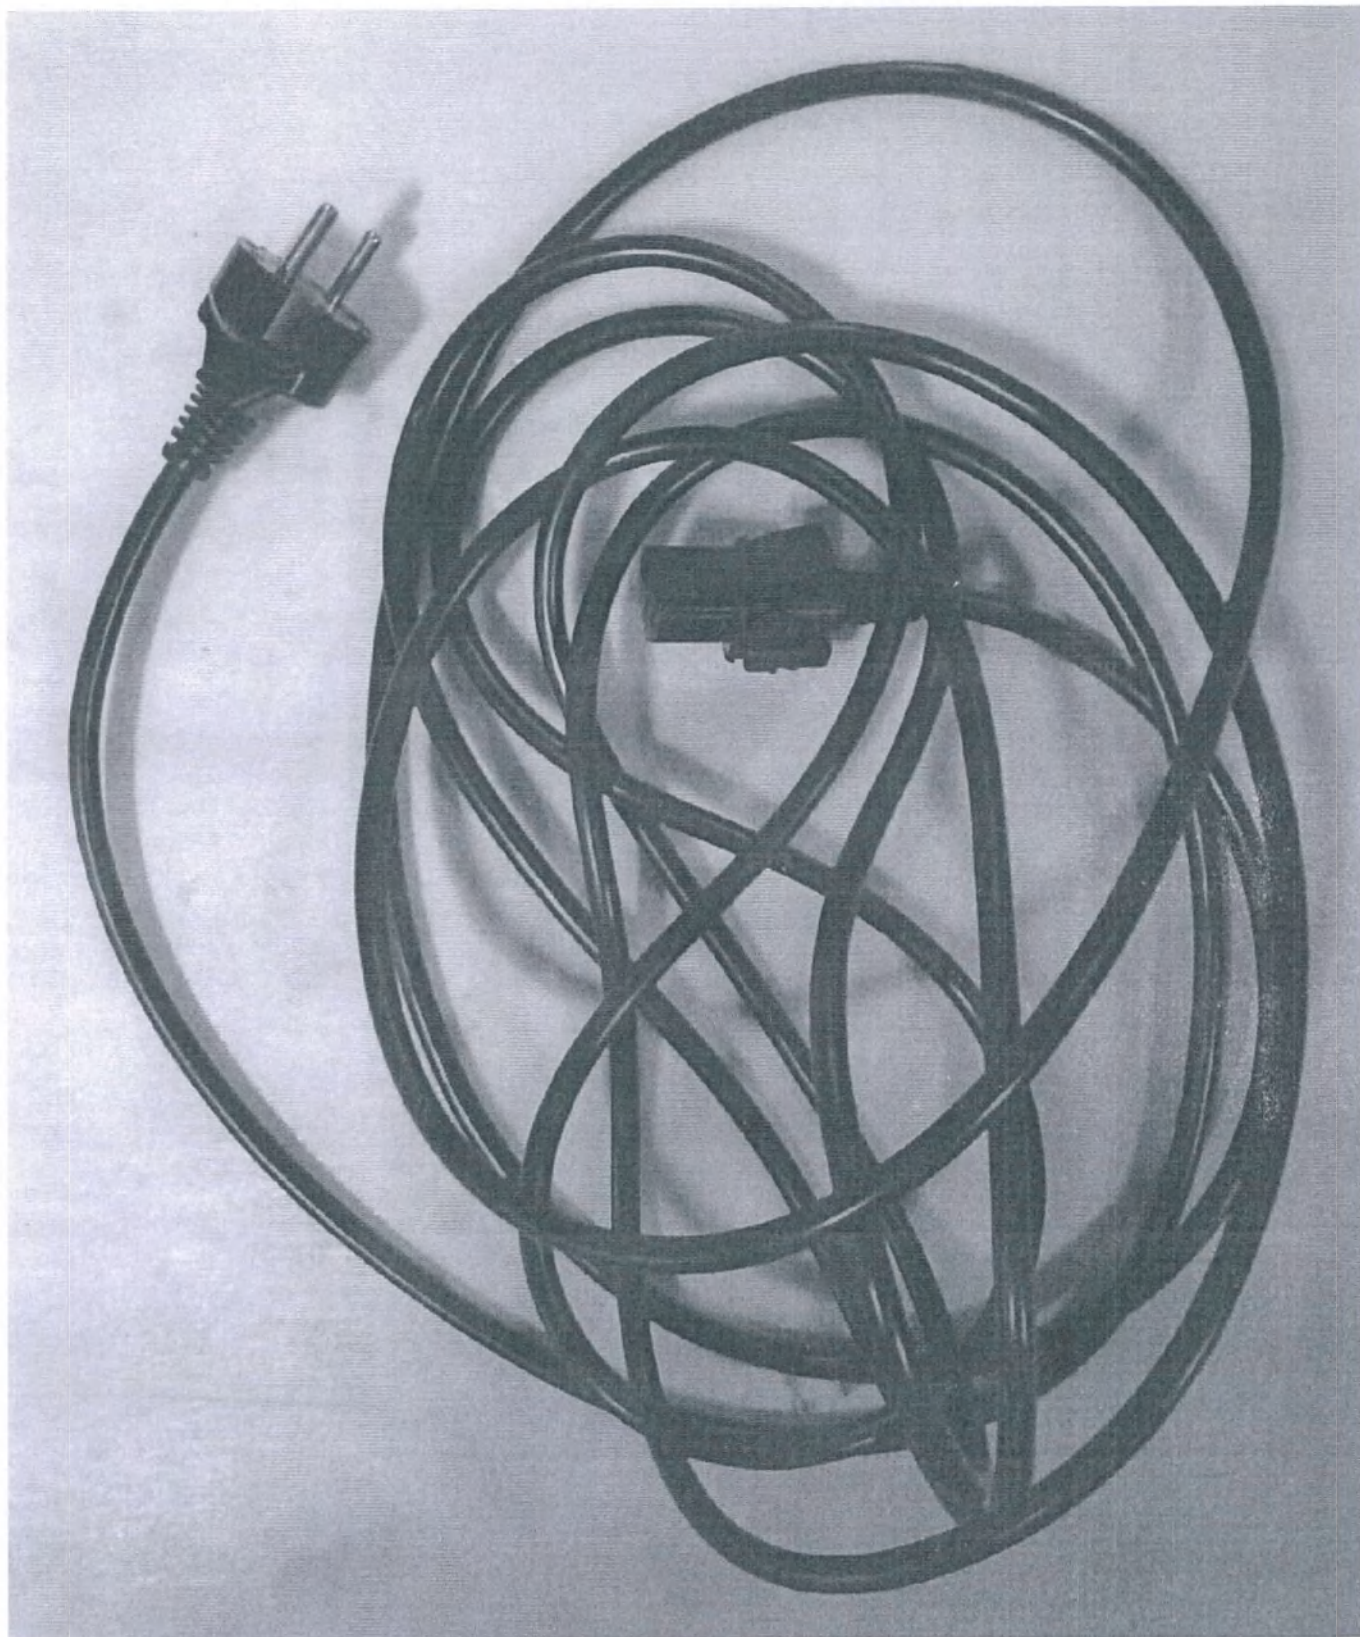


Общий вид изделия

Стандартный оптоволоконный кабель

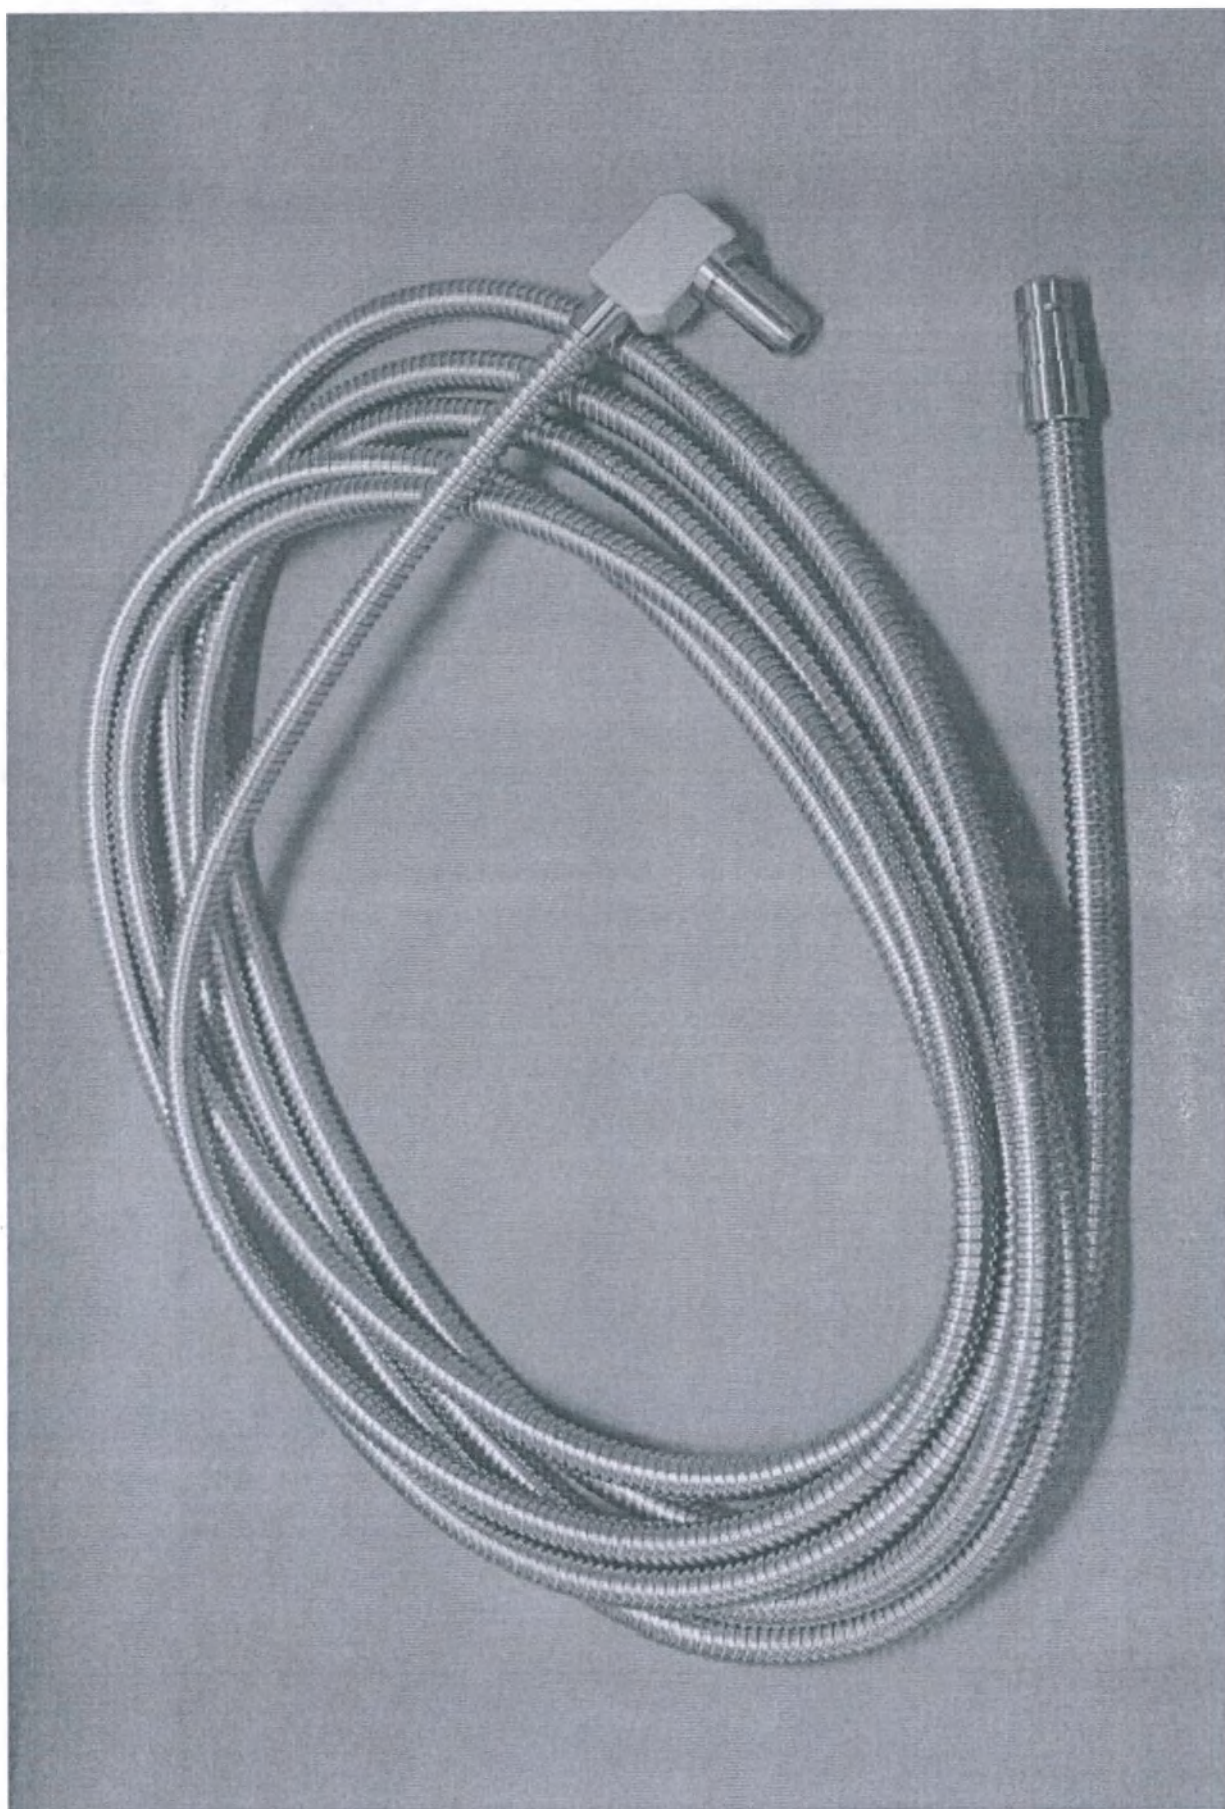


Общий вид изделия

Блок ксеноновой лампы 400W

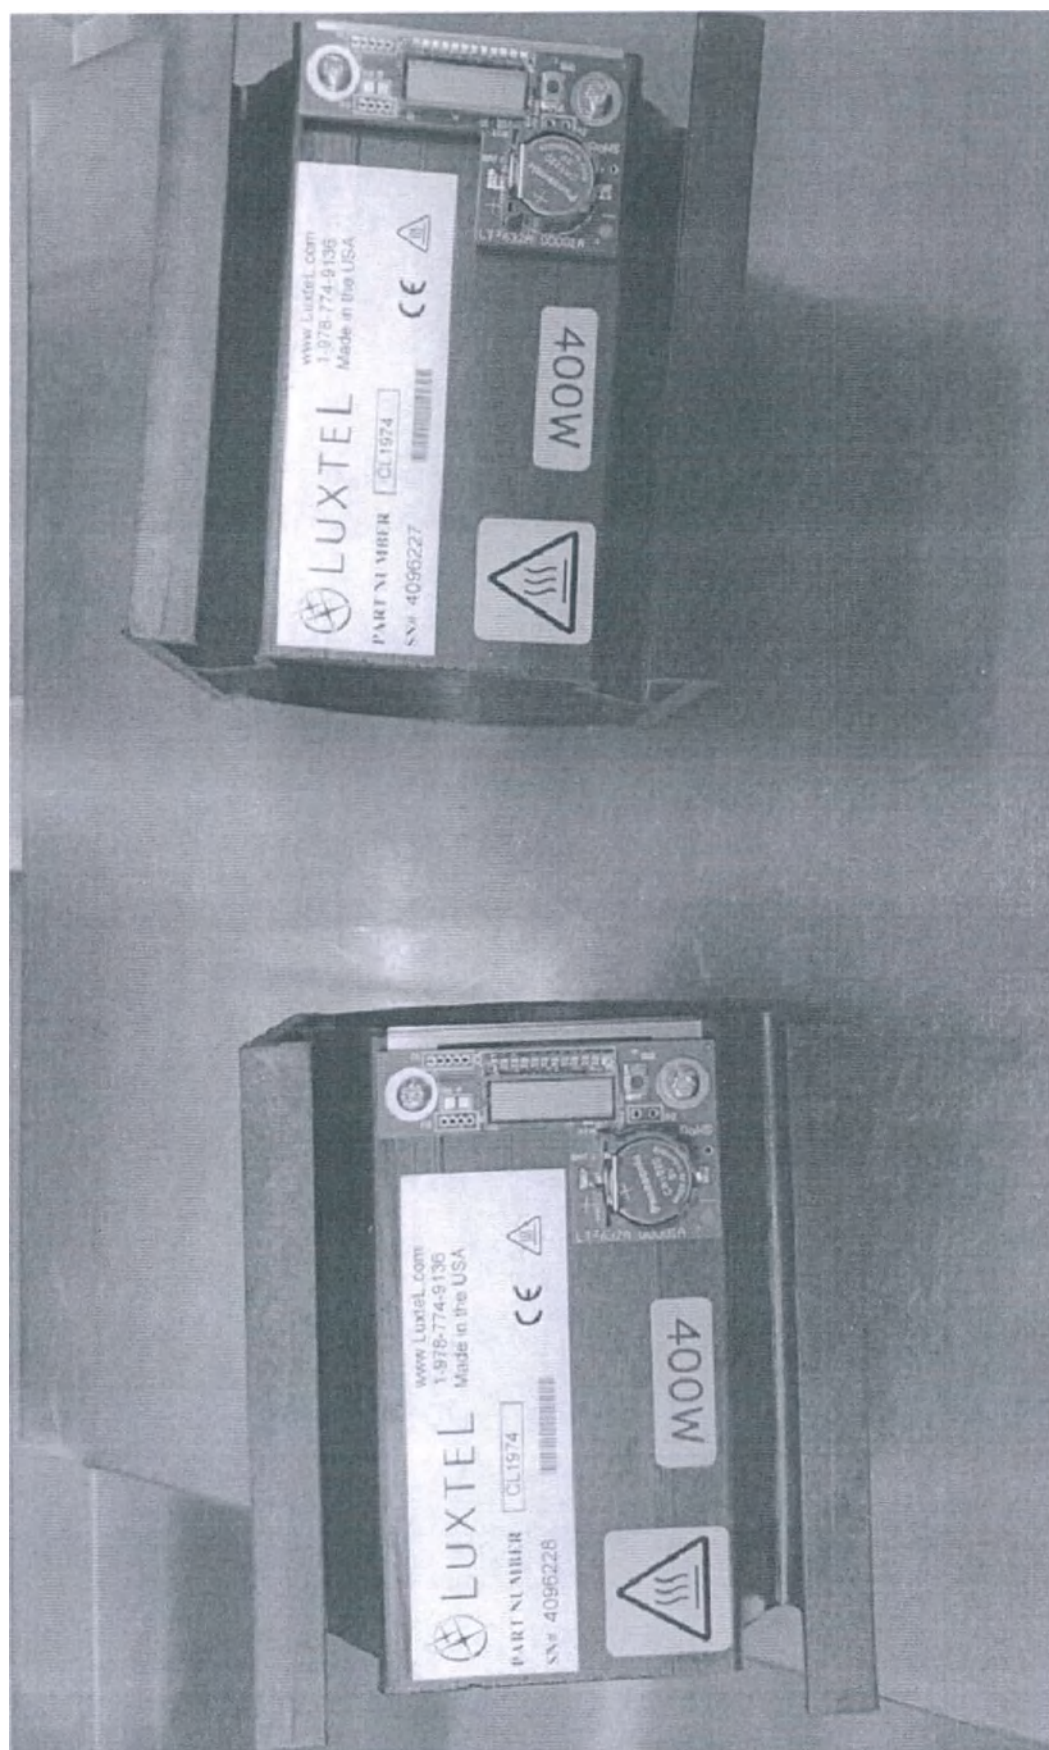

Общий вид и маркировка изделия

Ротовой переключатель

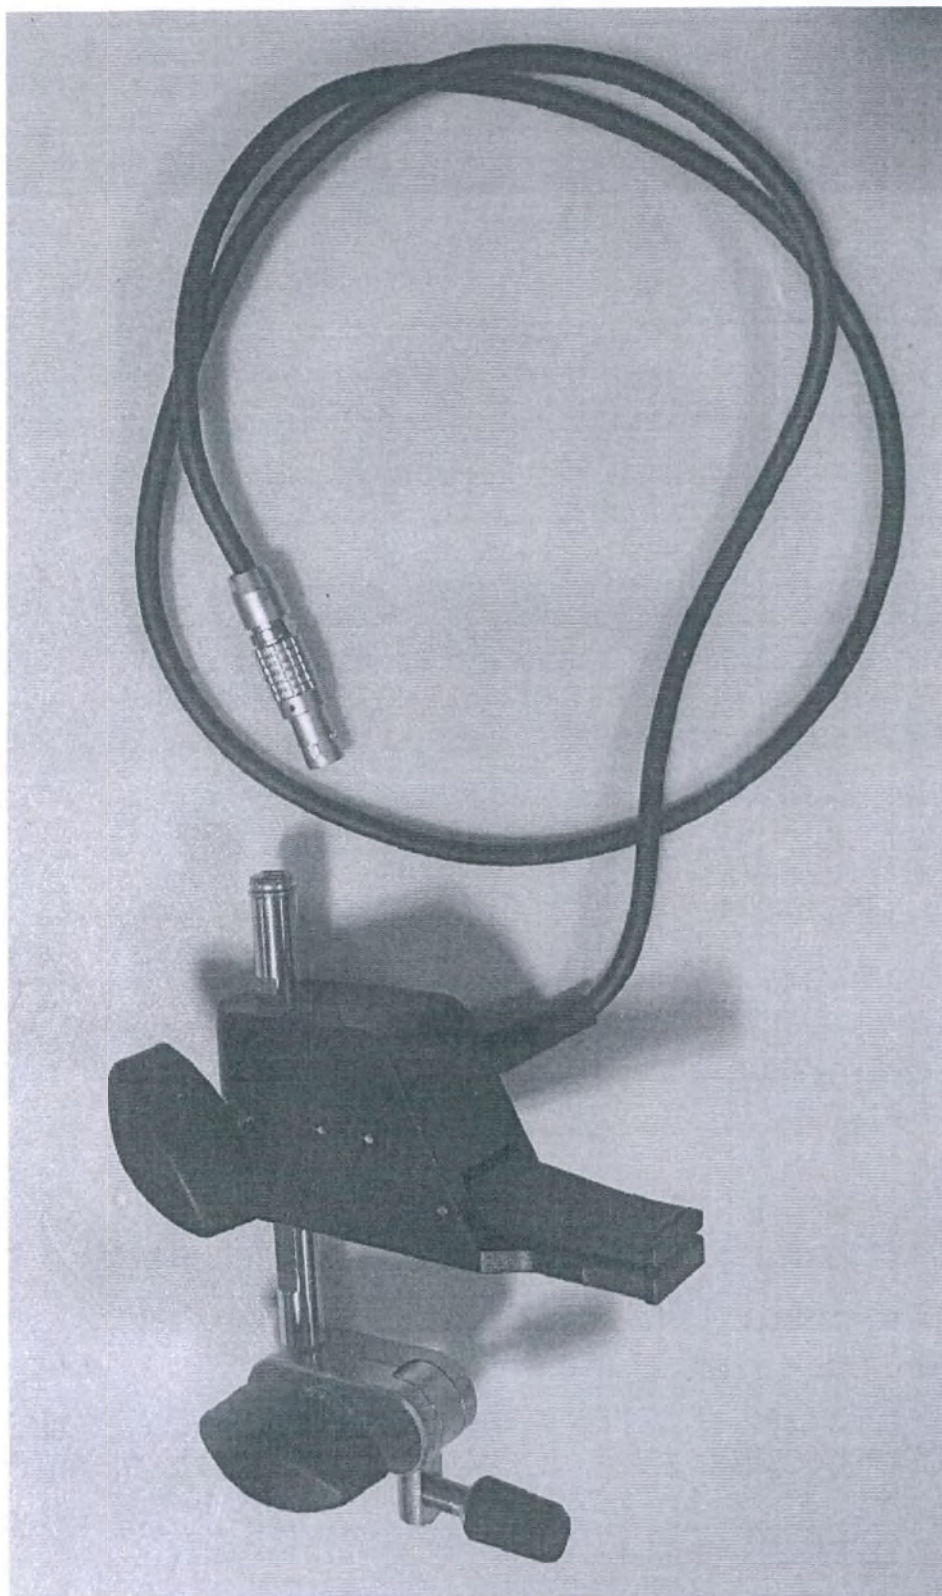


Общий вид изделия




Маркировка на изделии

Цветная камера 3D Mitaka (3D, 2K)

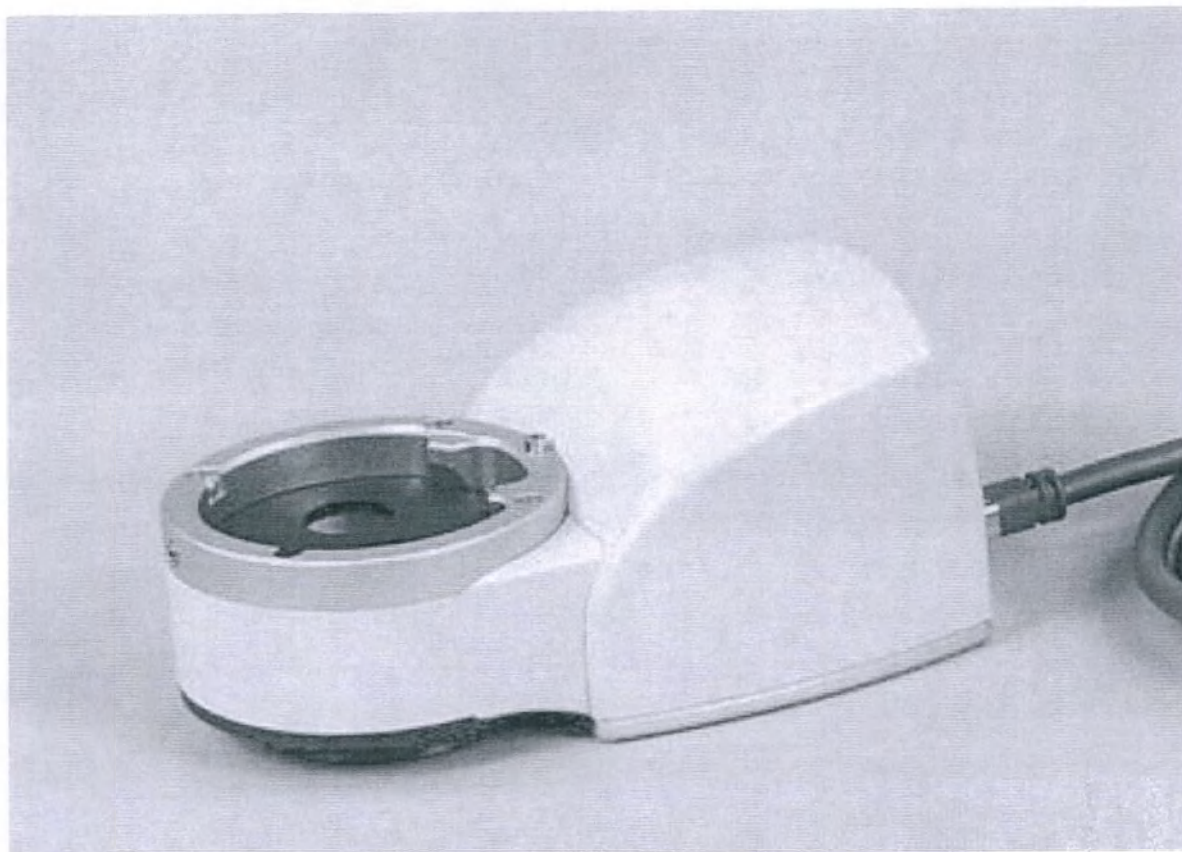


Общий вид головки камеры

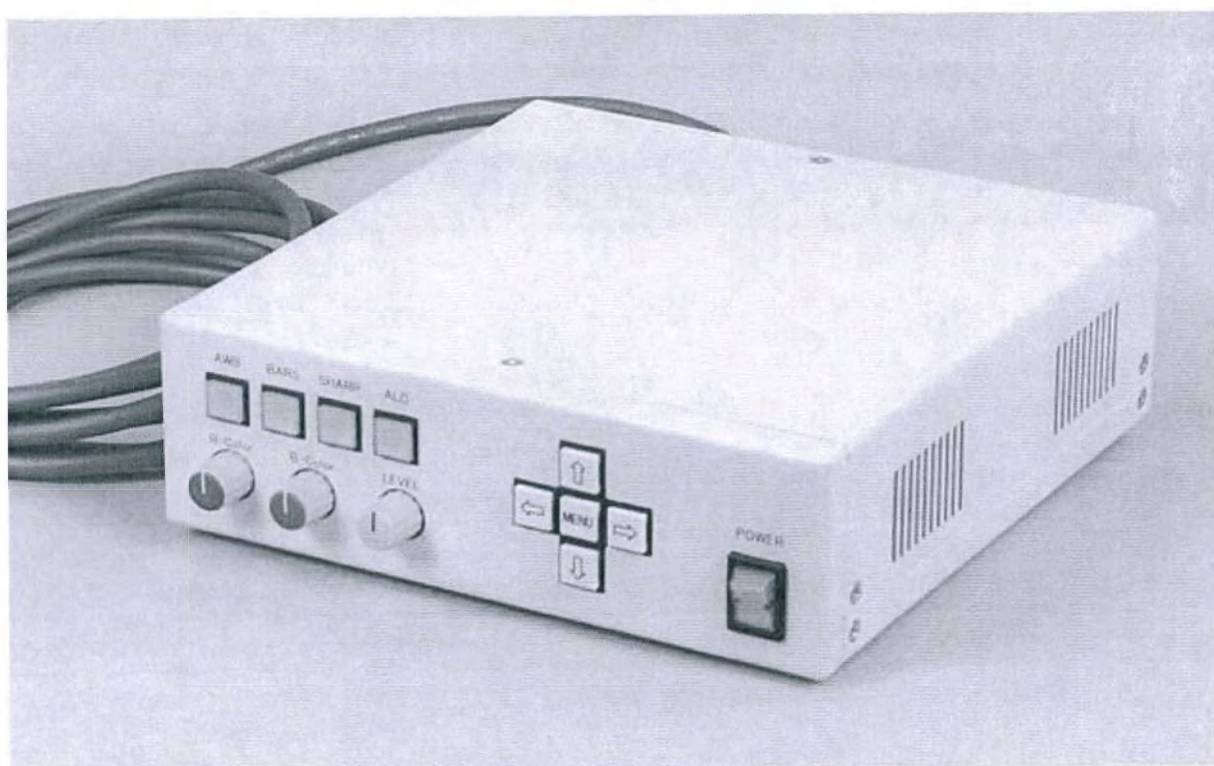


Общий вид блока управления

Цветная камера 3D Mitaka

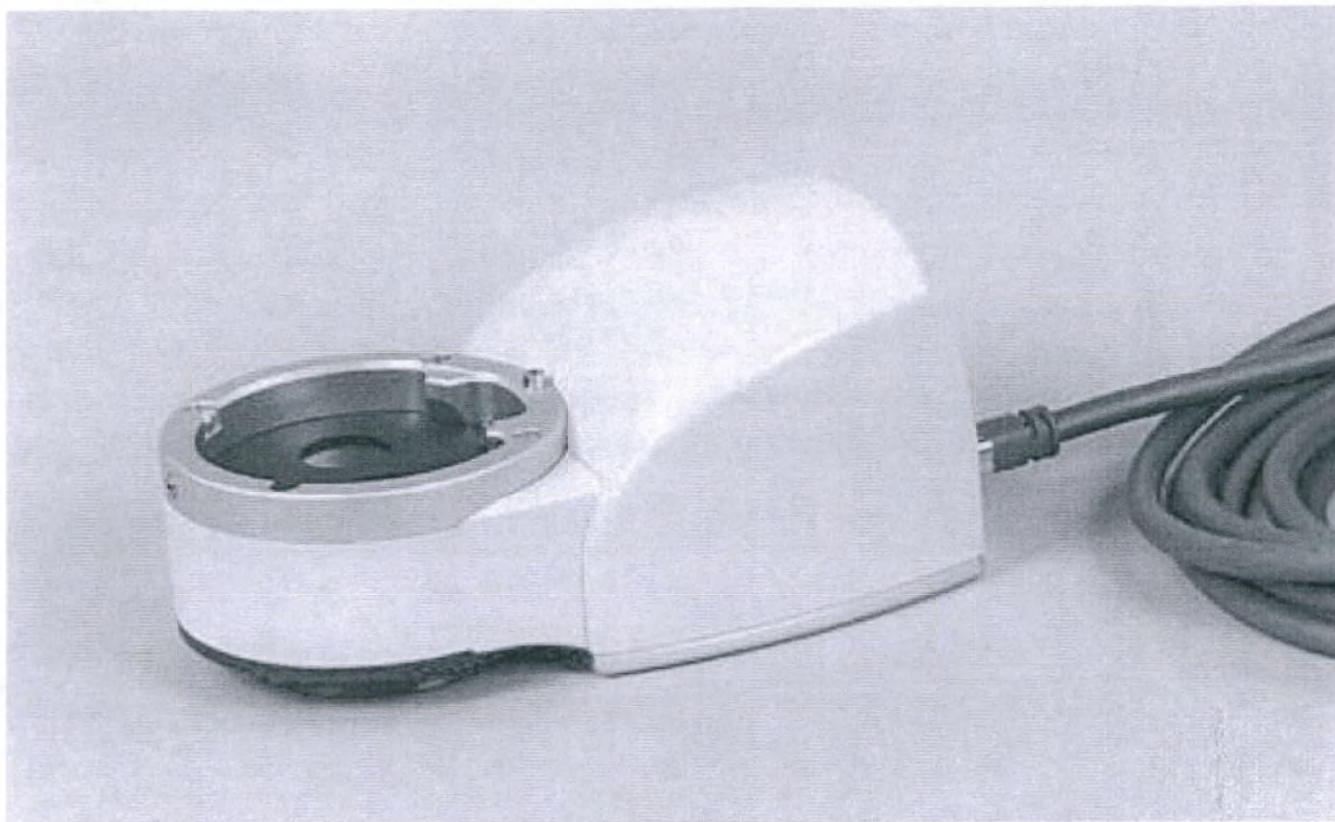

Общий вид головки камеры

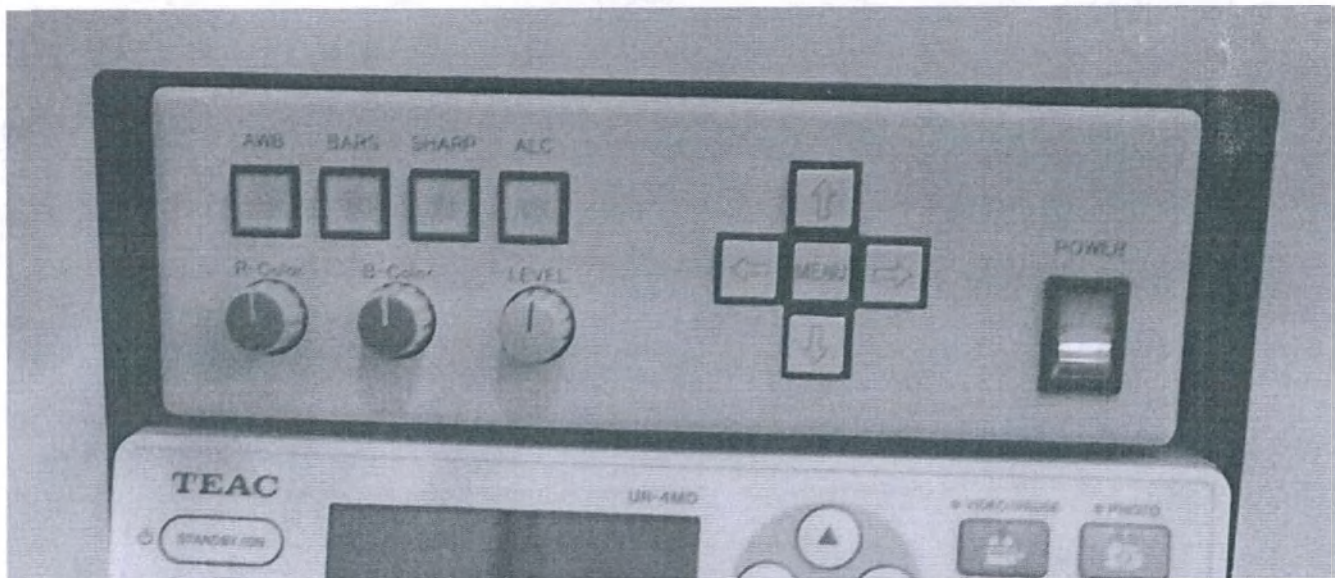

Блок управления предустановленный в штатив микроскопа

Цветная камера Panasonic (2D, Full HD)



Общий вид головки камеры и маркировка на изделии




Общий вид блока управления

Цветная камера Panasonic (2D, 4K)




Общий вид головки камеры и маркировка на изделии

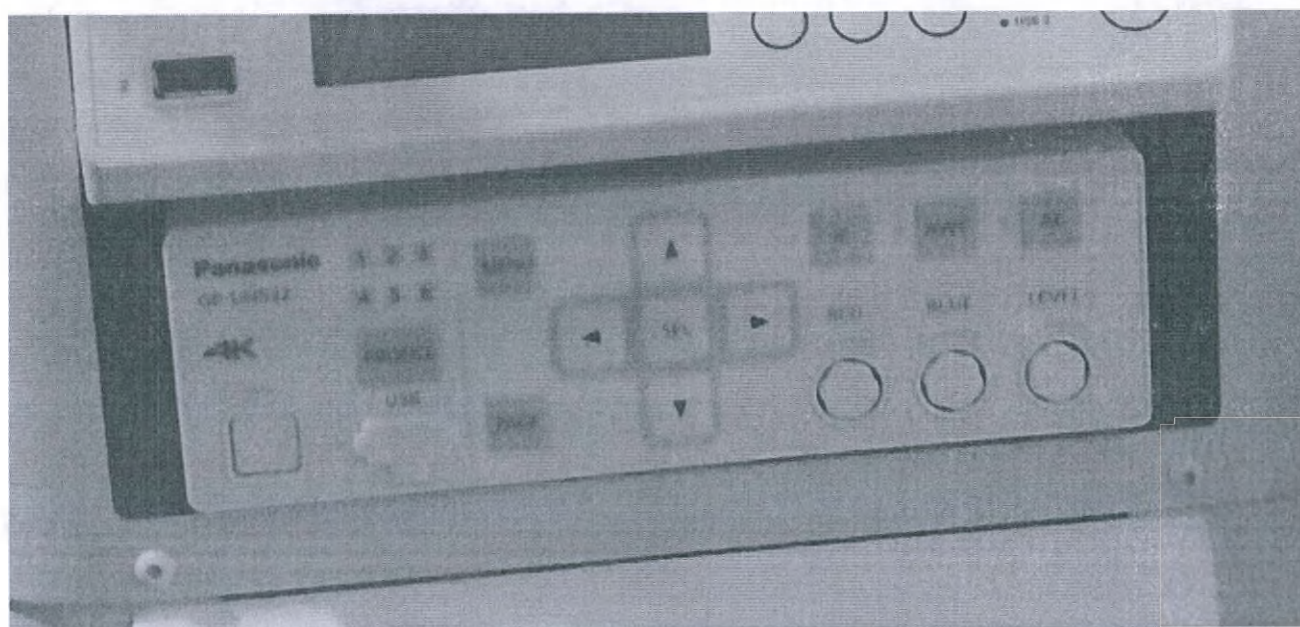


Блок управления (предустановлен в штатив микроскопа)


Монитор 2D, 27 дюймов

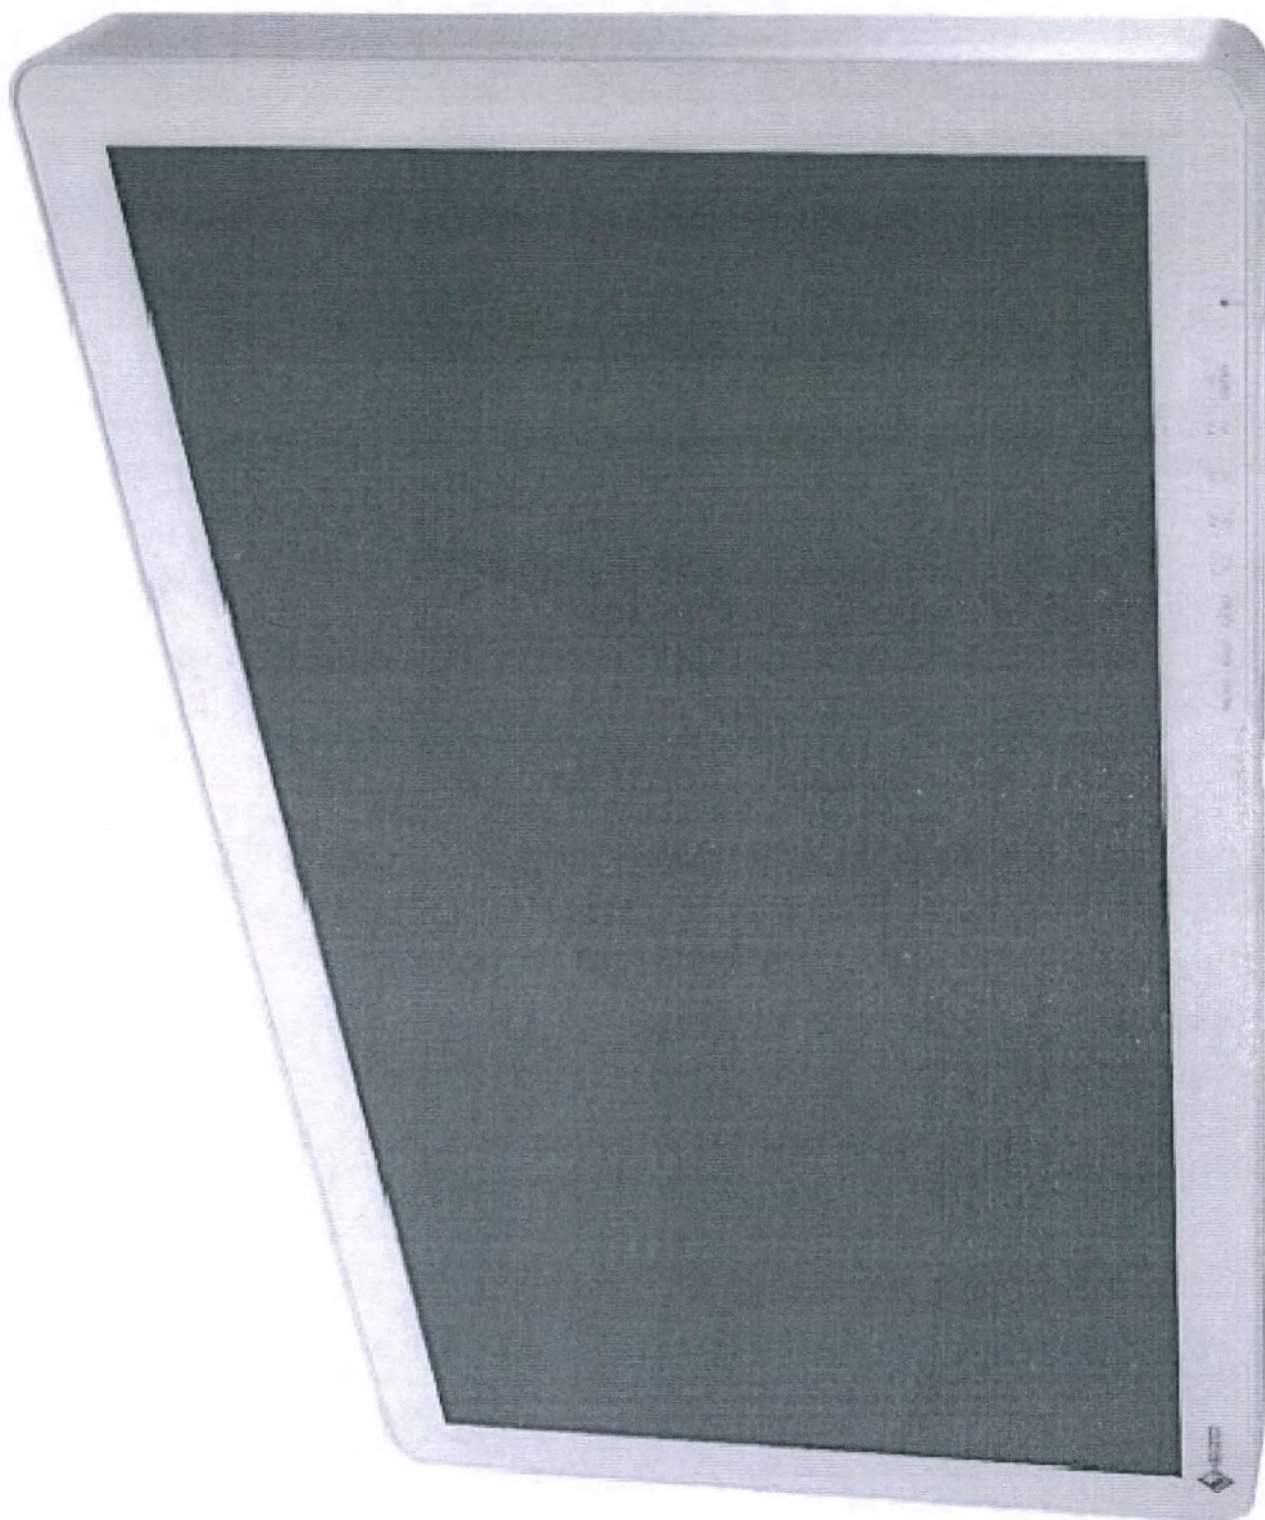


Общий вид изделия

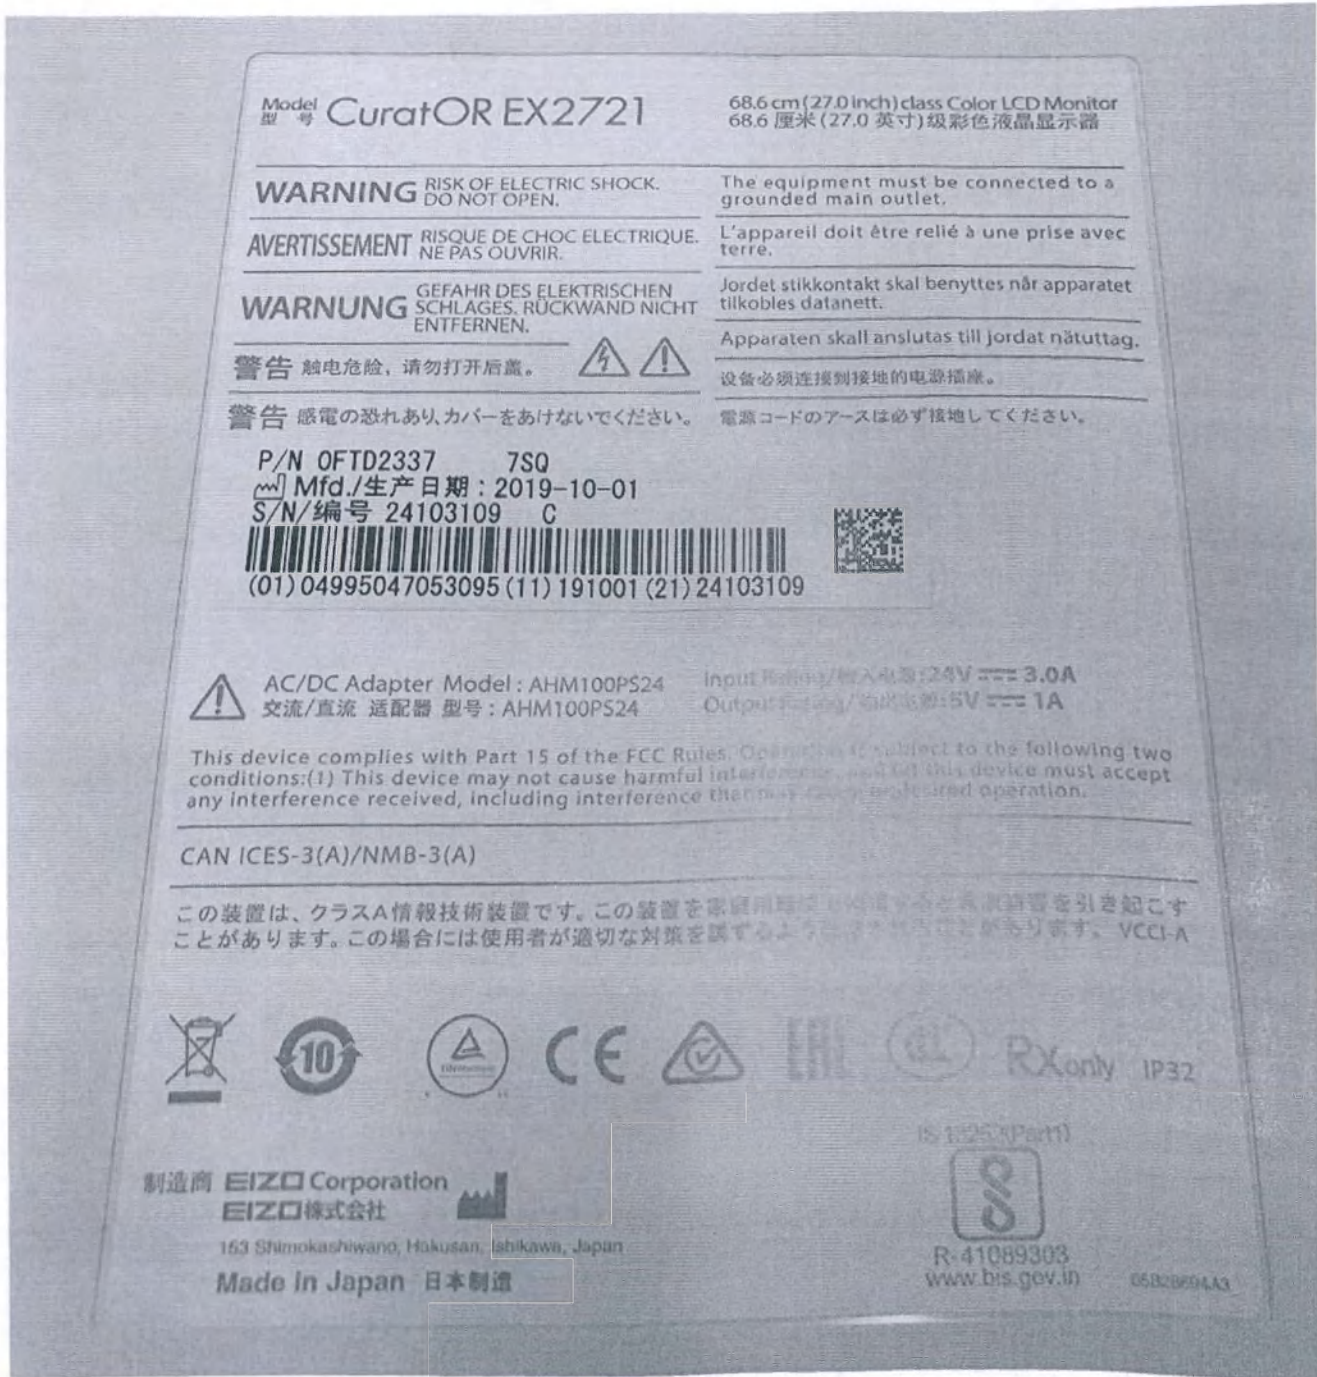


Монитор 2D, 32 дюйма

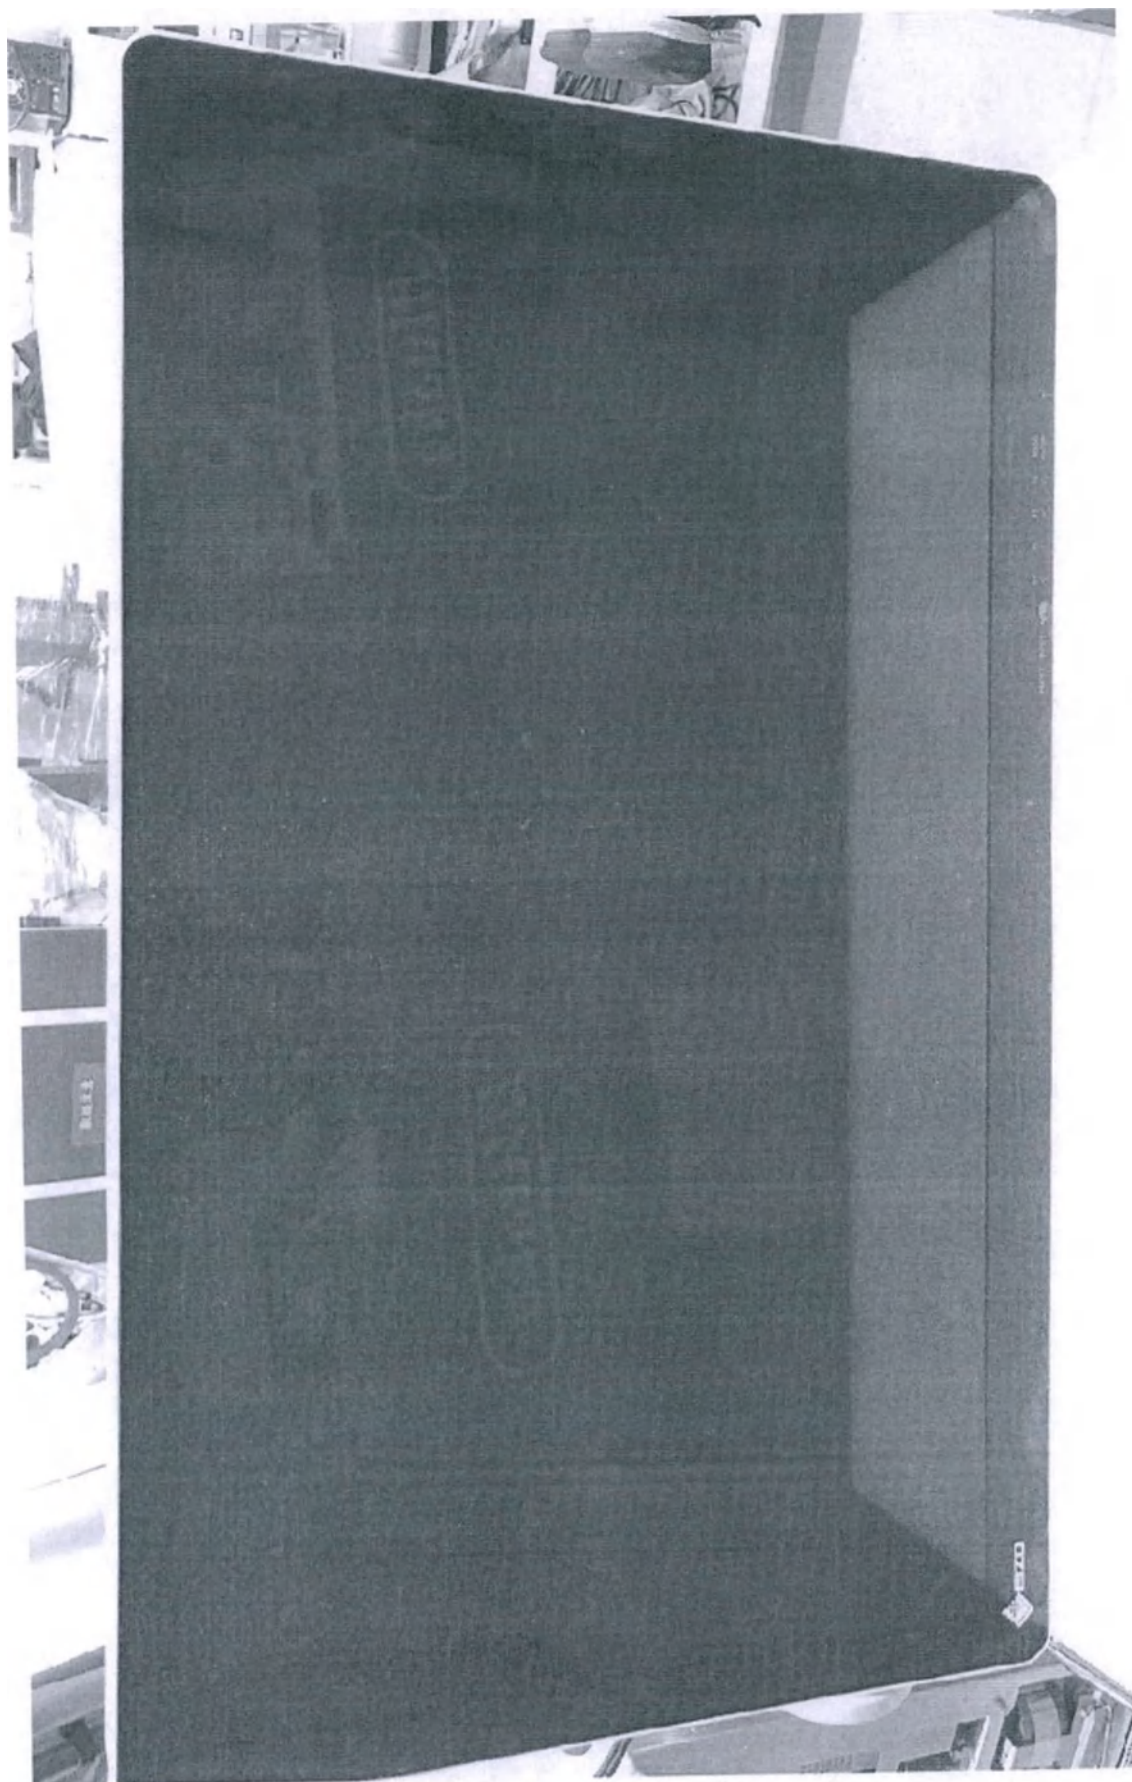

Общий вид изделия

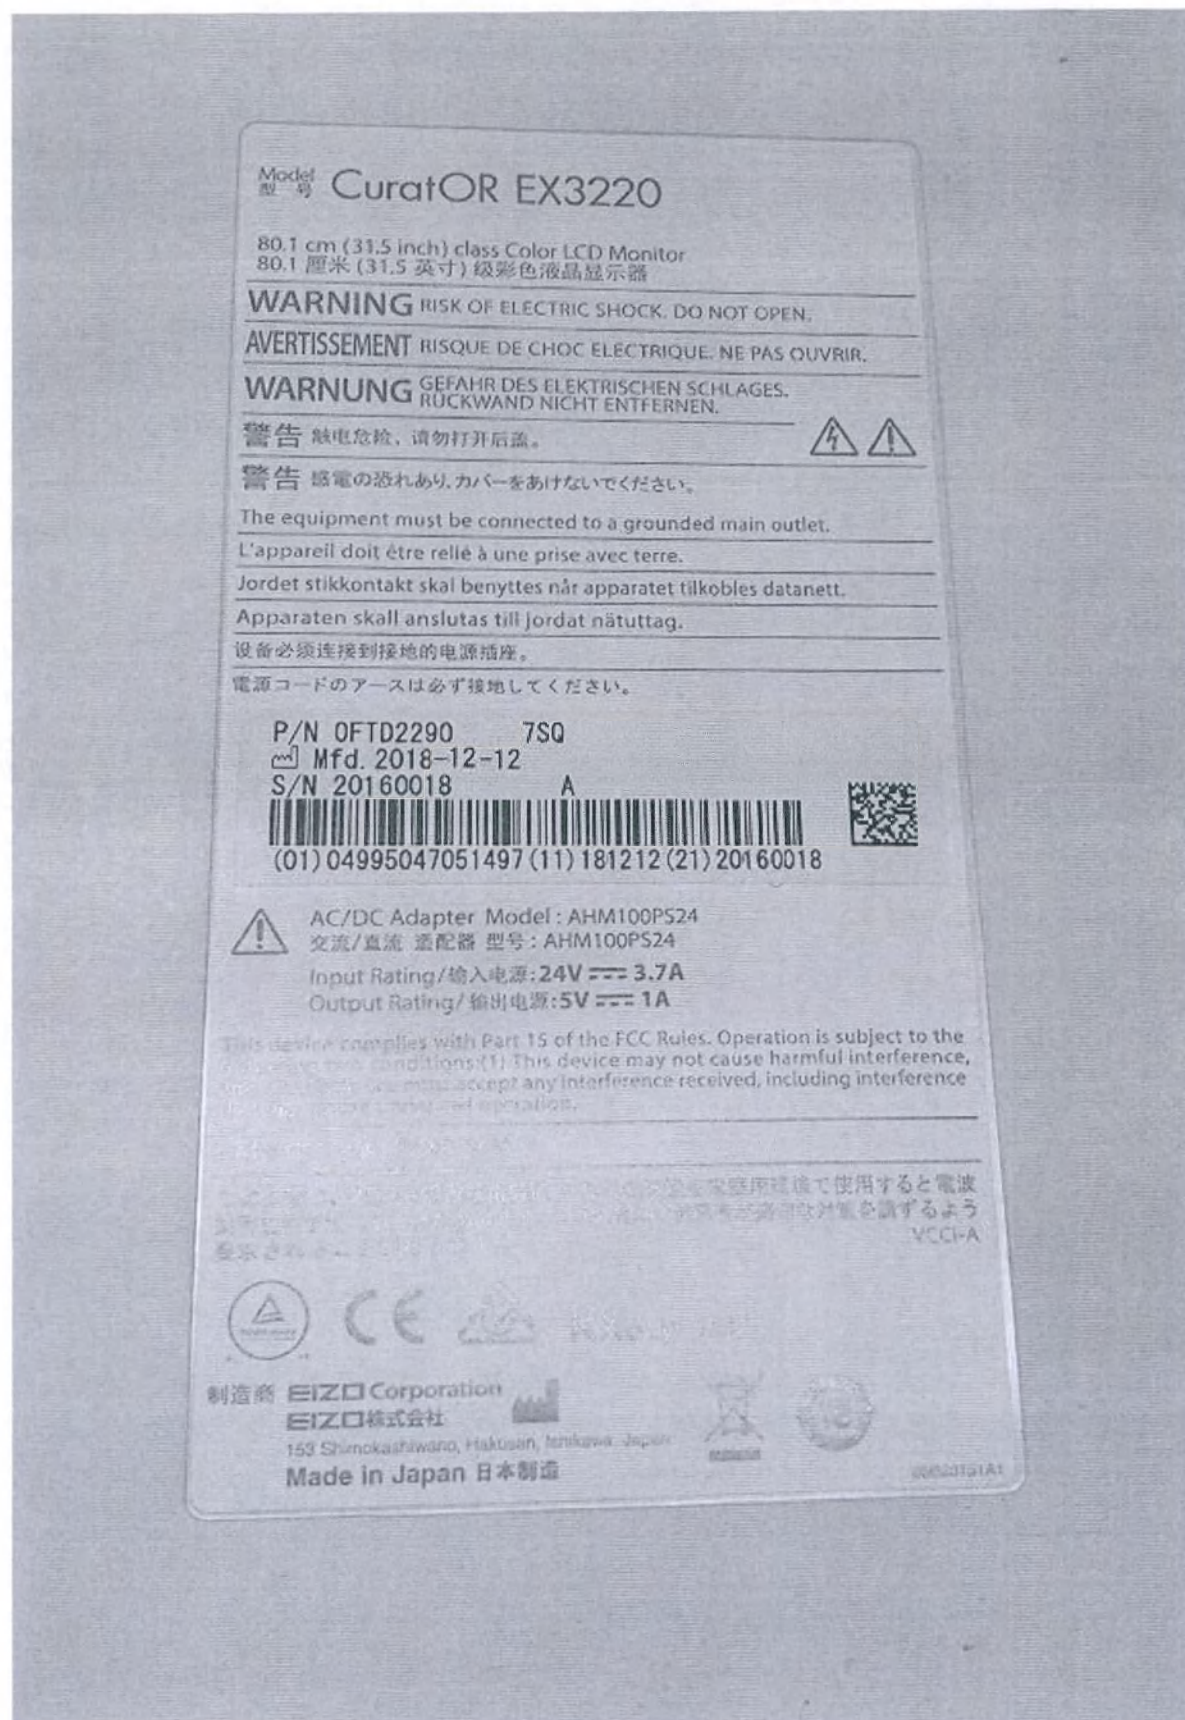

Монитор 3D, 32 дюйма.

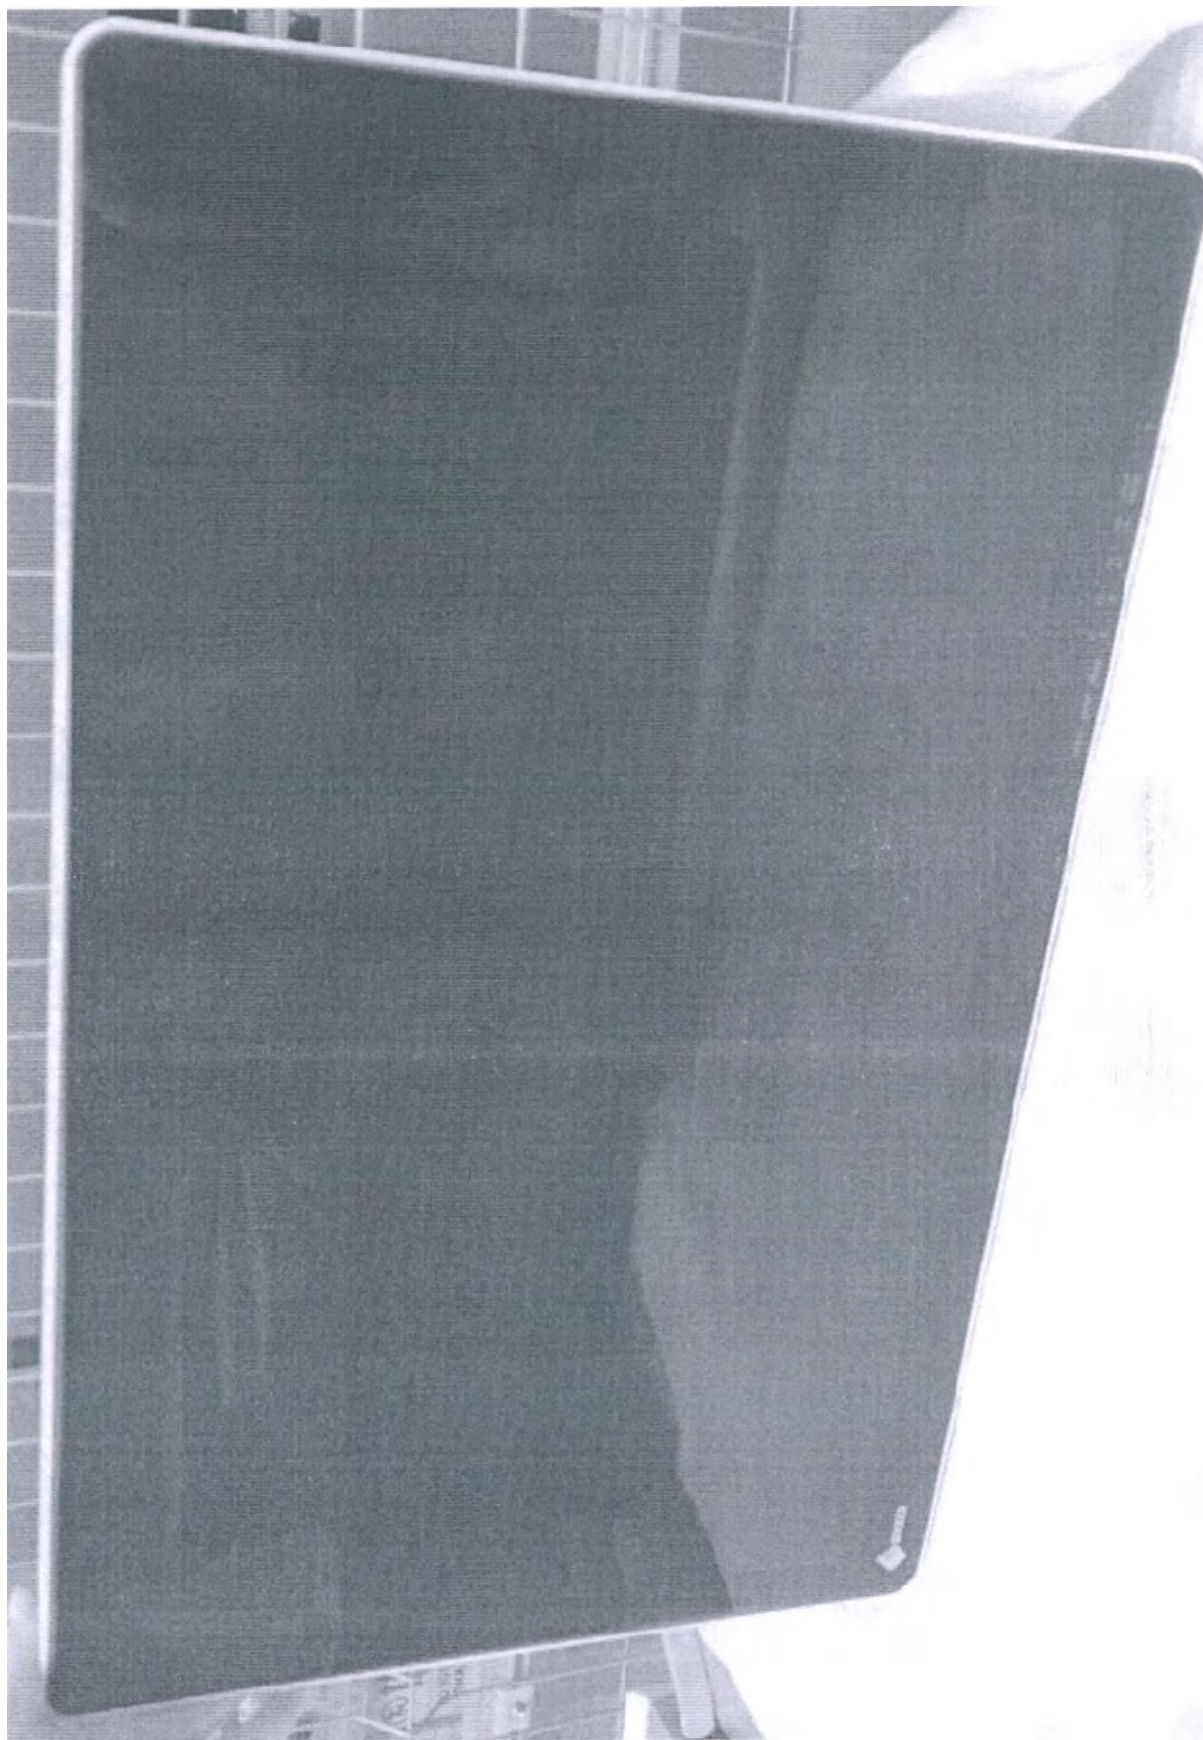


Общий вид изделия




Маркировка на изделии

Монитор 2D, 32 дюйма, 4К

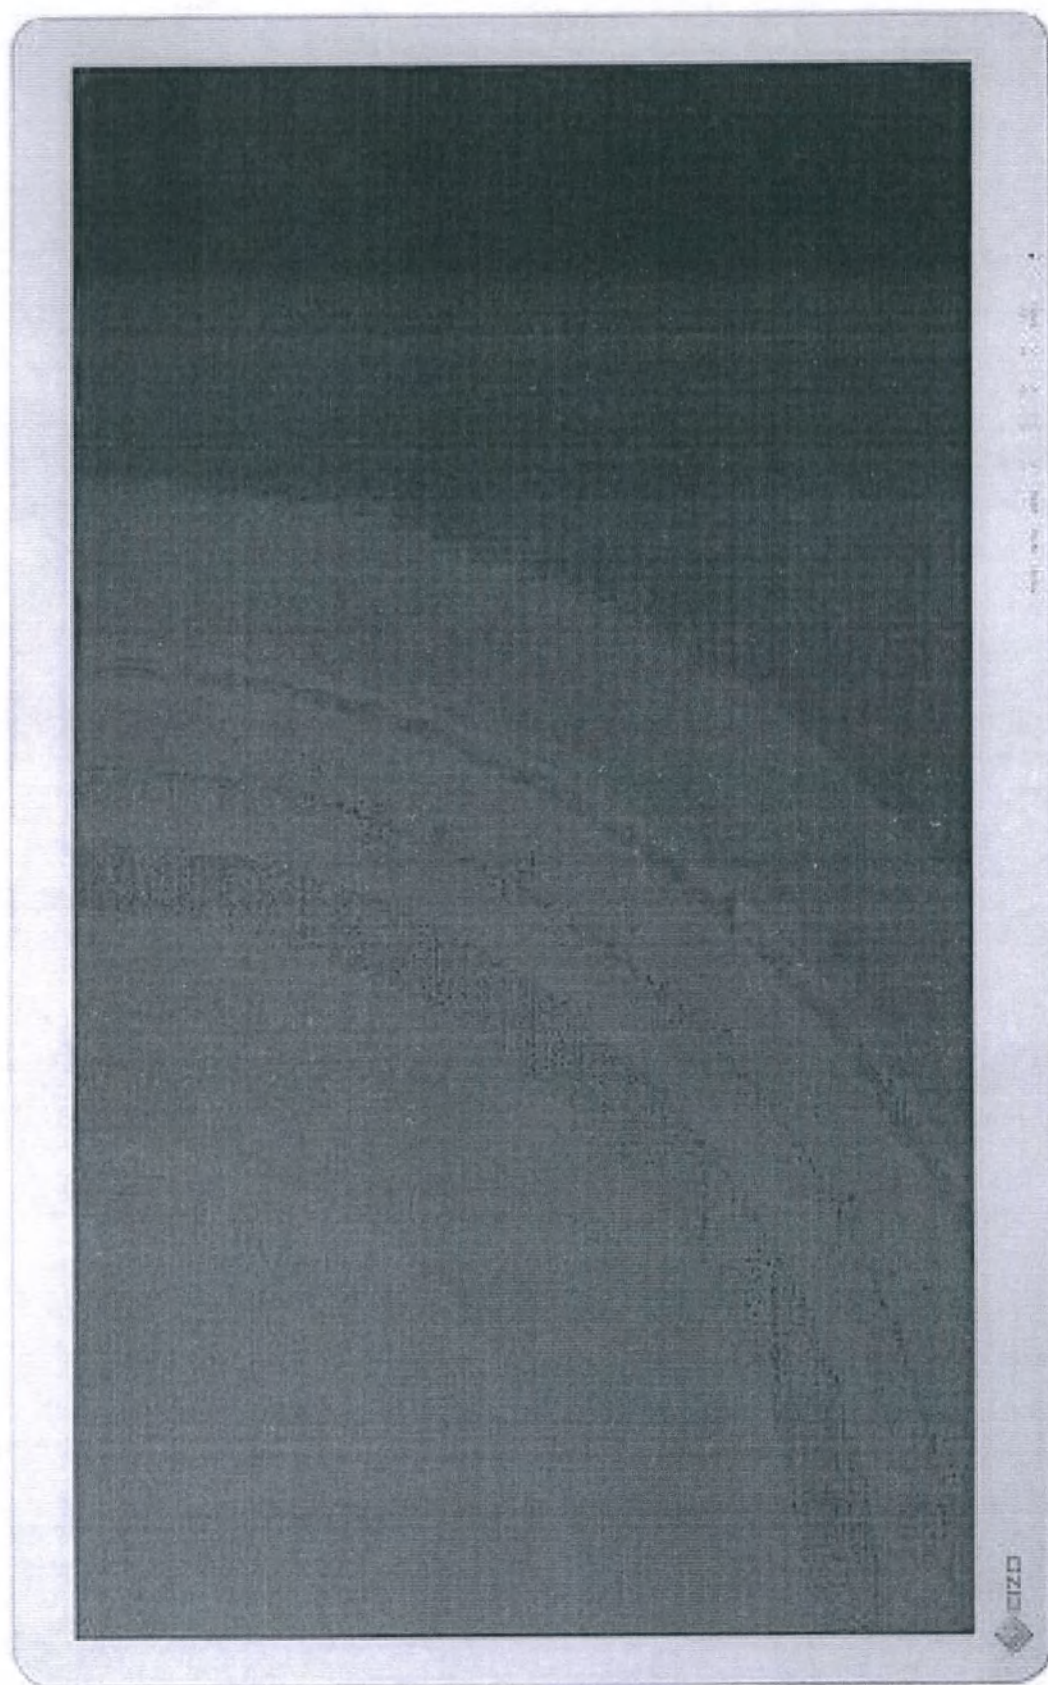


Общий вид изделия

Монитор 2D, 32 дюйма, 4K

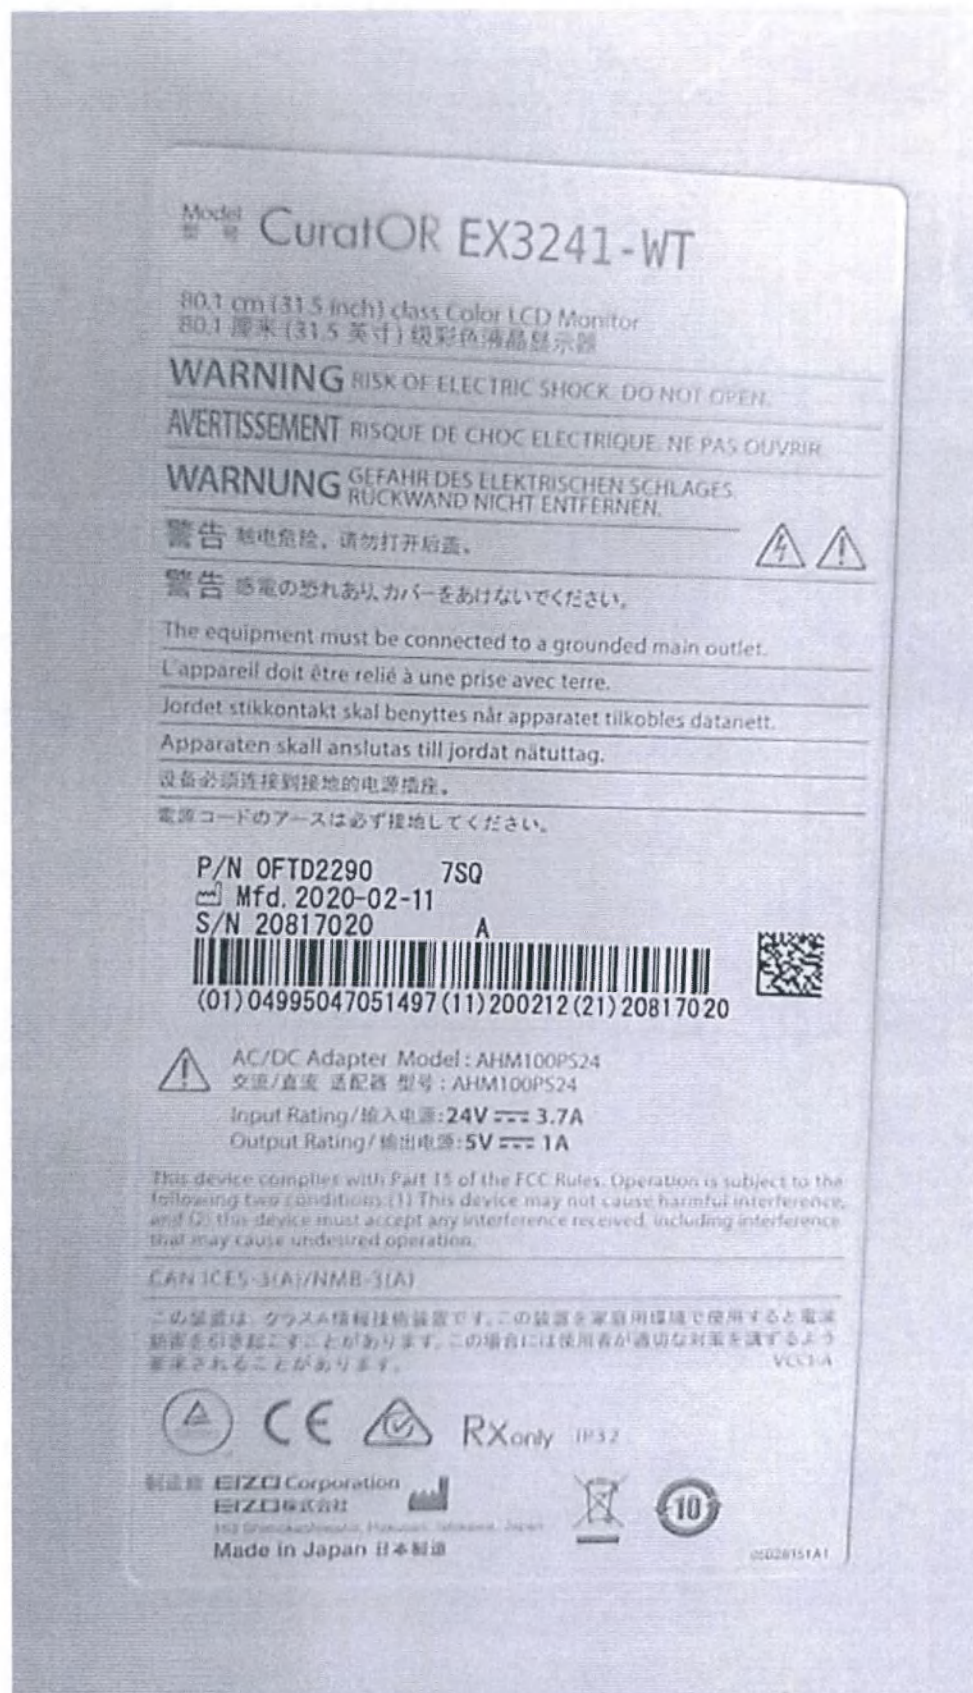


Маркировка изделия

Рекордер TEAC

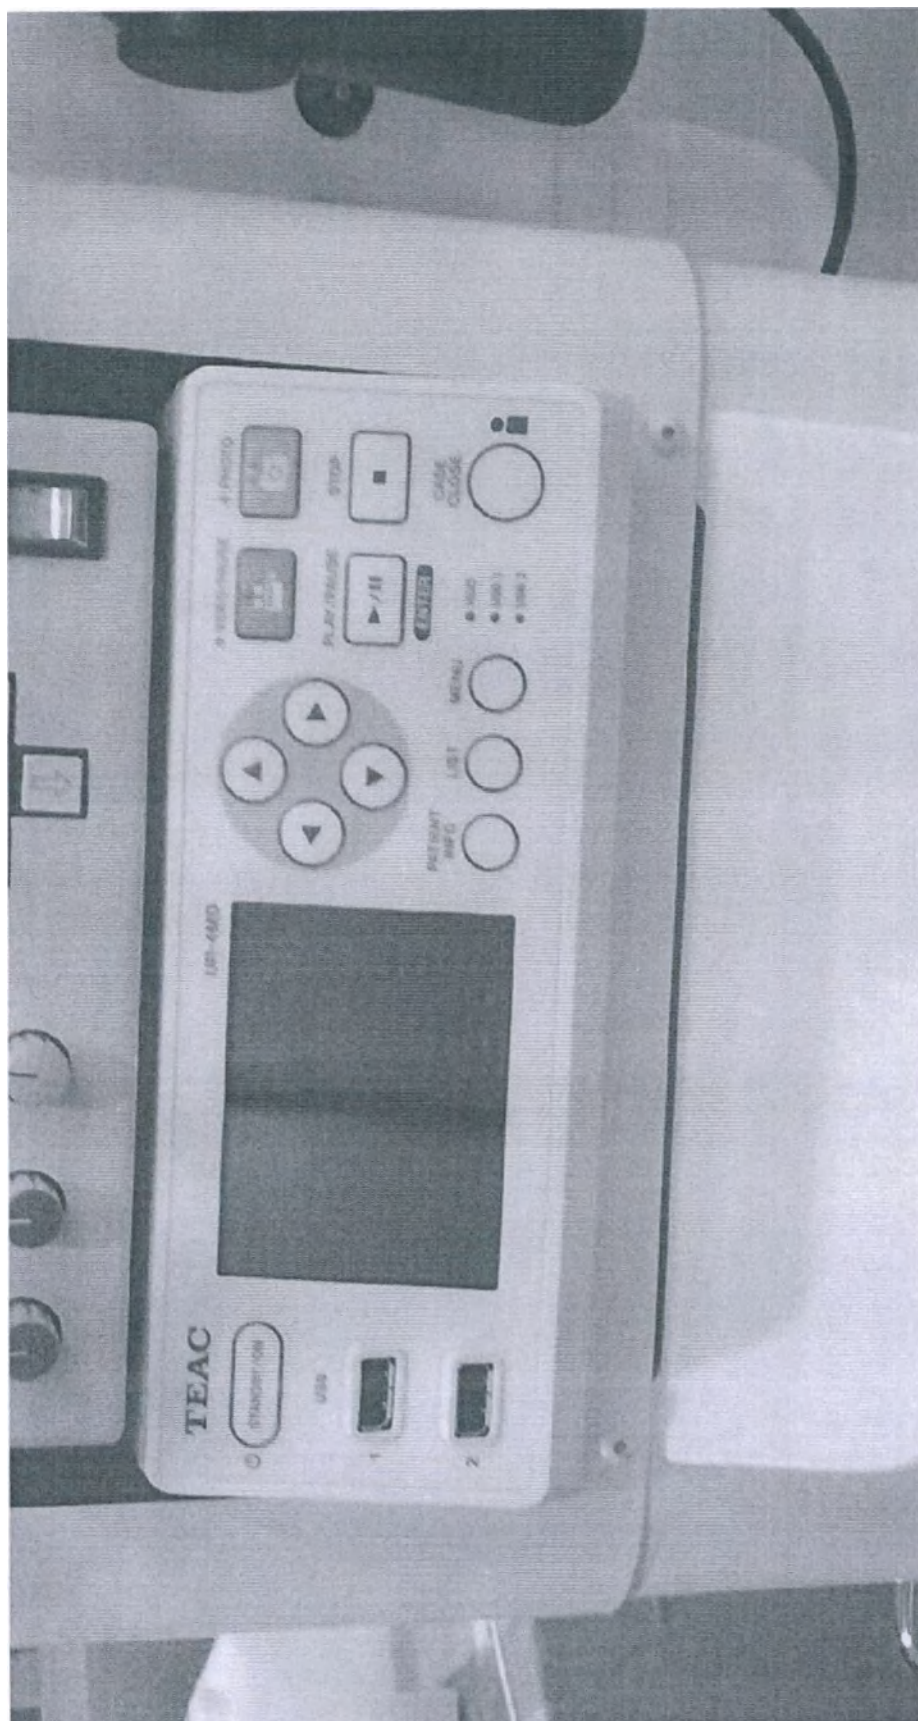


Общий вид изделия (предустановлен в штатив микроскопа)

Защитное покрытие

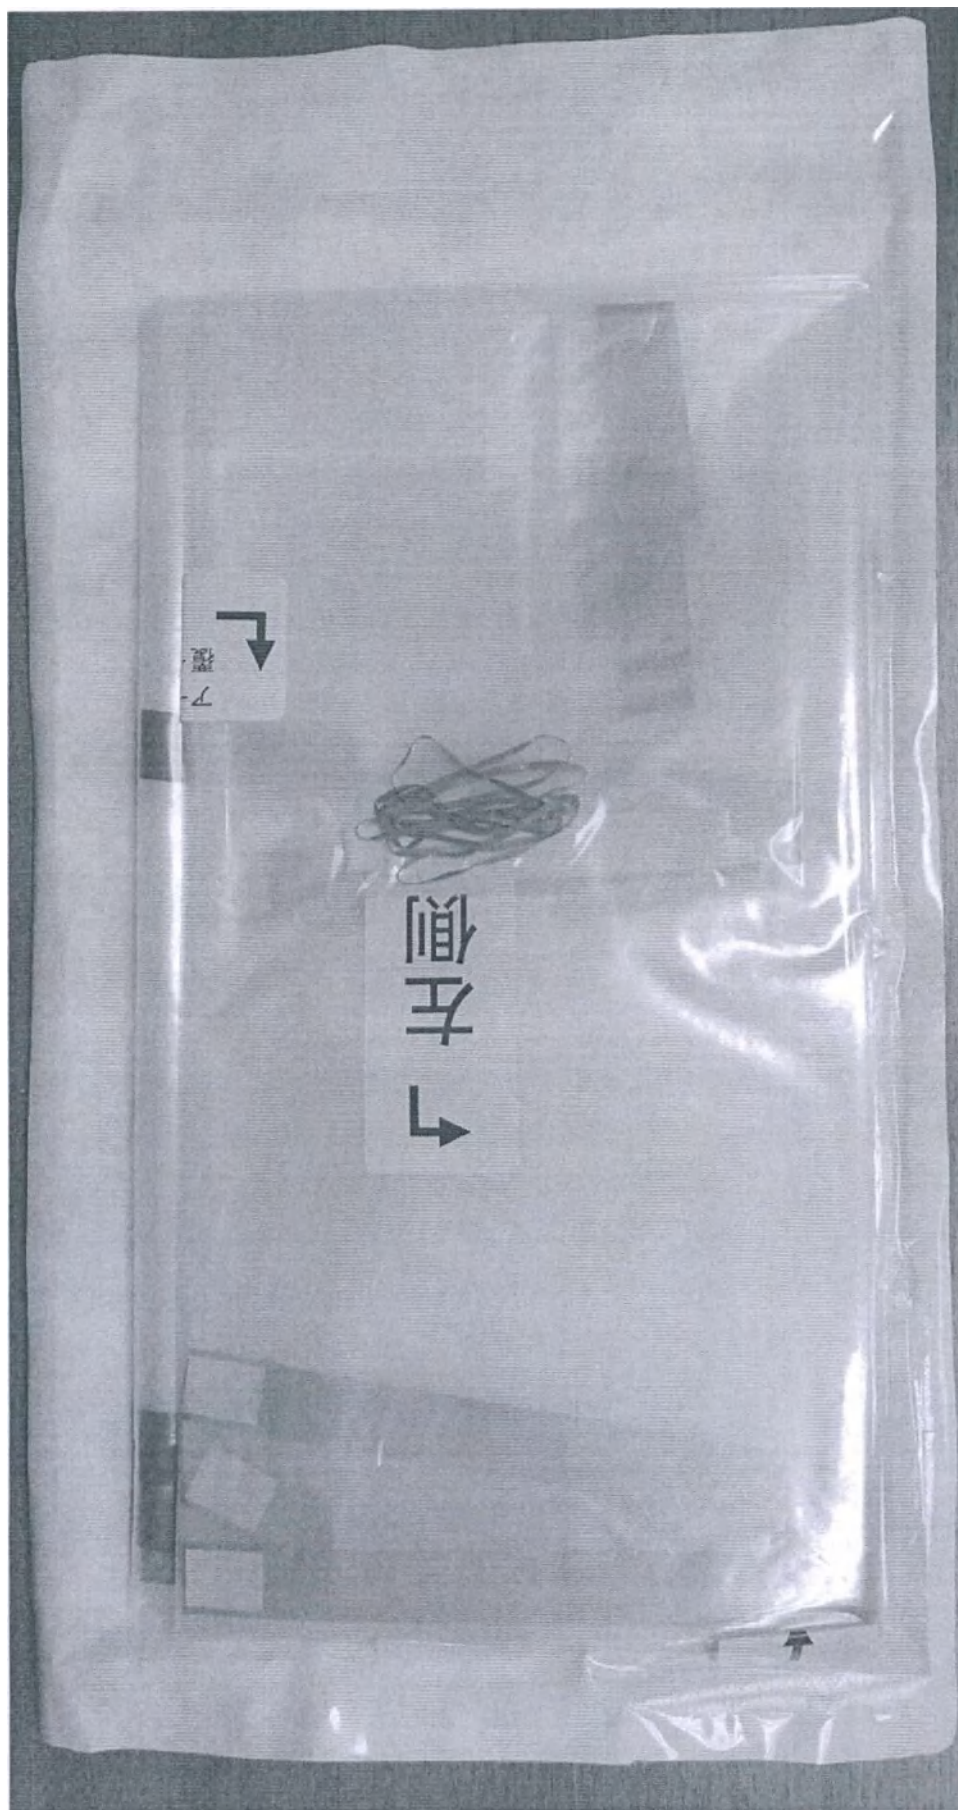


Изделие в стерильной упаковке

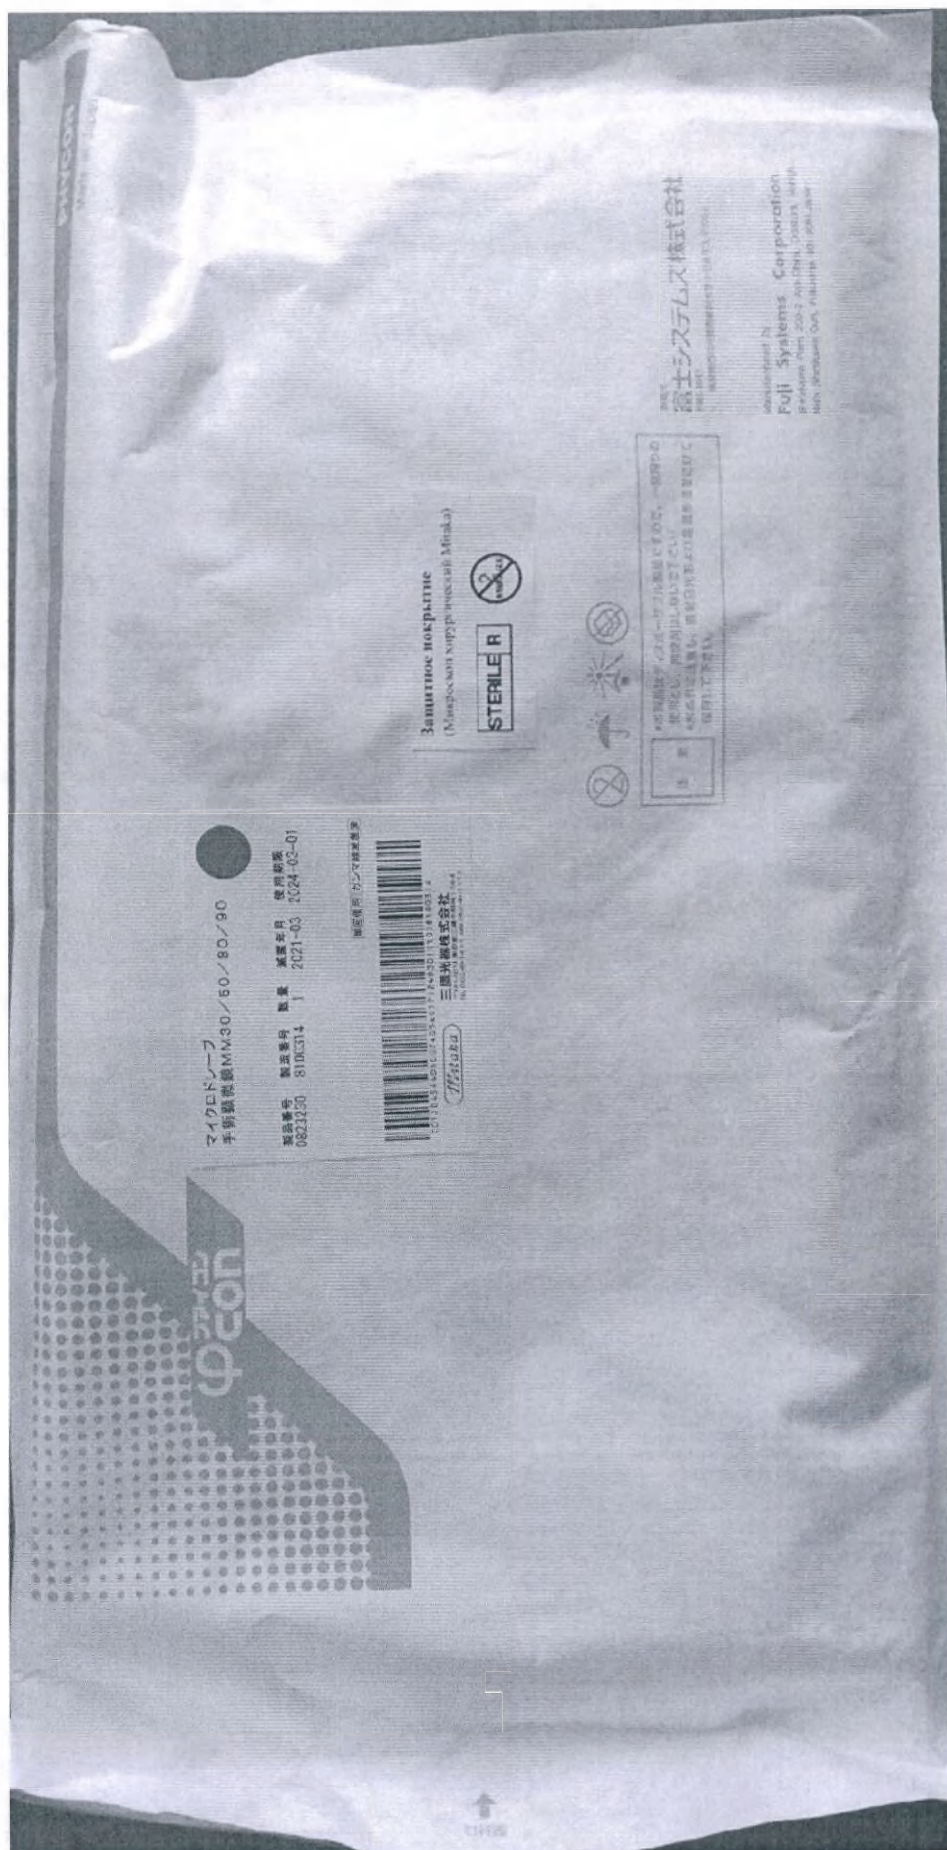


Маркировка на стерильном пакете

Хирургический микроскоп MM51/YOH

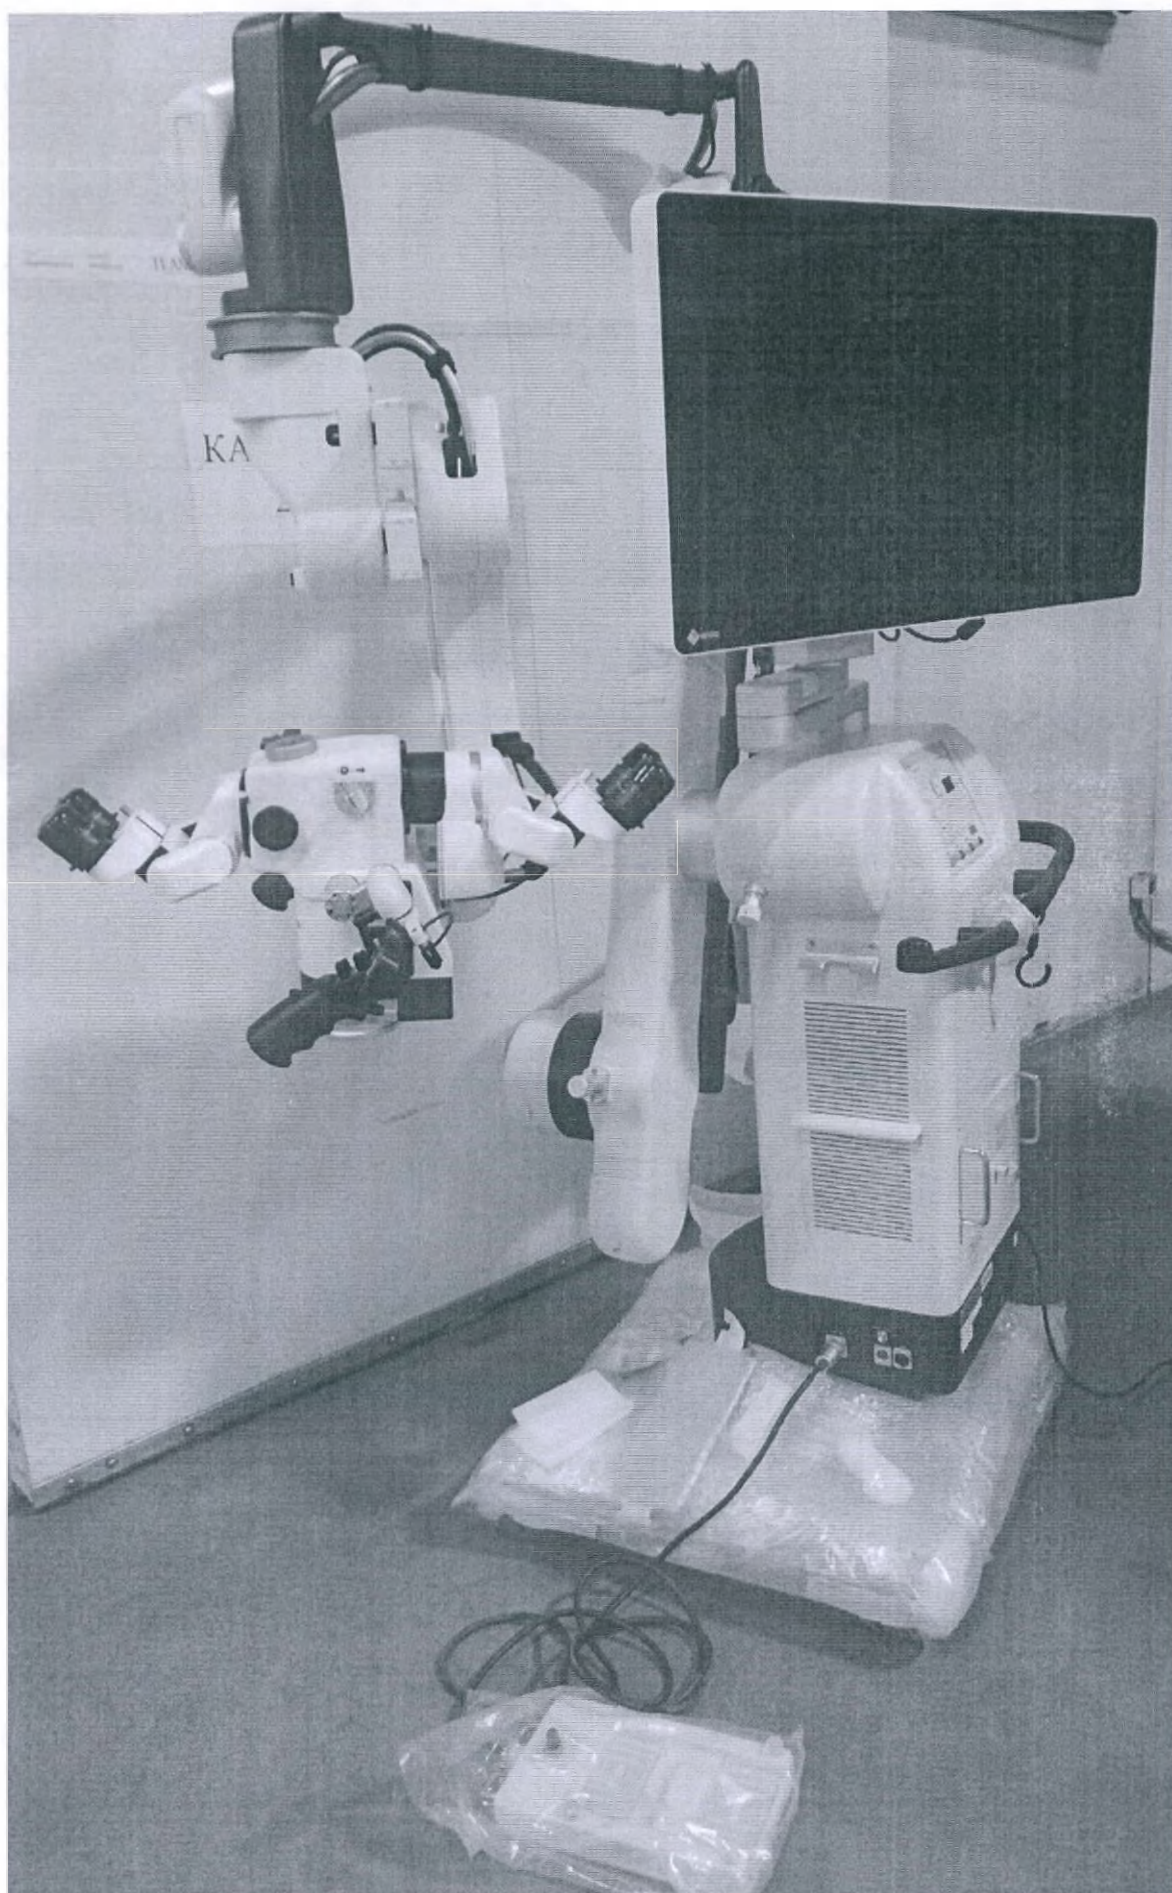


Общий вид изделия в сборке

Хирургический микроскоп MM51/YOH

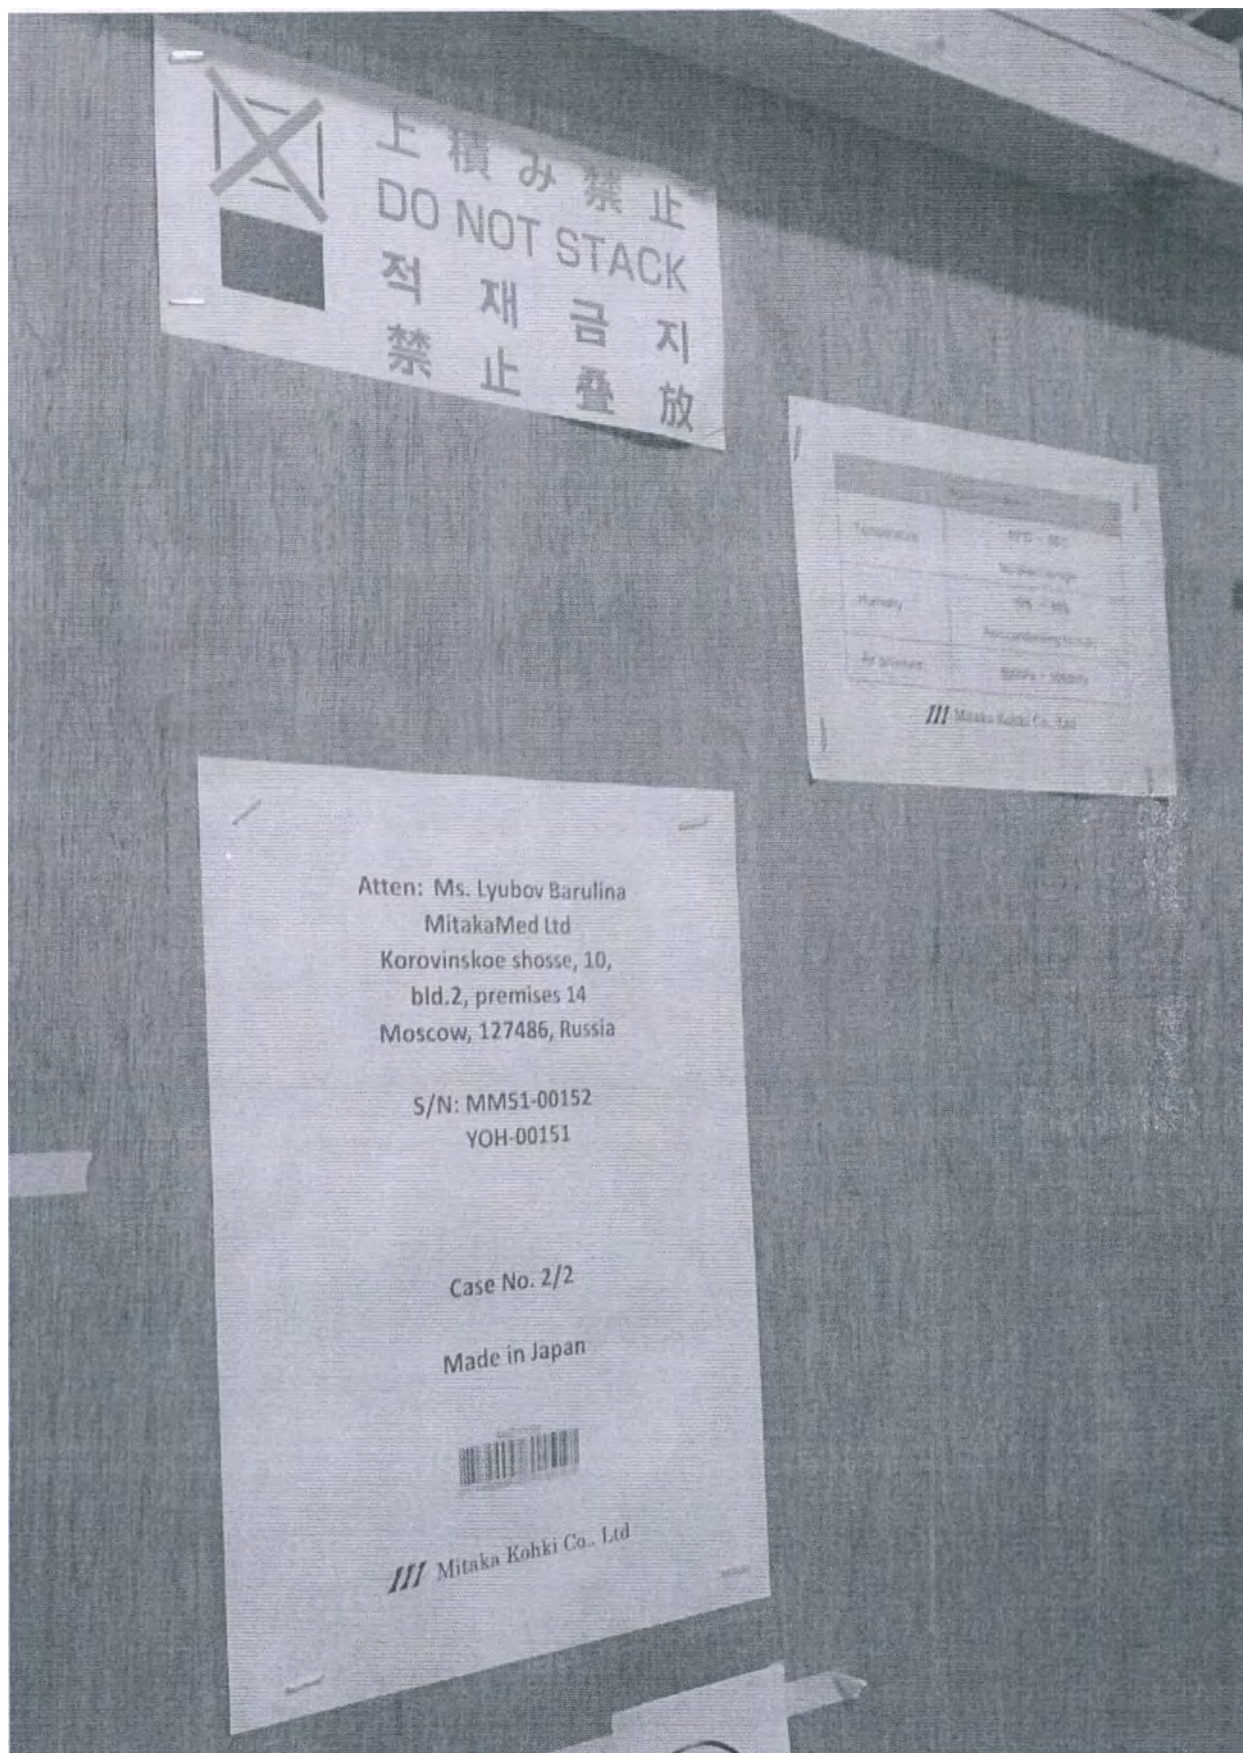


Маркировка на транспортной упаковке

Хирургический микроскоп MM51/YOH

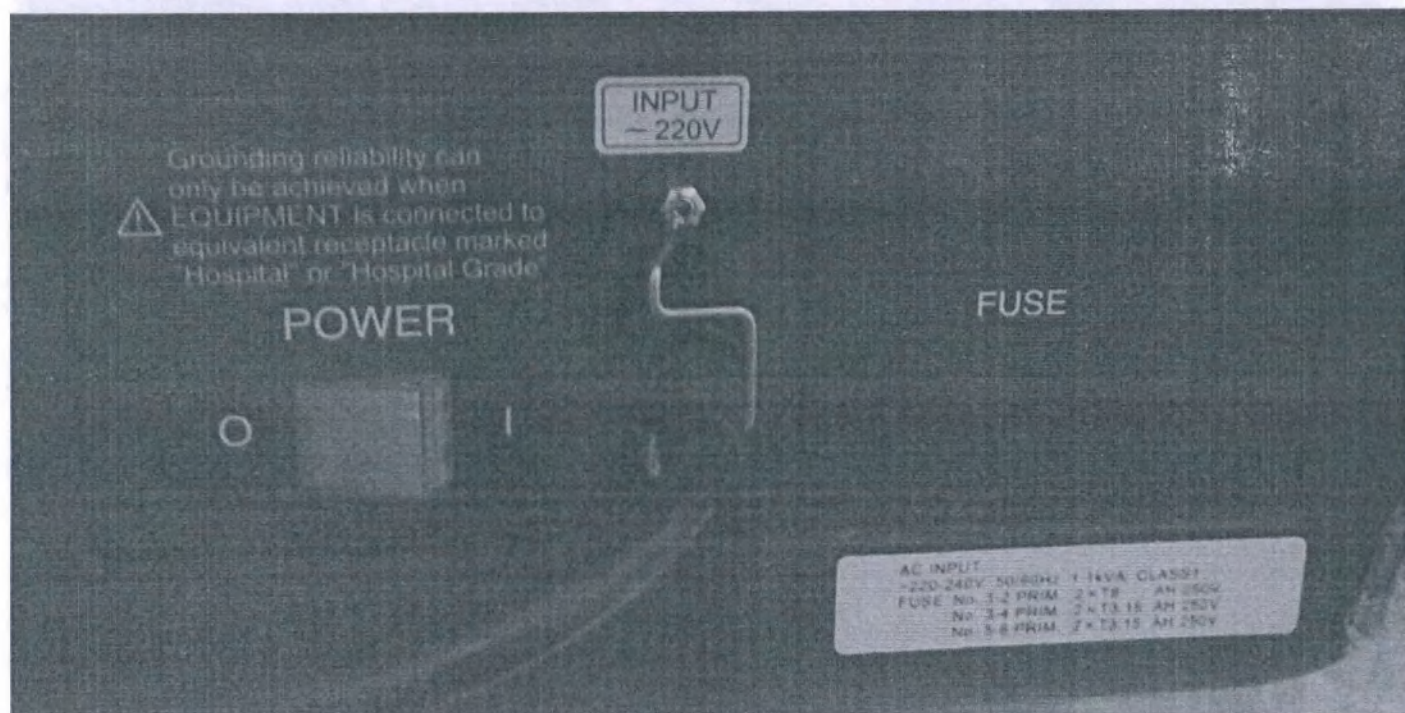


Маркировка на изделии

Микроскоп ММ51

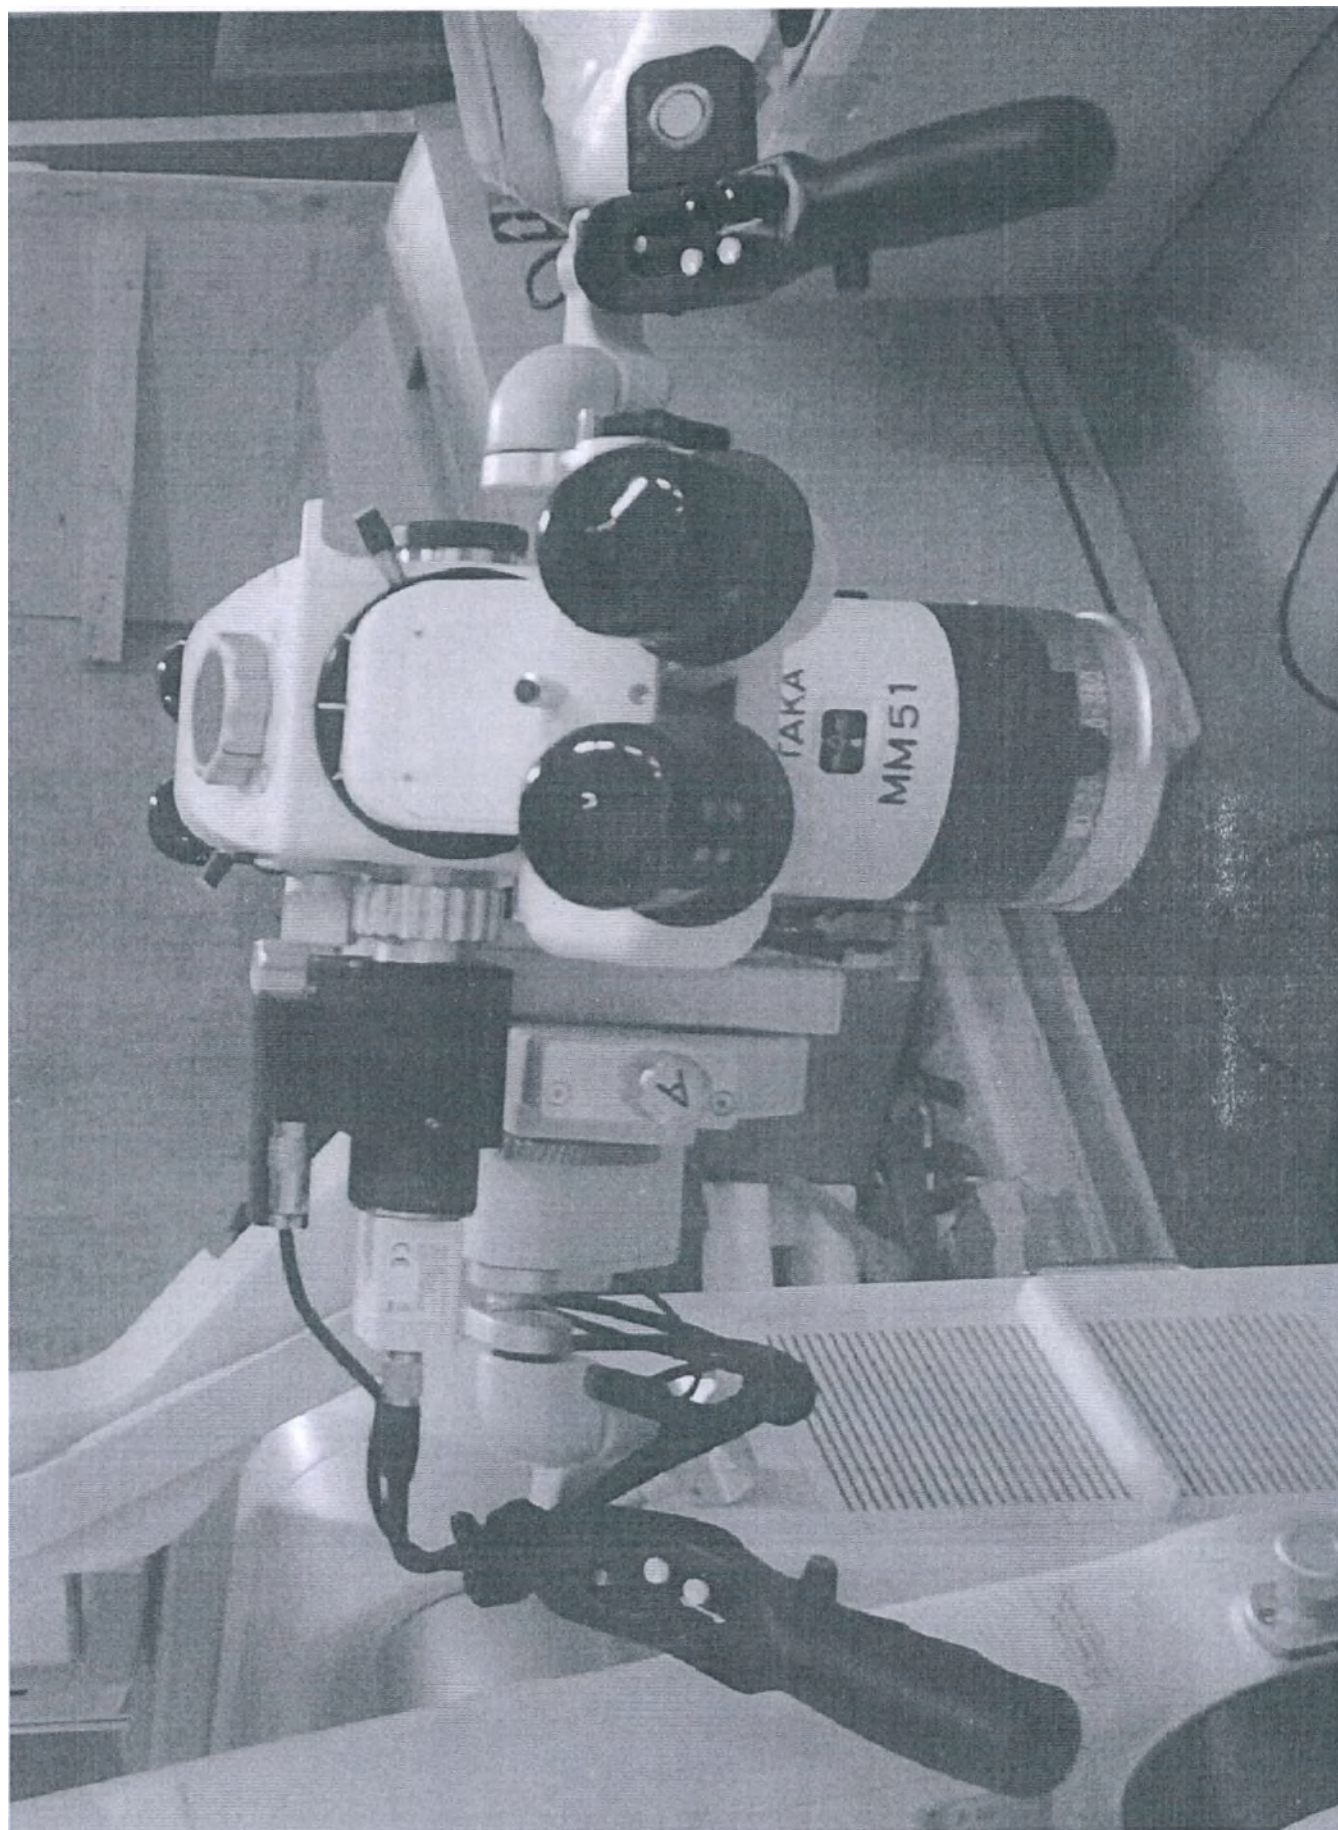


Общий вид изделия

Тубус с окулярами 10х

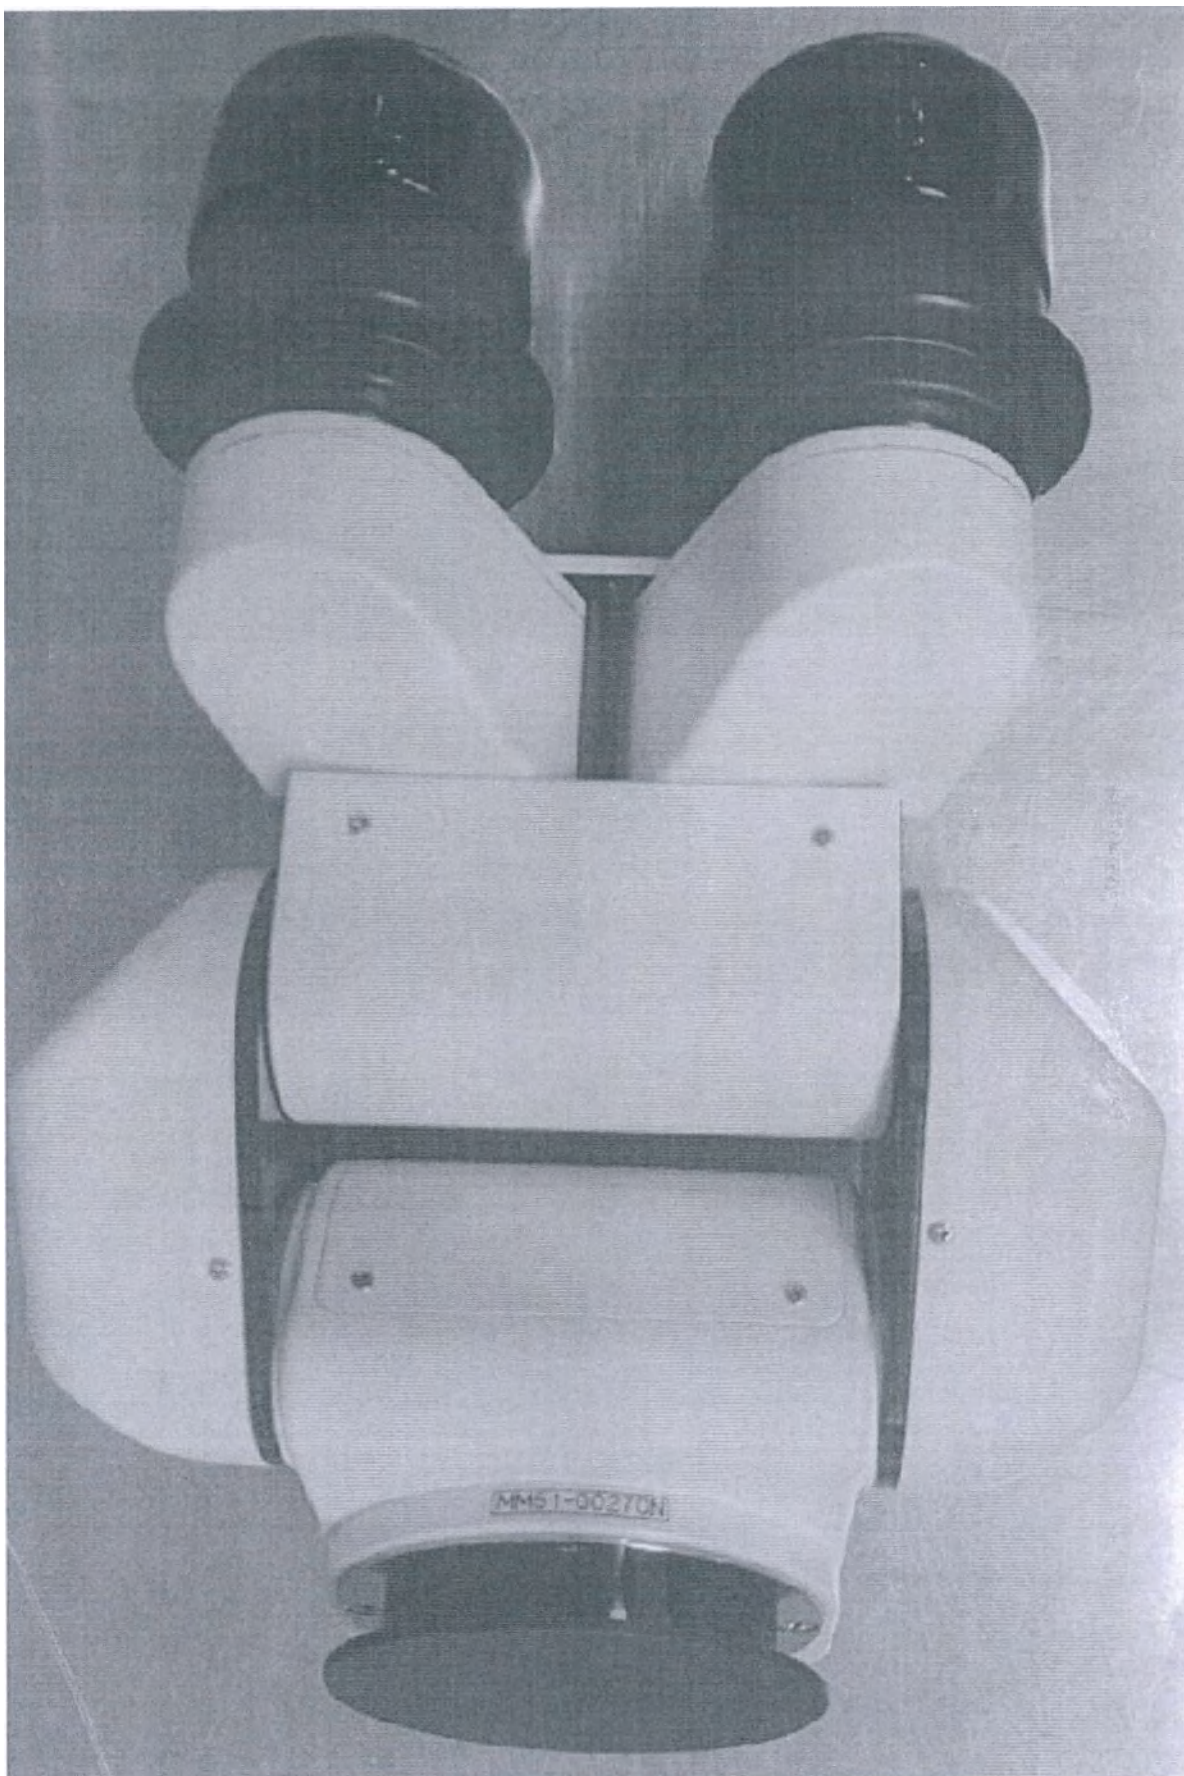


Общий вид изделия

Тубус с окулярами 8,3х

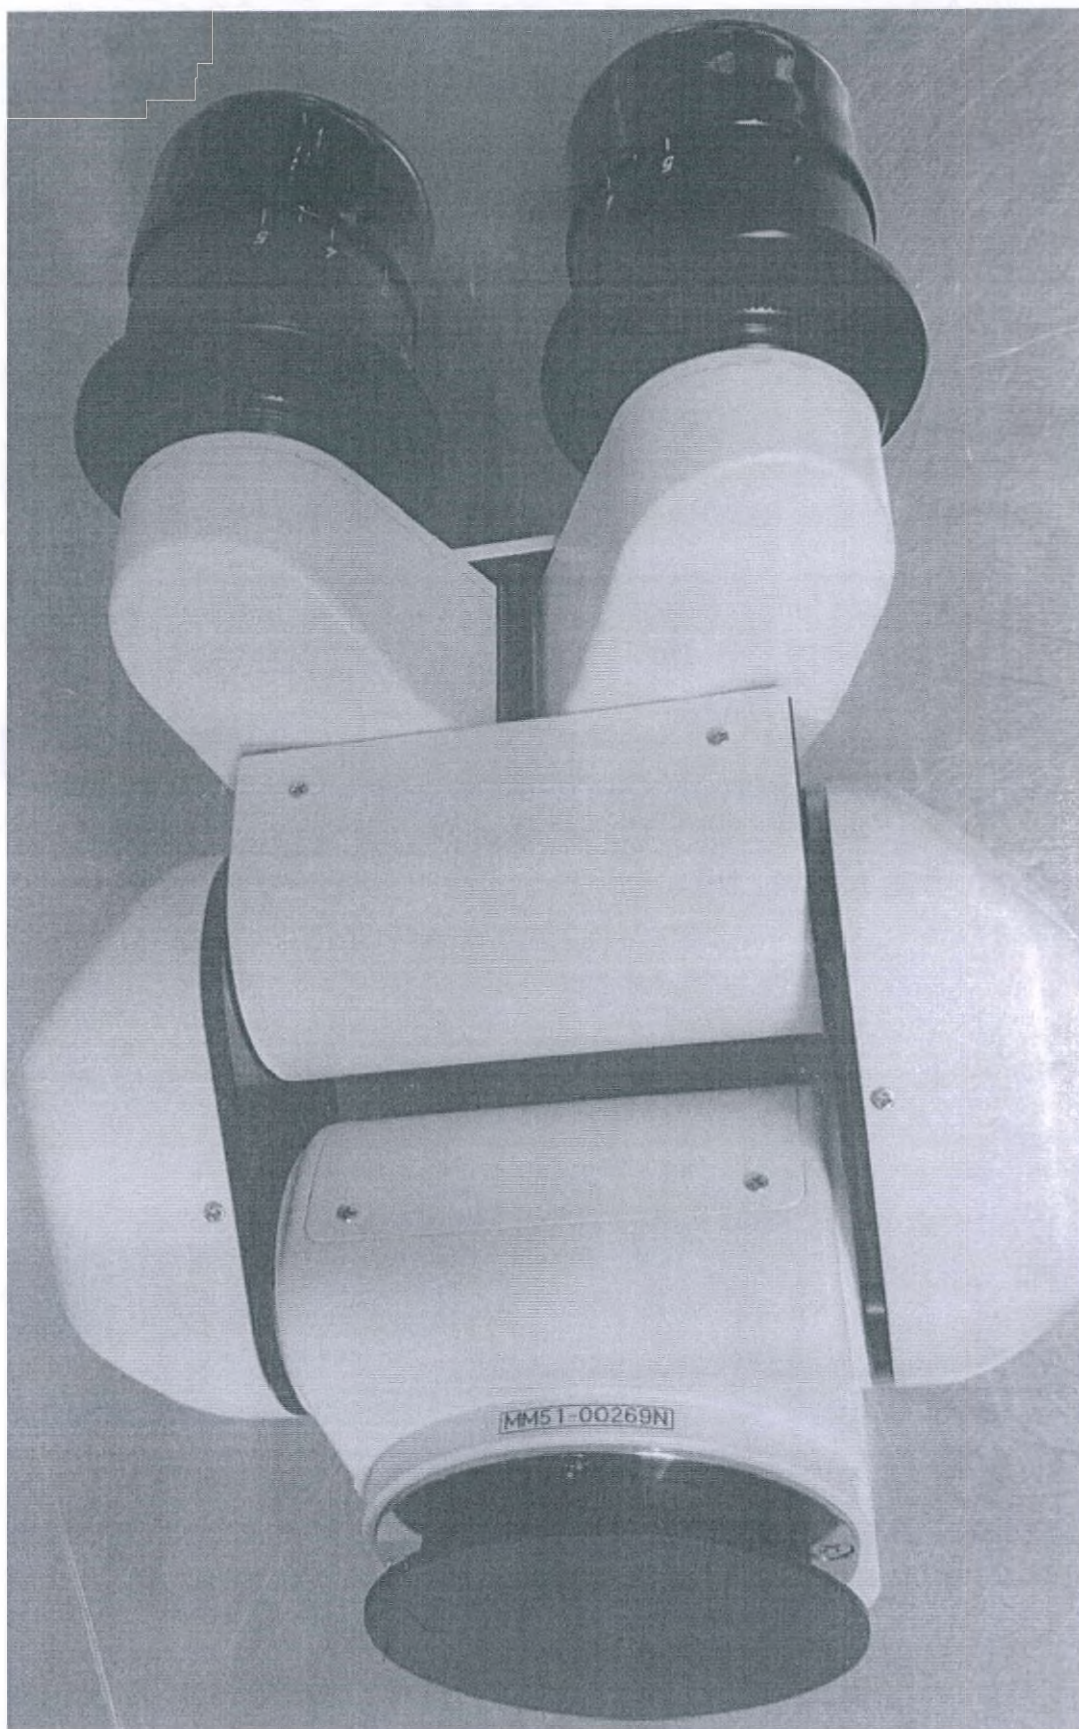


Общий вид изделия

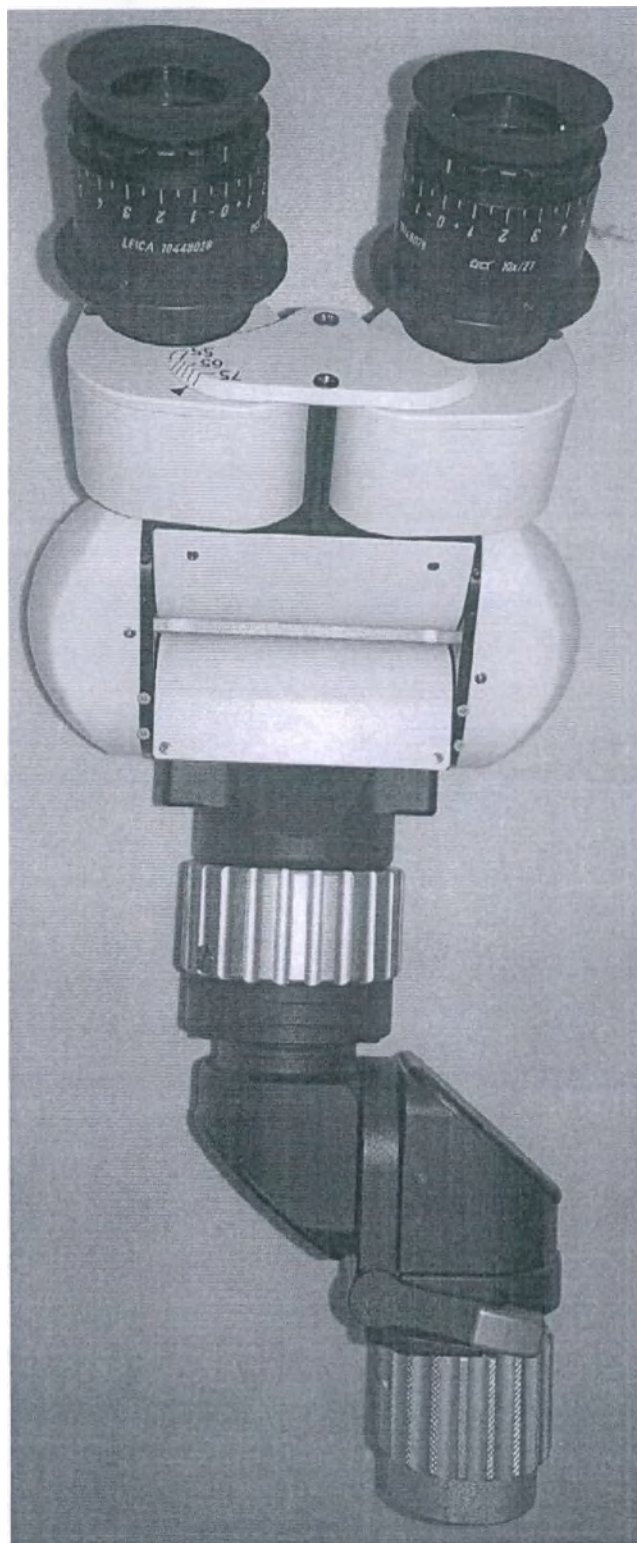

Общий вид изделия




Маркировка на изделии

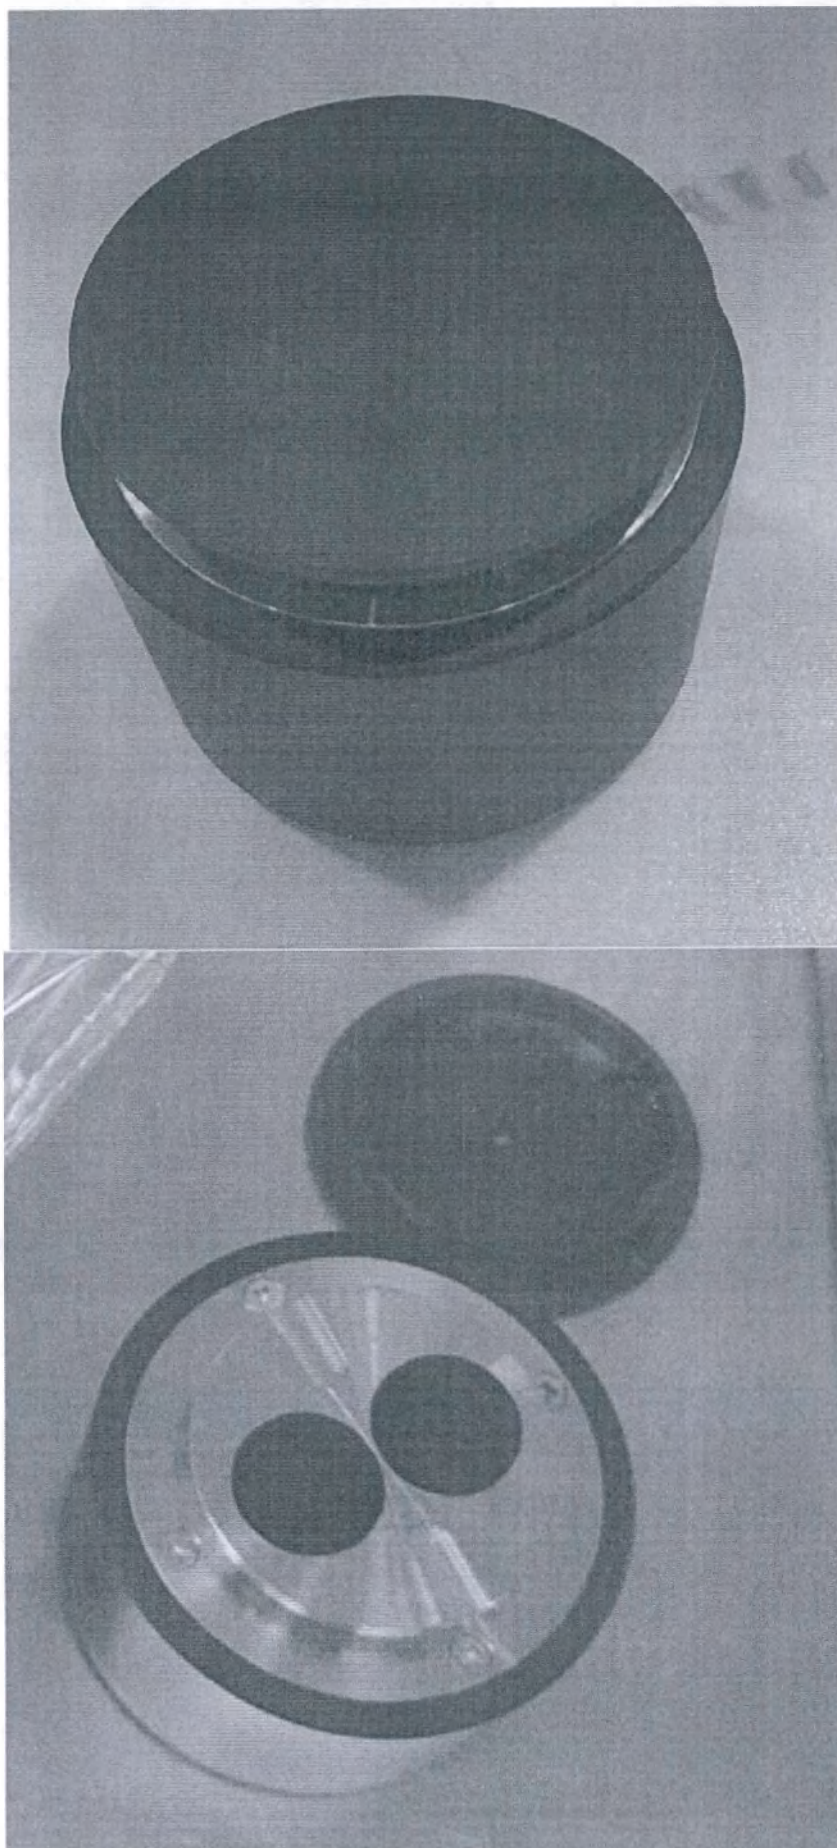


Общий вид изделия

Макролинза для объектива с фокусировкой 260 – 380 мм

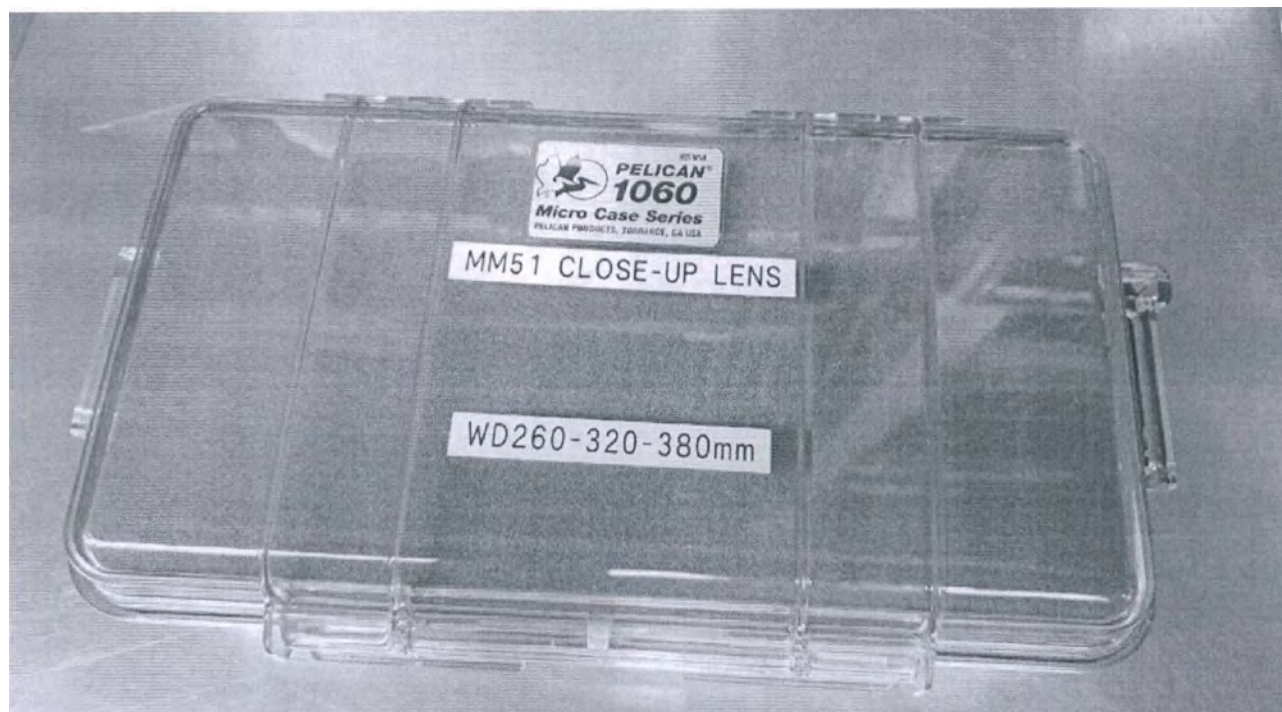


Упаковка

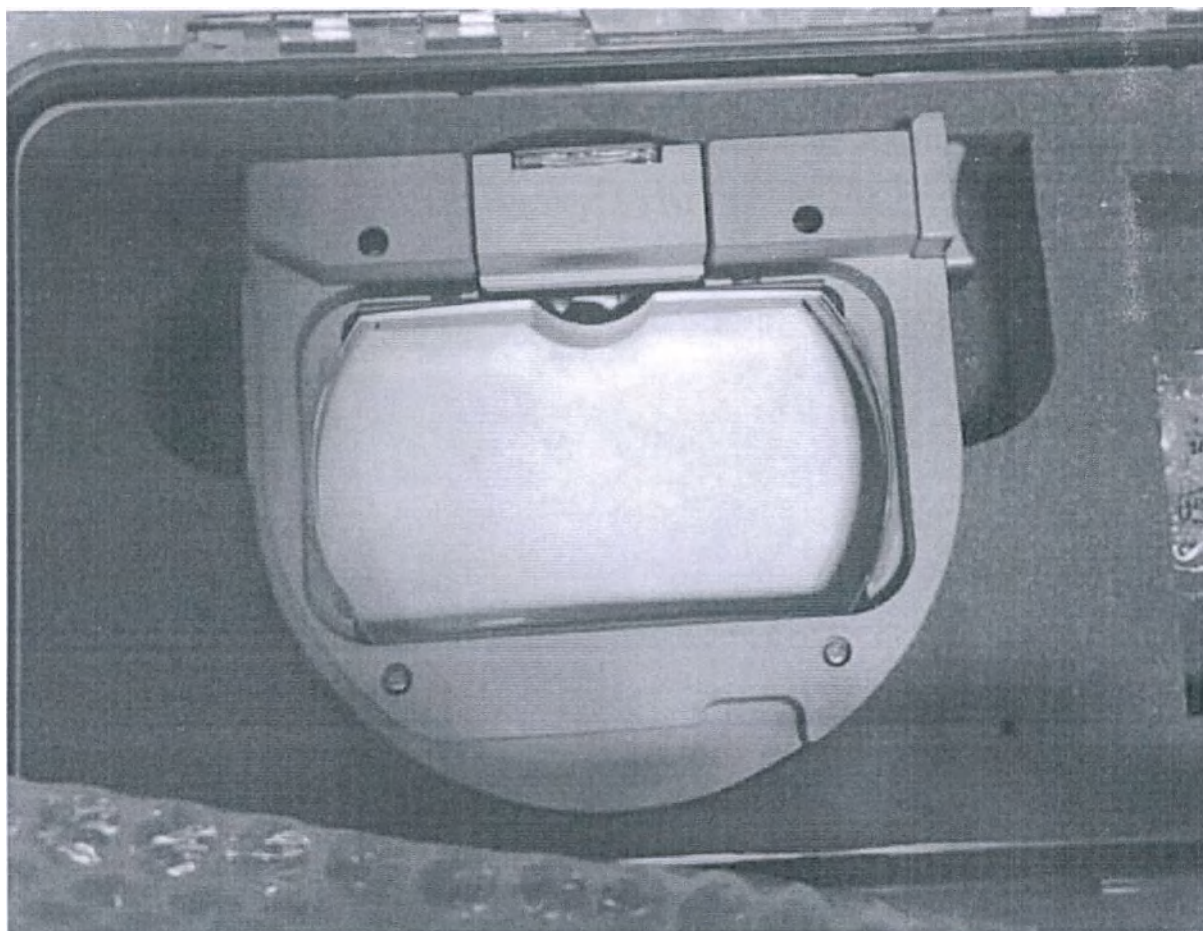


Общий вид изделия

Макролинза для объектива с фокусировкой 190 – 250 мм

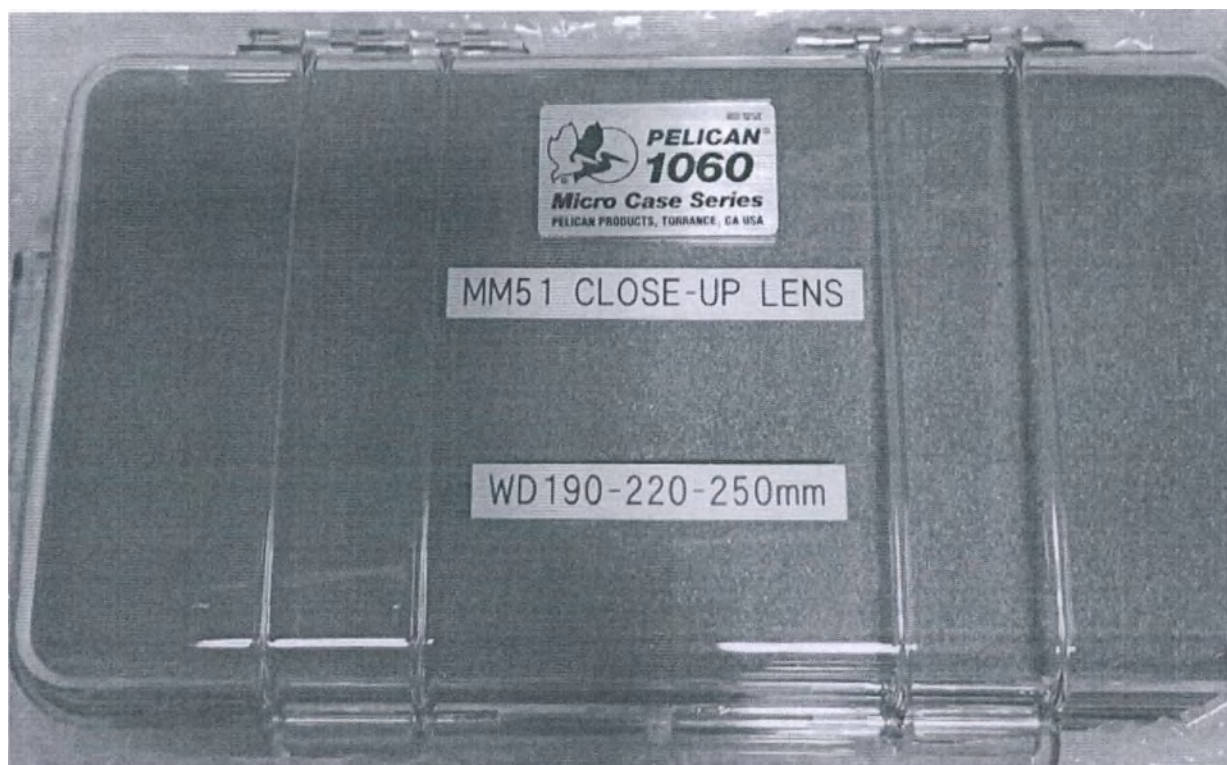


Упаковка

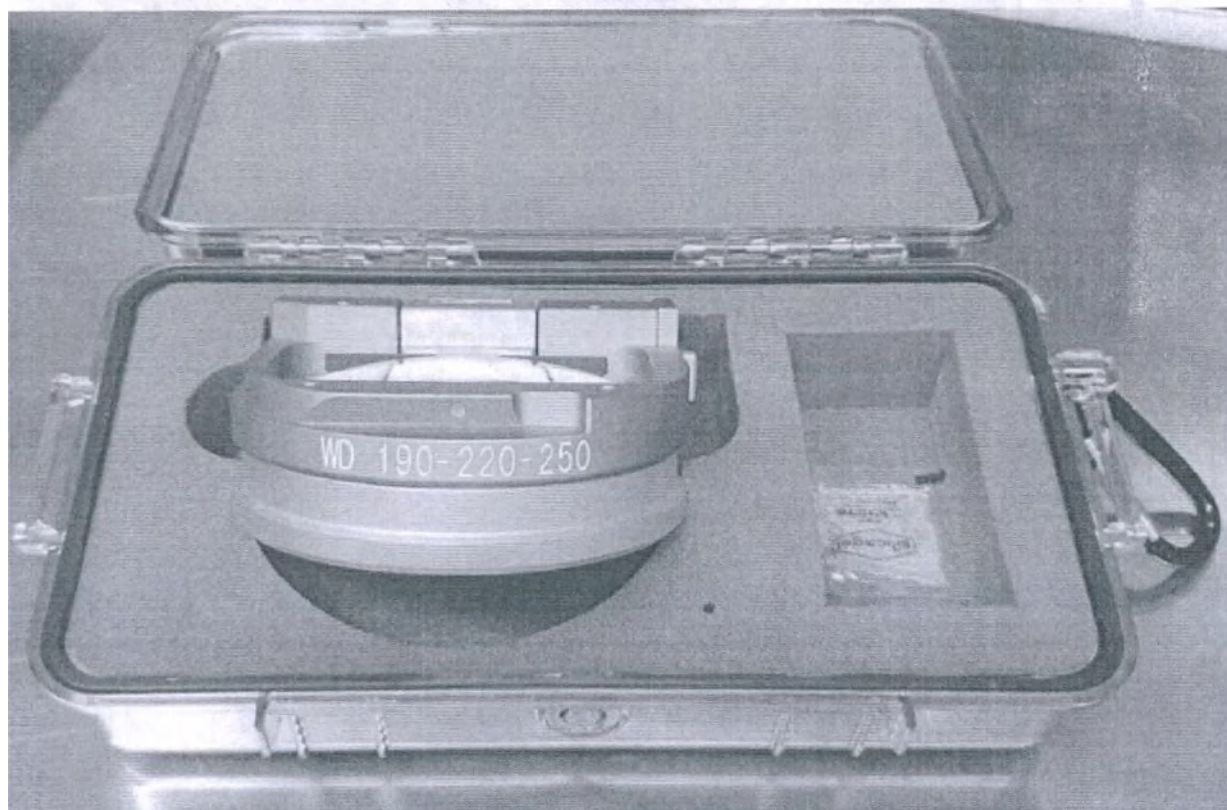


Общий вид изделия

Макролинза для объектива с фокусировкой 240 – 330 мм

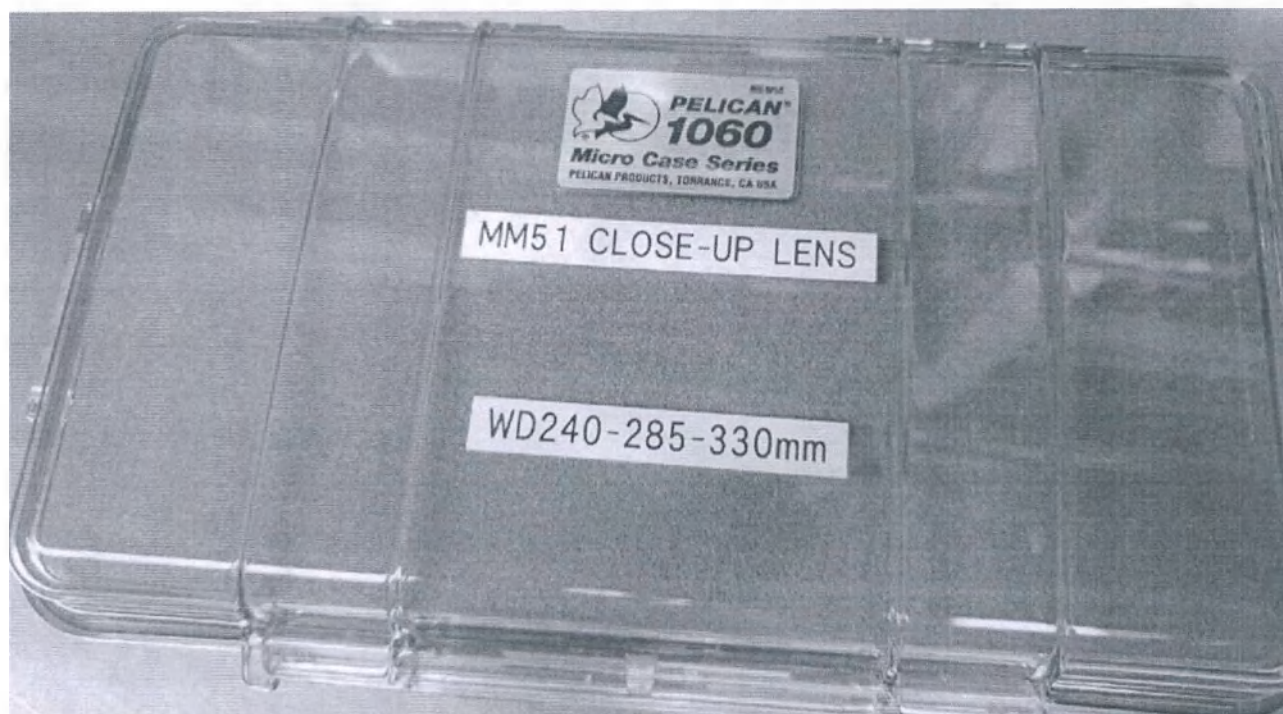


Упаковка

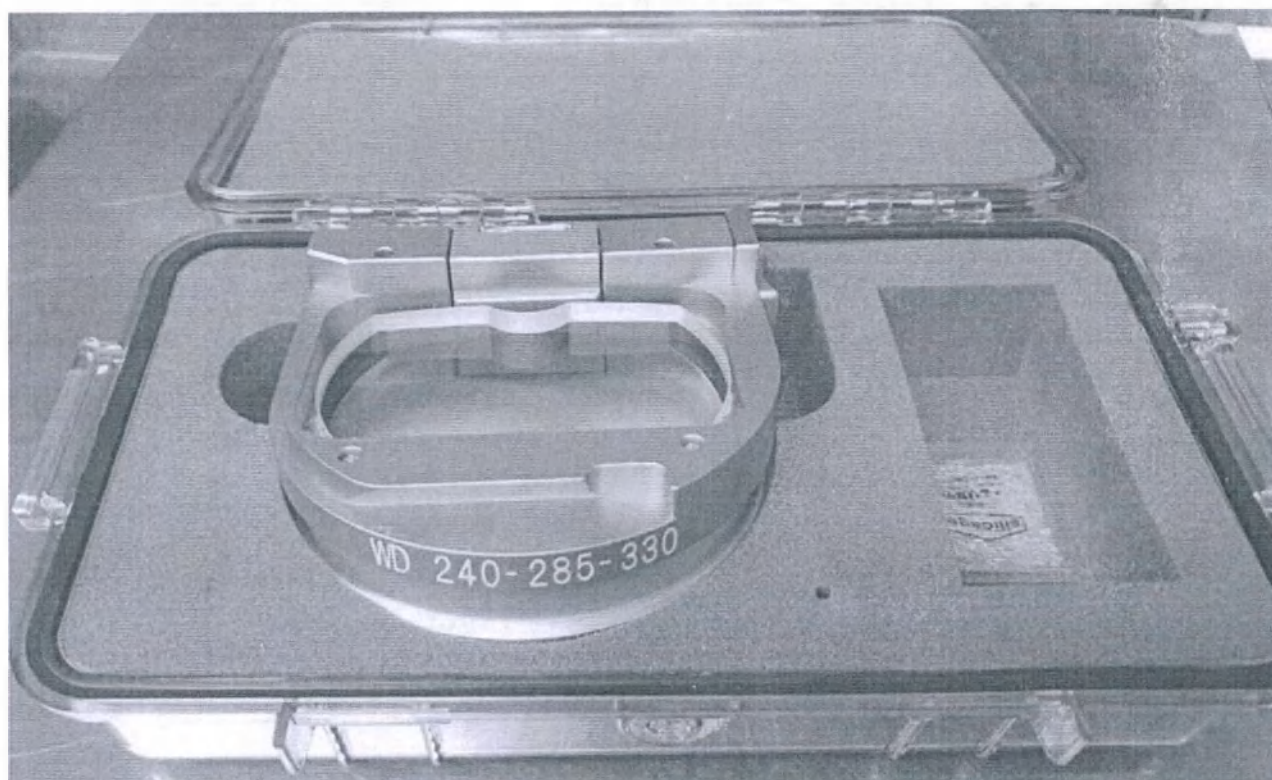


Общий вид изделия

Макролинза для объектива с фокусировкой 280 – 430 мм

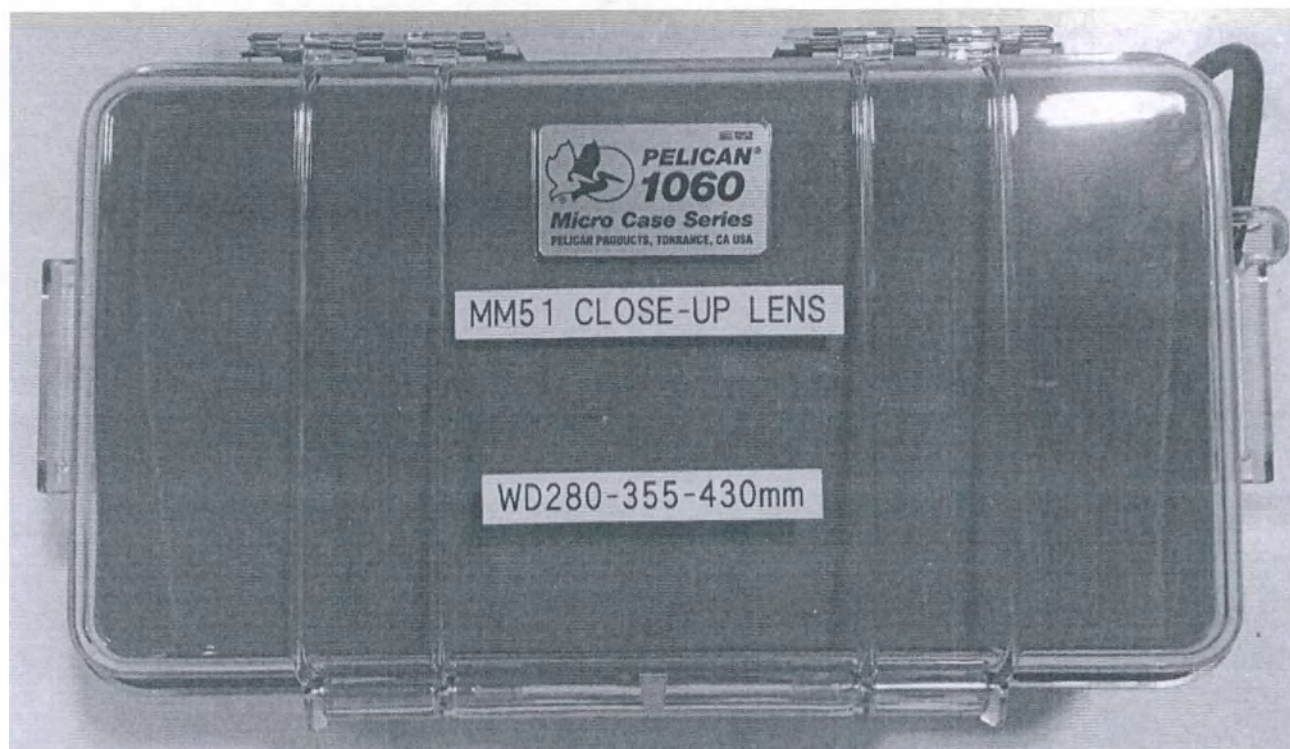


Упаковка

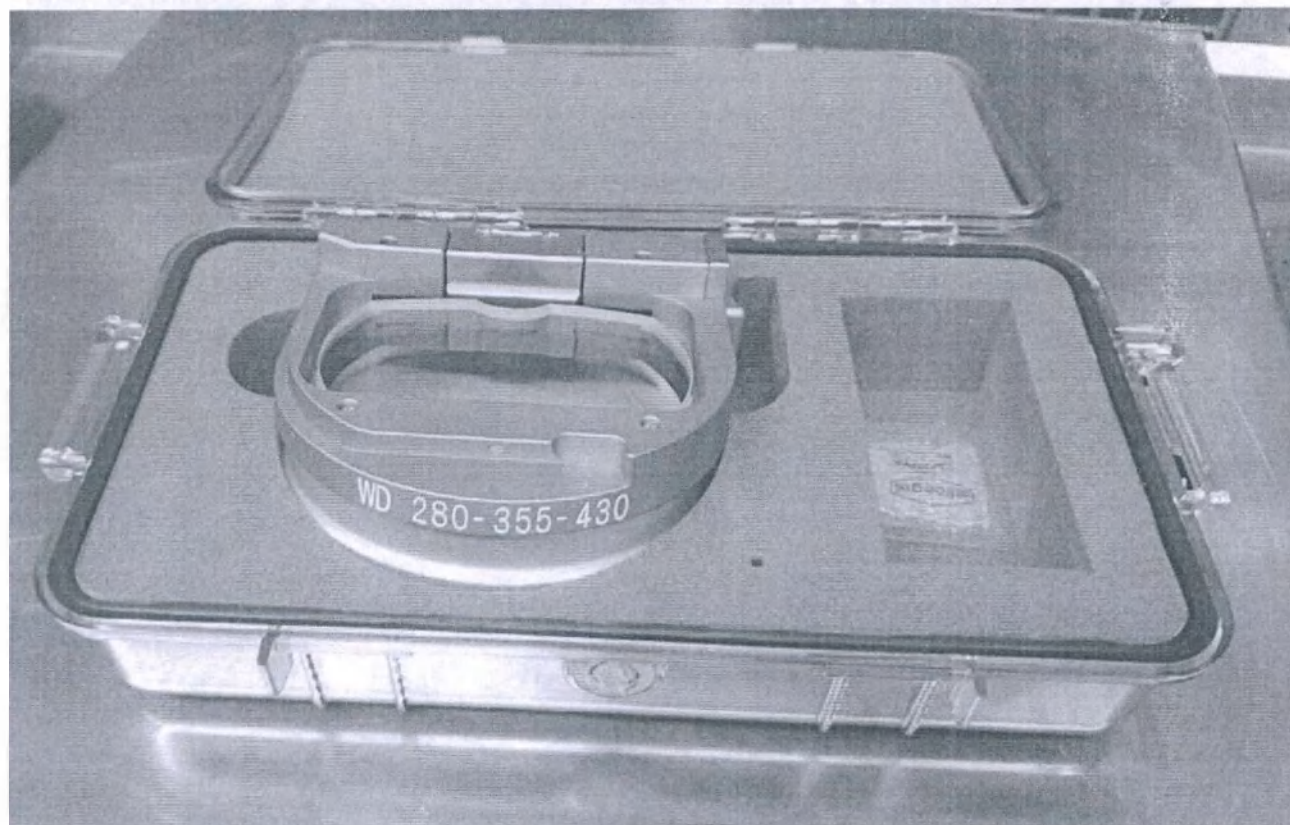


Общий вид изделия

Макролинза для объектива с фокусировкой 330 – 530 мм

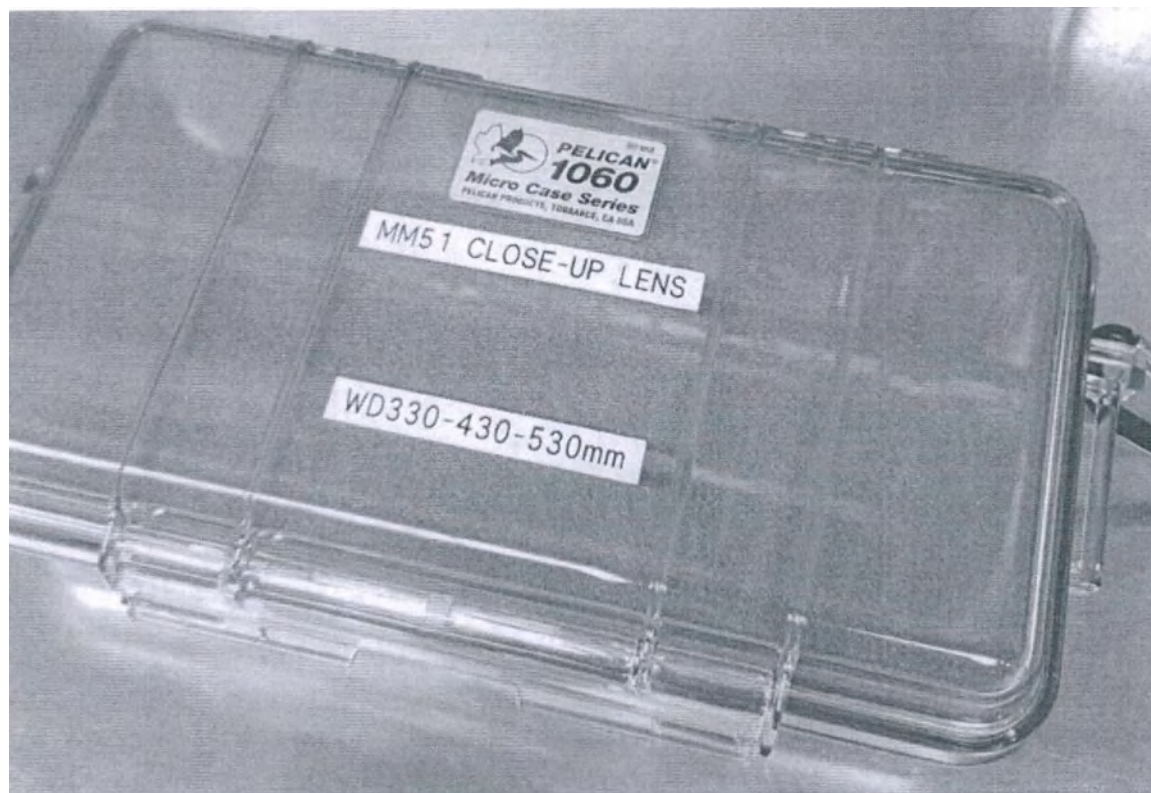


Упаковка

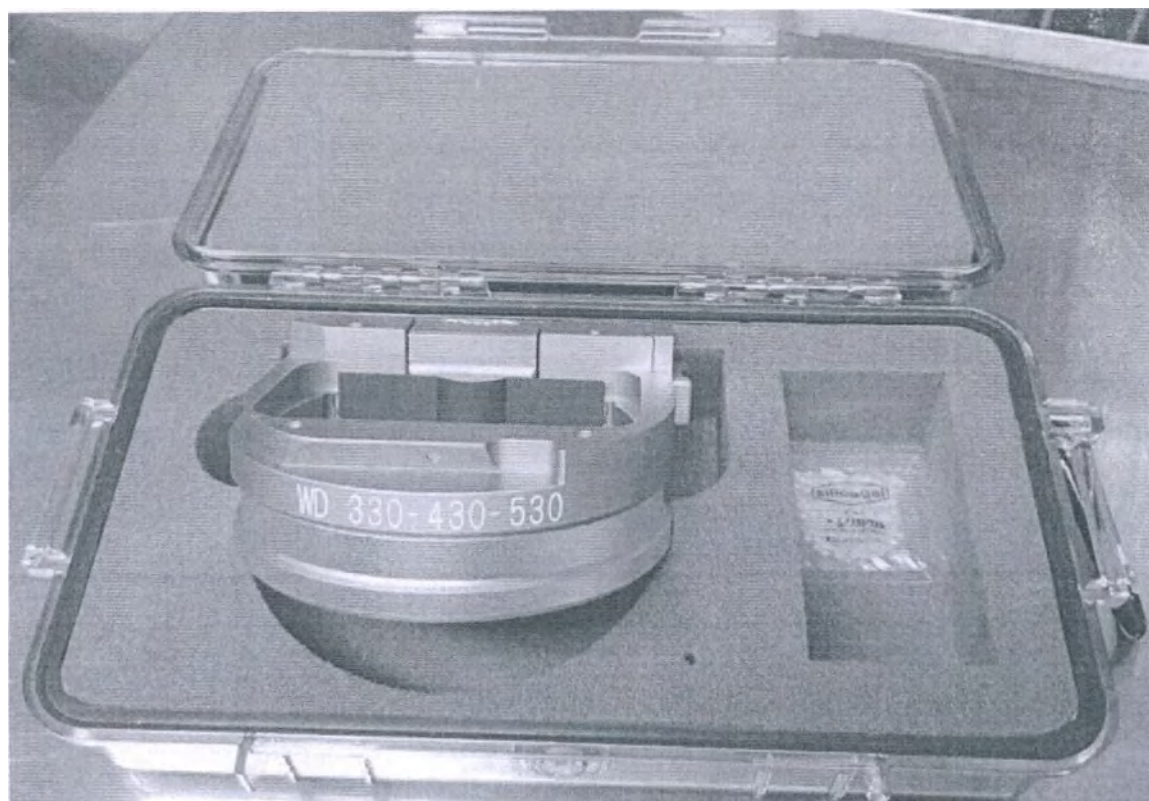

Общий вид изделия

Адаптер камеры однокомпонентный

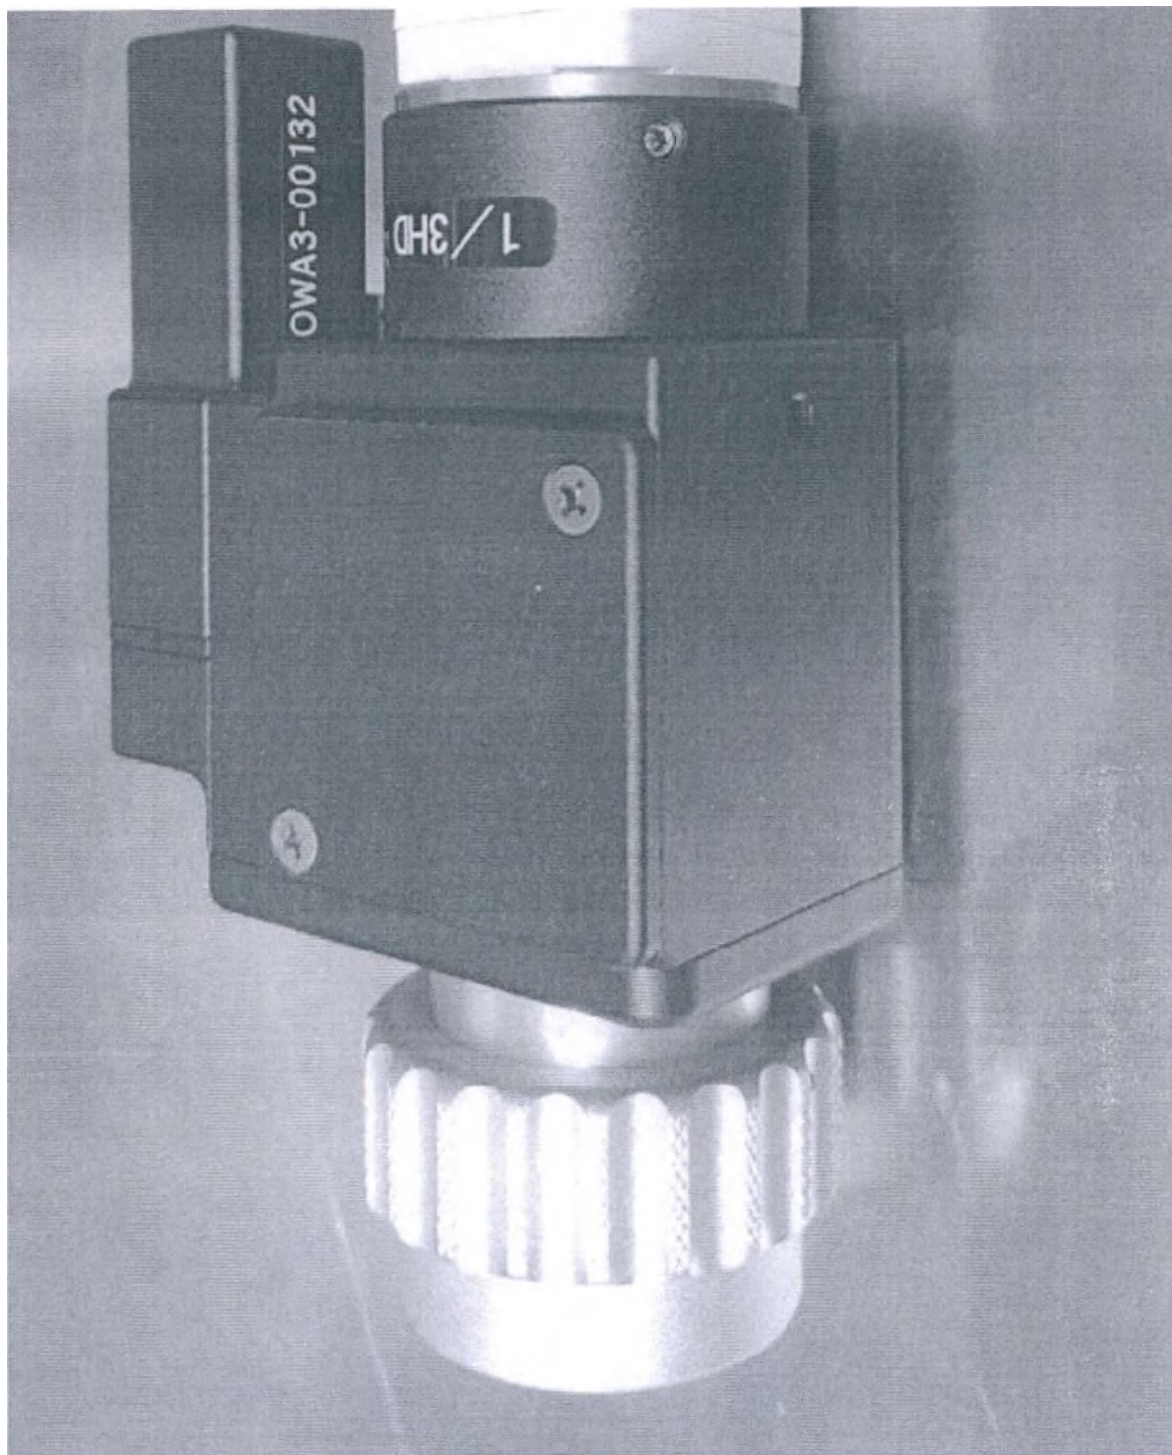


Общий вид изделия

Контроллер фокусировки камеры




Общий вид изделия

Защитное стекло на объектив

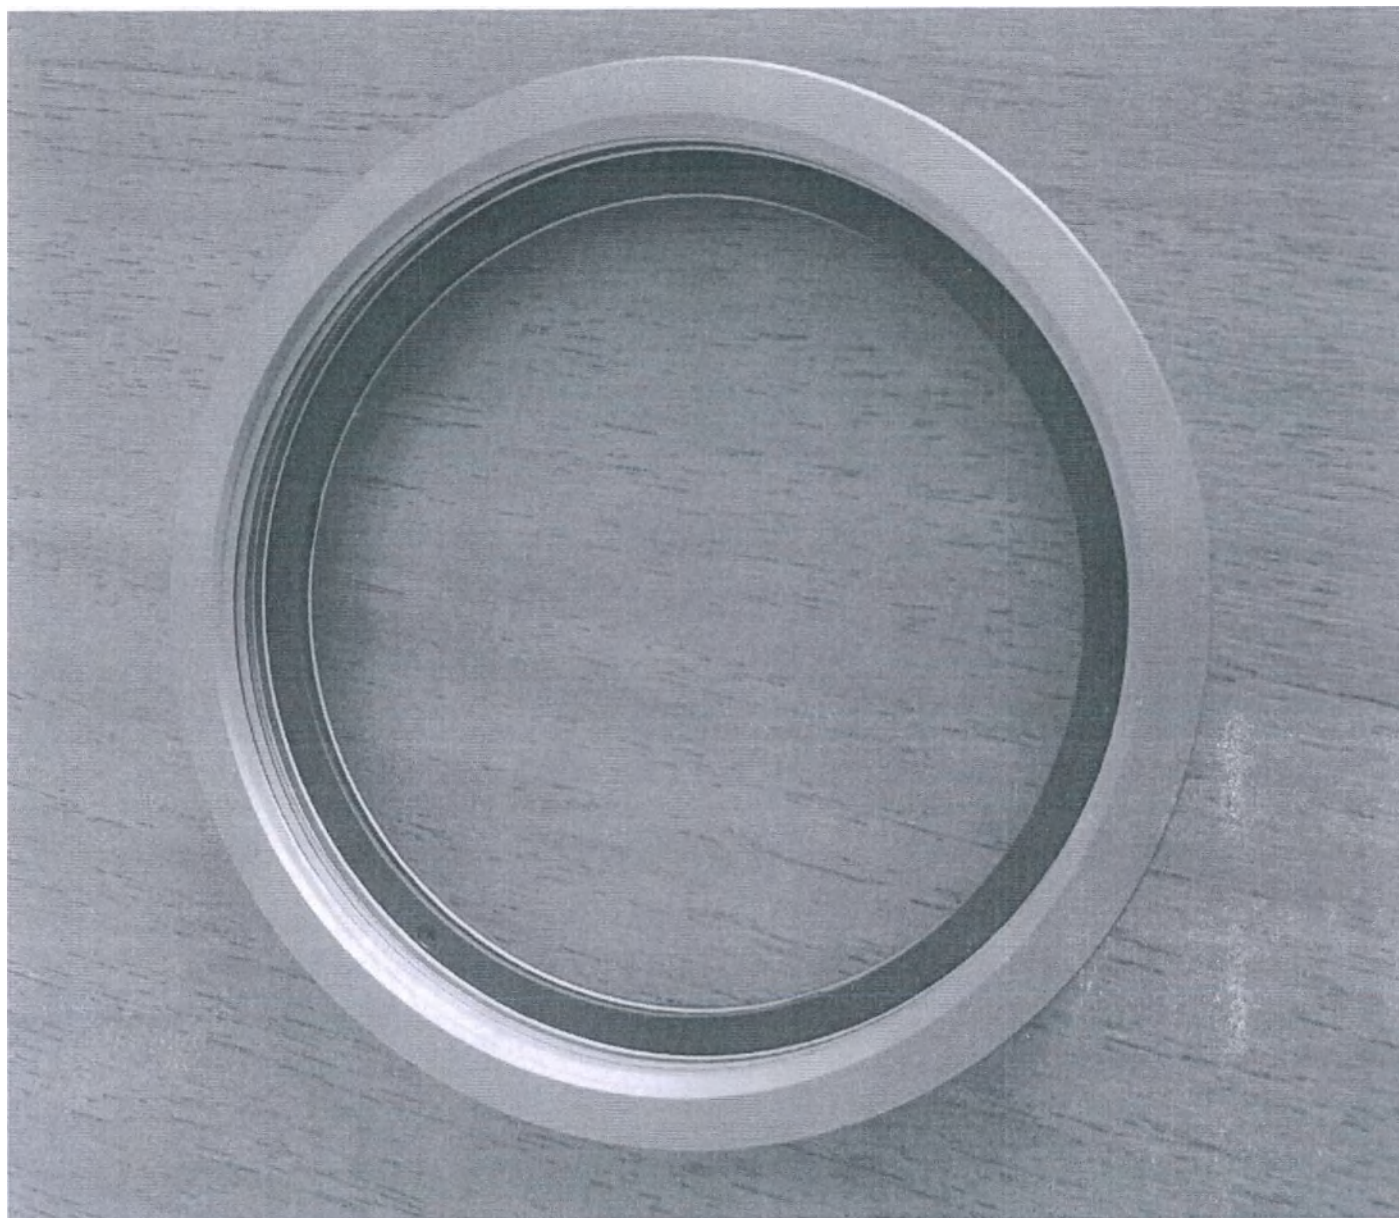


Общий вид изделия

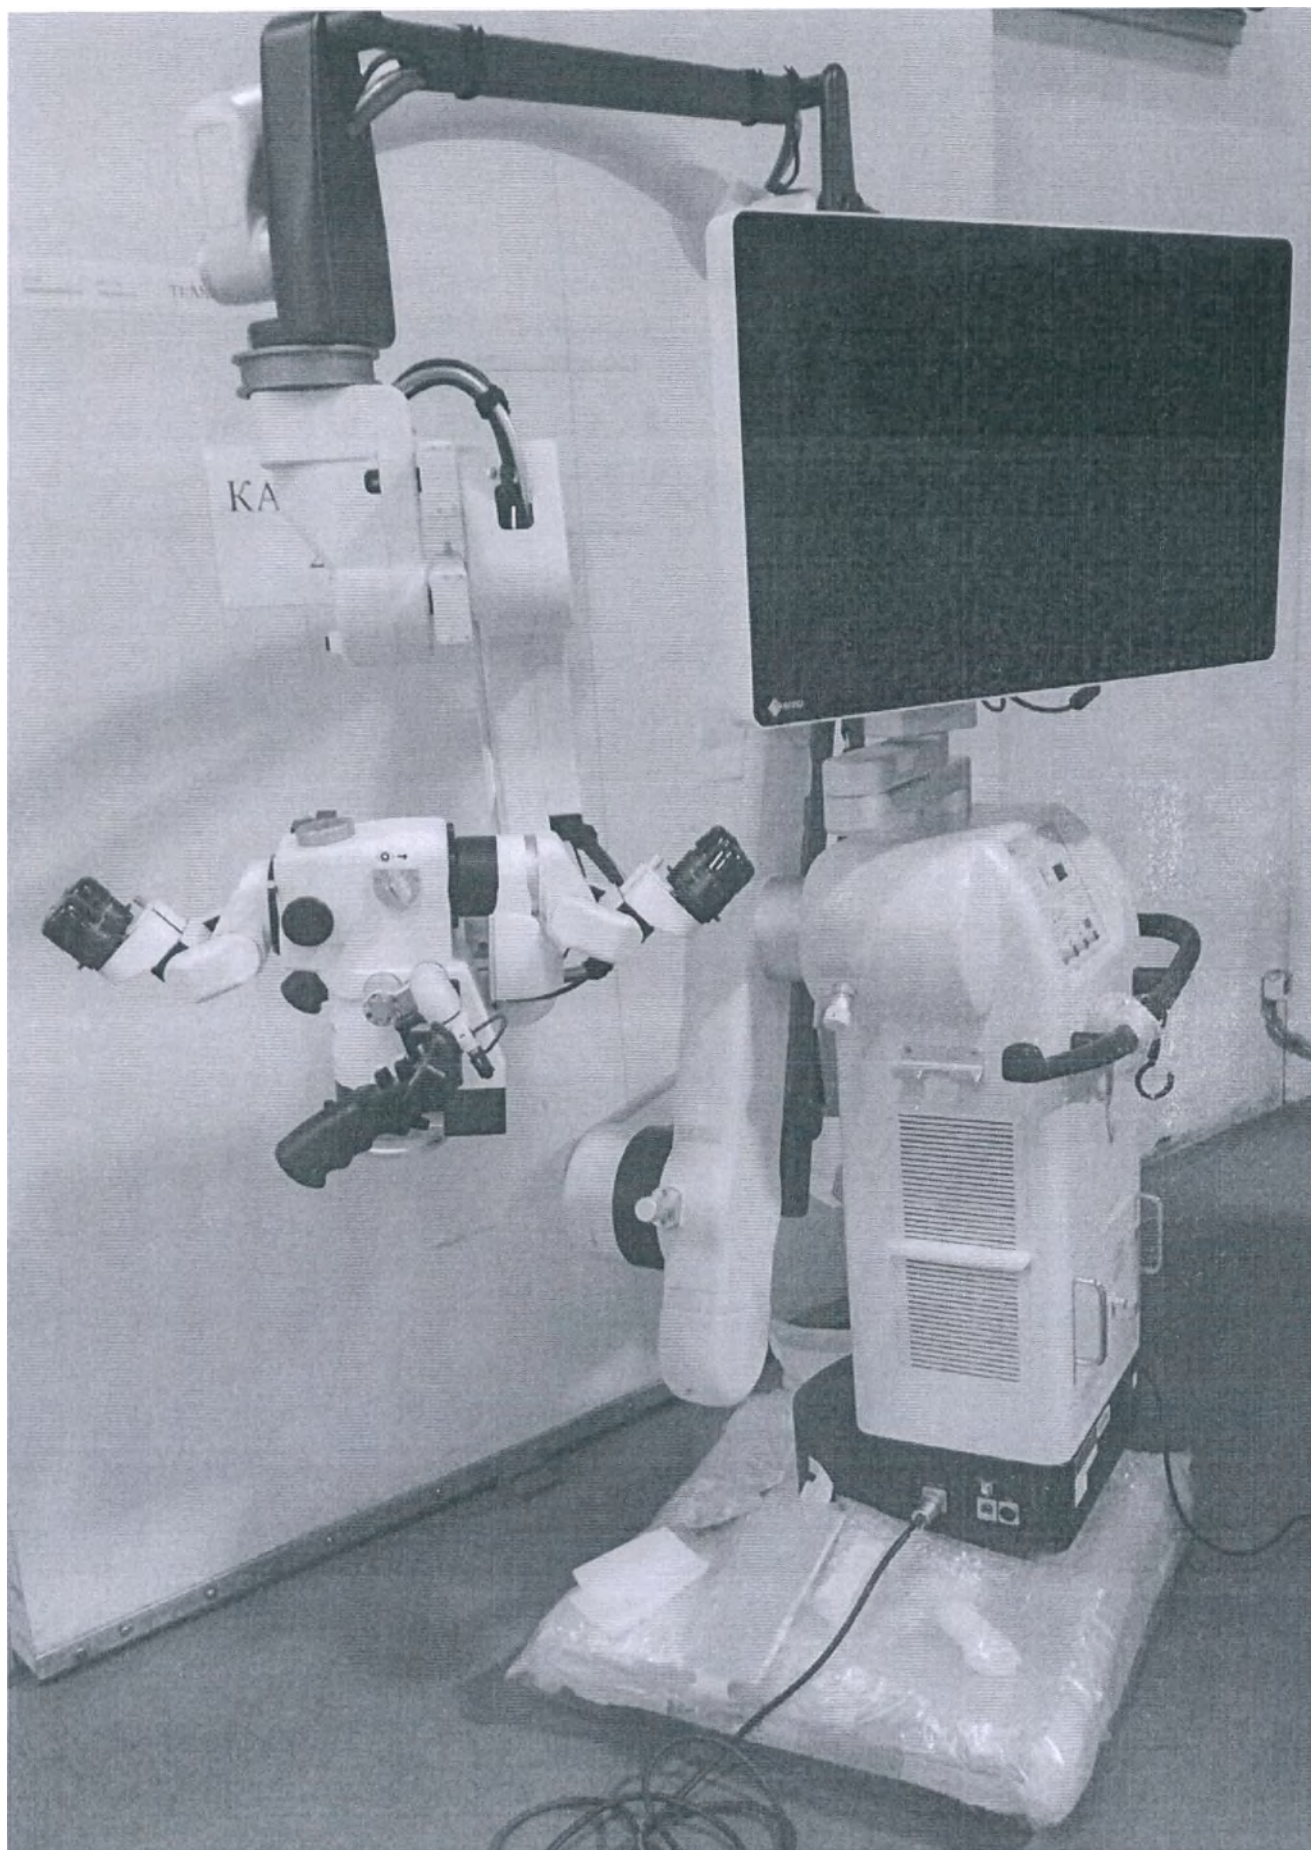


Общий вид в сборе с микроскопом и монитором

Держатель для монитора

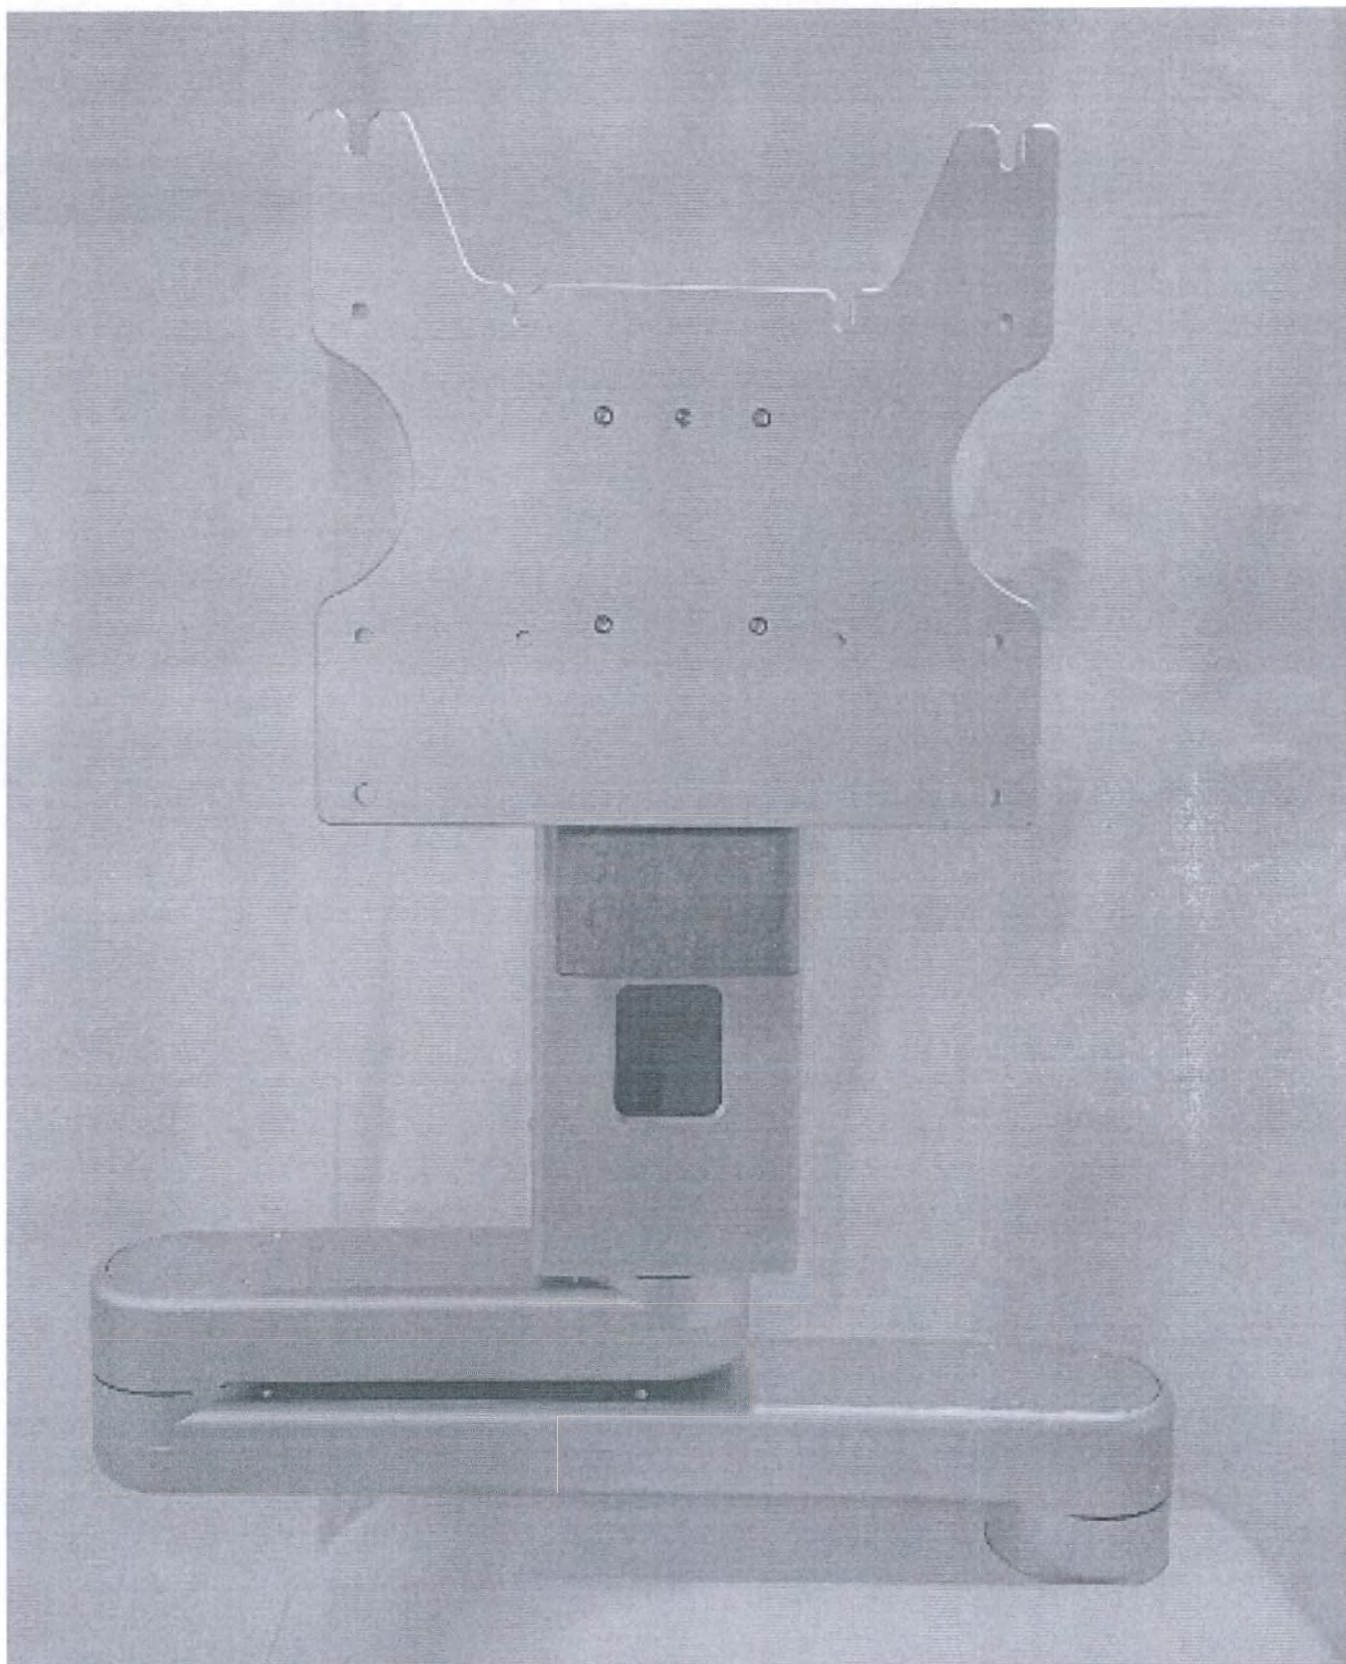

Общий вид изделия

Ножной переключатель

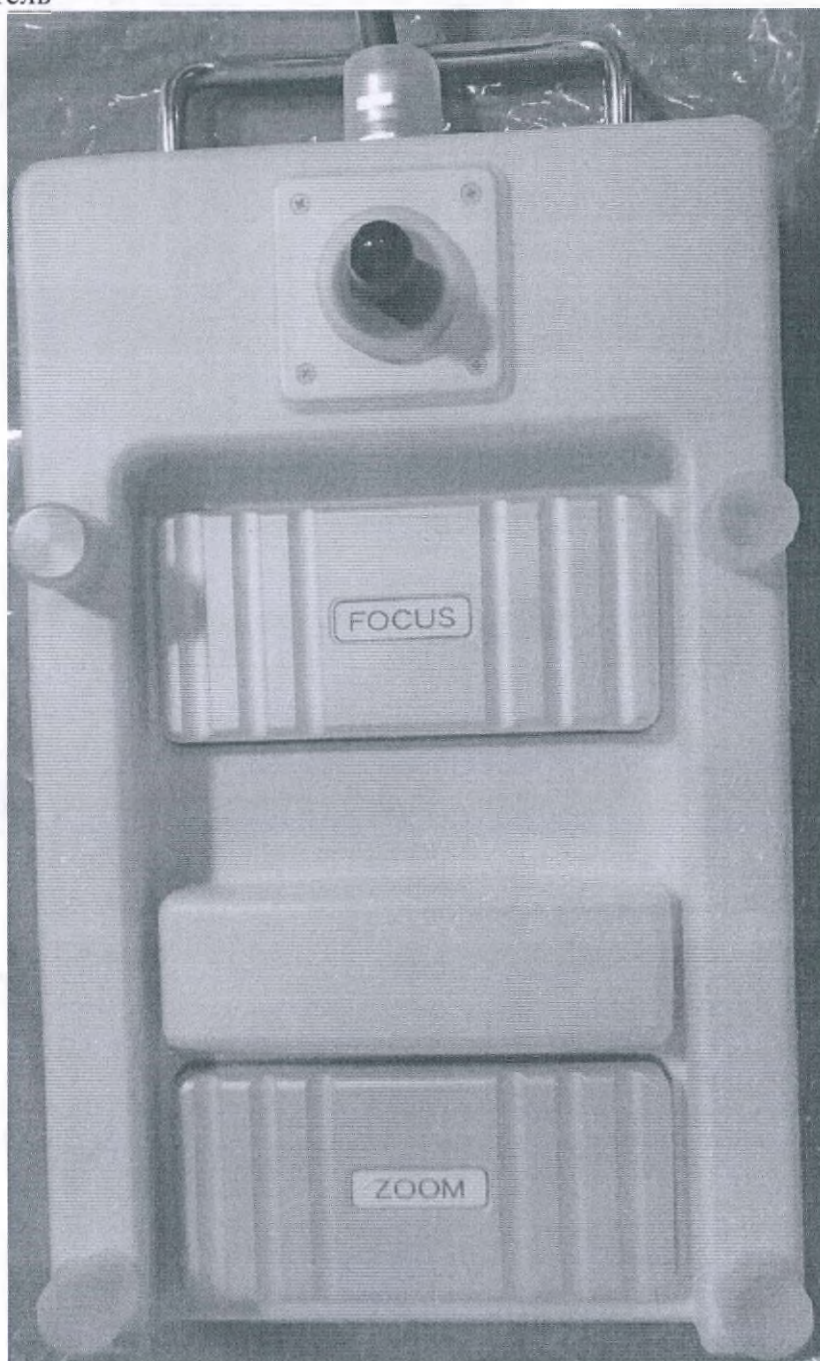


Общий вид изделия




Маркировка на изделии

Сетевой кабель

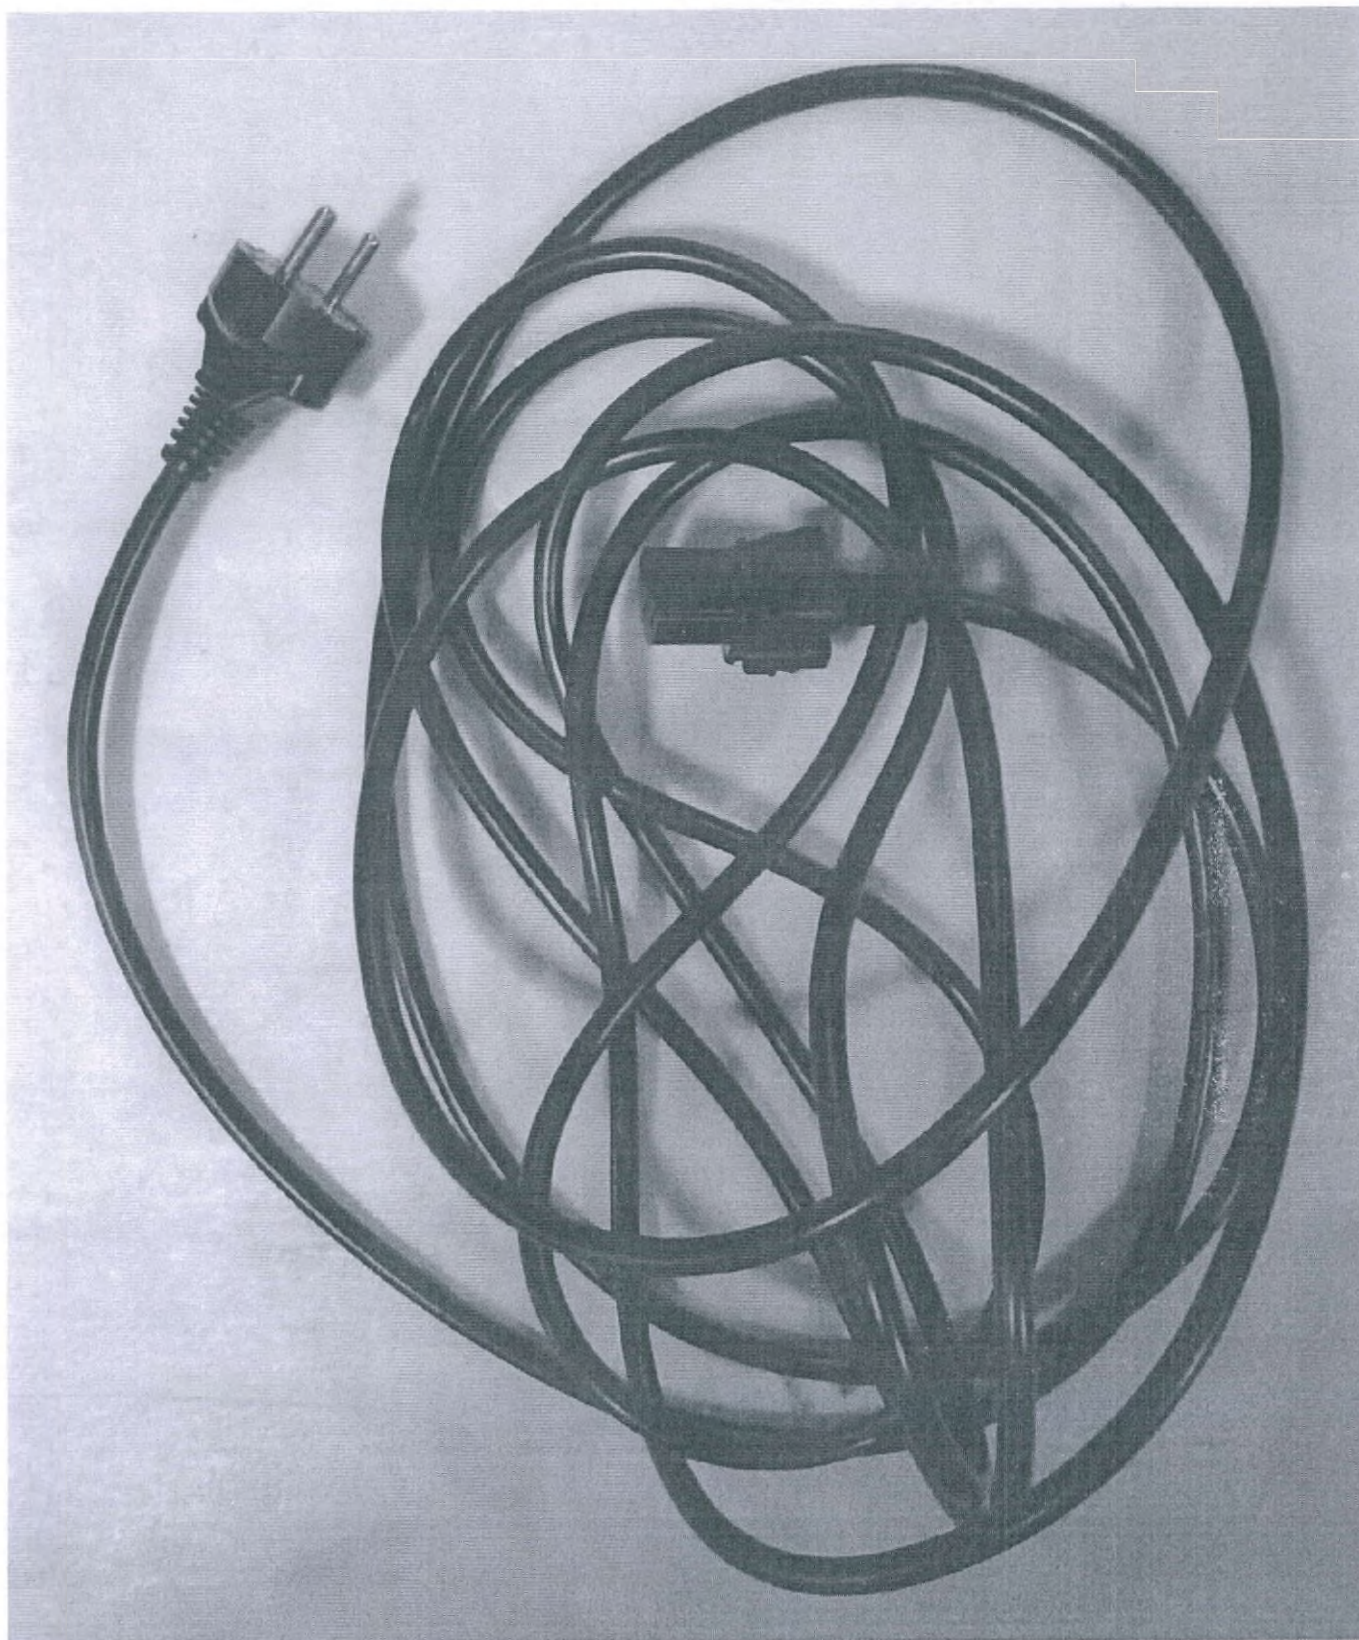


Общий вид изделия

Стандартный оптоволоконный кабель

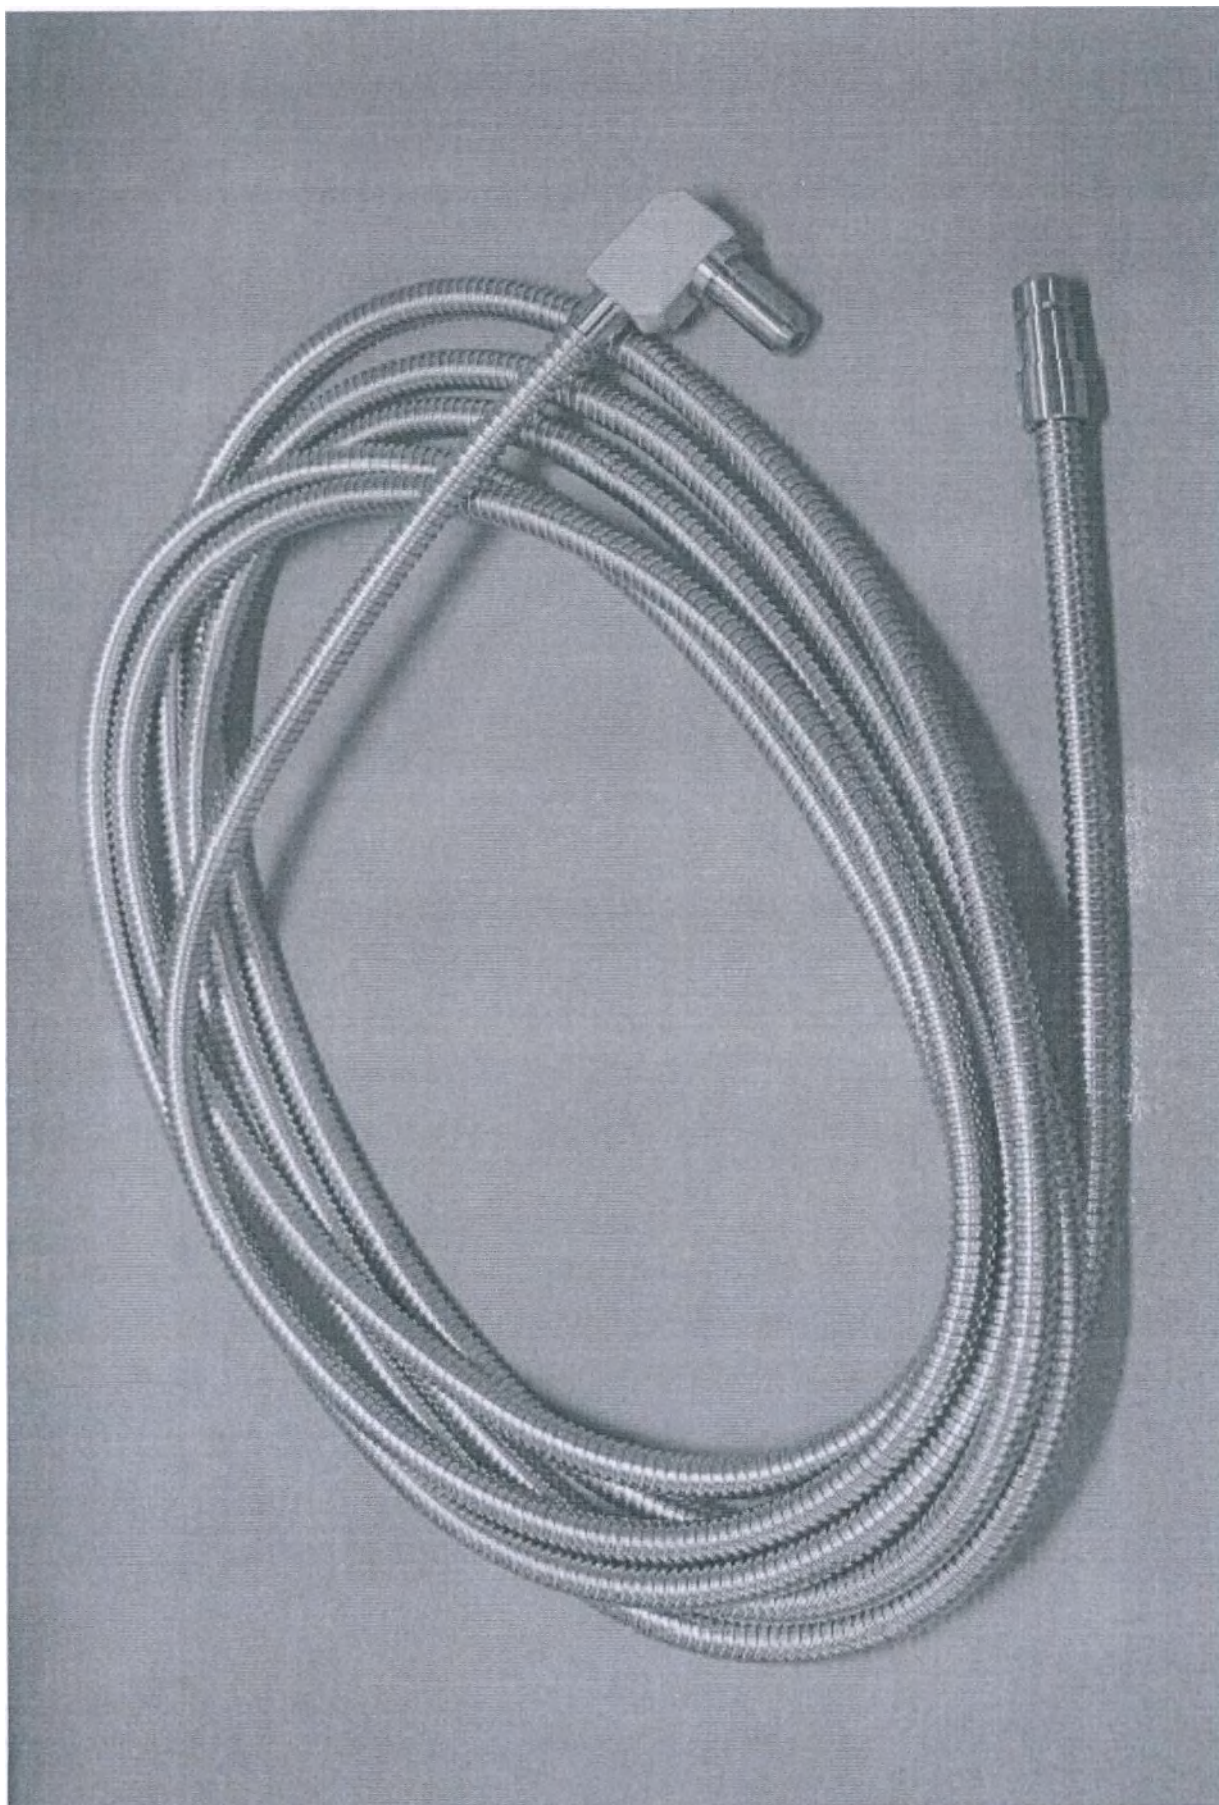


Общий вид изделия

Блок ксеноновой лампы 300W

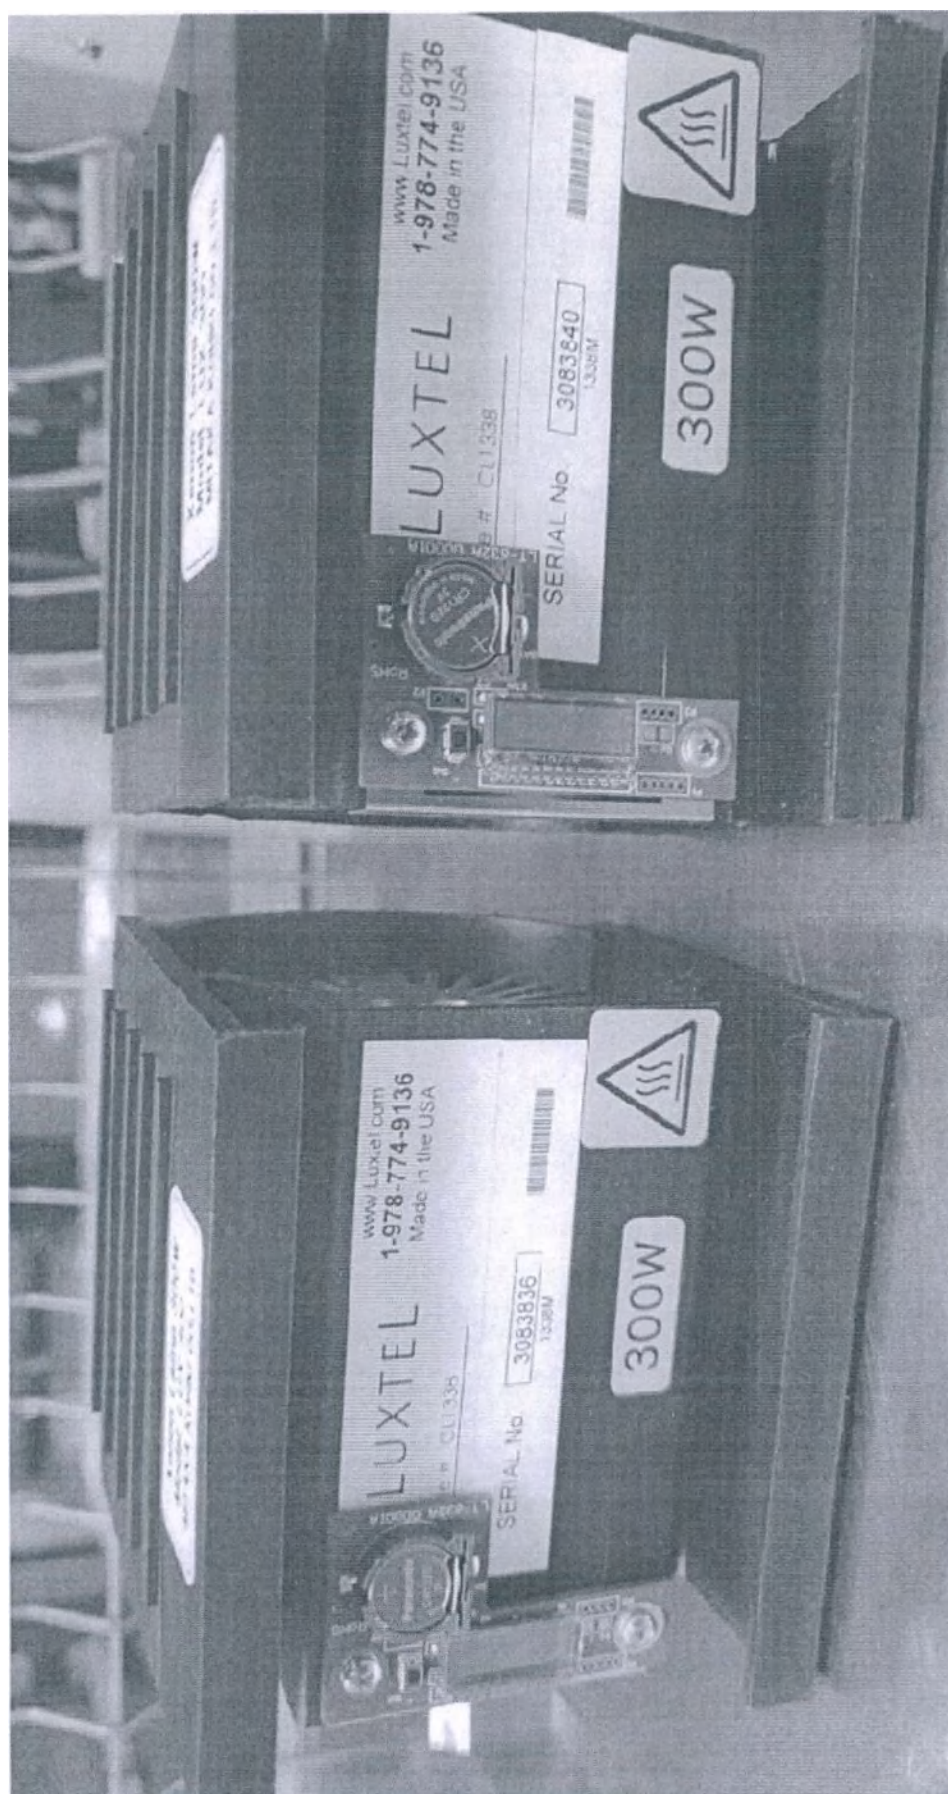


Общий вид изделия

Ротовой переключатель

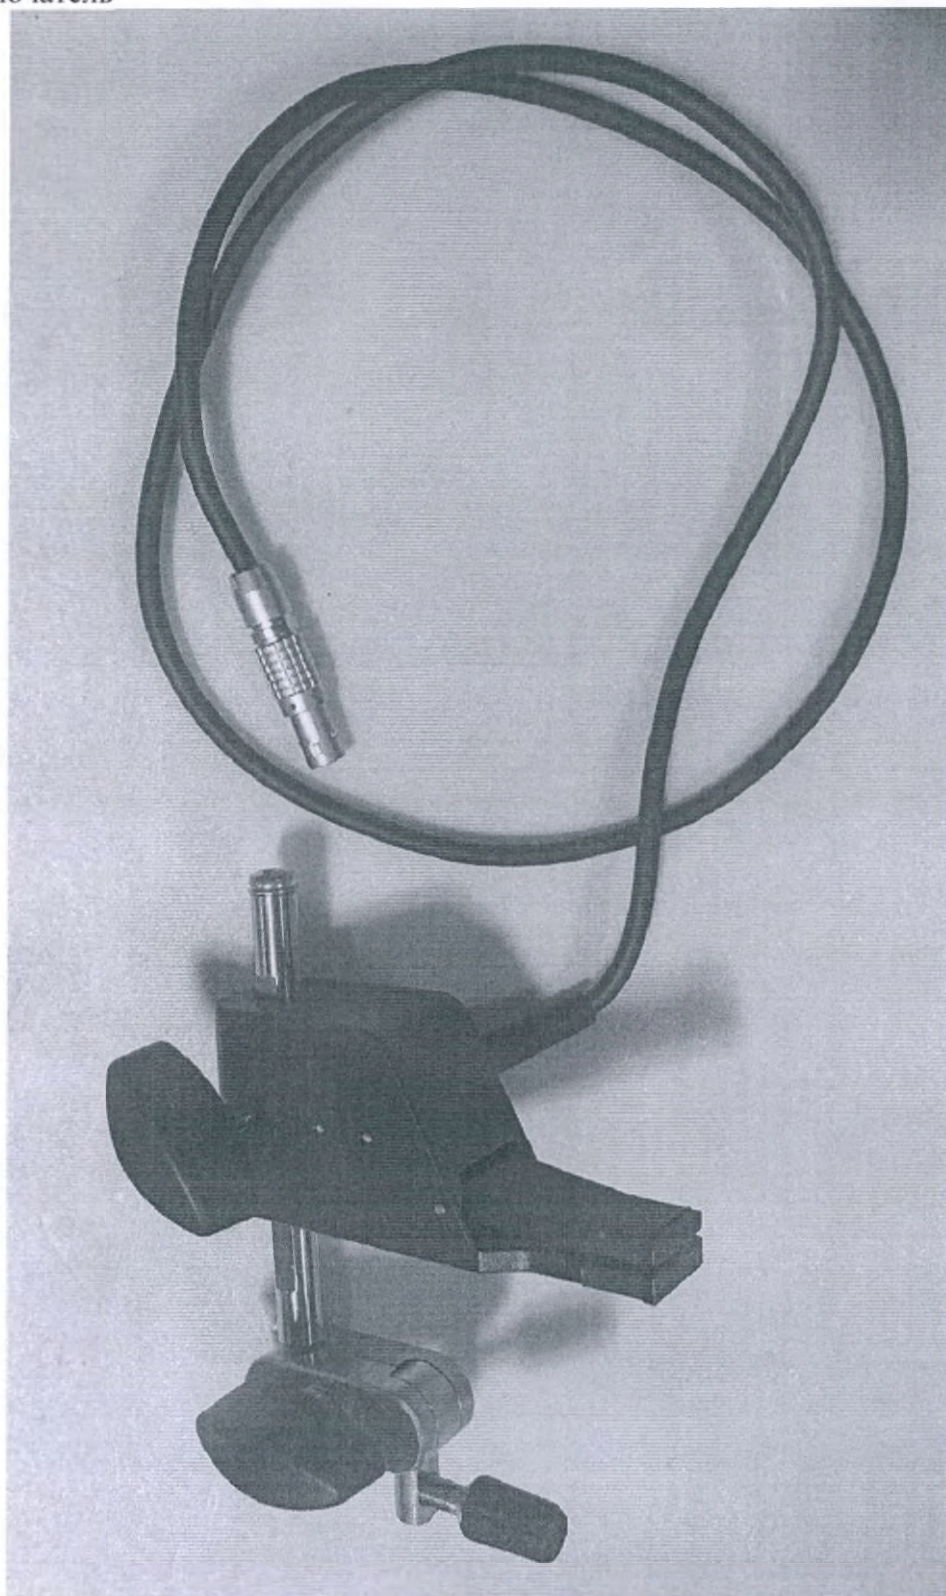


Общий вид изделия

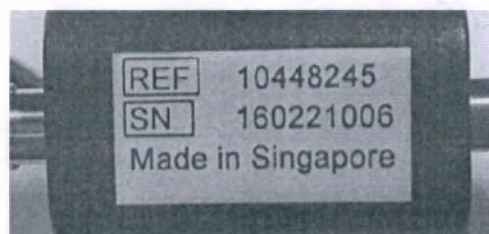


Маркировка на изделии


Камера 3D Mitaka для микроскопа MM51 (3D, 2K)

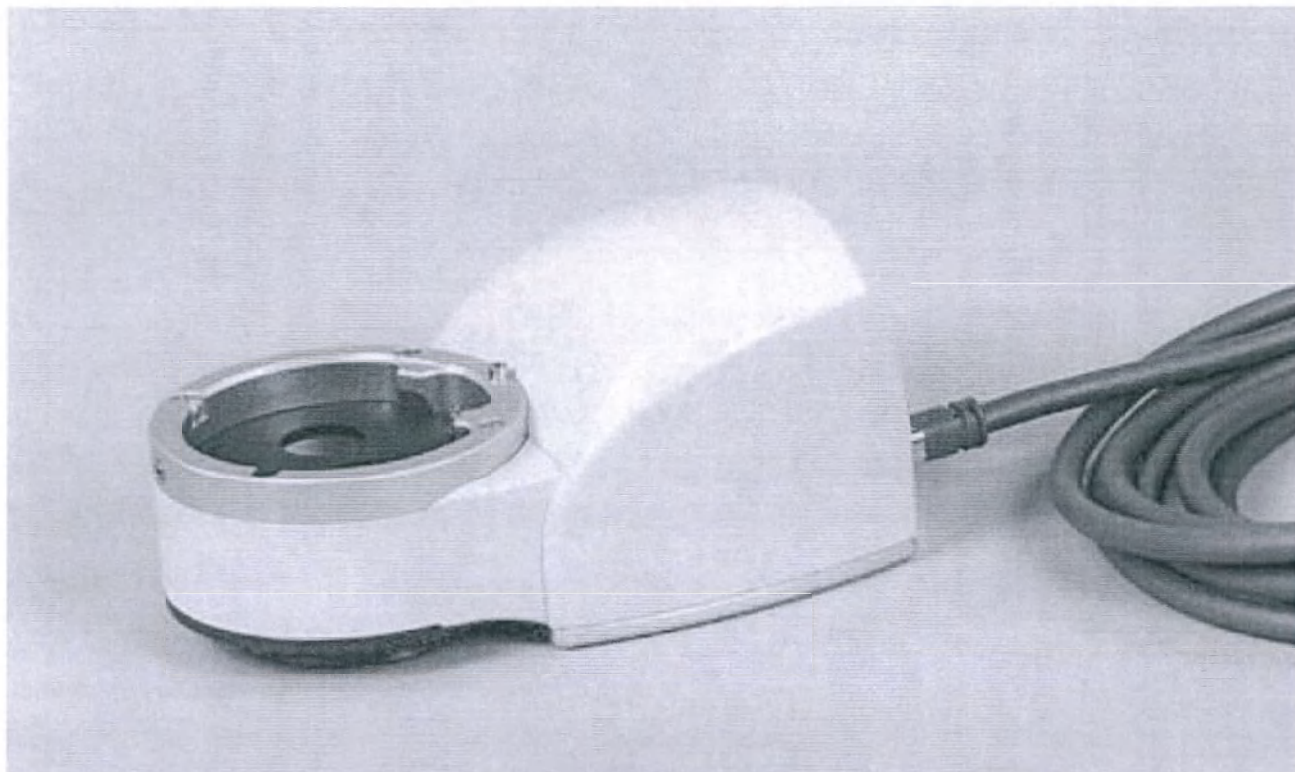


Головка камеры

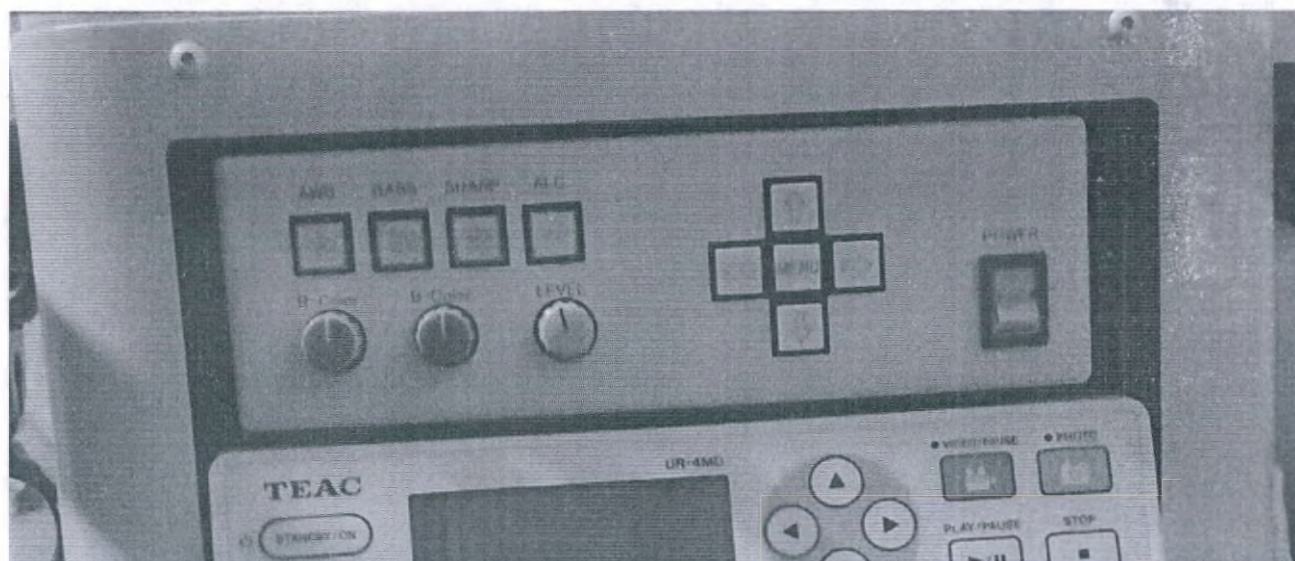

Блок управления камерой, предустановленный в штатив микроскопа

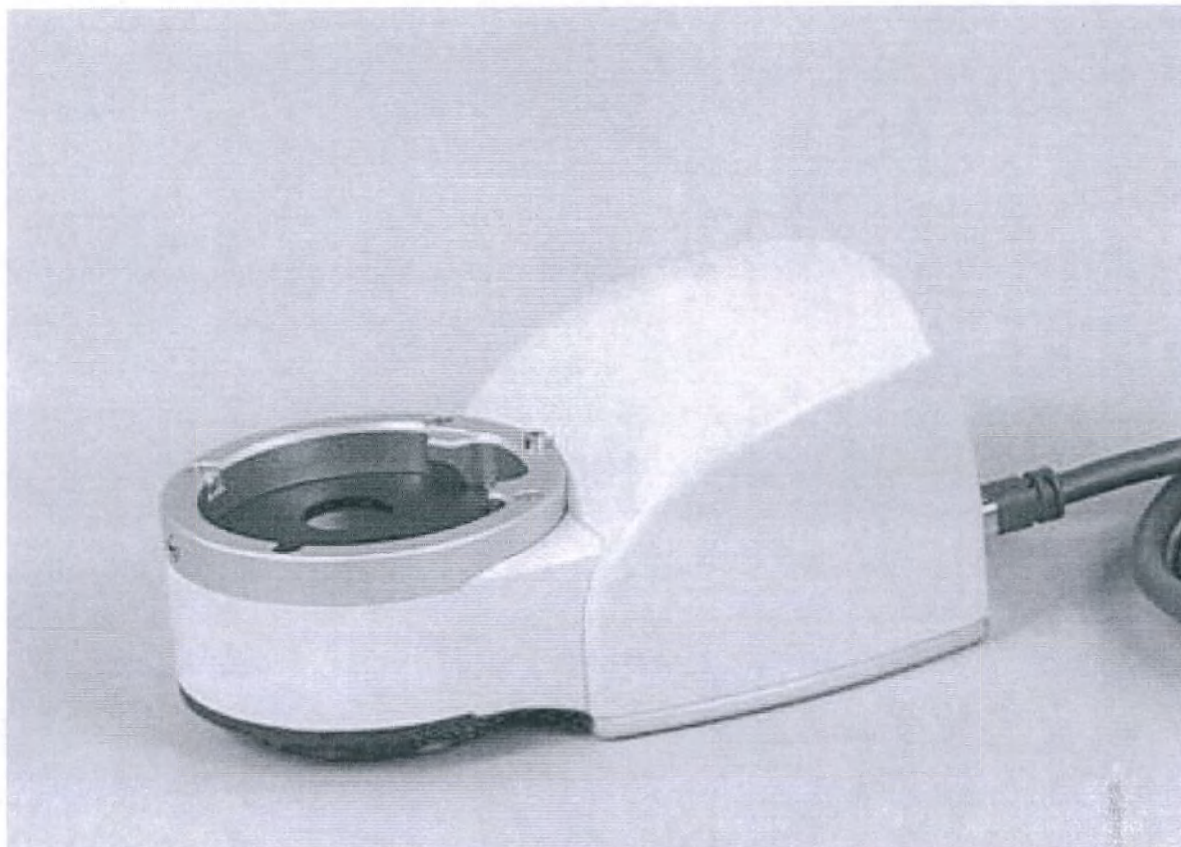

Общий вид головки камеры

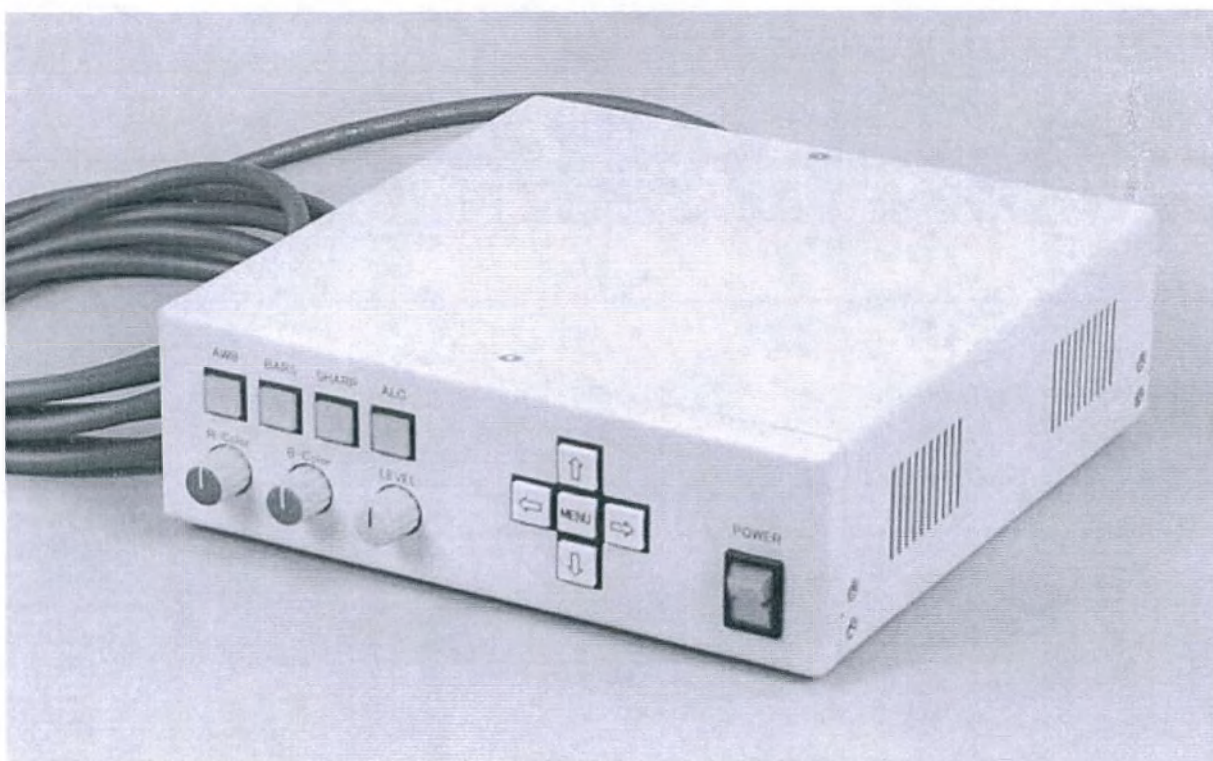


Общий вид блока управления

Цветная камера Panasonic (2D, Full HD)



Общий вид головки камеры и маркировка на изделии

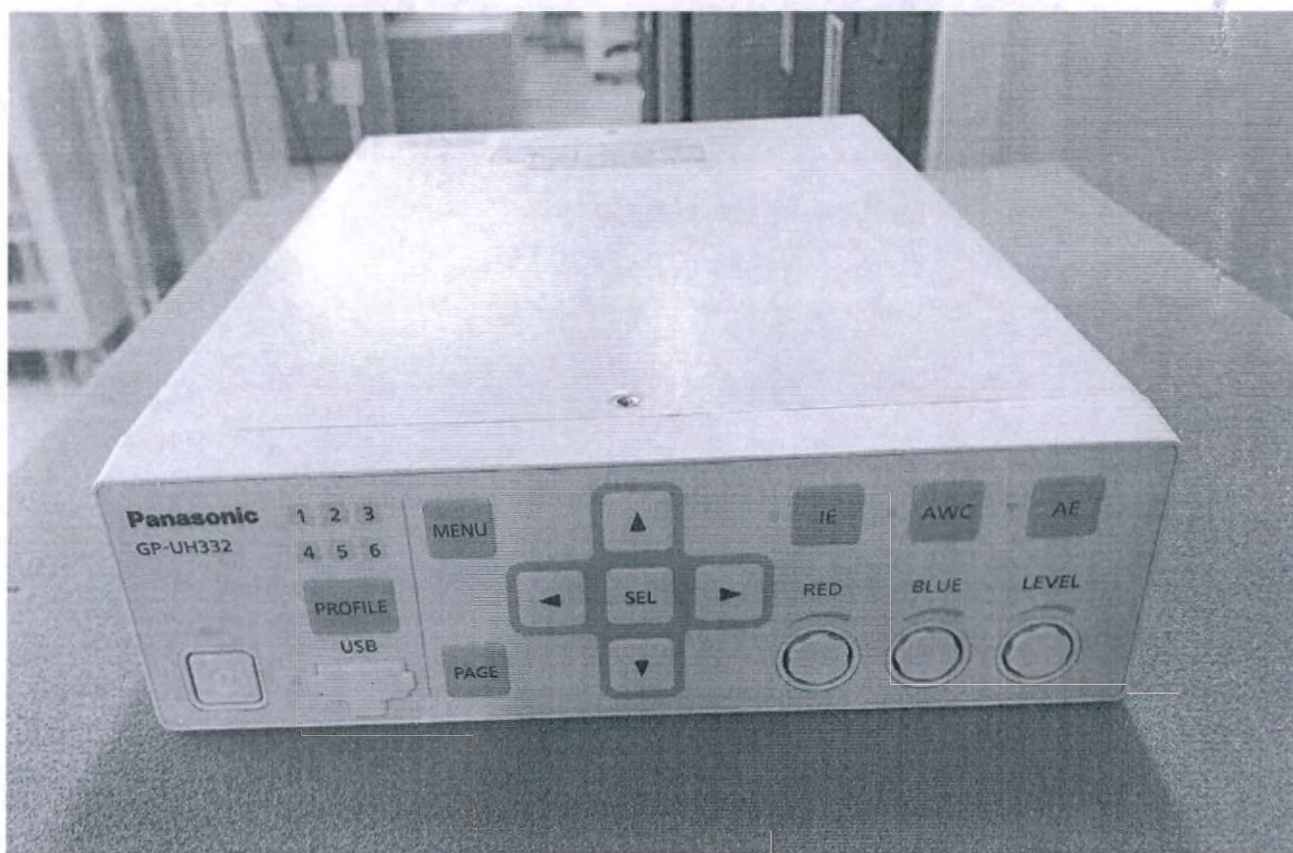


Блок управления

Цветная камера Panasonic (2D, 4K)




Общий вид головки камеры и маркировка на изделии

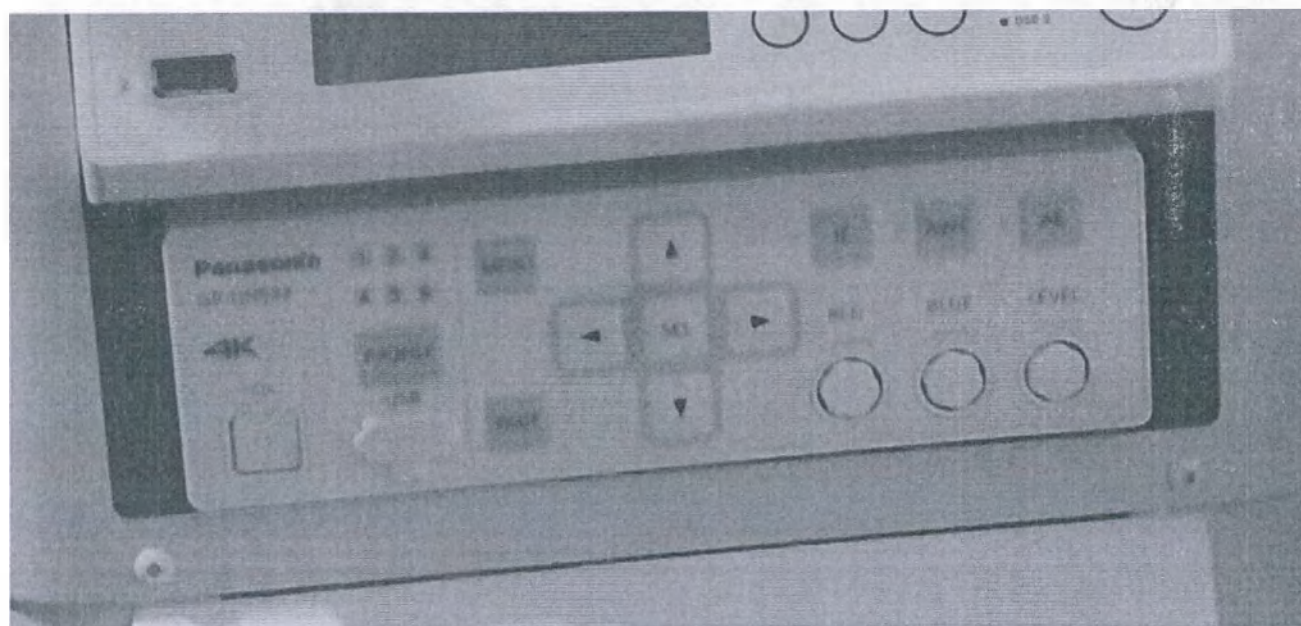

Блок управления (предустановлен в штатив микроскопа)


Монитор 2D, 27 дюймов

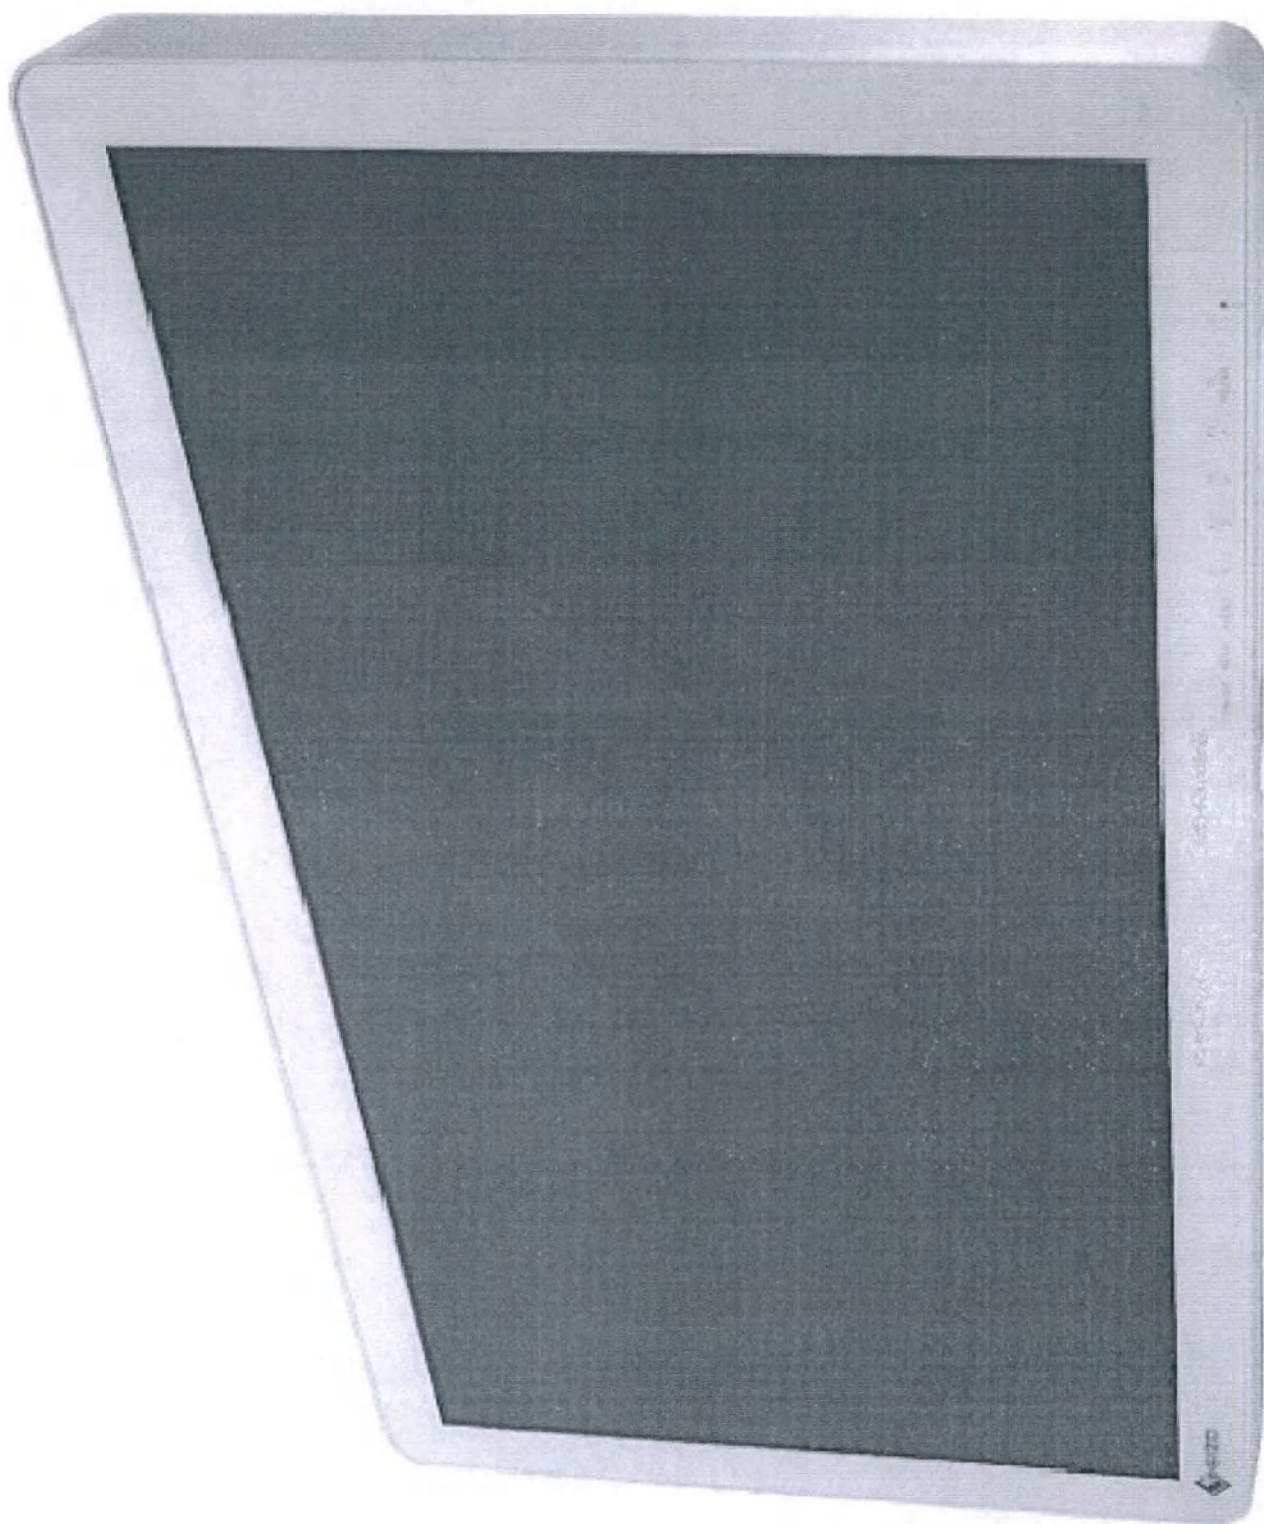


Общий вид изделия




Монитор 2D, 32 дюйма

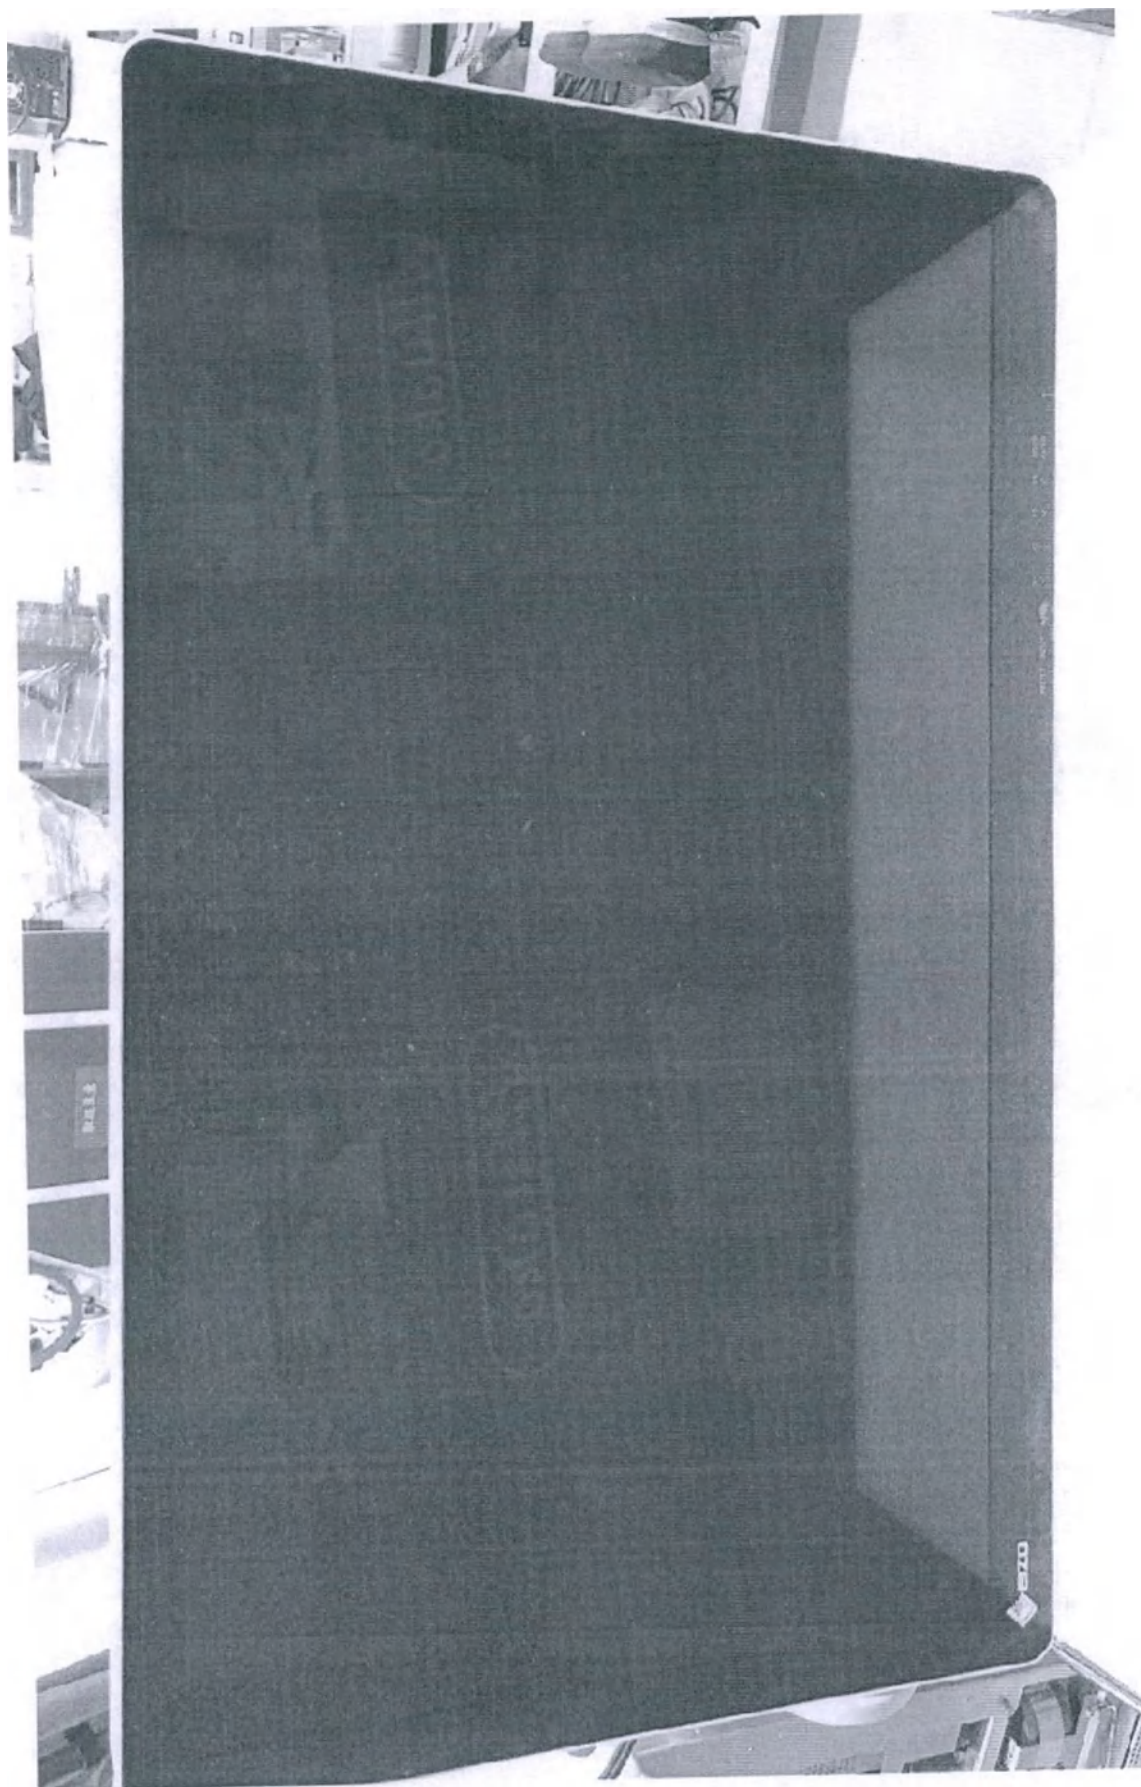


Общий вид изделия

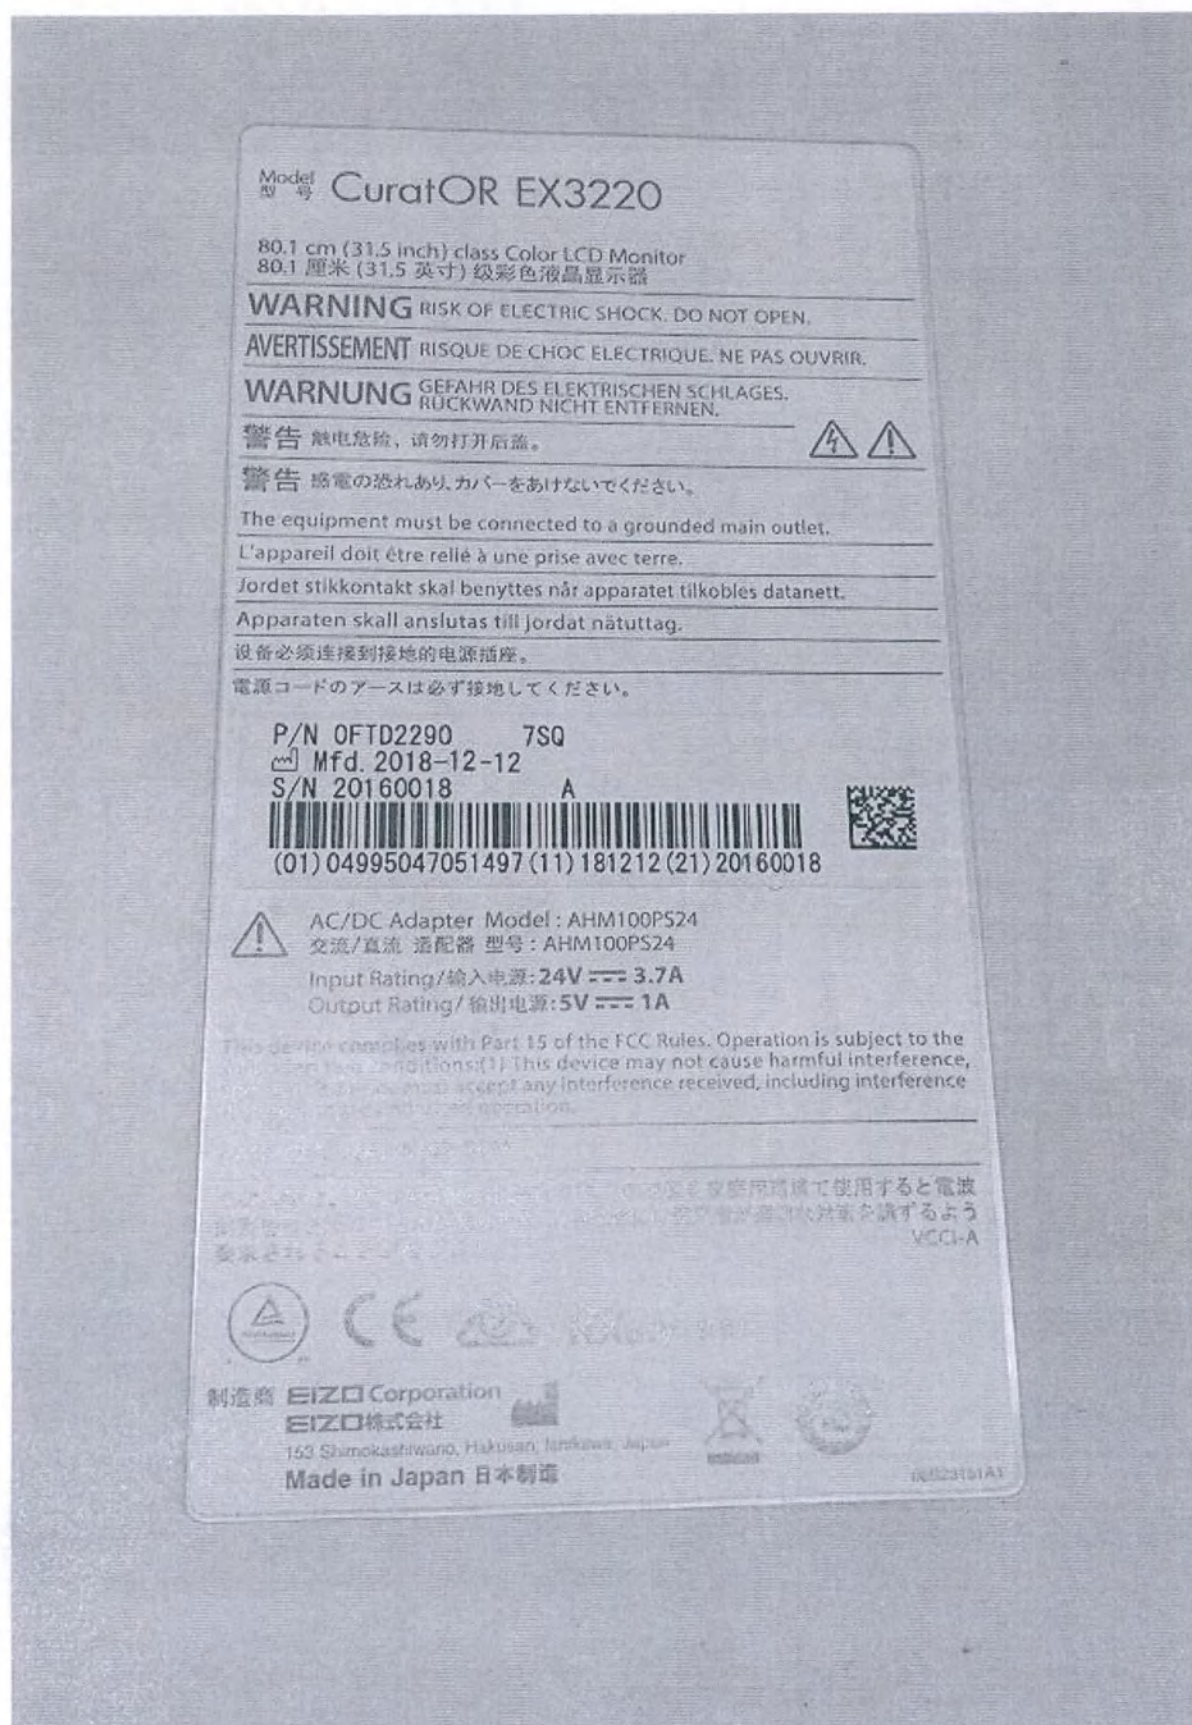

Монитор 3D, 32 дюйма.

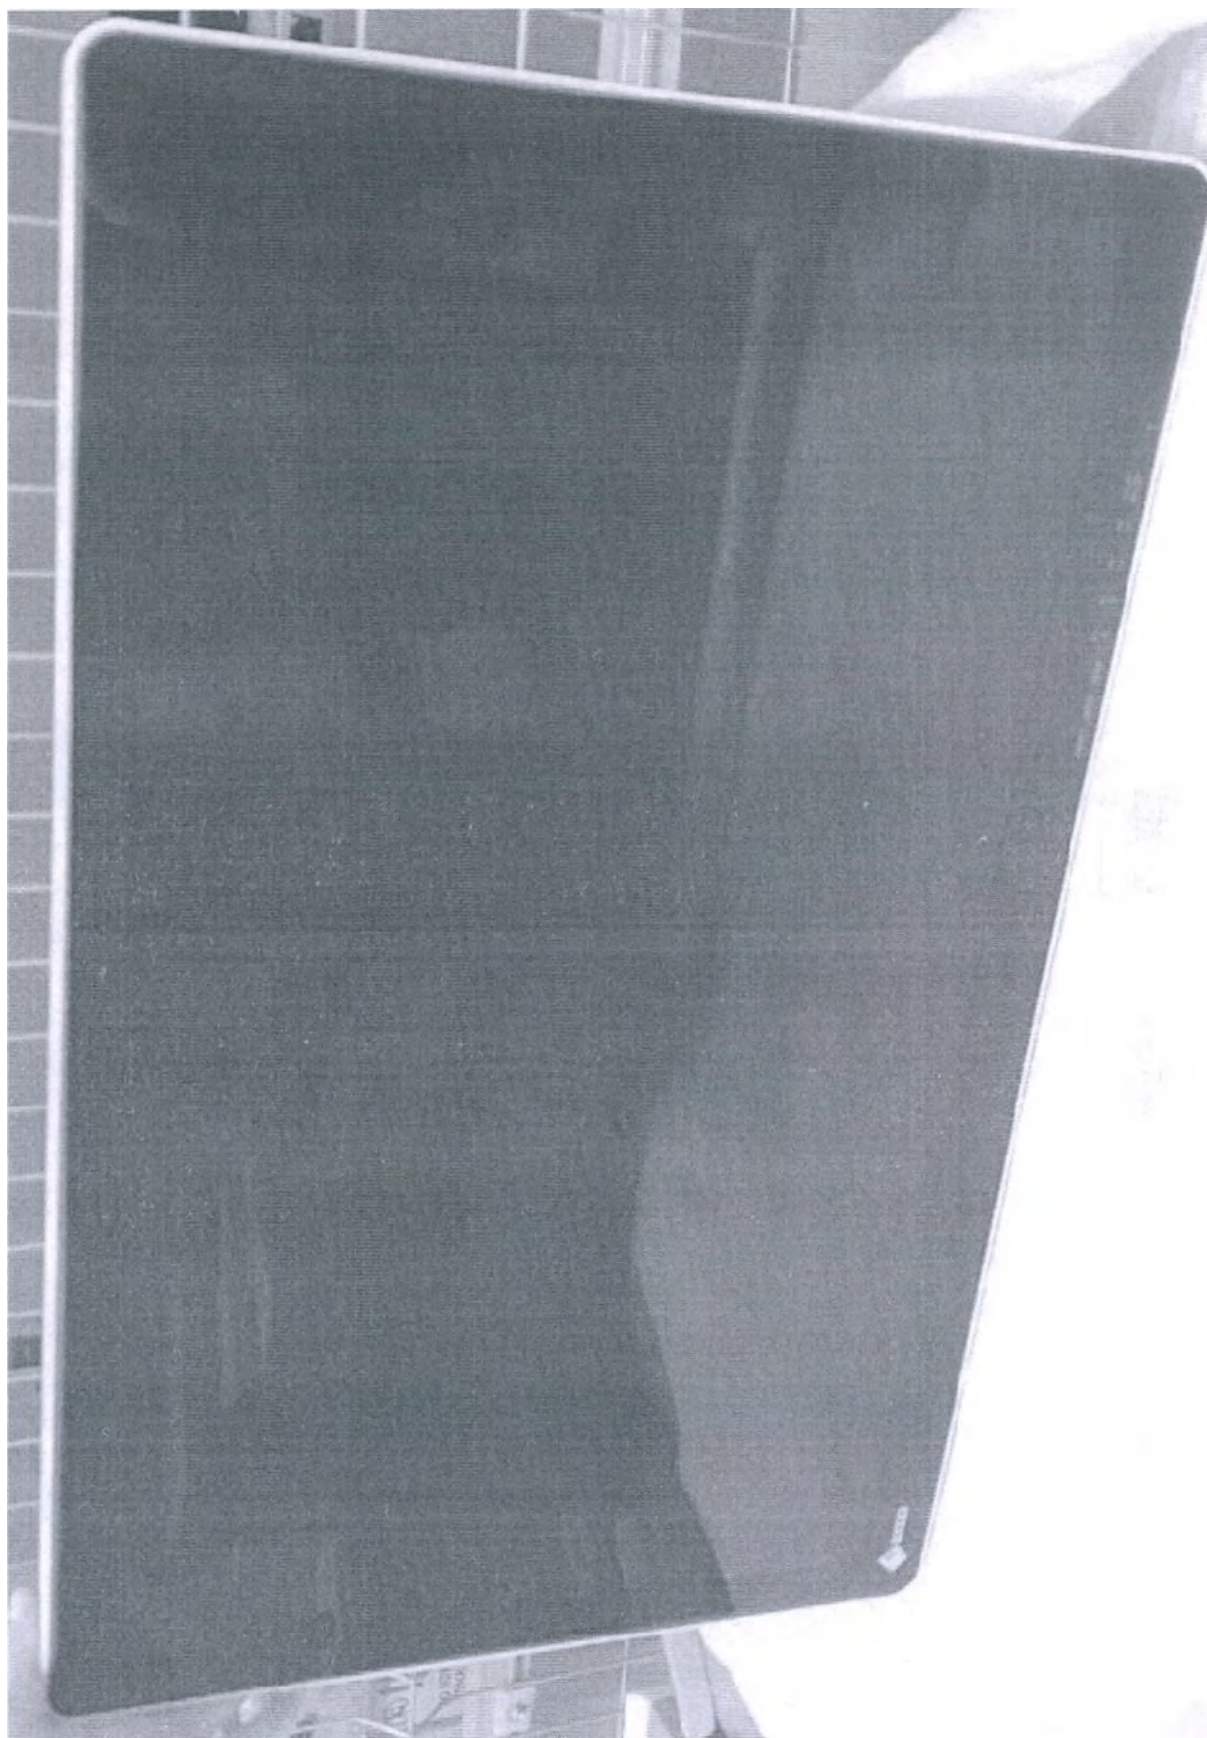

Общий вид изделия

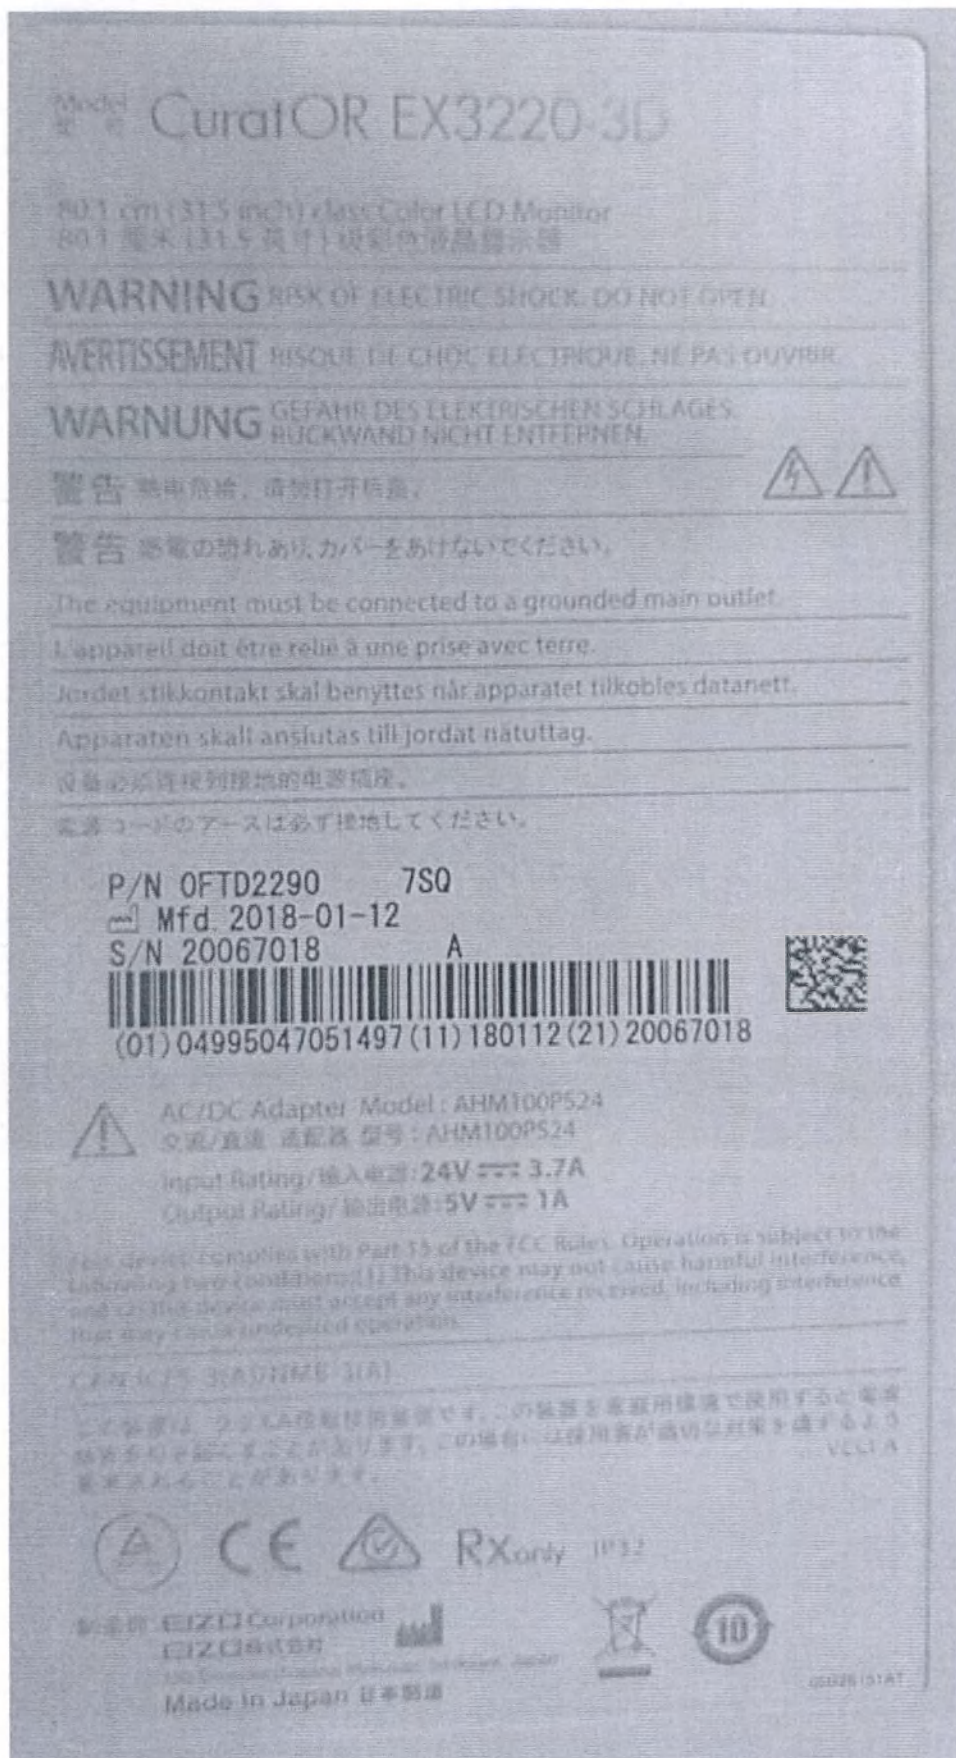


Маркировка на изделии


Монитор 2D, 32 дюйма, 4К



Общий вид изделия

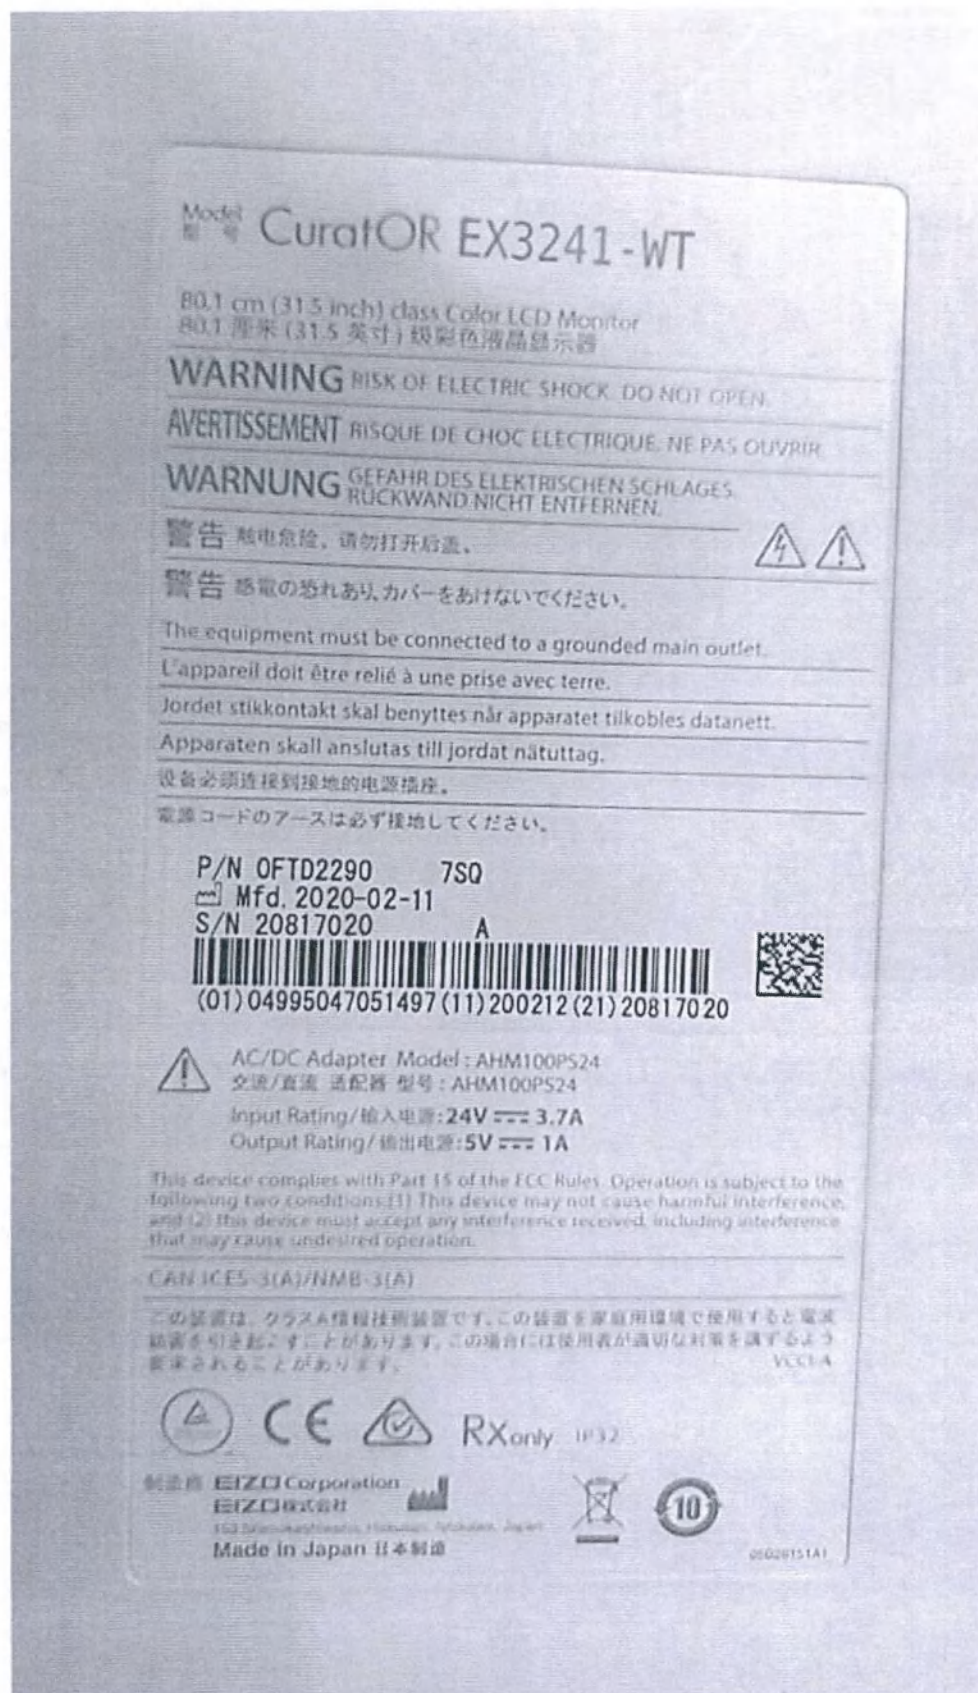


Маркировка изделия

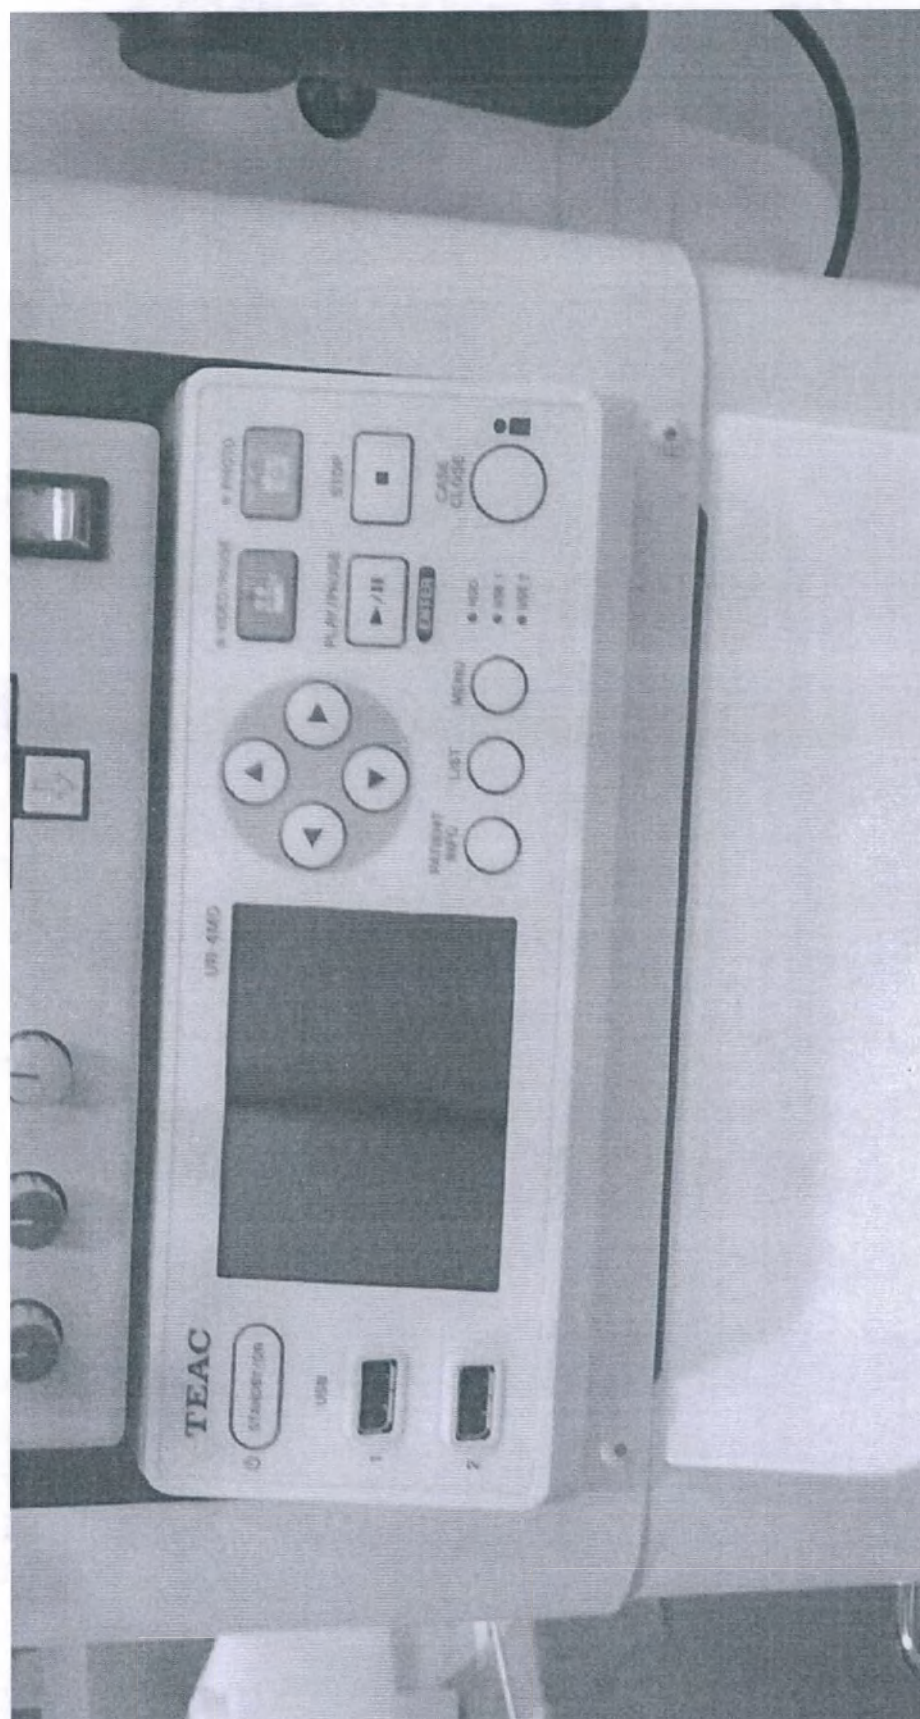

Общий вид изделия (предустановлен в штатив микроскопа)

Защитное покрытие

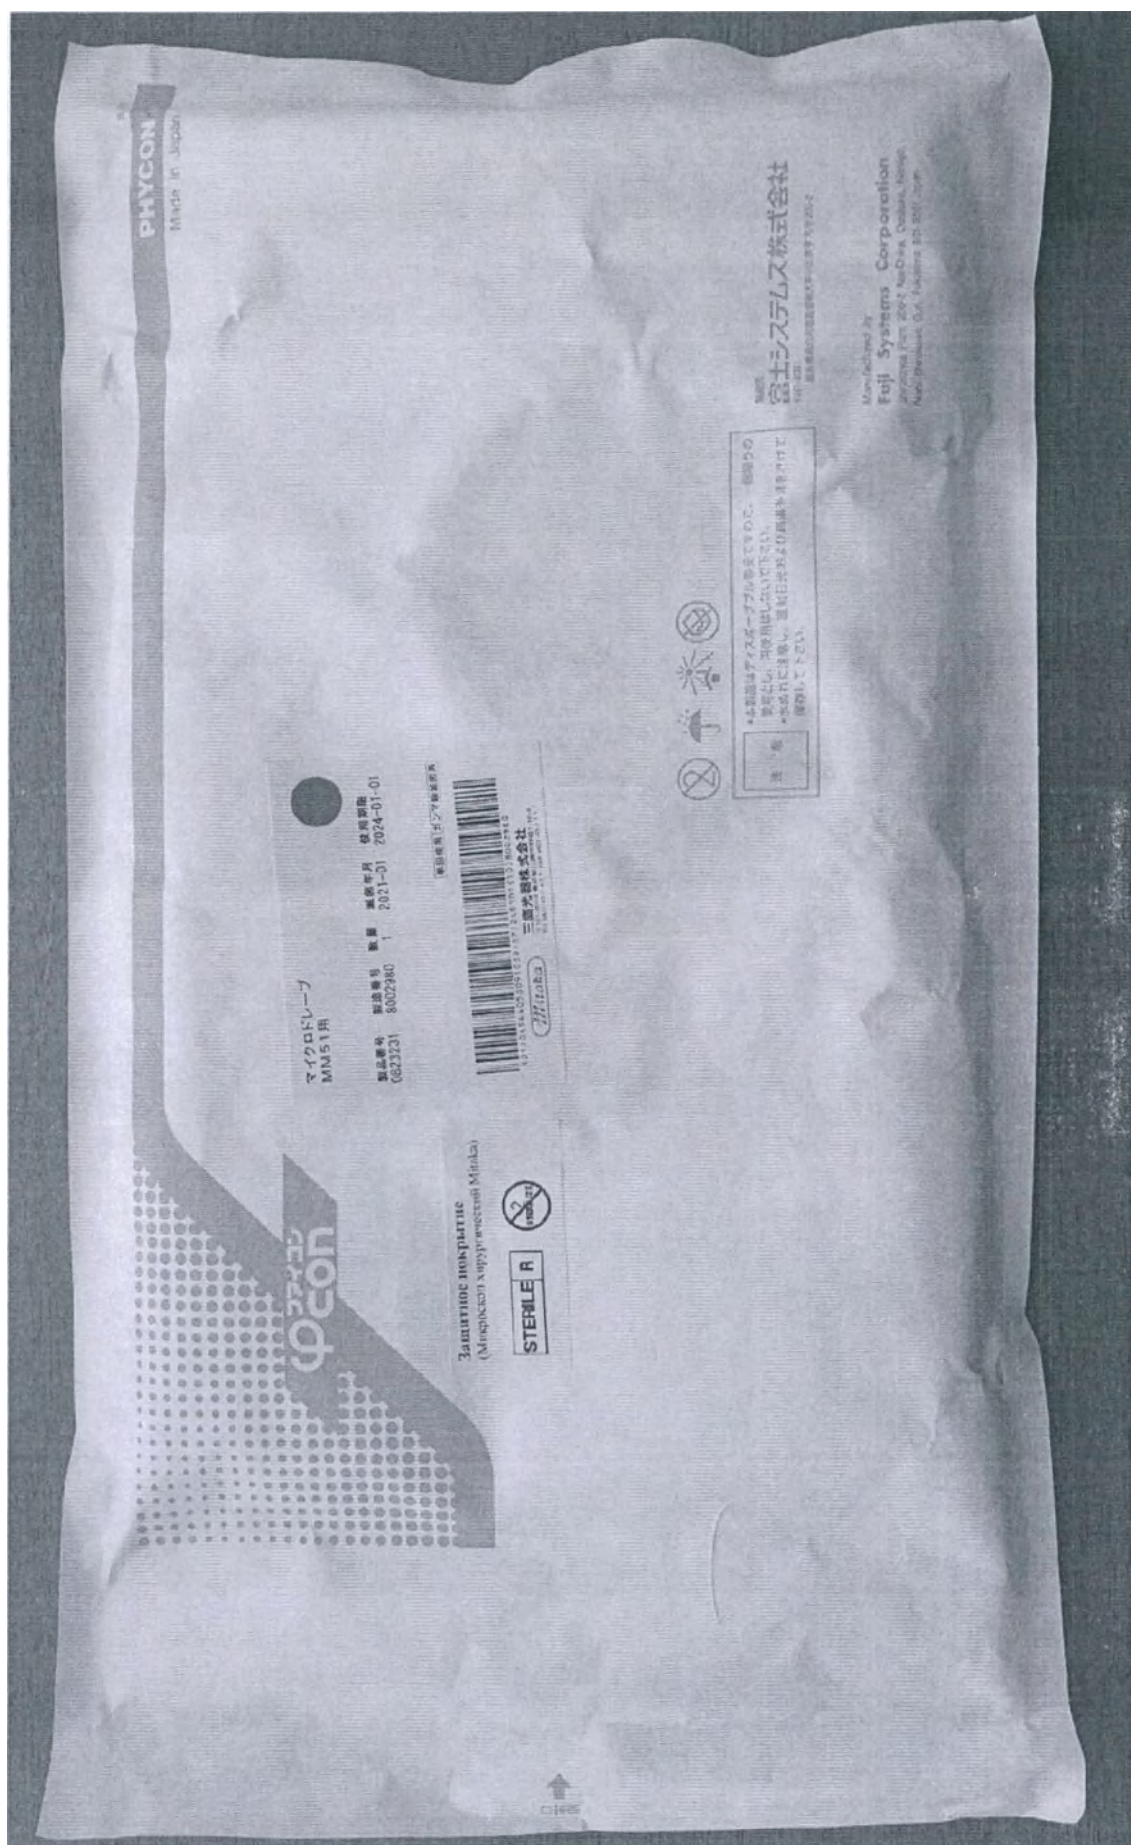

Маркировка на стерильной упаковке

Защитное покрытие



Изделие в стерильной упаковке

Принадлежности:

Камера ближнего ИК-диапазона для функции ICG



Общий вид изделия




Маркировка на изделии

Система переключения сигналов.




Общий вид изделия

Система переключения сигналов

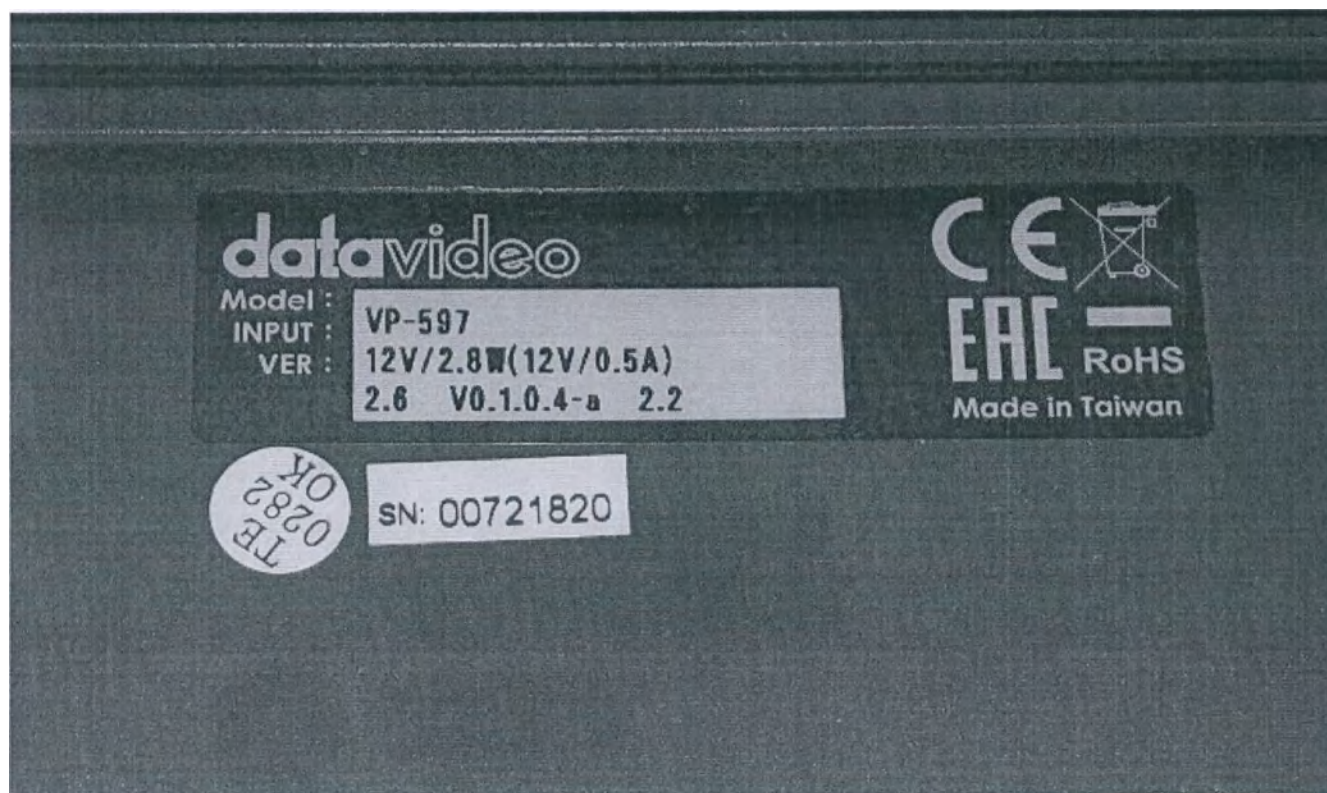

Маркировка на изделии

Фильтр ICG для источника света.

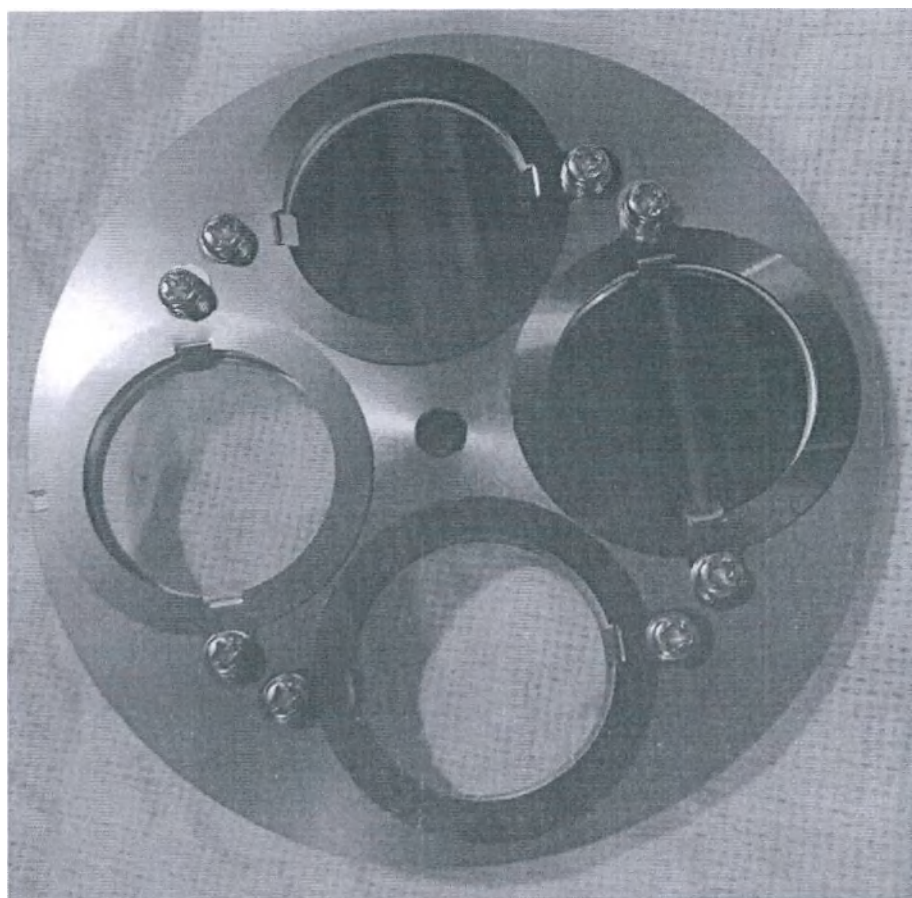


Общий вид изделия

Адаптер камеры двухкомпонентный для функции ICG.




Общий вид изделия в сборе с предустановленной камерой ближнего ИК-диапазона для функции ICG

ИК камера Flovel сверхчувствительная для функции ICG

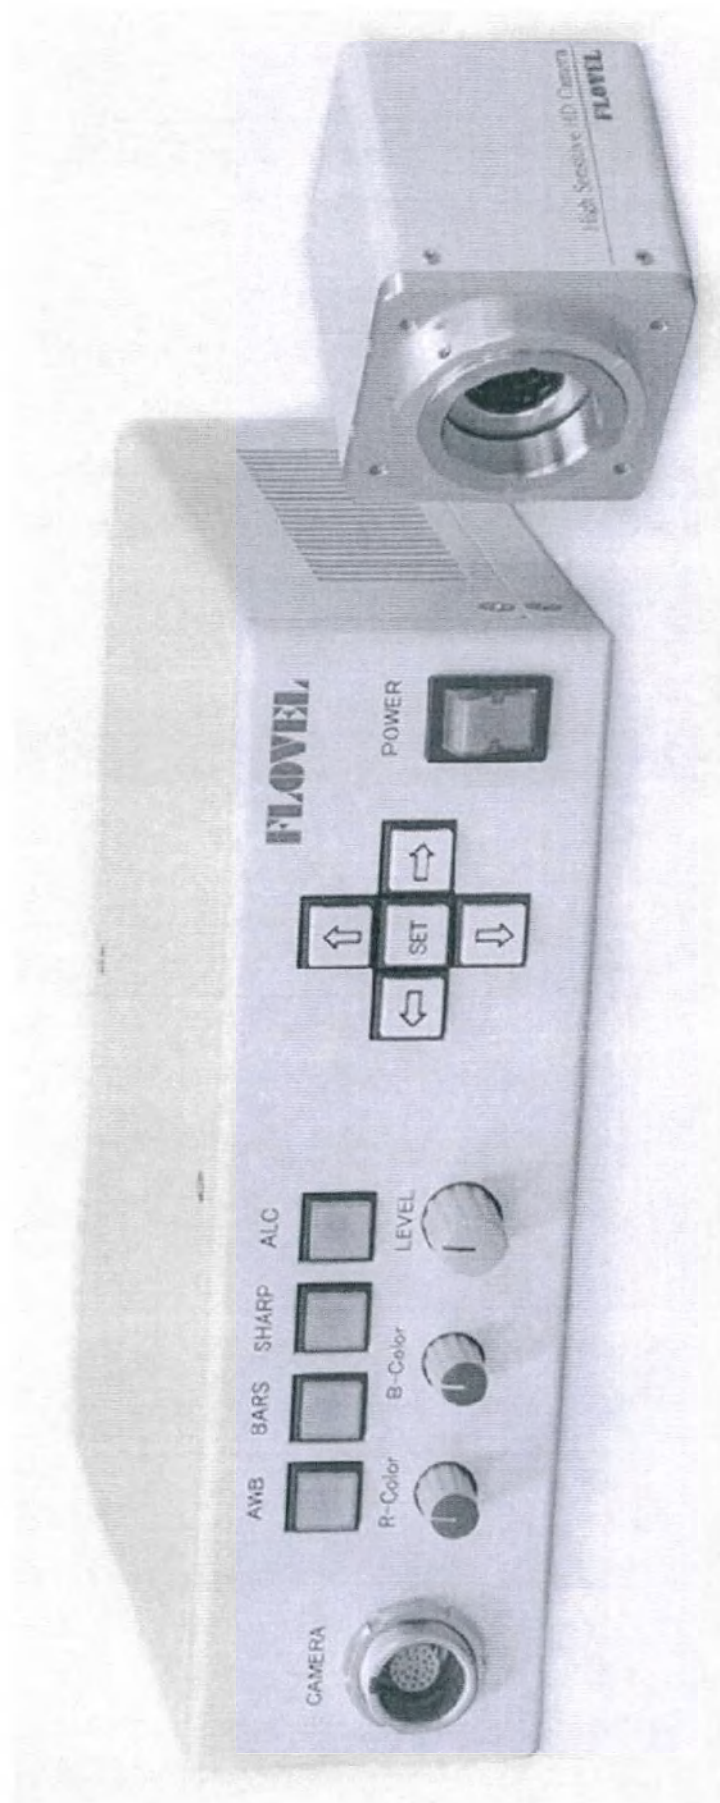


Общий вид изделия

Адаптер двухкомпонентный для камеры Flovel

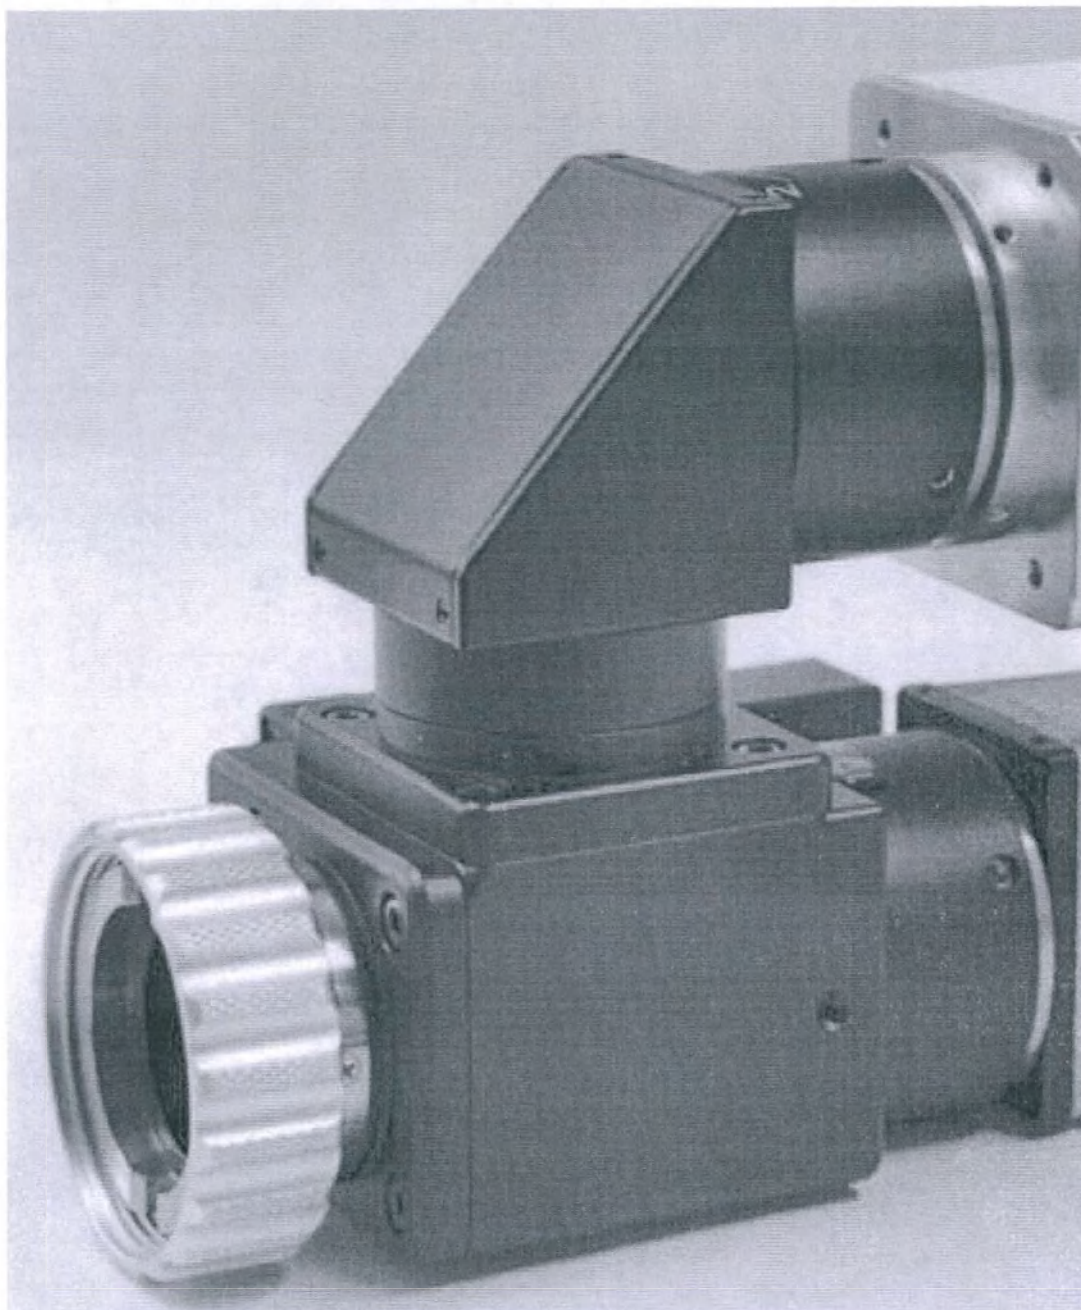


Общий вид изделия

Фильтр 5 ALA для источника света

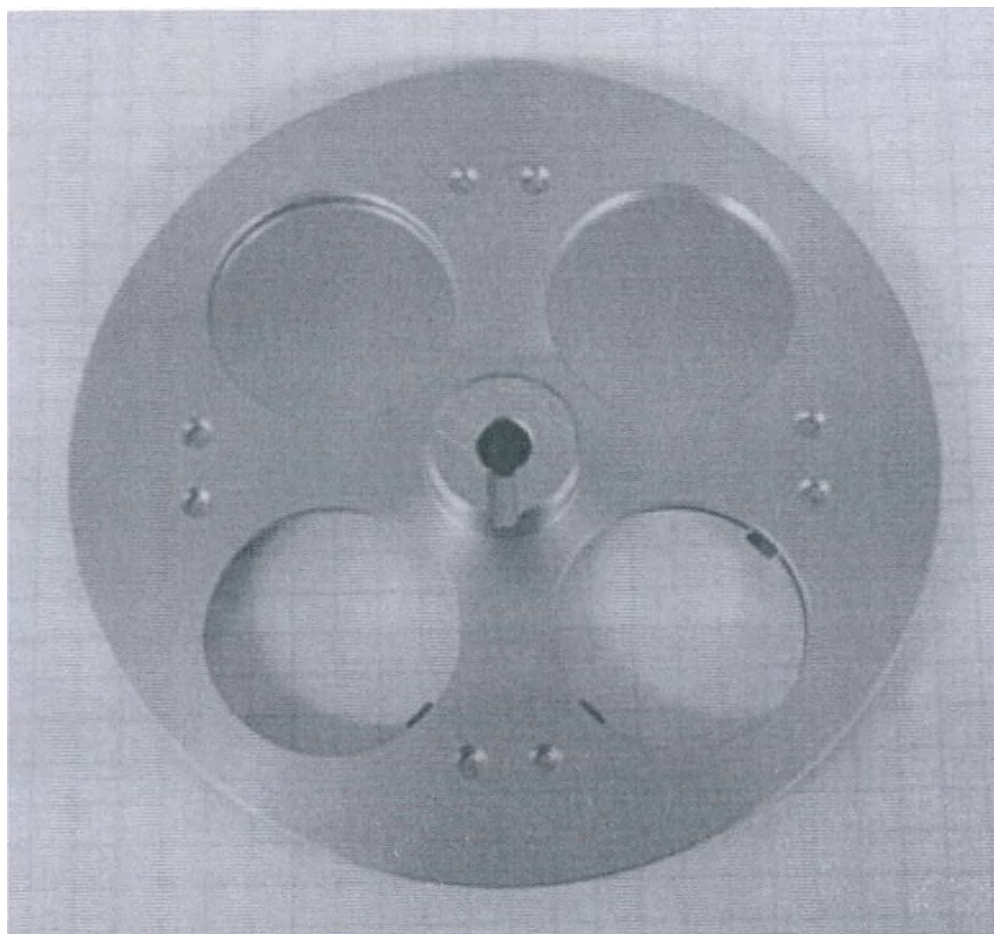


Общий вид изделия

Фильтр FL-Y для источника света

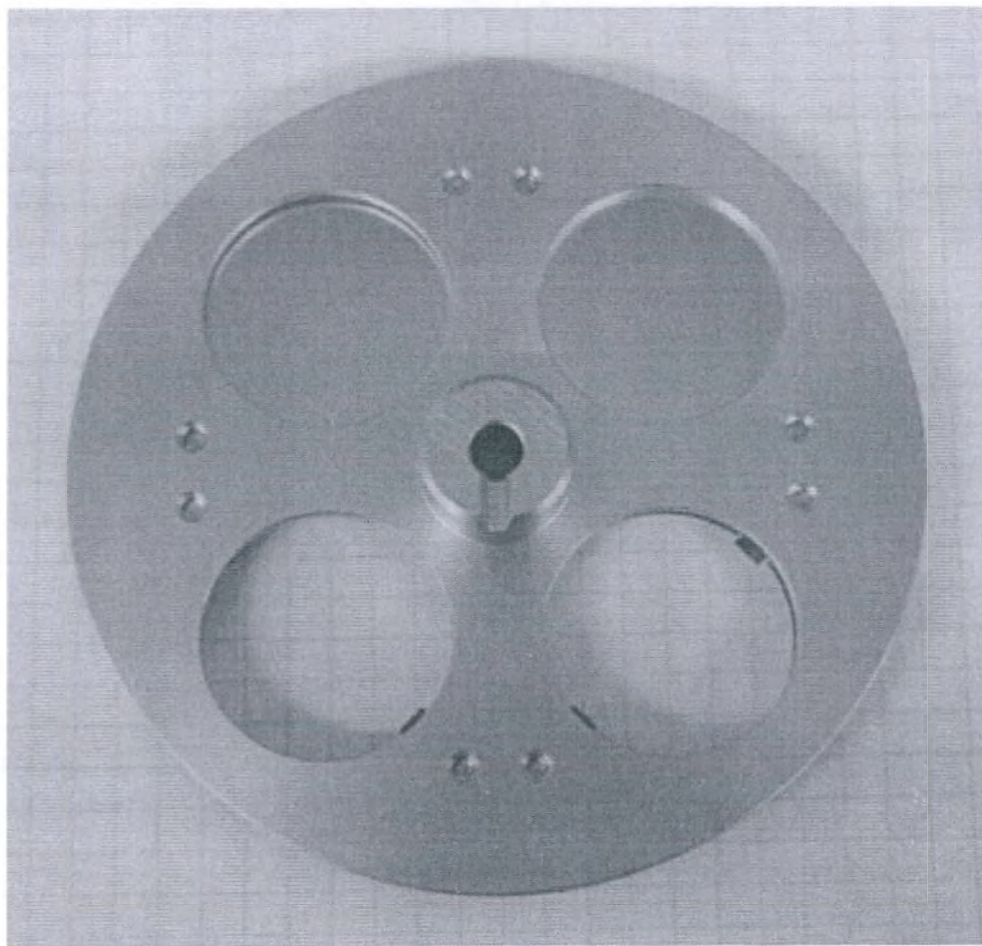


Общий вид изделия

Фильтр FL-Y/5 ALA для микроскопа MM90.

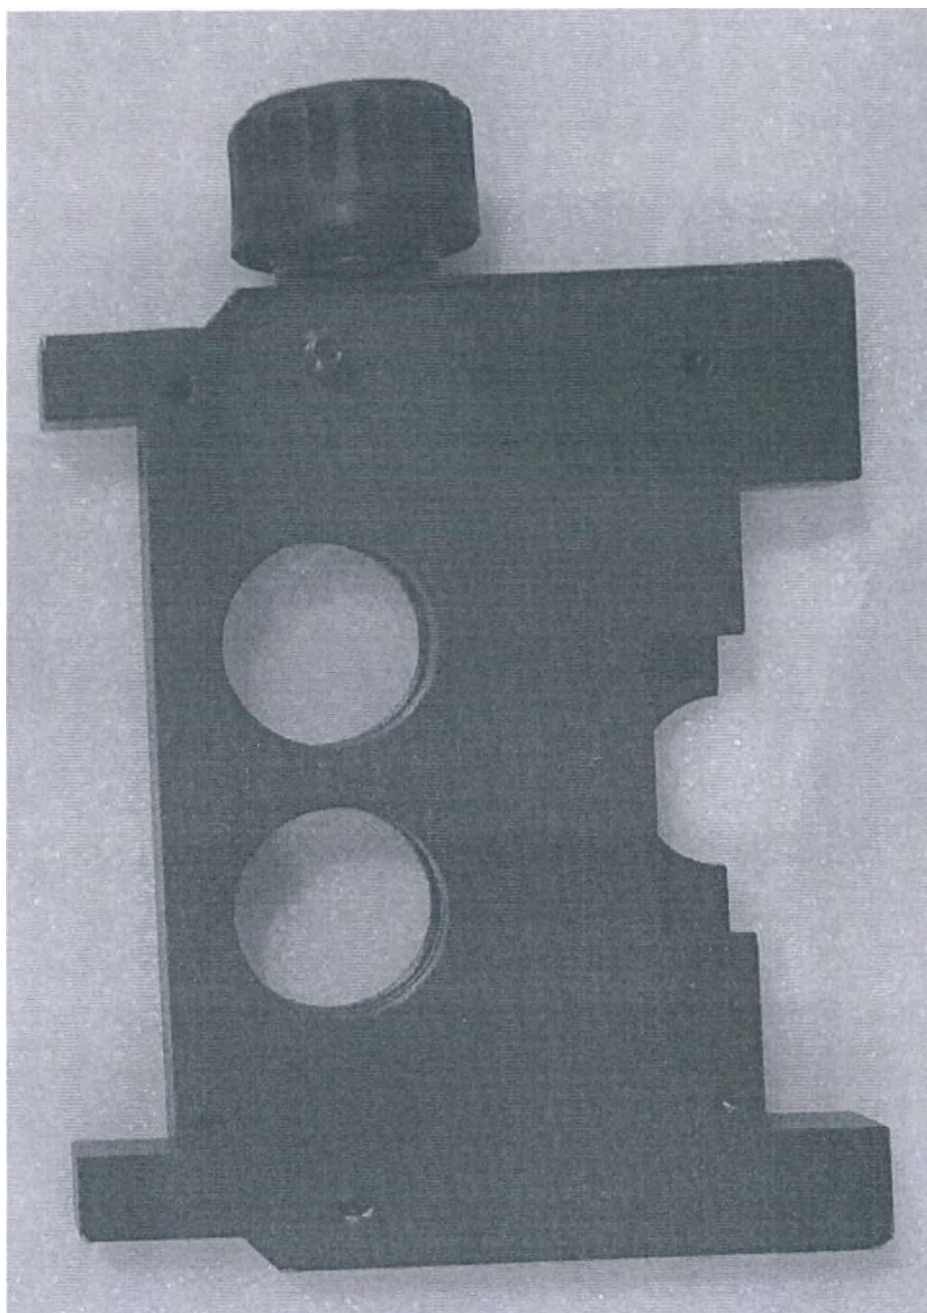


Общий вид изделия

Фильтр FL-Y/5 ALA для микроскопа MM51

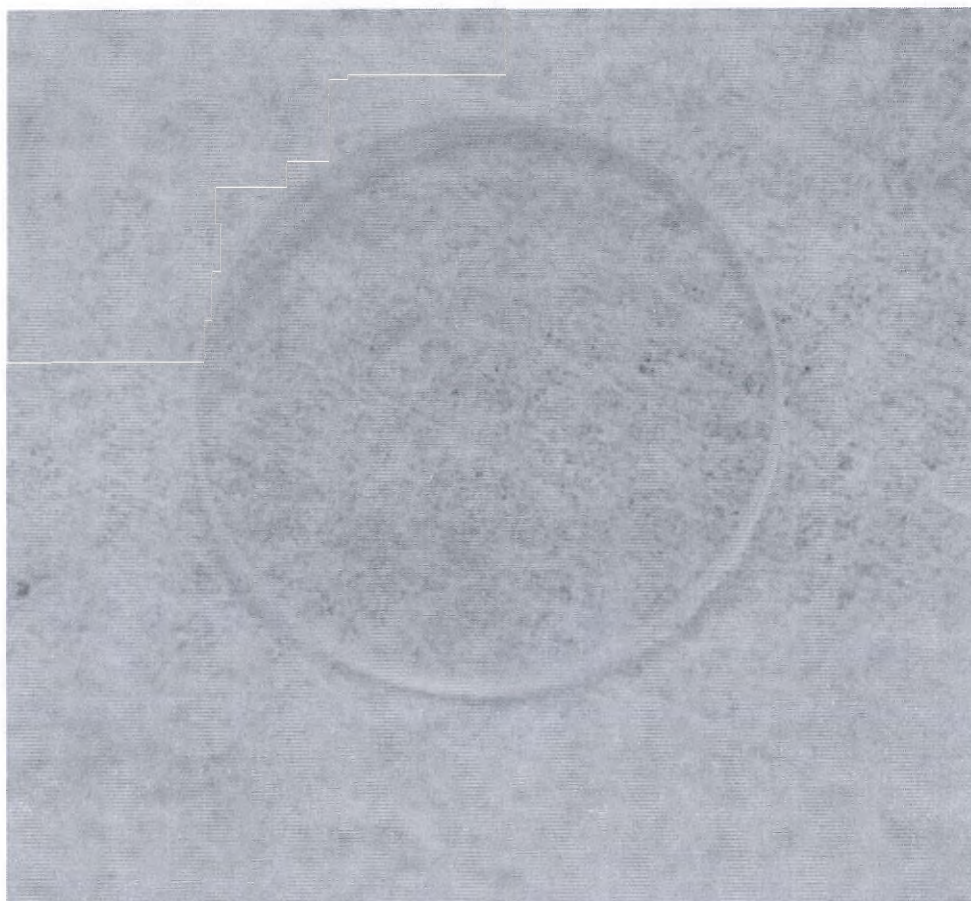


Общий вид изделия

Очки 3D, плёночного типа.

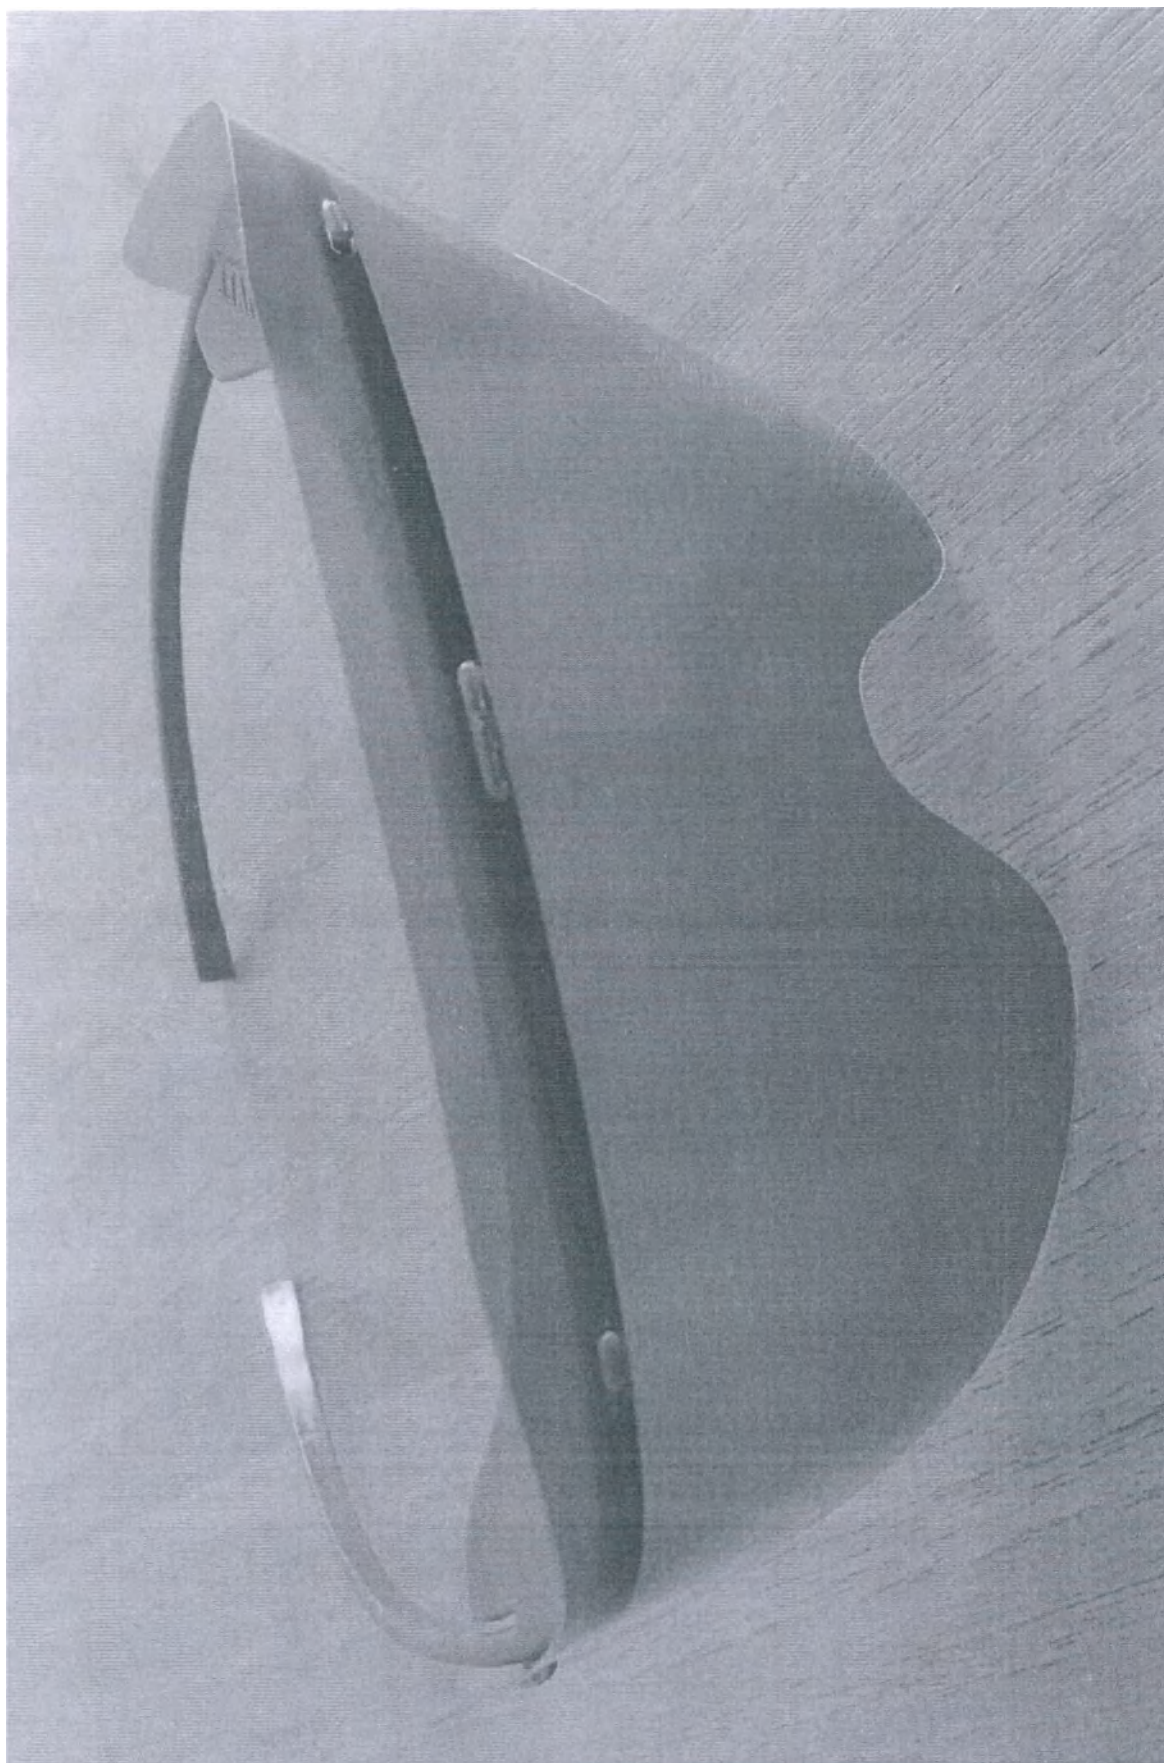

Общий вид изделия

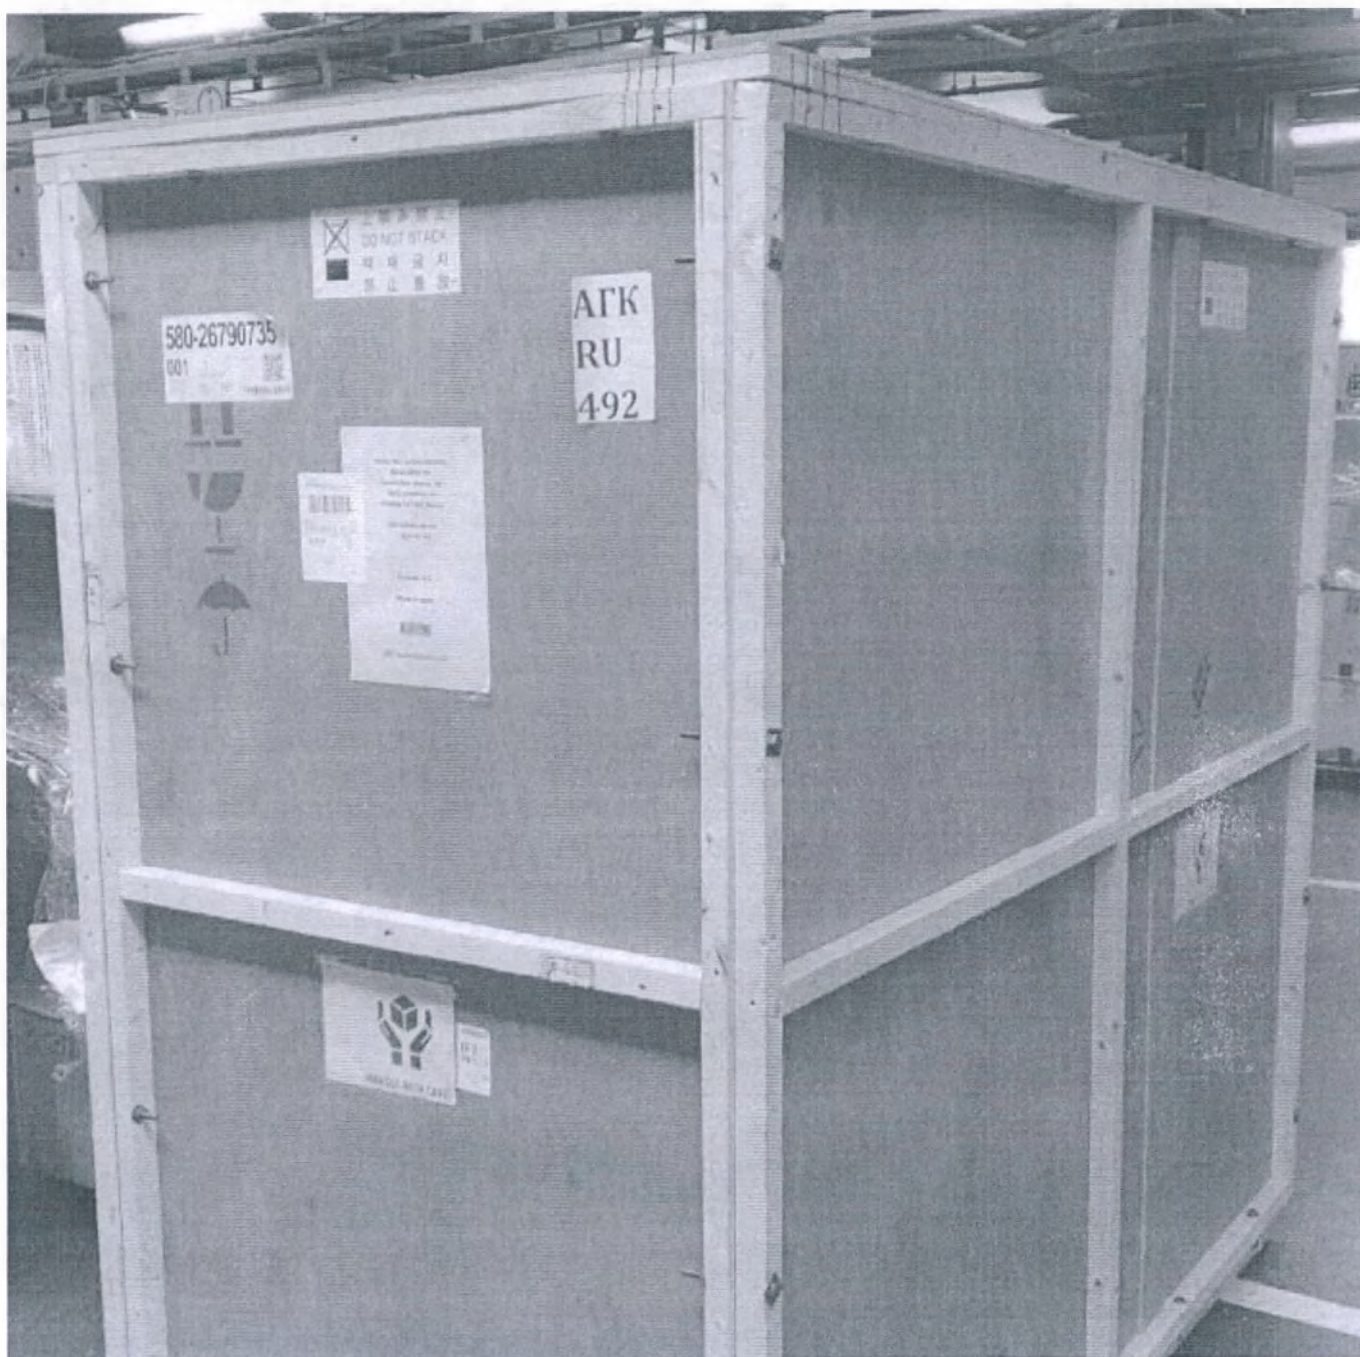

Внешний вид общей коробки для транспортировки микроскопа



Внутренний вид коробки для транспортировки микроскопа

Всего пронумеровано, прошнуровано
и скреплено печатью

84 (восьмидесять четыре) лист 06



Директор Ван /Васильева Л.С./

