



УТВЕРЖДАЮ

Директор ФБУН ГНЦ ПМБ



И.А. Дятлов


2021 г.

Фотографические изображения

**«Набор реагентов для анализа сыворотки или плазмы крови человека на
наличие специфических иммуноглобулинов класса G к нуклеокапсиду вируса
SARS-CoV-2 методом иммуноферментного анализа**

(Набор реагентов «ИФА анти-SARS-CoV-2 IgG»)

по ТУ 21.20.23-356-78095326-2021, Серия 07»

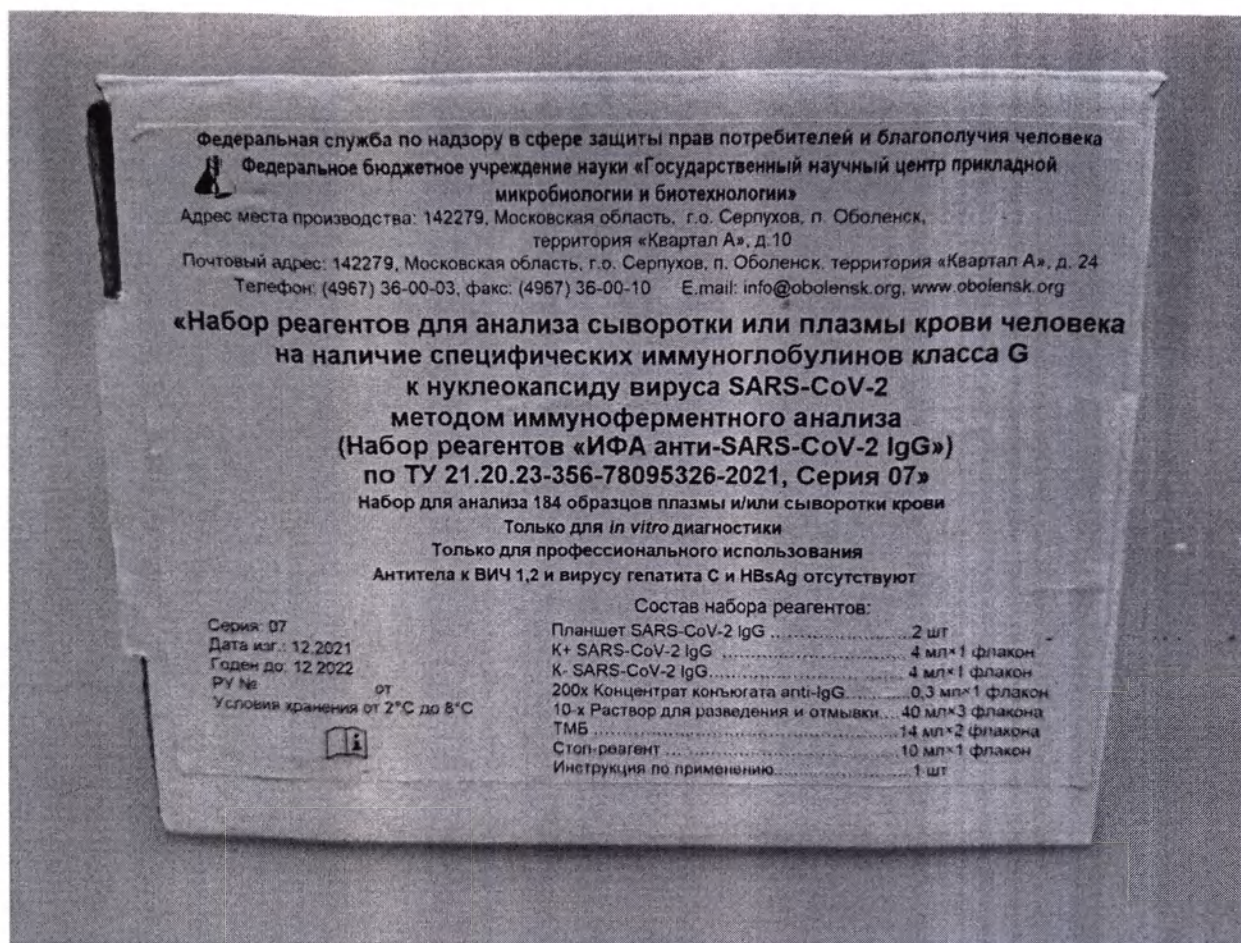

а) фотоизображение набора реагентов в упаковке

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
 Федеральное бюджетное учреждение науки «Государственный научный центр прикладной микробиологии и биотехнологии»
 Адрес места производства: 142279, Московская область, г.о. Серпухов, п. Оболенск, территория «Квартал А», д. 10
 Почтовый адрес: 142279, Московская область, г.о. Серпухов, п. Оболенск, территория «Квартал А», д. 24
 Телефон: (4967) 36-00-03, факс: (4967) 36-00-10 E.mail: info@obolensk.org, www.obolensk.org


«Набор реагентов для анализа сыворотки или плазмы крови человека на наличие специфических иммуноглобулинов класса G к нуклеокапсиду вируса SARS-CoV-2 методом иммуноферментного анализа (Набор реагентов «ИФА анти-SARS-CoV-2 IgG») по ТУ 21.20.23-356-78095326-2021, Серия 07»
 Набор для анализа 184 образцов плазмы и/или сыворотки крови
 Только для *in vitro* диагностики
 Только для профессионального использования
 Антитела к ВИЧ 1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

Серия: 07
 Дата изг.: 12.2021
 Годен до: 12.2022
 РУ № от
 Условия хранения от 2°C до 8°C


Состав набора реагентов:

Планшет SARS-CoV-2 IgG	2 шт
K+ SARS-CoV-2 IgG	4 мл×1 флакон
K- SARS-CoV-2 IgG	4 мл×1 флакон
200x Концентрат конъюгата anti-IgG	0,3 мл×1 флакон
10-х Раствор для разведения и отмывки	40 мл×3 флакона
ТМБ	14 мл×2 флакона
Стоп-реагент	10 мл×1 флакон
Инструкция по применению	1 шт

маркировка упаковки набора реагентов

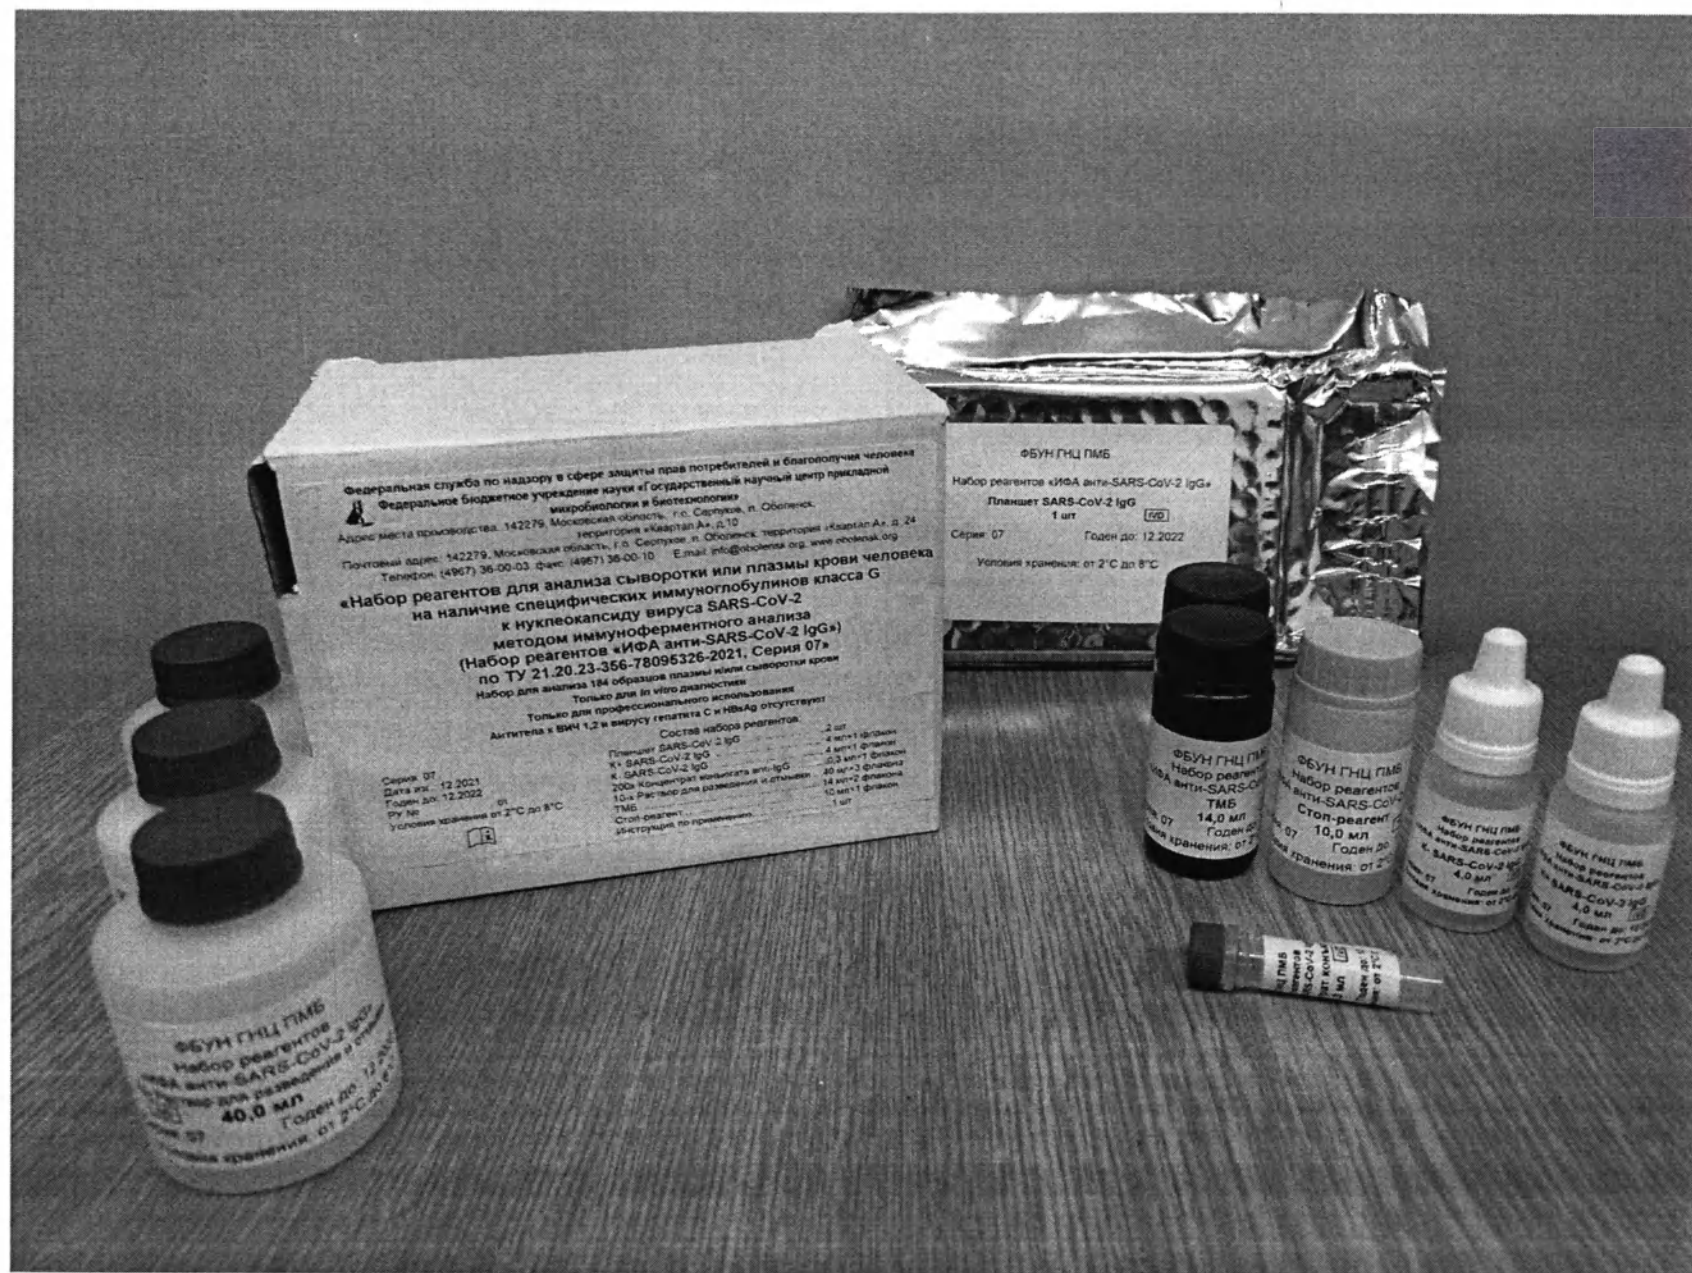


б) фотоизображение компонентов набора реагентов

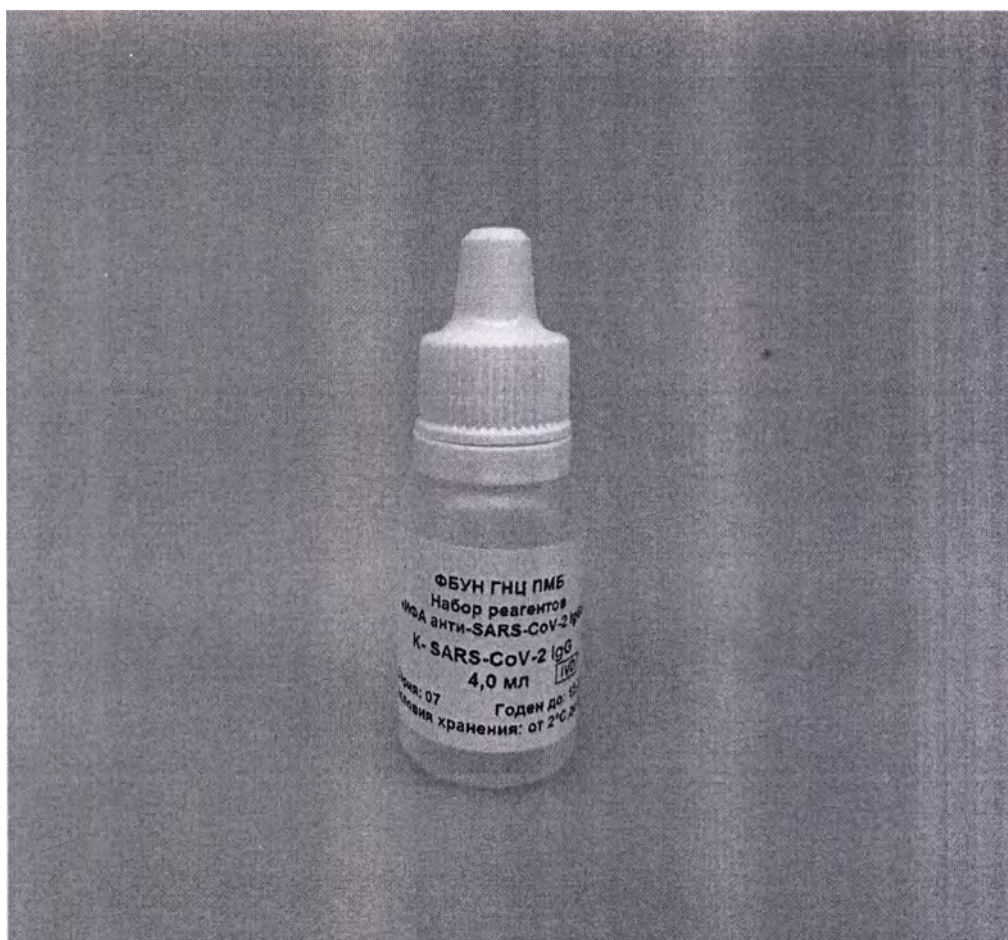

в) фотоизображение компонента К- SARS-CoV-2 IgG

ФБУН ГНЦ ПМБ
Набор реагентов
«ИФА анти-SARS-CoV-2 IgG»
К- SARS-CoV-2 IgG
4,0 мл IVB
Серия: 07 Годен до: 12.2022
Условия хранения: от 2°C до 8°C


маркировка компонента К- SARS-CoV-2 IgG

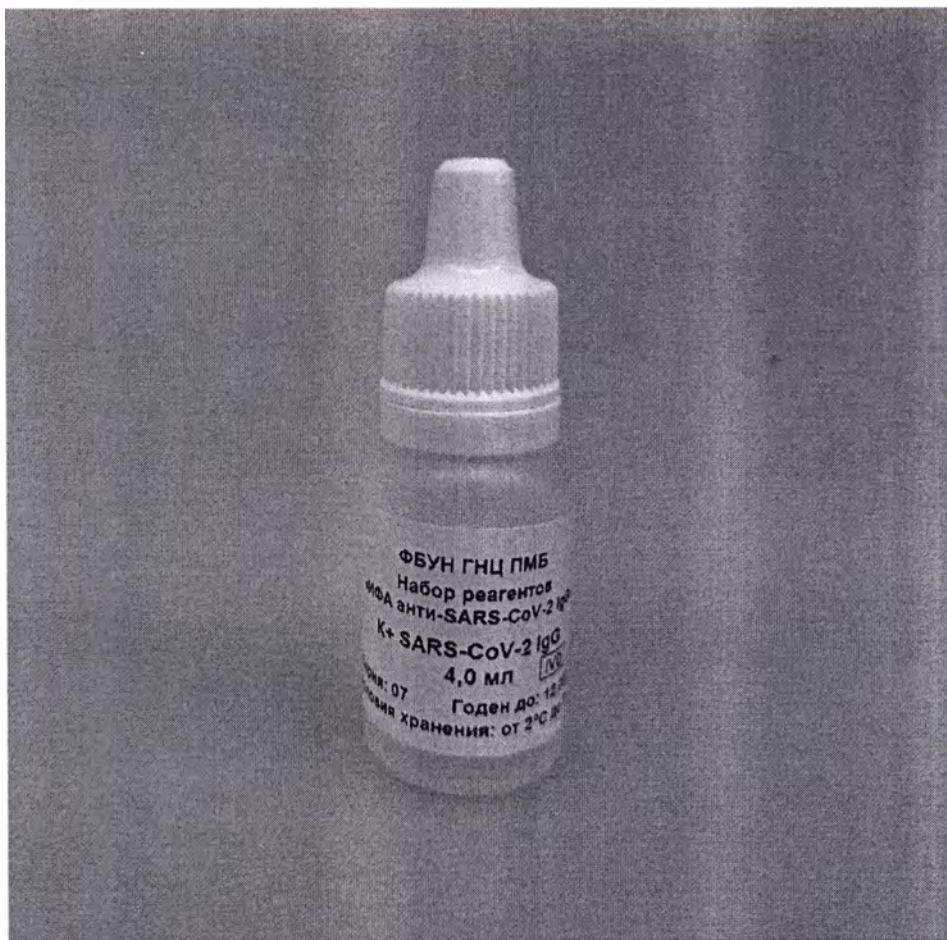

г) фотоизображение компонента K+ SARS-CoV-2 IgG

ФБУН ГИЦ ПМБ
Набор реагентов
«ИФА анти-SARS-CoV-2 IgG»
K+ SARS-CoV-2 IgG
4,0 мл IVF
Серия: 07 Годен до: 12.2022
Условия хранения: от 2°C до 8°C


маркировка компонента K-+SARS-CoV-2 IgG

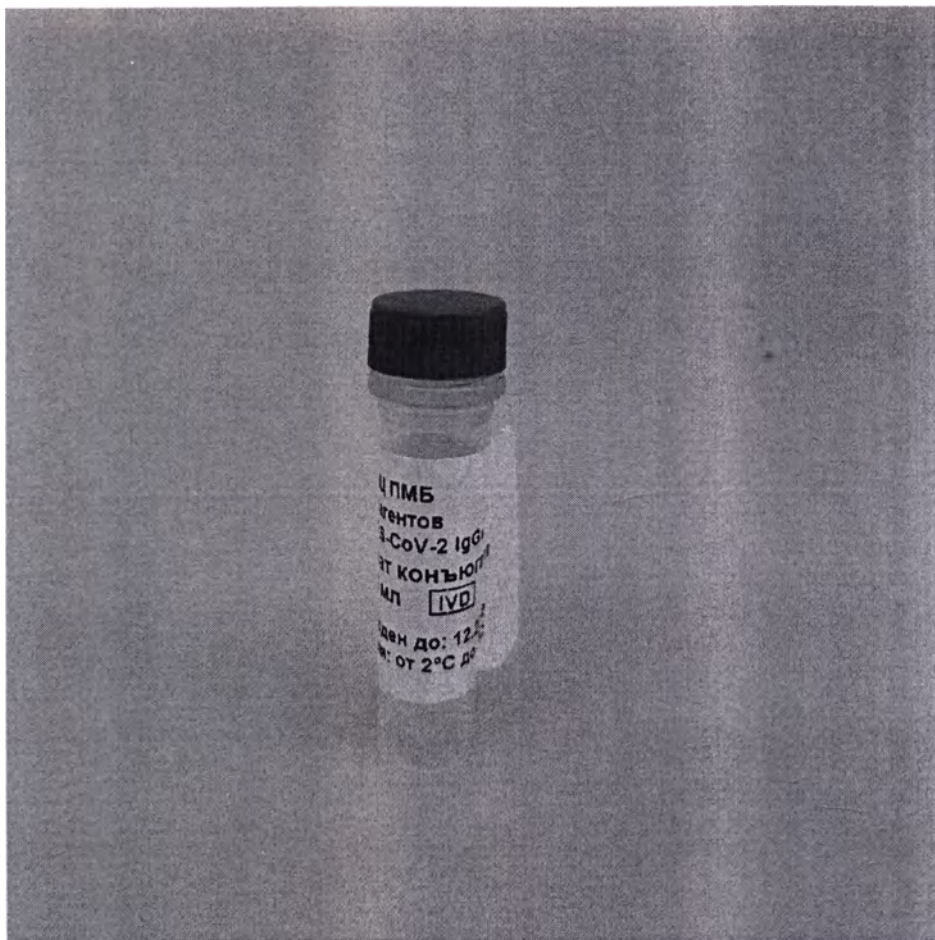

д) Фотоизображение компонента Концентрат конъюгата anti-IgG

ФБУН ГИЦ ЦПМБ
Набор реактивов
«ИФА анти-SARS-CoV-2 IgG»
200x Концентрат конъюгата
anti-IgG 0,3 мл IVD
Серия: 07 Годен до: 12.2022
Условия хранения: от 2°C до 8°C


маркировка компонента Концентрат конъюгата anti-IgG

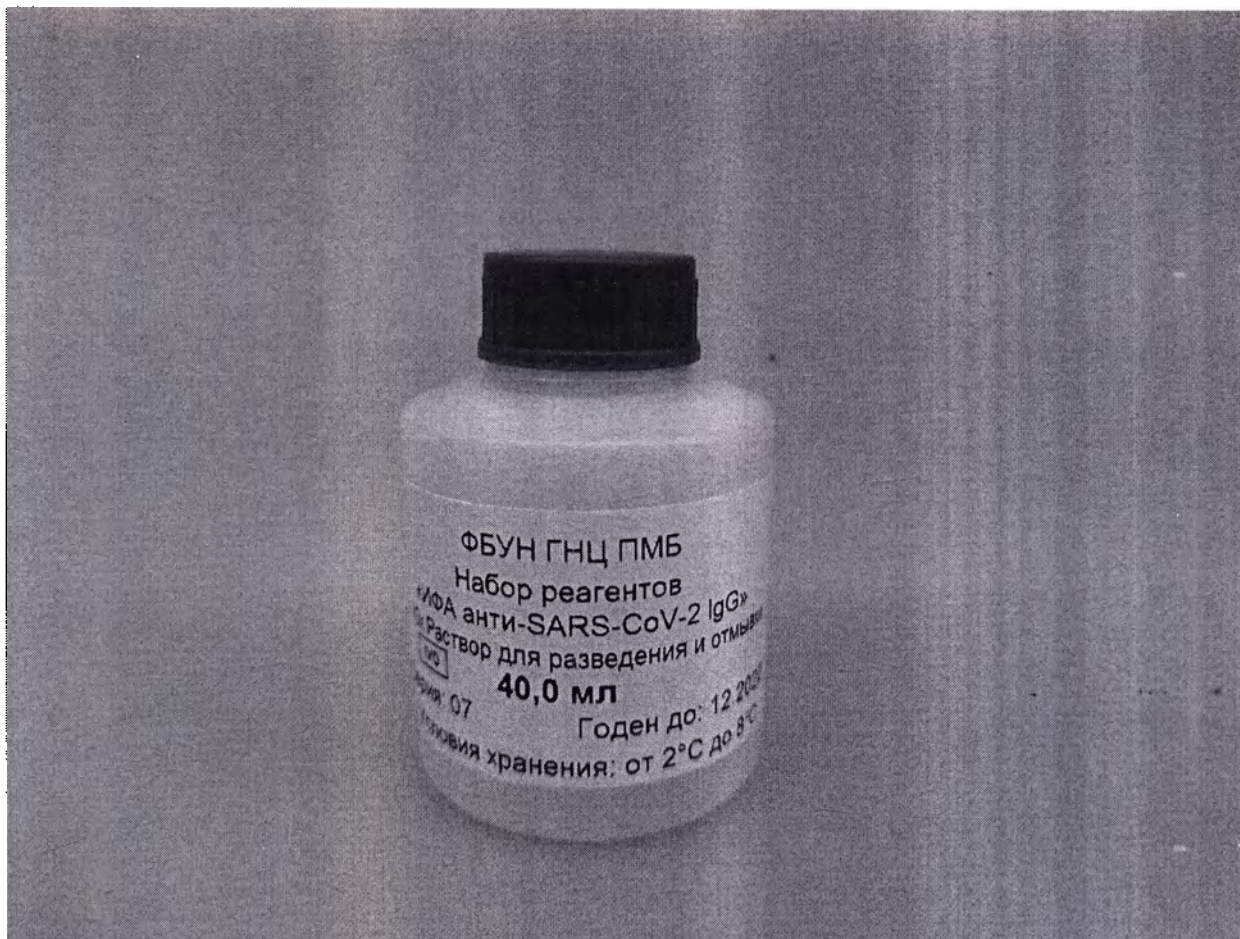

ж) фотоизображение компонента Раствор для разведения и отмывки

ФБУН ГНЦ ПМБ
Набор реагентов
«ИФА анти-SARS-CoV-2 IgG»
10x Раствор для разведения и отмывки
40,0 мл
Серия: 07 Годен до: 12.2022
Условия хранения: от 2°C до 8°C


маркировка компонента Раствор для разведения и отмывки

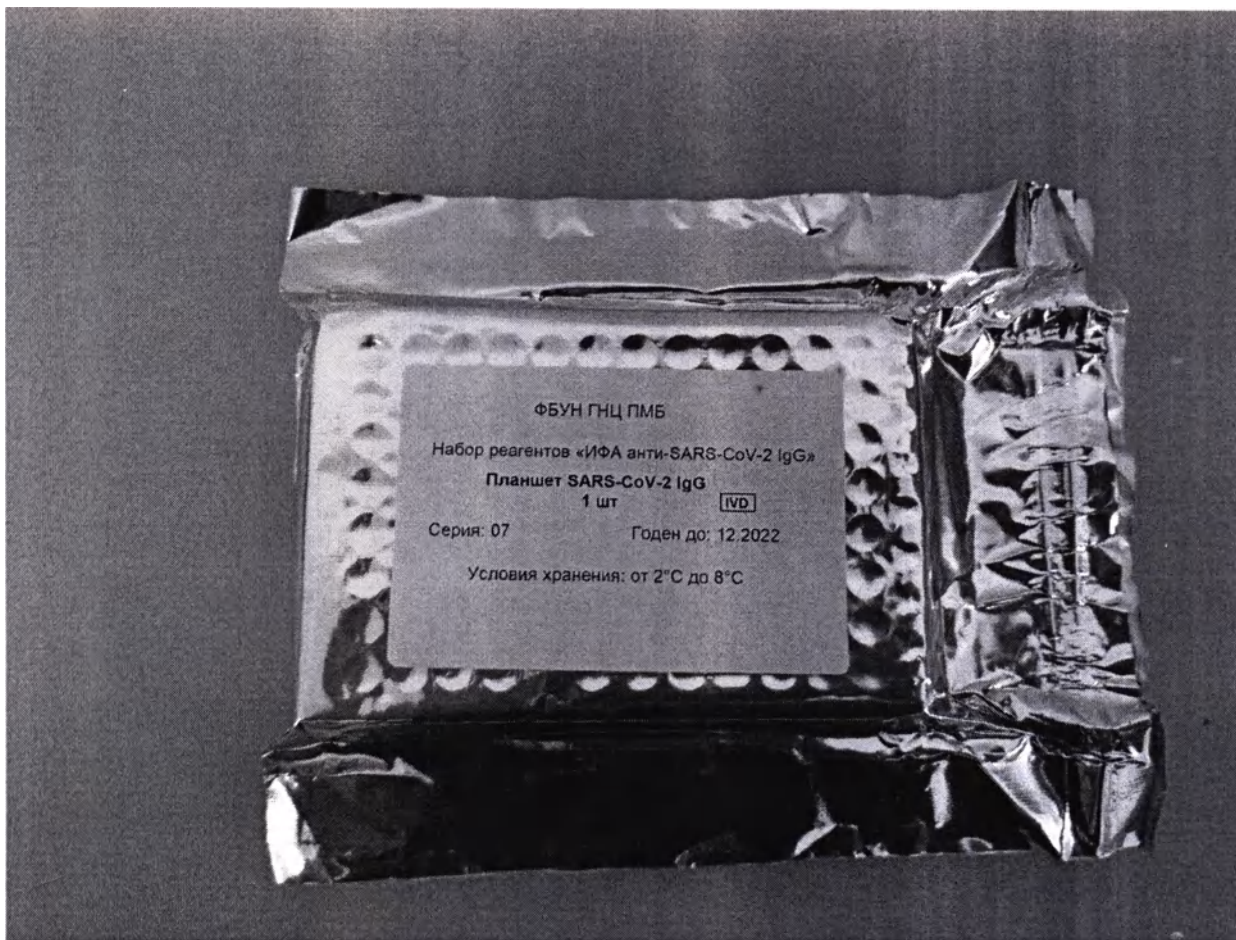

з) фотоизображение компонента Планшет SARS-CoV-2 IgG

ФБУН ГНЦ ПМБ
Набор реагентов «ИФА анти-SARS-CoV-2 IgG»
Планшет SARS-CoV-2 IgG
1 шт **IVD**
Серия: 07 **Годен до: 12.2022**
Условия хранения: от 2°C до 8°C


маркировка компонента Планшет SARS-CoV-2 IgG

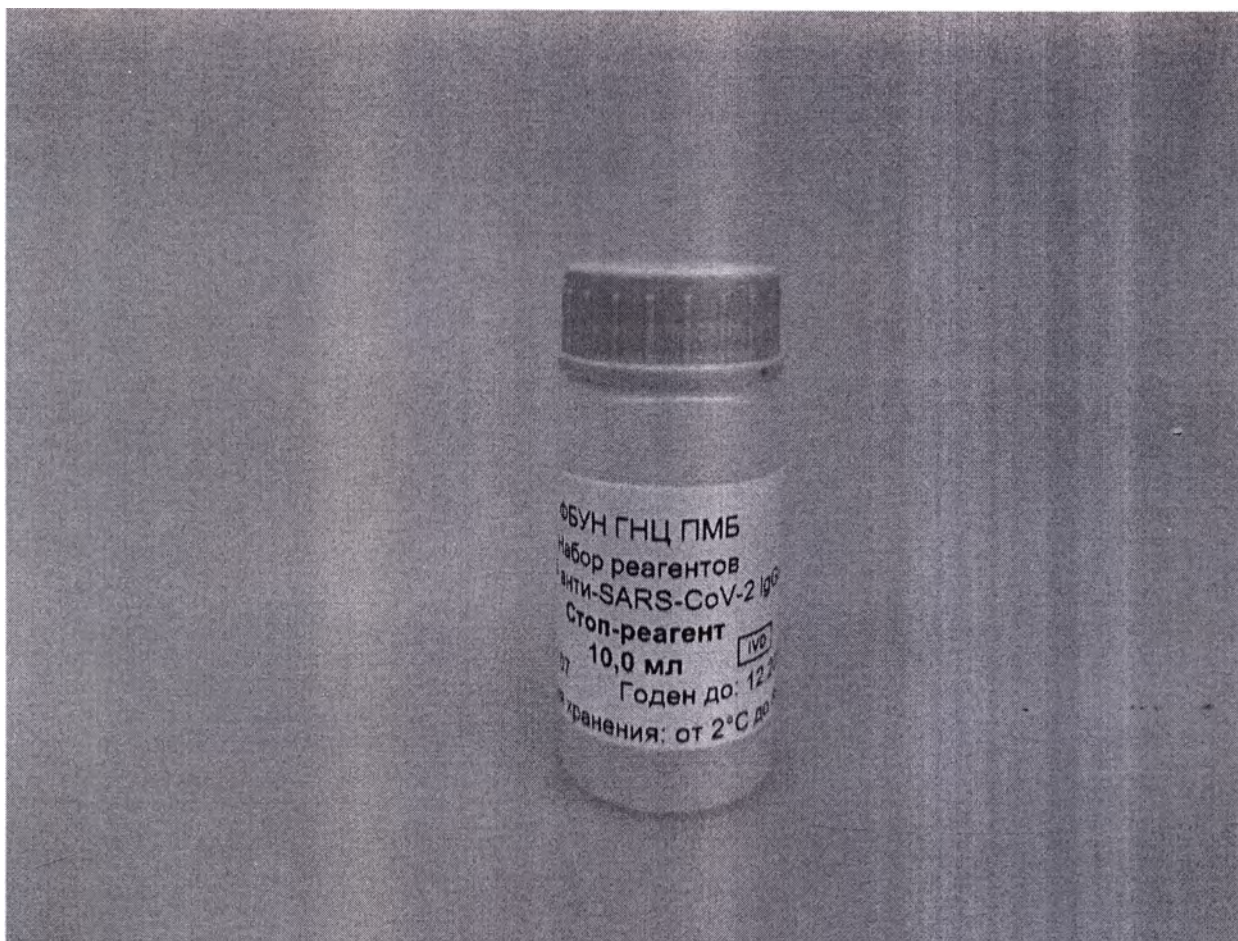

и) фотоизображение компонента Стоп-реагент

ФБУН ГНЦ ПМБ
 Набор реагентов
 «ИФА анти-SARS-CoV-2 IgG»
 Стоп-реагент
 10,0 мл IVD
 Серия: 07 Годен до: 12.2022
 Условия хранения: от 2°C до 8°C

маркировка компонента Стоп-реагент

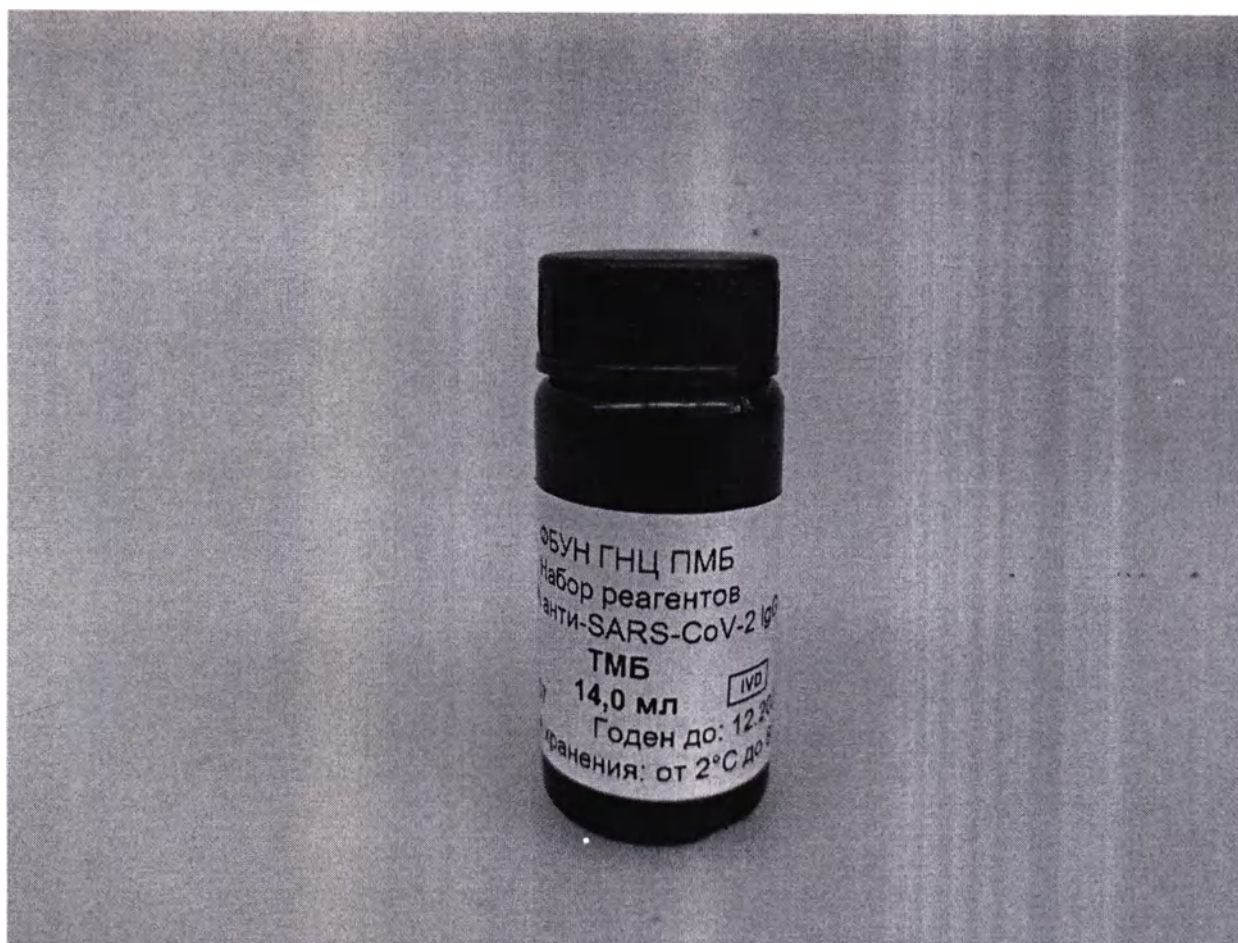

к) фотоизображение компонента ТМБ

ФБУН ГНЦ ПМБ
 Набор реагентов
 «ИФА анти-SARS-CoV-2 IgG»
 ТМБ
 14,0 мл ИВД
 Серия: 07 Годен до: 12.2022
 Условия хранения: от 2°C до 8°C

маркировка компонента ТМБ

Пронумеровано, прошнуровано,
скреплено подписью и печатью

9 (966-811)

листов. Подпись

" 28 "

12

2021 г.

(Подпись)

