

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор  
ЗАО «ИММУНОСКРИН»




Н. С. Осин

«01» июня 2018 г.

**Фотографические изображения  
медицинского изделия**


**НАБОР РЕАГЕНТОВ  
ДЛЯ КОЛИЧЕСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ СВОБОДНОЙ  
β-ЦЕПИ ХОРИОНИЧЕСКОГО ГОНАДОТРОПИНА  
(β-ХГч) В СЫВОРОТКЕ КРОВИ ЧЕЛОВЕКА МЕТОДОМ  
ЛАНТАНИДНОГО ИММУНОФЛУ-ОРЕСЦЕНТНОГО АНАЛИЗА  
«β-ХГч-ЛИФА»**

2019 г.

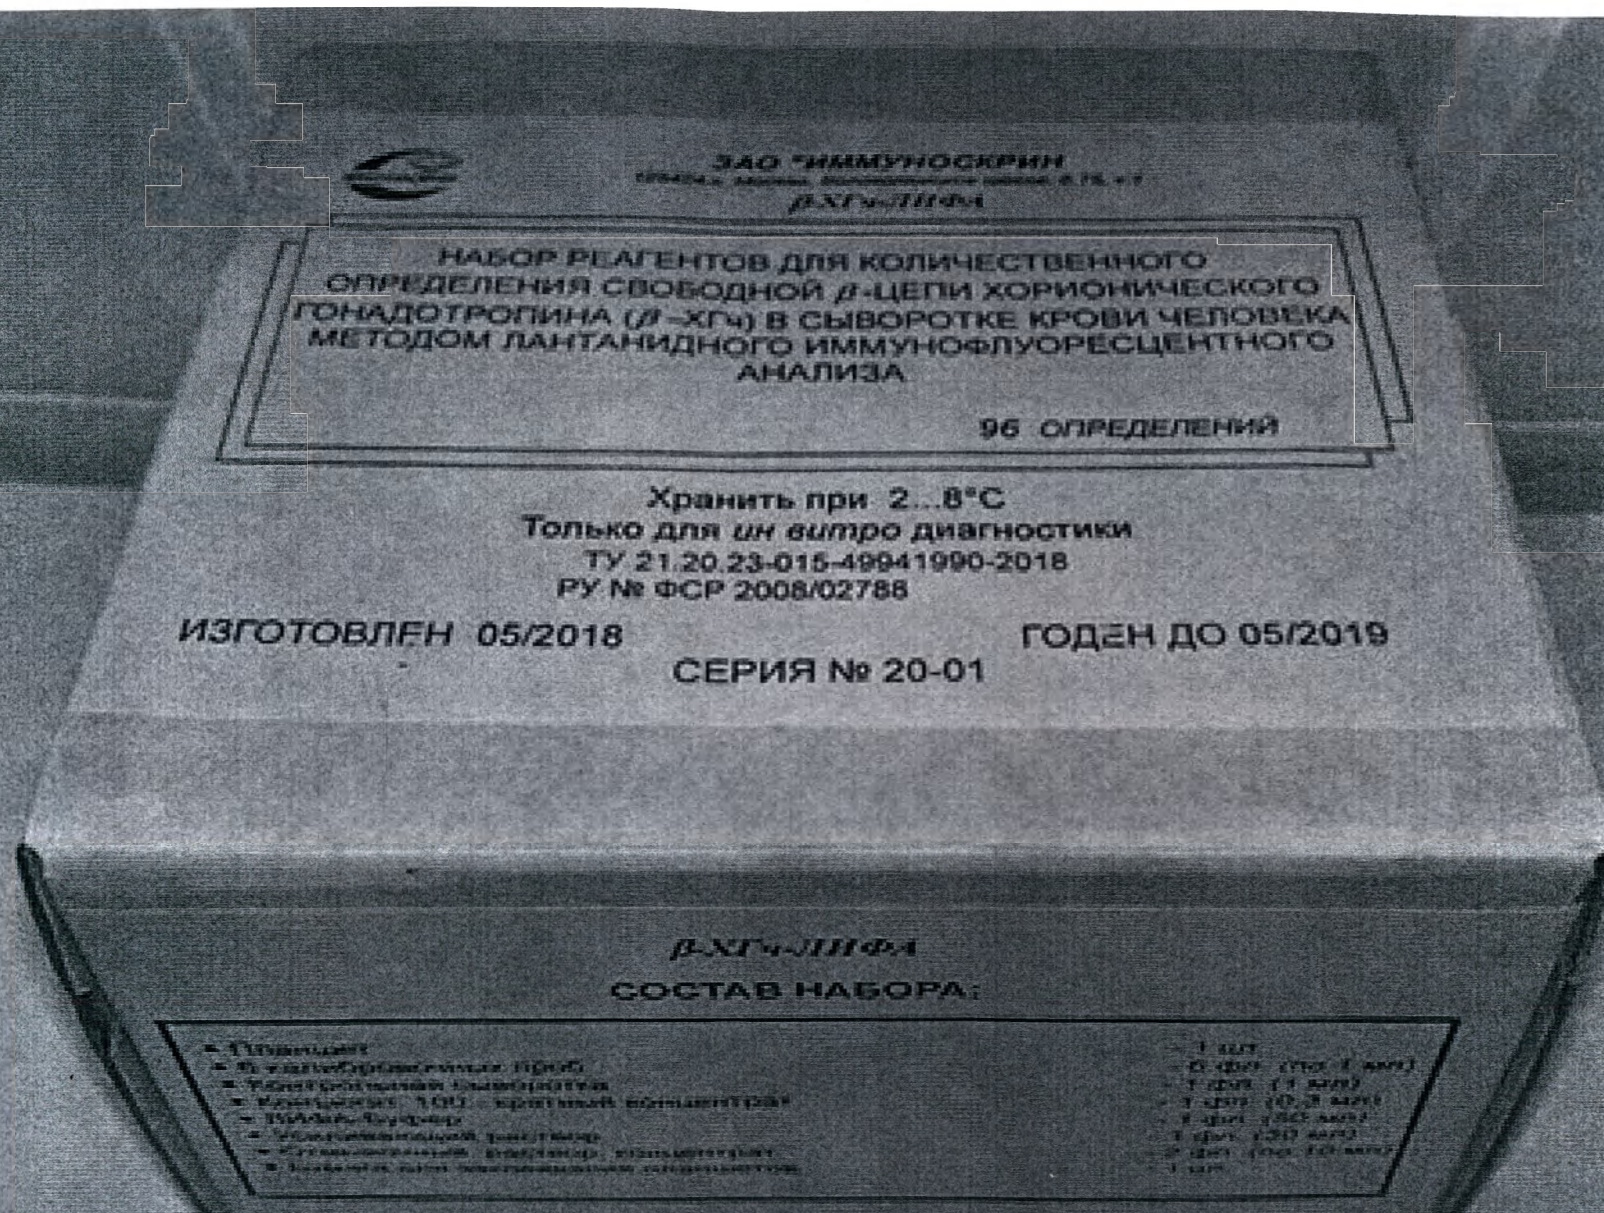


Набор реагентов для количественного определения свободной  $\beta$ -цепи хорионического гонадотропина ( $\beta$ -ХГч) в сыворотке крови человека методом лантанидного иммунофлуоресцентного анализа « $\beta$ -ХГч-ЛИФА» по ТУ 21.20.23-015-49941990-2018 *Общий вид в коробке*

Общий вид в открытой коробке

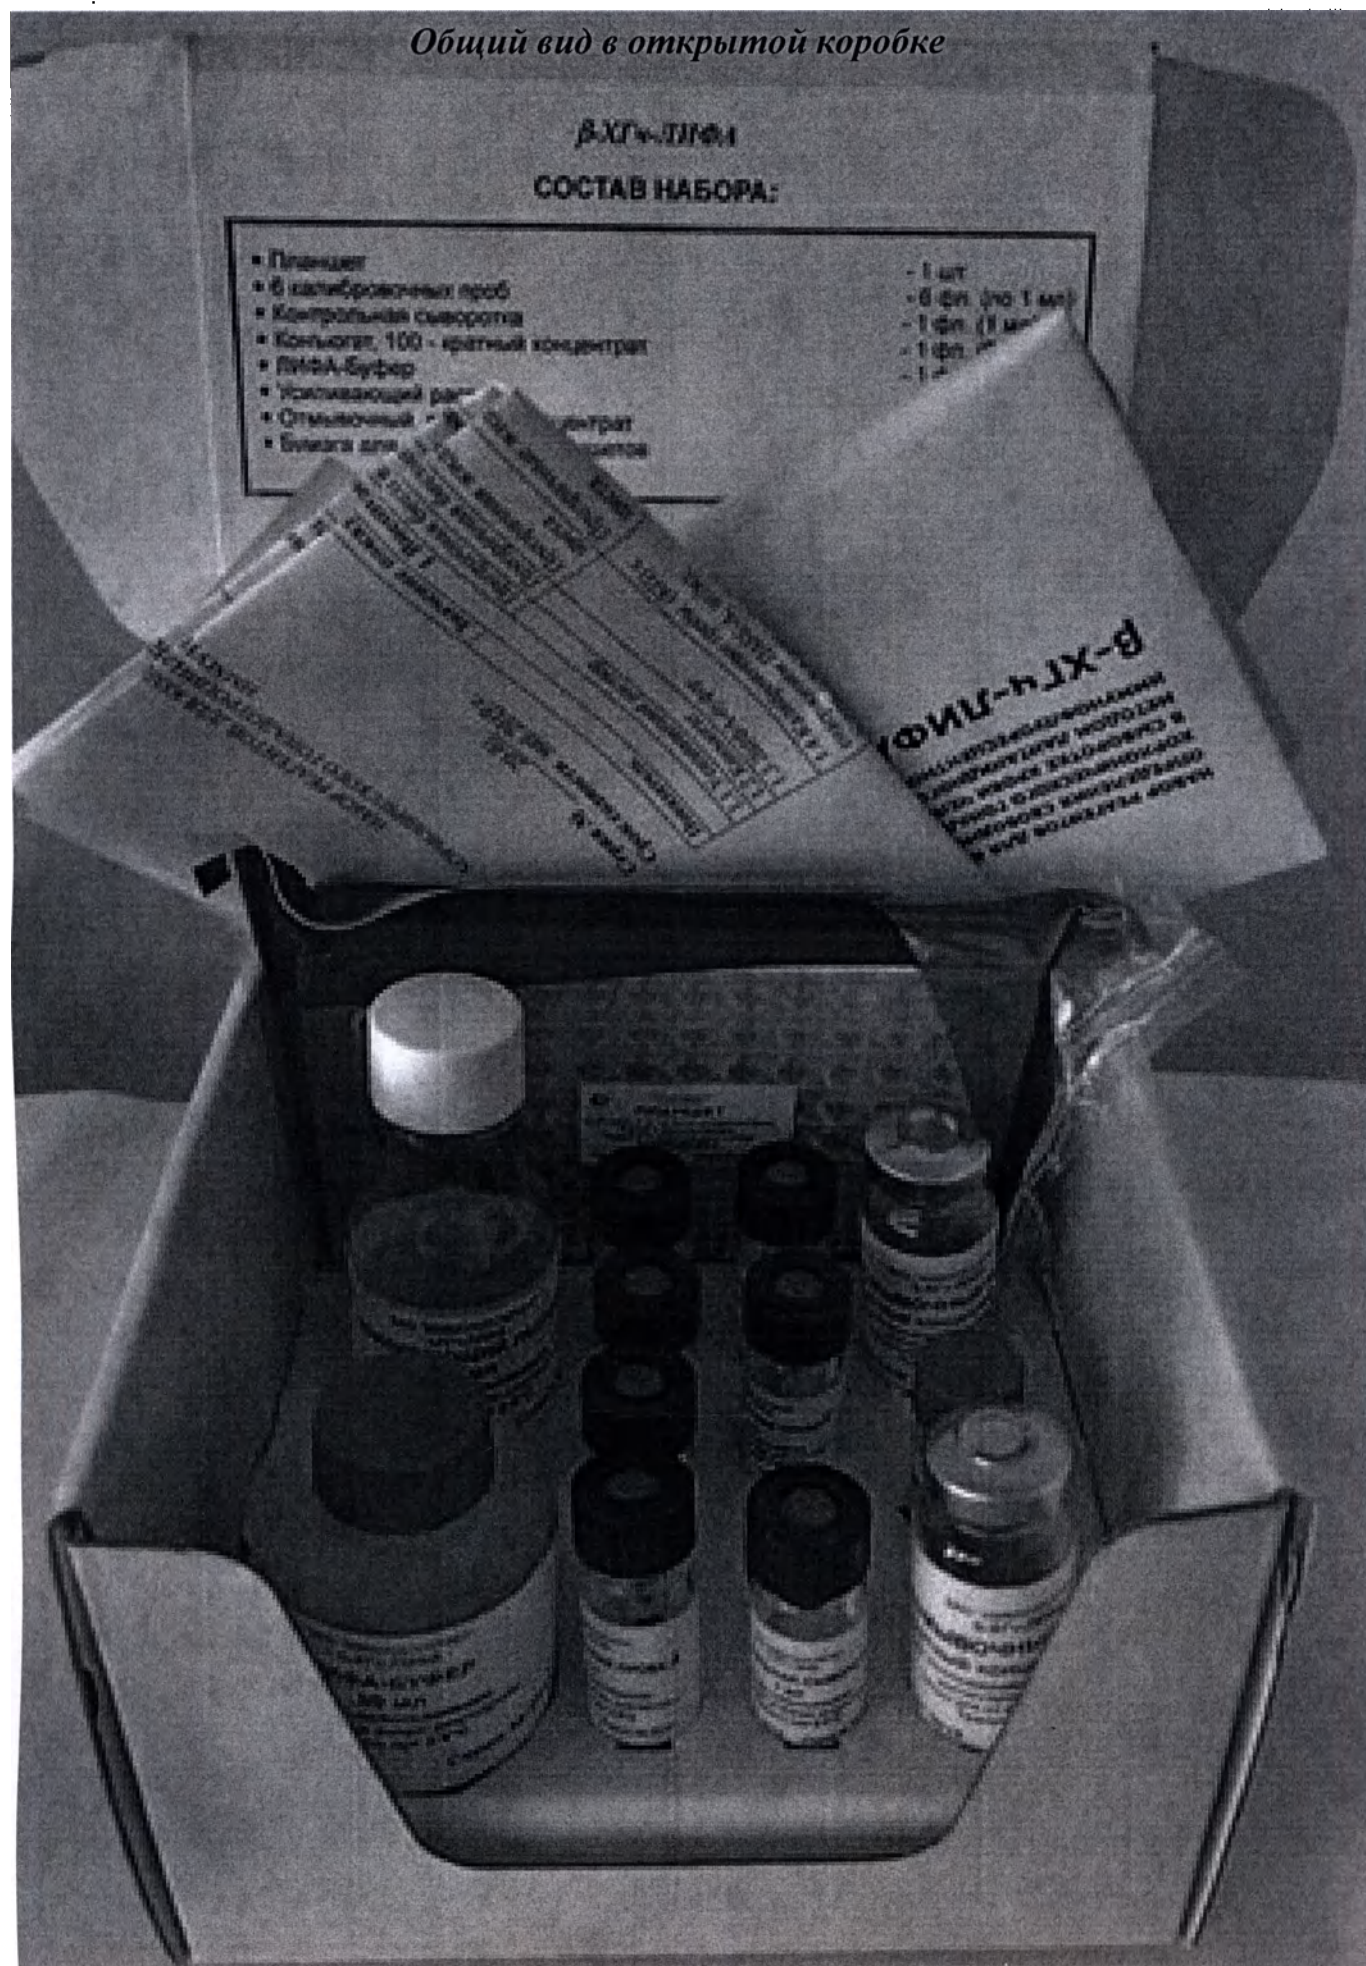


Общее фото набора



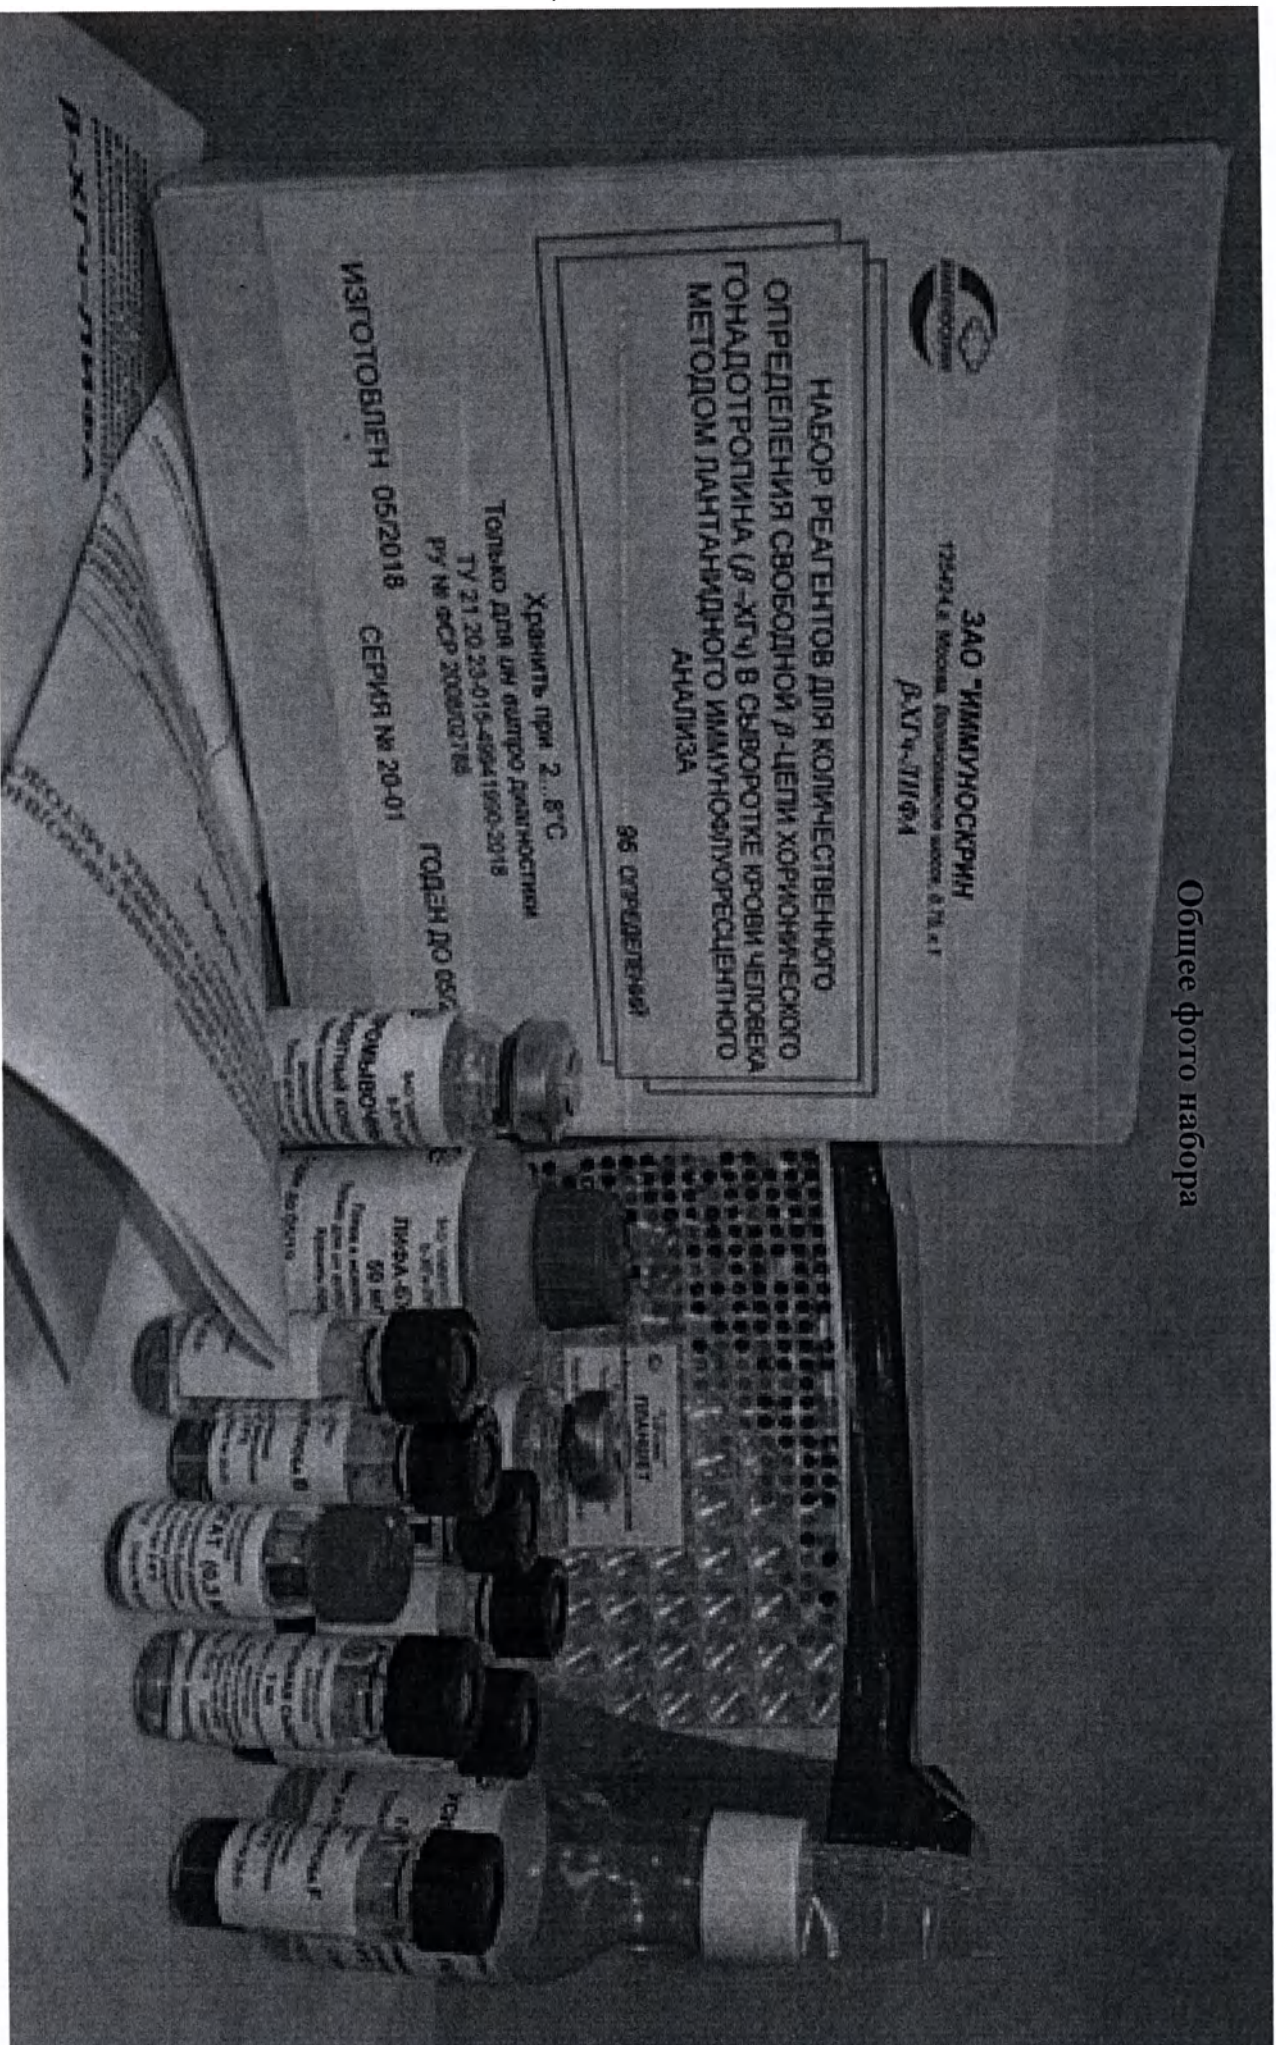


**Состав (набор для 96 определений)**




Планшет - 1 шт.

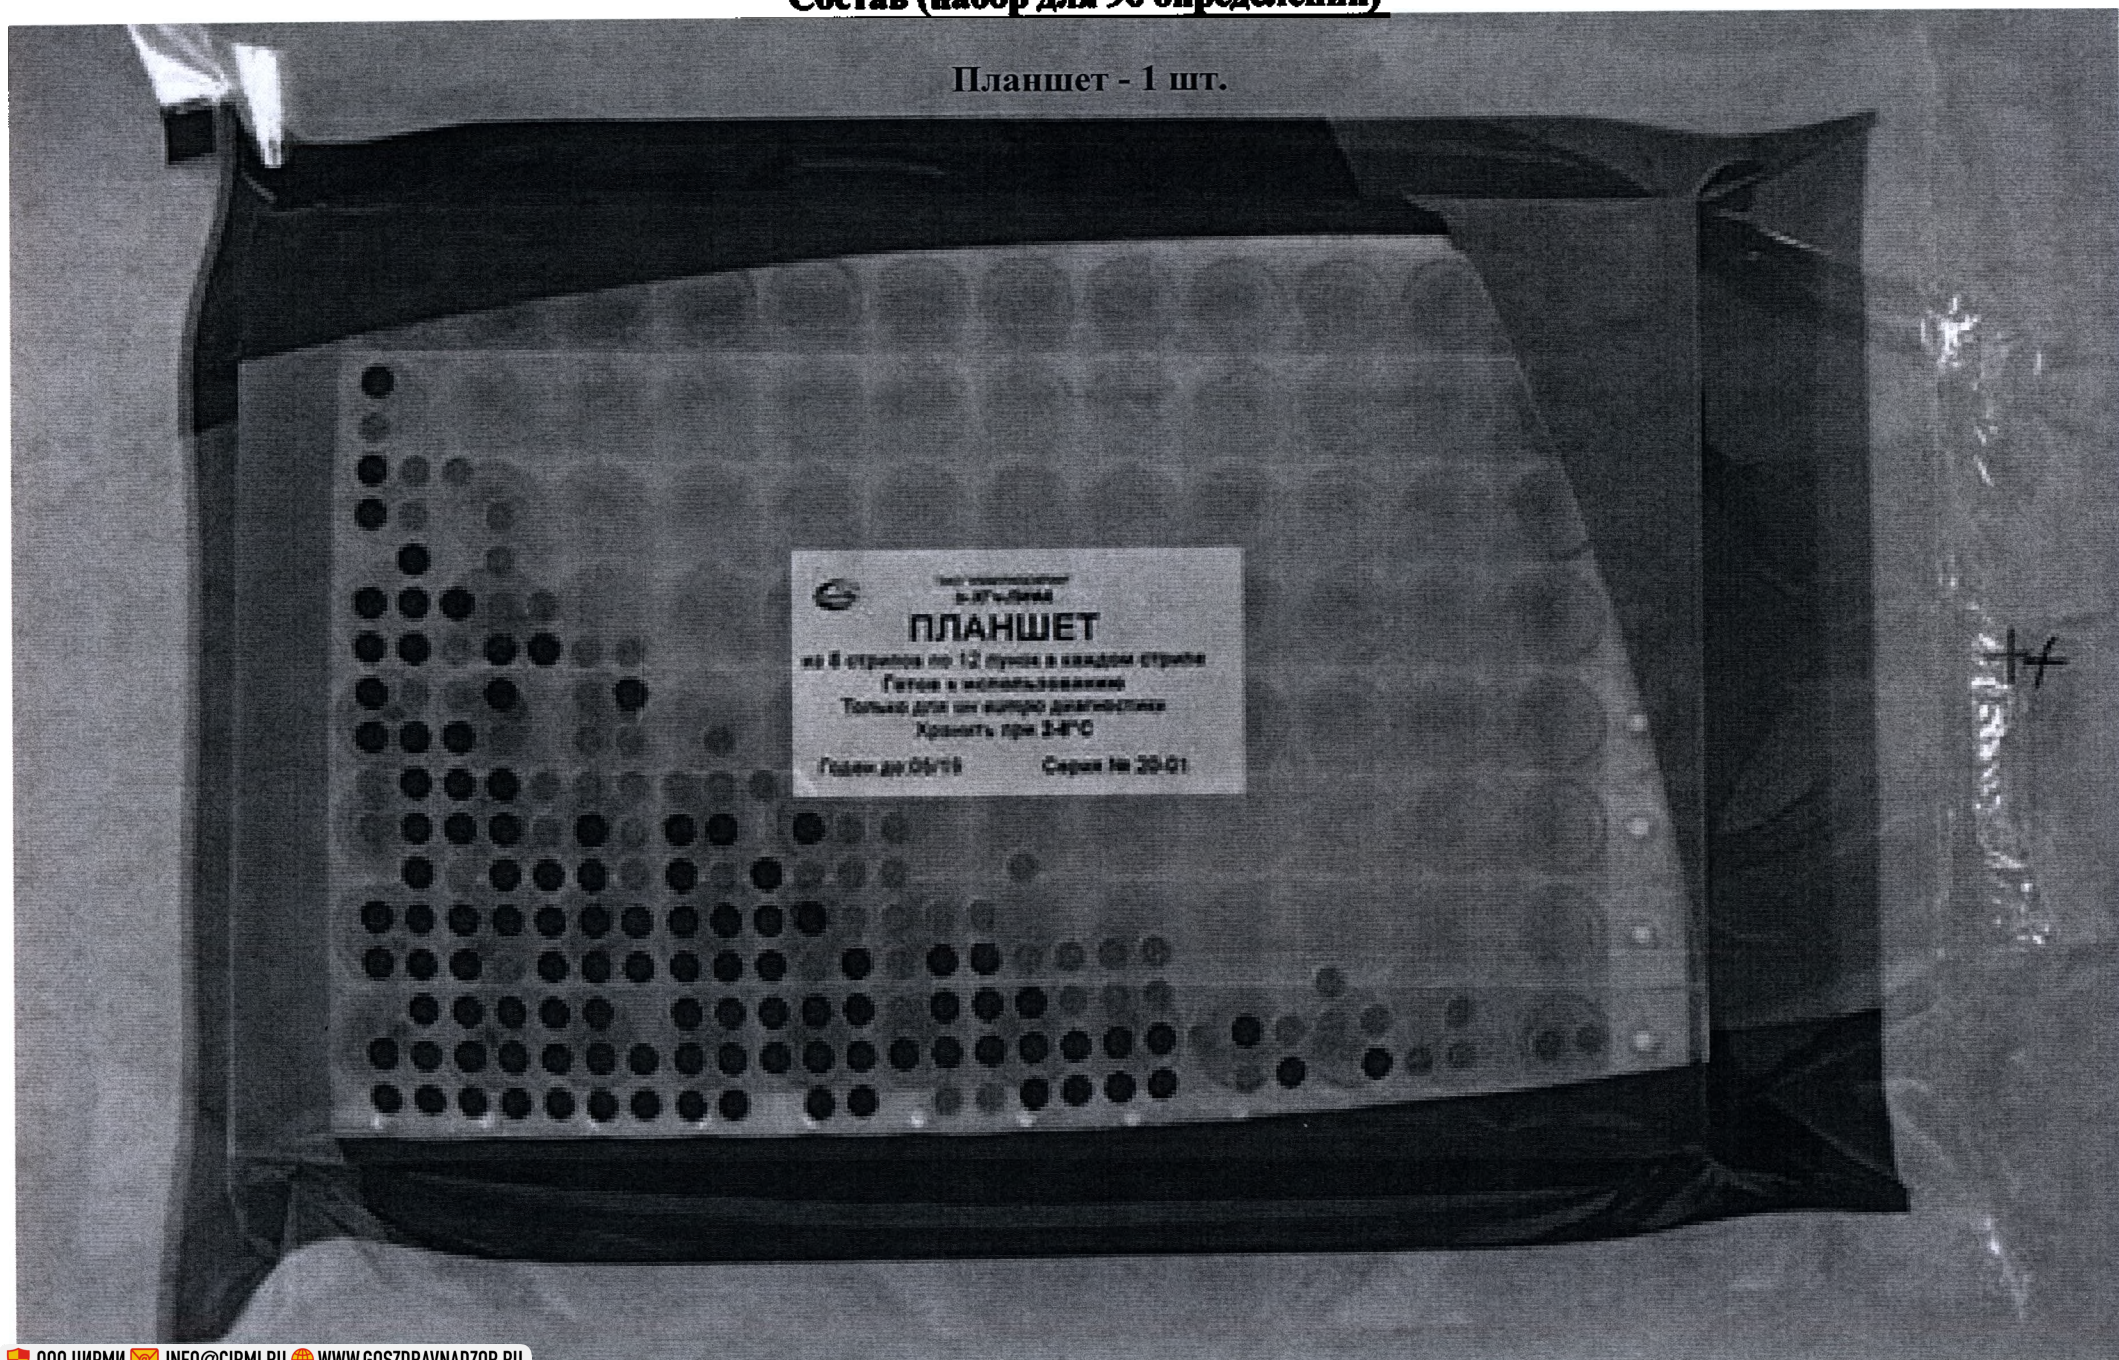

Калибровочная пробы – 6 пробирок или флаконов (по 1,0 мл каждая)

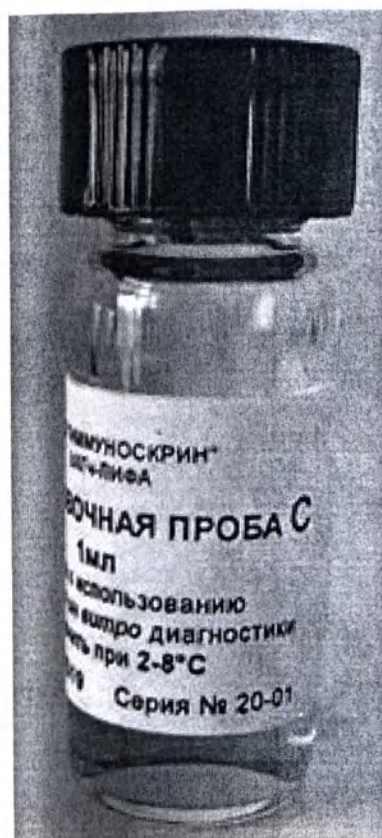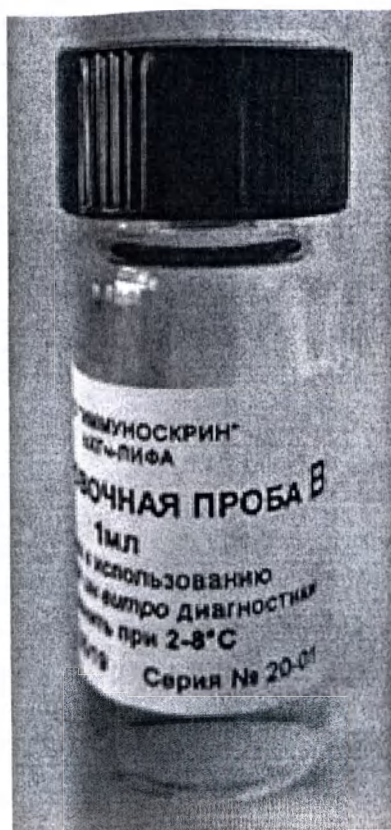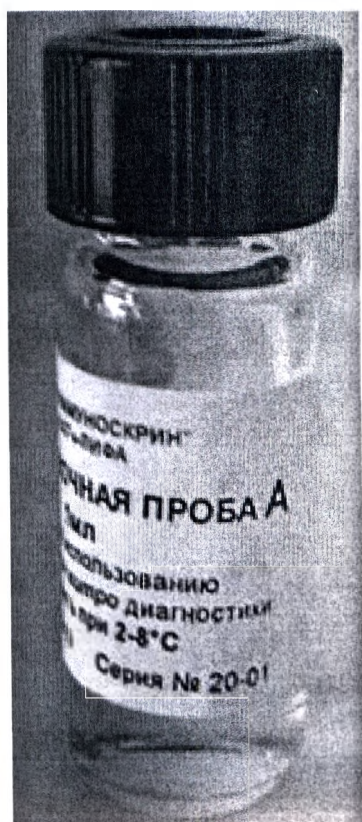


Калибровочная проба А    Калибровочная проба В    Калибровочная проба С

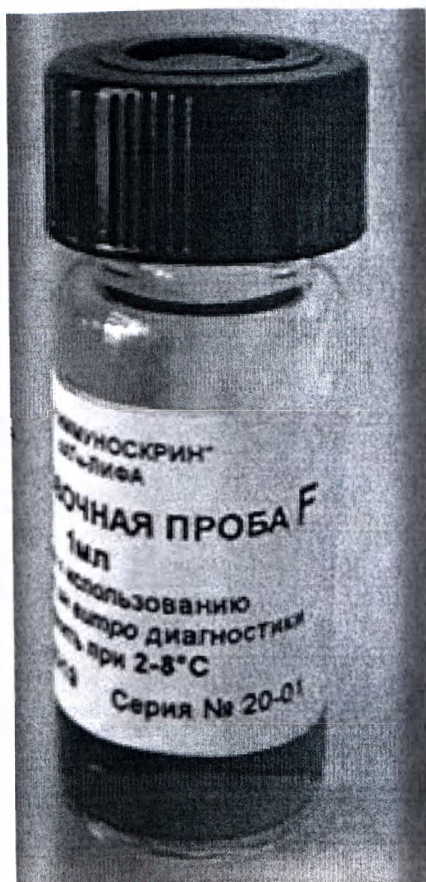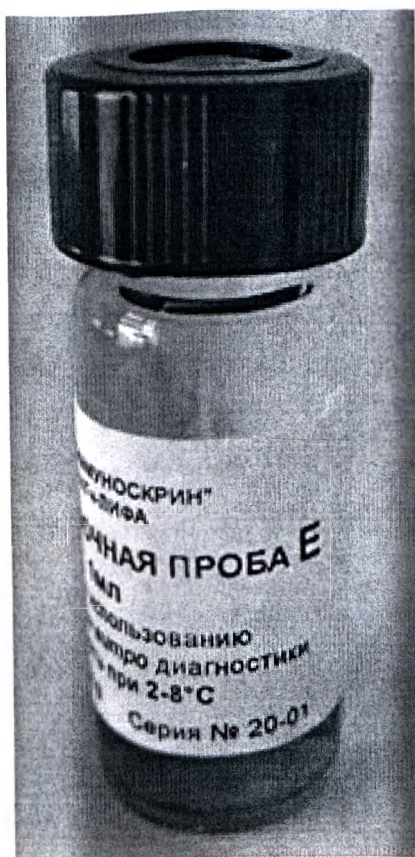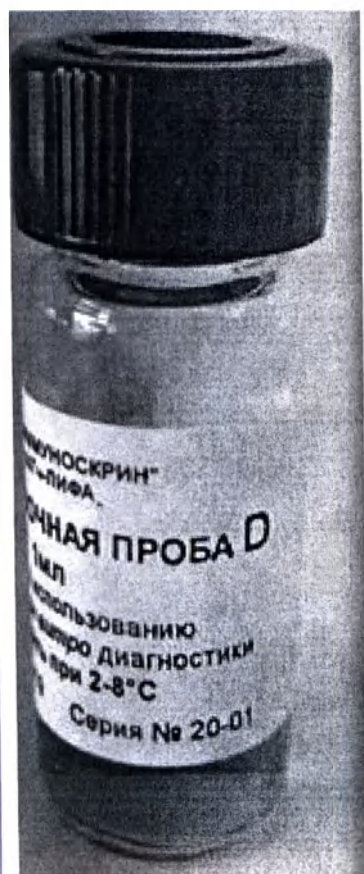


Калибровочная проба D    Калибровочная проба E    Калибровочная проба F


Контрольная сыворотка – 1 пробирка или флакон (1,0 мл)

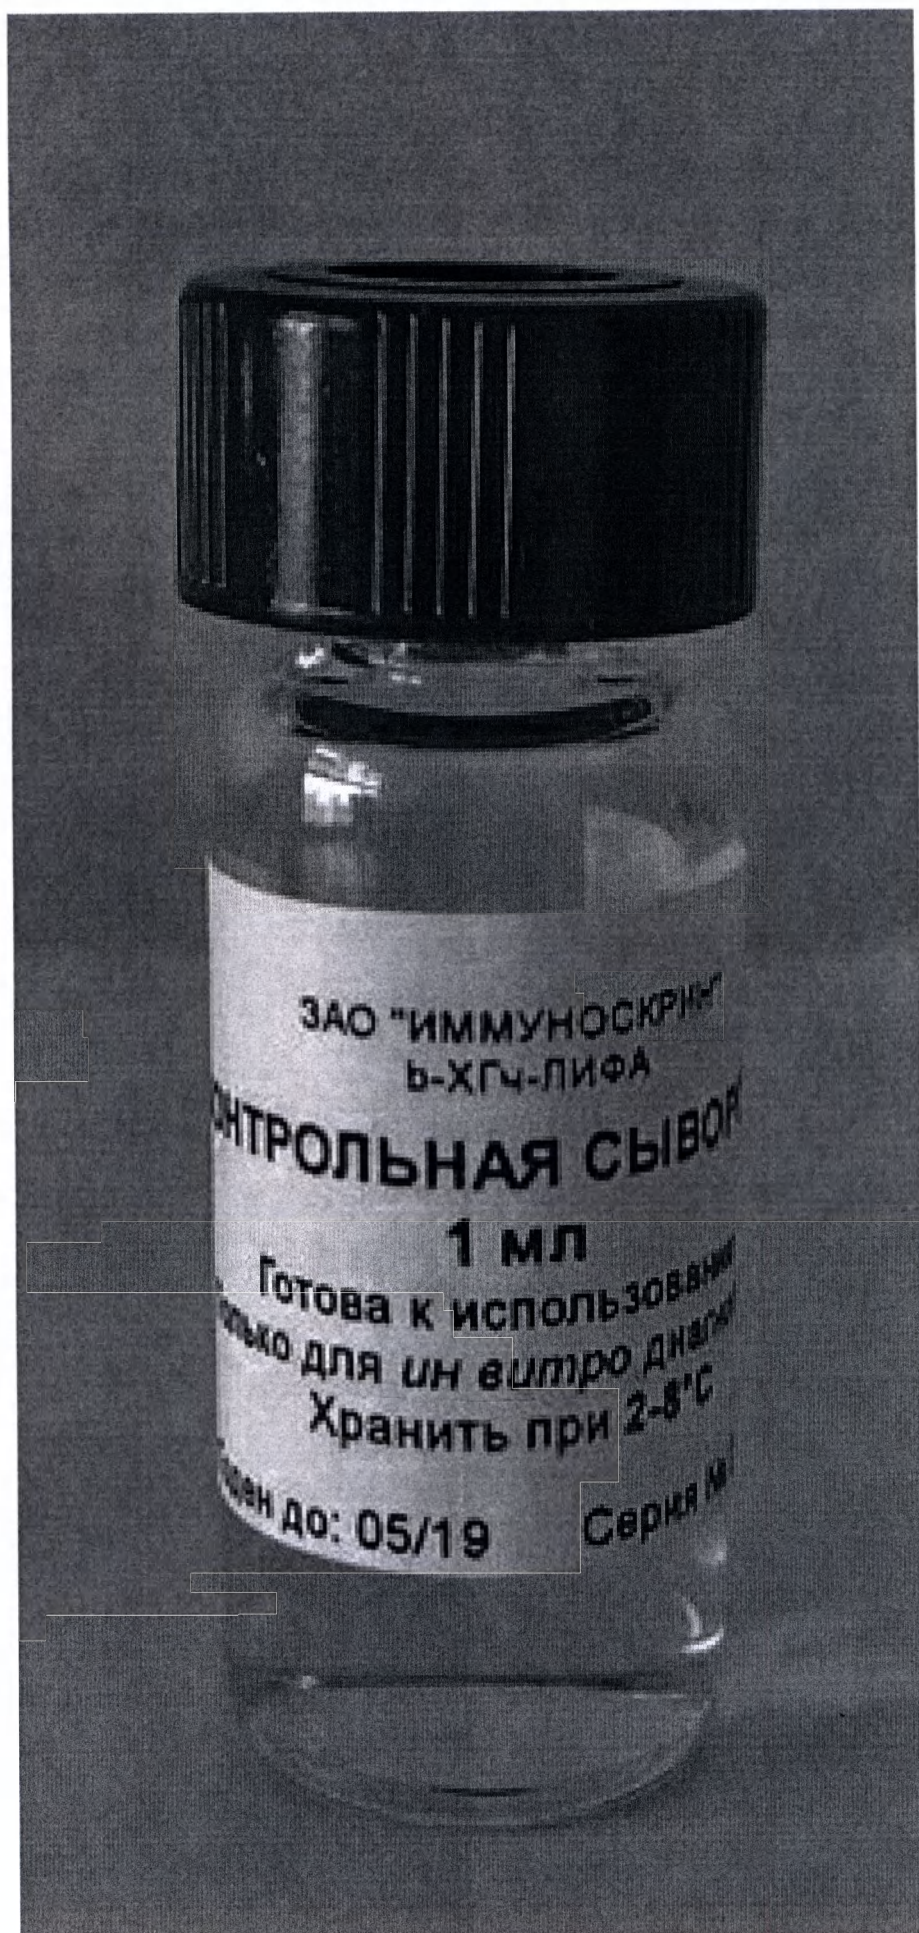


Концентрат конъюгата – 1 пробирка или флакон (0,3 мл)

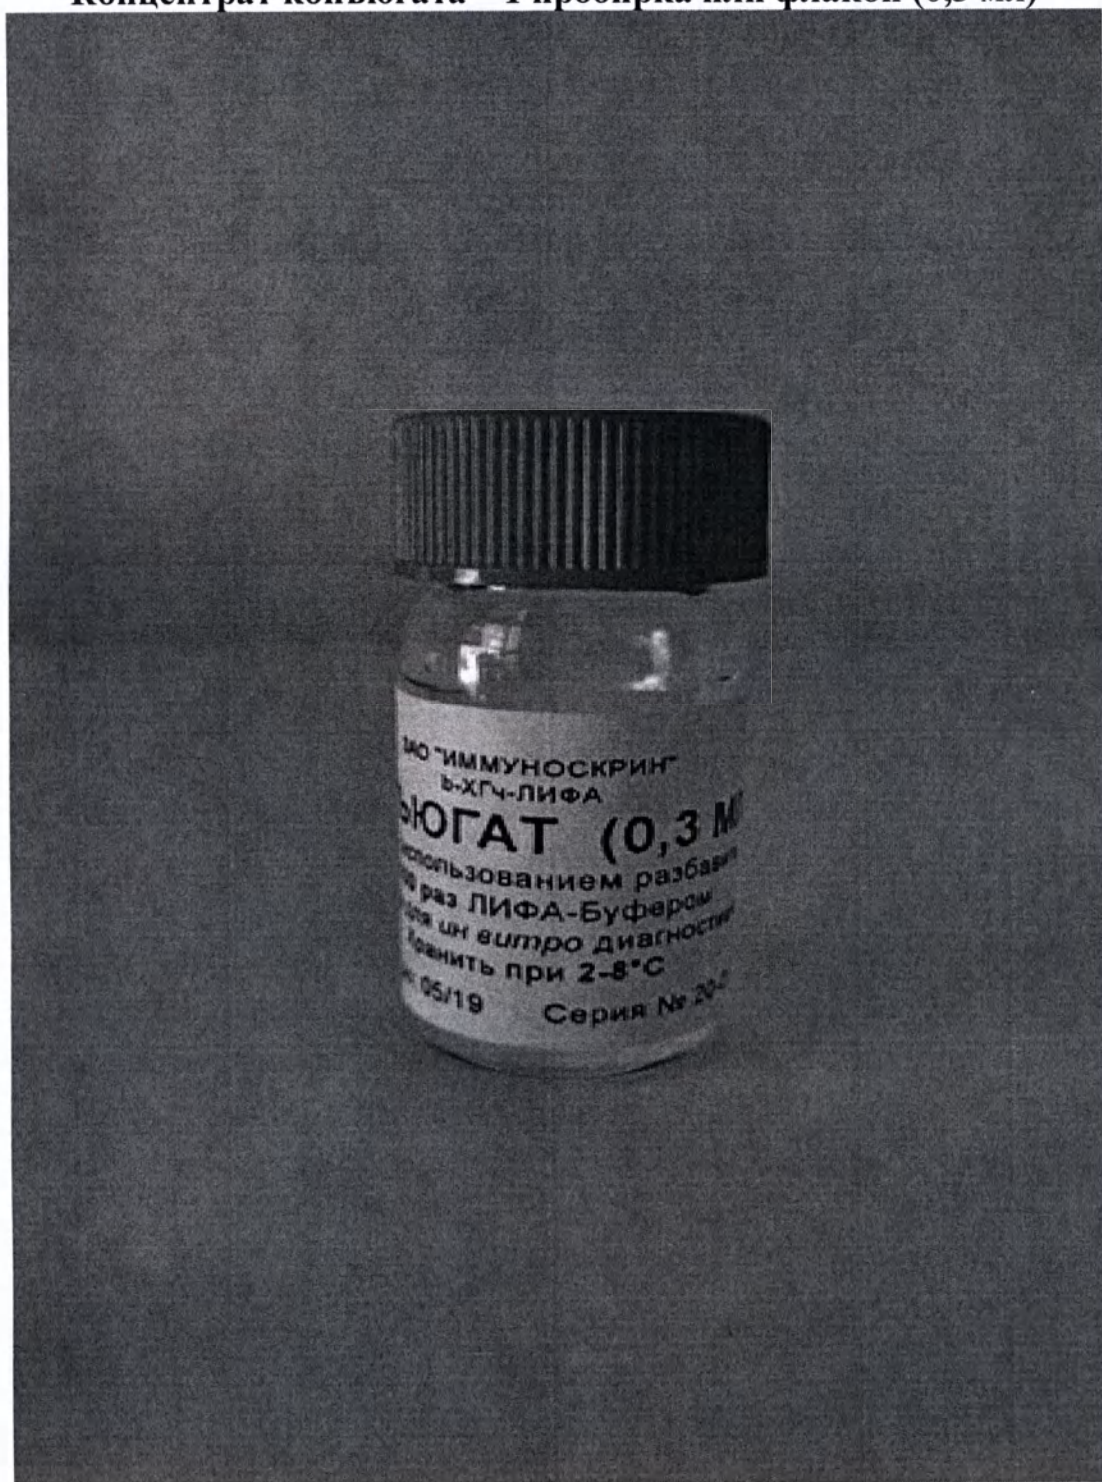


## Усиливающий раствор – 1 флакон (30 мл)

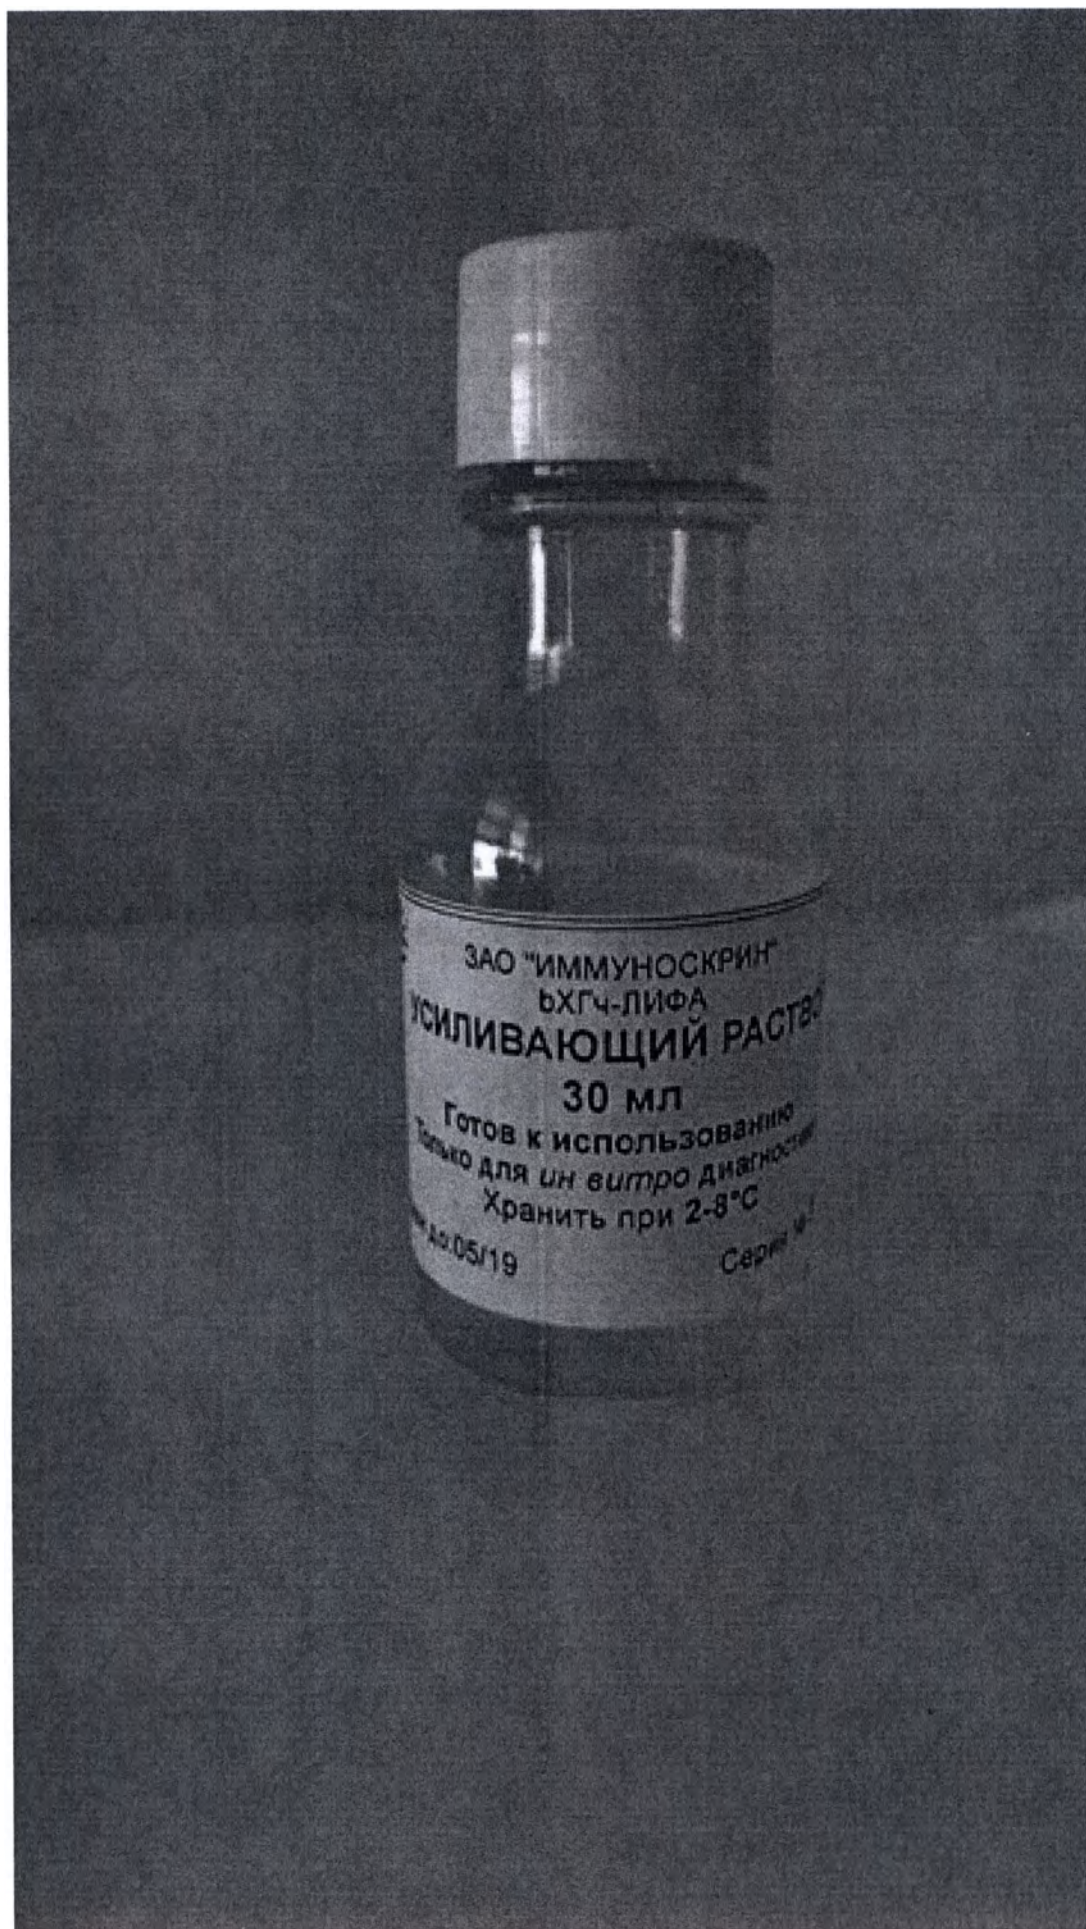

**ЛИФА-Буфер – 1 флакон (50 мл)**

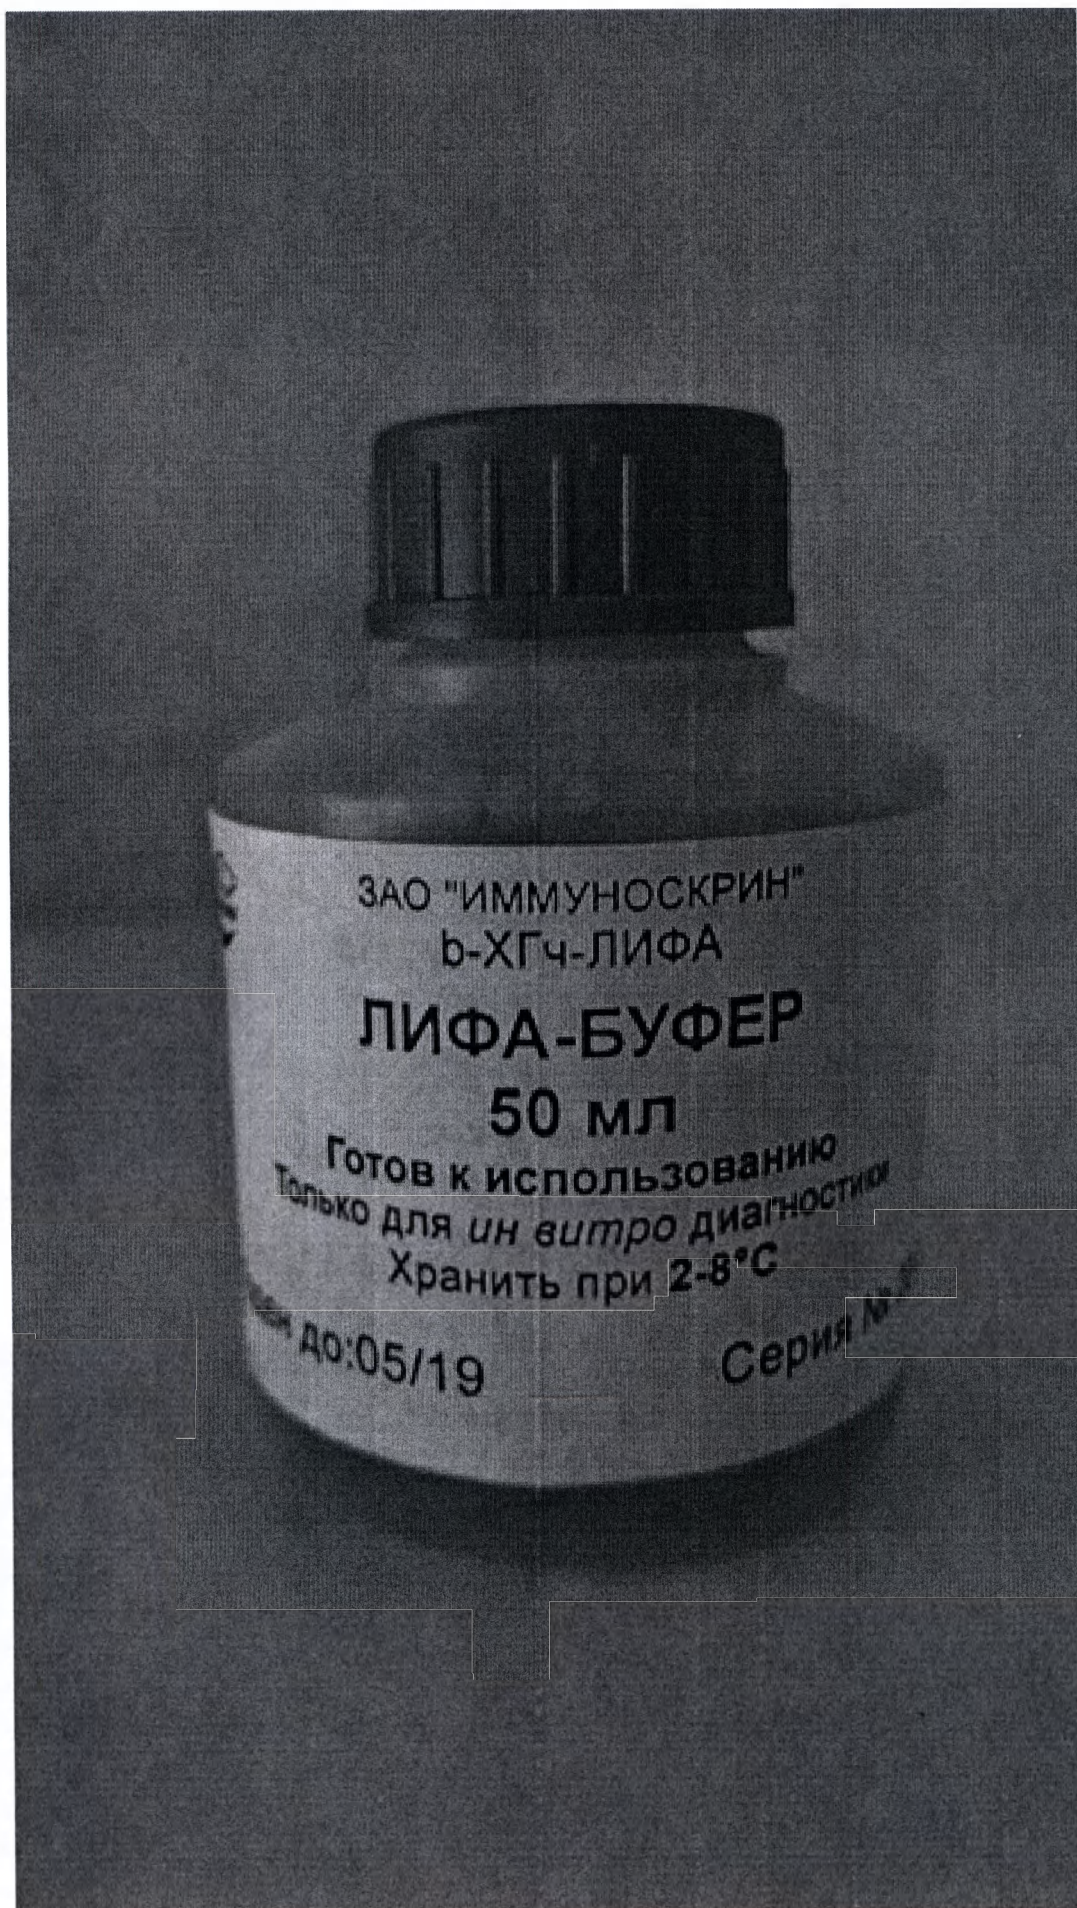

Концентрат отмывочного раствора – 2 флакона (по 10,0 мл каждый)

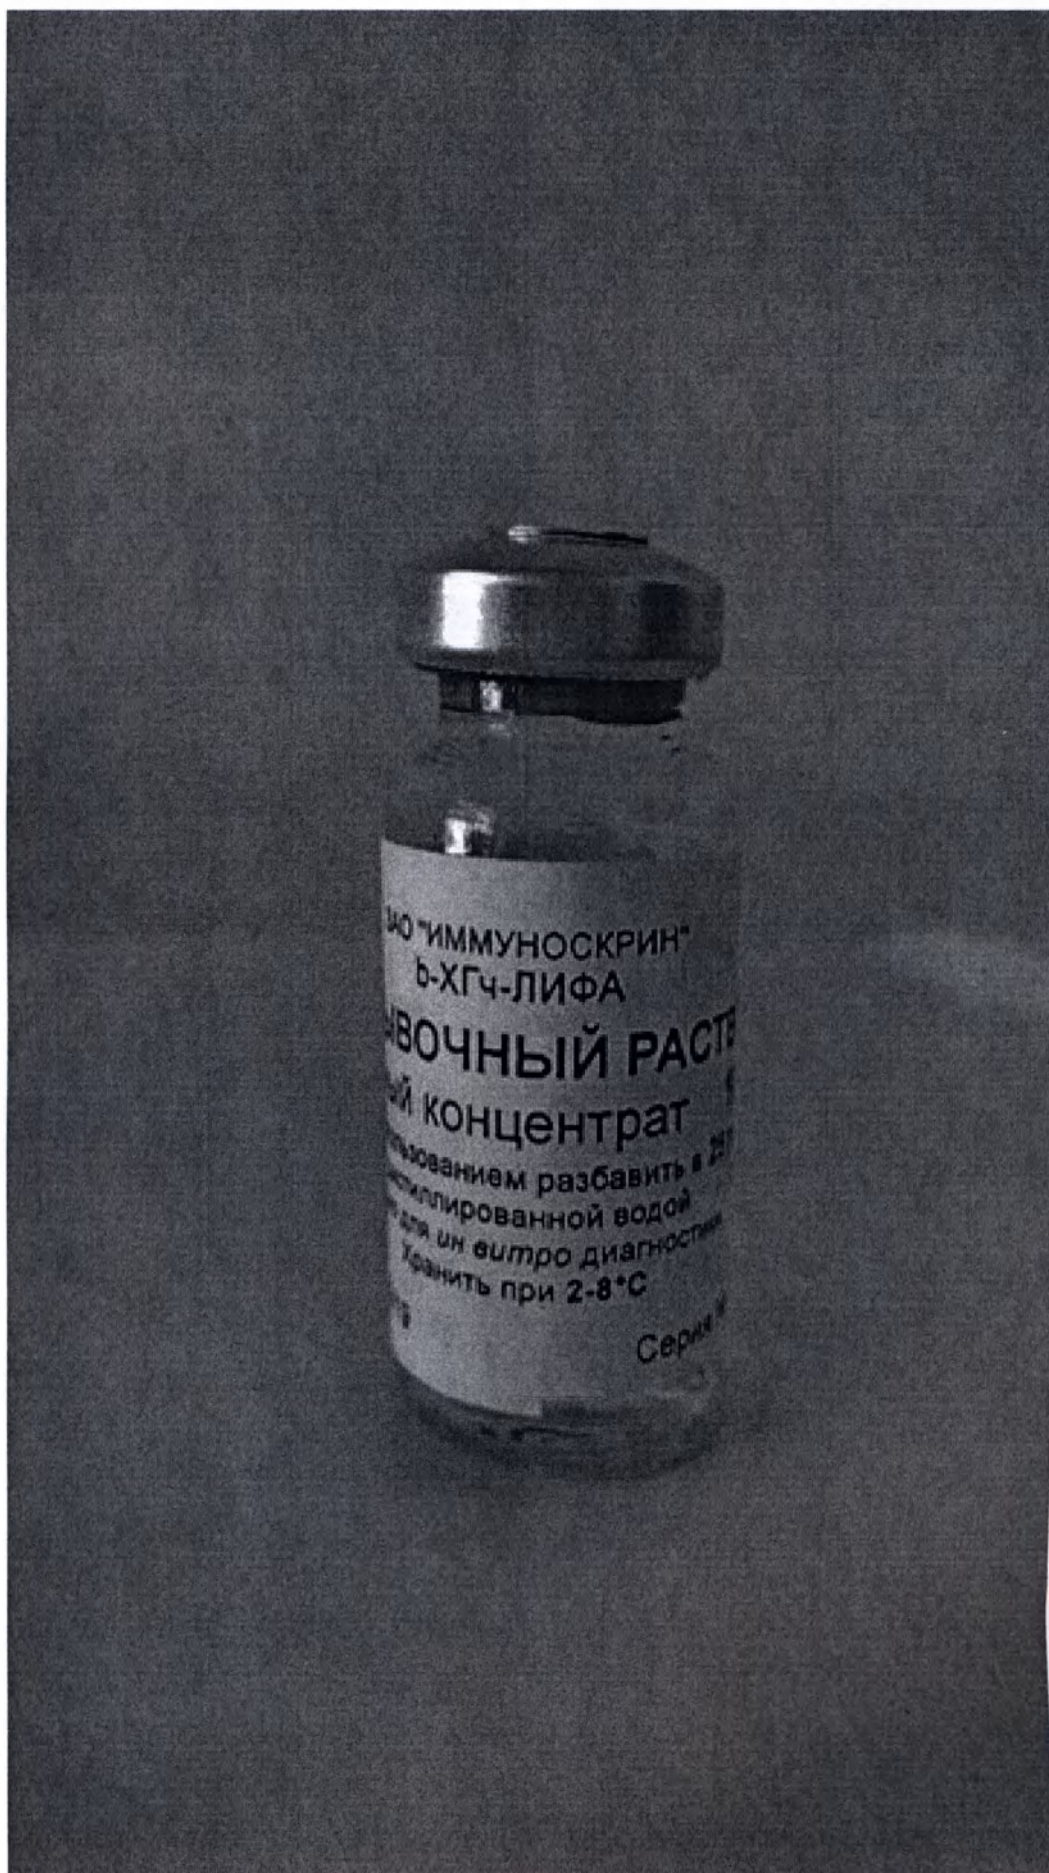

Всего прошито, пронумеровано и скреплено  
печатью: 11 листа (ов)  
Генеральный директор  
ЗАО «Иммуноскрин» Н. С. Осин

