


УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО «ЦКТ»
Киричков Е.А.




ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ:

Аппарат медицинский для хранения крови и ее компонентов серии «В», в вариантах
исполнения


1. Холодильник В 51

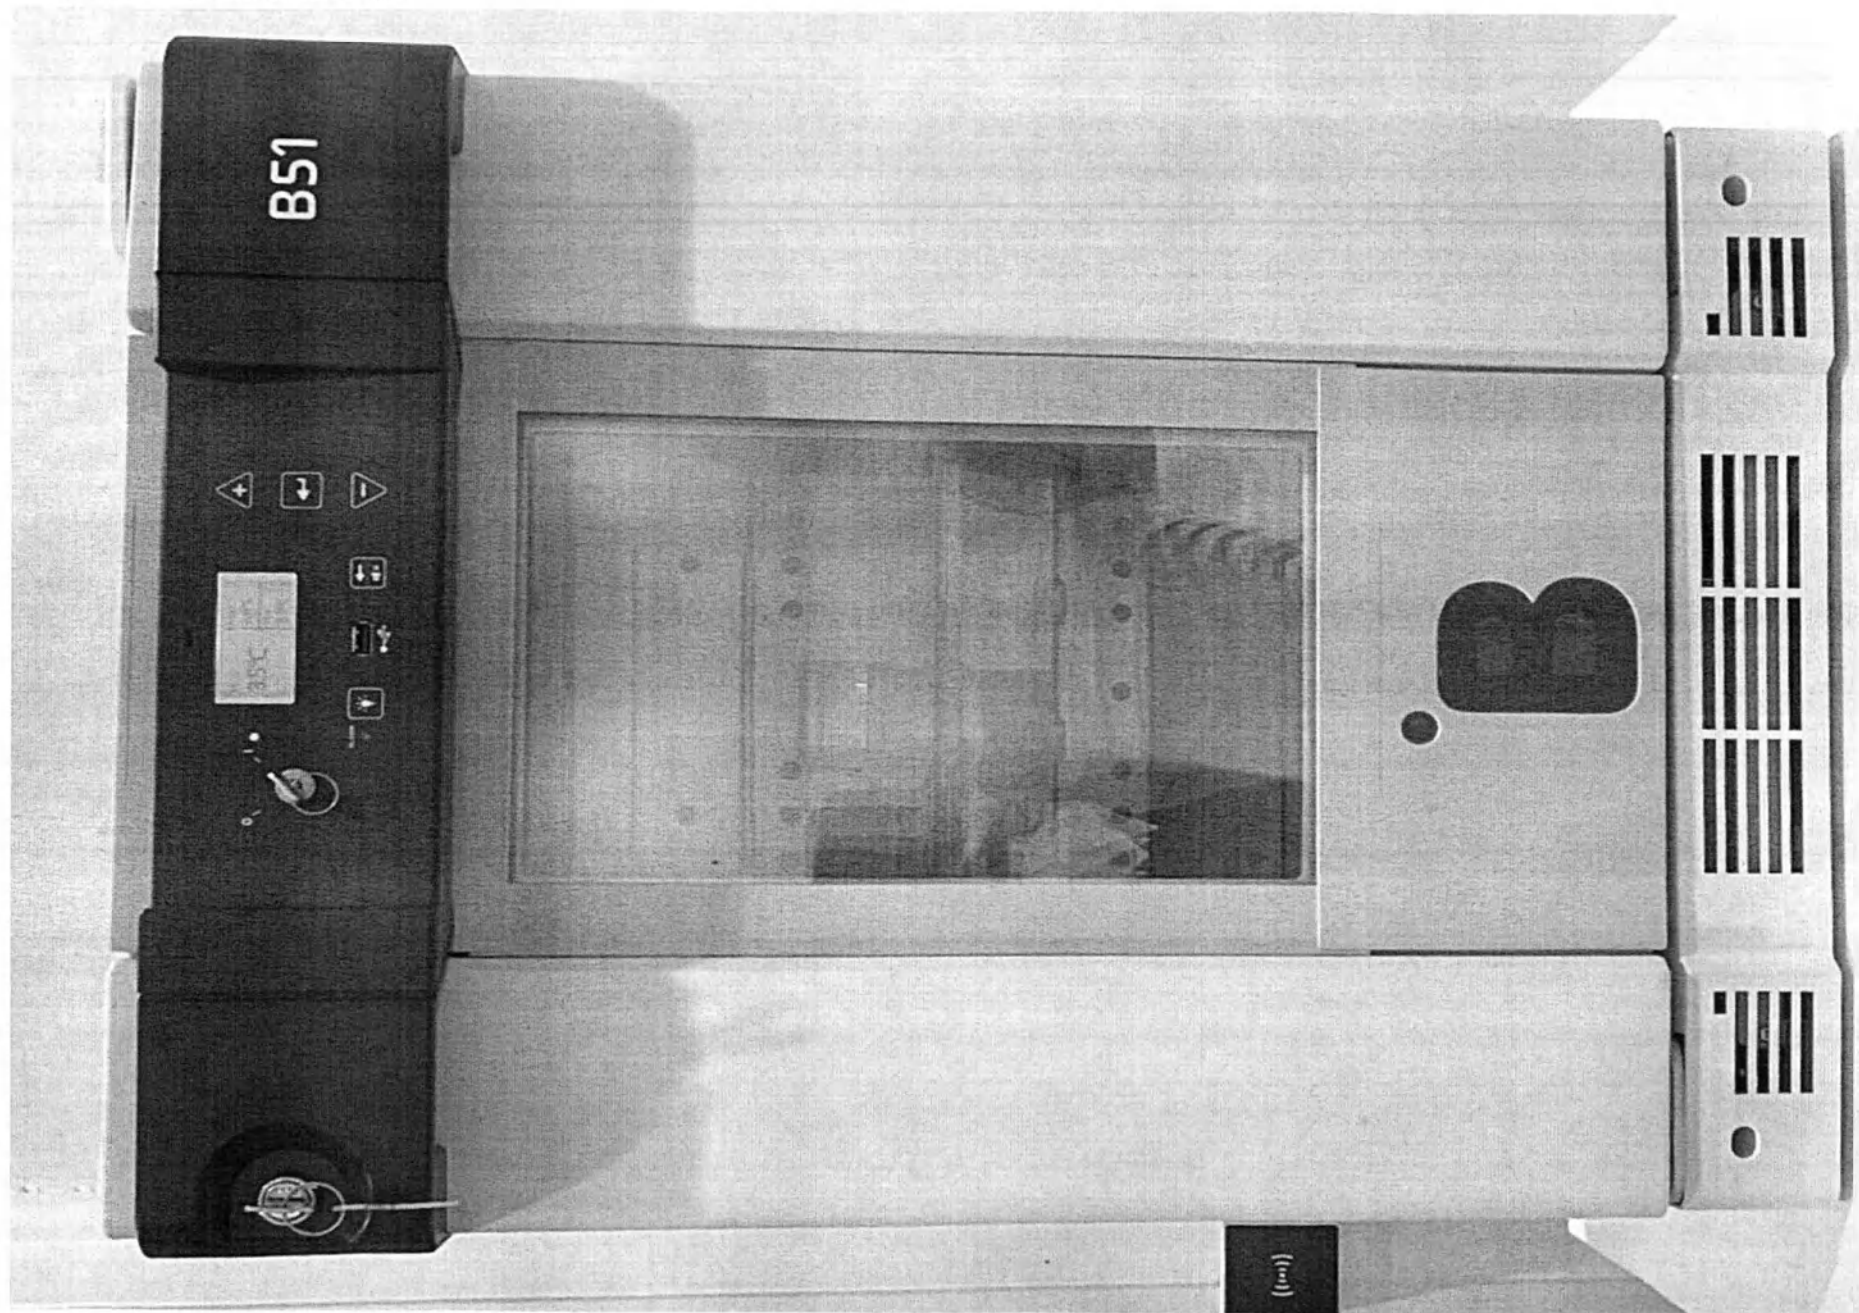


2. Холодильник В 131

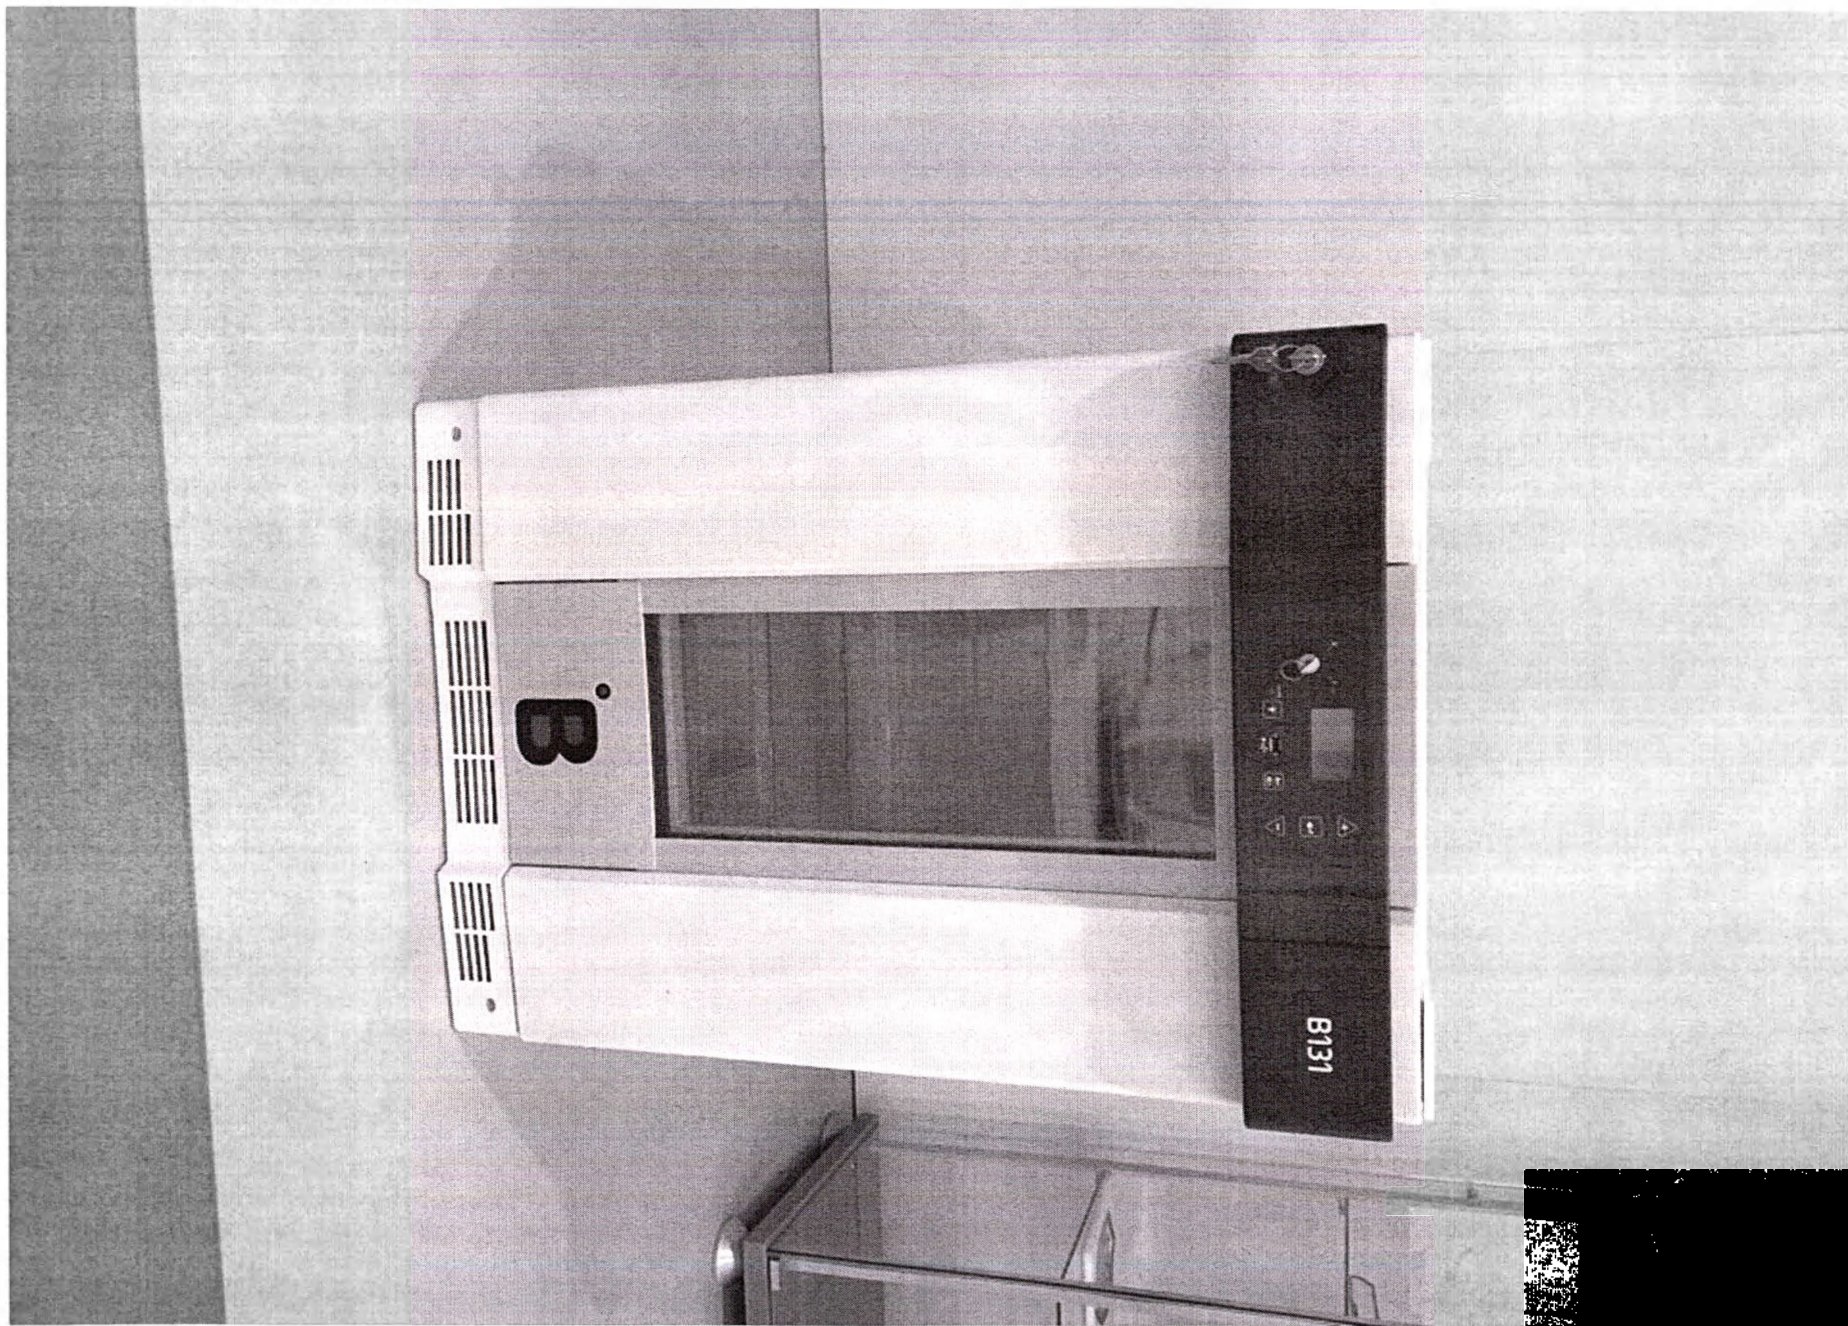


3. Холодильник В 291

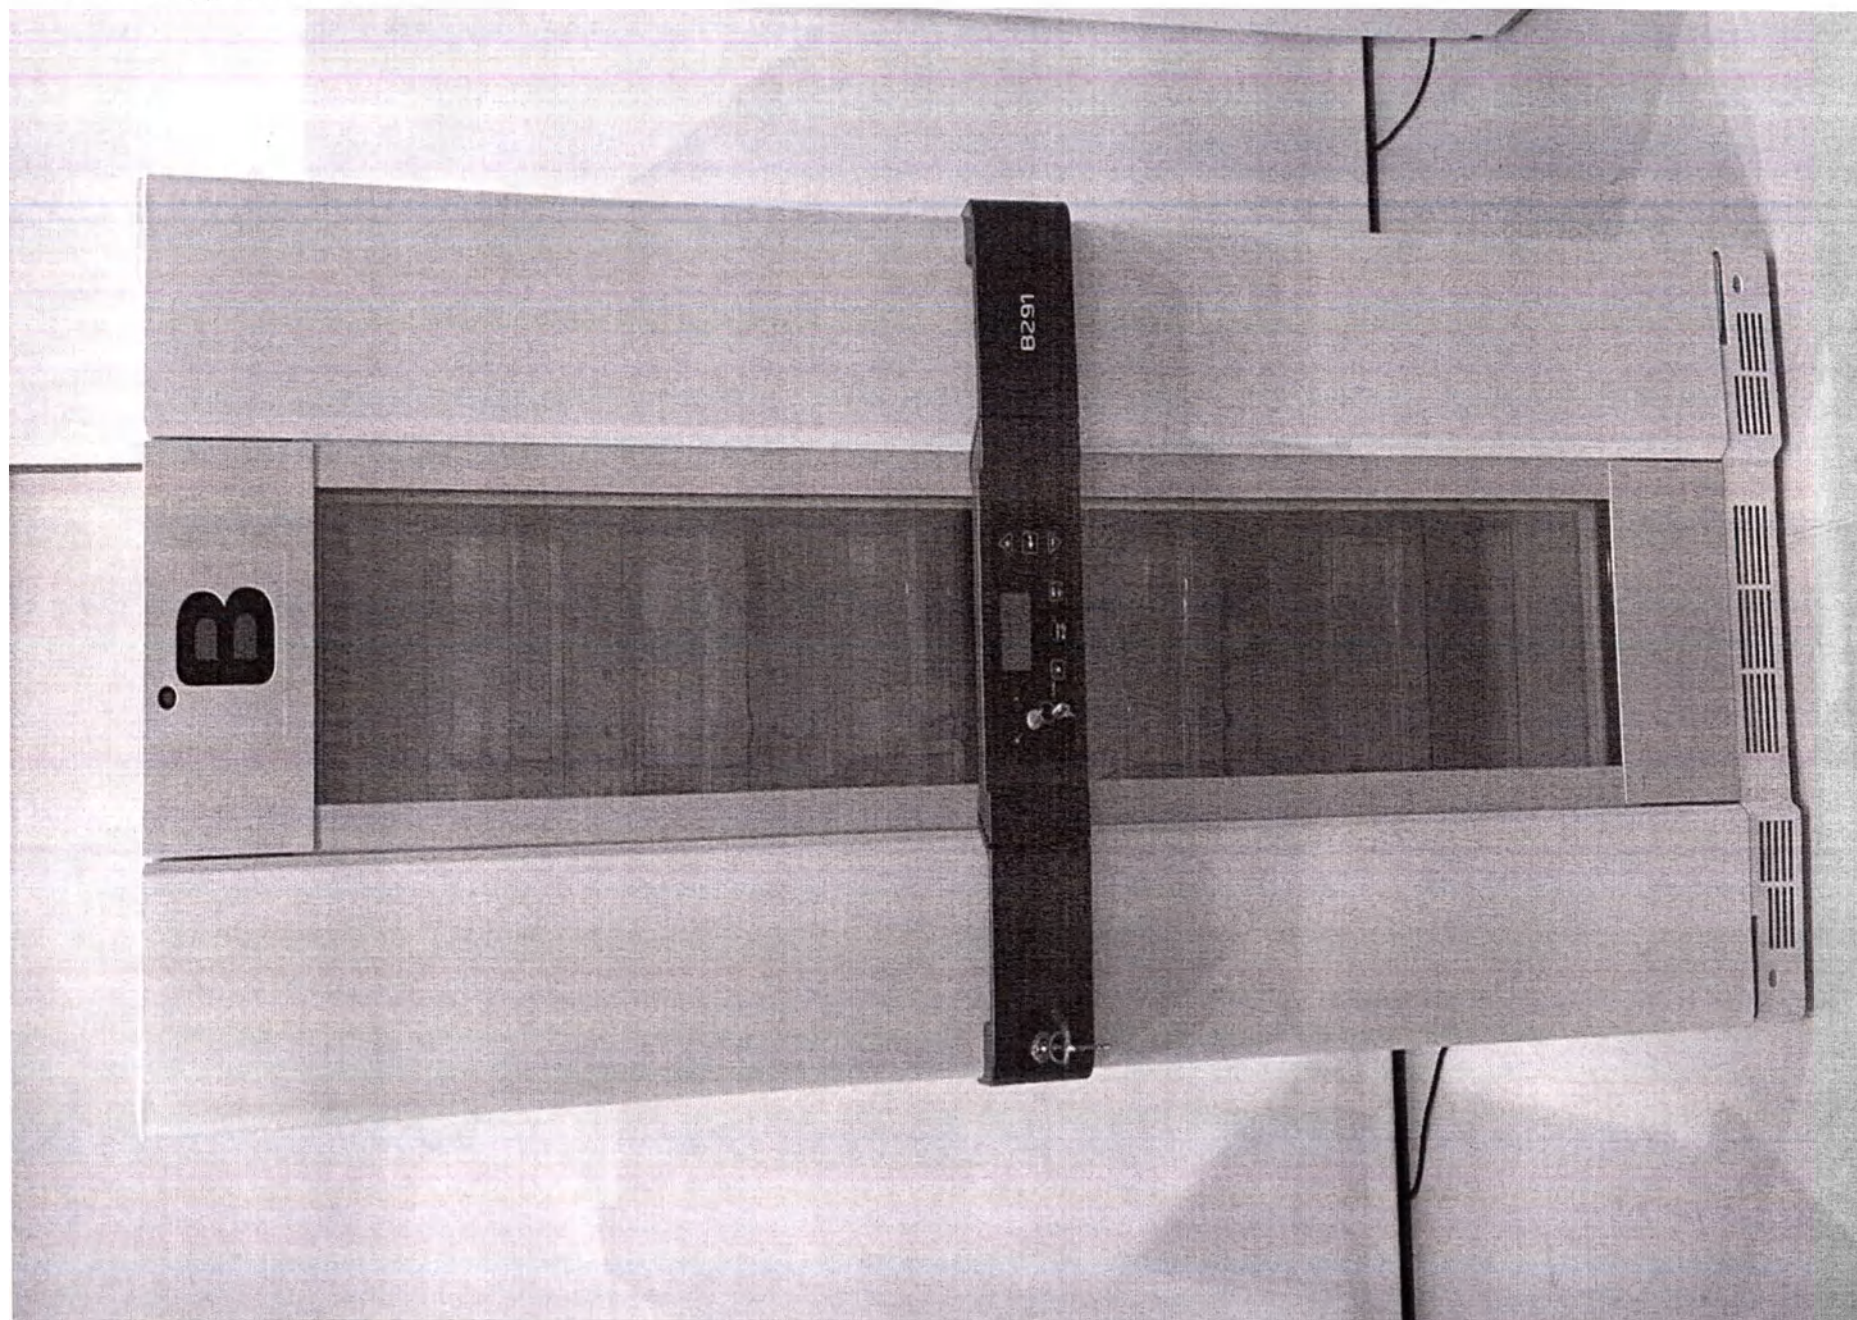


4. Холодильник В 381

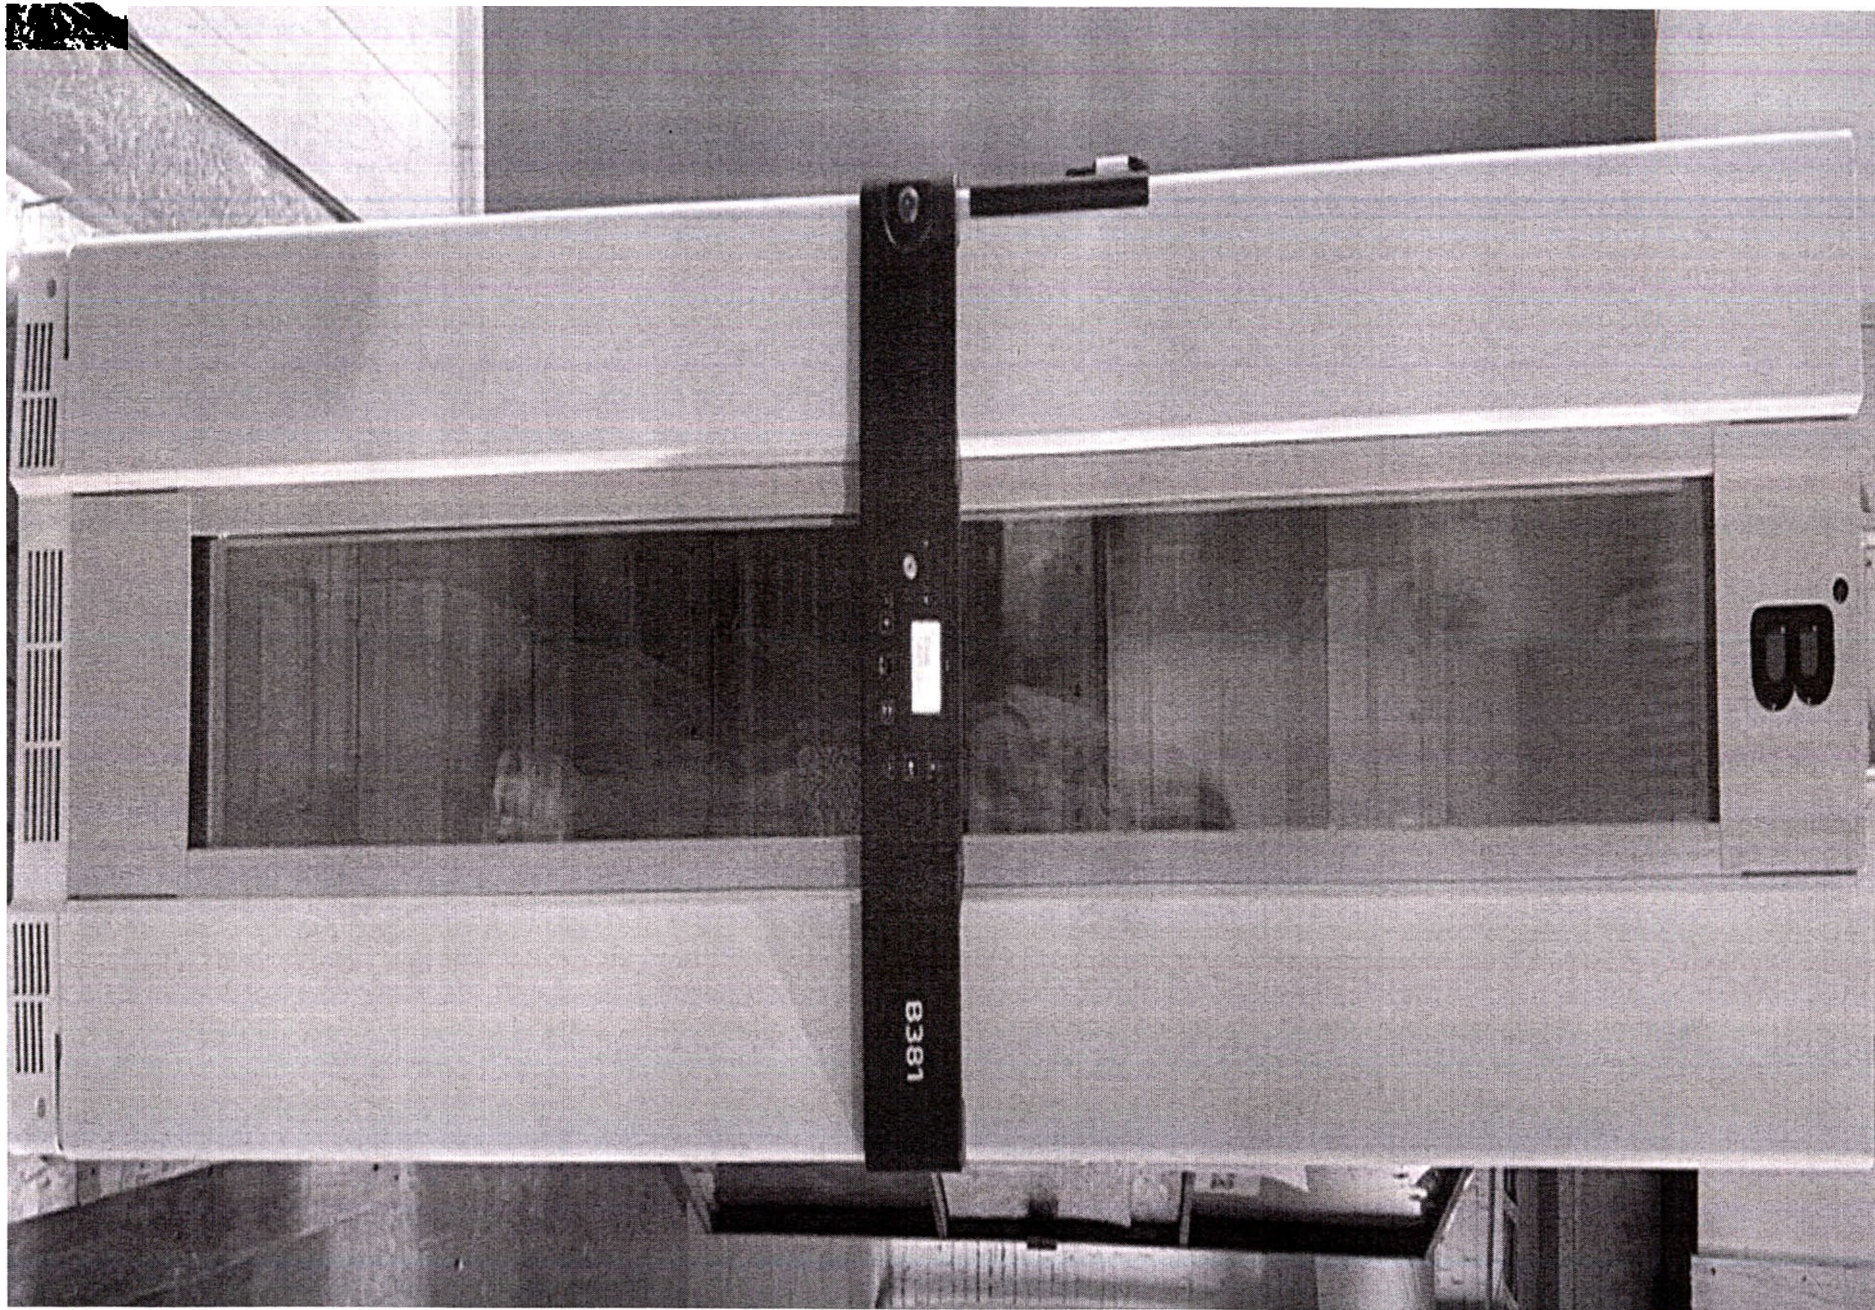


5. Холодильник В 401

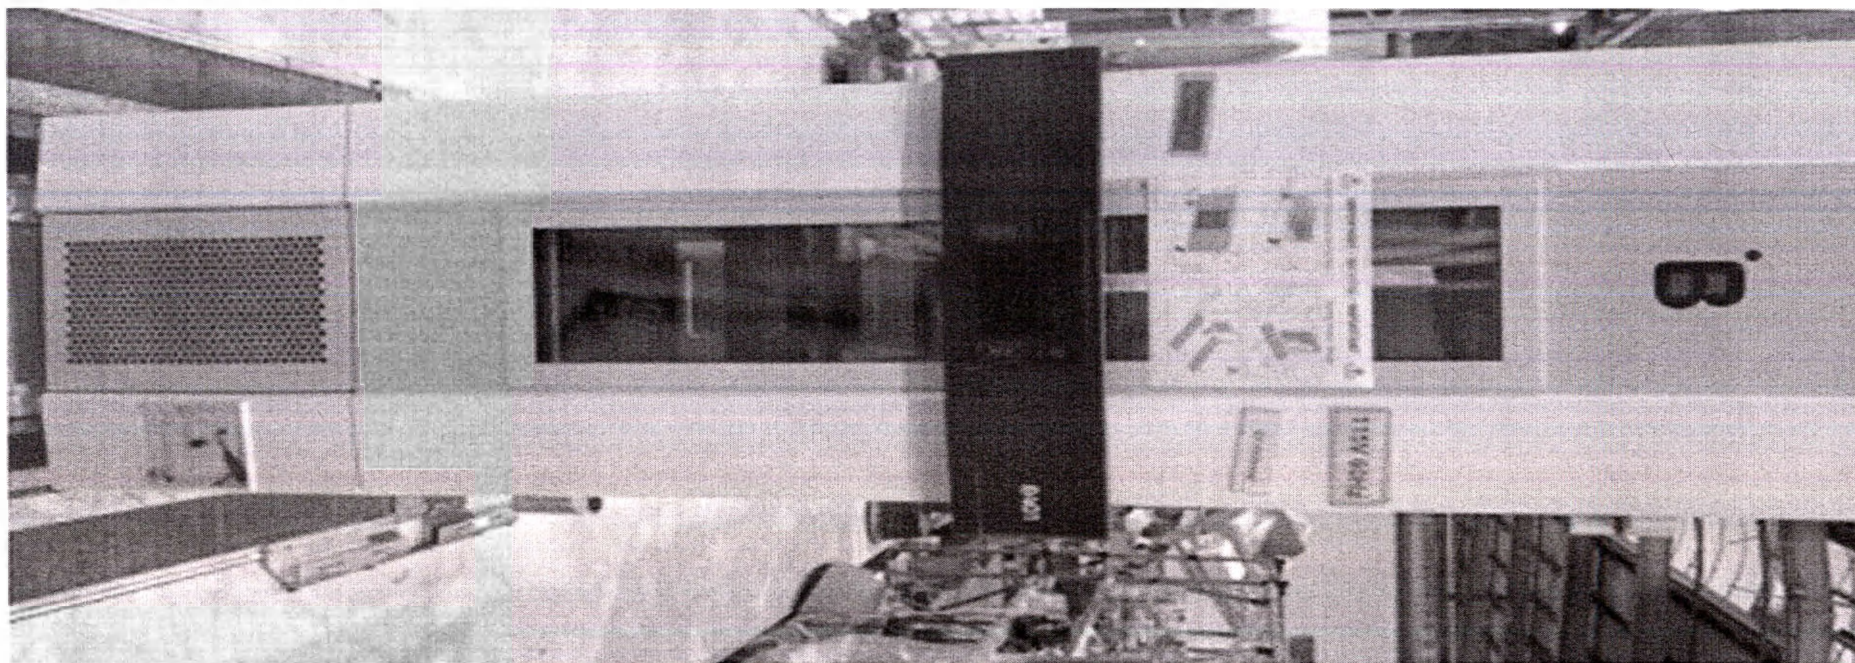


6. Холодильник В 501

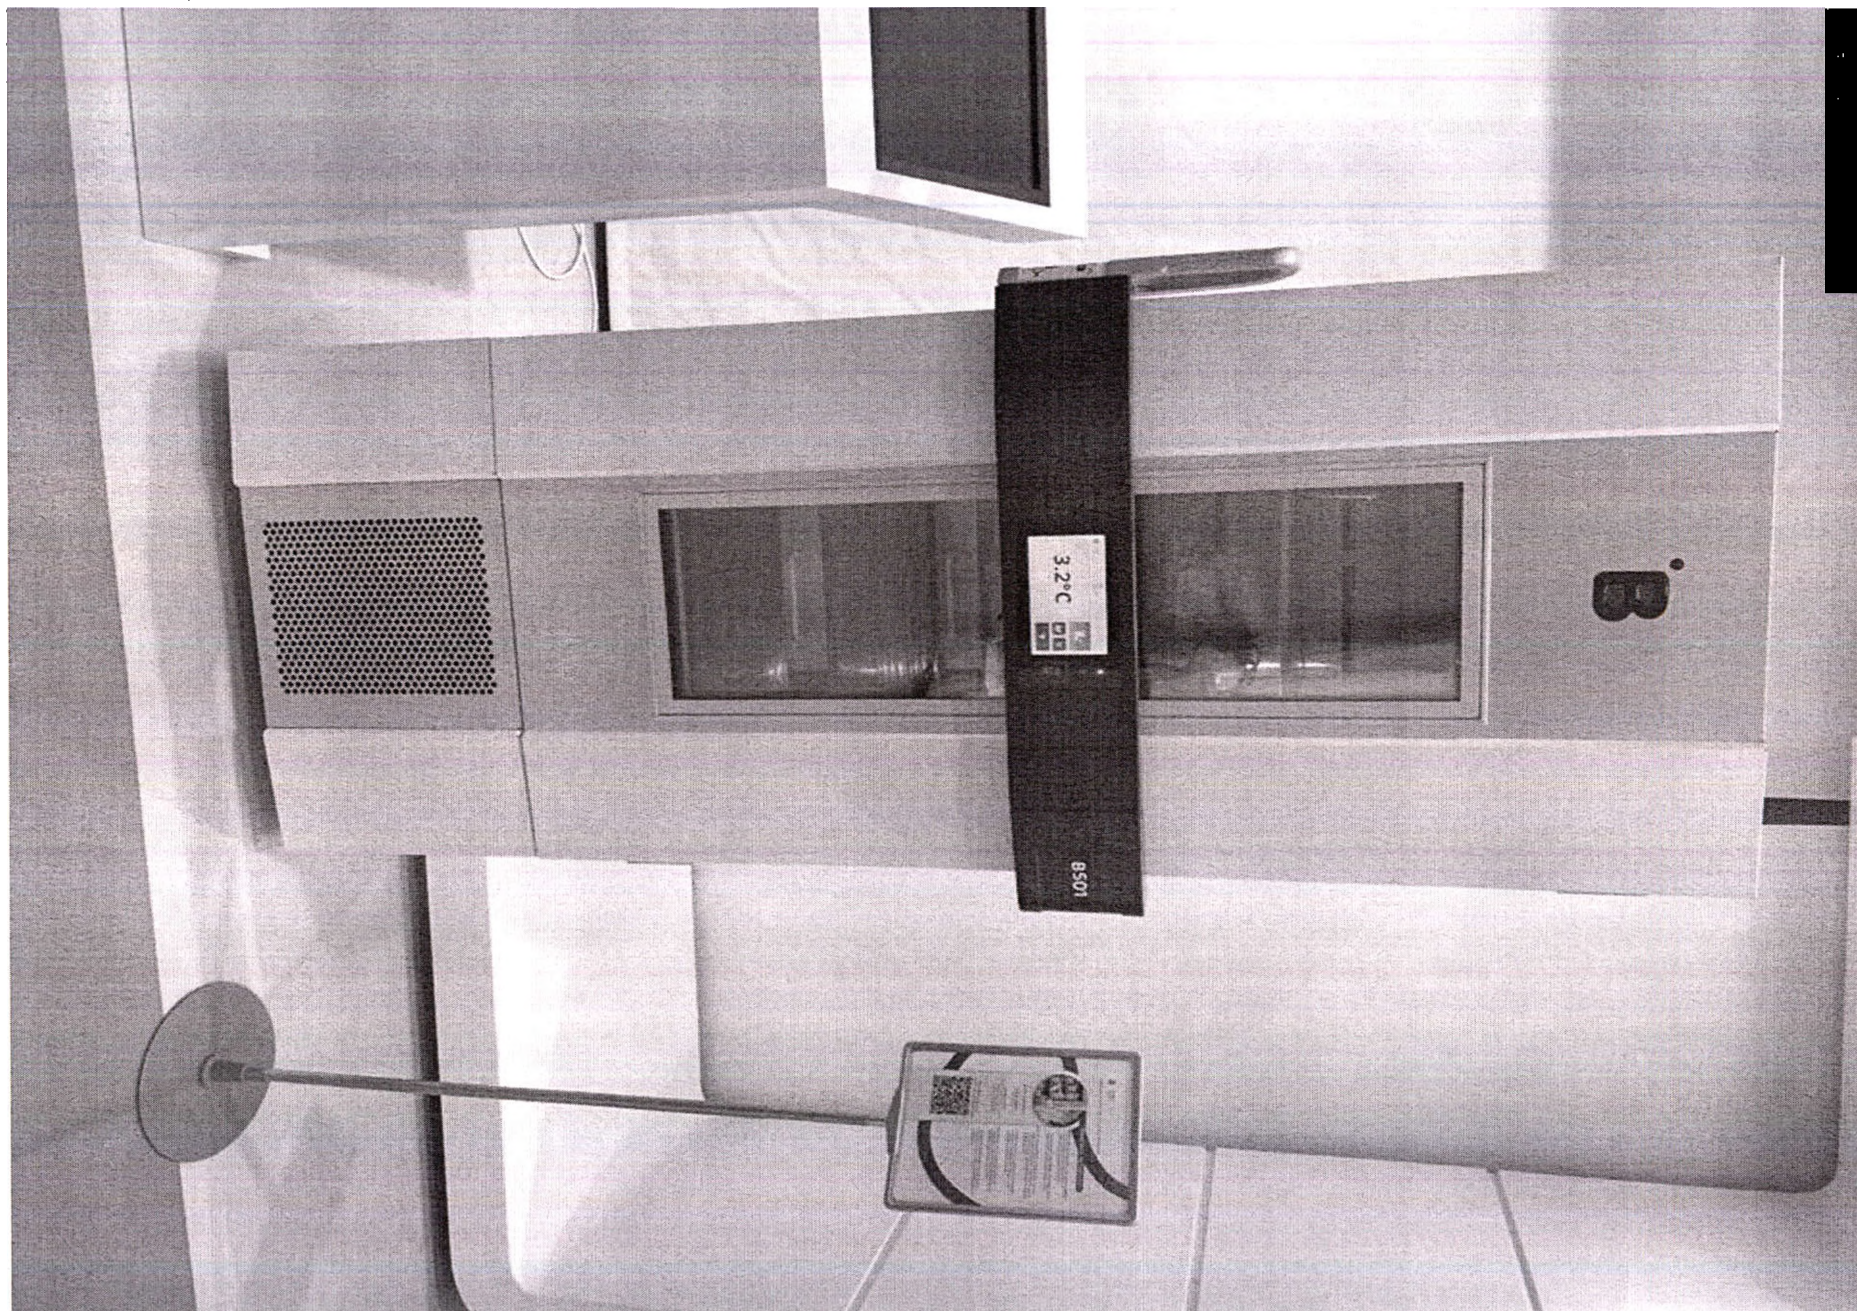


7. Холодильник В 701

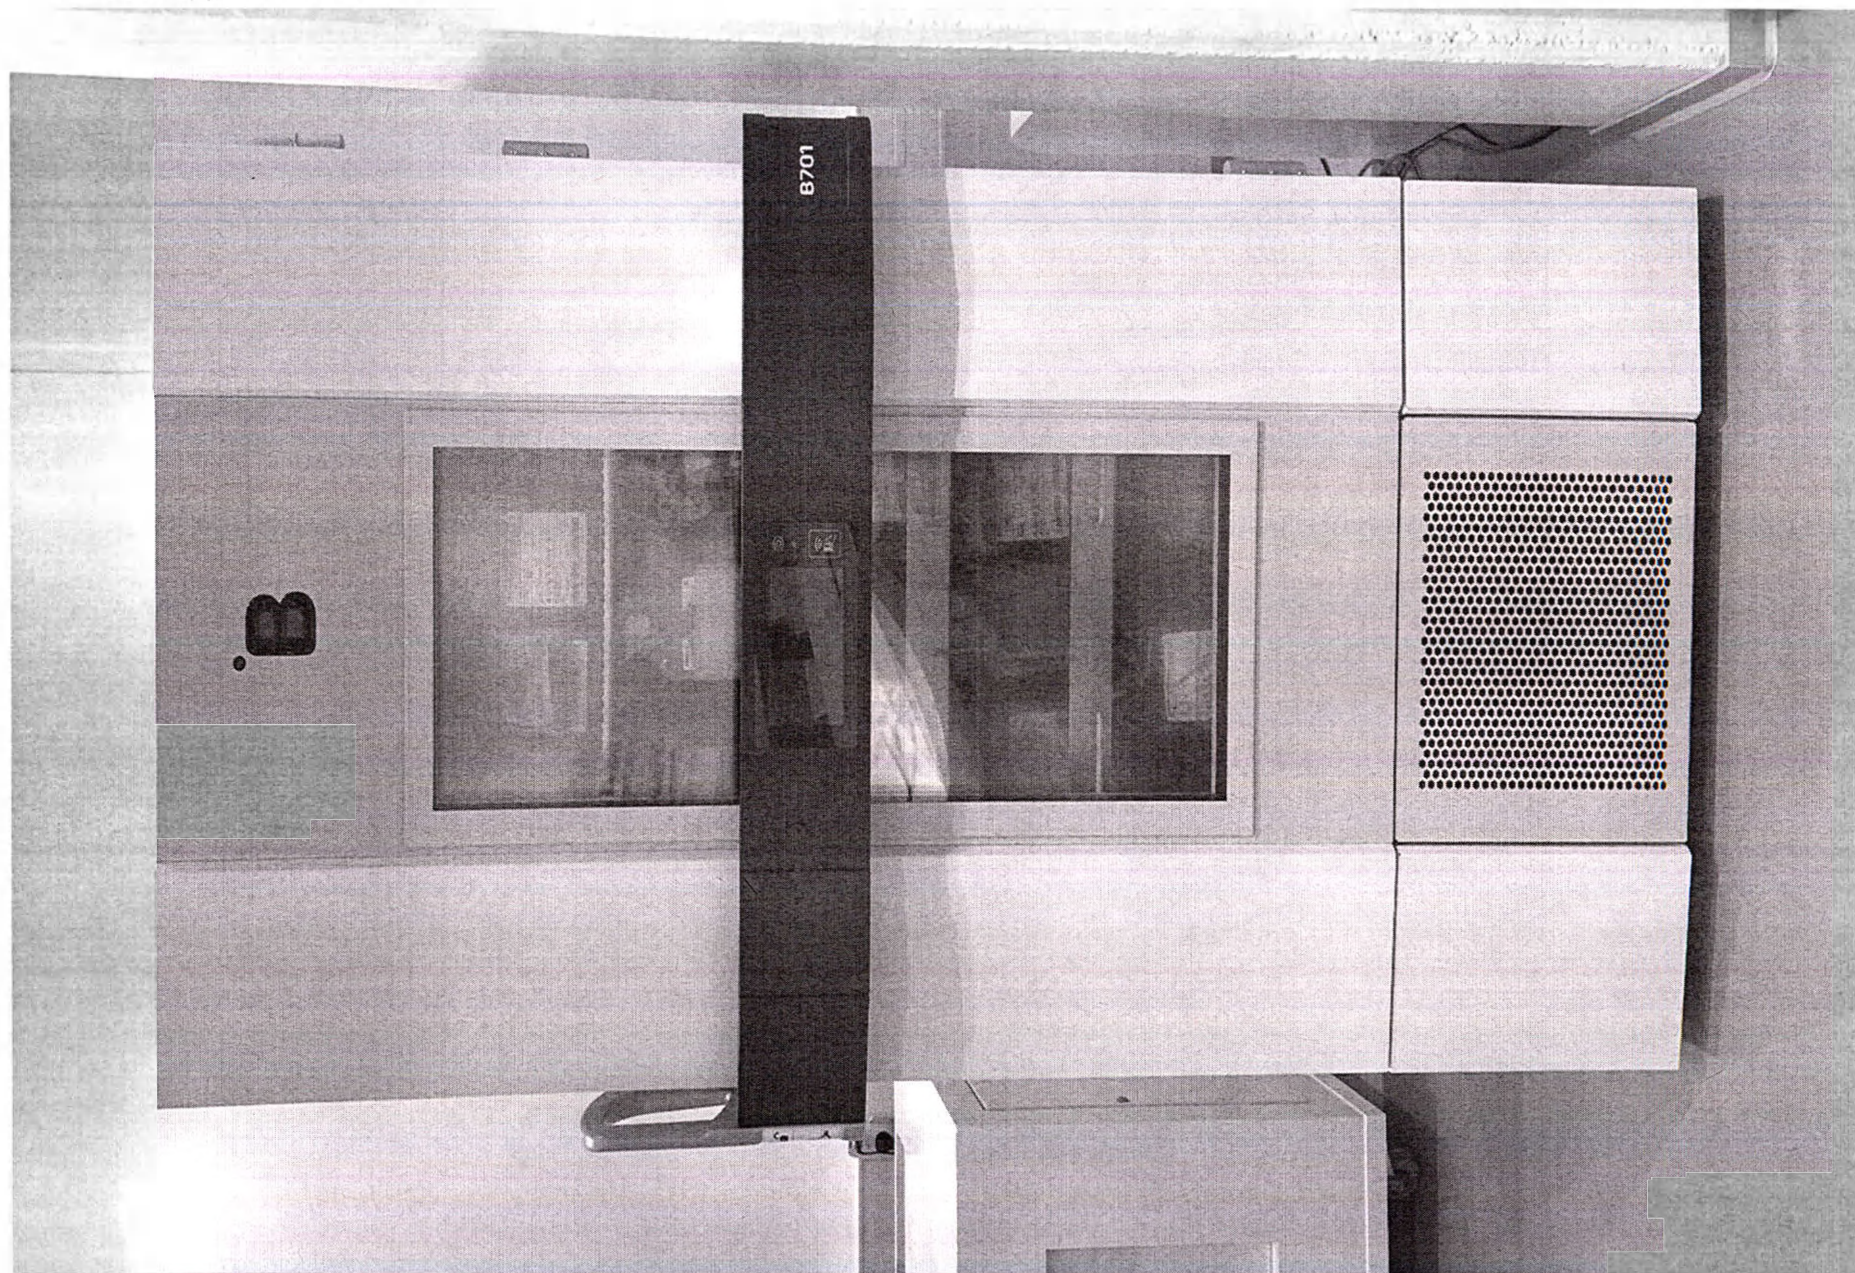


8. Холодильник В 901

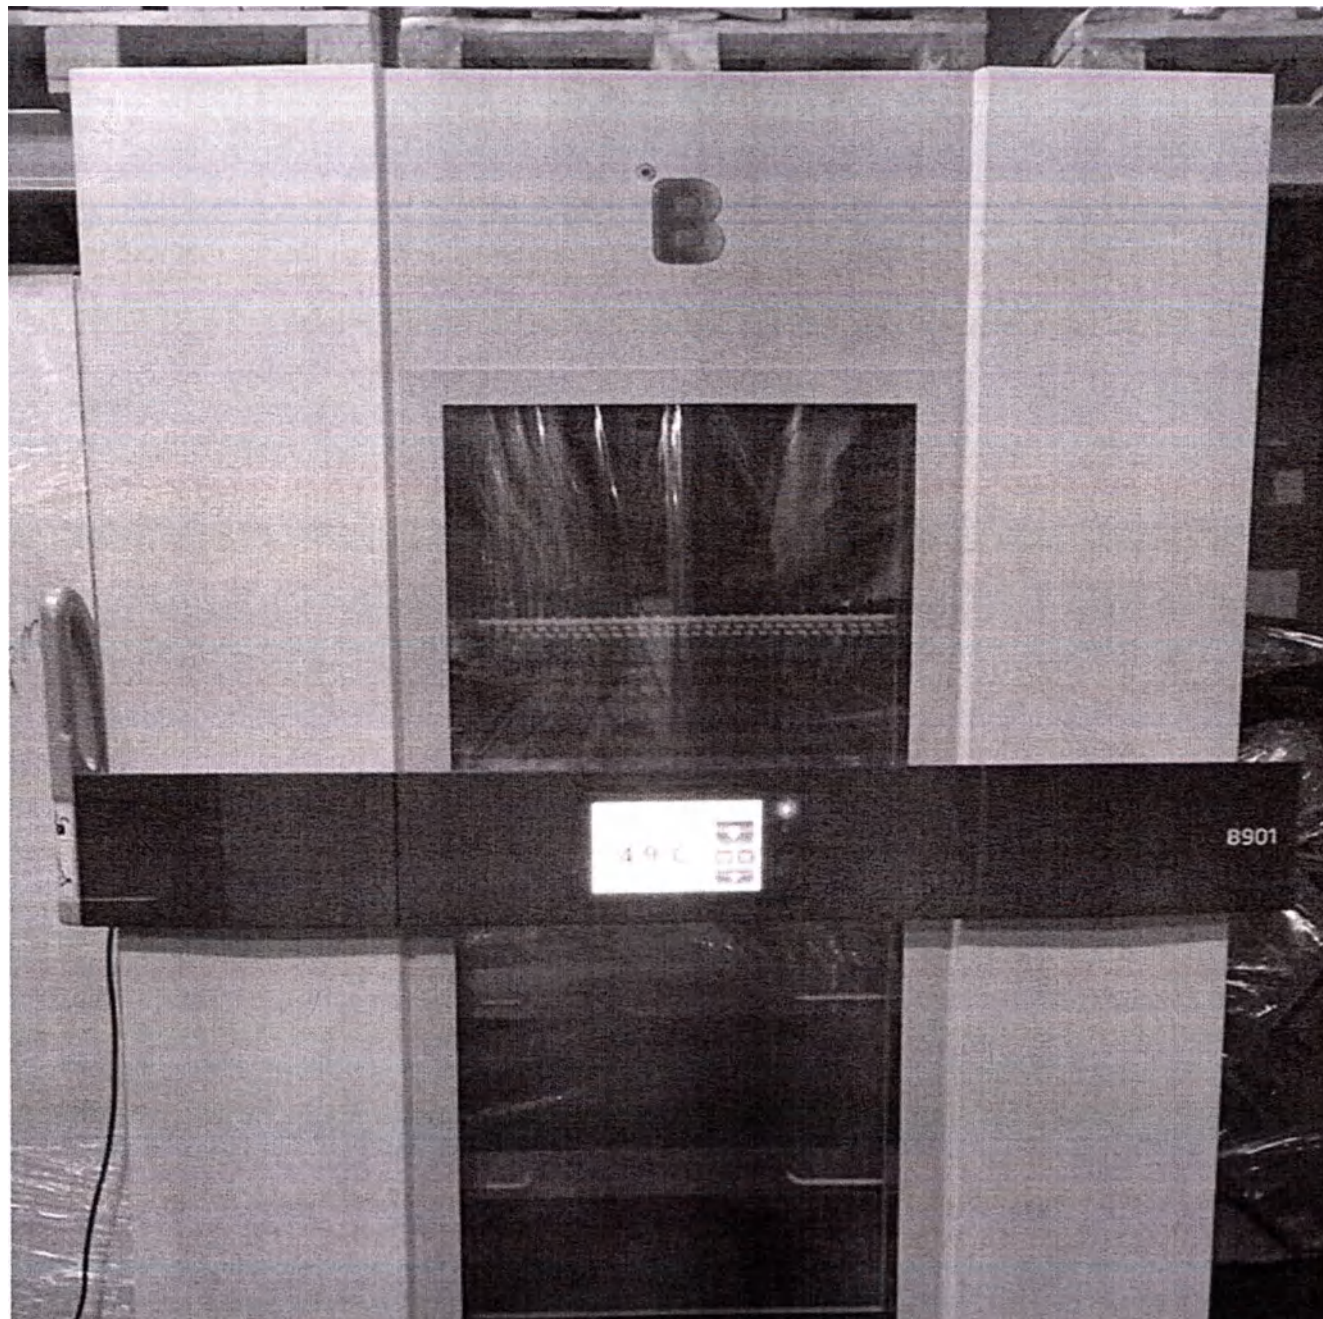

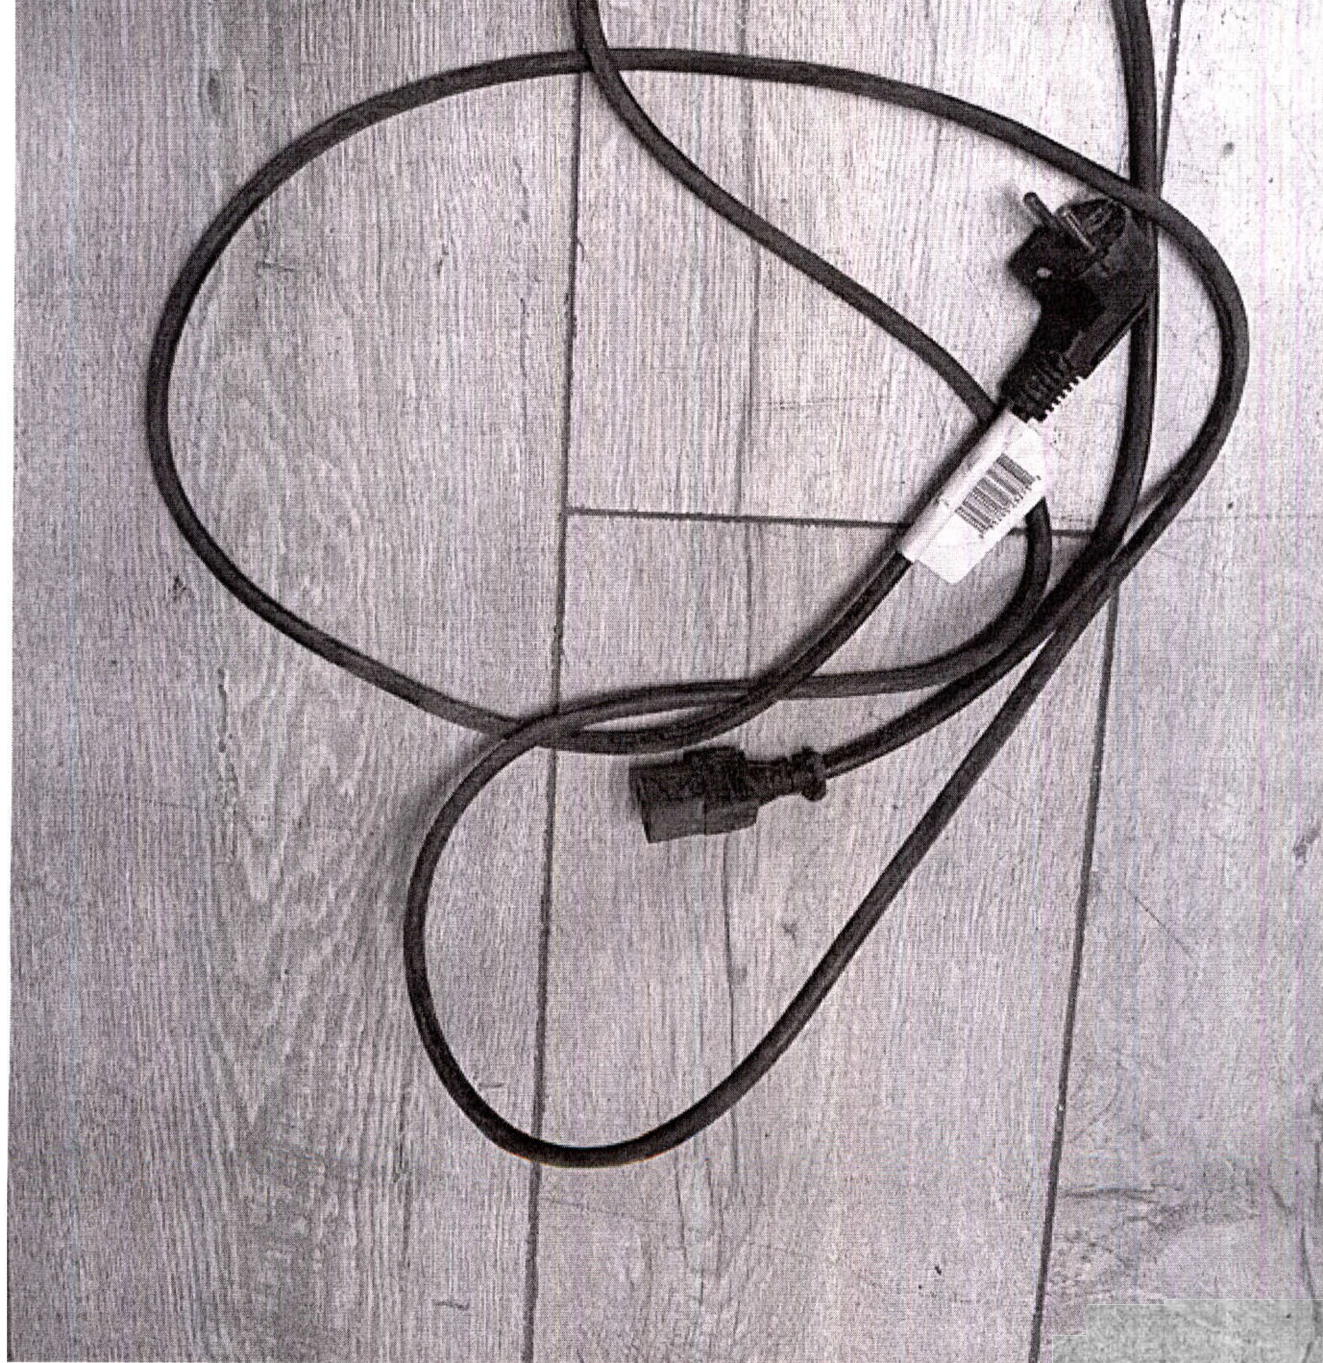


10. Ключ выключателя подачи электроэнергии

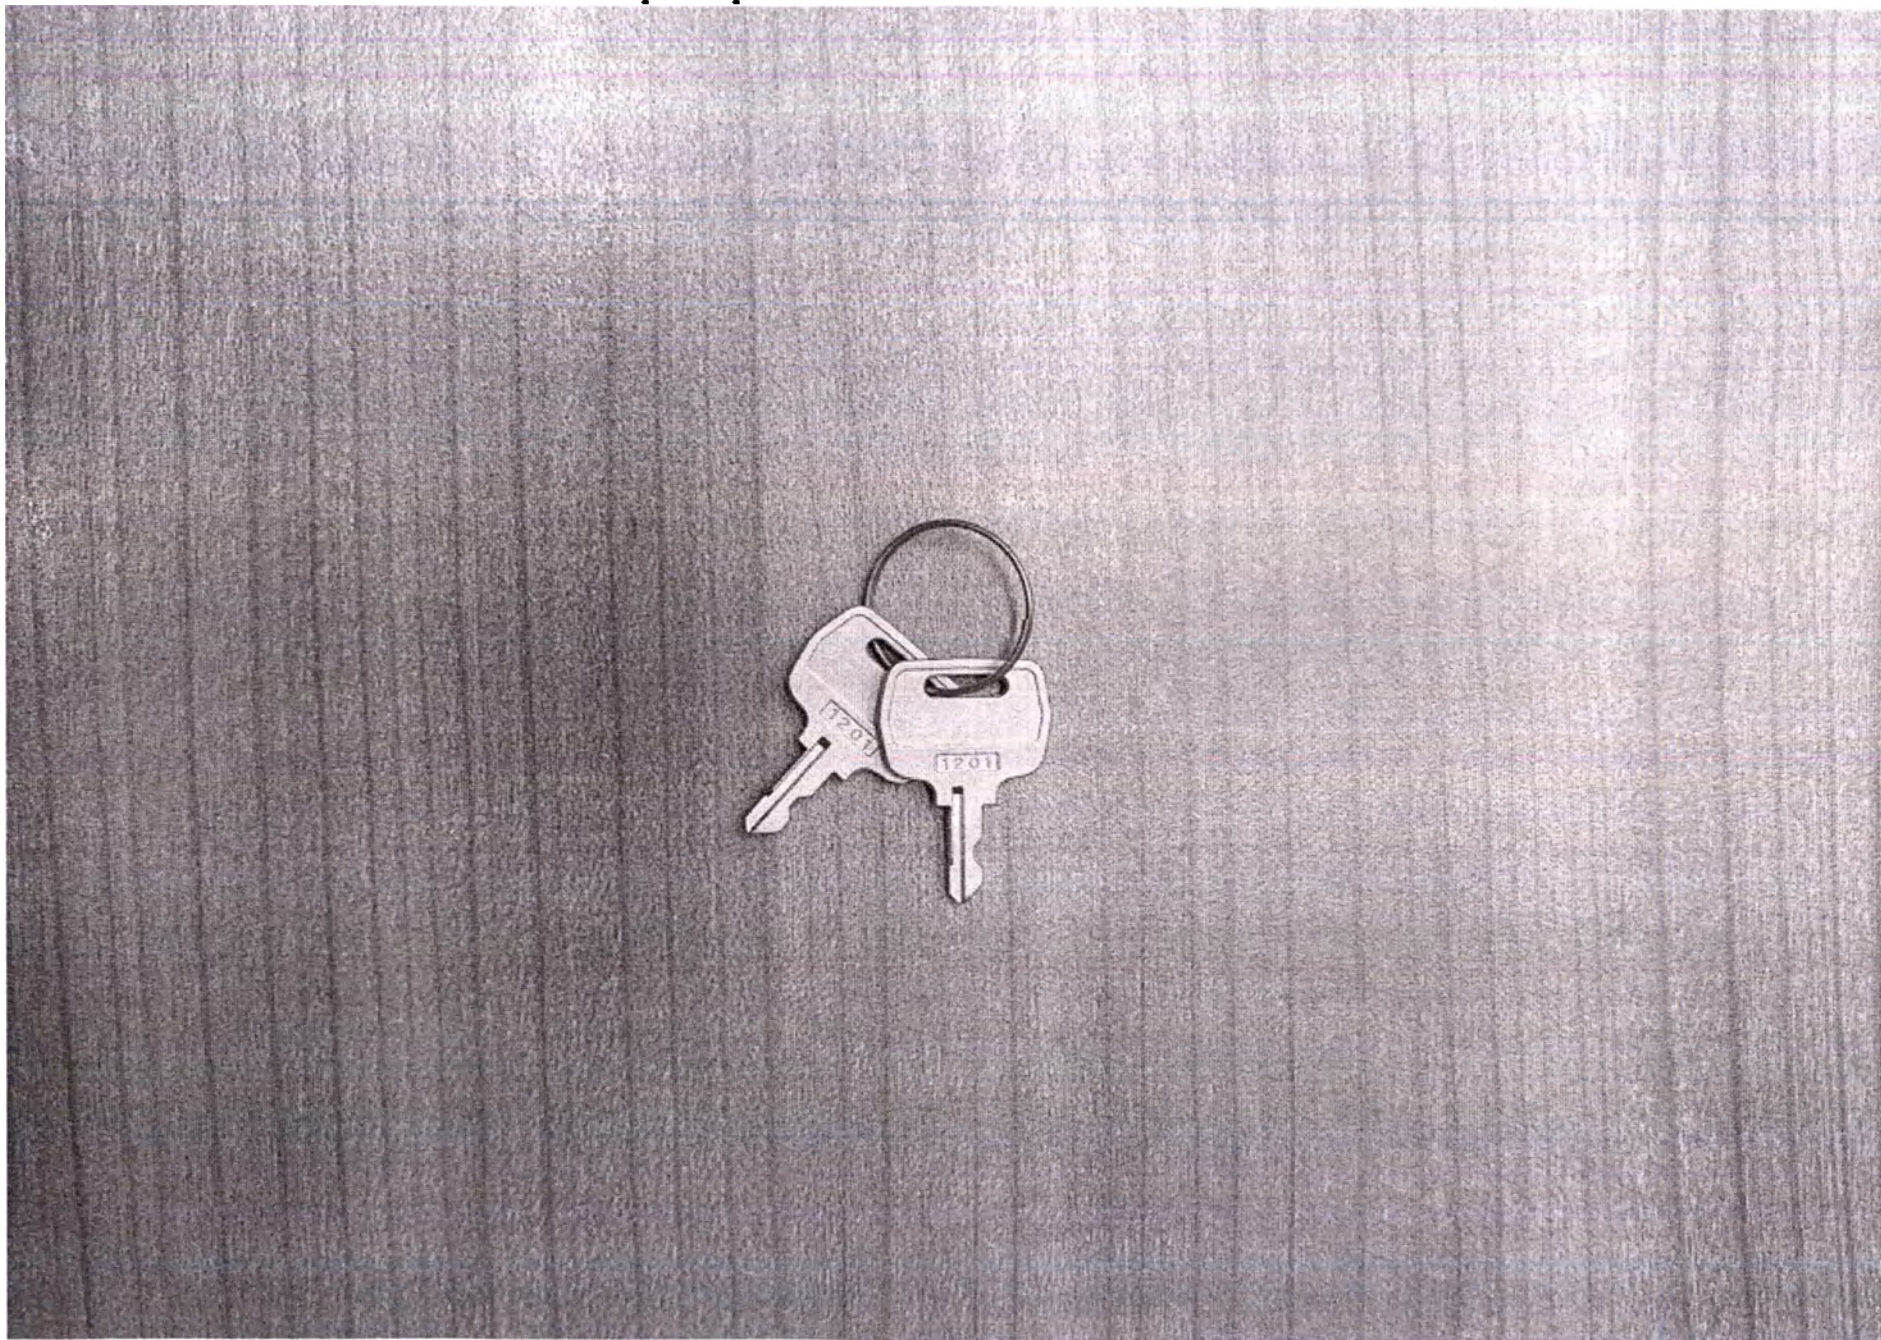


11.Ключ замка двери



12. Дистанционный упор

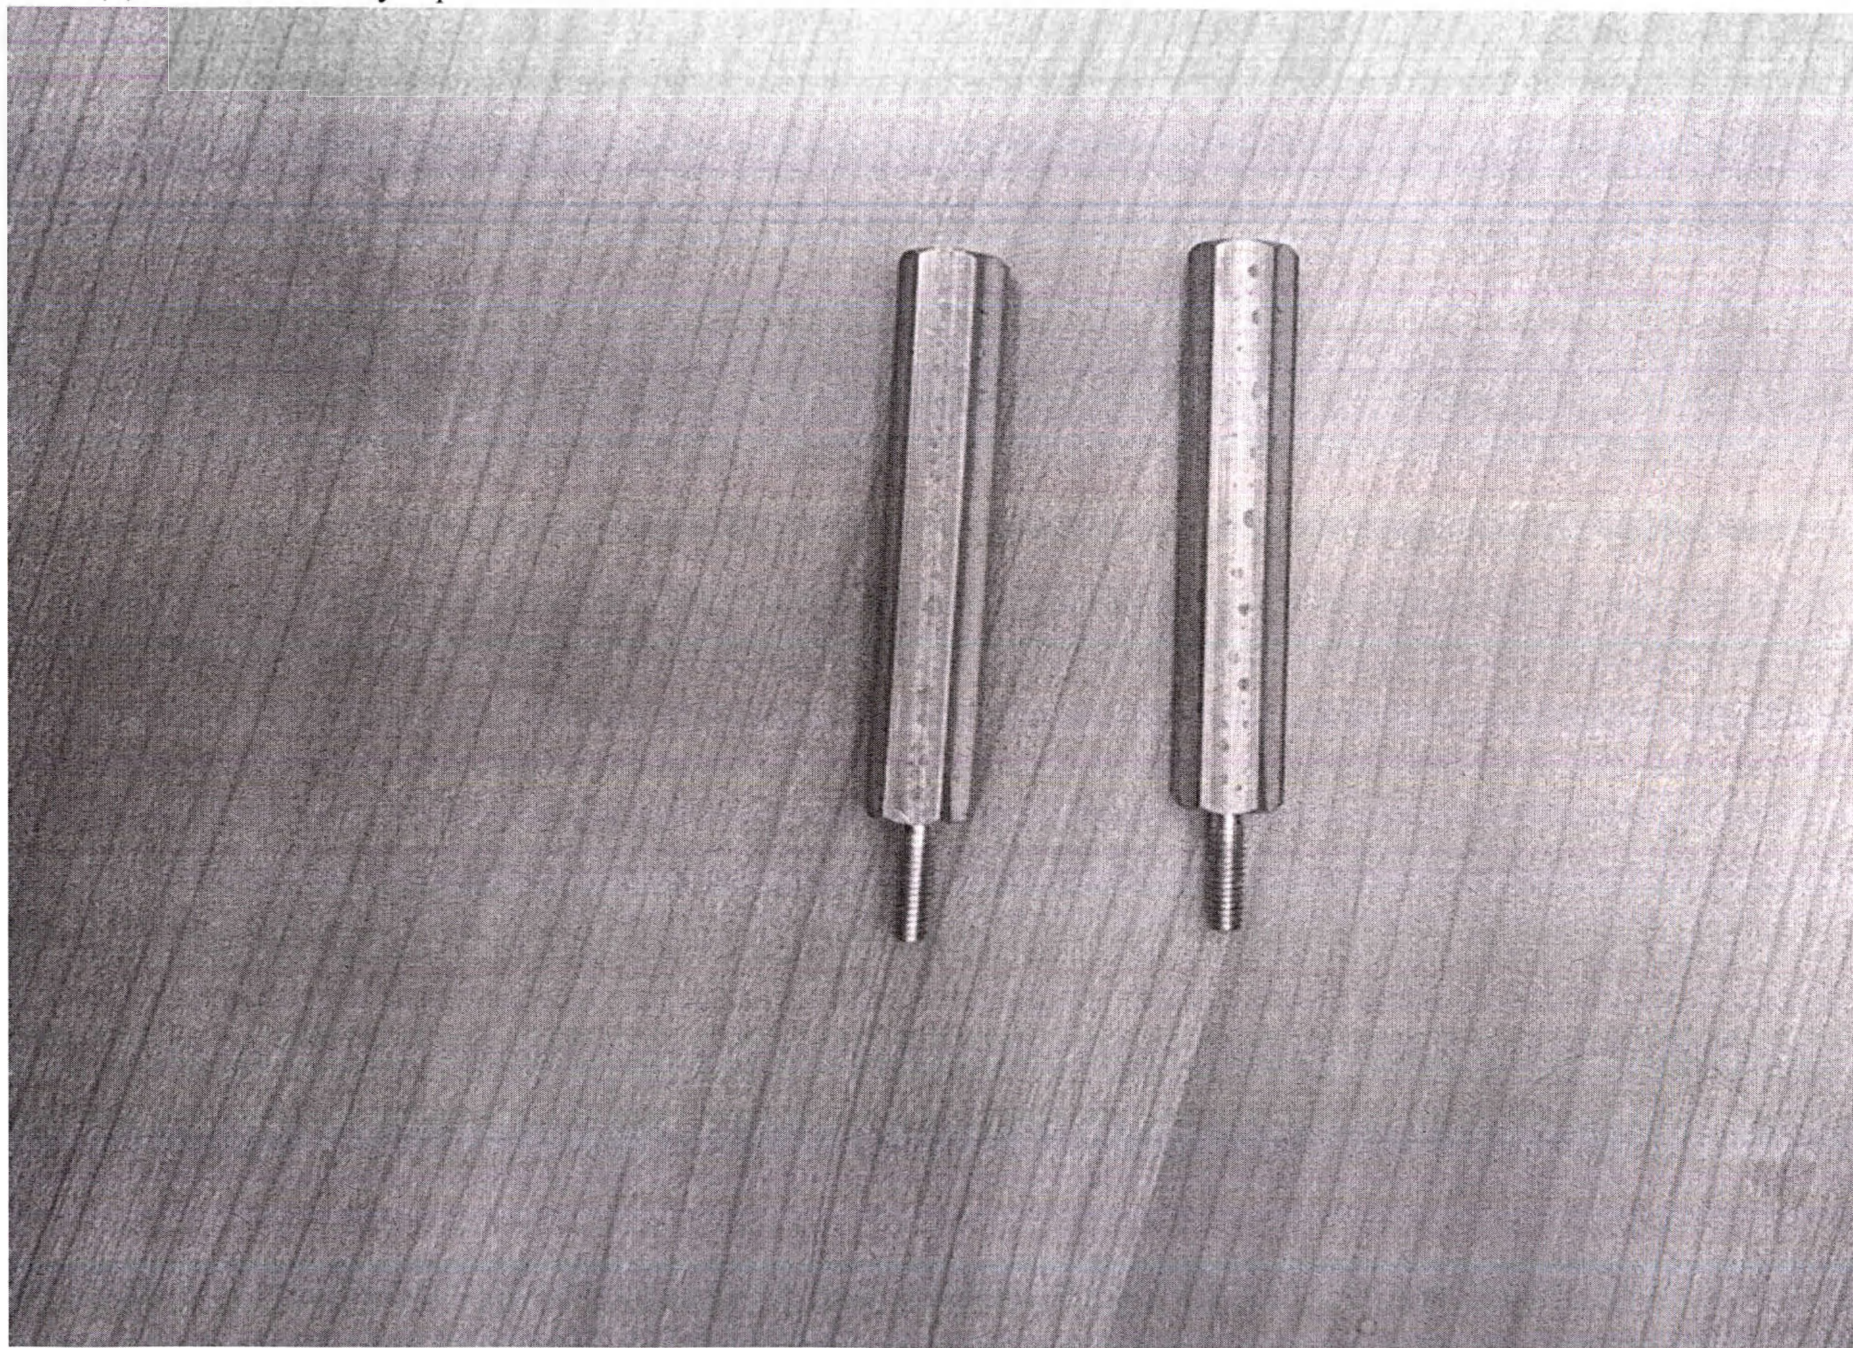

13. Трос для фиксации

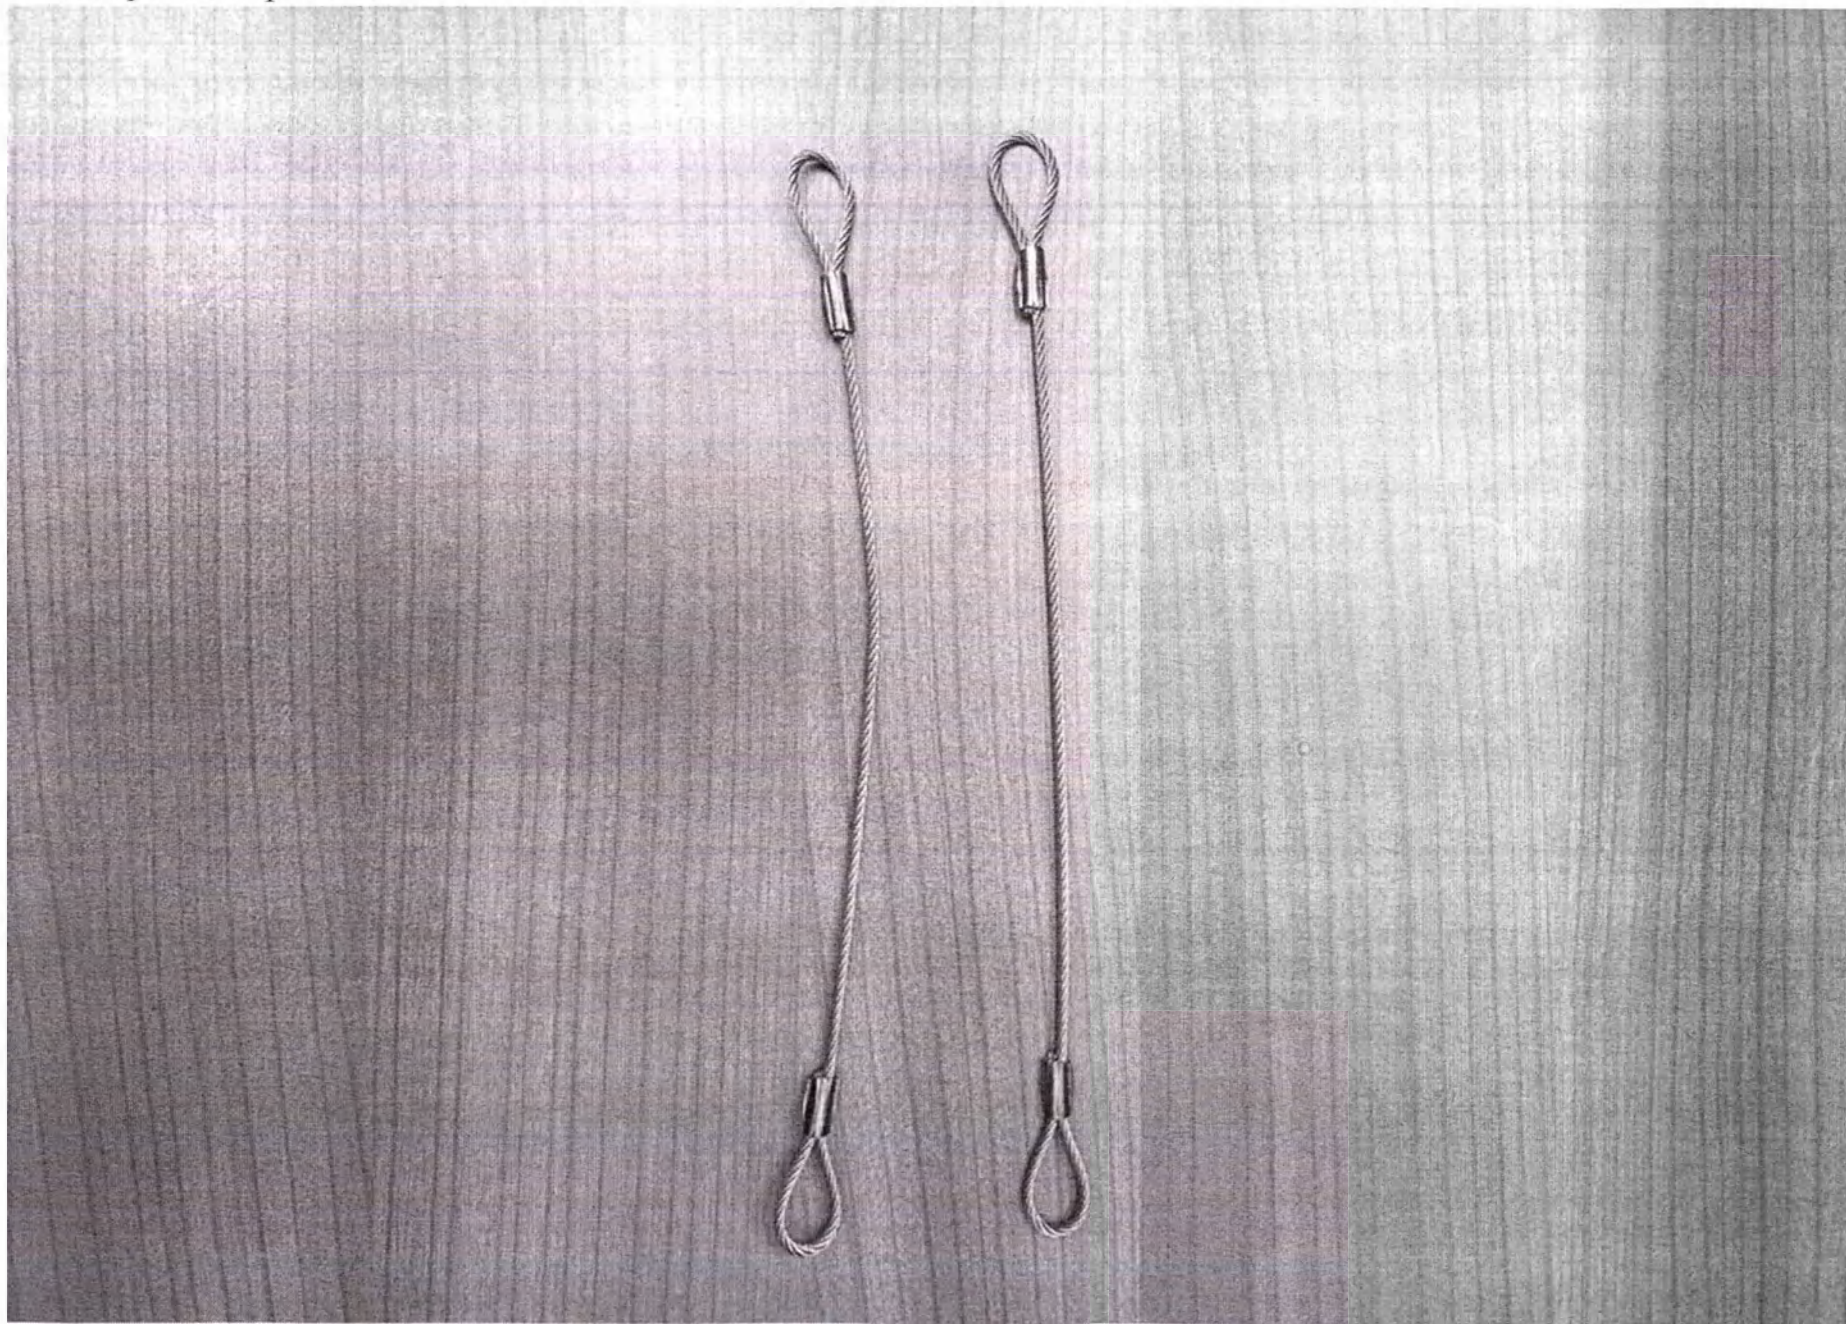

**DE**

Geräte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, müssen an dem örtlichen Sammelpunkt für die Entsorgung von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.
Dieses Produkt darf nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden.
Kühlschränke von „B Medical Systems“ enthalten das Symbol auf dem Typenschild.

DK

Apparater, som er mærket med dette symbol, skal afleveres hos det lokale opsamlingssted til bortskaffelse af elektriske og elektroniske apparater.

Dette produkt må ikke bortskaffes gennem normal husholdningsaffald. Køleskabe fra „B Medical Systems“ har symbolet på dataskiltet (typeskiltet).

EN

Appliances bearing this symbol must be deposited at the designated local reception point for the disposal of electrical and electronic equipment.

It is not permitted that this product be disposed of by way of the normal household refuse collection system.

„B Medical Systems“ refrigerators bear this symbol on the specifications plate (data plate).

ES

Los aparatos que lleven este símbolo deberán depositarse en los lugares locales de recogida de aparatos eléctricos y electrónicos. Este producto no debe desecharse en la basura doméstica convencional.

Los refrigeradores de „B Medical Systems“ llevan el símbolo en la placa de datos (placa indicadora) situada en el interior del aparato.

FR

Les appareils portant ce symbole doivent être obligatoirement remis à un point de collecte local pour la mise au rebut d'appareils électriques et électroniques.

Il est interdit de jeter ce produit dans les ordures ménagères.

Sur les réfrigérateurs „B Medical Systems“, le symbole figure sur la plaque des caractéristiques (plaque signalétique).

FI

Laitteet, jotka on merkitty viereisellä symbolilla, tulee toimittaa paikalliseen keräyspisteeseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden jätahuoltomääräysten mukaisesti.

Tätä tuotetta ei saa hävittää normaali kotitalousjätteiden mukana.

„B Medical Systems“ jääkaapeissa symboli löytyy laitteen sisäpuolelle sijoitetusta tyyppikilvestä.

IT

Gli apparecchi che sono contrassegnati con questo simbolo devono essere consegnati al posto di raccolta locale per lo smaltimento e il trattamento di apparecchi elettrici ed elettronici.

Questo prodotto non deve essere smaltito con i normali rifiuti domestici.

Il simbolo si trova sulla targhetta dei dati tecnici dei frigoriferi „B Medical Systems“ (targhetta del modello).

NL

Apparaten, die met dit symbool zijn voorzien, moeten bij het gemeentelijk verzamelpunt voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur worden afgegeven.

Ze mogen niet via het gewone huishafval worden weggegooid.

Bij koelkasten van „B Medical Systems“ staat het symbool op het typeplaatje.

NO

Apparater som er kjennetegnet med dette symbolet, må deponeres på lokale deponier for elektriske eller elektroniske apparater.

Dette produktet må ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Kjøleskap fra „B Medical Systems“ bærer symbolet på typeskiltet.

PT

Aparelhos caracterizados com este símbolo precisam ser jogados fora nos pontos de recolhalocais especiais para descarte de aparelhos eléctricos e electrónicos.

Este aparelho não deve ser jogado fora junto com o lixo doméstico normal!

Os frigoríficos da „B Medical Systems“ levam um símbolo na placa de características técnicas(placa do tipo).

SE

Apparater märkta med denna symbol skall lämnas in till kommunens samlingsställe för omhändertagande av elektriska och elektroniska apparater.

Denna produkt får inte slängas i hushållsavfallet.

På kylskåp från „B Medical Systems“ sitter denna symbol på märkskylten (typskylten).

GR

Συσκευές με αυτό το σύμβολο πρέπει να συγκεντρώνονται για αποκομιδή στα τοπικά σημεία αποκομιδής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών.

Απαγορεύεται η αποκομιδή αυτού του προϊόντος μαζί με τα συνήθη απορρίμματα του νοικοκυριού. Τα ψυγεία φέρουν αυτό το σύμβολο στην πινακίδα δεδομένων (πινακίδα μοντέλου).


RU

Приборы, имеющие этот символ, должны быть помещены в специальный местный пункт приема для утилизации электрического и электронного оборудования.

Не допускается утилизация данного продукта путем обычной системы сбора бытовых отходов.


Приборы B Medical Systems S.a. r.l. имеют этот символ на шильдике с маркировкой.


15.Руководство по эксплуатации, в электронном виде, на USB-флеш-накопителе

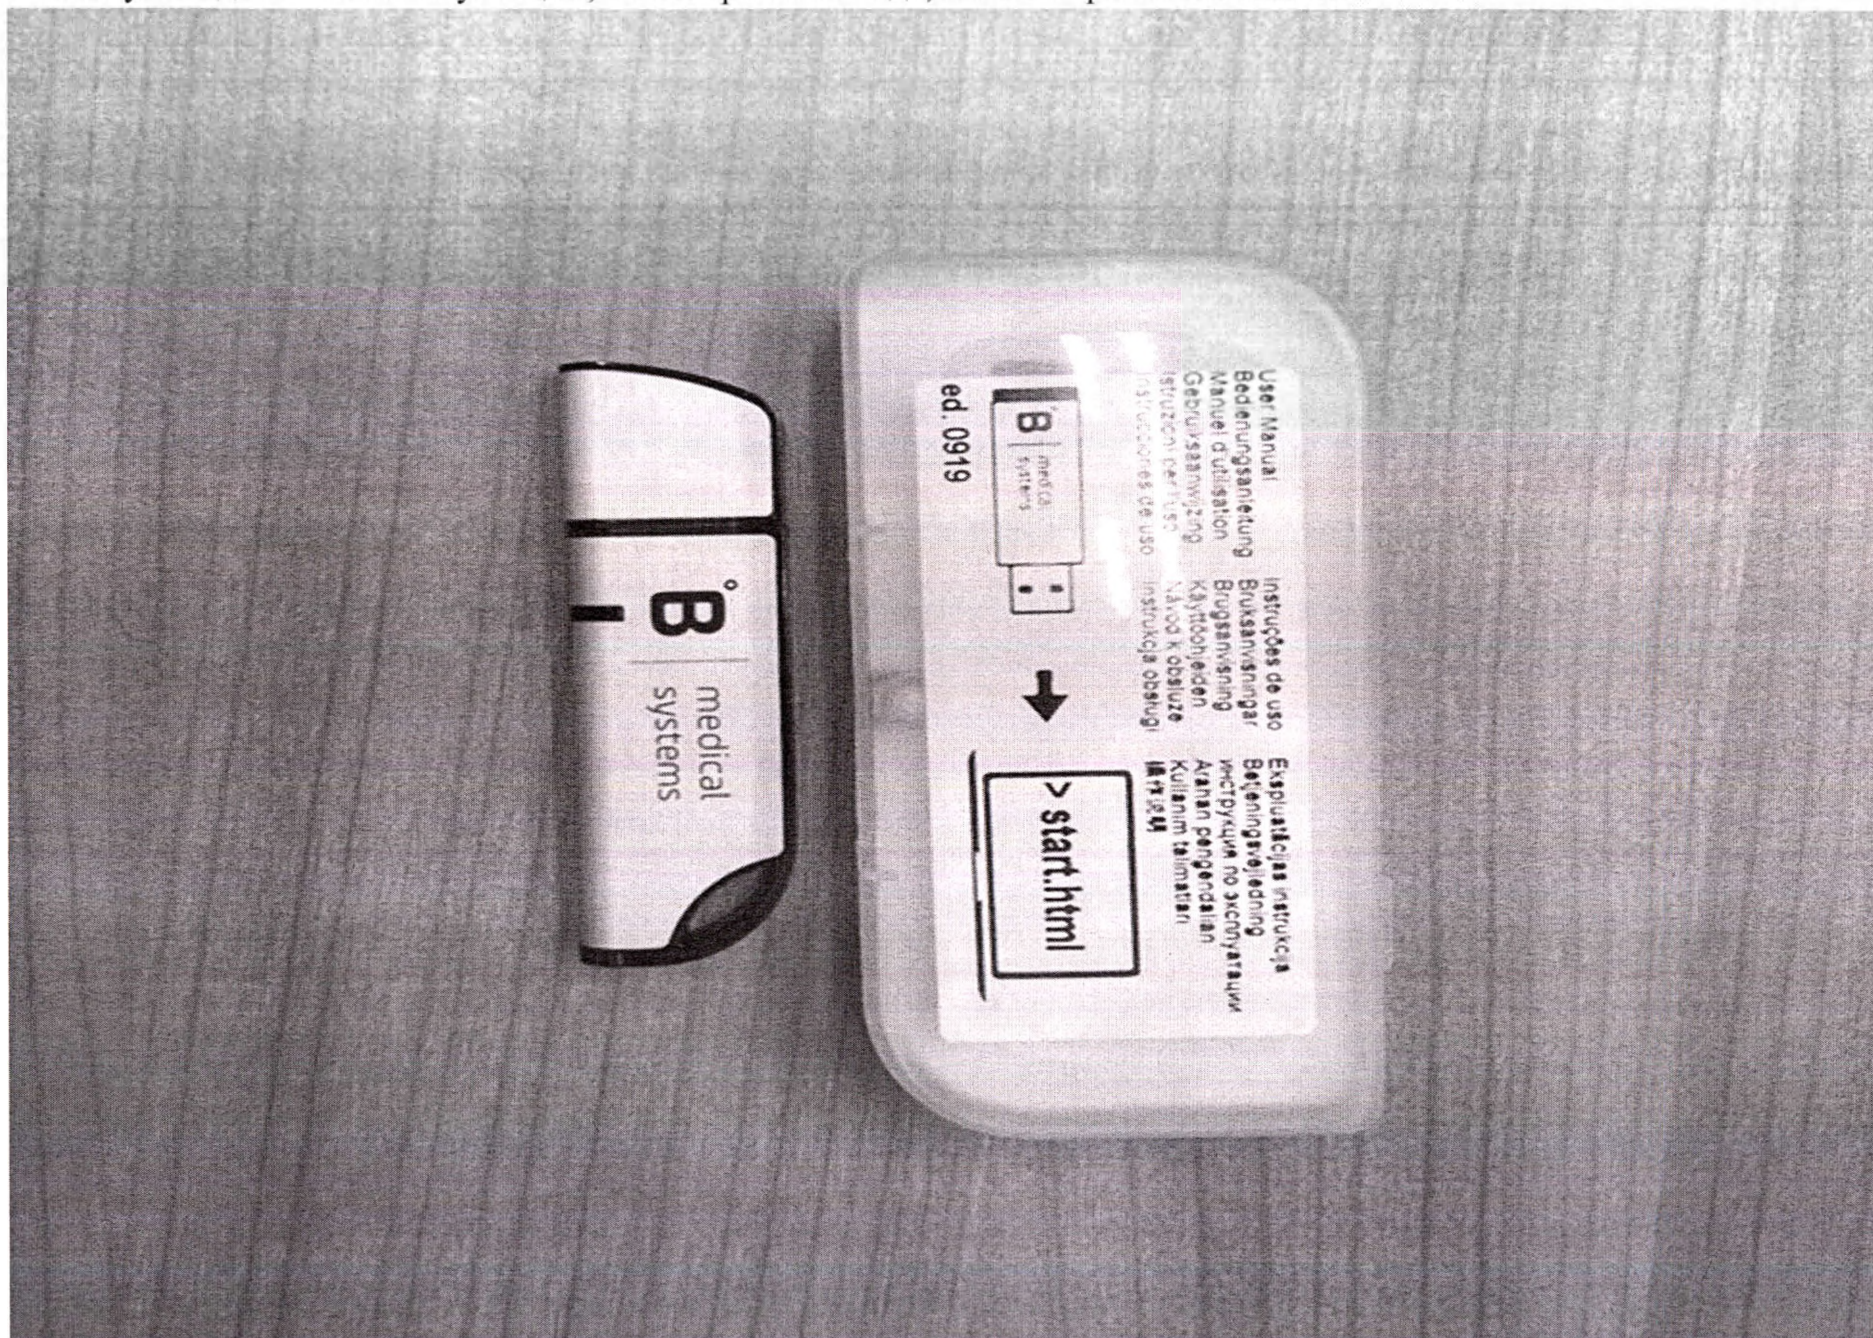


16. Устройство передачи данных на компьютер DCU, в составе:

16.1 Устройство DCU

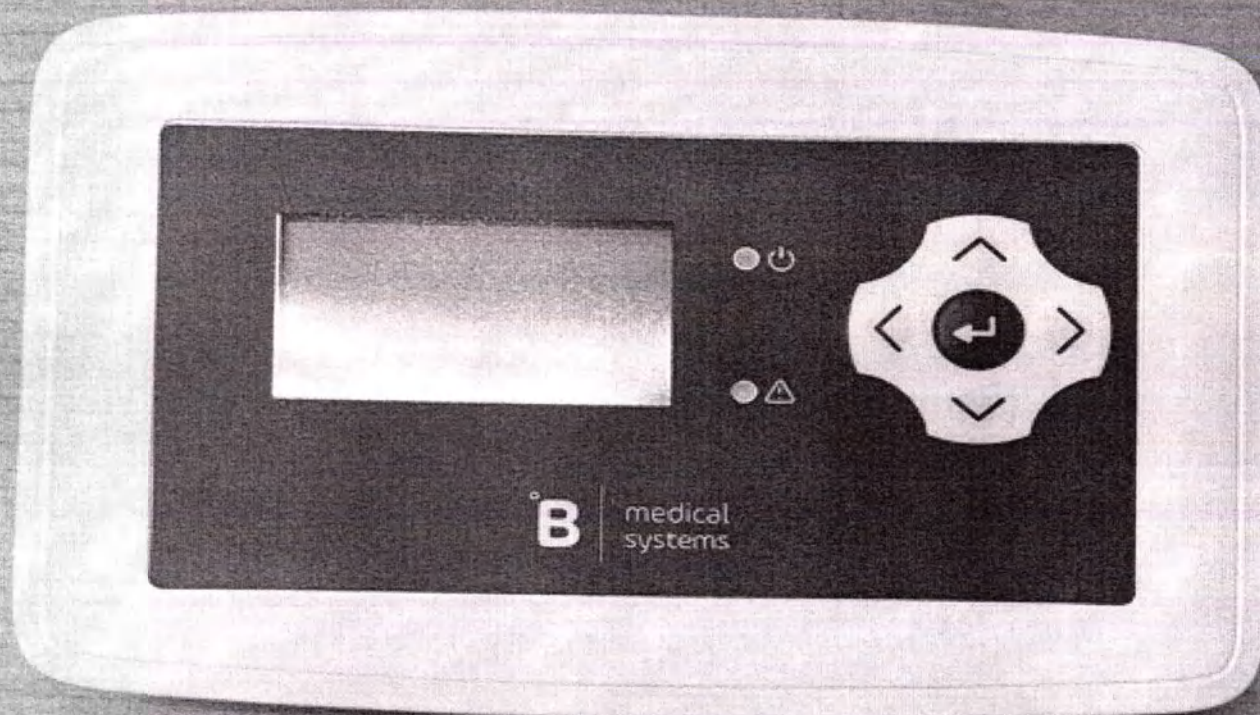


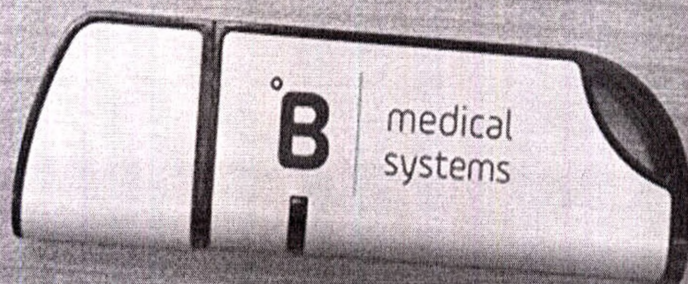


17.3 Стенд DCU

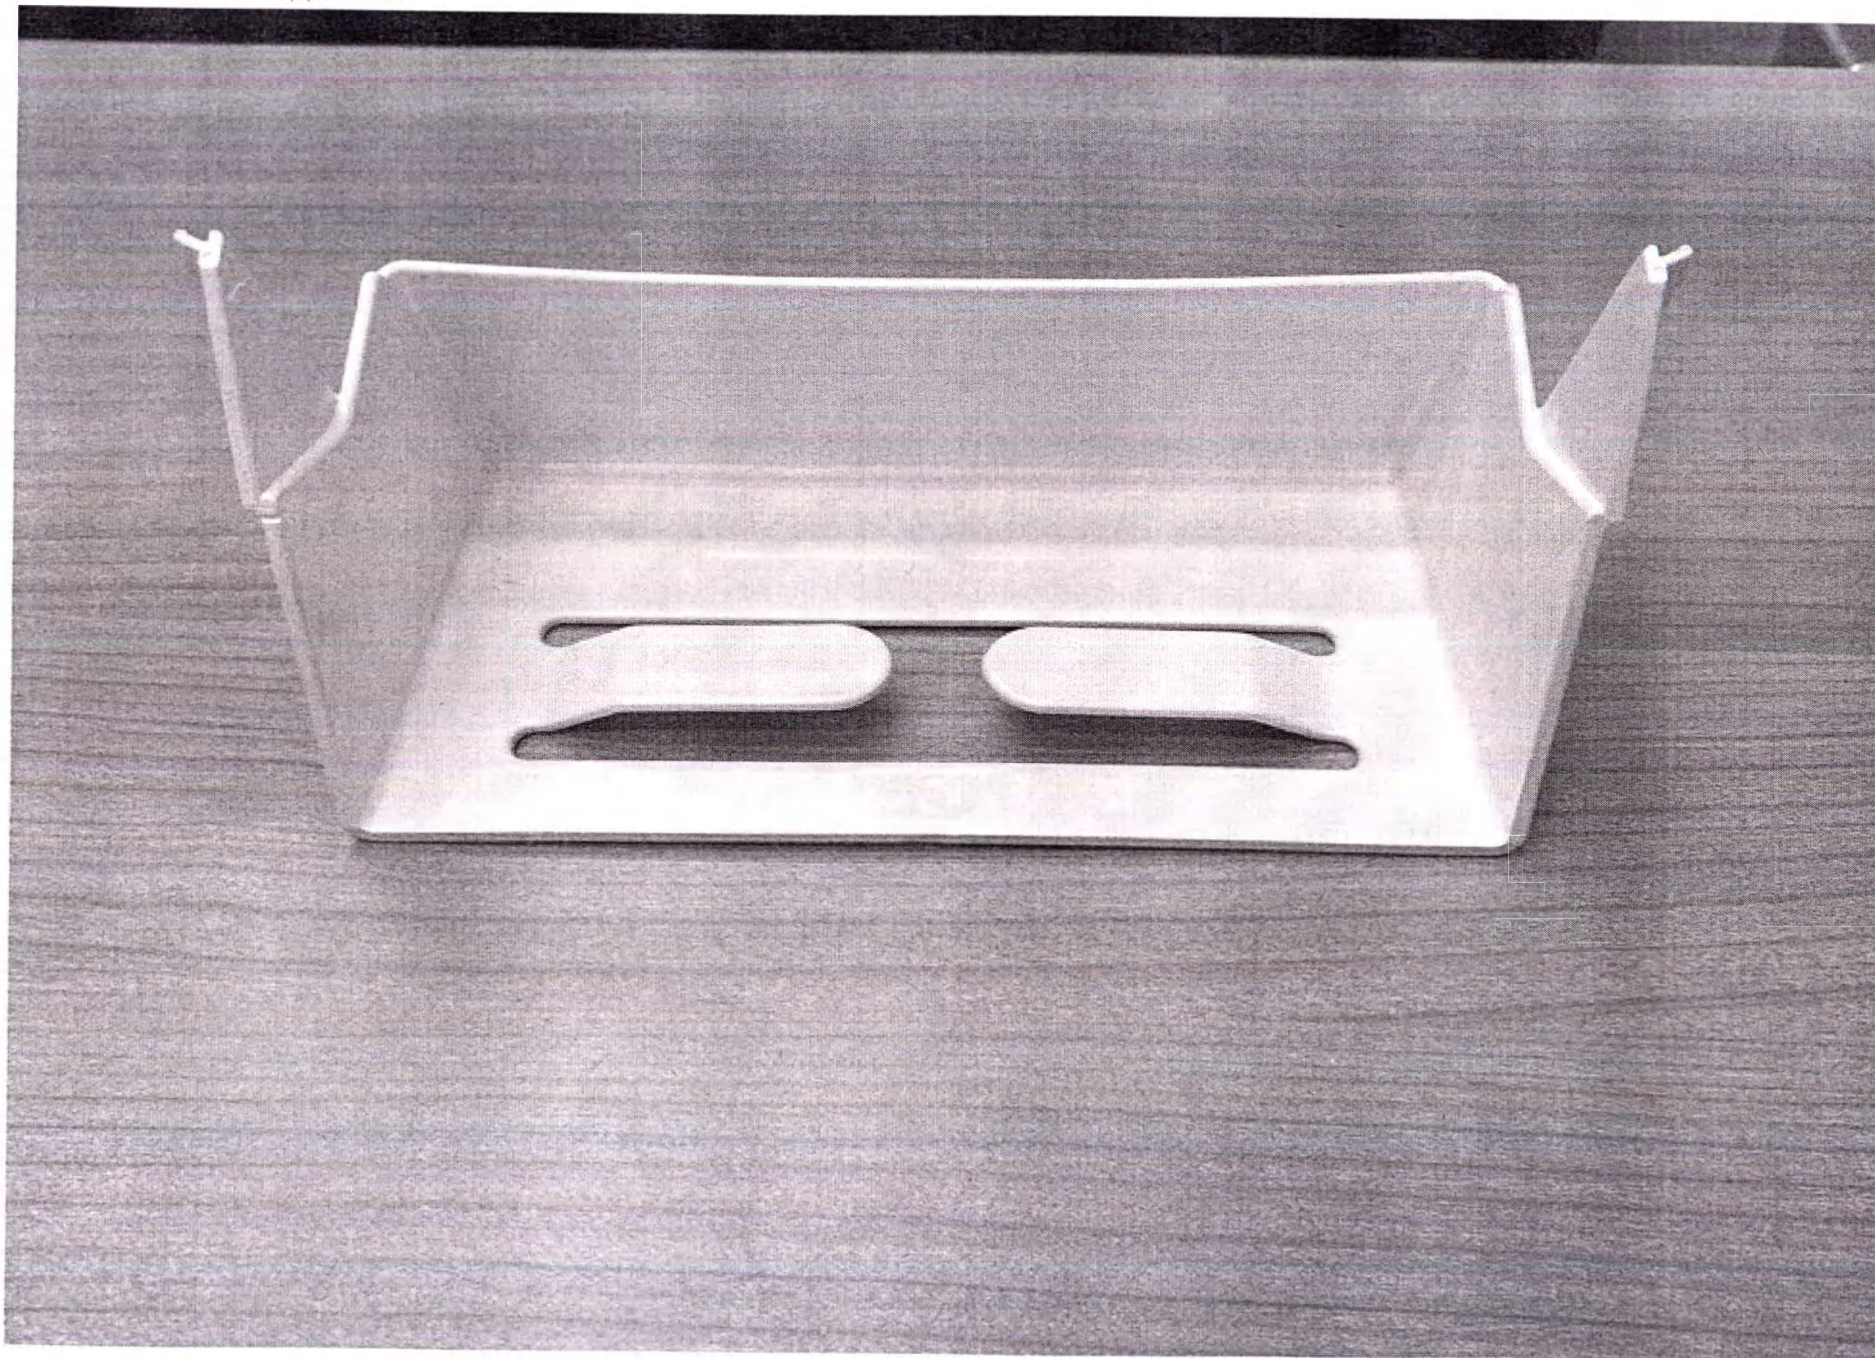


16.3 Кронштейн настенный

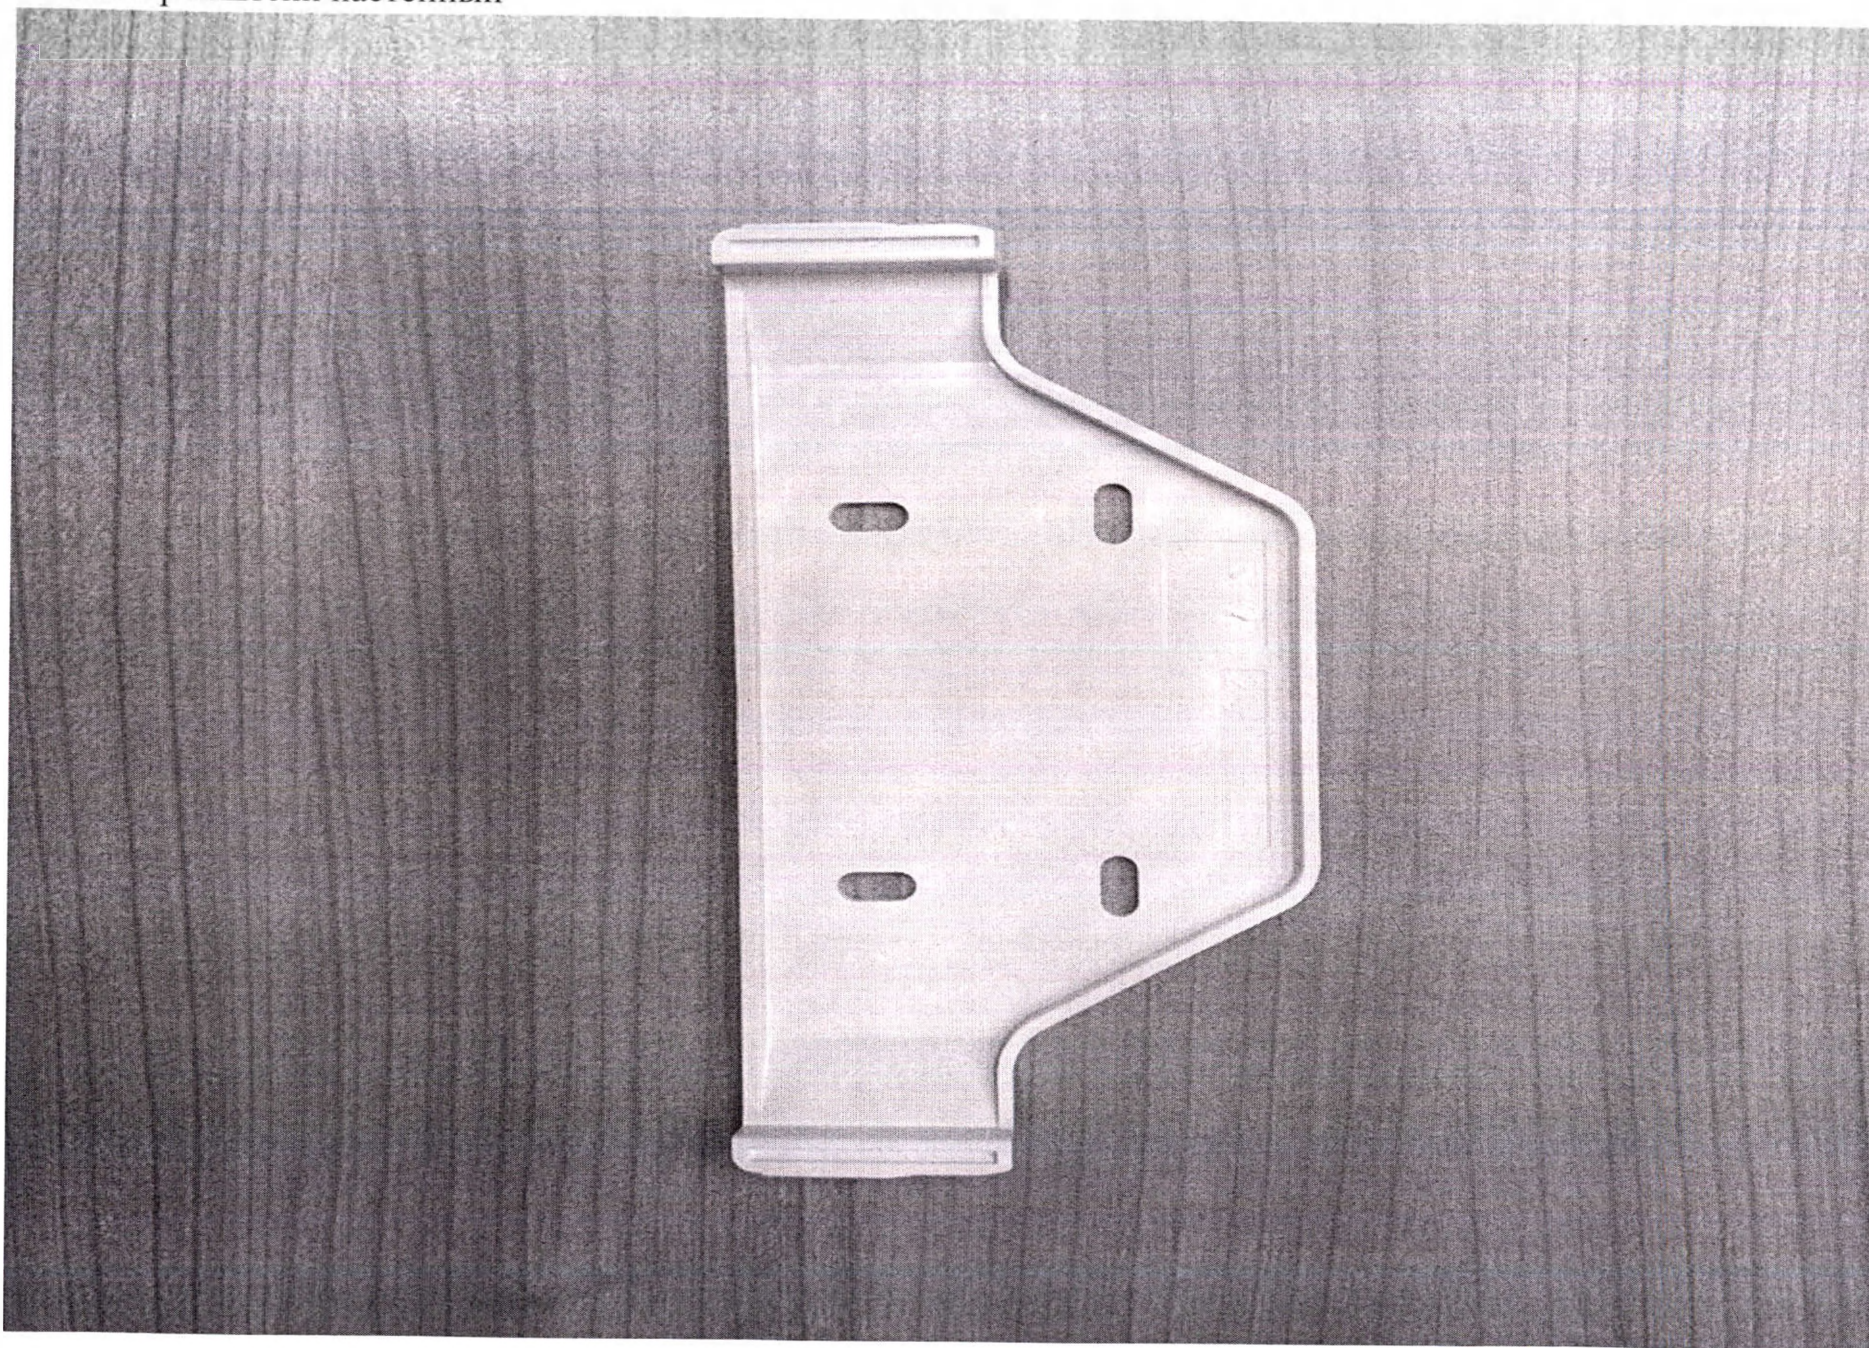


16.4 Блок питания универсальный 5 В

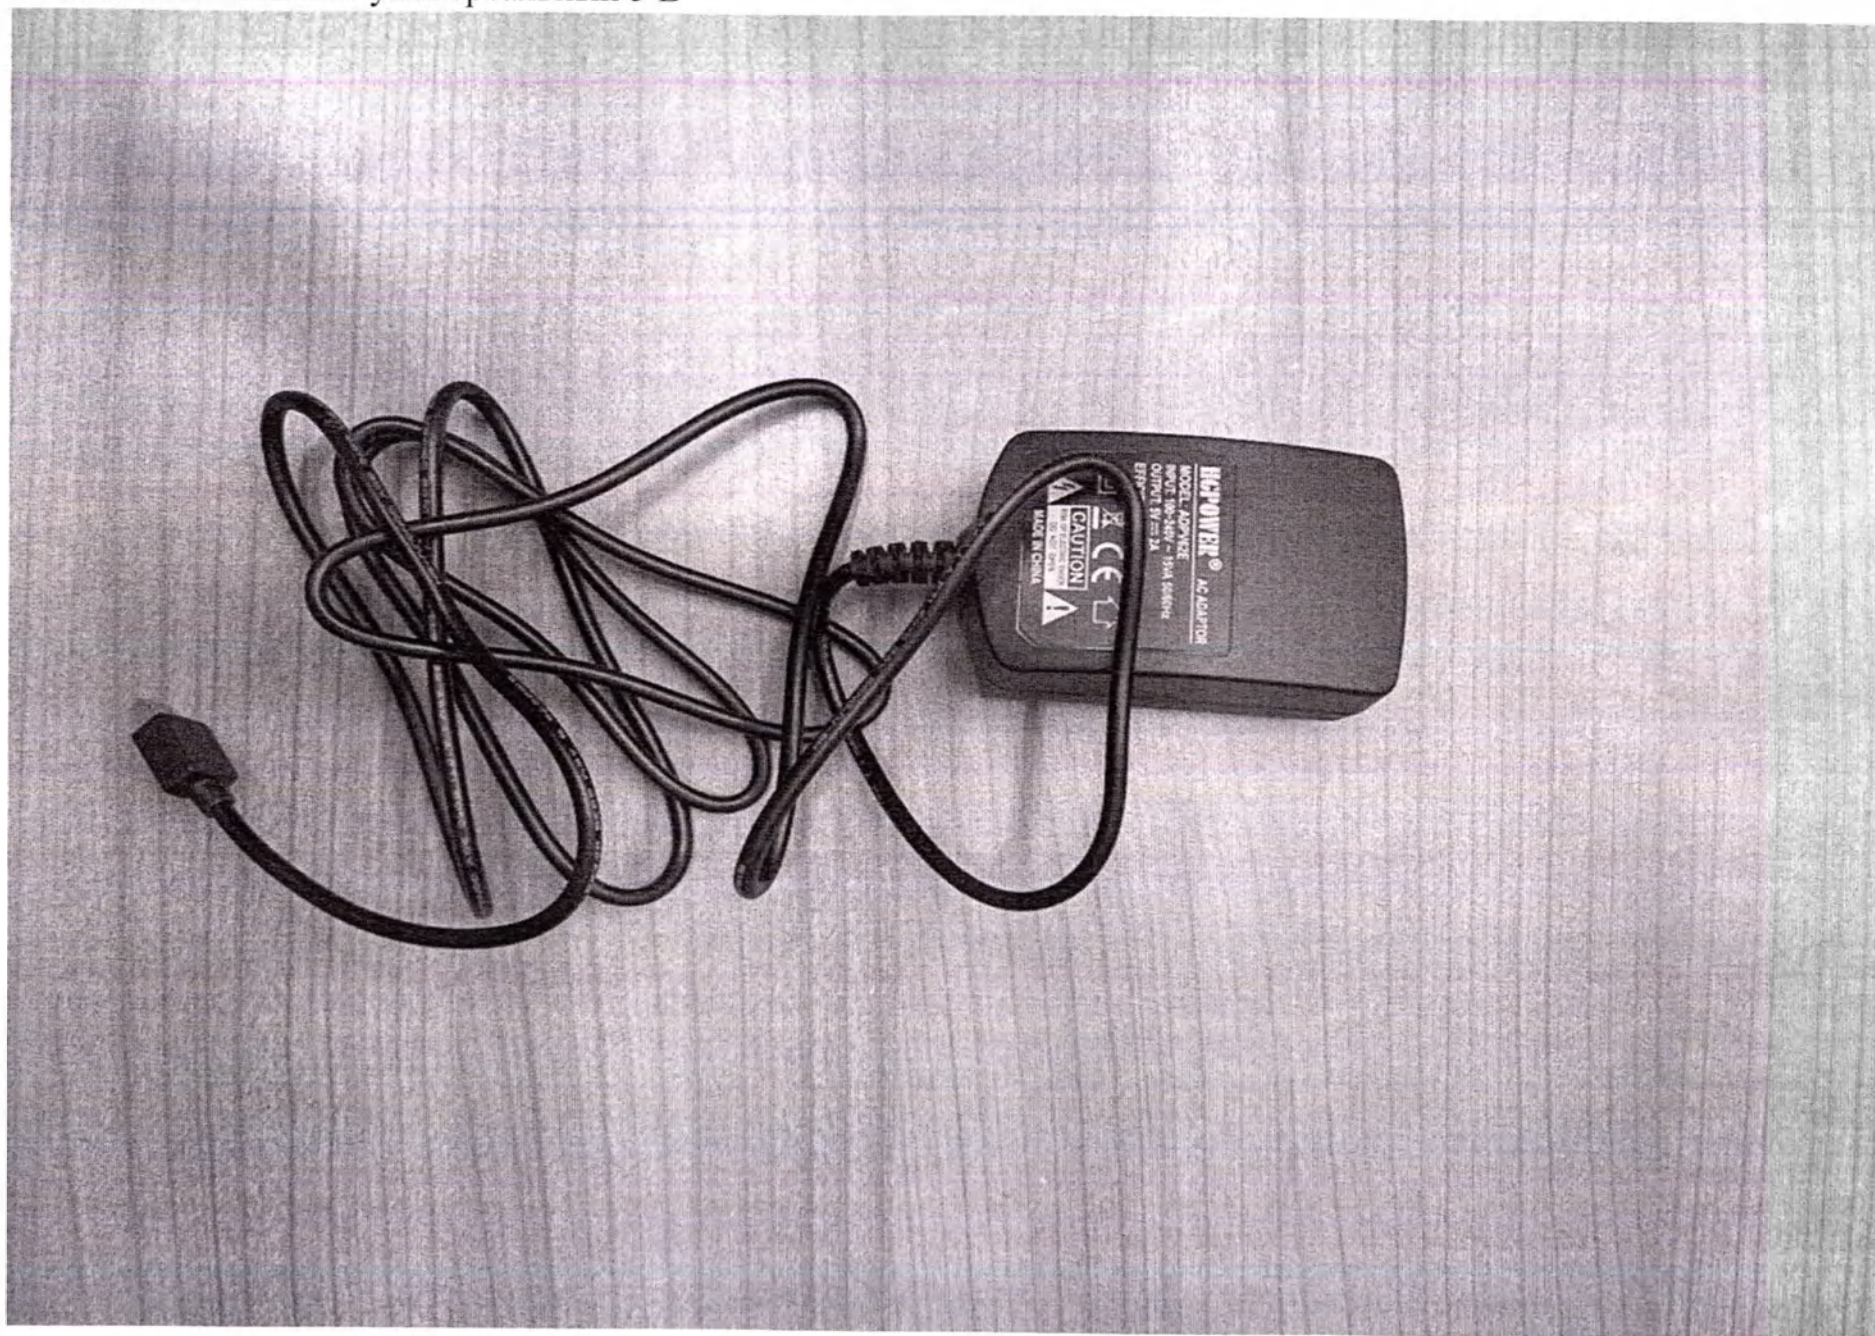


17.5 Кабель RS-485, 2000 мм

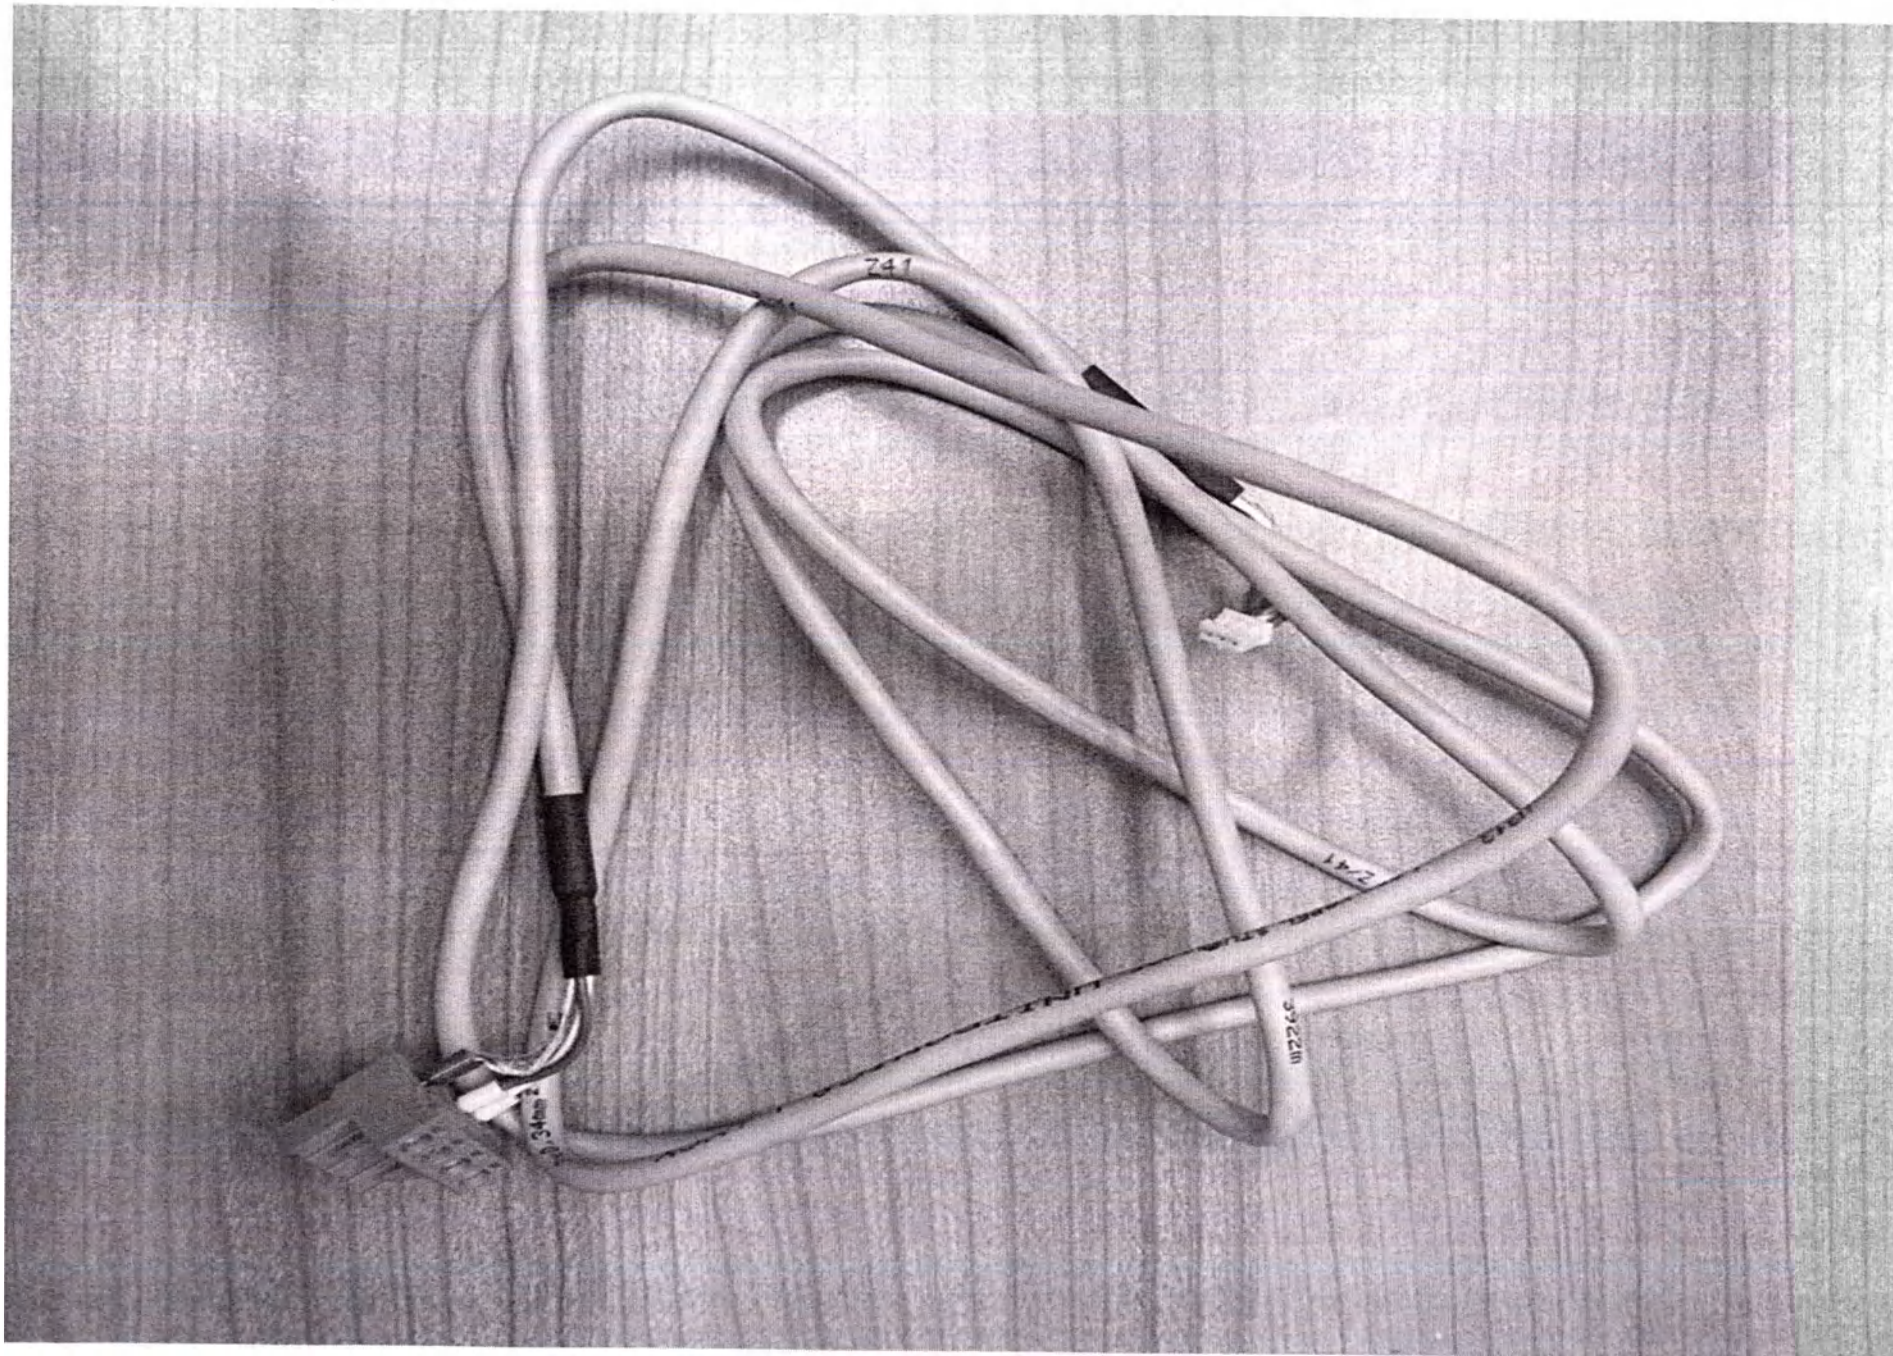


17.6 Кабель RS-485, 5000 мм

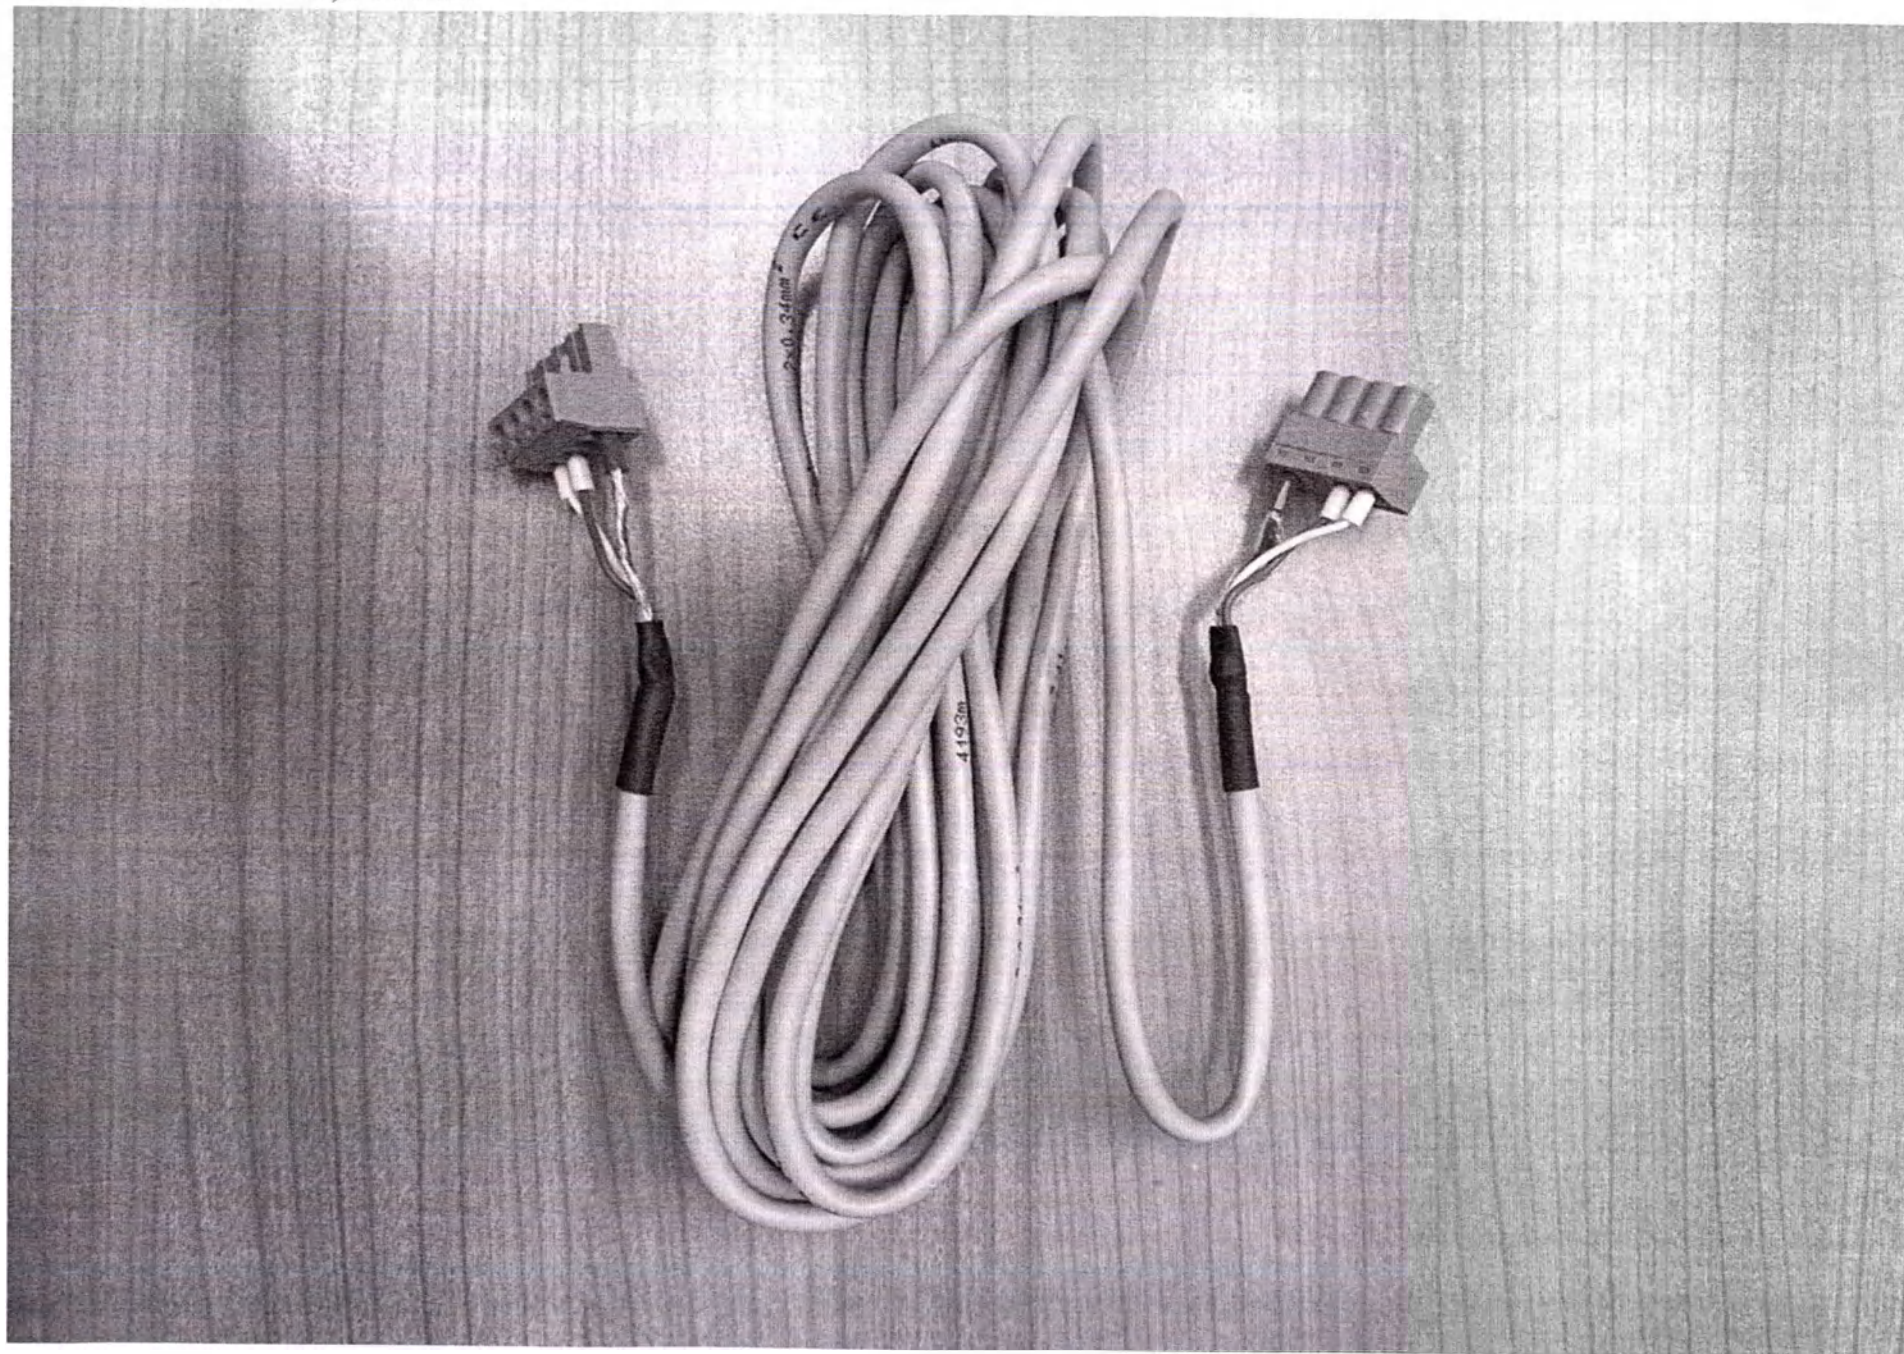


17.7 Адаптер EU

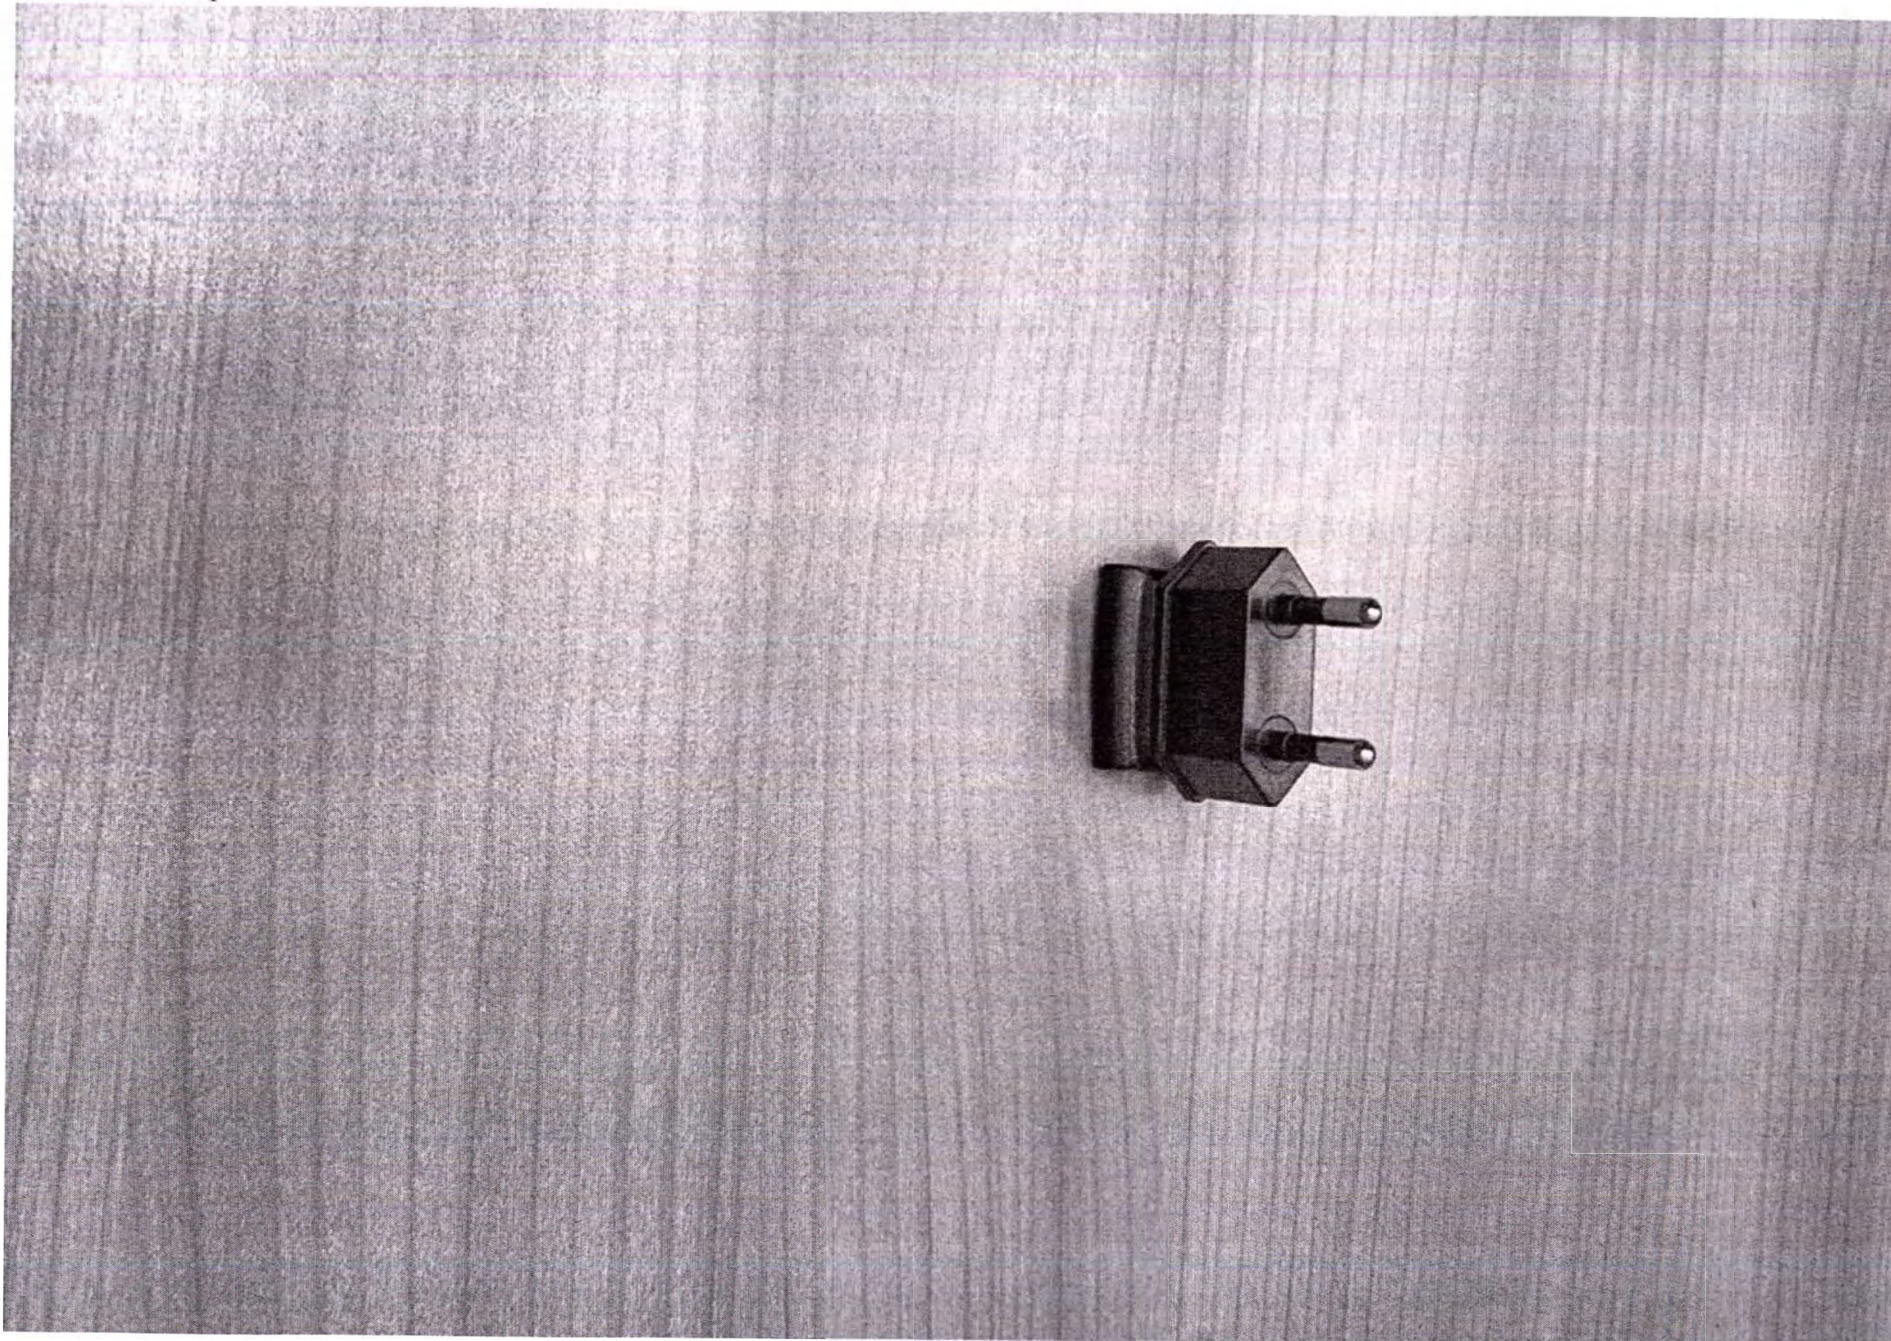


17.8 Адаптер UK

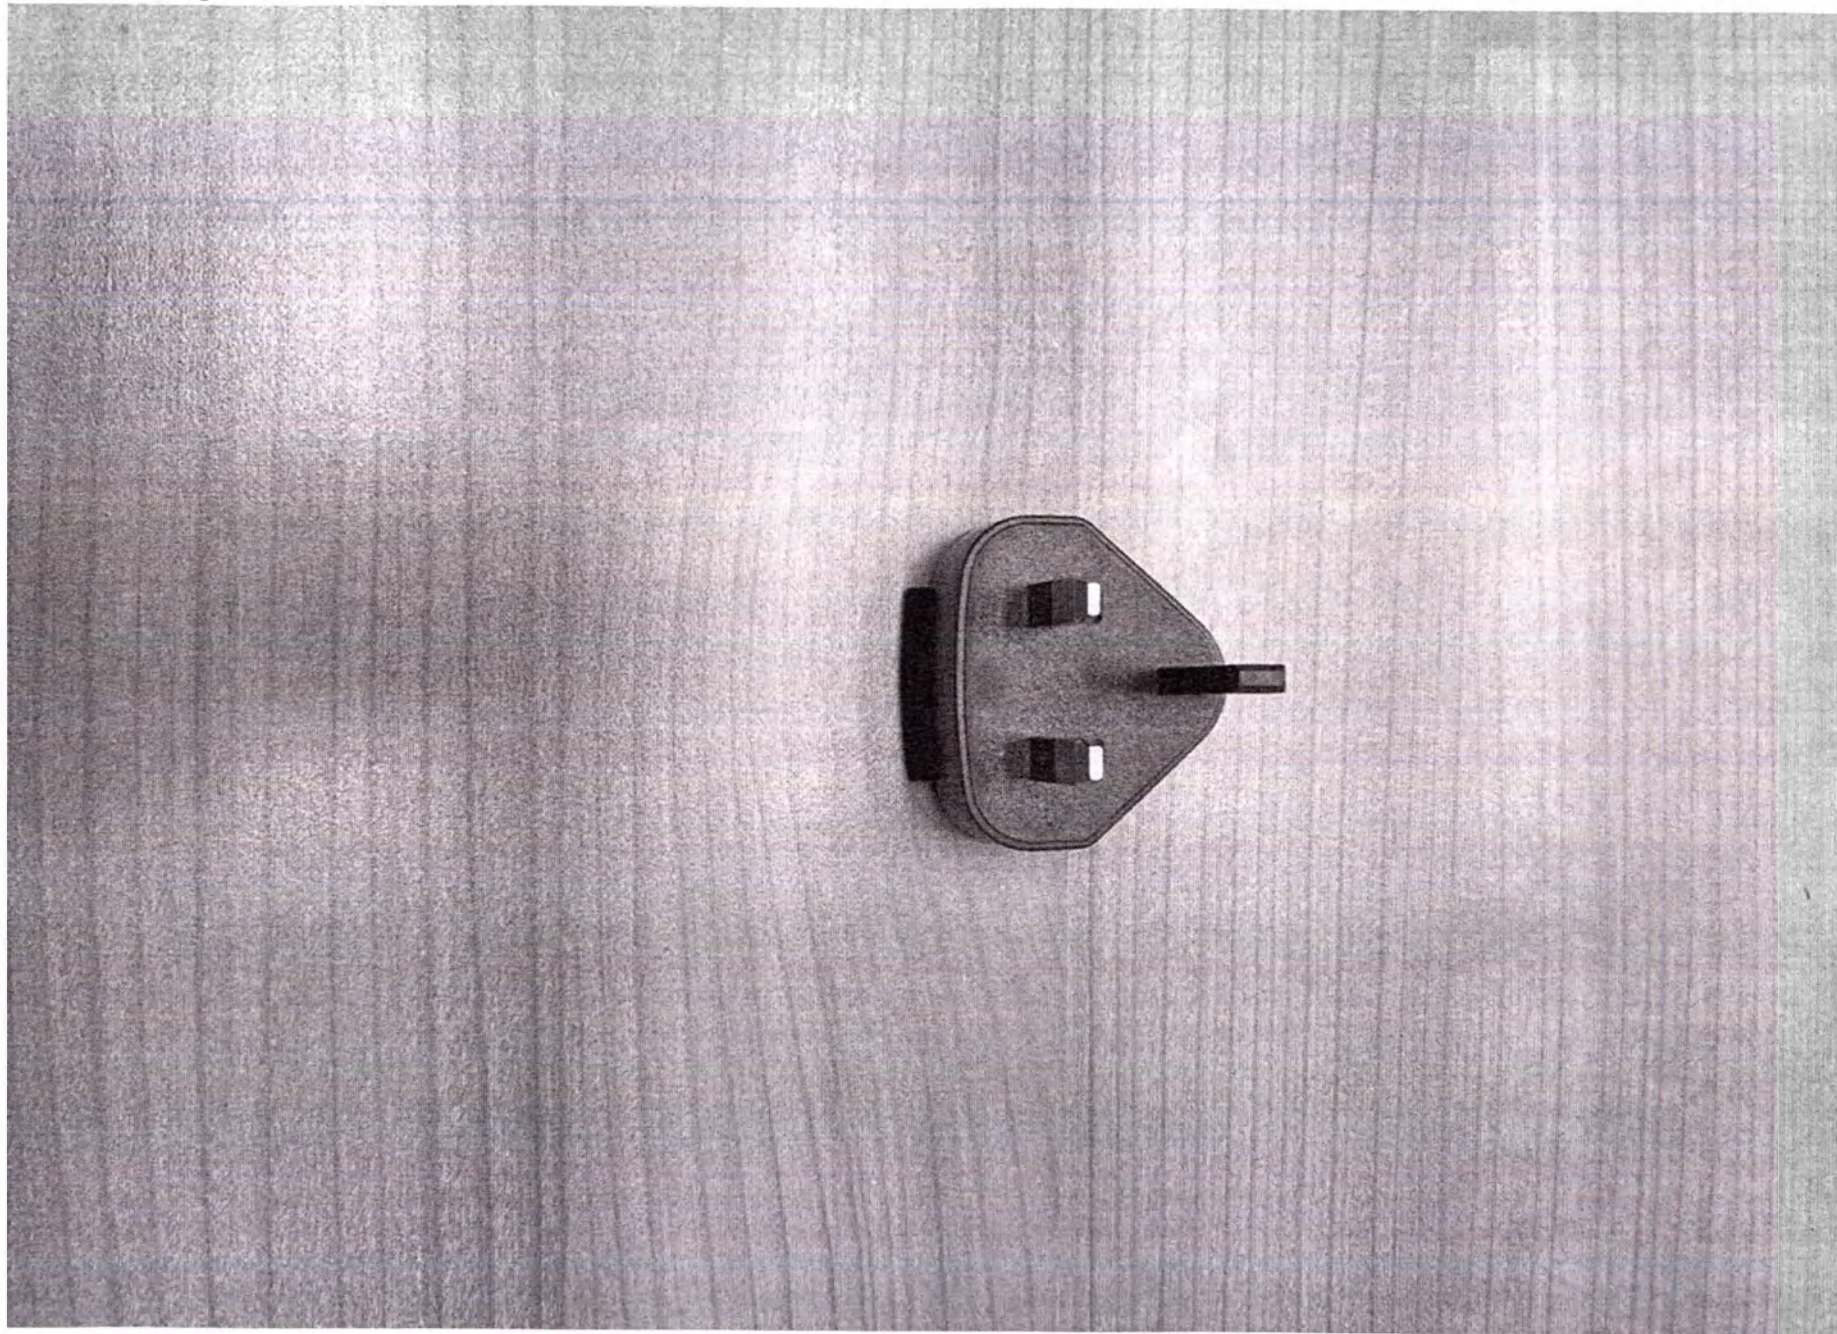


17. Датчик для независимого измерения температуры

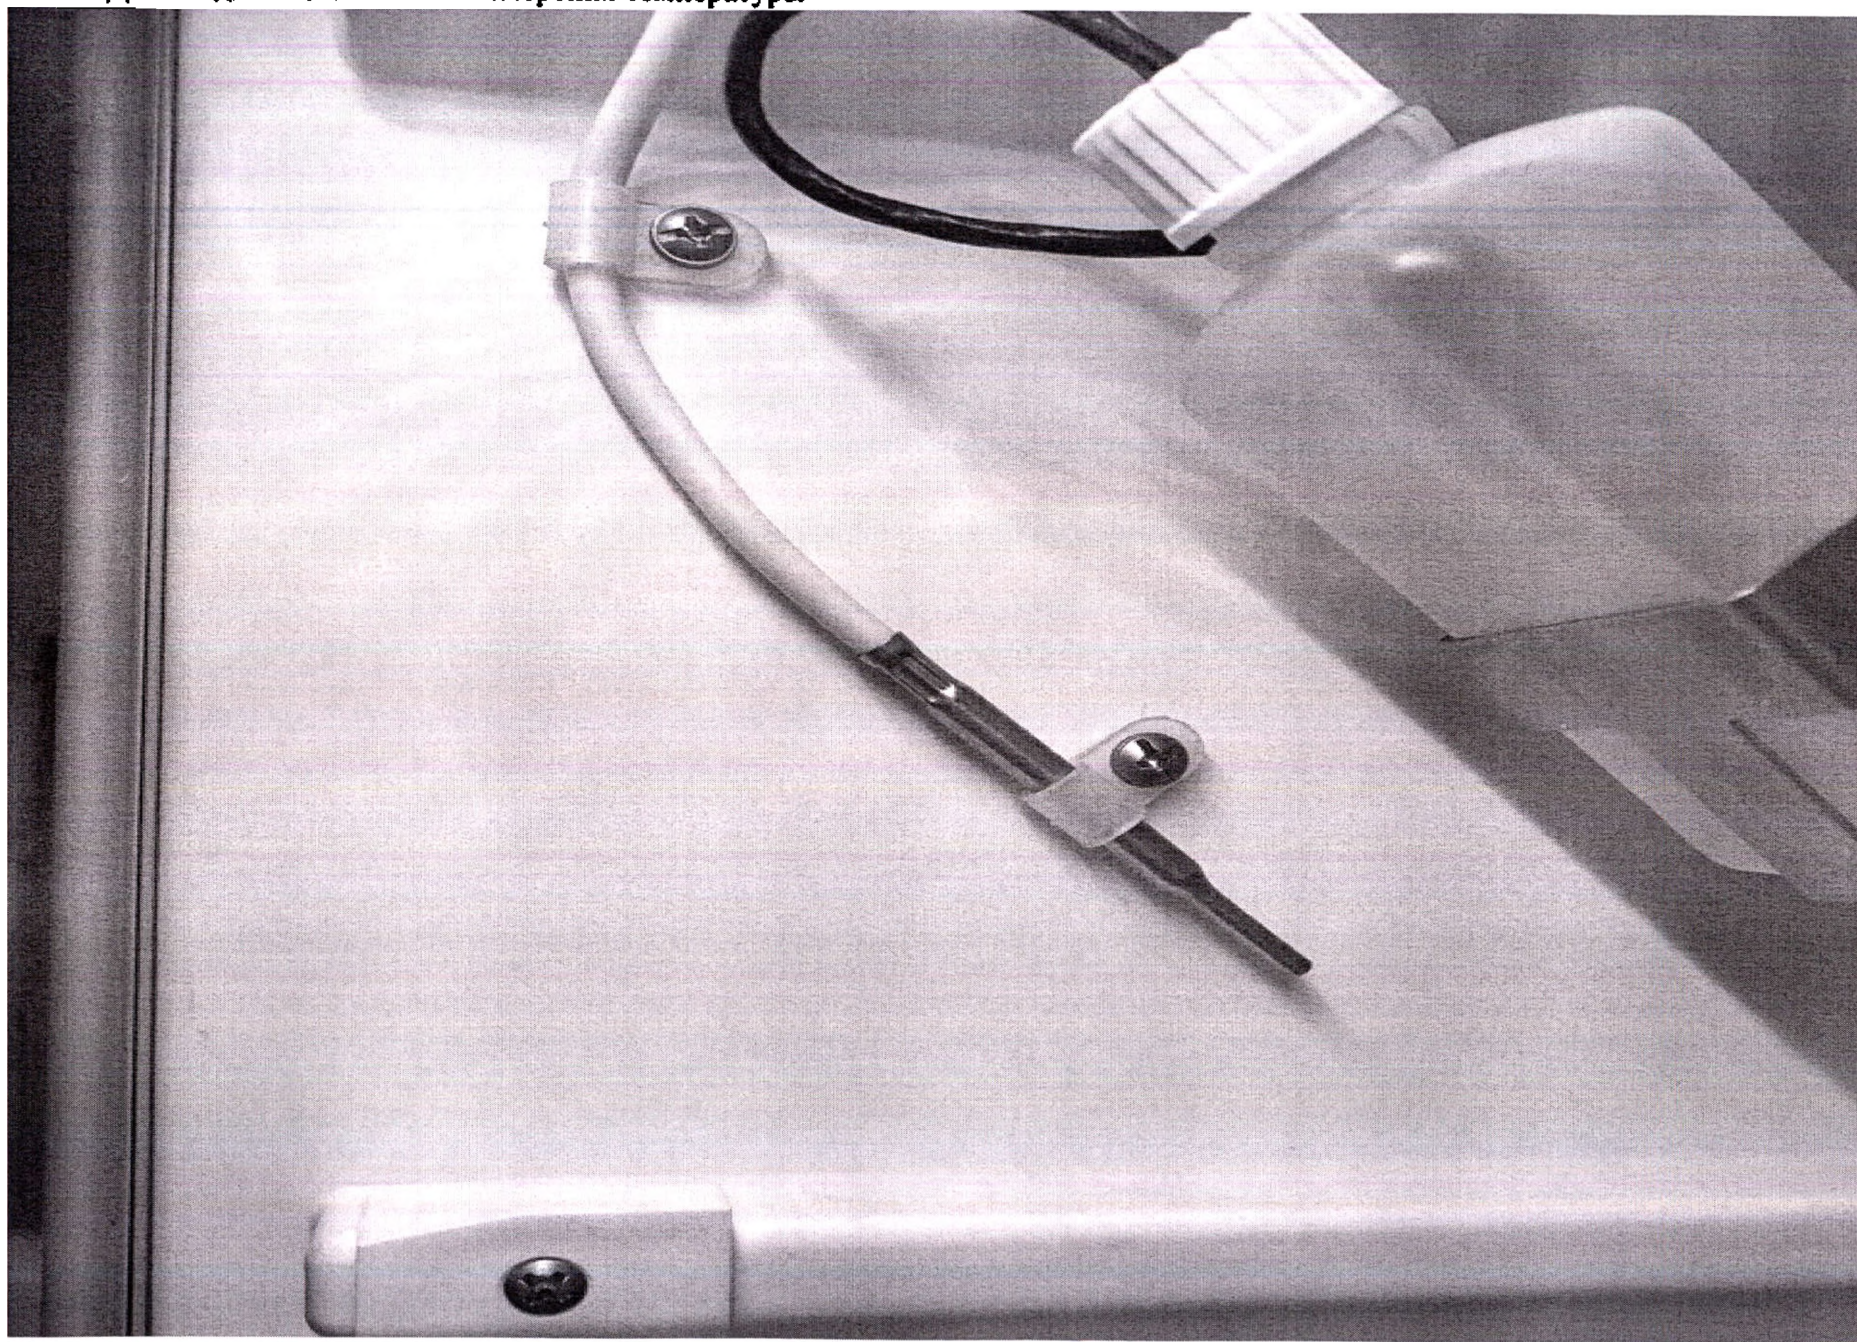


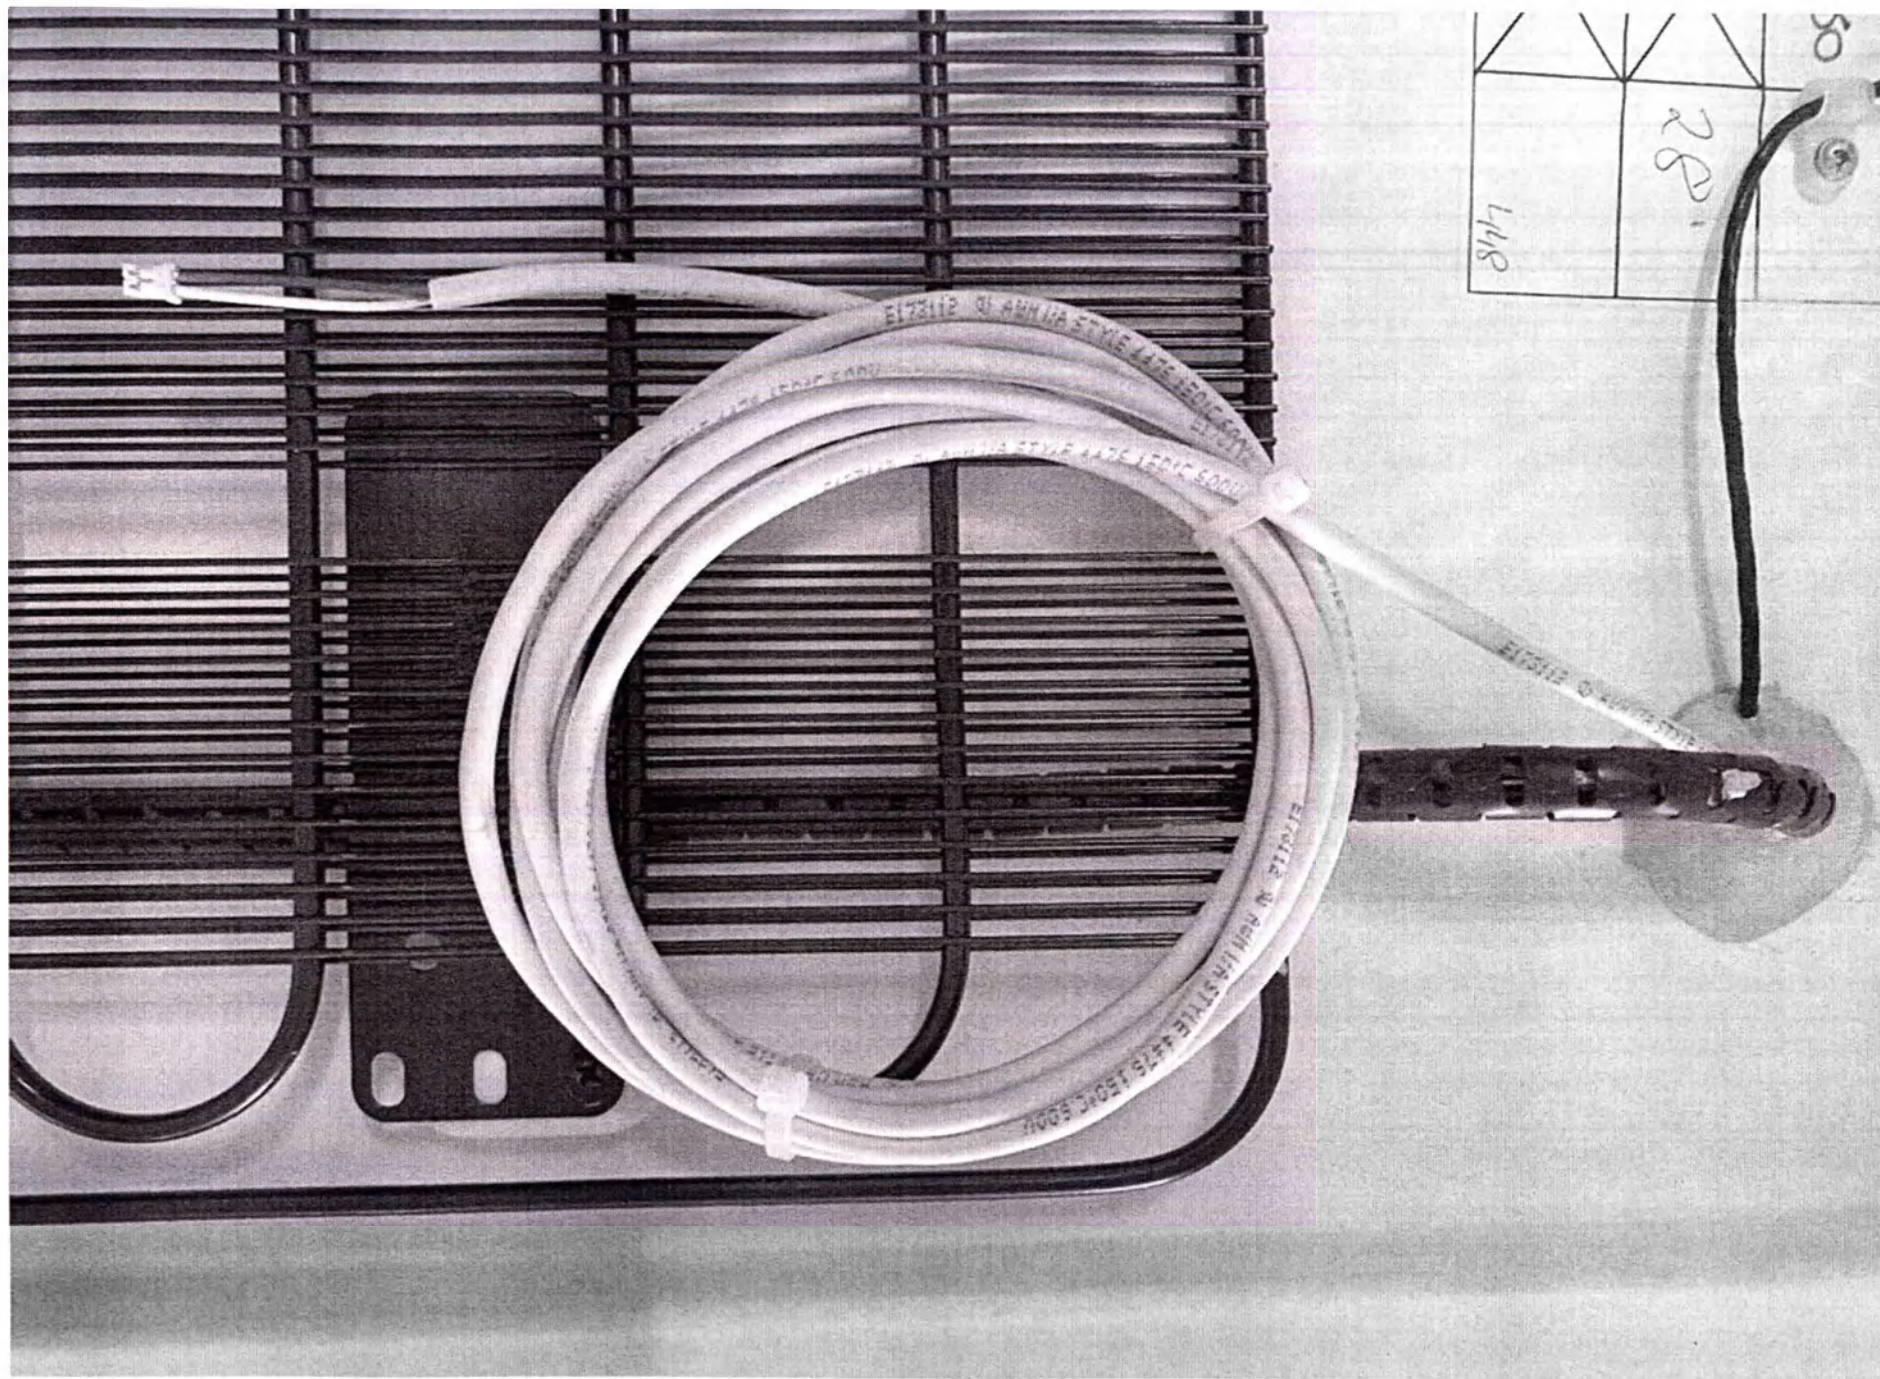


18.Самописец показаний температуры (встроенный)

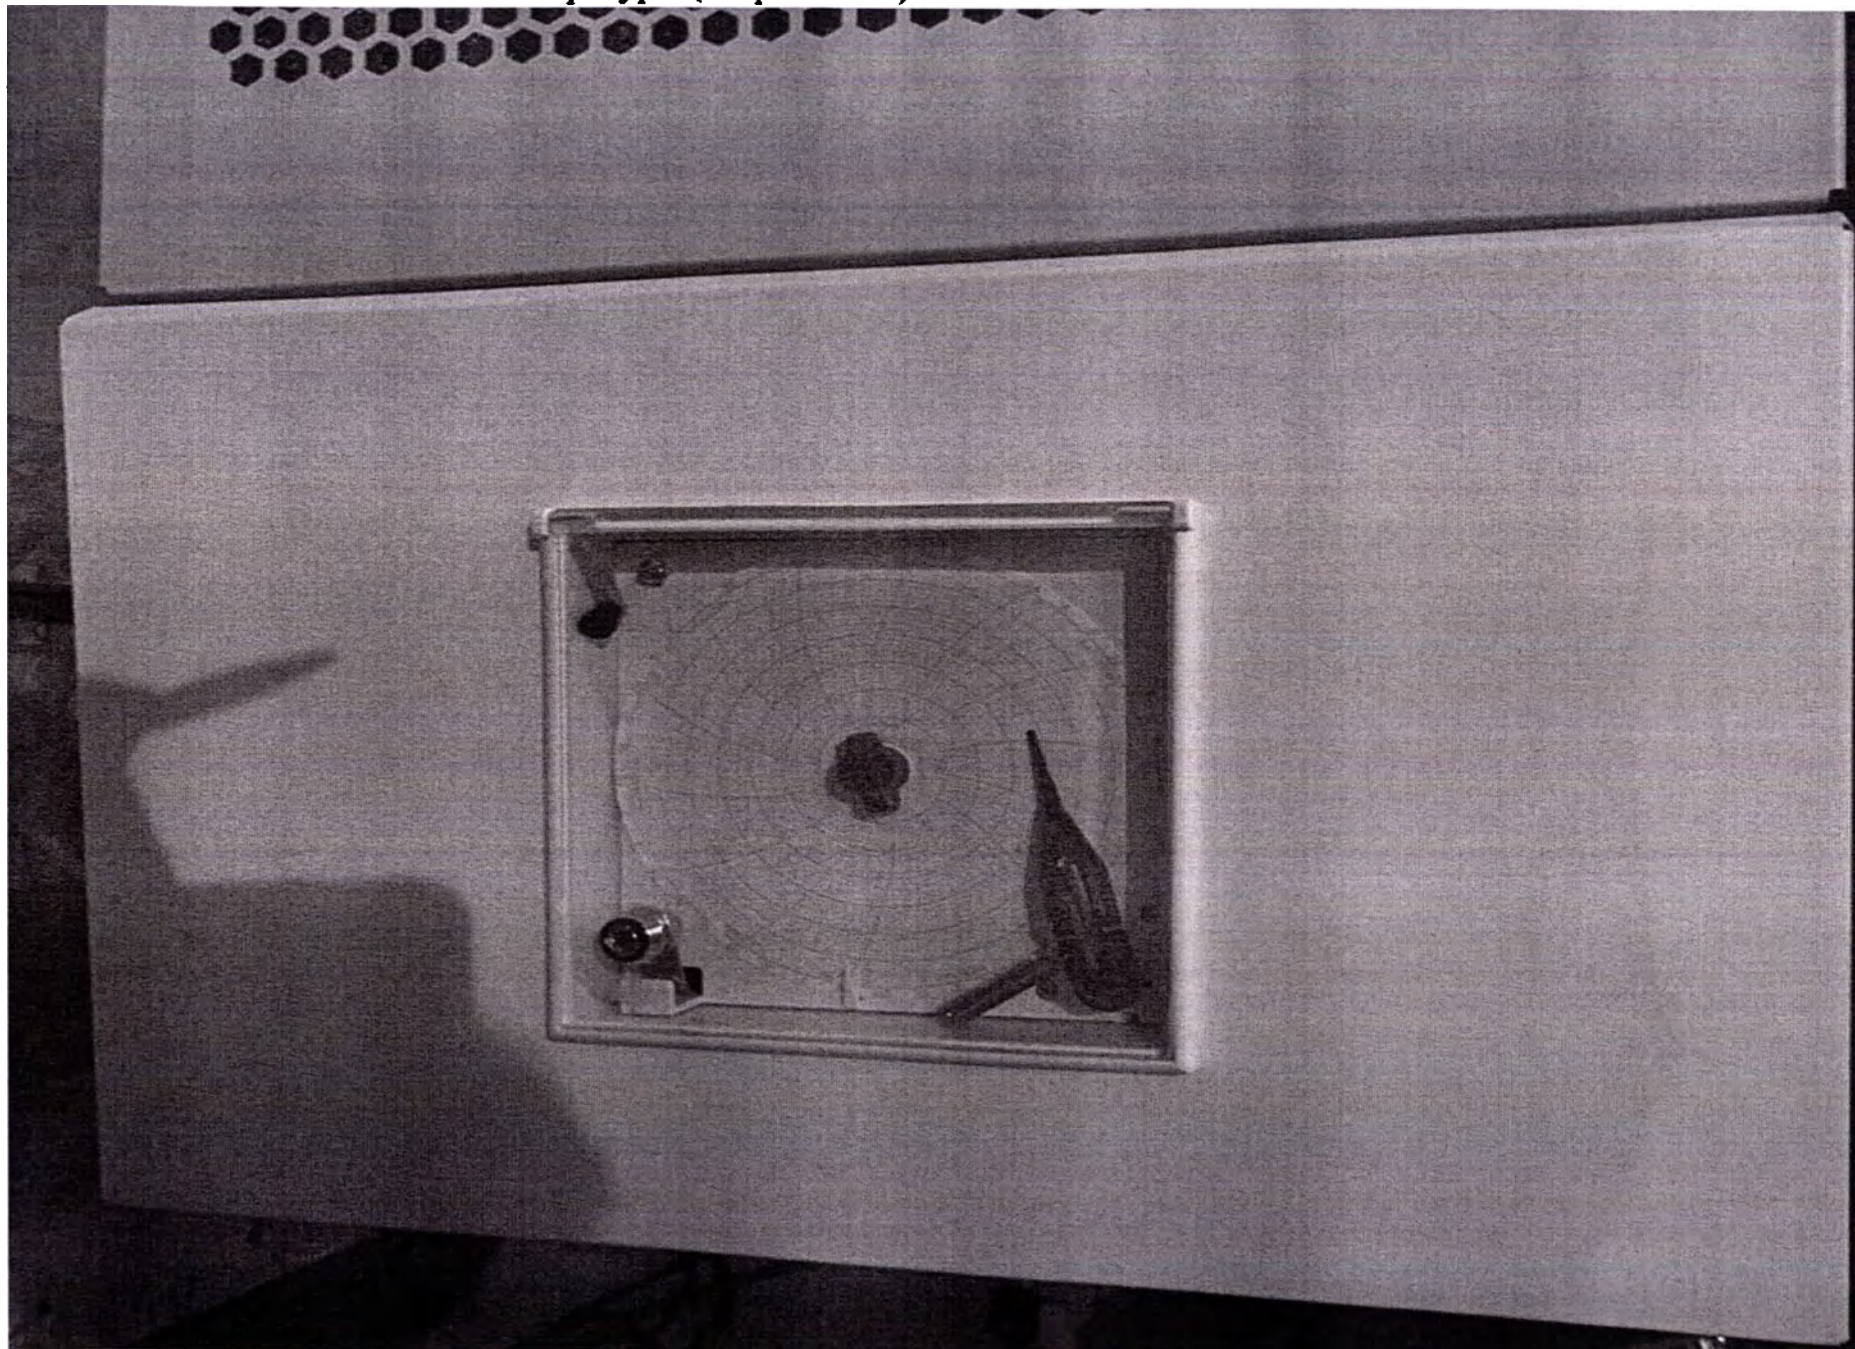


19.Бумага для самописца

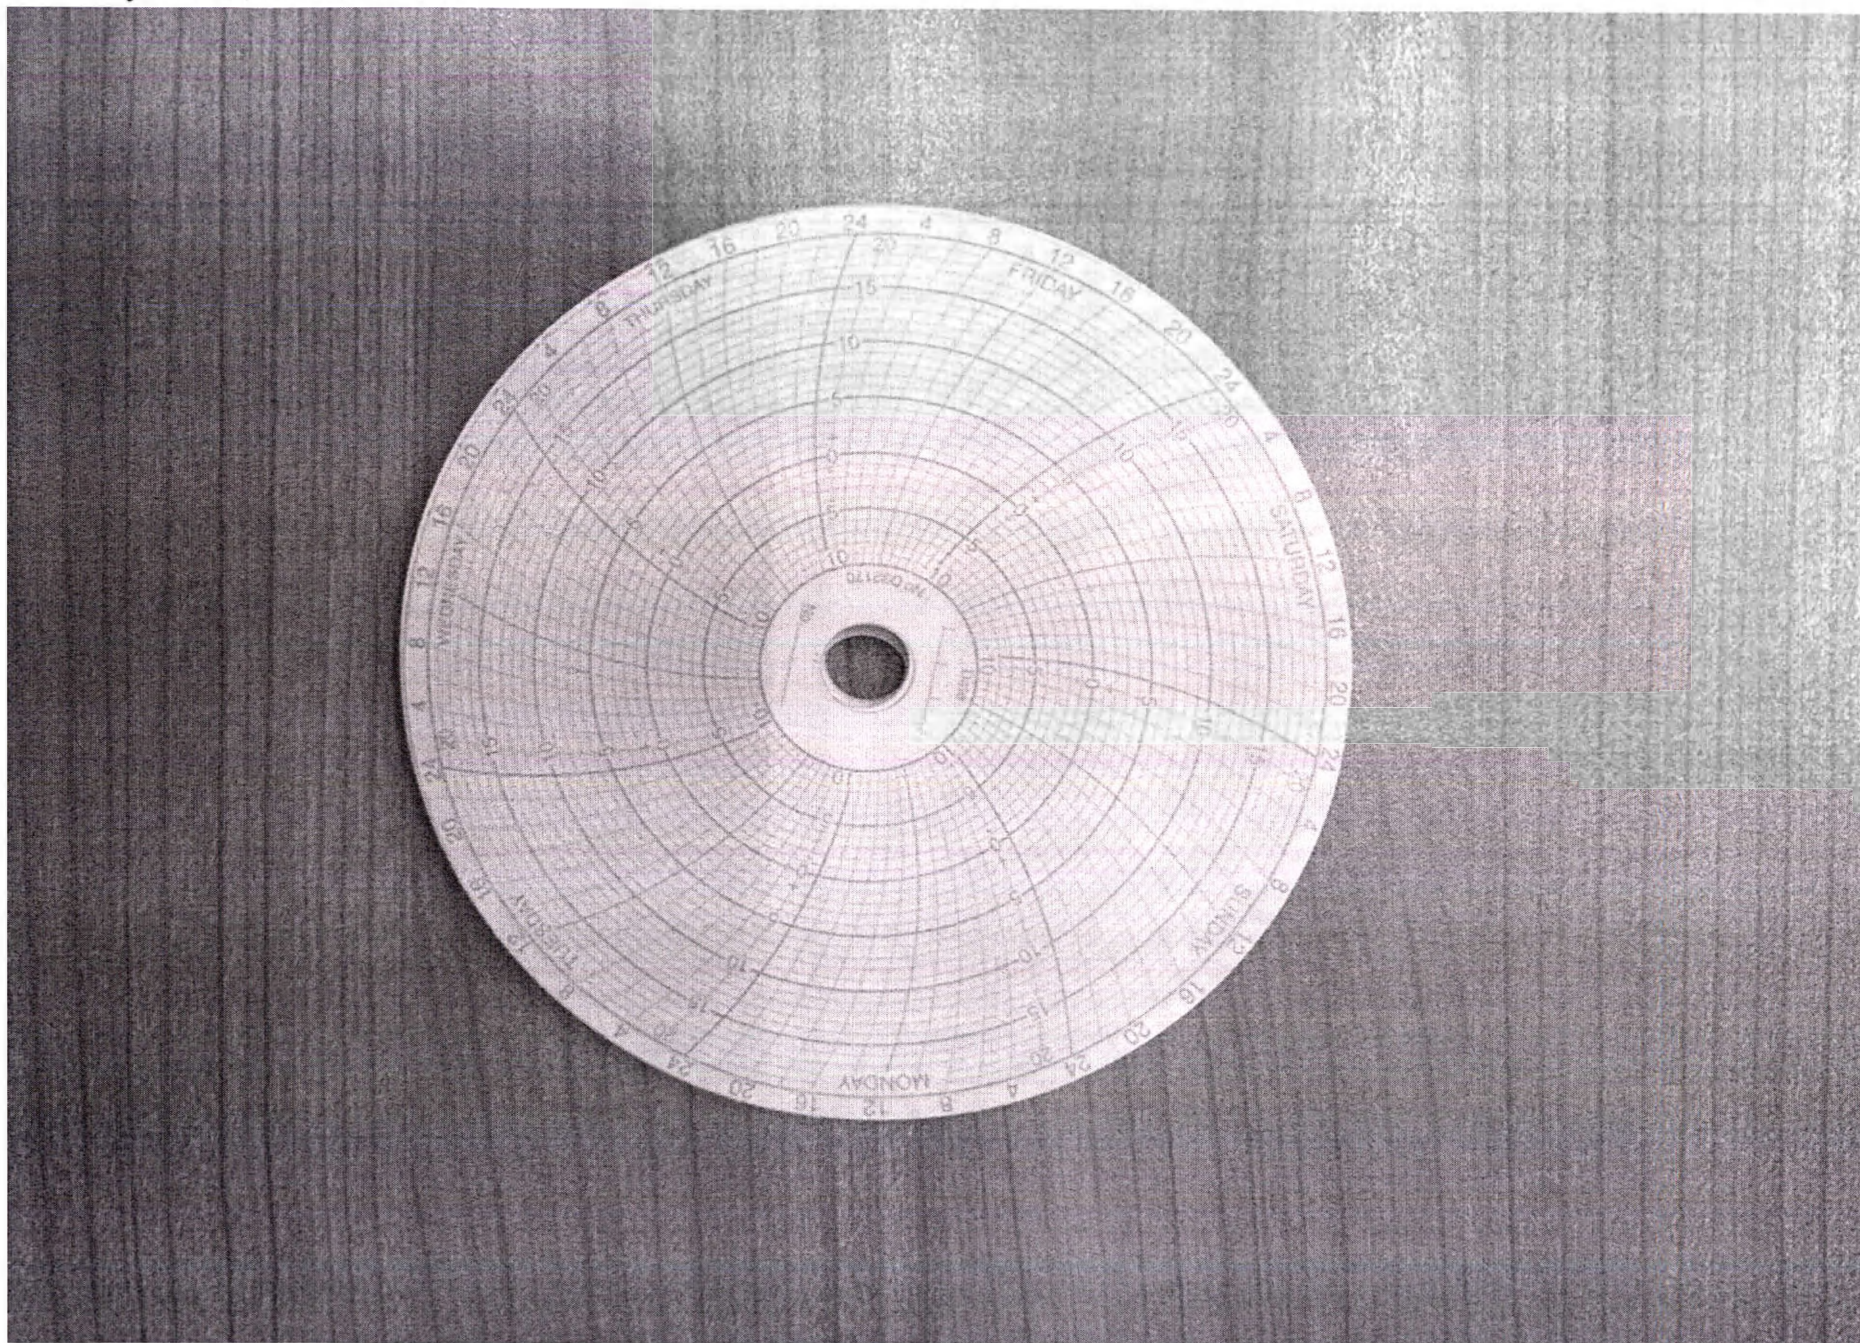


20. Ящик выдвижной с передней стенкой

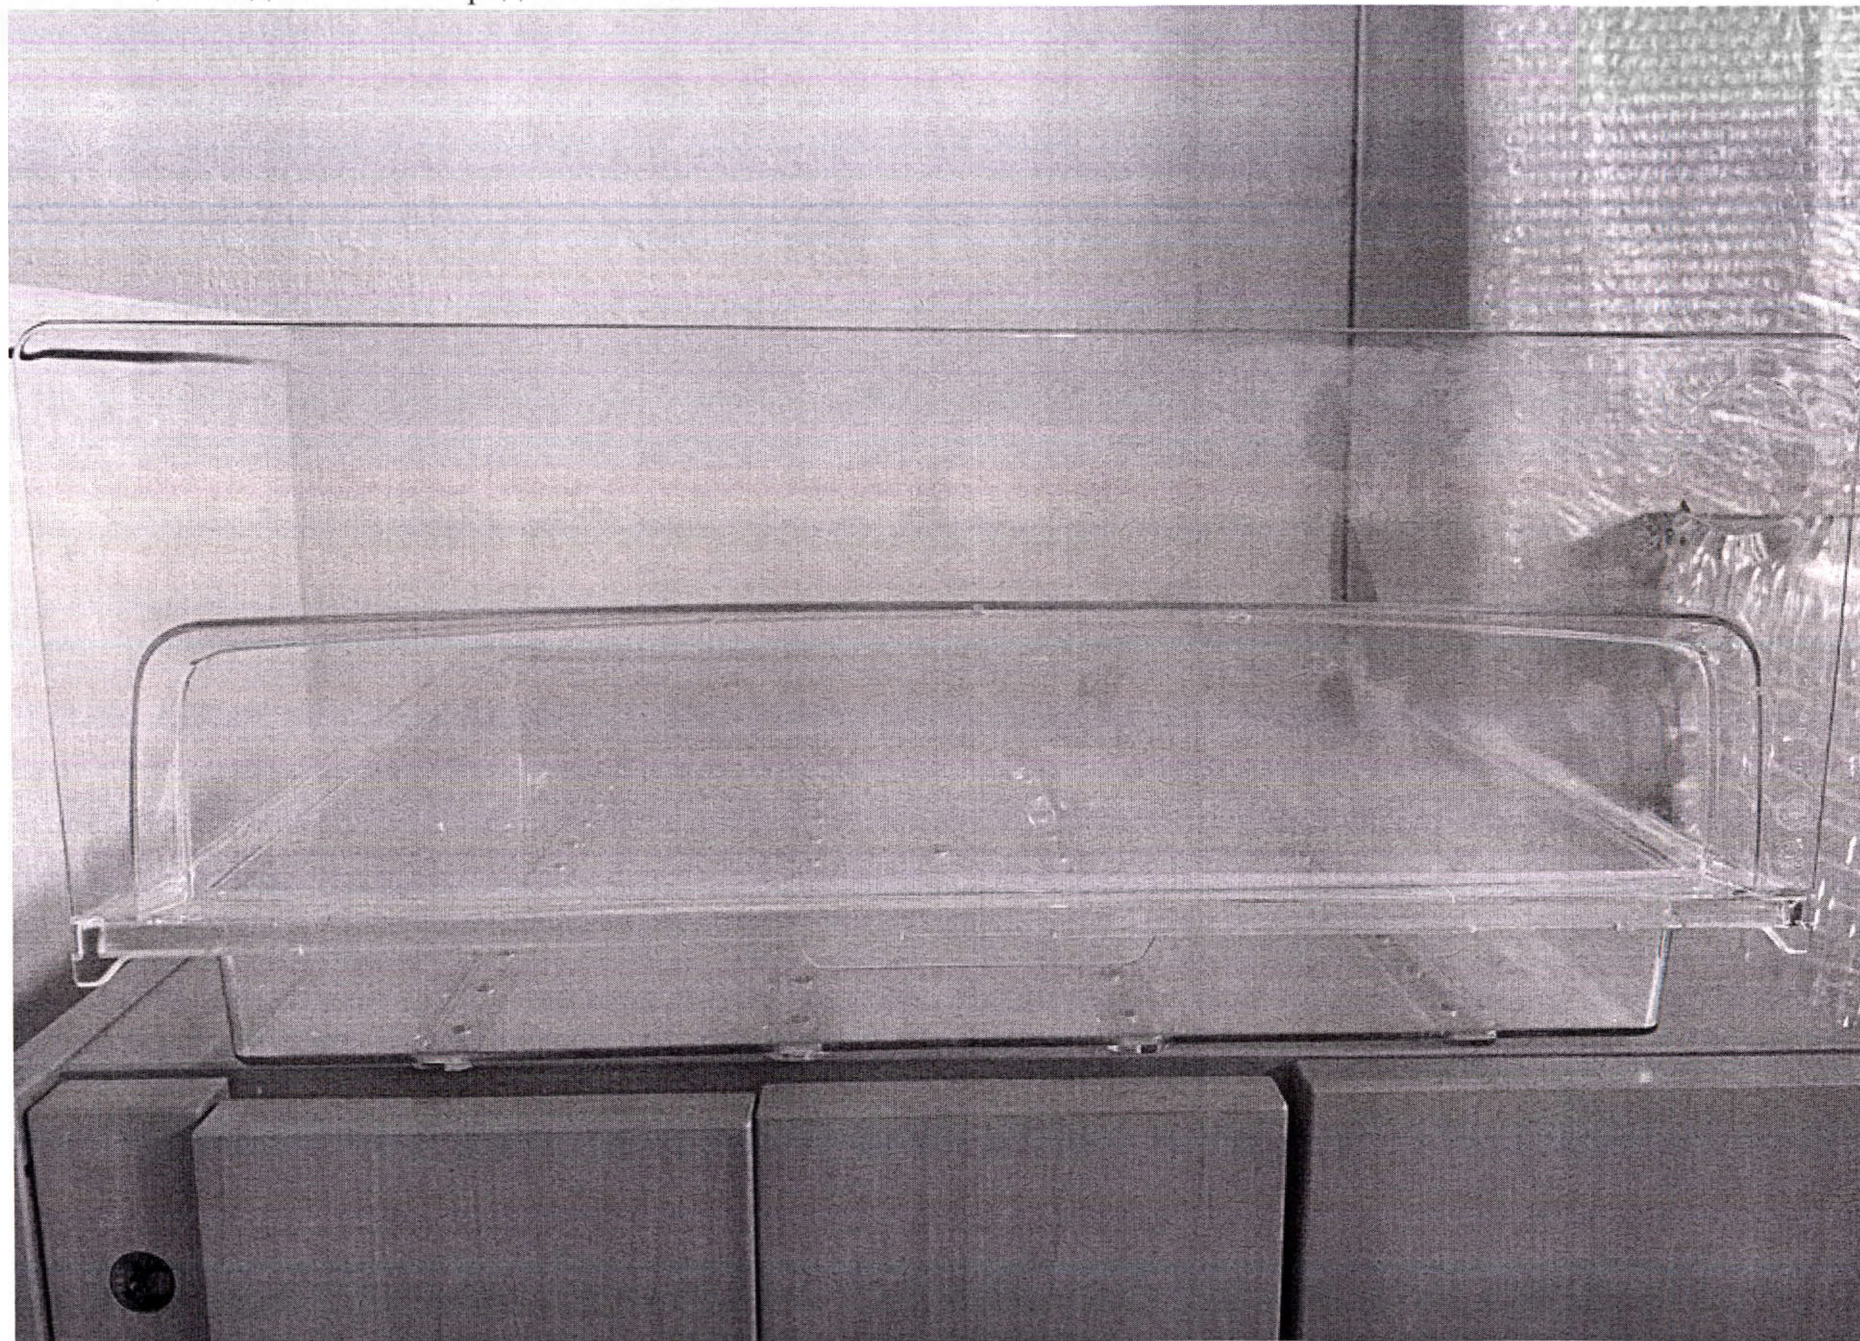


21. Ящик выдвижной нижний

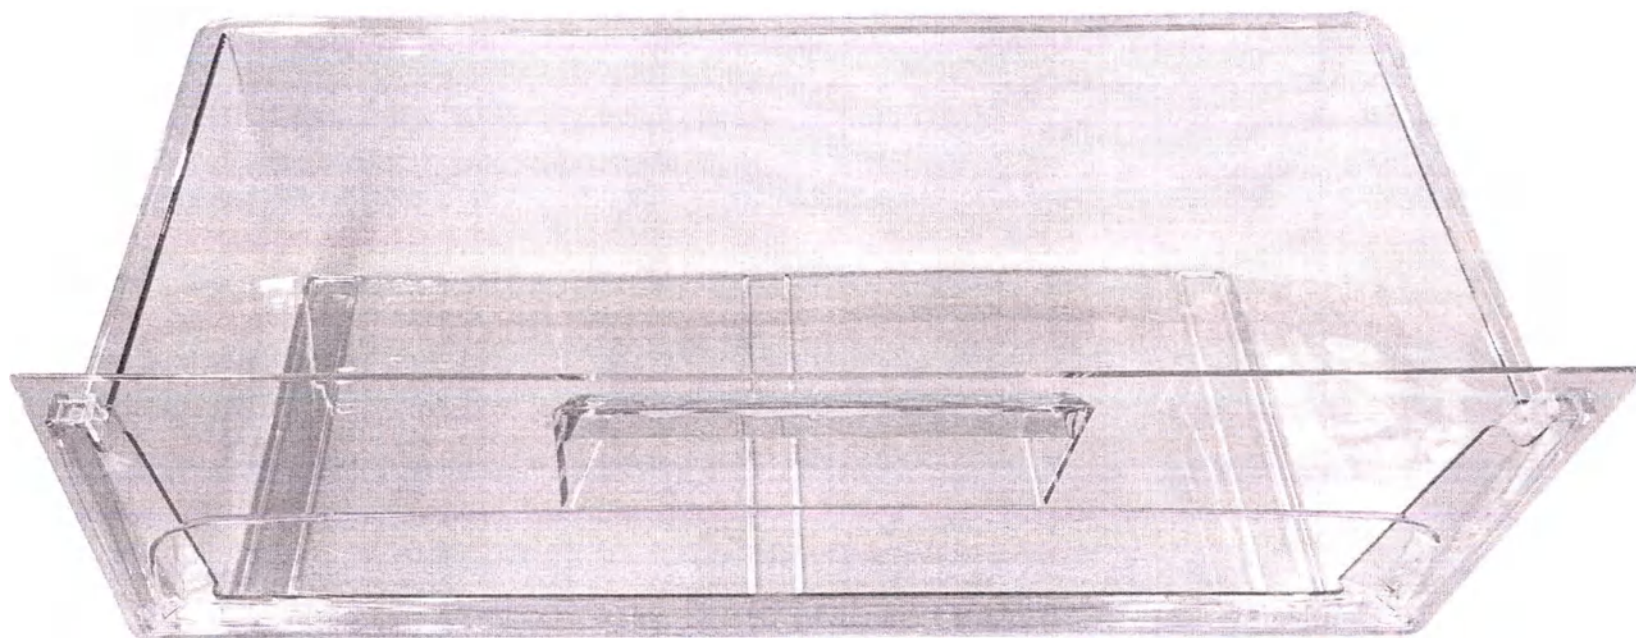


22. Набор разделителей

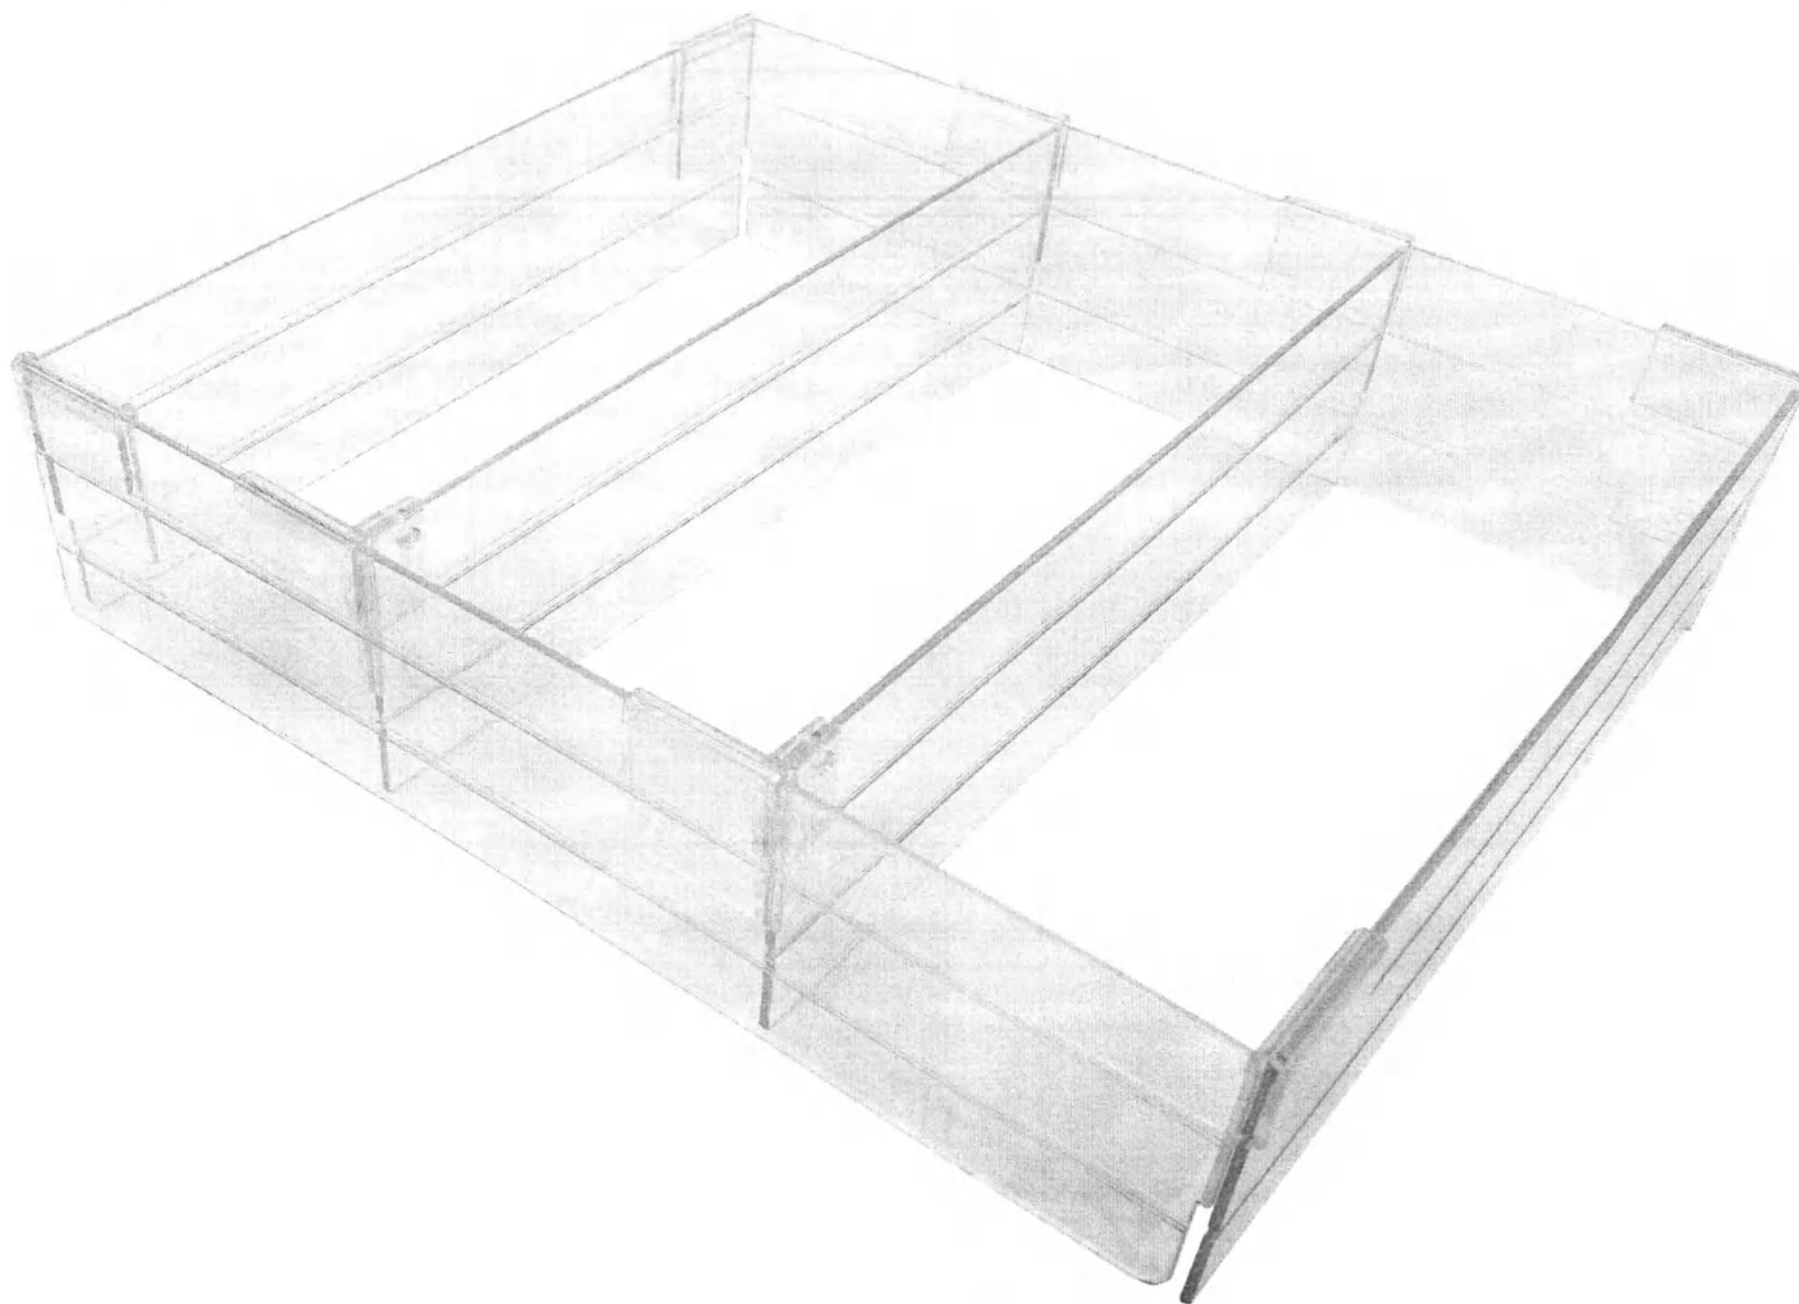


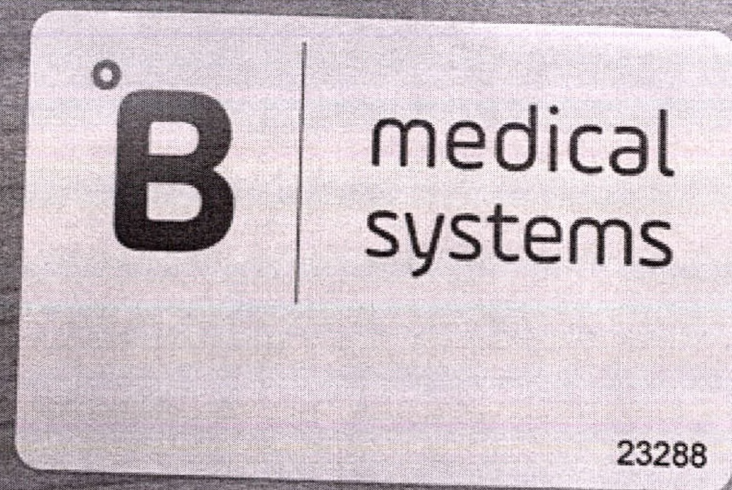


24. Заглушка разъемом D19/M8

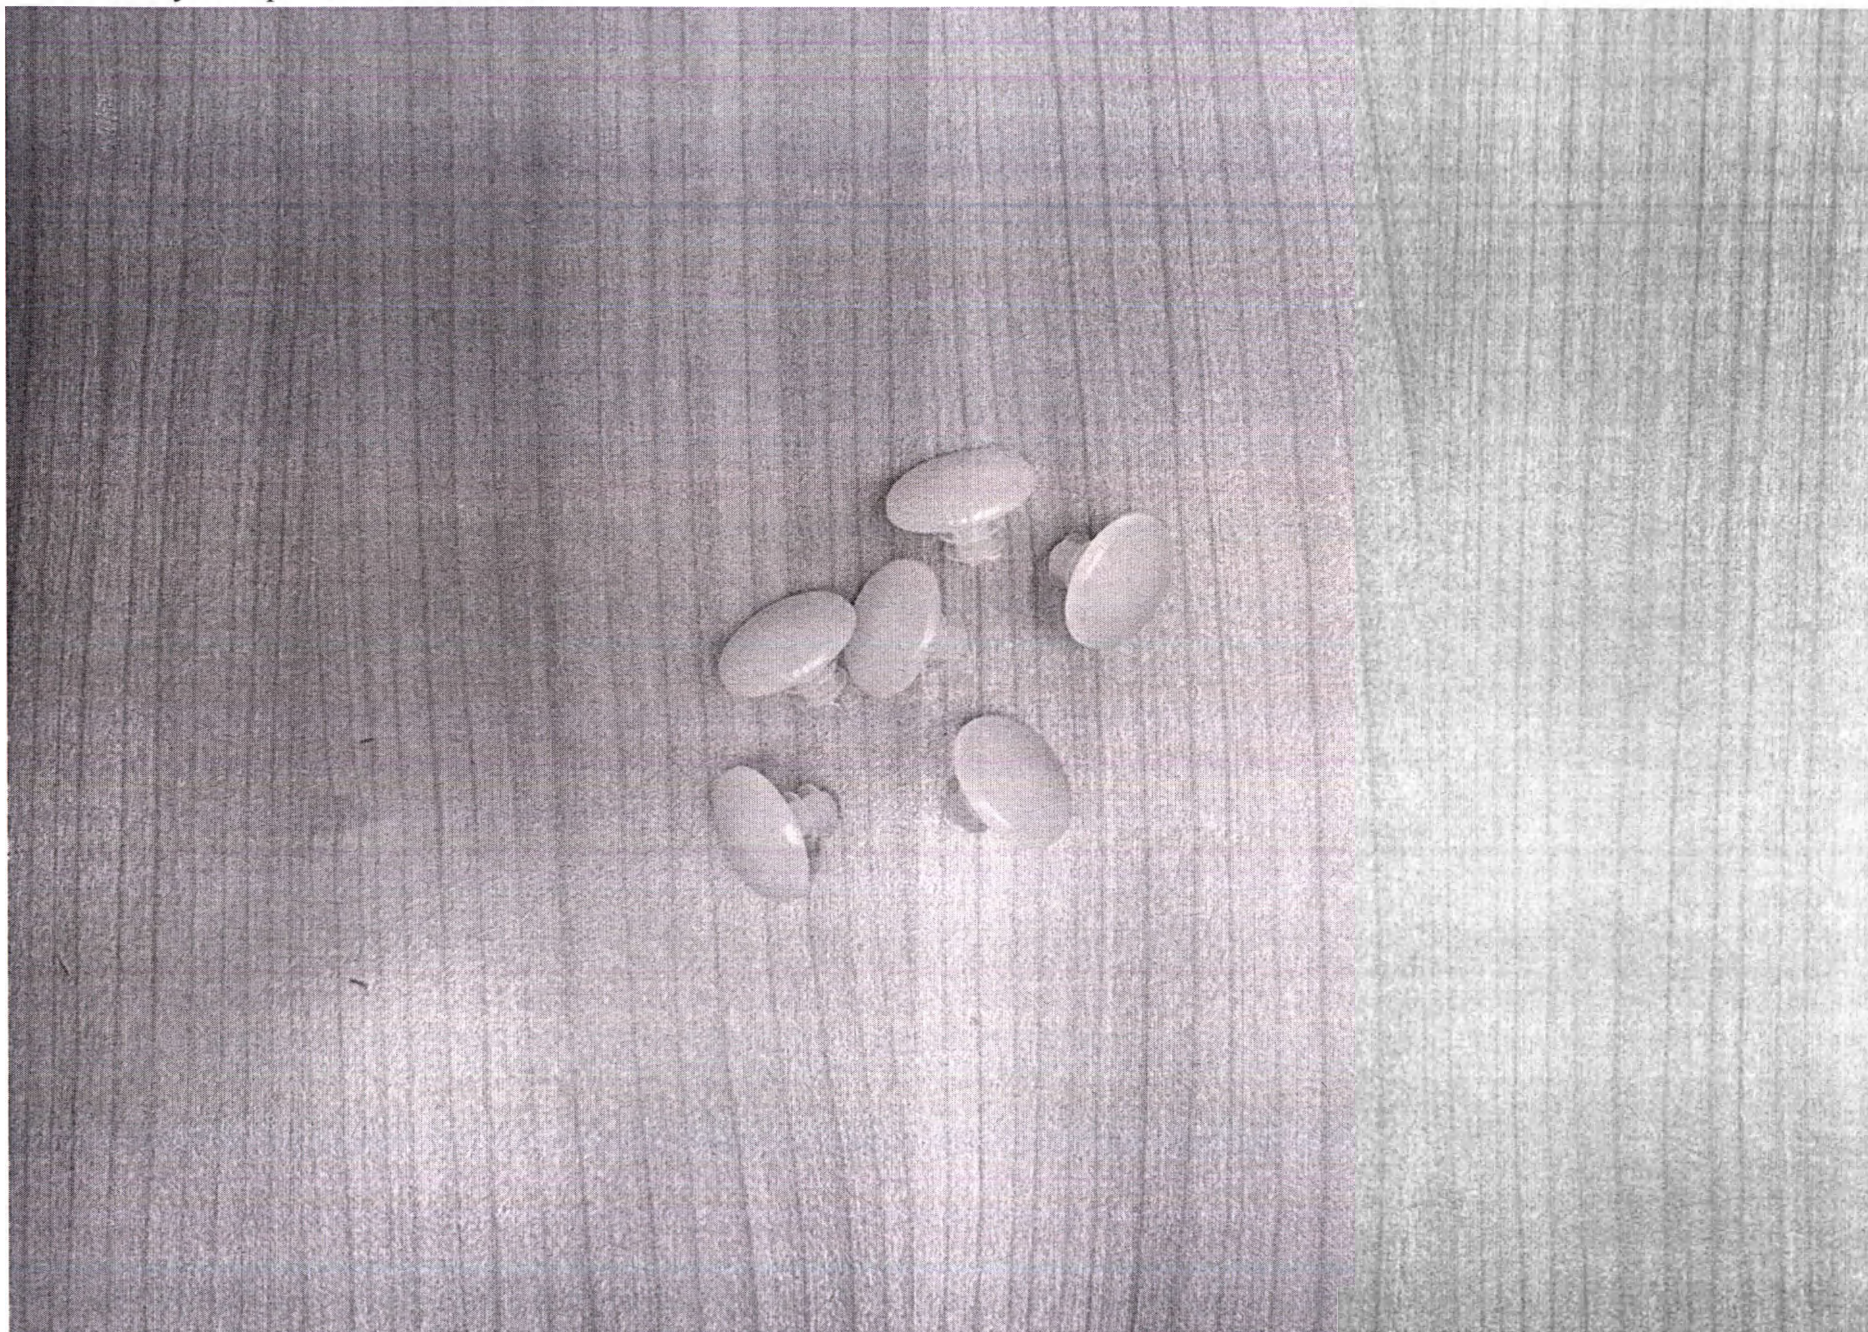


25. Ящик стальной выдвижной с передней стенкой

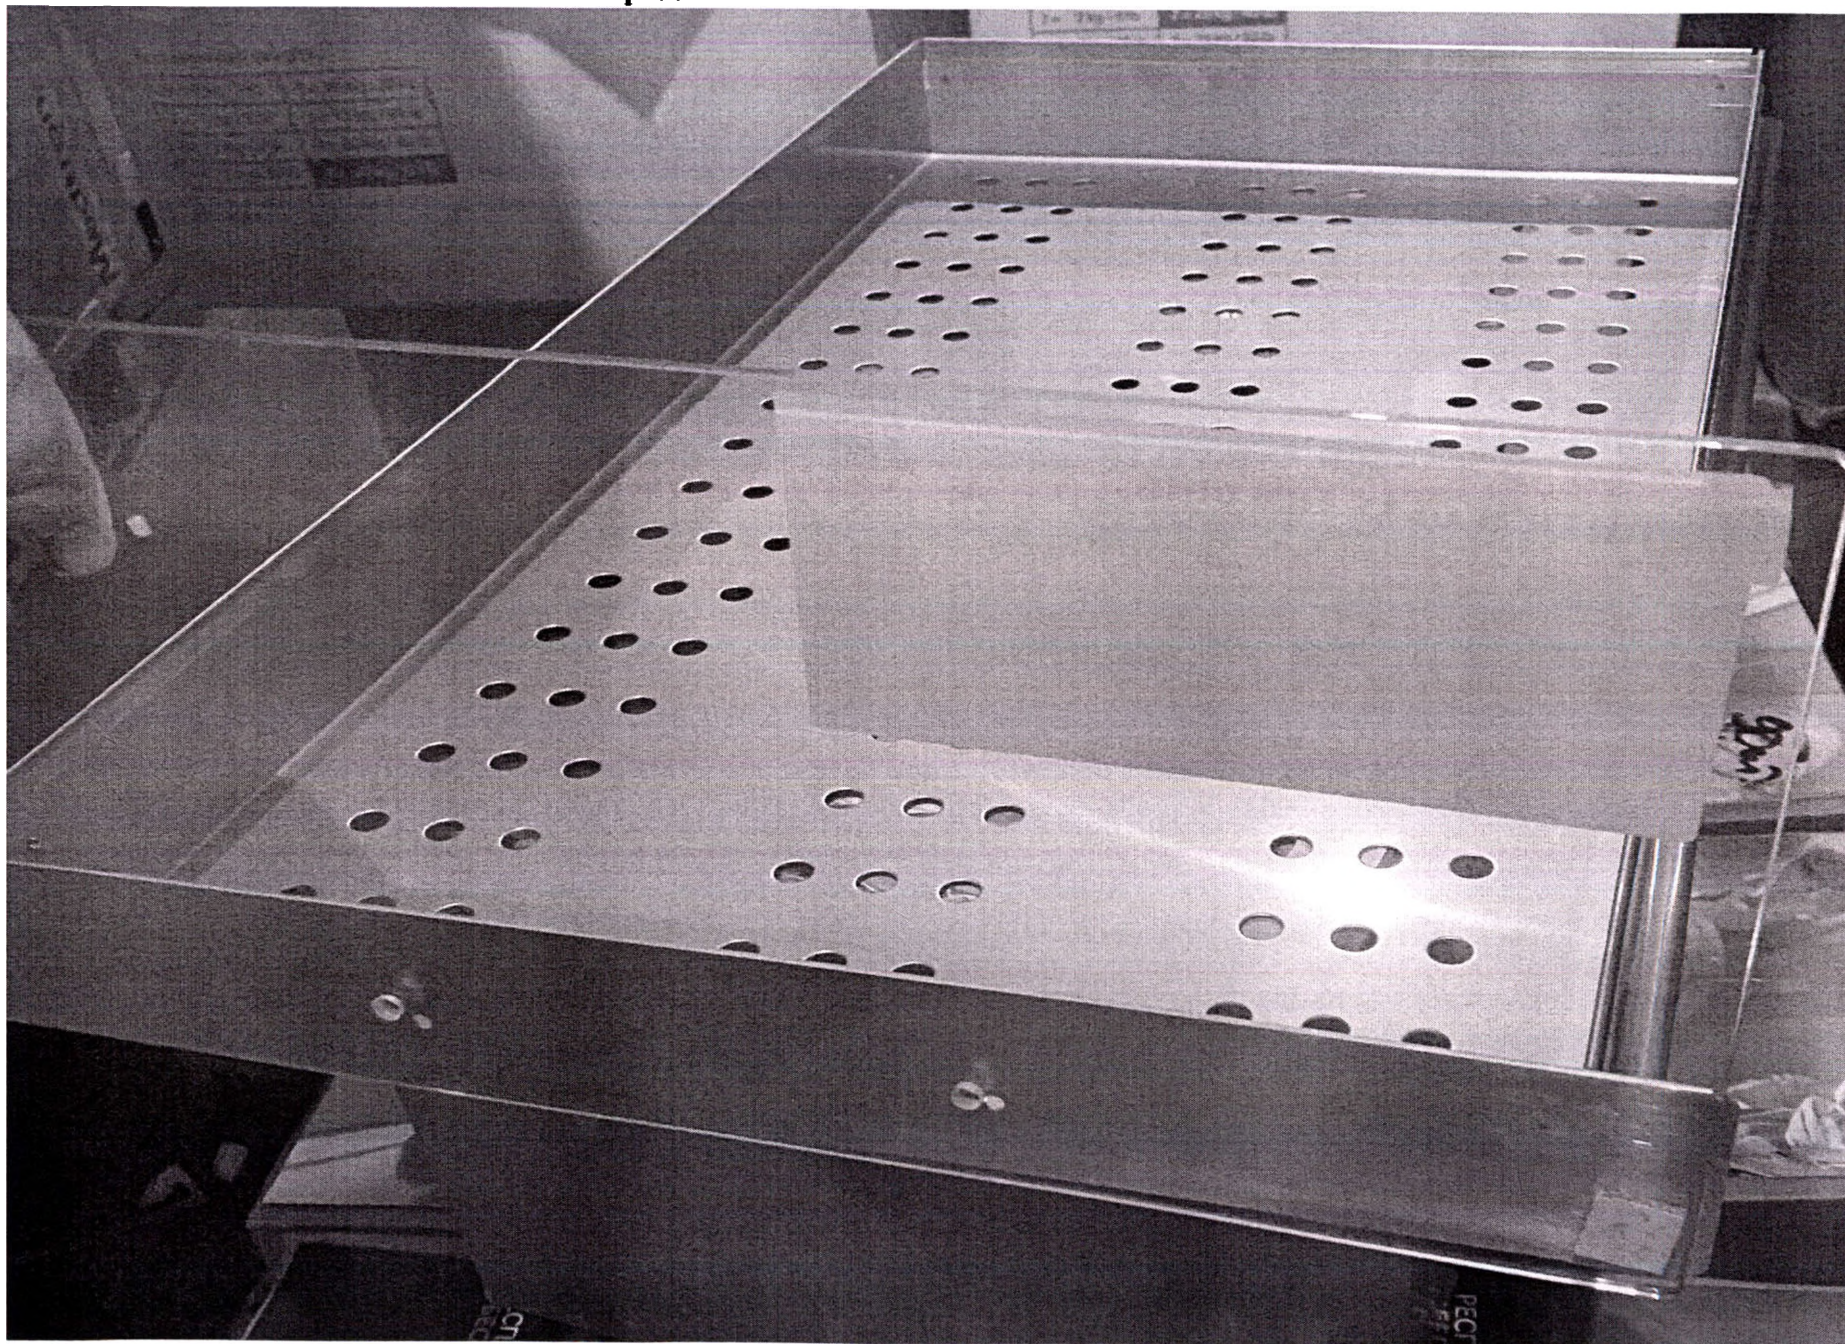


26. Решетчатая полка

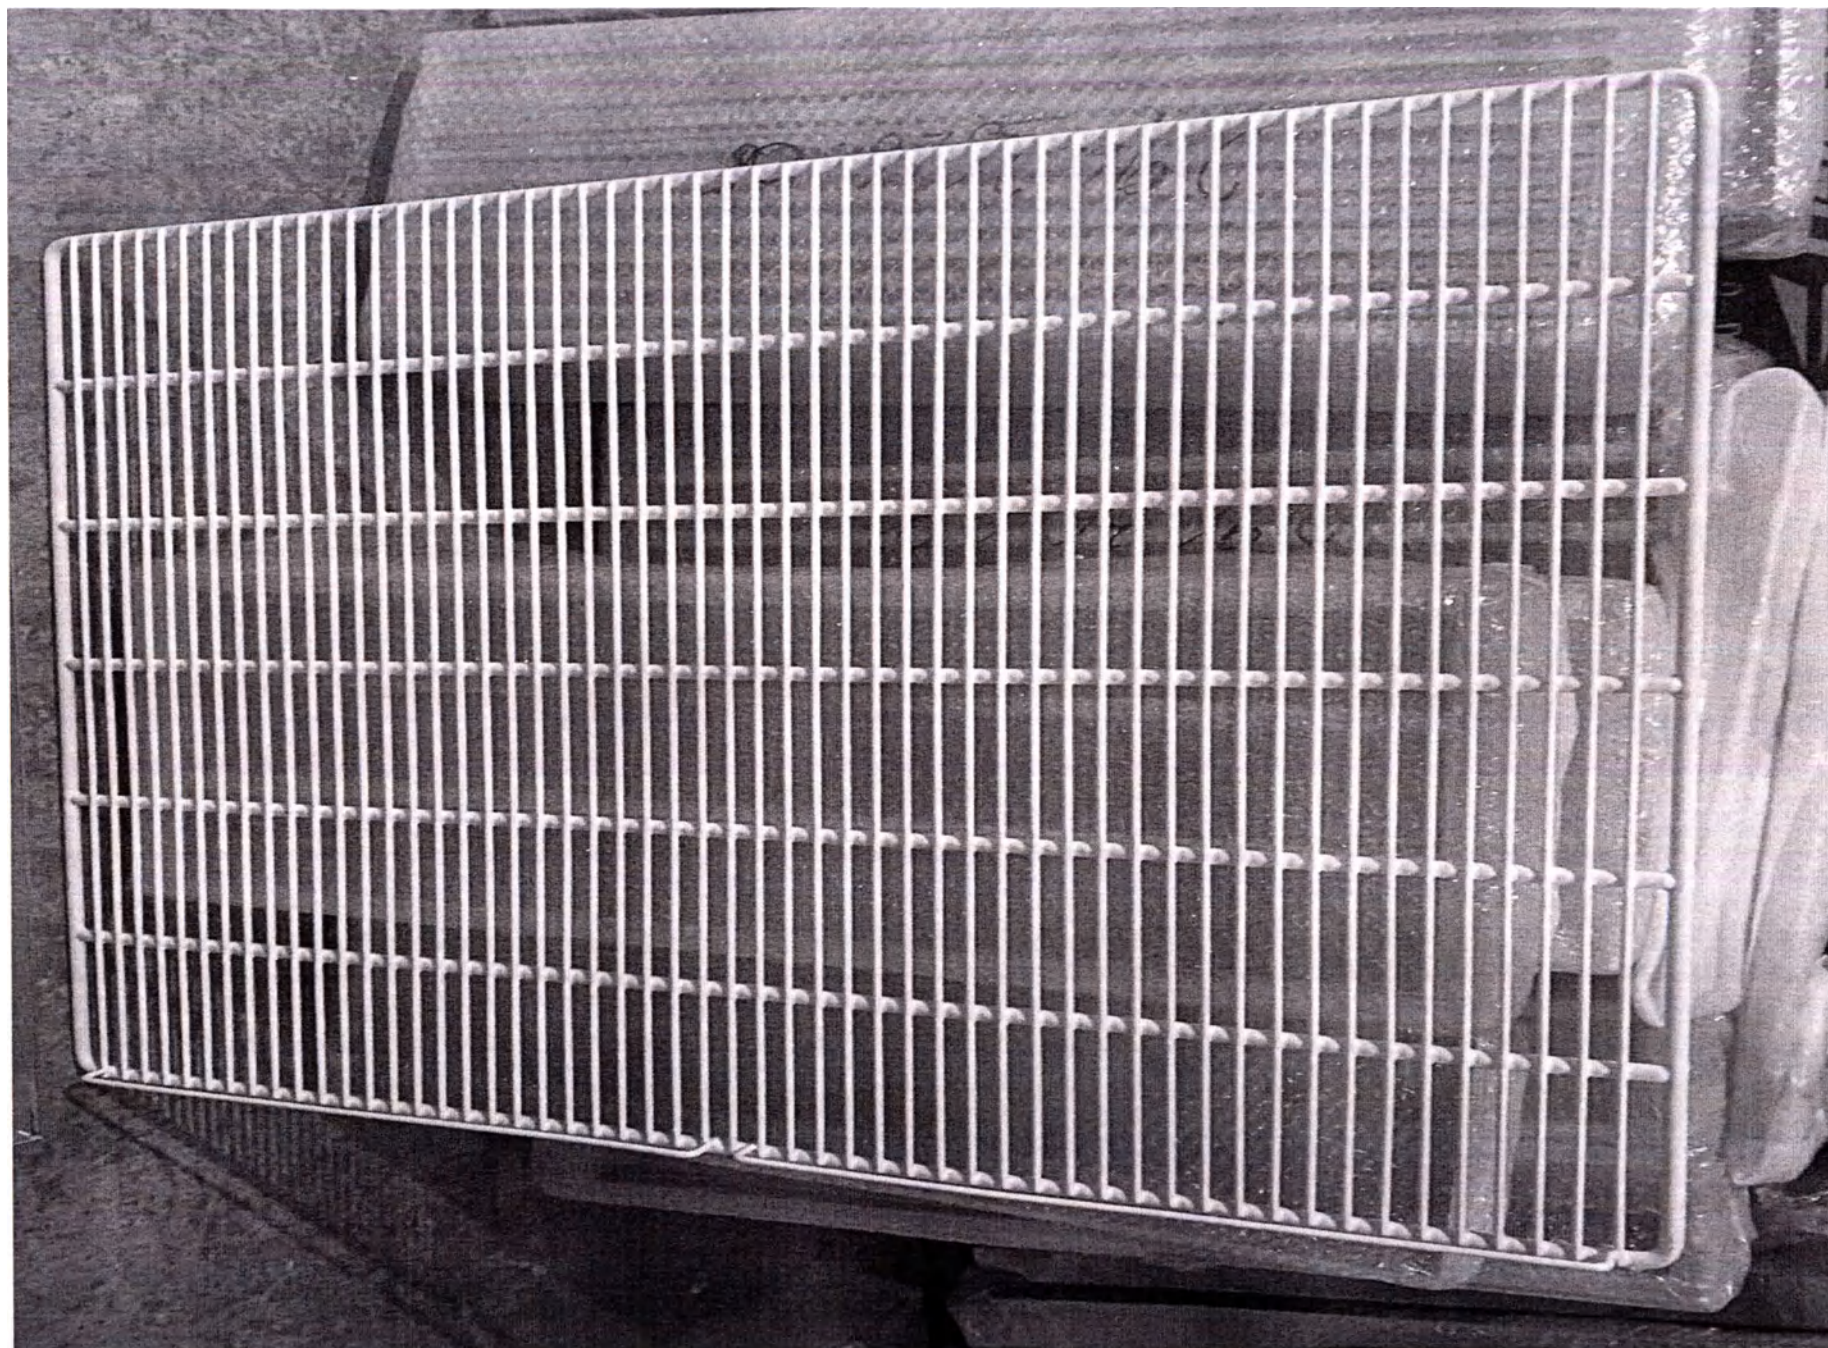


27. Ящик стальной выдвижной без передней стенки

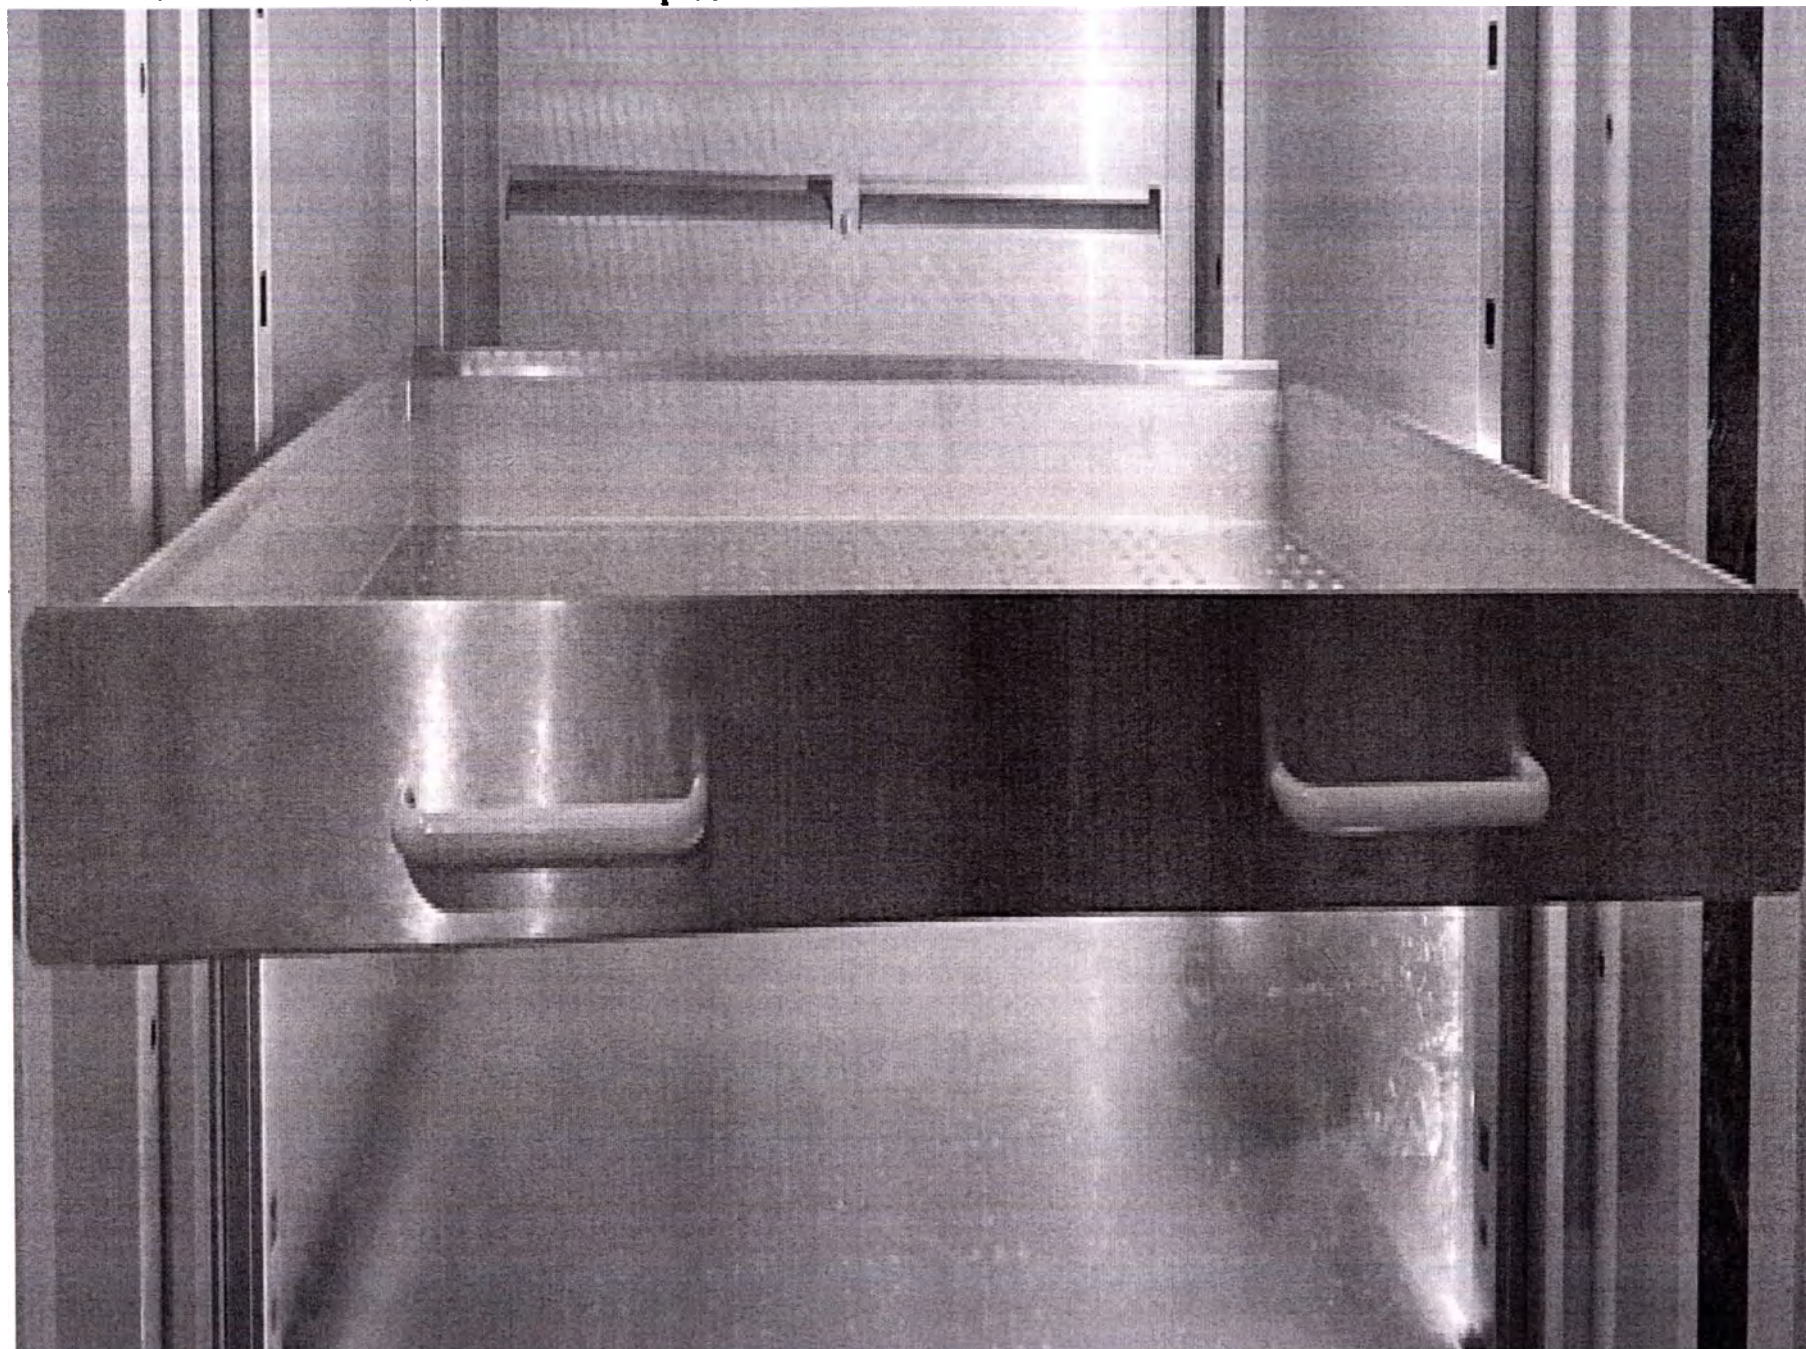


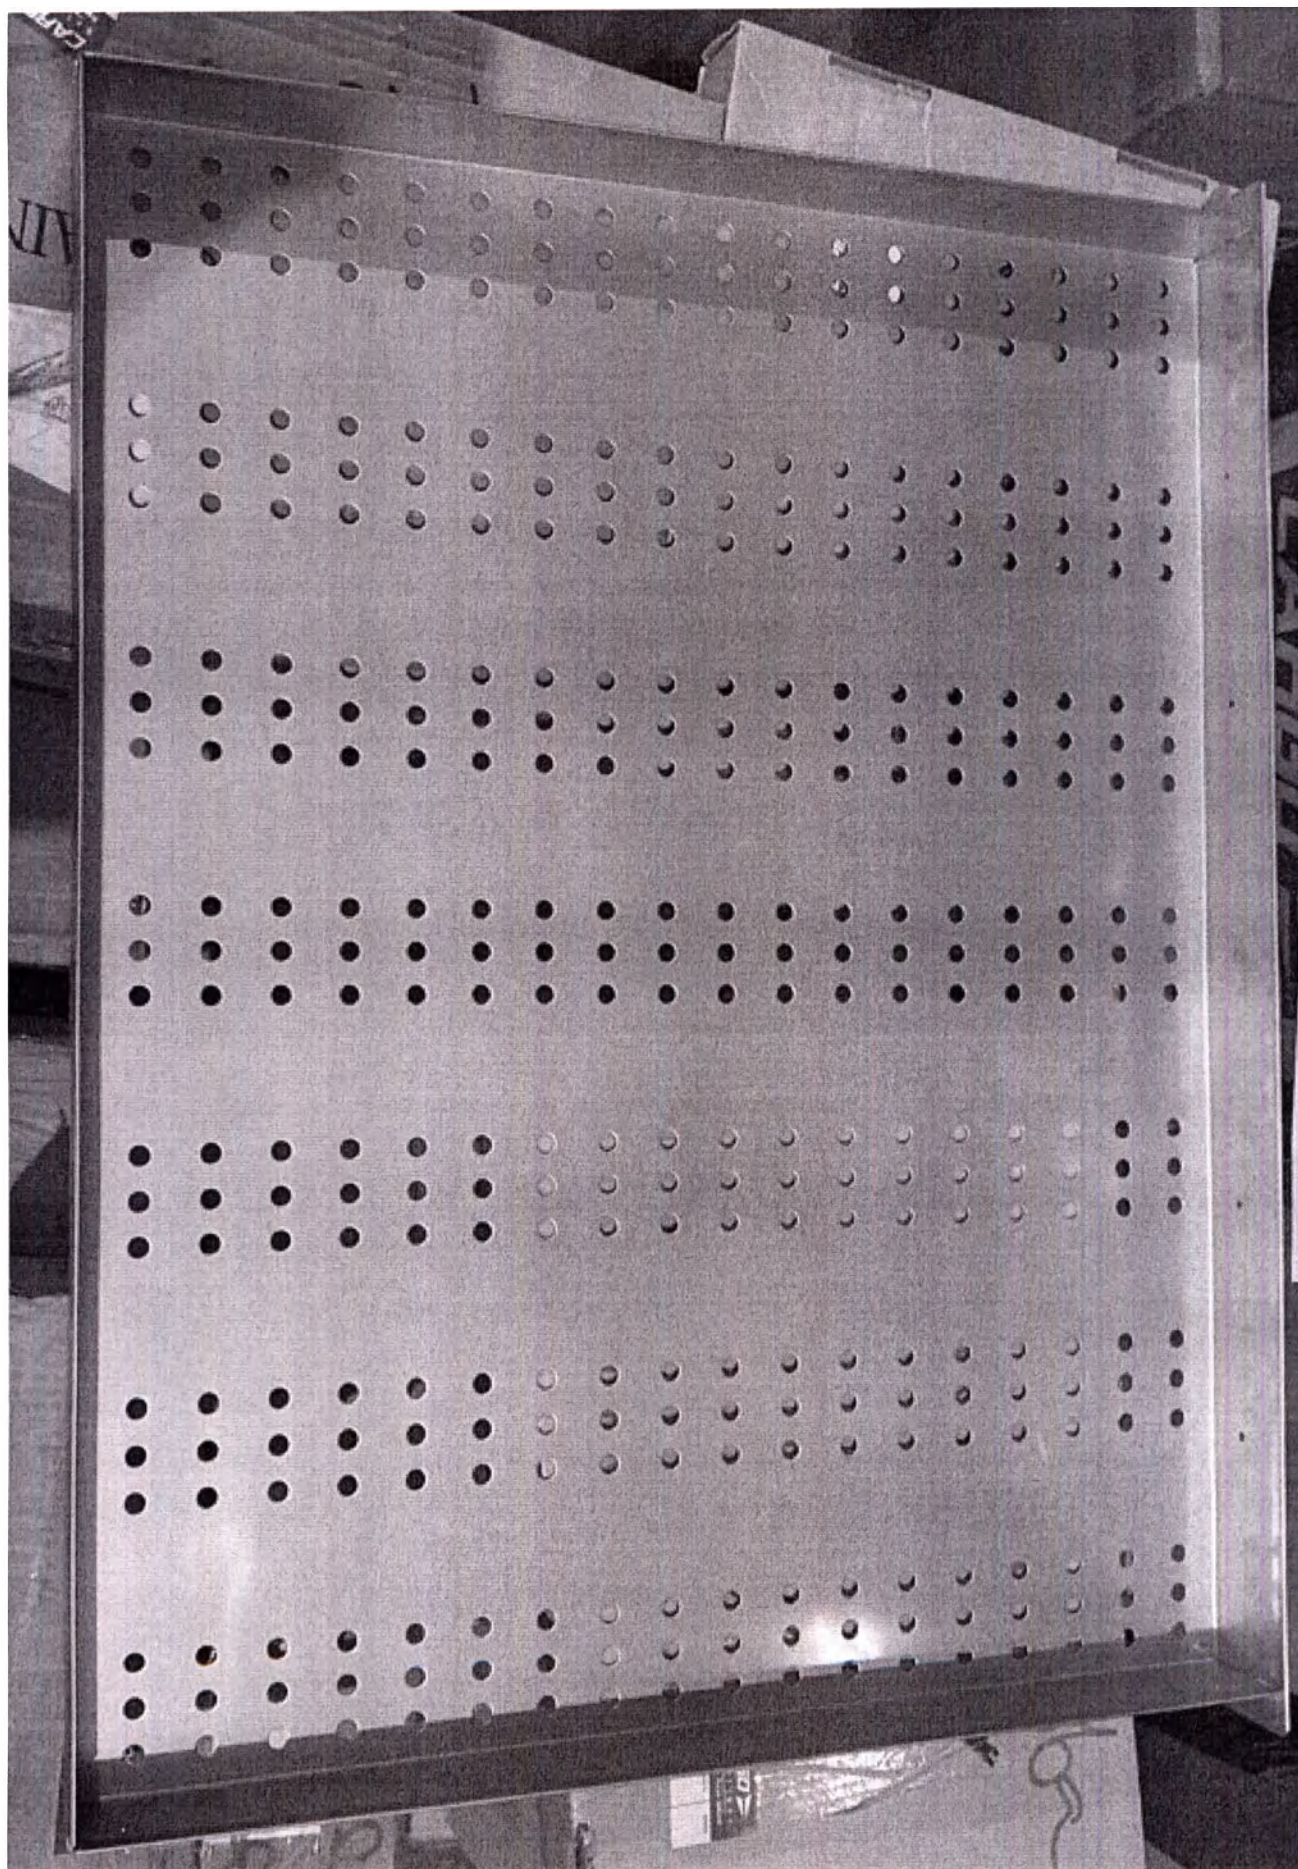


28. Стальная полка

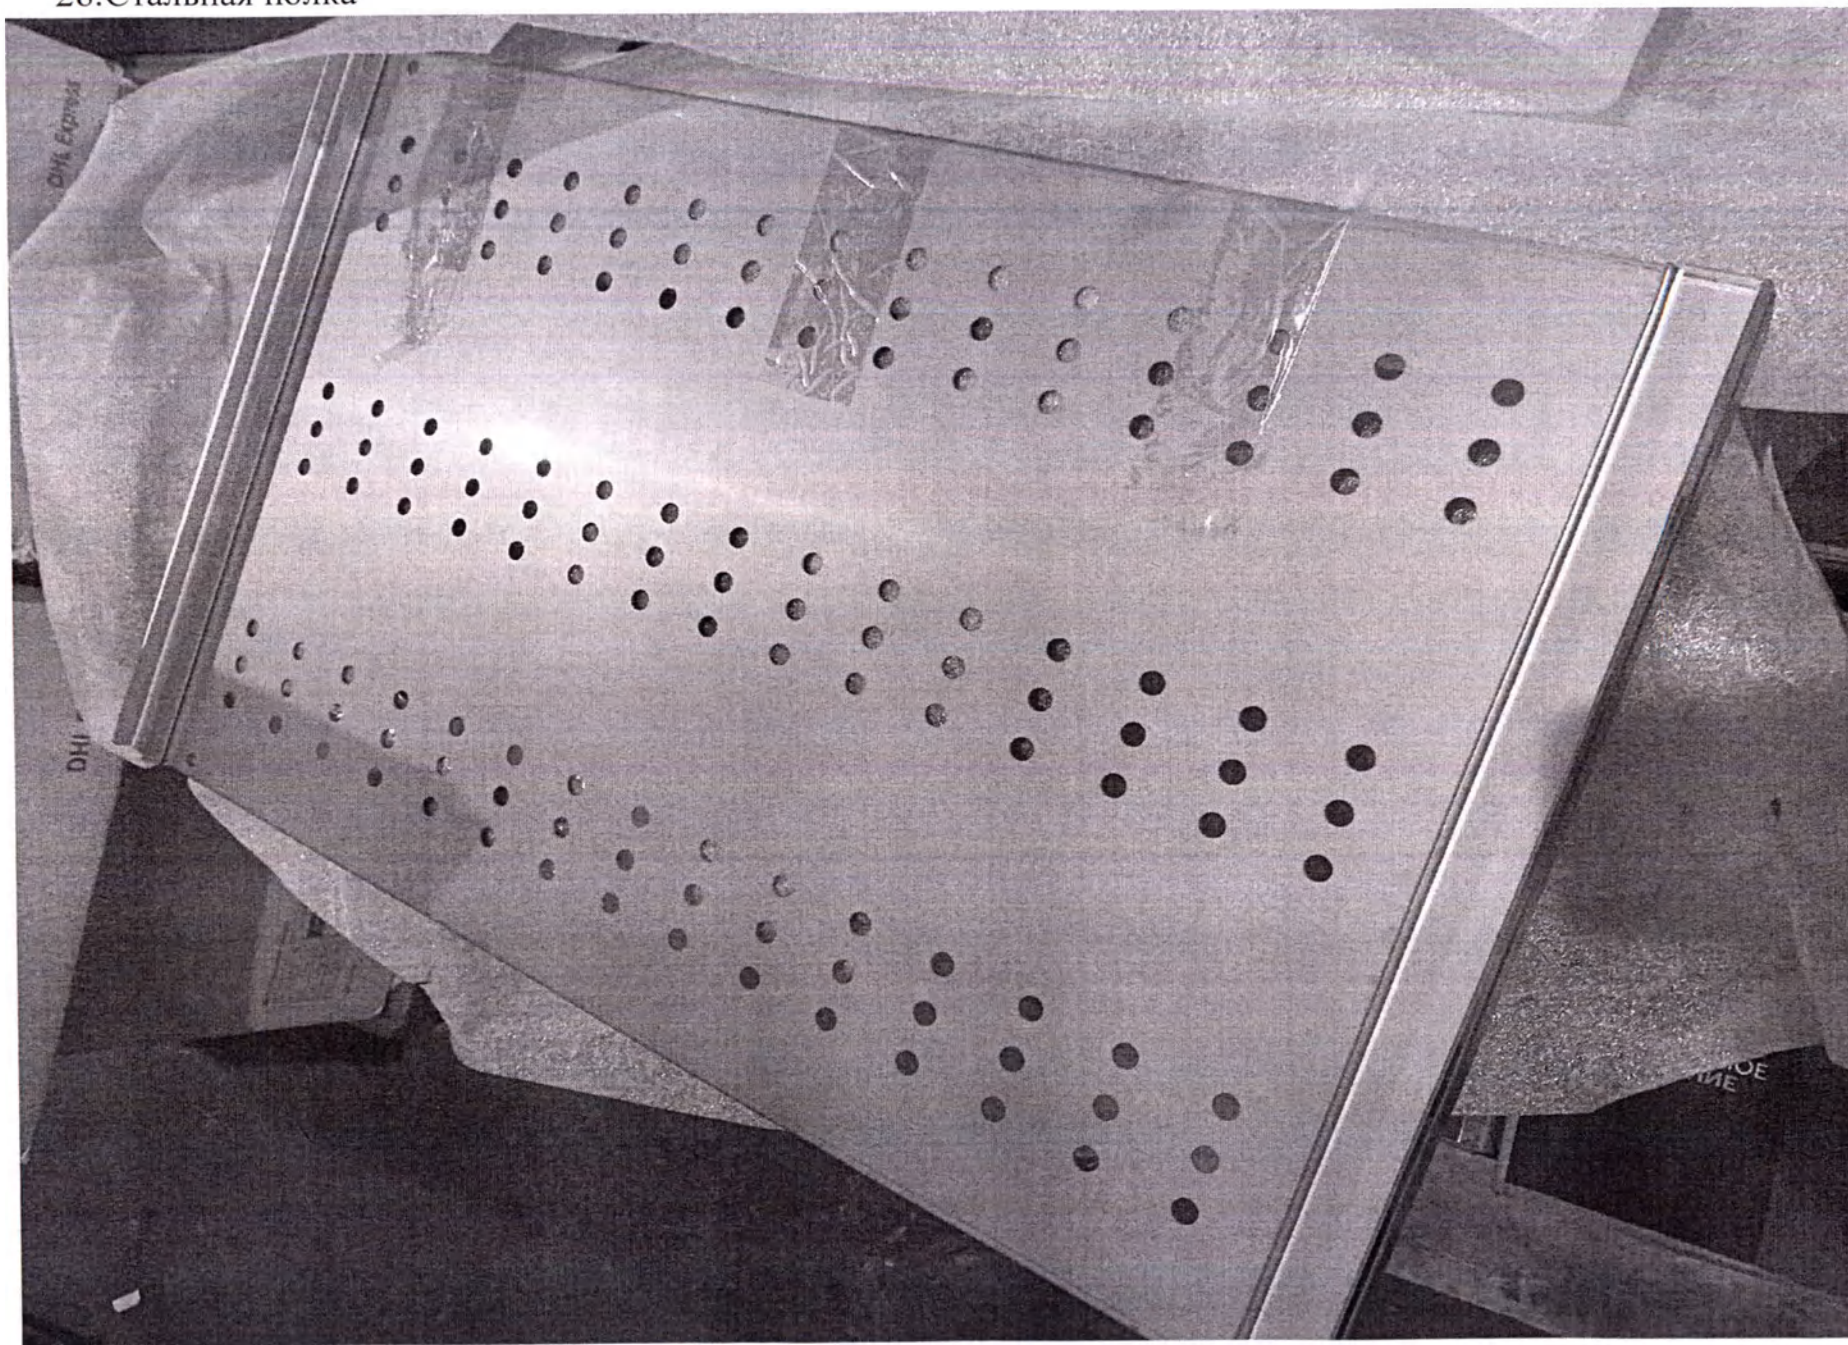


29. Пластиковая подставка

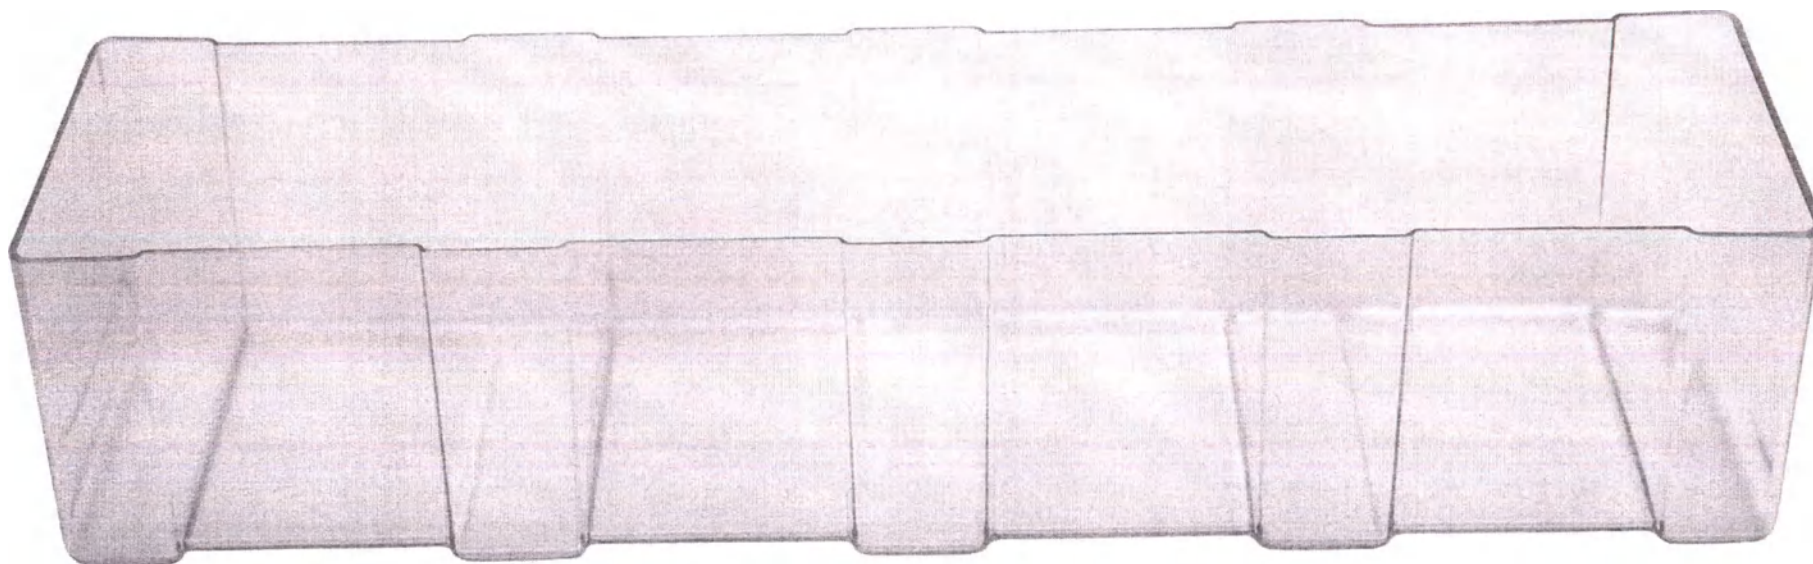

30. Инструмент для аварийного открытия двери

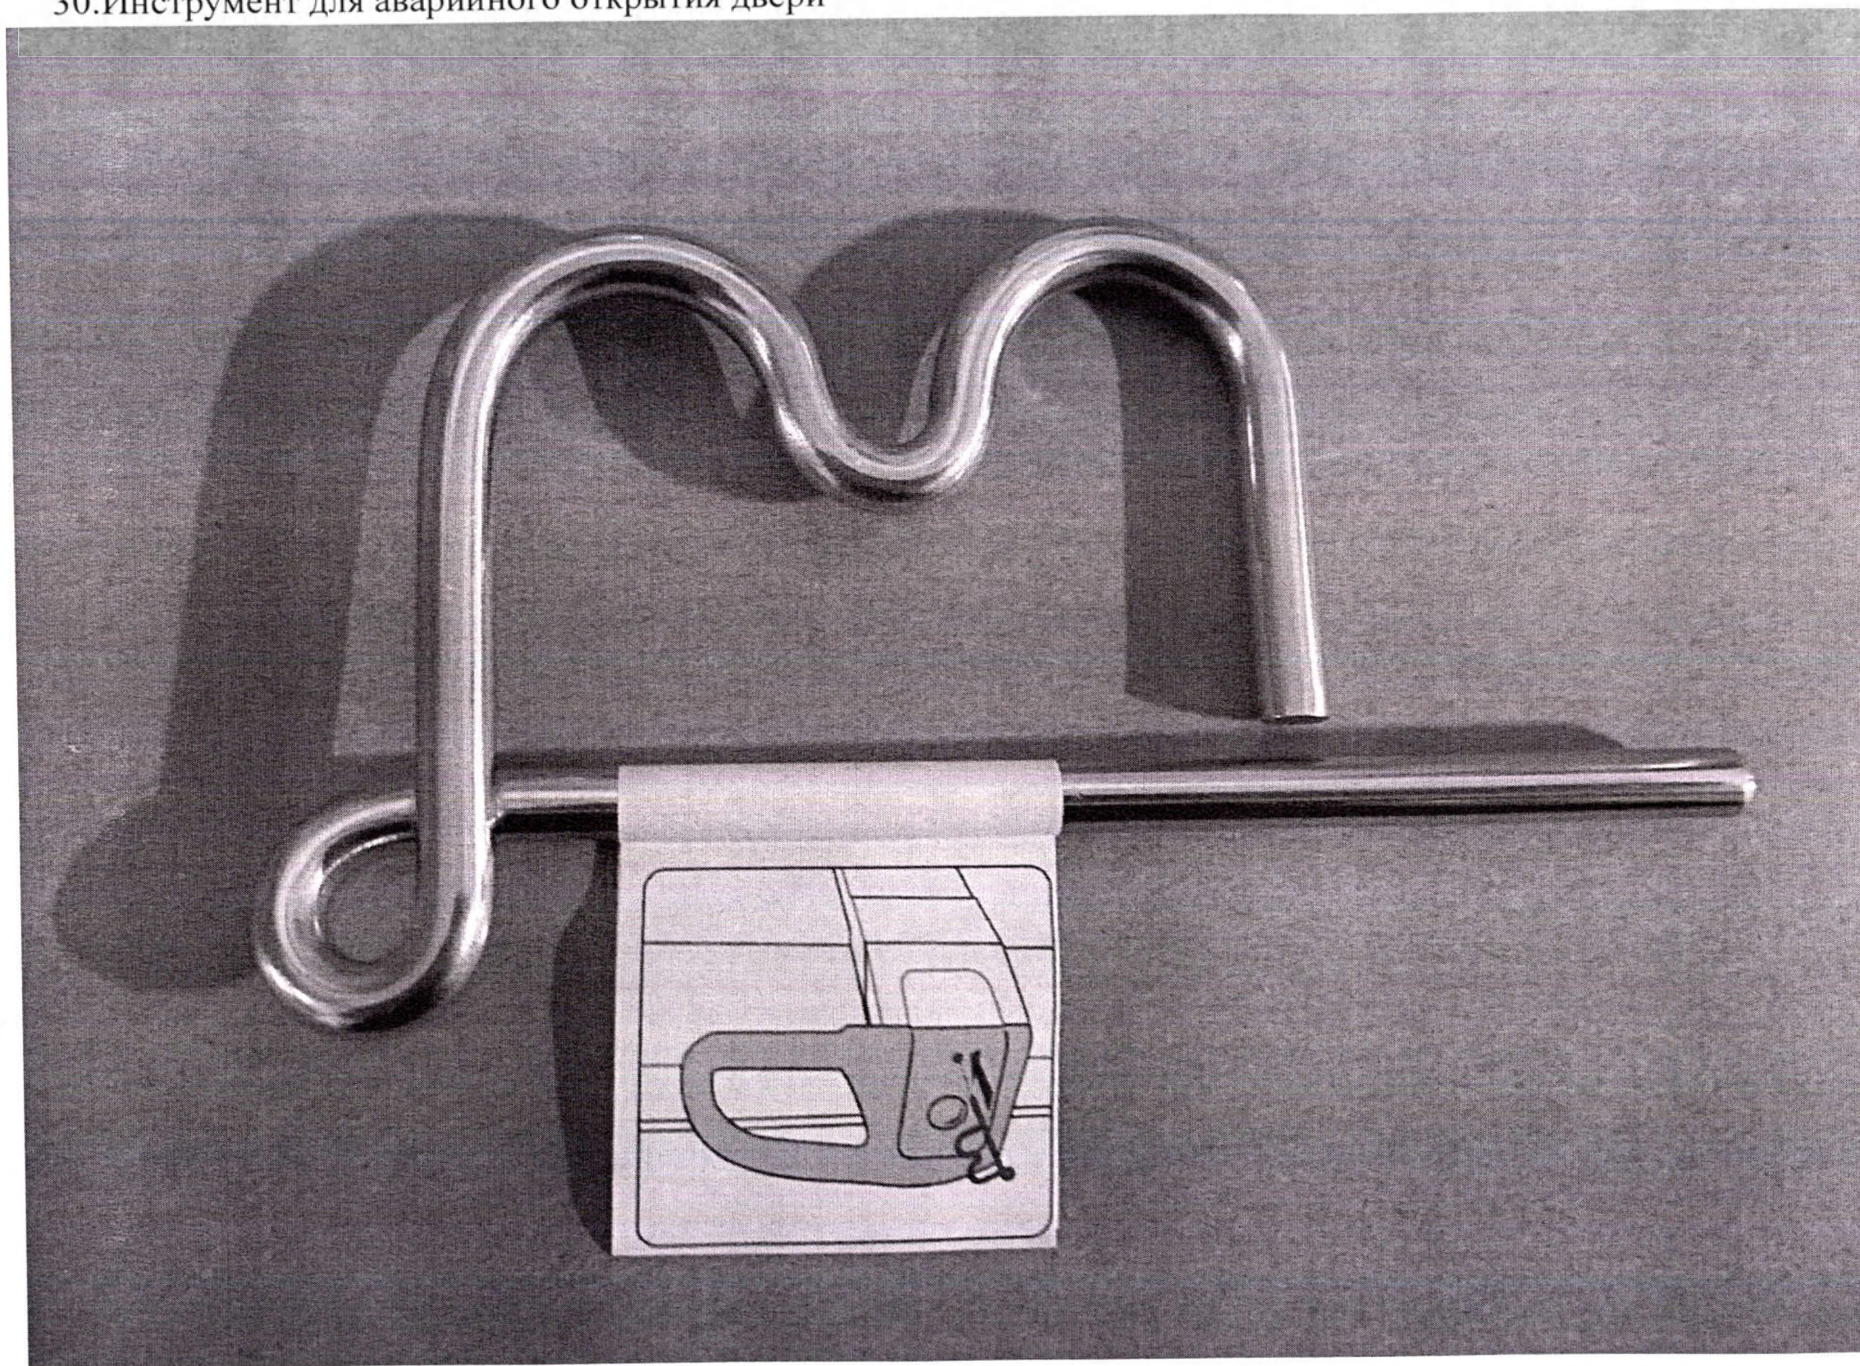

31. Стальная подставка

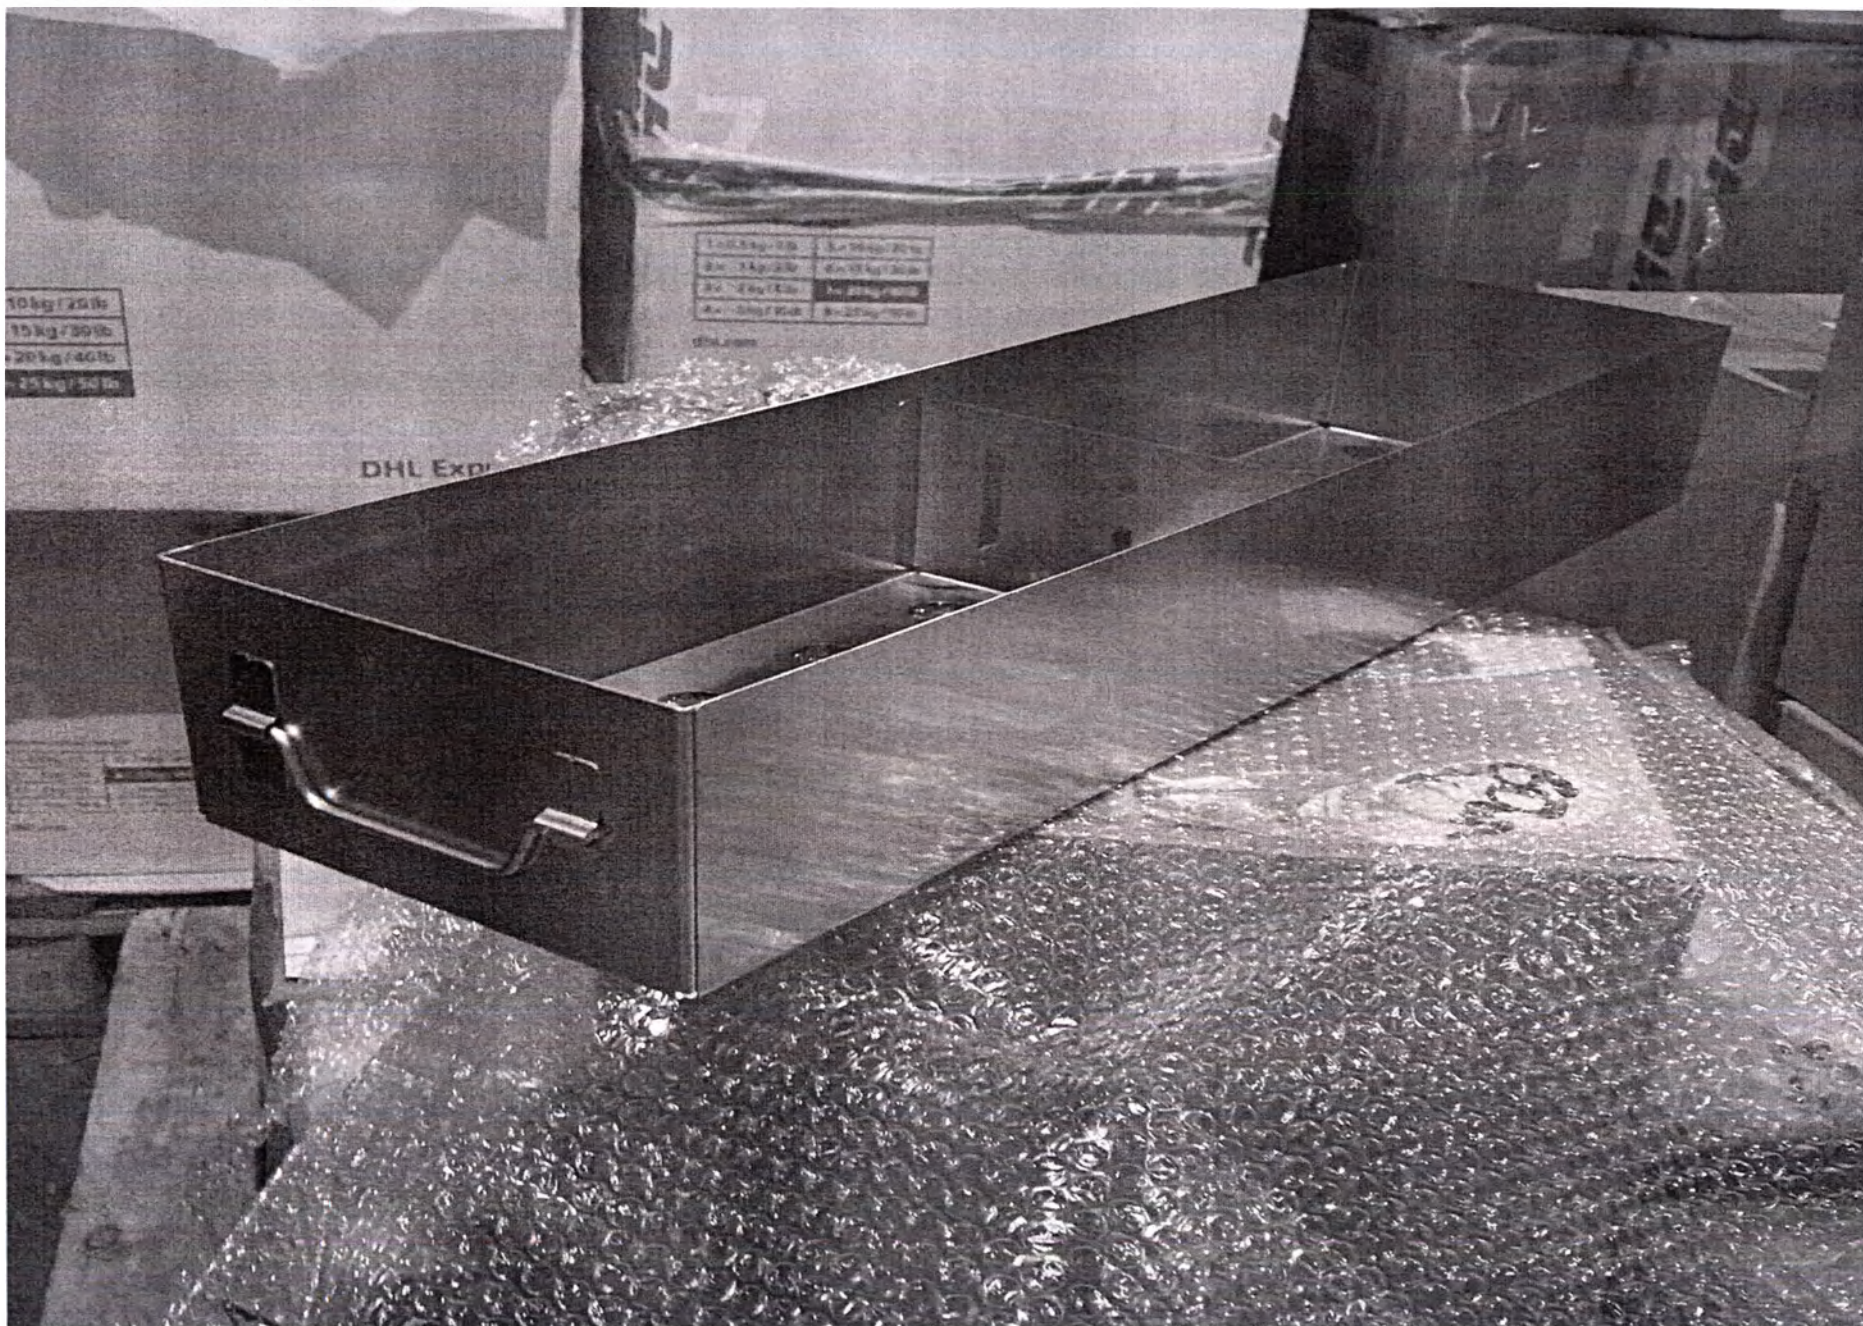

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью
43 (сорок три) листов(а)
Директор ООО «ЦКТ» Киричков Е.А.

