

Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия  
«Контрольная плазма для коагулологических исследований на основе плазмы крови  
человека (Контрольная плазма)» № 3 (вариант 1, серия 1)

Генеральный директор  
АО «Вектор-Бест»

Хусаинов М.Д.

2012 г.



**АО «Вектор-Бест»**

Россия, 630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово,  
Научно-производственная зона, корпус 36, комната 211,  
тел./факс: (383) 332-67-49, 332-67-52

**АО Vector-Best**

Koltsovo, Novosibirsk Region, 630559, Russia,  
Research and Production Area, housing 36, room 211,  
tel./fax: (383) 332-67-49, 332-67-52

**«Вектор-Бест» АҚ**

630559, Ресей, Новосибирск облысы, Кольцово ж.к.  
Ғылыми-өндірістік аймақ, 36 корпус, 211 бөлме  
тел./факс: (383) 332-67-49, 332-67-52

E-mail: [vbmarket@vector-best.ru](mailto:vbmarket@vector-best.ru)  
[www.vector-best.ru](http://www.vector-best.ru)

Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия  
«Контрольная плазма для коагулологических исследований на основе плазмы крови  
человека (Контрольная плазма)» № 3 (вариант 1, серия 2)

Генеральный директор  
АО «Вектор-Бест»

Хусаинов М.Д.

20 22 г.



**АО «Вектор-Бест»**

Россия, 630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово,  
Научно-производственная зона, корпус 36, комната 211,  
тел./факс: (383) 332-67-49, 332-67-52

**AO Vector-Best**

Koltsovo, Novosibirsk Region, 630559, Russia,  
Research and Production Area, housing 36, room 211,  
tel./fax: (383) 332-67-49, 332-67-52

**«Вектор-Бест» АҚ**

630559, Ресей, Новосибирск облысы, Кольцово ж.к.  
Ғылыми-өндірістік аймақ, 36 корпус, 211 бөлме  
тел./факс: (383) 332-67-49, 332-67-52

E-mail: [vbmarket@vector-best.ru](mailto:vbmarket@vector-best.ru)  
[www.vector-best.ru](http://www.vector-best.ru)

Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия  
«Контрольная плазма для коагулологических исследований на основе плазмы крови  
человека (Контрольная плазма)» № 3 (вариант 2, серия 1)

Генеральный директор  
АО «Вектор-Бест»

Хусаинов М.Д.

20 dd г.



**АО «Вектор-Бест»**

Россия, 630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово,  
Научно-производственная зона, корпус 36, комната 211,  
тел./факс: (383) 332-67-49, 332-67-52

**AO Vector-Best**

Koltsovo, Novosibirsk Region, 630559, Russia,  
Research and Production Area, housing 36, room 211,  
tel./fax: (383) 332-67-49, 332-67-52

**«Вектор-Бест» АҚ**

630559, Ресей, Новосибирск облысы, Кольцово ж.к.  
Ғылыми-өндірістік аймақ, 36 корпус, 211 бөлме  
тел./факс: (383) 332-67-49, 332-67-52

E-mail: [vbmarket@vector-best.ru](mailto:vbmarket@vector-best.ru)  
[www.vector-best.ru](http://www.vector-best.ru)

Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия  
«Контрольная плазма для коагулологических исследований на основе плазмы крови  
человека (Контрольная плазма)» № 3 (вариант 2, серия 2)

Генеральный директор  
АО «Вектор-Бест»

Хусаинов М.Д.

20 22 г.



**АО «Вектор-Бест»**

Россия, 630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово,  
Научно-производственная зона, корпус 36, комната 211,  
тел./факс: (383) 332-67-49, 332-67-52

**АО Vector-Best**

Koltsovo, Novosibirsk Region, 630559, Russia,  
Research and Production Area, housing 36, room 211,  
tel./fax: (383) 332-67-49, 332-67-52

**«Вектор-Бест» АҚ**

630559, Ресей, Новосибирск облысы, Кольцово ж.к.  
Ғылыми-өндірістік аймақ, 36 корпус, 211 бөлме  
тел./факс: (383) 332-67-49, 332-67-52

E-mail: [vbmarket@vector-best.ru](mailto:vbmarket@vector-best.ru)  
[www.vector-best.ru](http://www.vector-best.ru)

Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия  
«Контрольная плазма для коагулологических исследований на основе плазмы крови  
человека (Контрольная плазма)» № 3 (вариант 3, серия 1)

Генеральный директор  
АО «Вектор-Бест»

Хусаинов М.Д.

20 22 г.



**АО «Вектор-Бест»**

Россия, 630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово,  
Научно-производственная зона, корпус 36, комната 211,  
тел./факс: (383) 332-67-49, 332-67-52

**AO Vector-Best**

Koltsovo, Novosibirsk Region, 630559, Russia,  
Research and Production Area, housing 36, room 211,  
tel./fax: (383) 332-67-49, 332-67-52

**«Вектор-Бест» АҚ**

630559, Ресей, Новосибирск облысы, Кольцово ж.к.  
Ғылыми-өндірістік аймақ, 36 корпус, 211 бөлме  
тел./факс: (383) 332-67-49, 332-67-52

E-mail: [vbmarket@vector-best.ru](mailto:vbmarket@vector-best.ru)  
[www.vector-best.ru](http://www.vector-best.ru)



**АО «Вектор-Бест»**

Россия, 630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово,  
Научно-производственная зона, корпус 36, комната 211,  
тел./факс: (383) 332-67-49, 332-67-52

**АО Vector-Best**

Koltsovo, Novosibirsk Region, 630559, Russia,  
Research and Production Area, housing 36, room 211,  
tel./fax: (383) 332-67-49, 332-67-52

**«Вектор-Бест» АҚ**

630559, Ресей, Новосибирск облысы, Кольцово ж.к.  
Ғылыми-өндірістік аймақ, 36 корпус, 211 бөлме  
тел./факс: (383) 332-67-49, 332-67-52

**E-mail: [vbmarket@vector-best.ru](mailto:vbmarket@vector-best.ru)  
[www.vector-best.ru](http://www.vector-best.ru)**

Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия  
«Контрольная плазма для коагулологических исследований на основе плазмы крови  
человека (Контрольная плазма)» № 3 (вариант 4, серия 1)

Генеральный директор  
АО «Вектор-Бест»

Хусаинов М.Д.

20 22 г.



**АО «Вектор-Бест»**

Россия, 630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово,  
Научно-производственная зона, корпус 36, комната 211,  
тел./факс: (383) 332-67-49, 332-67-52

**AO Vector-Best**

Koltsovo, Novosibirsk Region, 630559, Russia,  
Research and Production Area, housing 36, room 211,  
tel./fax: (383) 332-67-49, 332-67-52

**«Вектор-Бест» АҚ**

630559, Ресей, Новосибирск облысы, Кольцово ж.к.  
Ғылыми-өндірістік аймақ, 36 корпус, 211 бөлме  
тел./факс: (383) 332-67-49, 332-67-52

E-mail: [vbmarket@vector-best.ru](mailto:vbmarket@vector-best.ru)  
[www.vector-best.ru](http://www.vector-best.ru)

Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия  
«Контрольная плазма для коагулологических исследований на основе плазмы крови  
человека (Контрольная плазма)» № 3 (вариант 4, серия 2)

Генеральный директор  
АО «Вектор-Бест»

Хусаинов М.Д.

20 dd г.



**АО «Вектор-Бест»**

Россия, 630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово,  
Научно-производственная зона, корпус 36, комната 211,  
тел./факс: (383) 332-67-49, 332-67-52

**АО Vector-Best**

Koltsovo, Novosibirsk Region, 630559, Russia,  
Research and Production Area, housing 36, room 211,  
tel./fax: (383) 332-67-49, 332-67-52

**«Вектор-Бест» АҚ**

630559, Ресей, Новосибирск облысы, Кольцово ж.к.  
Ғылыми-өндірістік аймақ, 36 корпус, 211 бөлме  
тел./факс: (383) 332-67-49, 332-67-52


E-mail: [vbmarket@vector-best.ru](mailto:vbmarket@vector-best.ru)  
[www.vector-best.ru](http://www.vector-best.ru)

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия  
«Контрольная плазма для коагулологических исследований на основе плазмы крови  
человека (Контрольная плазма)» № 1 (вариант 4, серия 1)

Генеральный директор  
АО «Вектор-Бест»


Хусаинов М.Д.

2021 г.

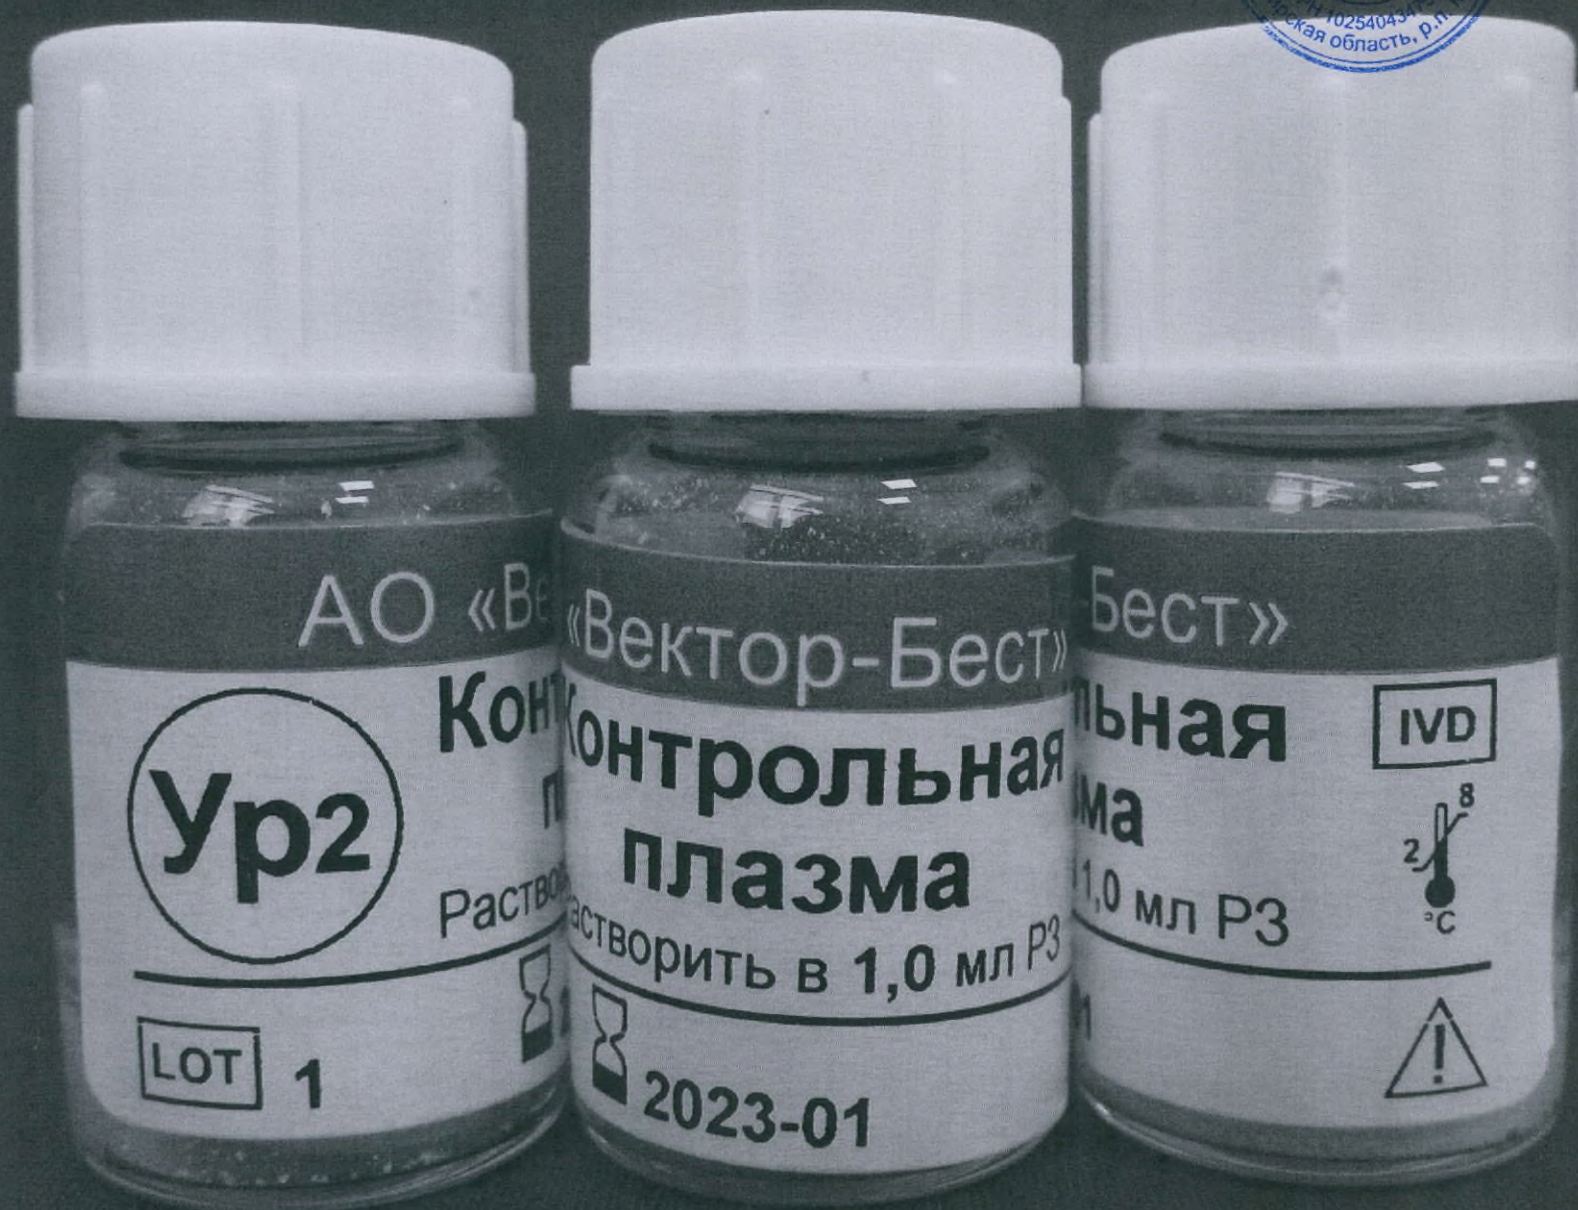

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия  
«Контрольная плазма для коагулологических исследований на основе плазмы крови  
человека (Контрольная плазма)» № 2 (вариант 4, серия 1)

Генеральный директор Хусаинов М.Д.  
АО «Вектор-Бест» 13 2021 г.

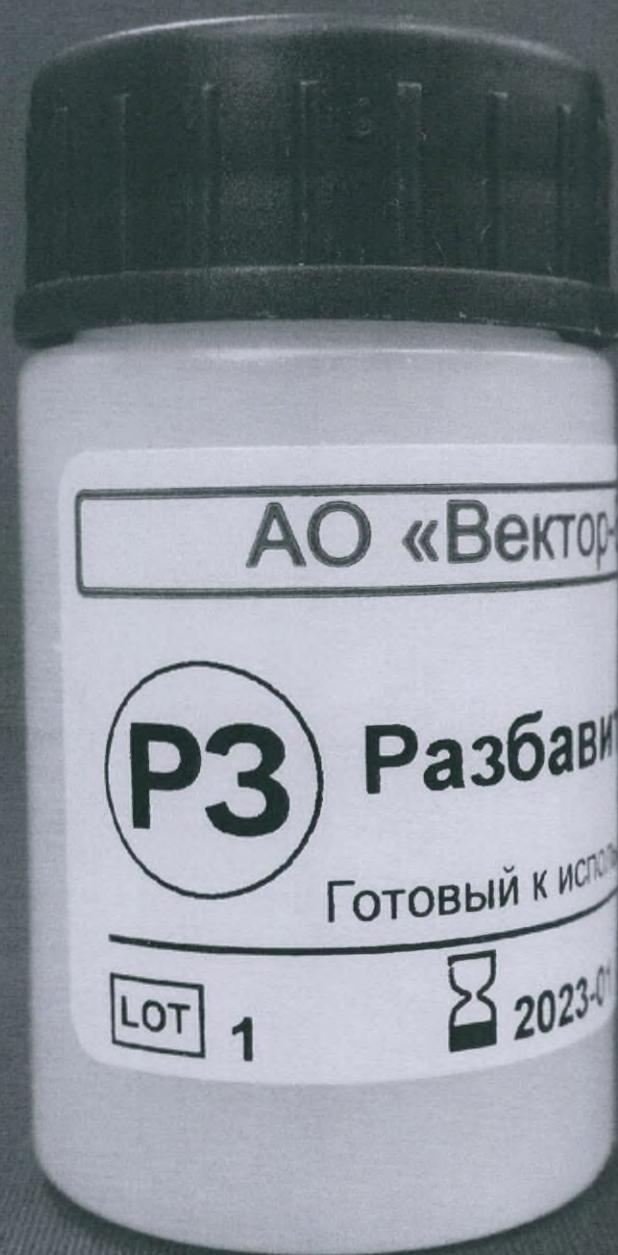

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия  
«Контрольная плазма для коагулологических исследований на основе плазмы крови  
человека (Контрольная плазма)» № 3 (вариант 4, серия 1)

Генеральный директор  
АО «Вектор-Бест»




Хусаинов М.Д.  
2021 г.



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия  
«Контрольная плазма для коагулологических исследований на основе плазмы крови  
человека (Контрольная плазма)» № 4 (вариант 4, серия 1)

Генеральный директор  
АО «Вектор-Бест» \_\_\_\_\_ Хусаинов М.Д.  
\_\_\_\_\_ 2021 г.





Хранить при темпер  
Транспортировать п  
°С. Допускается п  
температура до 2

Протромб

по применению контрольной таблицы для контроля  
на основе таблицы второй модели  
(Контрольная таблица)

| Комплексная планка | Базисная     |
|--------------------|--------------|
| 10,64 (Vol%)       | 10,64 (Vol%) |
| 11,72 (Vol%)       | 11,72 (Vol%) |
| 10,64 (Vol%)       | 10,64 (Vol%) |
| 11,72 (Vol%)       | 11,72 (Vol%) |

| Вариант комплектации | Оформля                     |
|----------------------|-----------------------------|
| 1                    | 10 фн (Vp1),<br>1-12-м (P3) |
| 2                    | 10 фн (Vp2),<br>1-12-м (P3) |
| 3                    | 5 фн (Vp1),<br>1-12-м (P3)  |
| 4                    | 5 фн (Vp2),<br>1-12-м (P3)  |

2.4. ХАРАКТЕРИСТИКА КОНТРОЛЬНОЙ ПЛАЗМЫ

2. ХАРАКТЕРИСТИКА КОНТРОЛЬНЫХ УРОВНЕЙ

2.1. Состав контрольных плазм

В состав контрольной плазмы входят:

- плазма крови человека;
- раствор содержащий натрий (0,05%)

(Ур2); на основе плазмы крови человека, содержащий натрий (0,05%)

лиофилизированная.

Состав вариантов контрольных плазм:

- 1) - контрольная плазма, уровень 1 - 10 факторов;
- 2) - рабавитель - 1 фактор (12 мг);

Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия  
«Контрольная плазма для коагулологических исследований на основе плазмы крови  
человека (Контрольная плазма)» № 1 (вариант 4, серия 2)

Генеральный директор  
АО «Вектор-Бест»

Хусаинов М.Д.

2021 г.



ВЕКТОР

**БЕСТ**

REF

**X-XXXX**

контрольная плазма  
для коагулологических  
исследований на основе  
плазмы крови человека

## Контрольная плазма

Состав: Ур2 (5 фл)  
РЗ (1×12 мл)

ТУ 21.20.23-146-23548172-2021  
РУ

Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия  
«Контрольная плазма для коагулологических исследований на основе плазмы крови  
человека (Контрольная плазма)» № 2 (вариант 4, серия 2)

Генеральный директор  
АО «Вектор-Бест»

Хусаинов М.Д.

2021 г.



REF

LOT

2

**X-XXXX**




2021-02




2023-02

## Контрольная плазма




XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



Для профессионального применения  
Антитела к ВИЧ 1,2 и вирусу гепатита С  
и HBsAg отсутствуют


Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия  
«Контрольная плазма для коагулологических исследований на основе плазмы крови  
человека (Контрольная плазма)» № 1 (вариант 4, серия 2)

Генеральный директор  
АО «Вектор-Бест» \_\_\_\_\_ Хусаинов М.Д.  
103 2021 г.

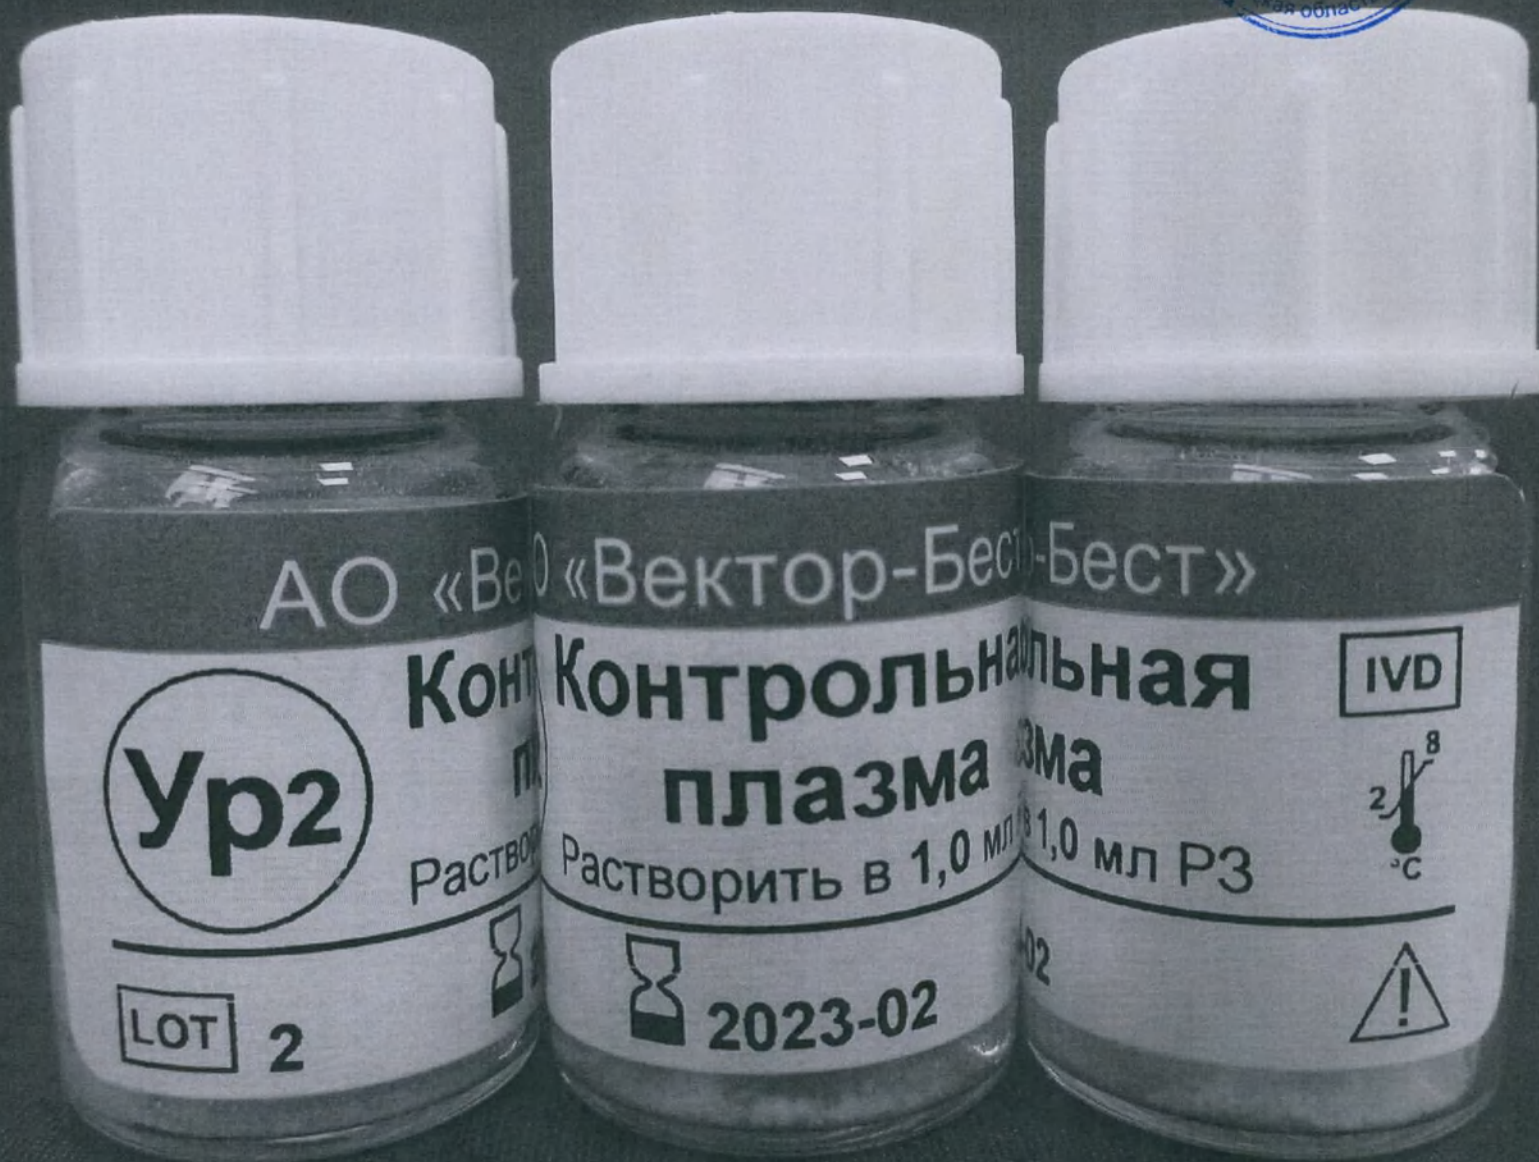

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия  
«Контрольная плазма для коагулологических исследований на основе плазмы крови  
человека (Контрольная плазма)» № 2 (вариант 4, серия 2)

Генеральный директор общества  
АО «Вектор-Бест» Хусаинов М.Д.  
«04» \_\_\_\_\_ 2021 г.

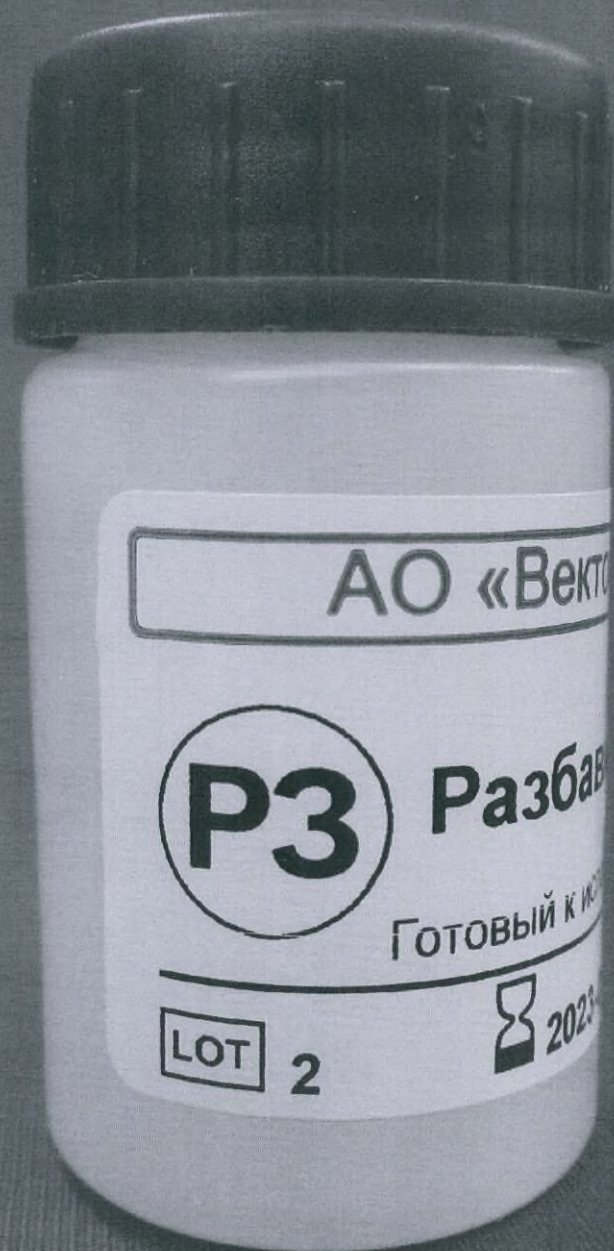

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия  
«Контрольная плазма для коагулологических исследований на основе плазмы крови  
человека (Контрольная плазма)» № 3 (вариант 4, серия 2)

Генеральный директор  
АО «Вектор-Бест» Хусаинов М.Д.  
03 2021 г.



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия  
«Контрольная плазма для коагулологических исследований на основе плазмы крови  
человека (Контрольная плазма)» № 4 (вариант 4, серия 2)

Генеральный директор  
АО «Вектор-Бест»

Хусаинов М.Д.  
2021 г.




Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия  
«Контрольная плазма для коагулологических исследований на основе плазмы крови  
человека (Контрольная плазма)» № 1 (вариант 2, серия 2)

Генеральный директор Хусаинов М.Д.  
АО «Вектор-Бест»



10.03 2021 г.

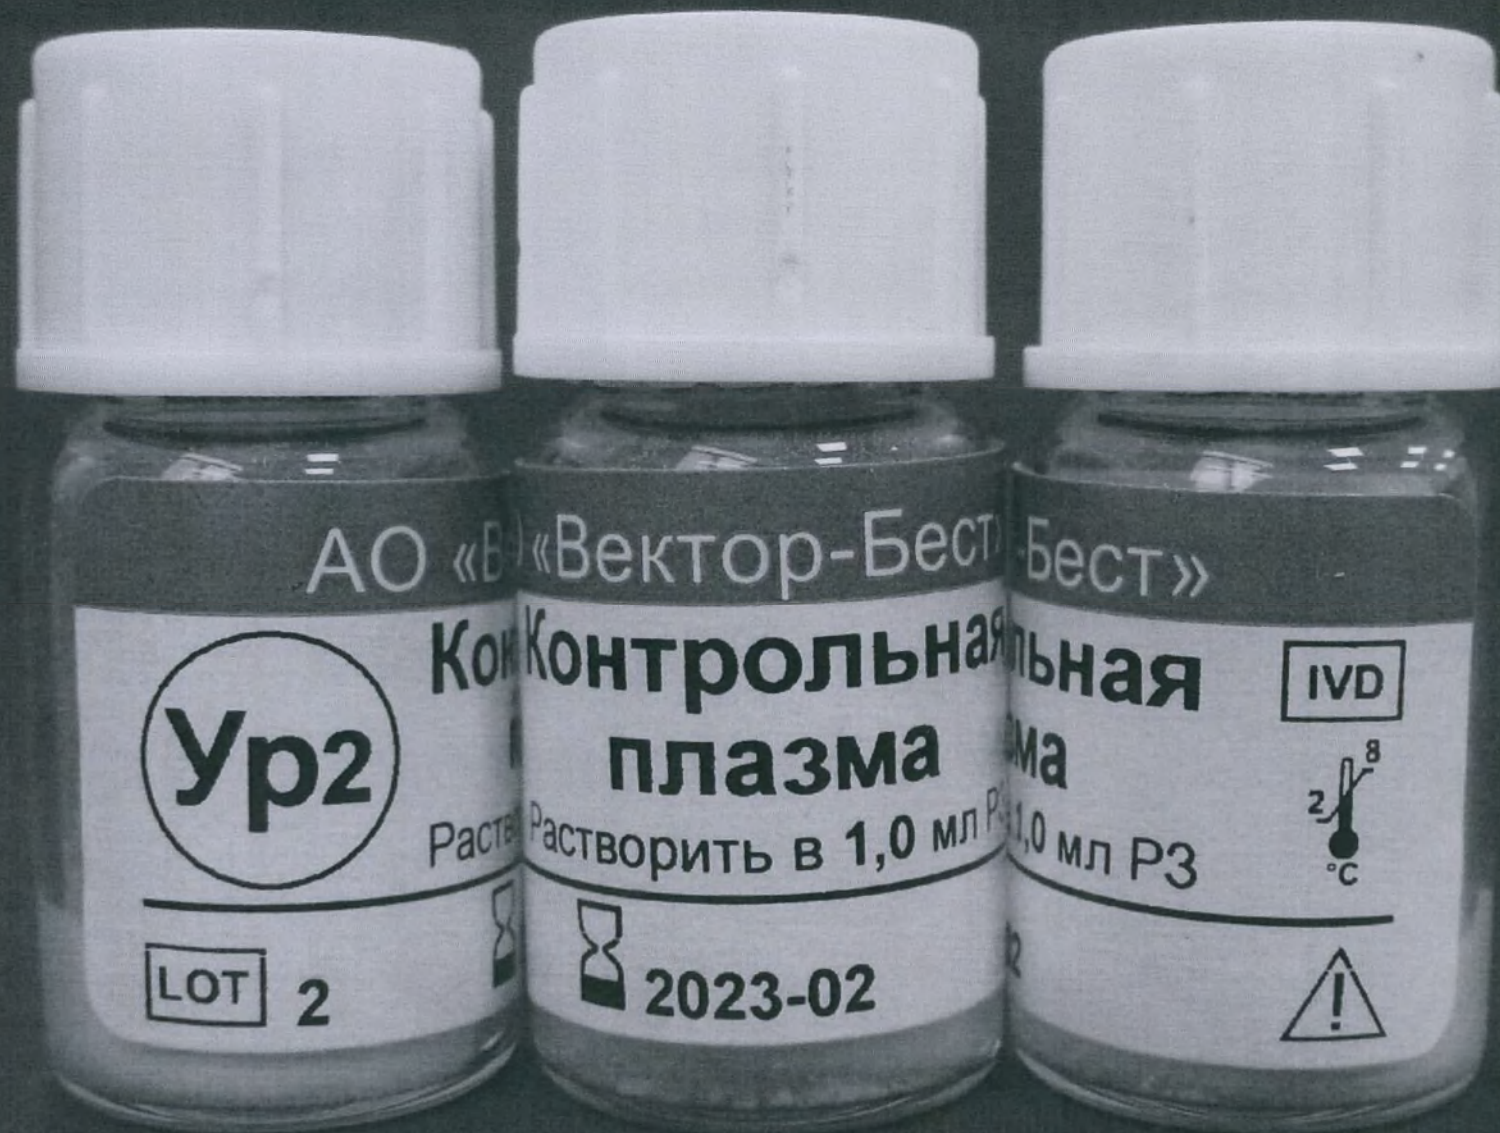


Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия  
«Контрольная плазма для коагулологических исследований на основе плазмы крови  
человека (Контрольная плазма)» № 2 (вариант 2, серия 2)

Генеральный директор  
АО «Вектор-Бест»




Хусаинов М.Д.  
10.03 2021 г.

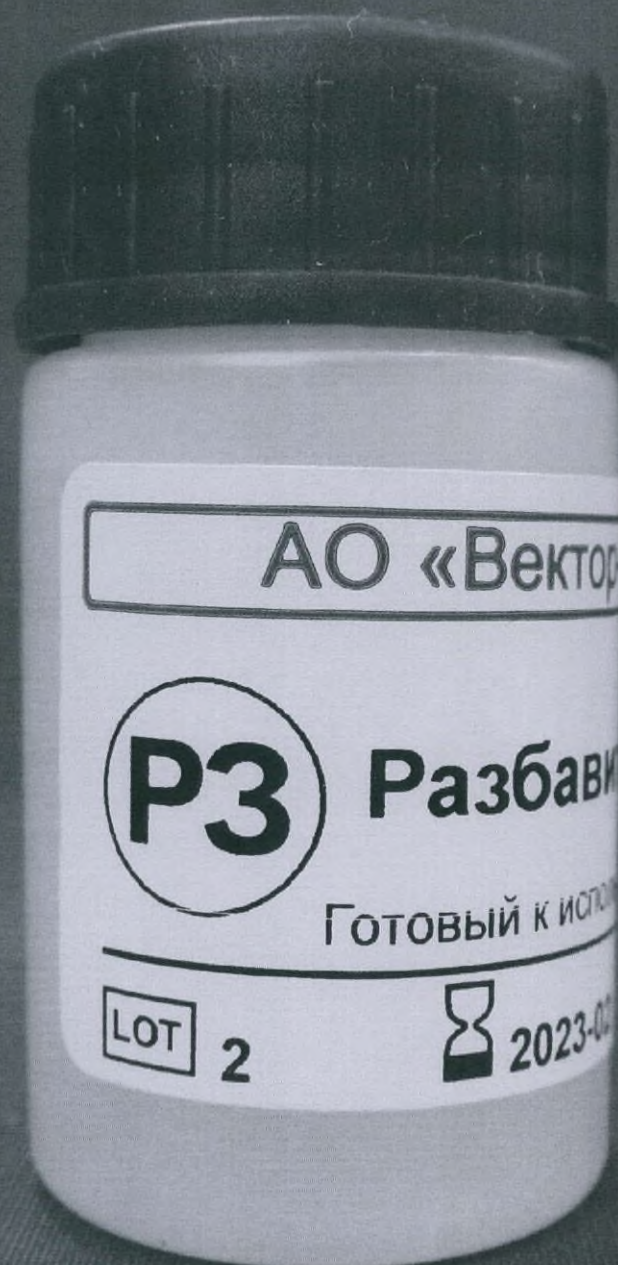

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия  
«Контрольная плазма для коагулологических исследований на основе плазмы крови  
человека (Контрольная плазма)» № 3 (вариант 2, серия 2)

Генеральный директор  
АО «Вектор-Бест»

Хусаинов М.Д.  
103 2021 г.

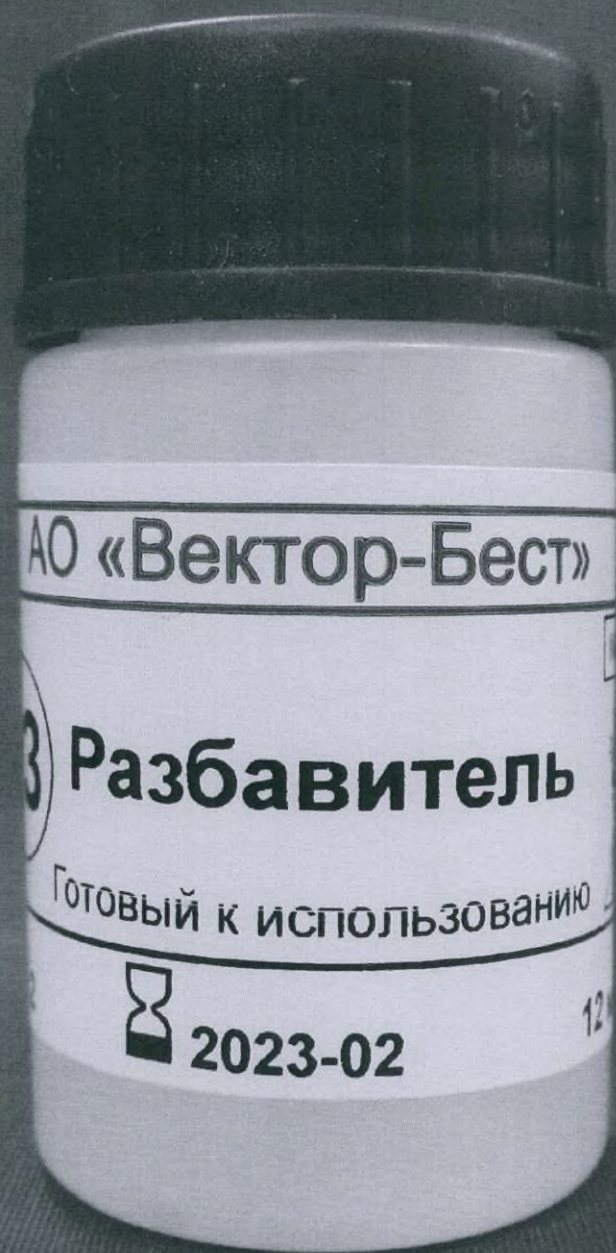

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия  
«Контрольная плазма для коагулологических исследований на основе плазмы крови  
человека (Контрольная плазма)» № 4 (вариант 2, серия 2)

Генеральный директор  
АО «Вектор-Бест»

Хусаинов М.Д.

2021 г.




Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия  
«Контрольная плазма для коагулологических исследований на основе плазмы крови человека (Контрольная плазма)» (вариант 3, серия 1)

Генеральный директор  
АО «Вектор-Бест»



2021 г.

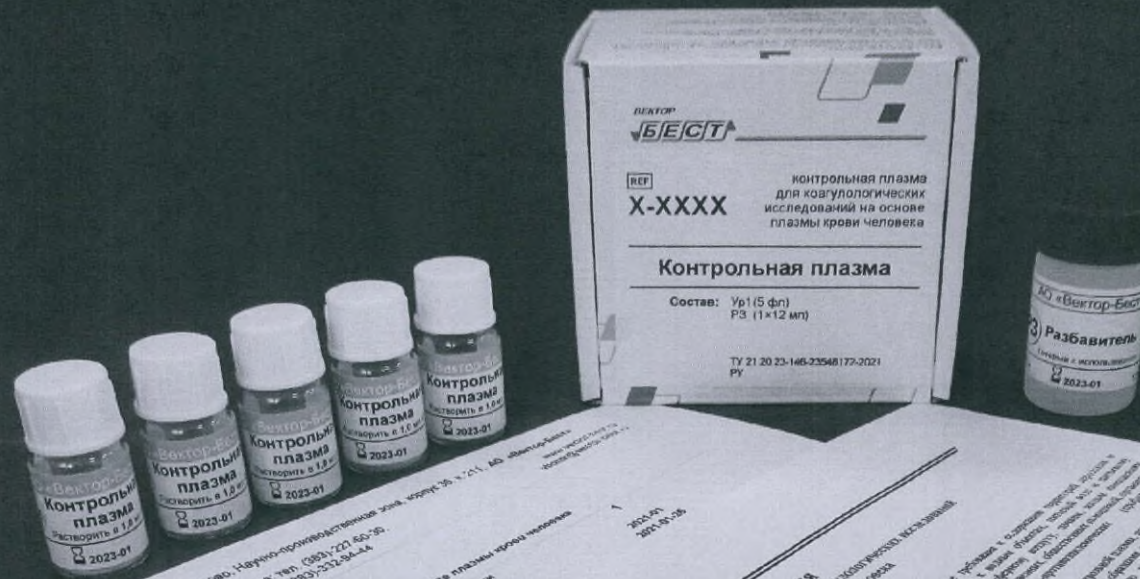

ПАСПОРТ НА ИЗДЕЛИЕ  
Контрольная плазма



### ИНСТРУКЦИЯ

по применению контрольной плазмы для коагулологических исследований на основе плазмы крови человека (Контрольная плазма)

#### 1. НАЗНАЧЕНИЕ

- 1.1. Контрольная плазма для коагулологических исследований на основе плазмы крови человека (Контрольная плазма) используется для проведения коагулологических исследований в лабораториях с помощью автоматизированных анализаторов.
- 1.2. Контрольная плазма используется для контроля качества работы анализатора.

| Вариант комплектации | Объем          |
|----------------------|----------------|
| 1                    | 10 мл (100 мл) |
| 2                    | 10 мл (100 мл) |
| 3                    | 10 мл (100 мл) |
| 4                    | 5 мл (50 мл)   |
| 5                    | 5 мл (50 мл)   |

#### 2. ХАРАКТЕРИСТИКА КОНТРОЛЬНОЙ ПЛАЗМЫ

- В состав контрольной плазмы входят:
- плазма крови человека
  - разбавитель
- Состав контрольной плазмы:
- 1) - плазма крови человека, содержание натрия ионов (0,05%);
  - 2) - плазма крови человека, содержание натрия ионов (0,05%);
  - 3) - плазма крови человека, содержание натрия ионов (0,05%);
  - 4) - плазма крови человека, содержание натрия ионов (0,05%);
  - 5) - плазма крови человека, содержание натрия ионов (0,05%);

Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия  
«Контрольная плазма для коагулологических исследований на основе плазмы крови  
человека (Контрольная плазма)» № 1 (вариант 3, серия 1)

Генеральный директор  
АО «Вектор-Бест»

Хусаинов М.Д.

2021 г.



БЕКТОР

**БЕСТ**

REF

**X-XXXX**

контрольная плазма  
для коагулологических  
исследований на основе  
плазмы крови человека

## Контрольная плазма

Состав: Ур1 (5 фл)  
РЗ (1×12 мл)

ТУ 21.20.23-146-23548172-2021  
РУ

Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия  
«Контрольная плазма для коагулологических исследований на основе плазмы крови  
человека (Контрольная плазма)» № 2 (вариант 3, серия 1)

Генеральный директор  
АО «Вектор-Бест»

Хусаинов М.Д.

2021 г.



REF

X-XXXX

LOT

1





2021-01



2023-01

## Контрольная плазма



XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

IVD



Для профессионального применения  
Антитела к ВИЧ 1,2 и вирусу гепатита С  
и HBsAg отсутствуют


Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия  
«Контрольная плазма для коагулологических исследований на основе плазмы крови  
человека (Контрольная плазма)» № 1 (вариант 3, серия 1)

Генеральный директор Хусаинов М.Д.  
АО «Вектор-Бест» 103 2021 г.



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия  
«Контрольная плазма для коагулологических исследований на основе плазмы крови  
человека (Контрольная плазма)» № 2 (вариант 3, серия 1)

Генеральный директор Хусаинов М.Д.  
АО «Вектор-Бест» «01» 03 2021 г.

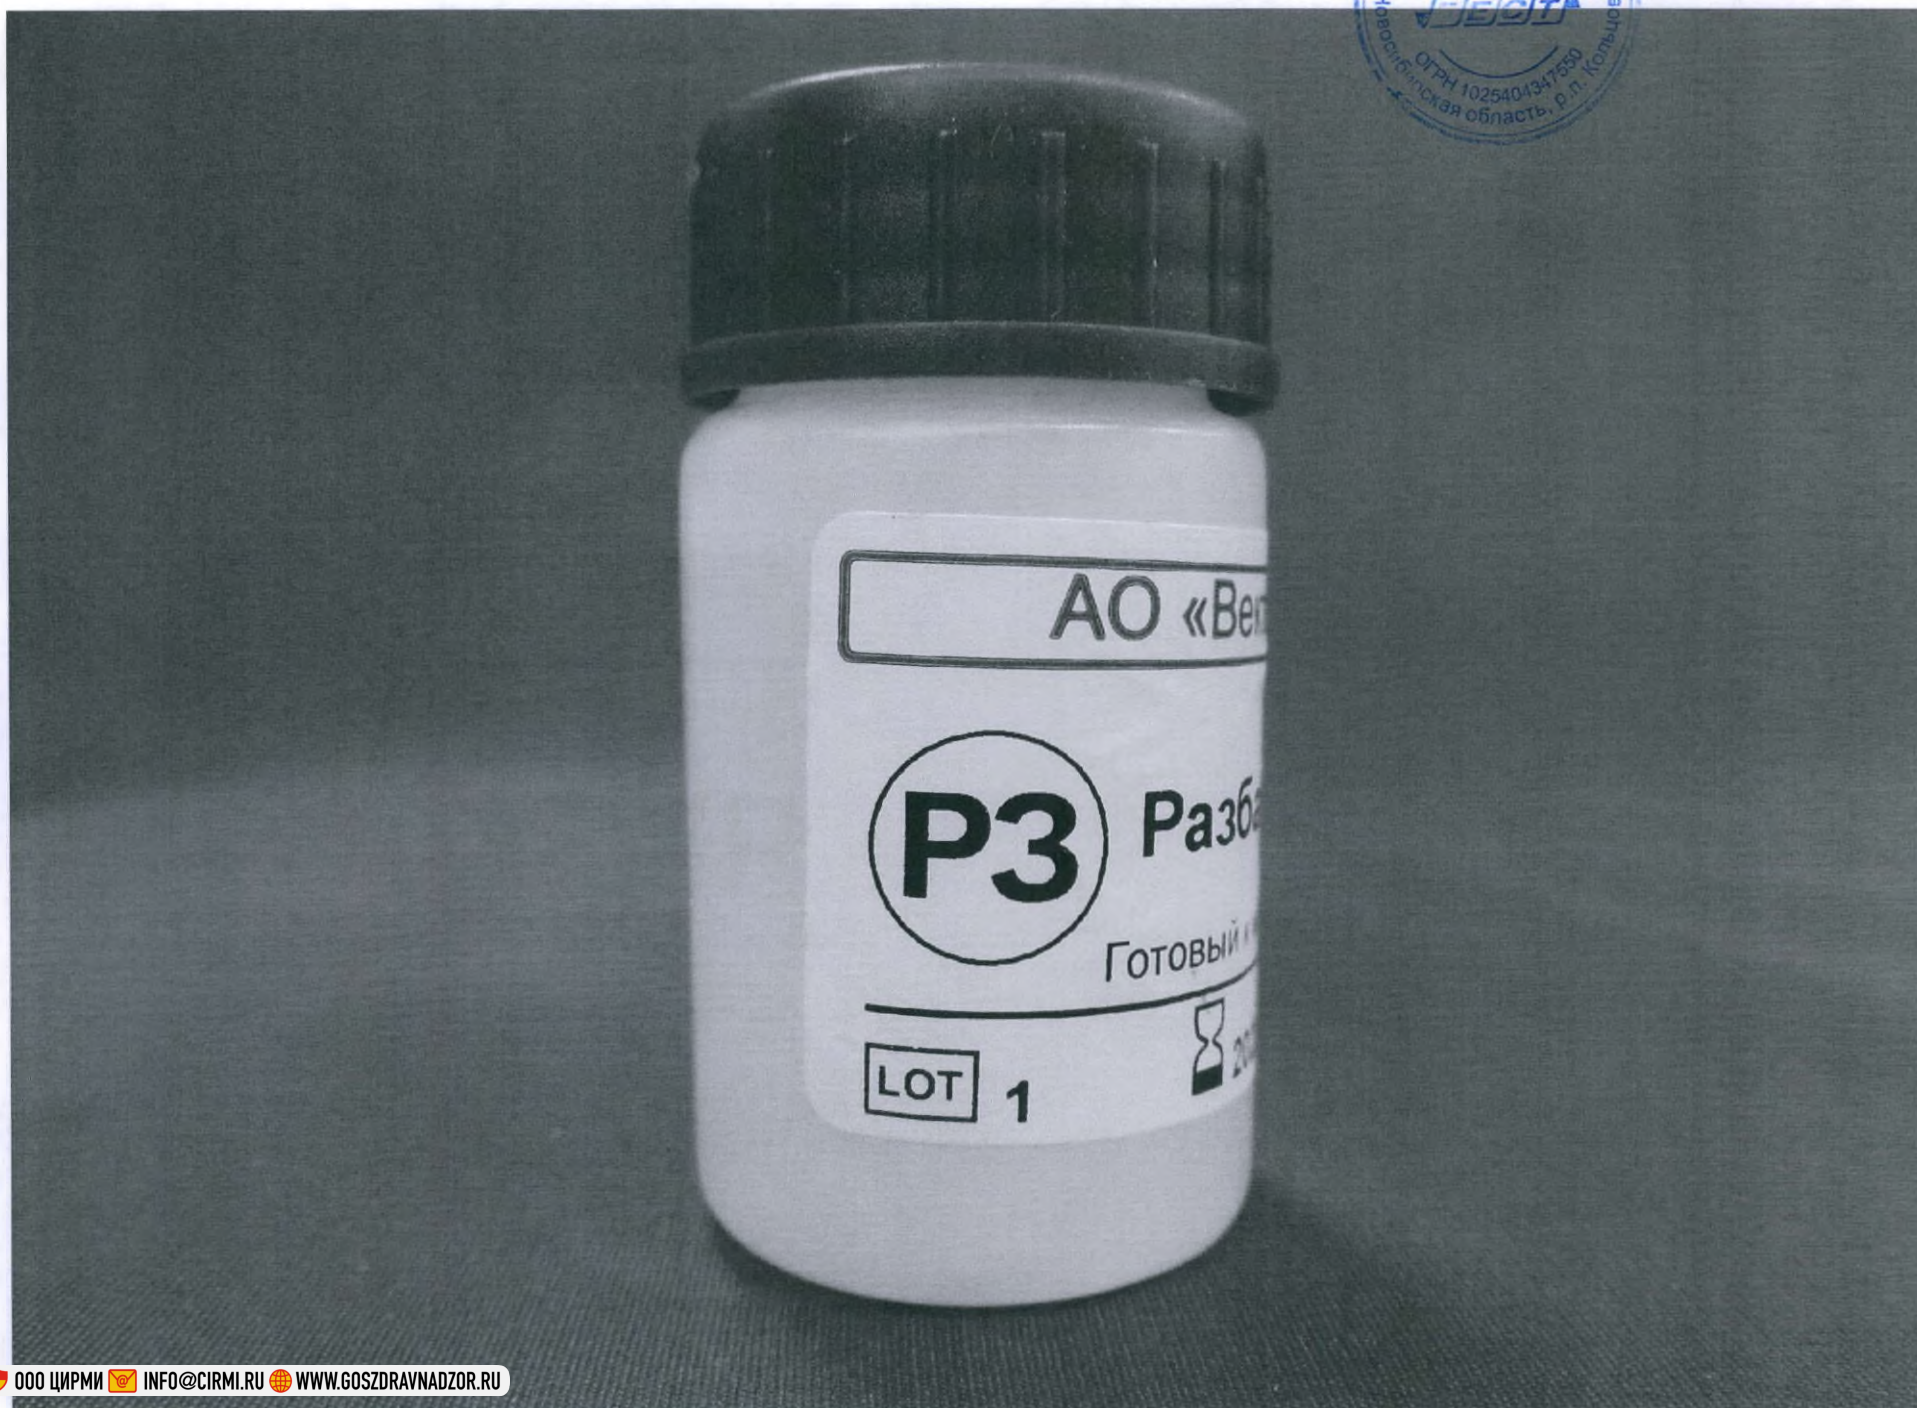

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия  
«Контрольная плазма для коагулологических исследований на основе плазмы крови  
человека (Контрольная плазма)» № 3 (вариант 3, серия 1)

Генеральный директор  
АО «Вектор-Бест» \_\_\_\_\_ Хусаинов М.Д.  
\_\_\_\_\_ 103 2021 г.



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия  
«Контрольная плазма для коагулологических исследований на основе плазмы крови  
человека (Контрольная плазма)» № 4 (вариант 3, серия 1)

Генеральный директор  
АО «Вектор-Бест» \_\_\_\_\_ Хусаинов М.Д.  
«09» \_\_\_\_\_ 103 2021 г.




Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия  
«Контрольная плазма для коагулологических исследований на основе плазмы крови человека (Контрольная плазма)» (вариант 3, серия 2)

Генеральный директор  
АО «Вектор-Бест»



Хусаинов М.Д.  
2021 г.

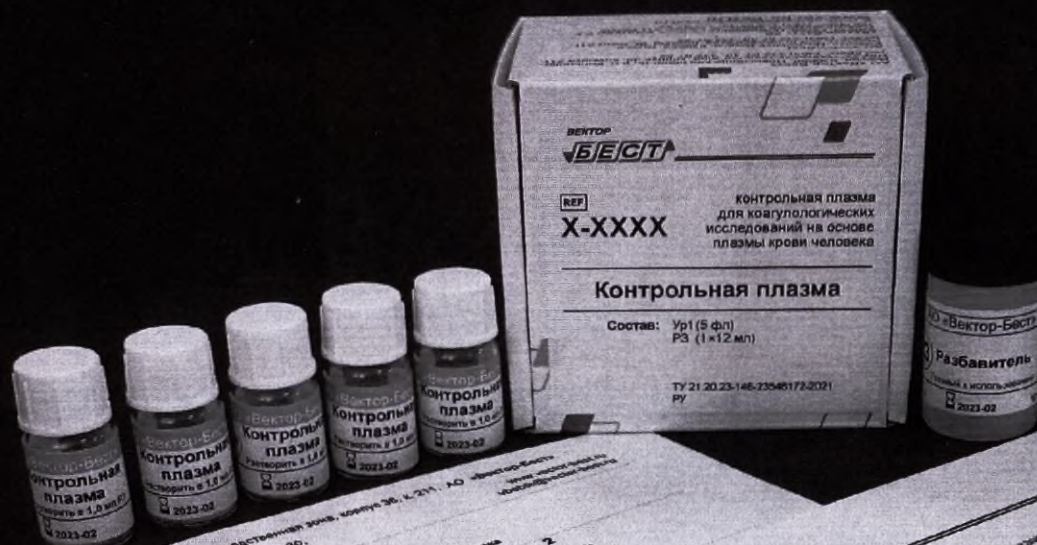

Россия, 630559, Новосибирск, а/я 482  
Для писем: 630117, г. Новосибирск, а/я 482  
Паспорт № 456-21  
Контрольная плазма  
на основе плазмы крови человека  
Применяется для коагулологических исследований на основе плазмы крови человека  
Фасовка 0,5-1,0 мл  
2023-02

Контрольная плазма для коагулологических исследований на основе плазмы крови человека  
ТУ 21.20.23-146-23548172-2021  
Хранить при температуре от 2 до 8 °С.  
Транспортируется при температуре от 2 до 8 °С.  
Допускается транспортирование при температуре до 26 °С не более 10 суток.

Состав  
Плазма контрольная (Р-Ф), серия 2  
Разбавитель (Р-Д), серия 2  
Показатель  
Растворимость лиофилизированного контрольного плазмы в разбавителе при температуре от 18 до 26 °С, мин. не более  
Фибриноген, г/л  
Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ), с  
Тромбиновое время (ТВ), с  
Протромбиновое время (ПВ), с



ИНСТРУКЦИЯ  
по применению контрольной плазмы для коагулологических исследований на основе плазмы крови человека (Контрольная плазма)

1.1. Контрольная плазма для коагулологических исследований на основе плазмы крови человека (Контрольная плазма) (Контрольная плазма) предназначена для проведения коагулологических исследований в лаборатории.

1.2. Контрольная плазма выпускается в виде раствора.

| Вариант комплектации | Объем                          |
|----------------------|--------------------------------|
| 1                    | 10 мл (0,9%)<br>1-12 мл (0,9%) |
| 2                    | 10 мл (0,9%)<br>1-12 мл (0,9%) |
| 3                    | 5 мл (0,9%)<br>1-12 мл (0,9%)  |
| 4                    | 5 мл (0,9%)<br>1-12 мл (0,9%)  |

2. ХАРАКТЕРИСТИКА КОНТРОЛЬНОЙ ПЛАЗМЫ  
2.1. Состав контрольной плазмы:  
В состав контрольной плазмы входит:  
- плазма крови человека (Контрольная плазма) (0,9%)  
- разбавитель (Р-Д) (0,9%)  
Состав контрольной плазмы (0,9%)  
1) - разбавитель - 1 флакон (12 мл).

Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия  
«Контрольная плазма для коагулологических исследований на основе плазмы крови  
человека (Контрольная плазма)» № 1 (вариант 3, серия 2)

Генеральный директор  
АО «Вектор-Бест»

Хусаинов М.Д.

2021 г.



ВЕКТОР

**БЕСТ**

REF

**X-XXXX**

контрольная плазма  
для коагулологических  
исследований на основе  
плазмы крови человека

## Контрольная плазма

Состав: Ур1 (5 фл)  
РЗ (1×12 мл)

ТУ 21.20.23-146-23548172-2021  
РУ

Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия  
«Контрольная плазма для коагулологических исследований на основе плазмы крови  
человека (Контрольная плазма)» № 2 (вариант 3, серия 2)

Генеральный директор  
АО «Вектор-Бест»

Хусаинов М.Д.

2021 г.



REF

**X-XXXX**

LOT

**2**




2021-02



2023-02

## Контрольная плазма



XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

IVD



Для профессионального применения  
Антитела к ВИЧ 1,2 и вирусу гепатита С  
и HBsAg отсутствуют

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия  
«Контрольная плазма для коагулологических исследований на основе плазмы крови  
человека (Контрольная плазма)» № 1 (вариант 3, серия 2)

Генеральный директор  
АО «Вектор-Бест»

Хусаинов М.Д.

2021 г.




Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия  
«Контрольная плазма для коагулологических исследований на основе плазмы крови  
человека (Контрольная плазма)» № 2 (вариант 3, серия 2)

Генеральный директор  
АО «Вектор-Бест»

Хусаинов М.Д.

2021 г.

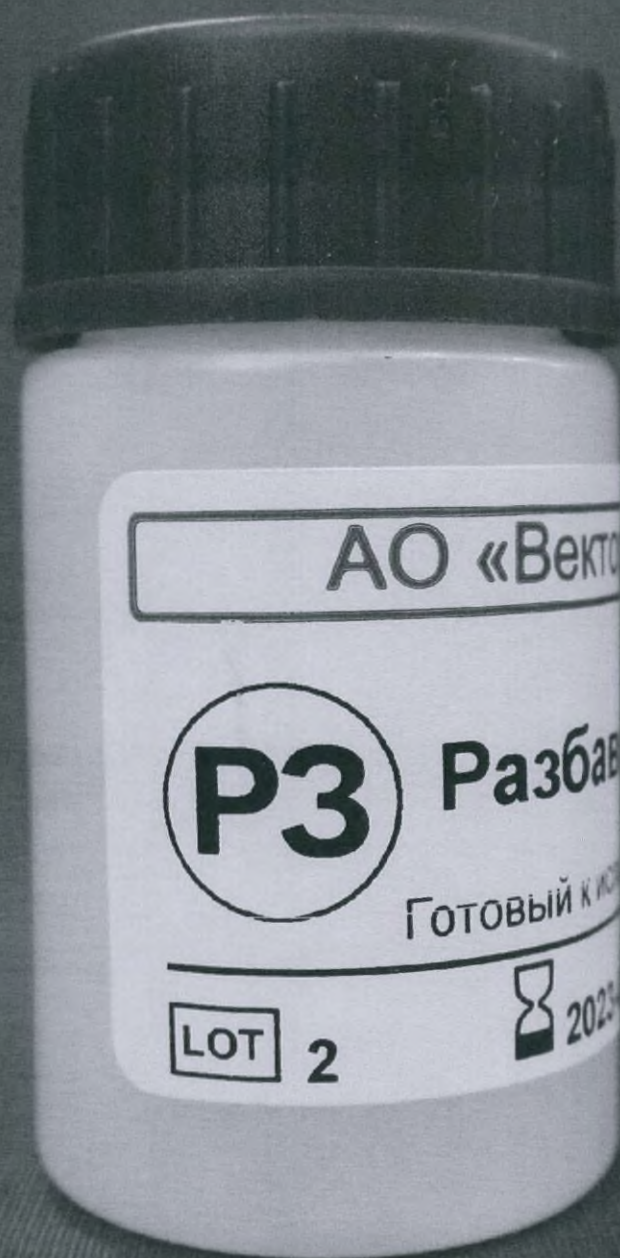

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия  
«Контрольная плазма для коагулологических исследований на основе плазмы крови  
человека (Контрольная плазма)» № 3 (вариант 3, серия 2)

Генеральный директор  
АО «Вектор-Бест»

Хусаинов М.Д.

2021 г.



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия  
«Контрольная плазма для коагулологических исследований на основе плазмы крови  
человека (Контрольная плазма)» № 4 (вариант 3, серия 2)

Генеральный директор  
АО «Вектор-Бест»

Хусаинов М.Д.


09 » 103 2021 г.



Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия  
«Контрольная плазма для коагулологических исследований на основе плазмы крови человека (Контрольная плазма)» (вариант 4, серия 1)

Генеральный директор  
АО «Вектор-Бест»

Хусаинов М.Д.  
2021 г.

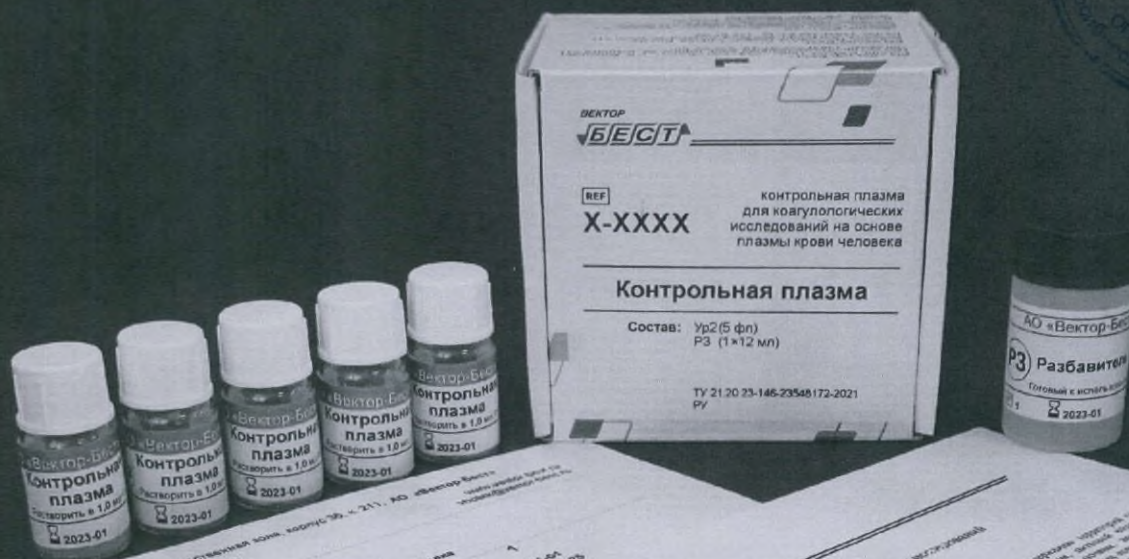

Россия, 630559, Новосибирская обл., г. Новосибирск, а/я 492  
сем: 630117, г. Новосибирск, а/я 492

ПАСПОРТ № 433-21  
Контрольная плазма  
для коагулологических исследований на основе плазмы крови человека

Примечание: тем. (20-25) до 20.  
Факс (383) 552-94-44

Хранить при температуре от 2 до 5 °С.  
Транспортировать при температуре от 2 до 5 °С.  
Допускается транспортирование при температуре до 20 °С не более 10 суток.

Состав

| Показатель                                                                                                      | Значение |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Разбавитель (РЗ), серия 1                                                                                       |          |
| Растворимость лиофилизированного контрольной плазмы в разбавителе при температуре от 18 до 20 °С, мин, не более |          |
| Фибриноген, г/л                                                                                                 |          |
| Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ), с                                                      |          |
| Тромбиновое время (ТВ), с                                                                                       |          |
| Протромбиновое время (ПВ), с                                                                                    |          |
| Протромбин по Кавку, %                                                                                          |          |

Вектор-Бест

ИНСТРУКЦИЯ  
по применению контрольной плазмы для коагулологических исследований на основе плазмы крови человека (Контрольная плазма) (вариант 4, серия 1) для исследования коагулологических показателей крови человека

1. НАЗНАЧЕНИЕ  
1.1. Контрольная плазма для коагулологических исследований на основе плазмы крови человека (Контрольная плазма) (вариант 4, серия 1) - это лиофилизированная плазма, предназначенная для проведения коагулологических исследований в лабораториях.

1.2. Контрольная плазма выпускается в виде:

| Вариант комплектации | Объем                         |
|----------------------|-------------------------------|
| 1                    | 10 г (0,9%)<br>1-12 мл (0,9%) |
| 2                    | 10 г (0,9%)<br>1-12 мл (0,9%) |
| 3                    | 5 г (0,9%)<br>1-12 мл (0,9%)  |
| 4                    | 5 г (0,9%)<br>1-12 мл (0,9%)  |

2. ХАРАКТЕРИСТИКА КОНТРОЛЬНОЙ ПЛАЗМЫ  
2.1. Состав контрольной плазмы:  
В состав контрольной плазмы входит:  
плазма крови человека (контрольная плазма) (вариант 4, серия 1) - 10 г (0,9%)  
- разбавитель (РЗ) - фактор концентрации контрольной плазмы (вариант 4, серия 1) - 10 г (0,9%)  
- контрольная плазма, уровень 1 - 10 г (0,9%)  
- разбавитель - 1 фл (12 мл)

2.2. Состав контрольной плазмы:  
В состав контрольной плазмы входит:  
плазма крови человека (контрольная плазма) (вариант 4, серия 1) - 10 г (0,9%)  
- разбавитель (РЗ) - фактор концентрации контрольной плазмы (вариант 4, серия 1) - 10 г (0,9%)  
- контрольная плазма, уровень 1 - 10 г (0,9%)  
- разбавитель - 1 фл (12 мл)

2.3. Состав контрольной плазмы:  
В состав контрольной плазмы входит:  
плазма крови человека (контрольная плазма) (вариант 4, серия 1) - 10 г (0,9%)  
- разбавитель (РЗ) - фактор концентрации контрольной плазмы (вариант 4, серия 1) - 10 г (0,9%)  
- контрольная плазма, уровень 1 - 10 г (0,9%)  
- разбавитель - 1 фл (12 мл)

2.4. Состав контрольной плазмы:  
В состав контрольной плазмы входит:  
плазма крови человека (контрольная плазма) (вариант 4, серия 1) - 10 г (0,9%)  
- разбавитель (РЗ) - фактор концентрации контрольной плазмы (вариант 4, серия 1) - 10 г (0,9%)  
- контрольная плазма, уровень 1 - 10 г (0,9%)  
- разбавитель - 1 фл (12 мл)

Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия  
«Контрольная плазма для коагулологических исследований на основе плазмы крови  
человека (Контрольная плазма)» № 1 (вариант 4, серия 1)

Генеральный директор  
АО «Вектор-Бест»

Хусаинов М.Д.

2021 г.



ВЕКТОР

**БЕСТ**

REF

**X-XXXX**


контрольная плазма  
для коагулологических  
исследований на основе  
плазмы крови человека

## Контрольная плазма

Состав: Ур2 (5 фл)  
РЗ (1×12 мл)

ТУ 21.20.23-146-23548172-2021  
РУ

« 09 » 103 2021 г.

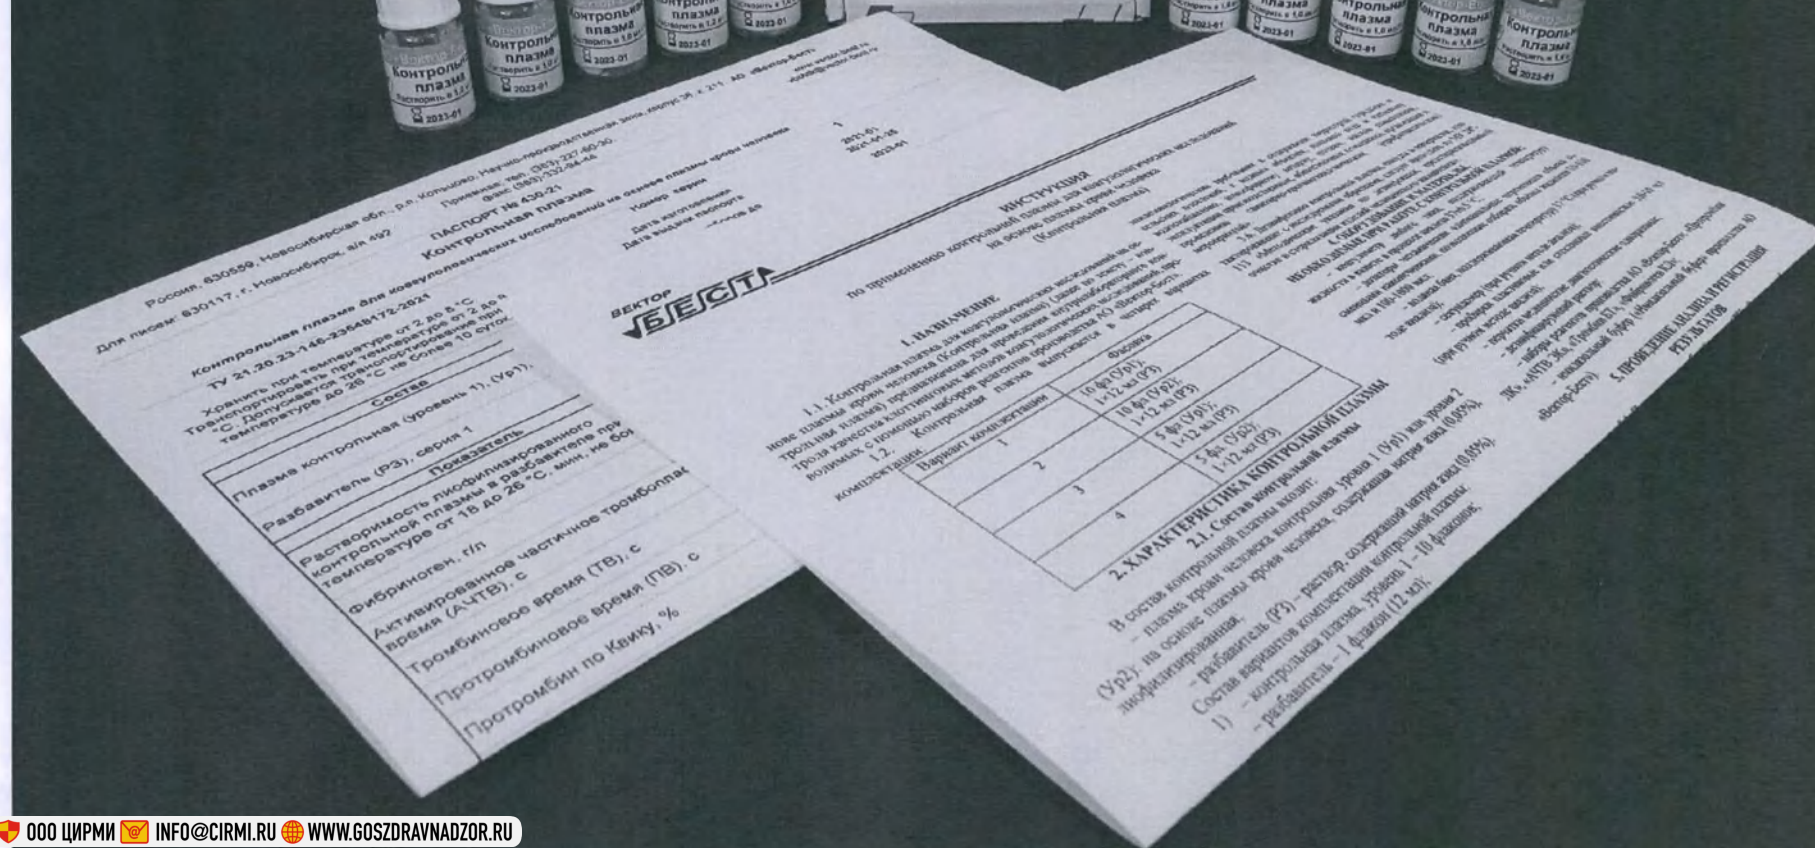

Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия  
«Контрольная плазма для коагулологических исследований на основе плазмы крови  
человека (Контрольная плазма)» № 1 (вариант 1, серия 1)

Генеральный директор  
АО «Вектор-Бест»

Хусаинов М.Д.

2021 г.



ВЕКТОР

**БЕСТ**

REF

**X-XXXX**

контрольная плазма  
для коагулологических  
исследований на основе  
плазмы крови человека

## Контрольная плазма

Состав: Ур1 (10 фл)  
РЗ (1×12 мл)

ТУ 21.20.23-146-23548172-2021  
РУ

Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия  
«Контрольная плазма для коагулологических исследований на основе плазмы крови  
человека (Контрольная плазма)» № 2 (вариант 1, серия 1)

Генеральный директор  
АО «Вектор-Бест»

Хусаинов М.Д.

«09» 103 2021 г.

REF

X-XXXX

LOT

1



2021-01



2023-01

**Контрольная плазма**



XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

IVD



Для профессионального применения  
Антитела к ВИЧ 1,2 и вирусу гепатита С  
и HBsAg отсутствуют

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия  
«Контрольная плазма для коагулологических исследований на основе плазмы крови  
человека (Контрольная плазма)» № 1 (вариант 1, серия 1)

Генеральный директор  
АО «Вектор-Бест»

Хусаинов М.Д.

2021 г.




Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия  
«Контрольная плазма для коагулологических исследований на основе плазмы крови  
человека (Контрольная плазма)» № 2 (вариант 1, серия 1)

Генеральный директор  
АО «Вектор-Бест»

Хусаинов М.Д.





2021 г.

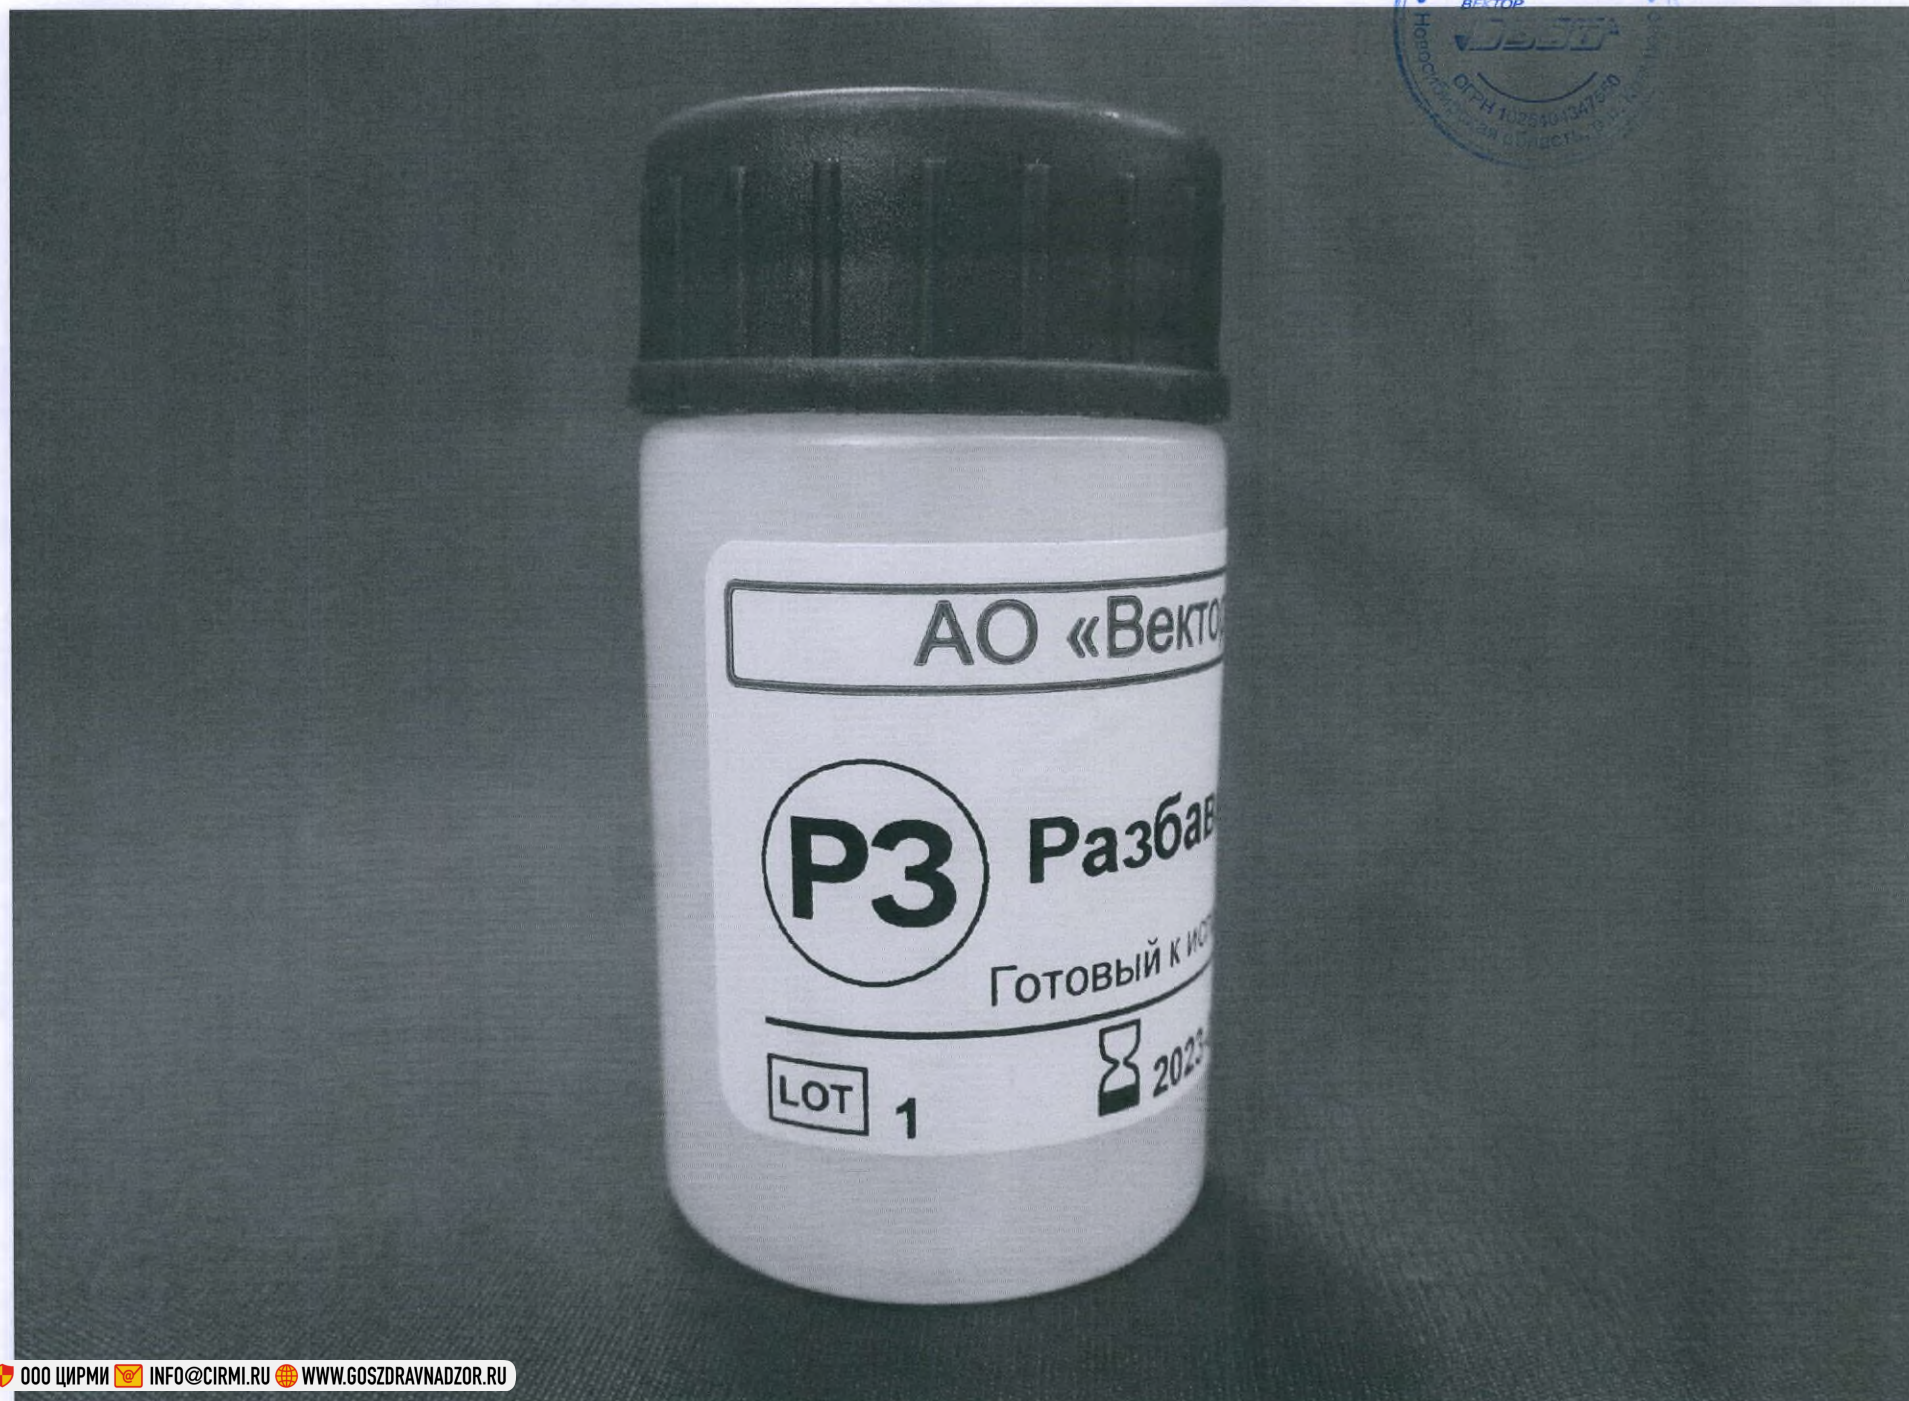

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия  
«Контрольная плазма для коагулологических исследований на основе плазмы крови  
человека (Контрольная плазма)» № 3 (вариант 1, серия 1)

Генеральный директор Хусаинов М.Д.  
АО «Вектор-Бест» «09» 03 2021 г.

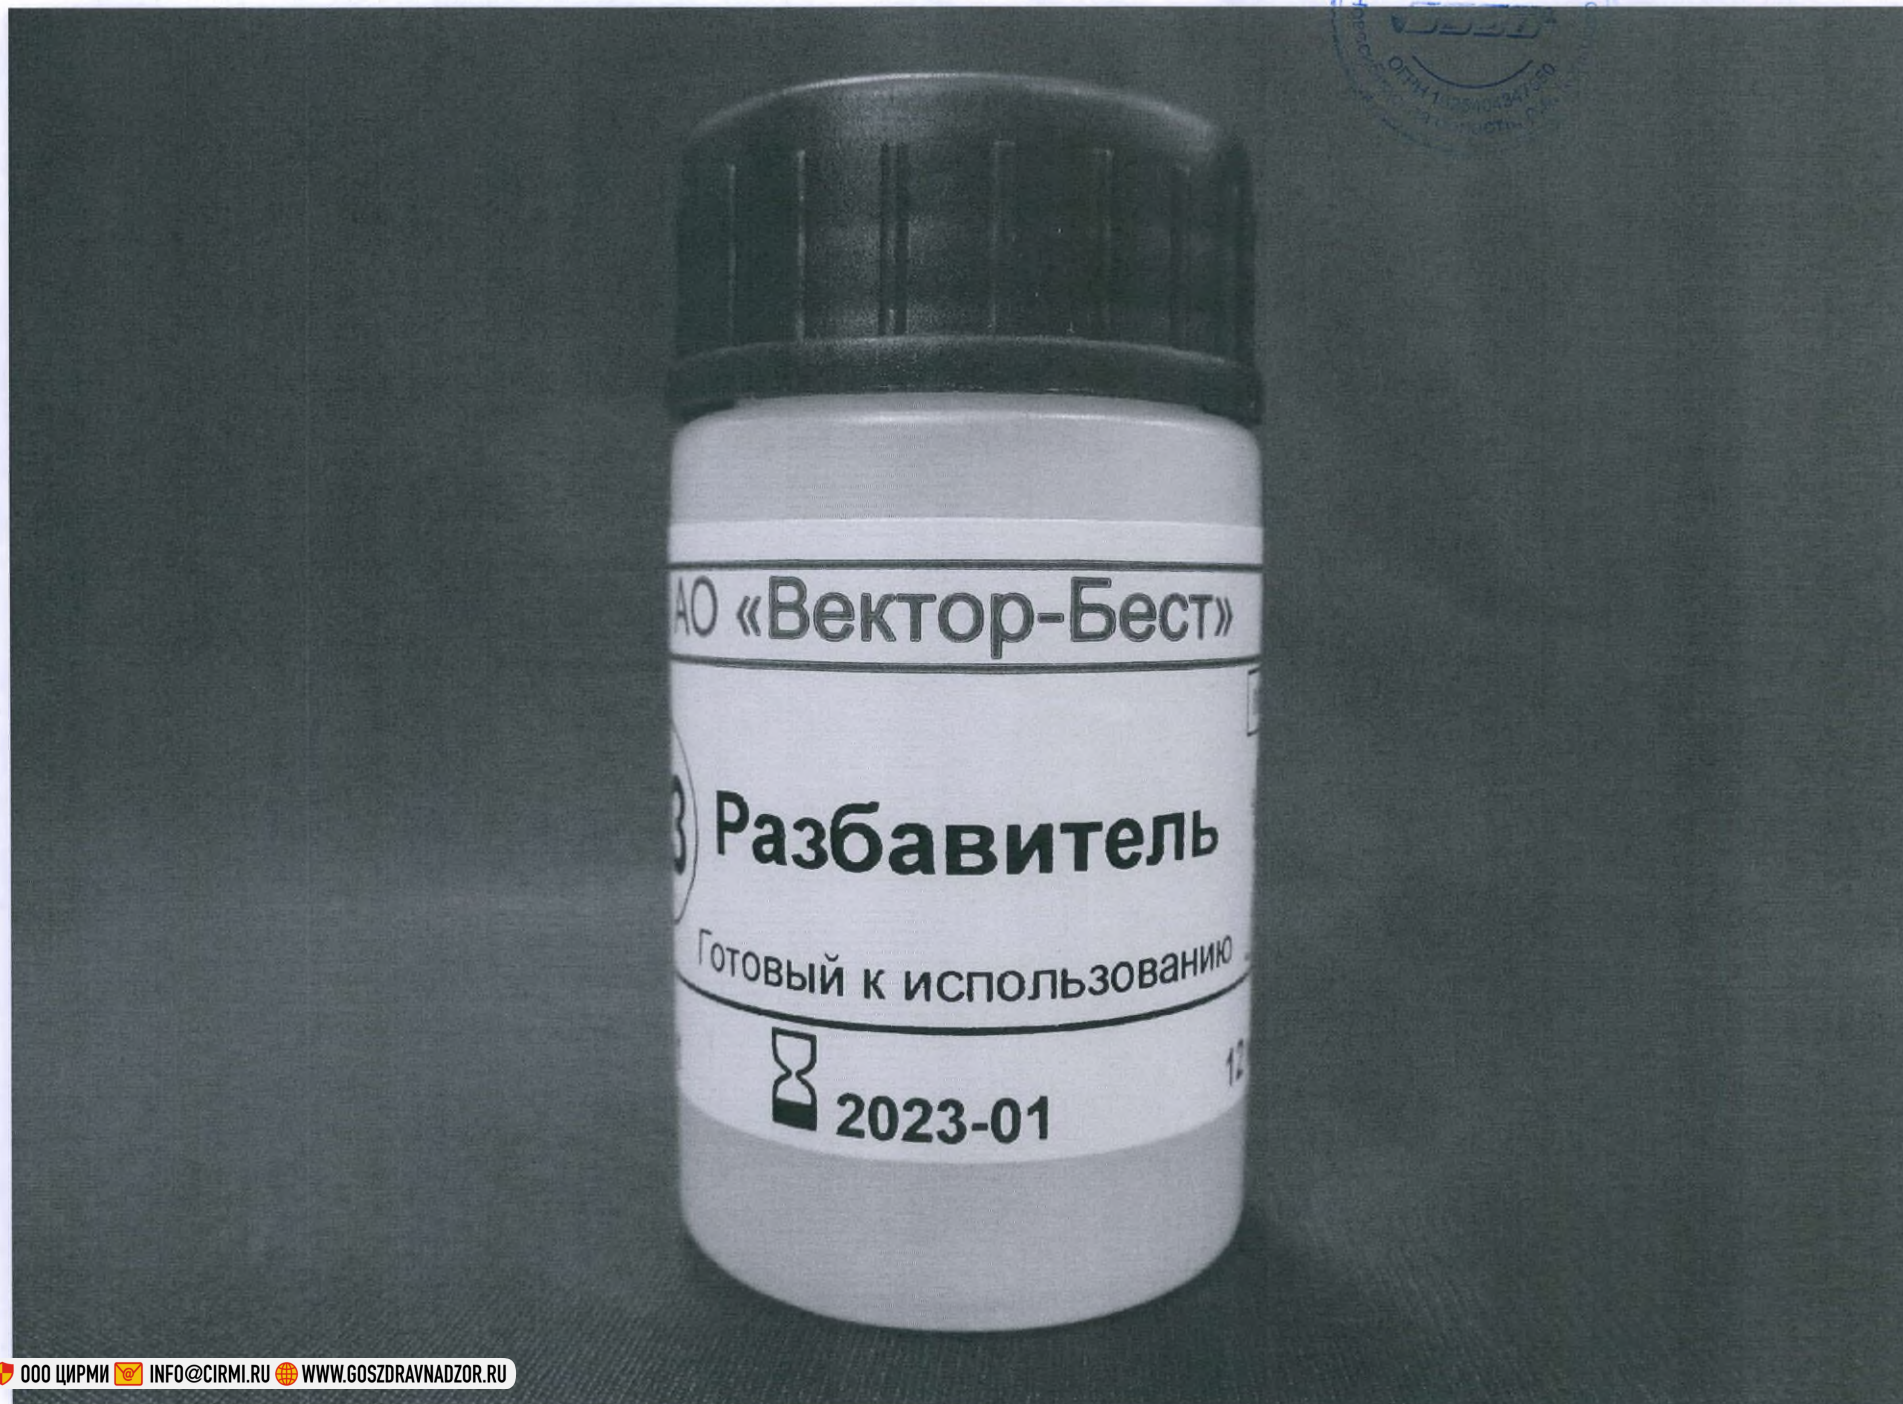

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия  
«Контрольная плазма для коагулологических исследований на основе плазмы крови  
человека (Контрольная плазма)» № 4 (вариант 1, серия 1)

Генеральный директор, Хусаинов М.Д.  
АО «Вектор-Бест» 09 103 2021 г.



Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия  
«Контрольная плазма для коагулологических исследований на основе плазмы крови человека (Контрольная плазма)» (вариант 1, серия 2)


Генеральный директор  
АО «Вектор-Бест»

Хусанов

«09»

03

ВЕКТОР

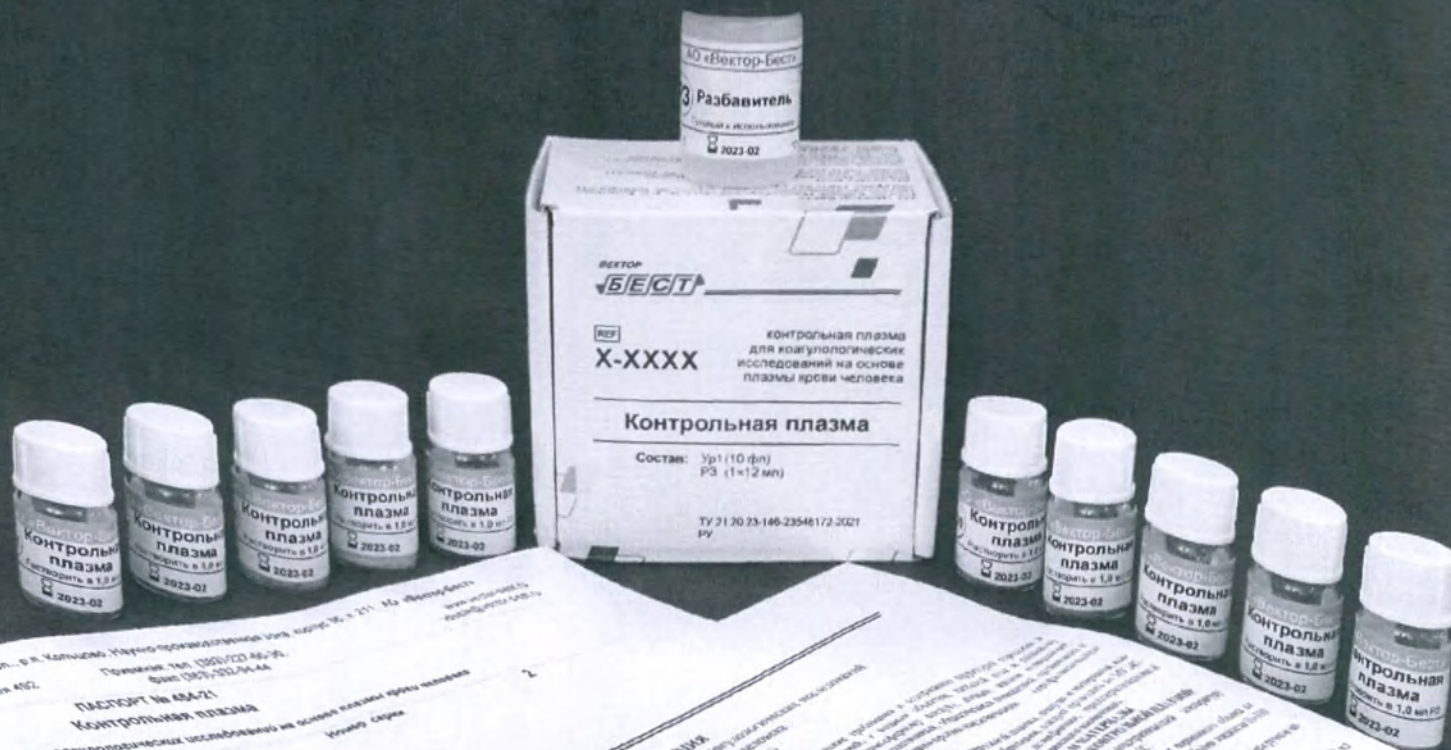

Росздравнадзор, Московская обл., г.п.г. Чеховский, Народно-промышленный парк, корпус 3, п. 111, АО «Вектор-Бест»  
Правление тел. (3506) 03 46-04  
Факс (3506) 03 44-44  
Дир. филиала: 8200177, г. Чеховский, ул. 452  
ПАСПОРТ № 64475  
Контрольная плазма  
Уникальная серия

Контрольная плазма для коагулологических исследований на основе плазмы крови человека  
ТУ 21 20 23-146-23546172-2021

Хранить при температуре  
Транспортировать при t  
Доставлять транспортным  
до 25°С не более

| Срок                      | Срок |
|---------------------------|------|
| Плазма контрольная (ур1)  | Срок |
| Разбавитель (Р3), серия 2 | Срок |
| Разбавительность плазмы   | Срок |
| плазмы в разбавителе при  | Срок |
| 25°С, мин. не более       | Срок |
| Разбавитель, мл           | Срок |
| Активированный частично   | Срок |
| фибриноген (АУТФ), с      | Срок |
| Фибриноген, время (ПФ)    | Срок |
| Протромбиновое время (П   | Срок |
| протромбин по Калку, %    | Срок |

ВЕКТОР  
БЕСТ

по применению контрольной плазмы для коагулологических исследований на основе плазмы крови человека  
(Контрольная плазма)

| 1. НАИМЕНОВАНИЕ                                                                                                            | 2. КОМПОНЕНТЫ | 3. КОМПОНЕНТЫ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 1.1. Контрольная плазма для коагулологических исследований на основе плазмы крови человека (Контрольная плазма) (серия 2)  | 10 фл (10 мл) | 10 фл (10 мл) |
| 1.2. Контрольная плазма для коагулологических исследований на основе плазмы крови человека (Контрольная плазма) (серия 2)  | 10 фл (10 мл) | 10 фл (10 мл) |
| 1.3. Контрольная плазма для коагулологических исследований на основе плазмы крови человека (Контрольная плазма) (серия 2)  | 10 фл (10 мл) | 10 фл (10 мл) |
| 1.4. Контрольная плазма для коагулологических исследований на основе плазмы крови человека (Контрольная плазма) (серия 2)  | 10 фл (10 мл) | 10 фл (10 мл) |
| 1.5. Контрольная плазма для коагулологических исследований на основе плазмы крови человека (Контрольная плазма) (серия 2)  | 10 фл (10 мл) | 10 фл (10 мл) |
| 1.6. Контрольная плазма для коагулологических исследований на основе плазмы крови человека (Контрольная плазма) (серия 2)  | 10 фл (10 мл) | 10 фл (10 мл) |
| 1.7. Контрольная плазма для коагулологических исследований на основе плазмы крови человека (Контрольная плазма) (серия 2)  | 10 фл (10 мл) | 10 фл (10 мл) |
| 1.8. Контрольная плазма для коагулологических исследований на основе плазмы крови человека (Контрольная плазма) (серия 2)  | 10 фл (10 мл) | 10 фл (10 мл) |
| 1.9. Контрольная плазма для коагулологических исследований на основе плазмы крови человека (Контрольная плазма) (серия 2)  | 10 фл (10 мл) | 10 фл (10 мл) |
| 1.10. Контрольная плазма для коагулологических исследований на основе плазмы крови человека (Контрольная плазма) (серия 2) | 10 фл (10 мл) | 10 фл (10 мл) |

2. ХАРАКТЕРИСТИКА КОНТРОЛЬНОЙ ПЛАЗМЫ  
2.1. Состав контрольной плазмы  
2.2. Состав контрольной плазмы  
2.3. Состав контрольной плазмы  
2.4. Состав контрольной плазмы  
2.5. Состав контрольной плазмы  
2.6. Состав контрольной плазмы  
2.7. Состав контрольной плазмы  
2.8. Состав контрольной плазмы  
2.9. Состав контрольной плазмы  
2.10. Состав контрольной плазмы

3. ХАРАКТЕРИСТИКА КОНТРОЛЬНОЙ ПЛАЗМЫ  
3.1. Состав контрольной плазмы  
3.2. Состав контрольной плазмы  
3.3. Состав контрольной плазмы  
3.4. Состав контрольной плазмы  
3.5. Состав контрольной плазмы  
3.6. Состав контрольной плазмы  
3.7. Состав контрольной плазмы  
3.8. Состав контрольной плазмы  
3.9. Состав контрольной плазмы  
3.10. Состав контрольной плазмы

Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия  
«Контрольная плазма для коагулологических исследований на основе плазмы крови  
человека (Контрольная плазма)» № 1 (вариант 1, серия 2)

Генеральный директор  
АО «Вектор-Бест»

Хусаинов М.Д.

«04» 103 2021 г.



ВЕКТОР  
**БЕСТ**

REF

**X-XXXX**

контрольная плазма  
для коагулологических  
исследований на основе  
плазмы крови человека

**Контрольная плазма**

Состав: Ур1 (10 фл)  
РЗ (1×12 мл)

ТУ 21.20.23-146-23548172-2021  
РУ

REF

X-XXXX

LOT

2



2021-02



2023-02

## Контрольная плазма



XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

IVD



Для профессионального применения  
Антитела к ВИЧ 1,2 и вирусу гепатита С  
и HBsAg отсутствуют

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия  
«Контрольная плазма для коагулологических исследований на основе плазмы крови  
человека (Контрольная плазма)» № 1 (вариант 1, серия 2)

Генеральный директор  
АО «Вектор-Бест» Хусаинов М.Д.  
03 2021 г.




Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия  
«Контрольная плазма для коагулологических исследований на основе плазмы крови  
человека (Контрольная плазма)» № 2 (вариант 1, серия 2)

Генеральный директор  
АО «Вектор-Бест»

Хусаинов М.Д.

03 2021 г.

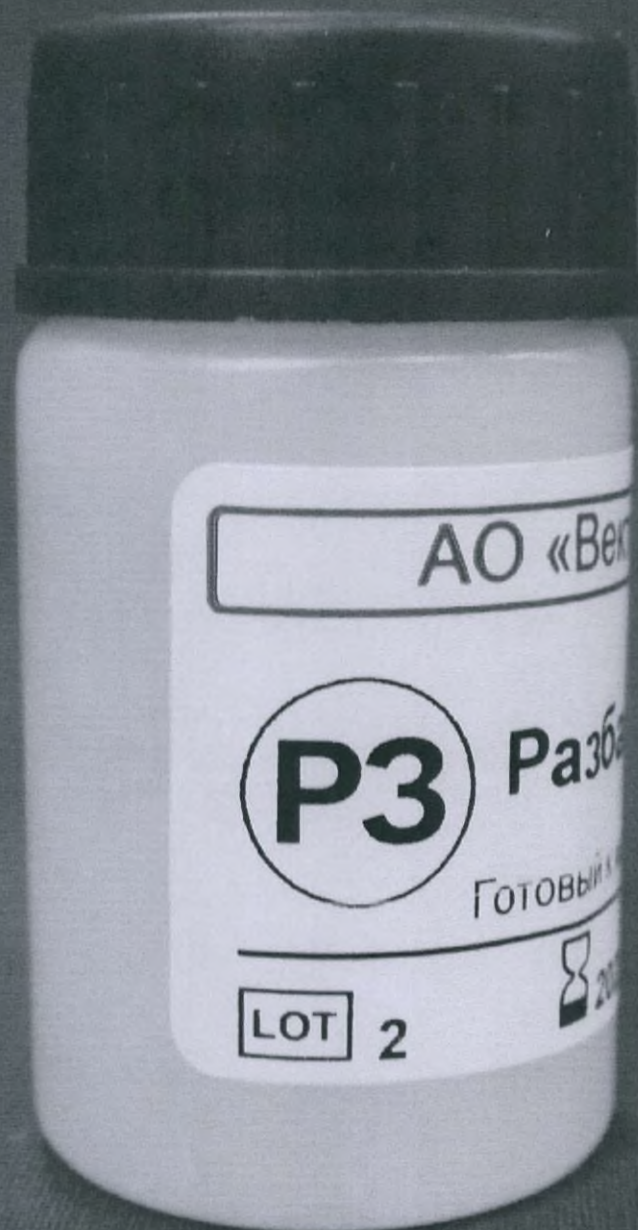


Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия  
«Контрольная плазма для коагулологических исследований на основе плазмы крови  
человека (Контрольная плазма)» № 3 (вариант 1, серия 2)

Генеральный директор  
АО «Вектор-Бест»



Хусаинов М.Д.  
2021 г.

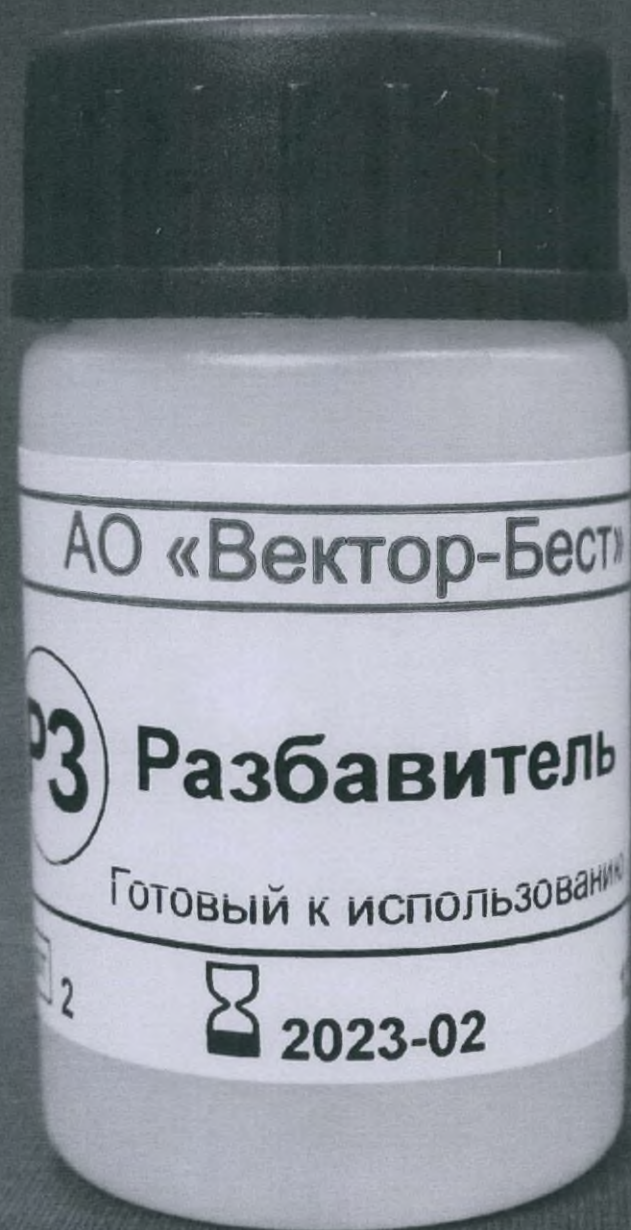

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия  
«Контрольная плазма для коагулологических исследований на основе плазмы крови  
человека (Контрольная плазма)» № 4 (вариант 1, серия 2)

Генеральный директор Хусаинов М.Д.  
АО «Вектор-Бест» «09» 103 2021 г.




Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия  
«Контрольная плазма для коагулологических исследований на основе плазмы крови человека (Контрольная плазма)» (вариант 2, серия 1)

Генеральный директор  
АО «Вектор-Бест»

Хусаинов М.Д.

2021 г.

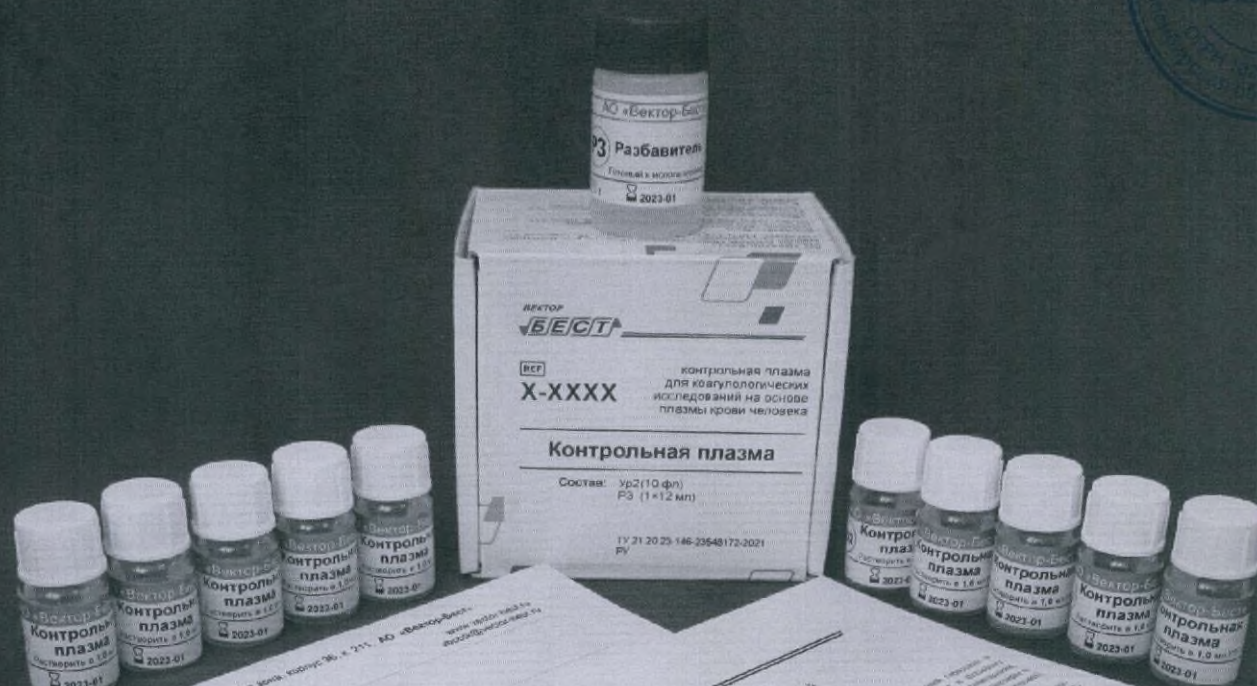

Для писем: 630569, Новосибирская обл., р.п. Колывань, Народно-просветительская зона, корпус 36, п. 211, АО «Вектор-Бест»  
Приемная тел: (383) 221-455-50  
Факс: (383) 392-34-44

Россия, 630569, Новосибирская обл., р.п. Колывань, Народно-просветительская зона, корпус 36, п. 211, АО «Вектор-Бест»

ПАСПОРТ № 431-21  
Контрольная плазма  
Номер, серия

по применению контрольной плазмы для коагулологических исследований на основе плазмы крови человека (Контрольная плазма)

**1. НАЗНАЧЕНИЕ.**  
1.1. Контрольная плазма для коагулологических исследований на основе плазмы крови человека (Контрольная плазма) (далее по тексту - контрольная плазма) предназначена для проведения внутрилабораторных исследований с целью контроля качества результатов исследований при применении контрольной плазмы.

| Параметр   | 1           | 2           | 3           | 4           |
|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Плотность  | 1,020 (Ур2) | 1,020 (Ур2) | 1,020 (Ур2) | 1,020 (Ур2) |
| Вязкость   | 1,12 мПа·с  | 1,12 мПа·с  | 1,12 мПа·с  | 1,12 мПа·с  |
| Активность | 5,49 (Ур1)  | 5,49 (Ур1)  | 5,49 (Ур1)  | 5,49 (Ур1)  |
| Активность | 1,12 мПа·с  | 1,12 мПа·с  | 1,12 мПа·с  | 1,12 мПа·с  |

**2. ХАРАКТЕРИСТИКА КОНТРОЛЬНОЙ ПЛАЗМЫ**  
2.1. Состав контрольной плазмы:  
- плазма крови человека (контрольная плазма) (Ур2) или (Ур1) или (Ур2) или (Ур1)  
- разбавитель (P3) - раствор, содержащий натрий хлорид (NaCl) и калий хлорид (KCl) в соотношении 1:1 (Ур2) или (Ур1) или (Ур2) или (Ур1)  
- контрольная плазма (Ур2) или (Ур1) или (Ур2) или (Ур1)  
- разбавитель (P3) - раствор, содержащий натрий хлорид (NaCl) и калий хлорид (KCl) в соотношении 1:1 (Ур2) или (Ур1) или (Ур2) или (Ур1)

4. ПРОЦЕДУРА ПРИМЕНЕНИЯ

Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия  
«Контрольная плазма для коагулологических исследований на основе плазмы крови  
человека (Контрольная плазма)» № 1 (вариант 2, серия 1)

Генеральный директор  
АО «Вектор-Бест»

Хусаинов М.Д.  
03 2021 г.



ВЕКТОР  
**БЕСТ**

REF

**X-XXXX**

контрольная плазма  
для коагулологических  
исследований на основе  
плазмы крови человека

## Контрольная плазма

Состав: Ур2(10 фл)  
РЗ (1×12 мл)

ТУ 21.20.23-146-23548172-2021  
РУ

Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия  
«Контрольная плазма для коагулологических исследований на основе плазмы крови  
человека (Контрольная плазма)» № 2 (вариант 2, серия 1)

Генеральный директор  
АО «Вектор-Бест»

Хусаинов М.Д.

2021 г.



REF

X-XXXX

LOT

1




2021-01



2023-01

## Контрольная плазма



XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

IVD



Для профессионального применения  
Антитела к ВИЧ 1,2 и вирусу гепатита С  
и HBsAg отсутствуют

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия  
«Контрольная плазма для коагулологических исследований на основе плазмы крови  
человека (Контрольная плазма)» № 1 (вариант 2, серия 1)

Генеральный директор  
АО «Вектор-Бест»


Хусаинов М.Д.

2021 г.



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия  
«Контрольная плазма для коагулологических исследований на основе плазмы крови  
человека (Контрольная плазма)» № 2 (вариант 2, серия 1)

Генеральный директор  
АО «Вектор-Бест» Хусаинов М.Д.  
«04» 03 2021 г.

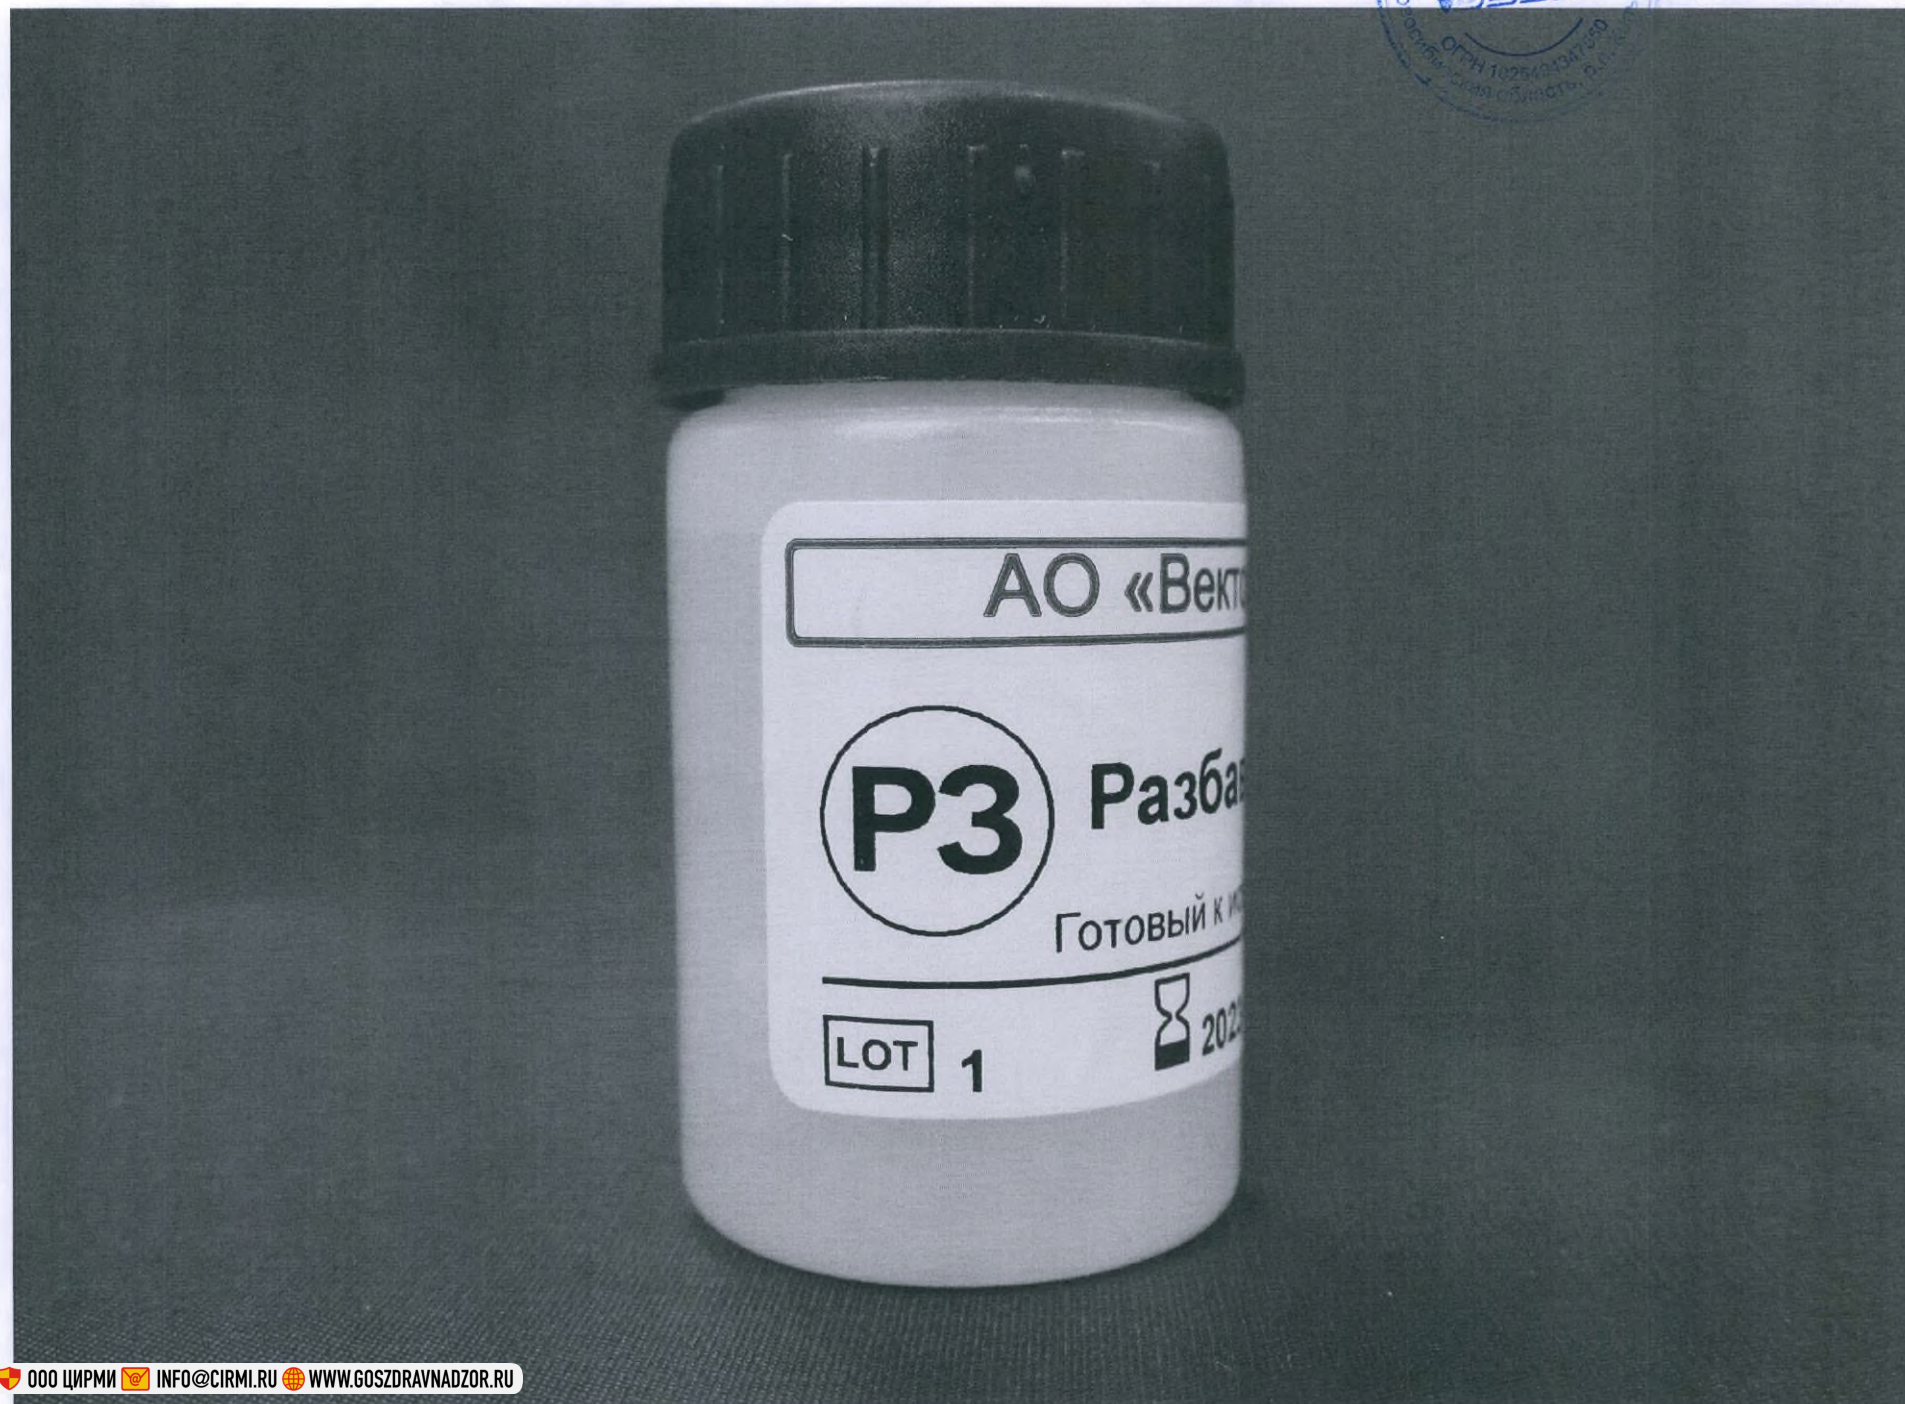


Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия  
«Контрольная плазма для коагулологических исследований на основе плазмы крови  
человека (Контрольная плазма)» № 3 (вариант 2, серия 1)

Генеральный директор  
АО «Вектор-Бест»

Хусаинов М.Д.

2021 г.

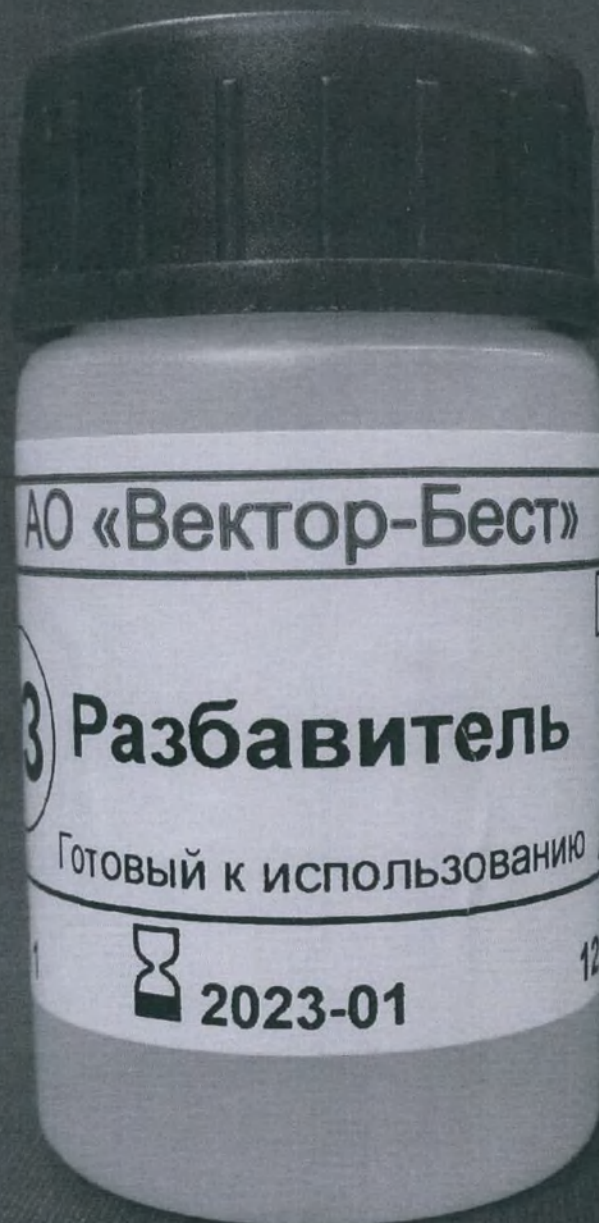

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия  
«Контрольная плазма для коагулологических исследований на основе плазмы крови  
человека (Контрольная плазма)» № 4 (вариант 2, серия 1)

Генеральный директор  
АО «Вектор-Бест»




Гусинов М.Д.  
03 2021 г.



Генеральный директор  
АО «Вектор-Бест» Хусаинов М.Д.

Генеральный директор  
АО «Вектор-Бест» \_\_\_\_\_ Хусаинов М.Д.  
«09» \_\_\_\_\_ 2021 г.

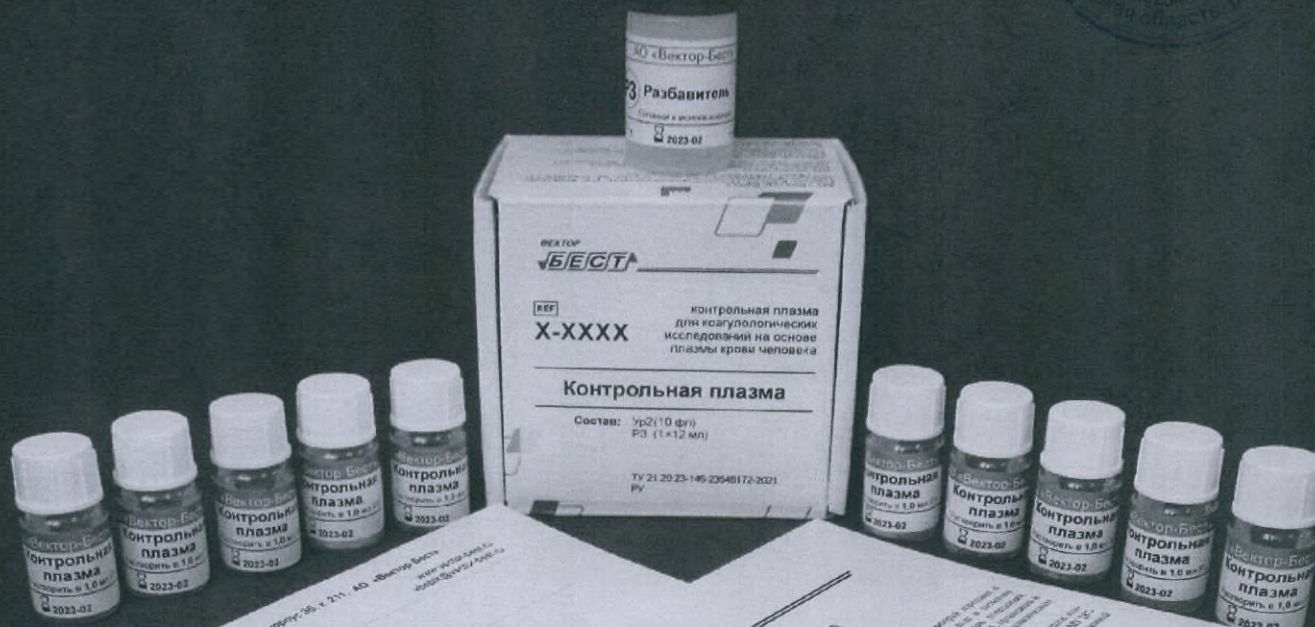

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

АО «Вектор-Бест»

М.Д. Хусаинов





2022 г.



Образцы маркировки на Контрольную плазму для коагулологических исследований на основе плазмы крови человека (Контрольная плазма)

1. Образцы этикеток на флаконы набора «Контрольная плазма»

| Наименование компонента                      | Этикетка |
|----------------------------------------------|----------|
| «Контрольная плазма», вариант комплектации 1 |          |
| Плазма контрольная<br>(уровень 1)            |          |
| Разбавитель                                  |          |
| «Контрольная плазма», вариант комплектации 2 |          |
| Плазма контрольная<br>(уровень 2)            |          |
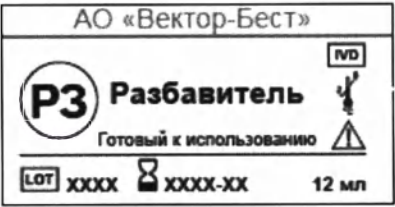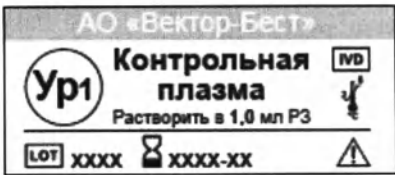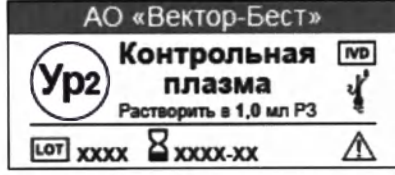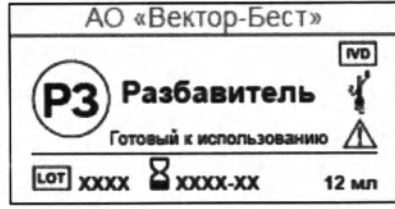
|                                              |                                                                                      |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Разбавитель                                  |    |
| «Контрольная плазма», вариант комплектации 3 |                                                                                      |
| Плазма контрольная (уровень 1)               |    |
| Разбавитель                                  |   |
| «Контрольная плазма», вариант комплектации 4 |                                                                                      |
| Плазма контрольная (уровень 2)               |  |
| Разбавитель                                  |  |

## 2. Образцы этикеток на коробке набора «Контрольная плазма»

### 2.1. Верхняя этикетка.

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Вариант комплектации 1 | <div><div><div>REF</div><div><b>X-XXXX</b></div></div><div>контрольная плазма<br/>для коагулологических<br/>исследований на основе<br/>плазмы крови человека</div></div> <div><b>Контрольная плазма</b></div> <div>Состав: Ур1 (10 фл)<br/>РЗ (1×12 мл)</div> <div>ТУ 21.20.23-146-23548172-2021<br/>РУ</div> |
| Вариант комплектации 2 | <div><div><div>REF</div><div><b>X-XXXX</b></div></div><div>контрольная плазма<br/>для коагулологических<br/>исследований на основе<br/>плазмы крови человека</div></div> <div><b>Контрольная плазма</b></div> <div>Состав: Ур2 (10 фл)<br/>РЗ (1×12 мл)</div> <div>ТУ 21.20.23-146-23548172-2021<br/>РУ</div> |
| Вариант комплектации 3 | <div><div><div>REF</div><div><b>X-XXXX</b></div></div><div>контрольная плазма<br/>для коагулологических<br/>исследований на основе<br/>плазмы крови человека</div></div> <div><b>Контрольная плазма</b></div> <div>Состав: Ур1 (5 фл)<br/>РЗ (1×12 мл)</div> <div>ТУ 21.20.23-146-23548172-2021<br/>РУ</div>  |

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Вариант комплектации 4</p> | <div data-bbox="760 126 1356 598"> <div> <div>REF</div> <div>X-XXXX</div> </div> <div> <div>контрольная плазма<br/>для коагулологических<br/>исследований на основе<br/>плазмы крови человека</div> </div> <hr/> <div>Контрольная плазма</div> <hr/> <div> <div>Состав:</div> <div>Ур2(5 фл)<br/>РЗ (1×12 мл)</div> </div> <div> <div>ТУ 21.20.23-146-23548172-2021</div> <div>РУ</div> </div> </div> |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 2.2. Боковая этикетка.

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Вариант комплектации 1</p> | <div data-bbox="802 869 1315 1299"> <div> <div>REF</div> <div>X-XXXX</div> </div> <div> <div>LOT XXXX</div> <div>XXXX-XX</div> <div>XXXX-XX</div> </div> <hr/> <div>Контрольная плазма</div> <hr/> <div> <div> <div> <div>IVD</div> <div>  </div> </div> <div> <div>  </div> </div> </div> <div> <div>Для профессионального применения</div> <div>Антитела к ВИЧ 1,2 и вирусу гепатита С</div> <div>и HBsAg отсутствуют</div> </div> </div> </div>  |
| <p>Вариант комплектации 2</p> | <div data-bbox="802 1469 1315 1900"> <div> <div>REF</div> <div>X-XXXX</div> </div> <div> <div>LOT XXXX</div> <div>XXXX-XX</div> <div>XXXX-XX</div> </div> <hr/> <div>Контрольная плазма</div> <hr/> <div> <div> <div> <div>IVD</div> <div>  </div> </div> <div> <div>  </div> </div> </div> <div> <div>Для профессионального применения</div> <div>Антитела к ВИЧ 1,2 и вирусу гепатита С</div> <div>и HBsAg отсутствуют</div> </div> </div> </div> |

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Вариант комплектации 3</p> | <div data-bbox="799 144 1315 576"> <div> <div>REF</div> <div>LOT</div> <div>XXXX</div> </div> <div> <div>X-XXXX</div> <div>XXXX-XX</div> <div>XXXX-XX</div> </div> <div> <div>Контрольная плазма</div> <div> <div> <div>IVD</div> <div>!</div> </div> <div> <div>XXXXXX-XXXXXX-XXXXXX</div> <div>XXXXXX-XXXXXX-XXXXXX</div> </div> </div> <div> <div>Для профессионального применения</div> <div>Антитела к ВИЧ 1,2 и вирусу гепатита С</div> <div>и HBsAg отсутствуют</div> </div> </div> </div>  |
| <p>Вариант комплектации 4</p> | <div data-bbox="799 663 1315 1096"> <div> <div>REF</div> <div>LOT</div> <div>XXXX</div> </div> <div> <div>X-XXXX</div> <div>XXXX-XX</div> <div>XXXX-XX</div> </div> <div> <div>Контрольная плазма</div> <div> <div> <div>IVD</div> <div>!</div> </div> <div> <div>XXXXXX-XXXXXX-XXXXXX</div> <div>XXXXXX-XXXXXX-XXXXXX</div> </div> </div> <div> <div>Для профессионального применения</div> <div>Антитела к ВИЧ 1,2 и вирусу гепатита С</div> <div>и HBsAg отсутствуют</div> </div> </div> </div> |

Примечание. Непосредственно на коробку типографским способом наносятся следующие надписи:

АО «Вектор-Бест»  
Россия, 630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово,  
Научно-производственная зона, корпус 36, комната 211,  
тел./факс: (383) 332-67-49, 332-67-52

AO Vector-Best  
Koltsovo, Novosibirsk Region, 630559, Russia,  
Research and Production Area, housing 36, room 211,  
tel./fax: (383) 332-67-49, 332-67-52

«Вектор-Бест» АҚ  
630559, Ресей, Новосибирск облысы, Кольцово ж.к.  
Ғылыми-өндірістік аймақ, 36 корпус, 211 бөлме  
тел./факс: (383) 332-67-49, 332-67-52

E-mail: [vbmarket@vector-best.ru](mailto:vbmarket@vector-best.ru)  
[www.vector-best.ru](http://www.vector-best.ru)

«СОГЛАСОВАНО»

Директор по производству  
АО «Вектор-Бест»

В.К. Ткачев

«22» февраля 2022 г.

Всего прошито, пронумеровано и  
скреплено печатью 5 листов.

Директор по технологии и качеству

АО "Вектор-Бест"

Масяго А.В.

20 dd г.



*[Handwritten signature]*