

Фотографические изображения
медицинского изделия

***Комплекс комбинированный для получения медицинских изображений методом ПЭТ/КТ с принадлежностями, варианты исполнения
Discovery MI Gen2: с шириной ПЭТ детектора: 15, 20, 25 см.***

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель отдела регистрации

и сертификации России и СНГ

ООО «ДжиИ Хэлскеа»

"ДжиИ Хэлскеа"

LLC GE Healthcare

 Харитонов А. П.

« 20 » декабря 20 21 г.




Общий вид комплекса Discovery MI Gen2




**I. Комплекс комбинированный для получения медицинских изображений
методом ПЭТ/КТ, варианты исполнения Discovery MI Gen2: с шириной
ПЭТ детектора: 15, 20, 25 см:**

1. Генри ПЭТ.

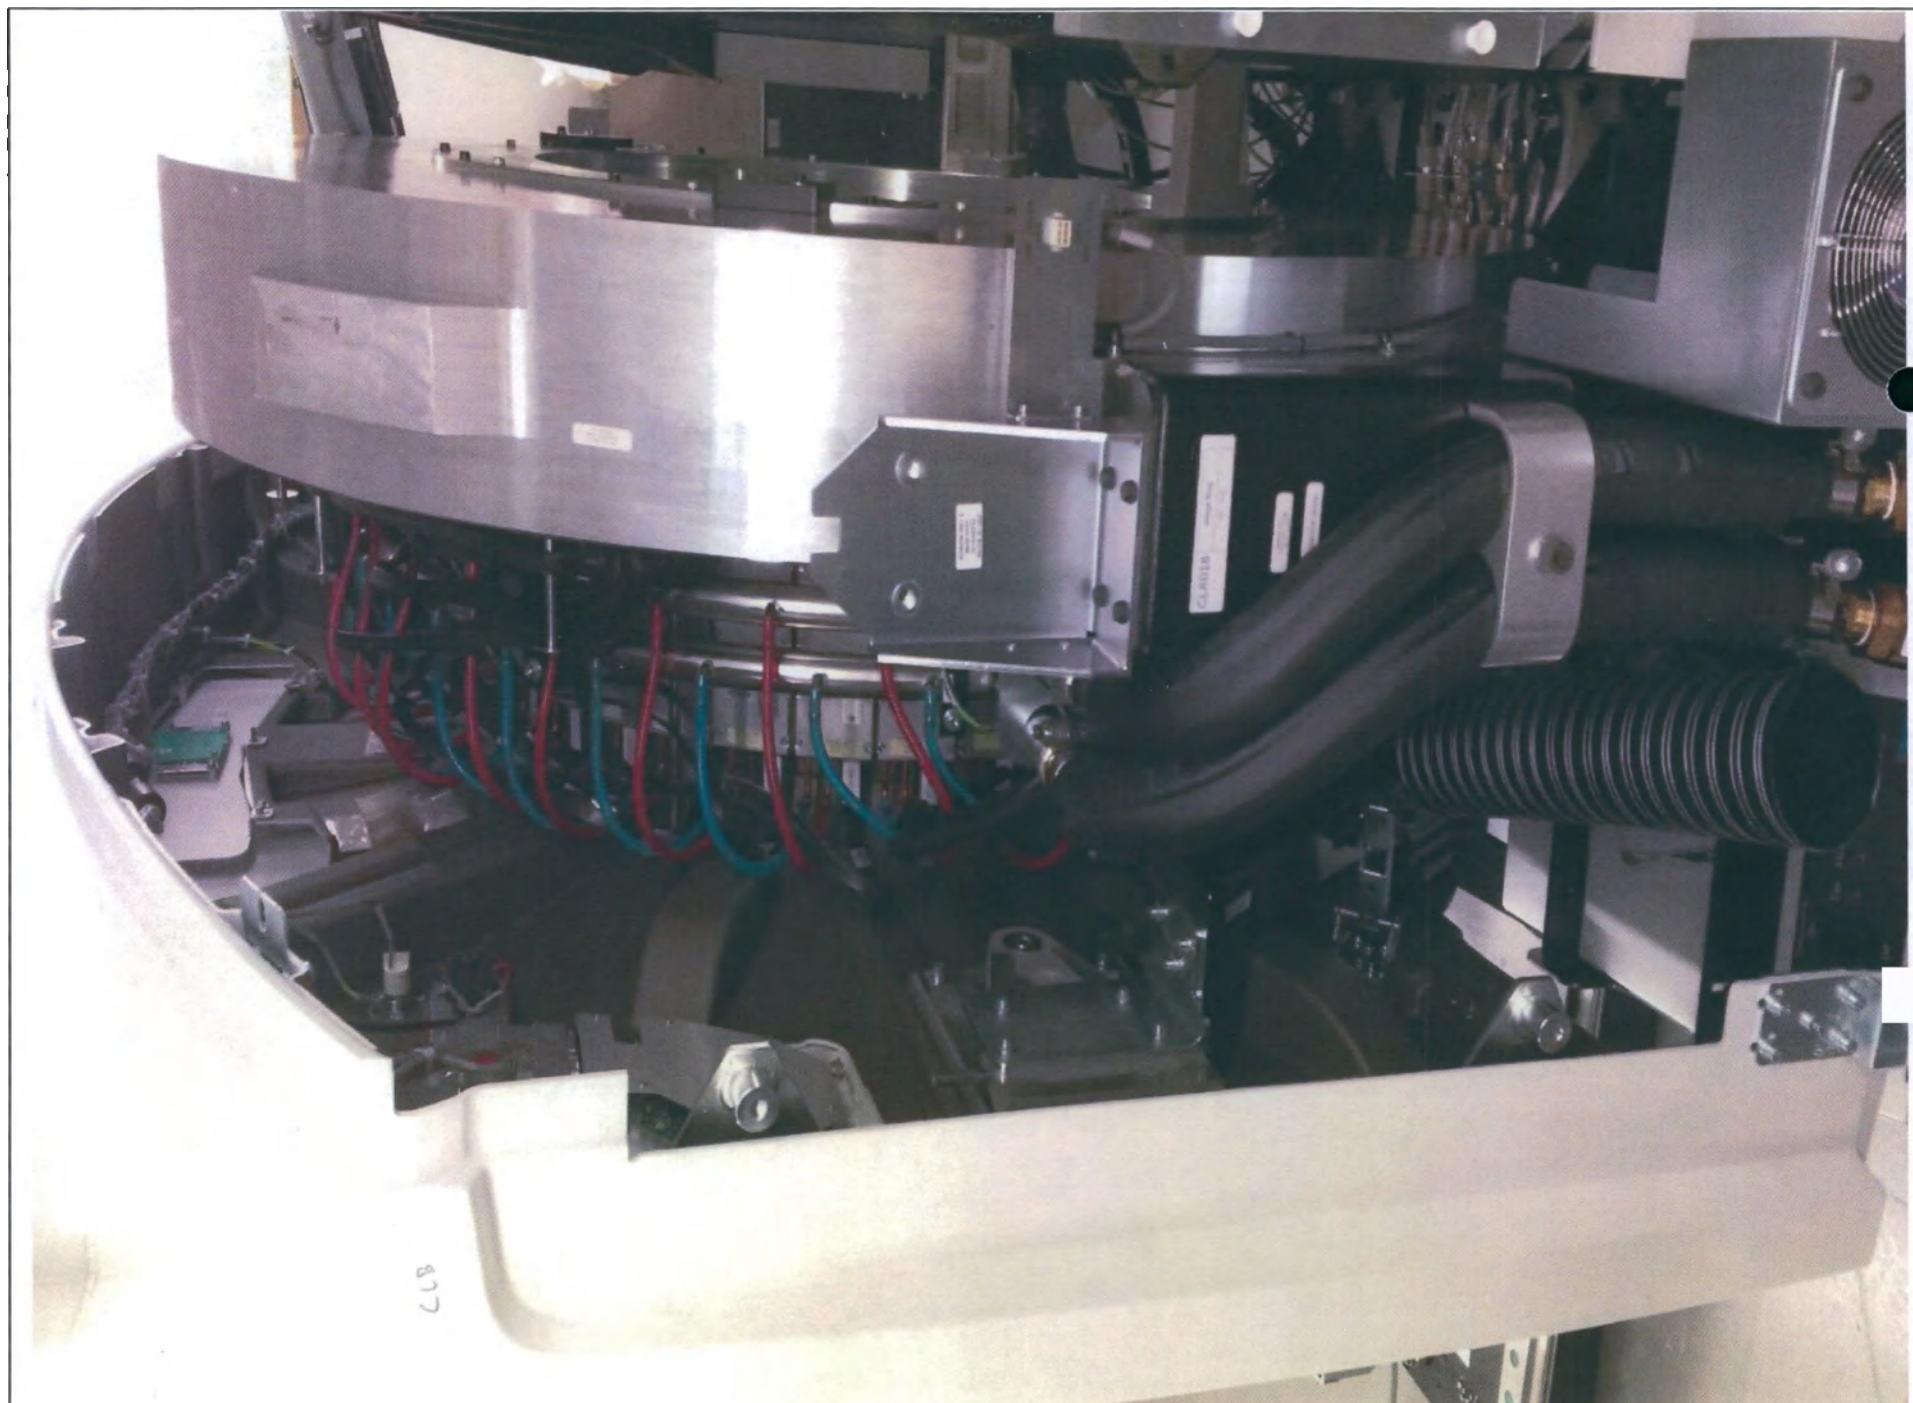

2. Генри КТ.

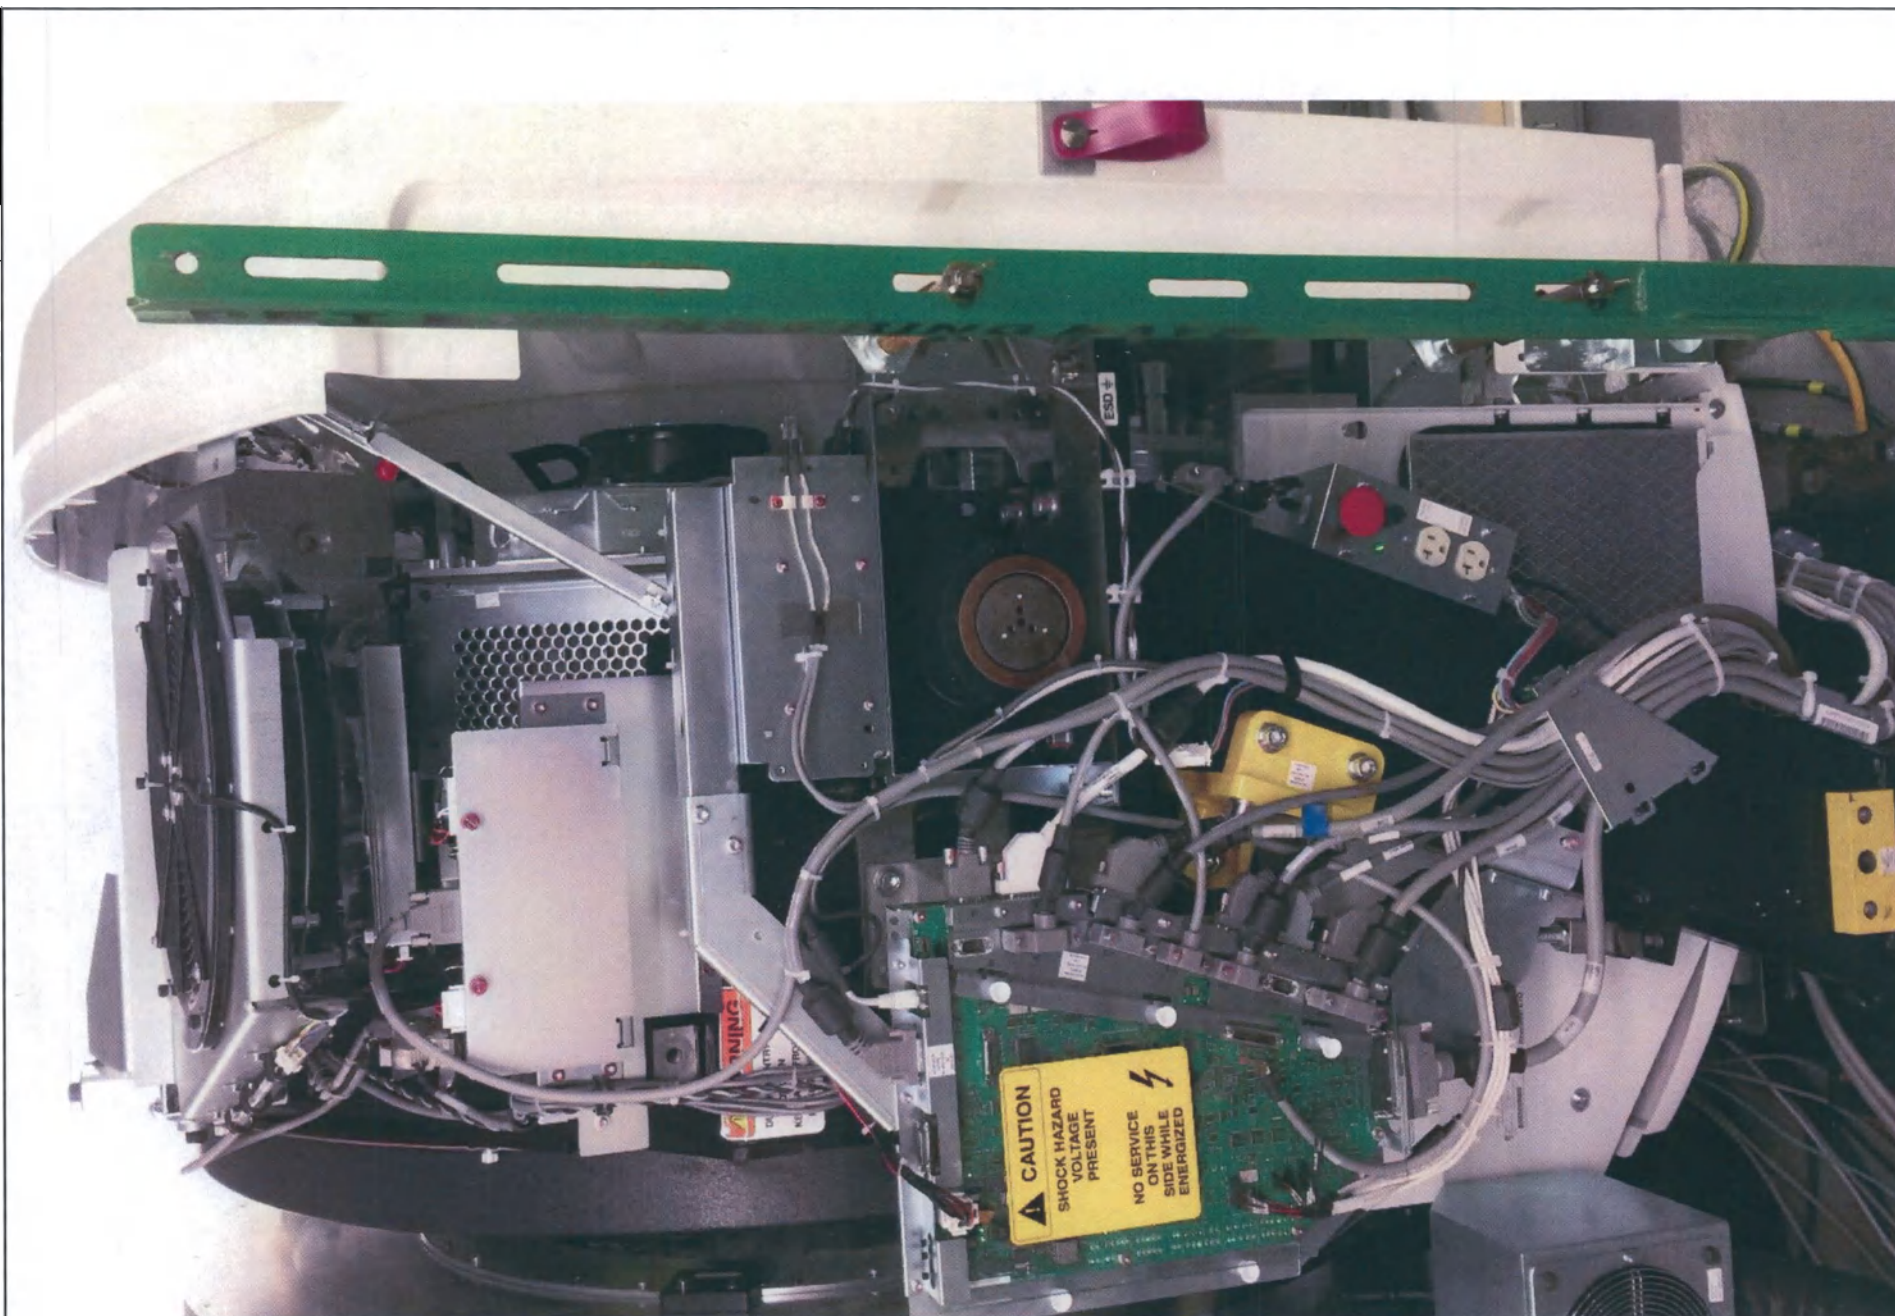

3. Стол пациента.



3. Стол пациента.



4. Консоли управления (не более 4 шт.).




4. Консоли управления (не более 4 шт.).



5. Мониторы для консоли управления (не более 10 шт.).



5. Мониторы для консоли управления (не более 10 шт.).

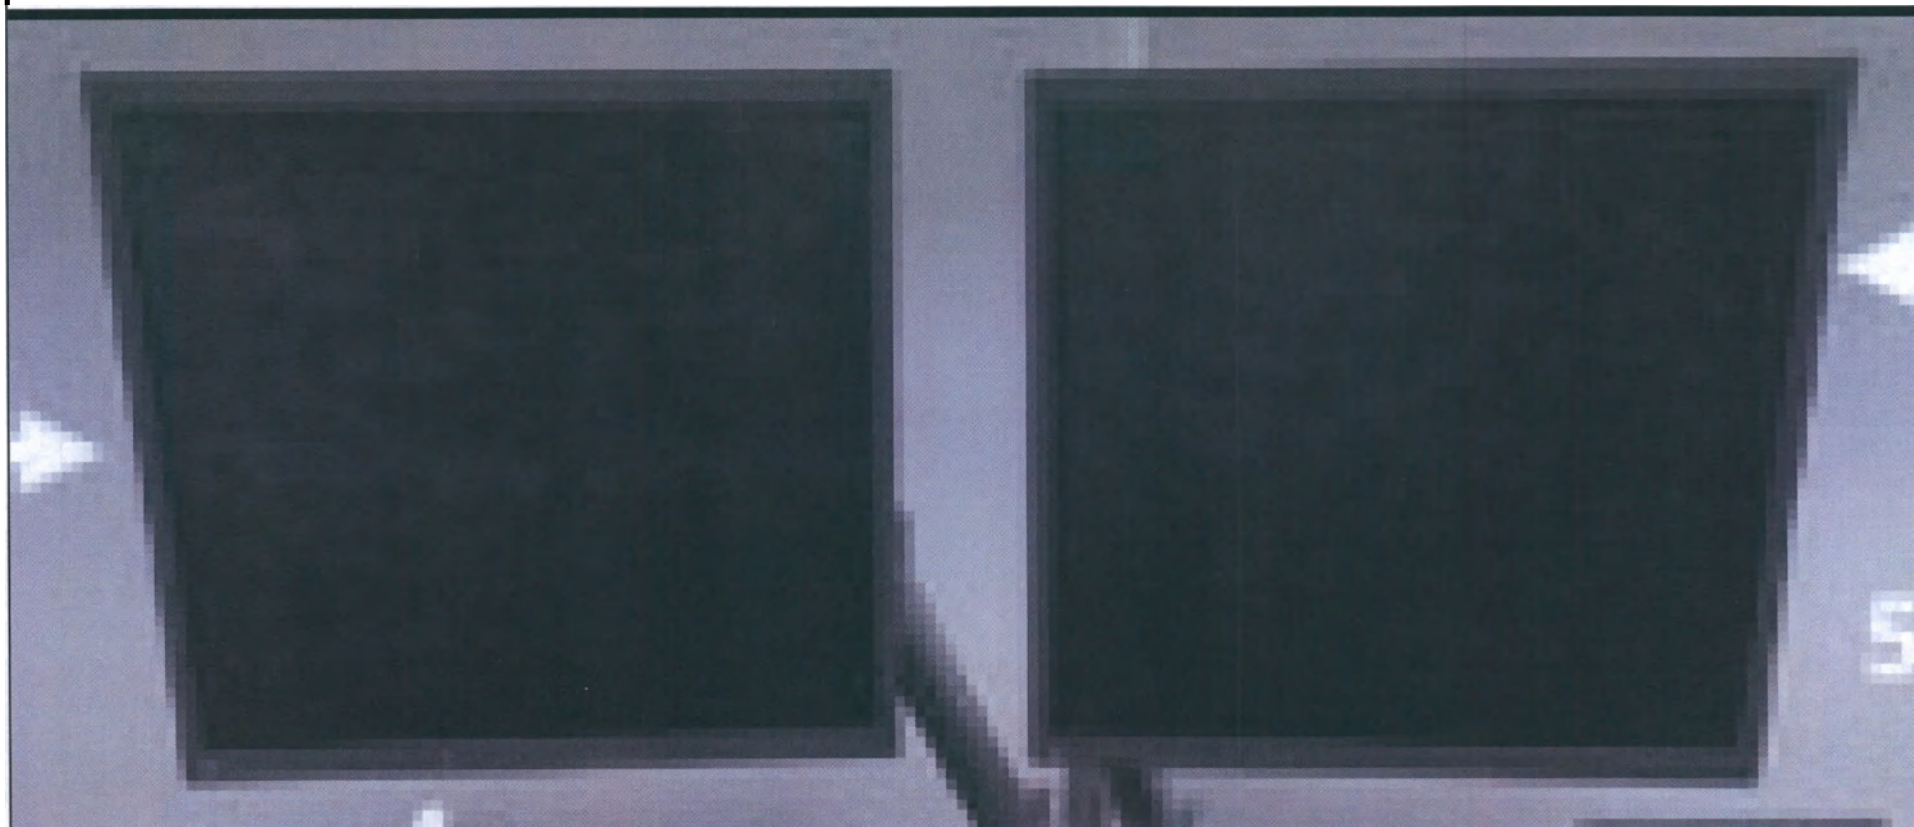


5. Мониторы для консоли управления (не более 10 шт.).




6. Шкафы питания распределительные (не более 4 шт.).




7. Контроллеры сбора и реконструкции данных ПЭТ (не более 4 шт.).

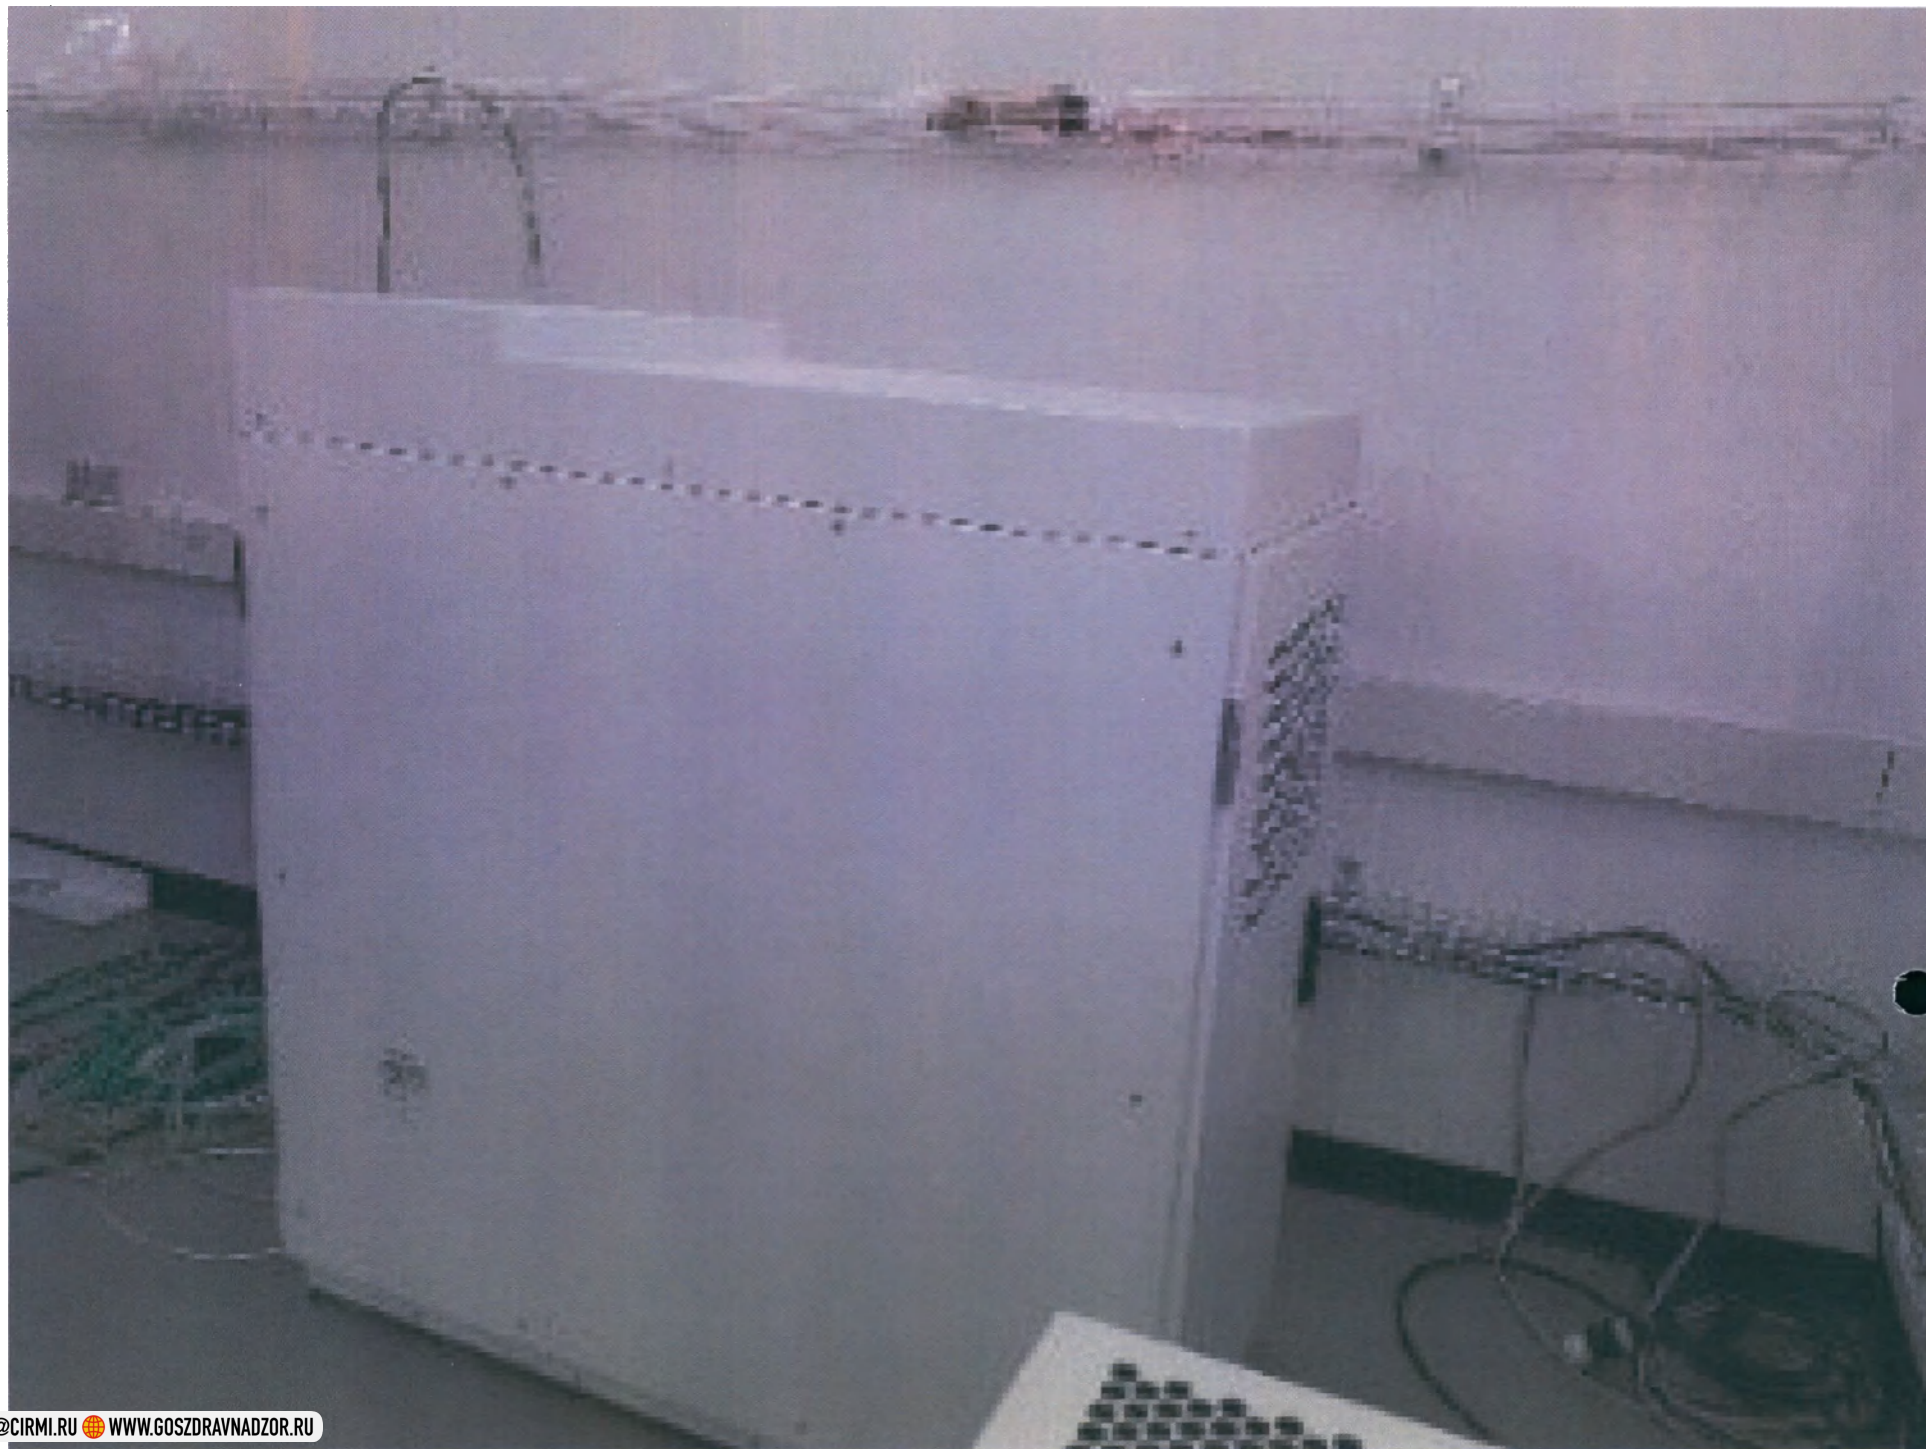

7. Контроллеры сбора и реконструкции данных ПЭТ (не более 4 шт.).

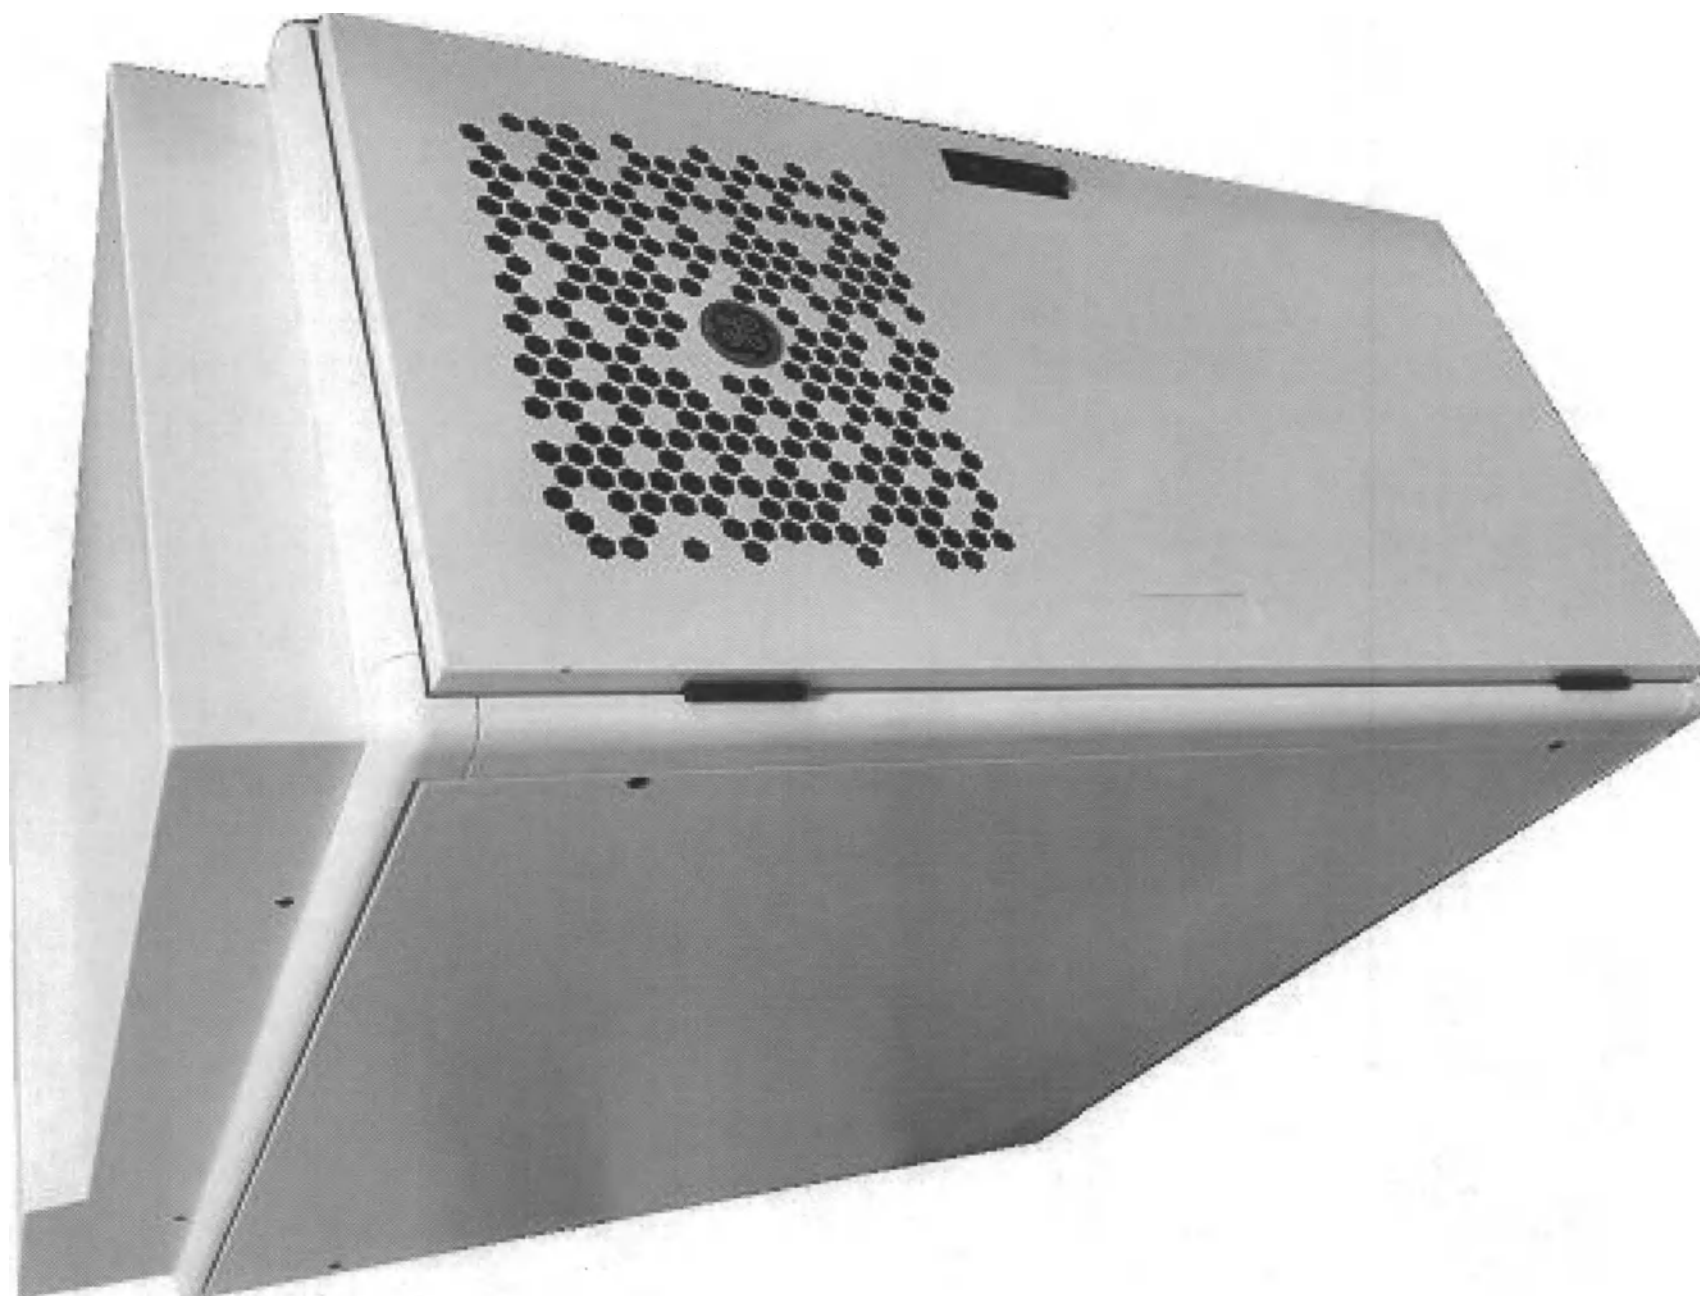

7. Контроллеры сбора и реконструкции данных ПЭТ (не более 4 шт.).

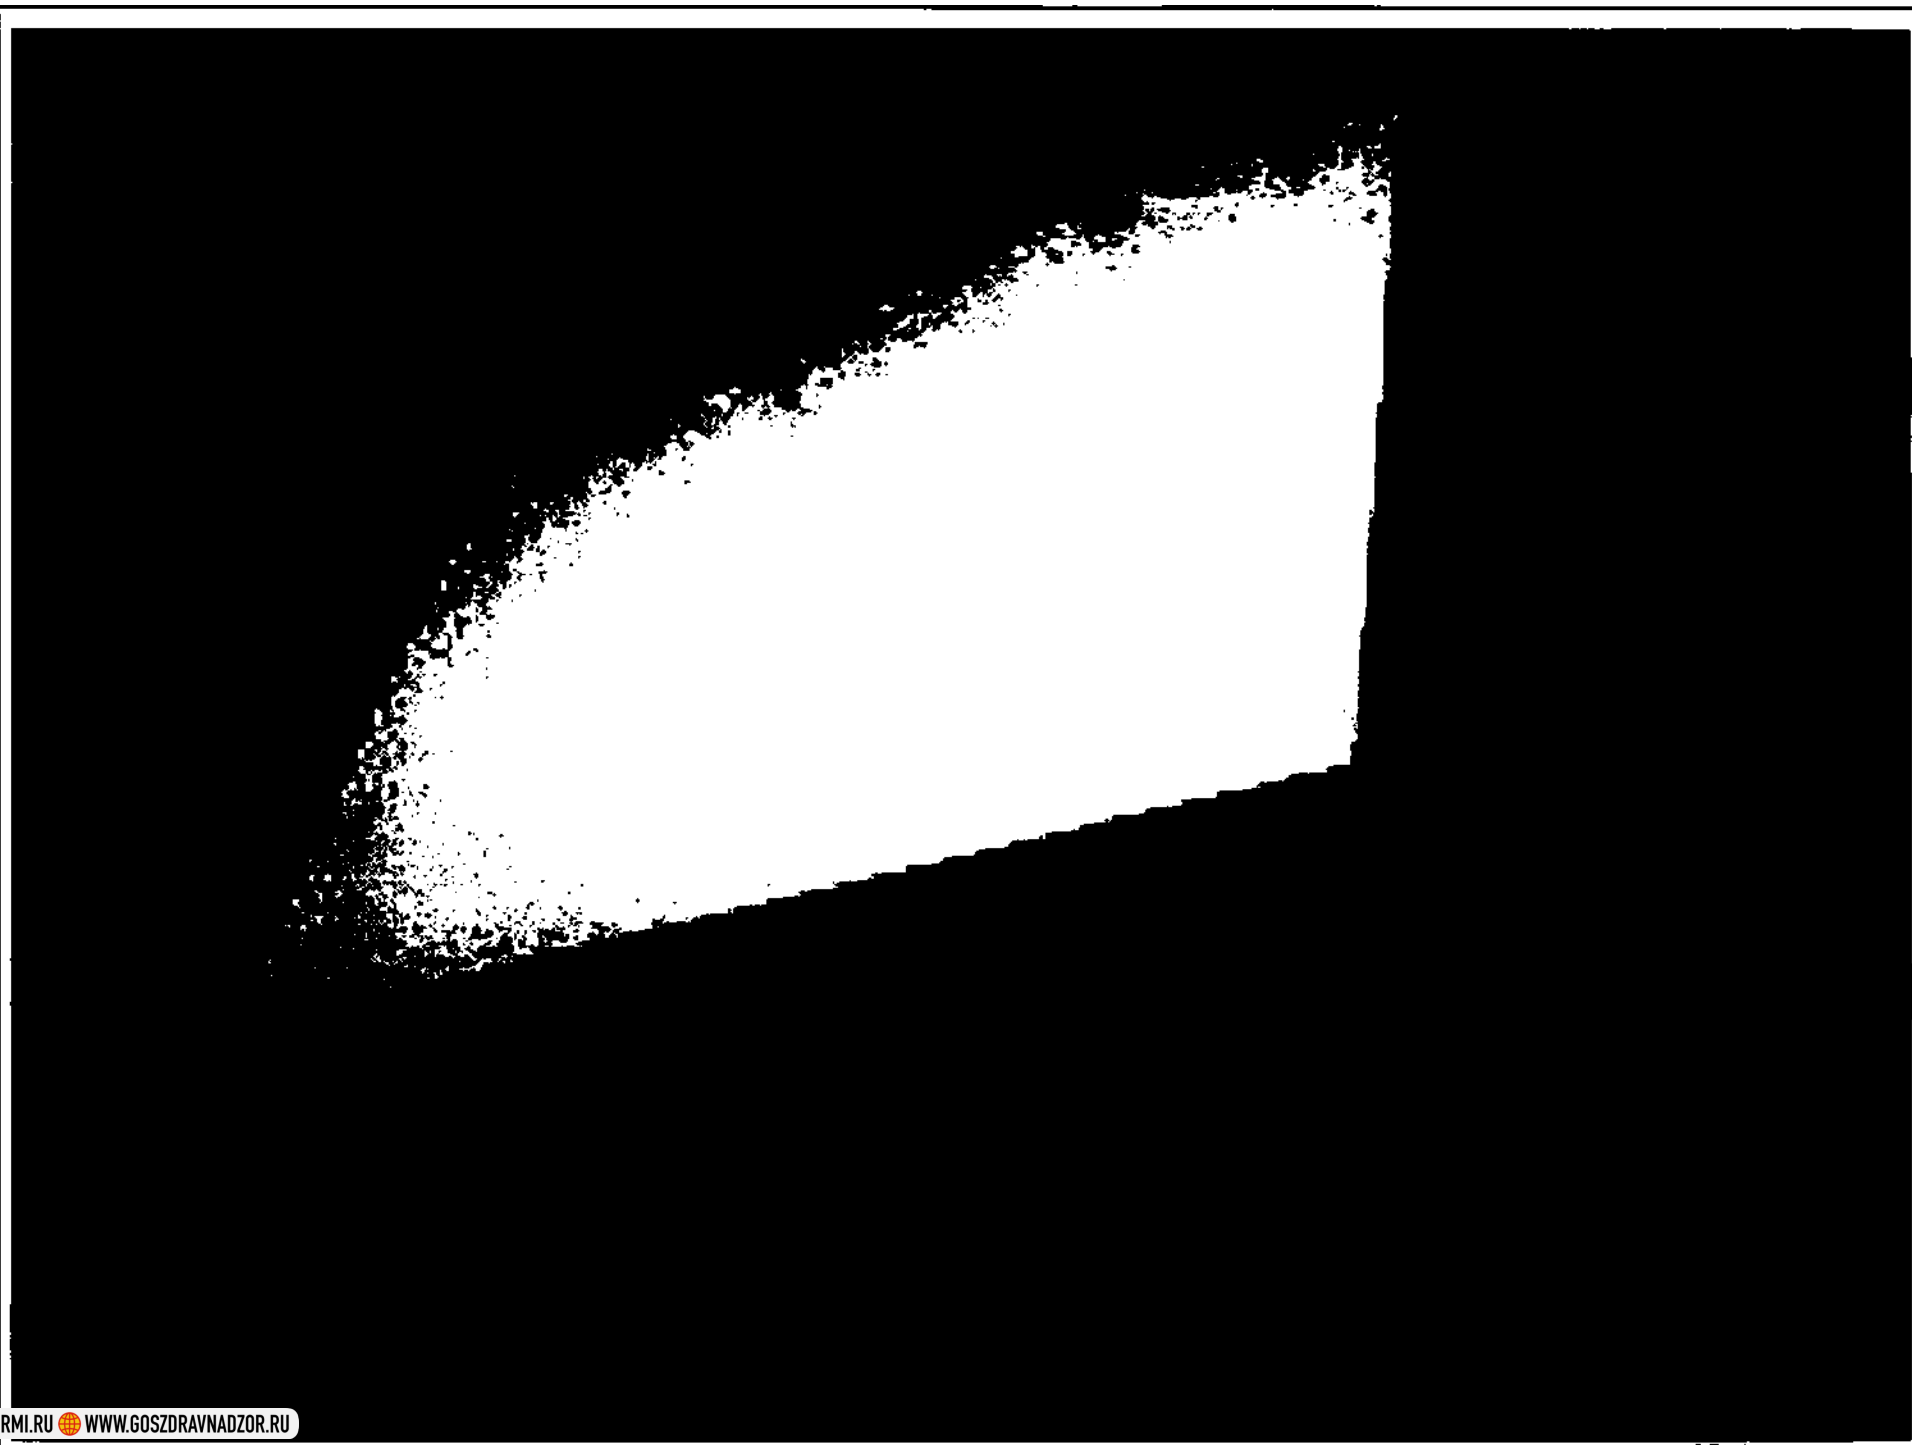

Системы Discovery™ MI Gen2, Discovery™ MI и Discovery™ MI Columbia

Руководство пользователя



Approval details stored in the electronic master, the Global MWS PLM System. This Document is under formal Change Control



5720964-1RU


Редакция 7

© 2020 General Electric Company

*Trademark of General Electric Company

Approved Document - 5720964-1RUTPH_r7.pdf Page 2 of 637

9. Охладитель комплекса.

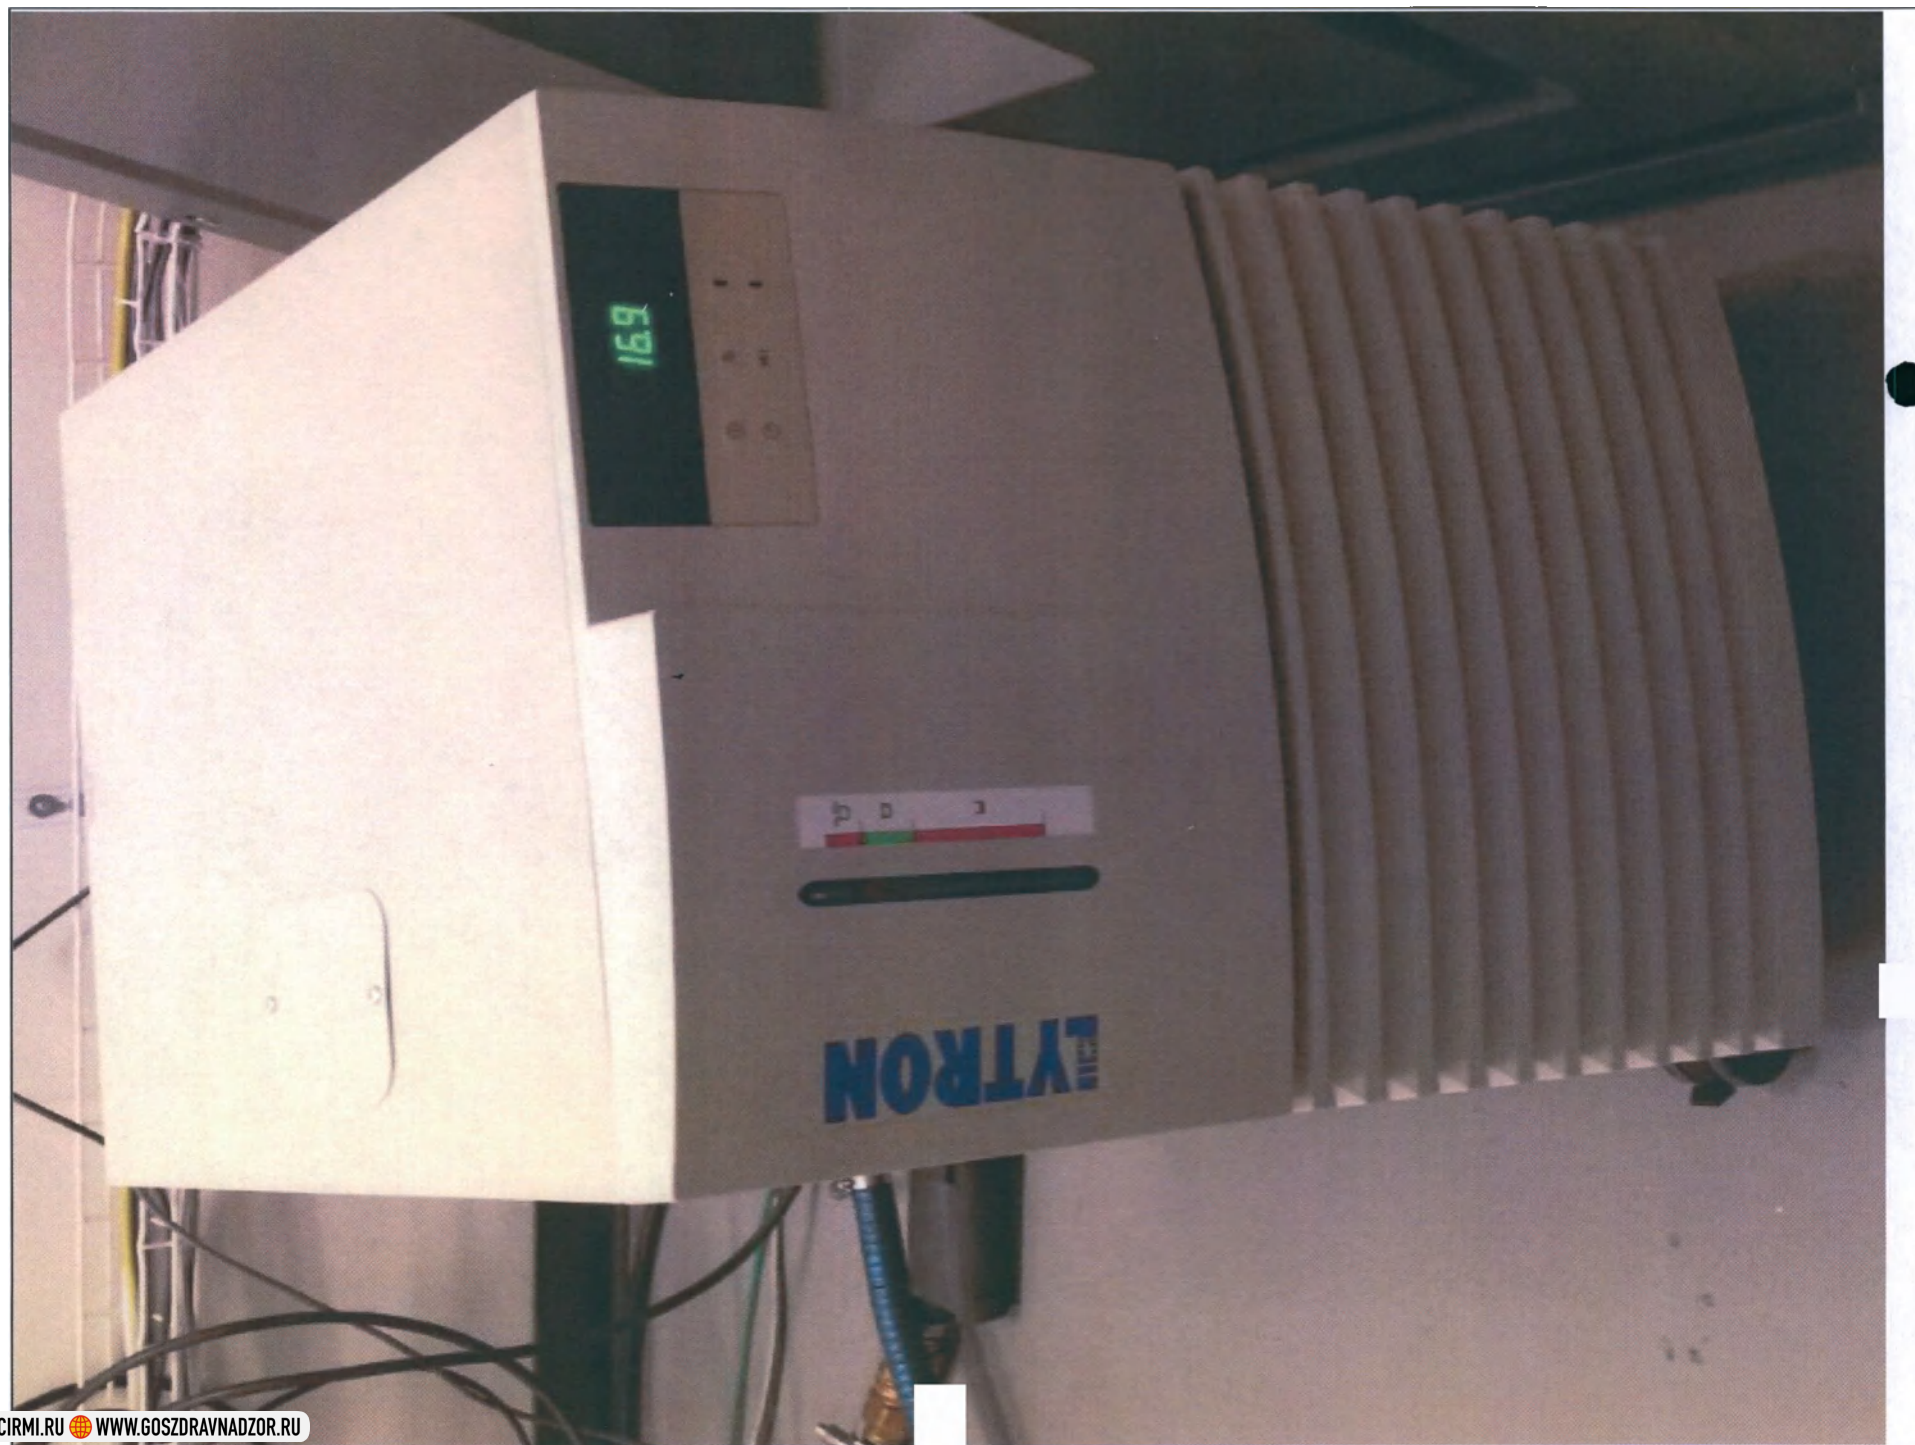


9. Охладитель комплекса.




9. Охладитель комплекса.




10. Щит электрораспределительный для охладителя комплекса.

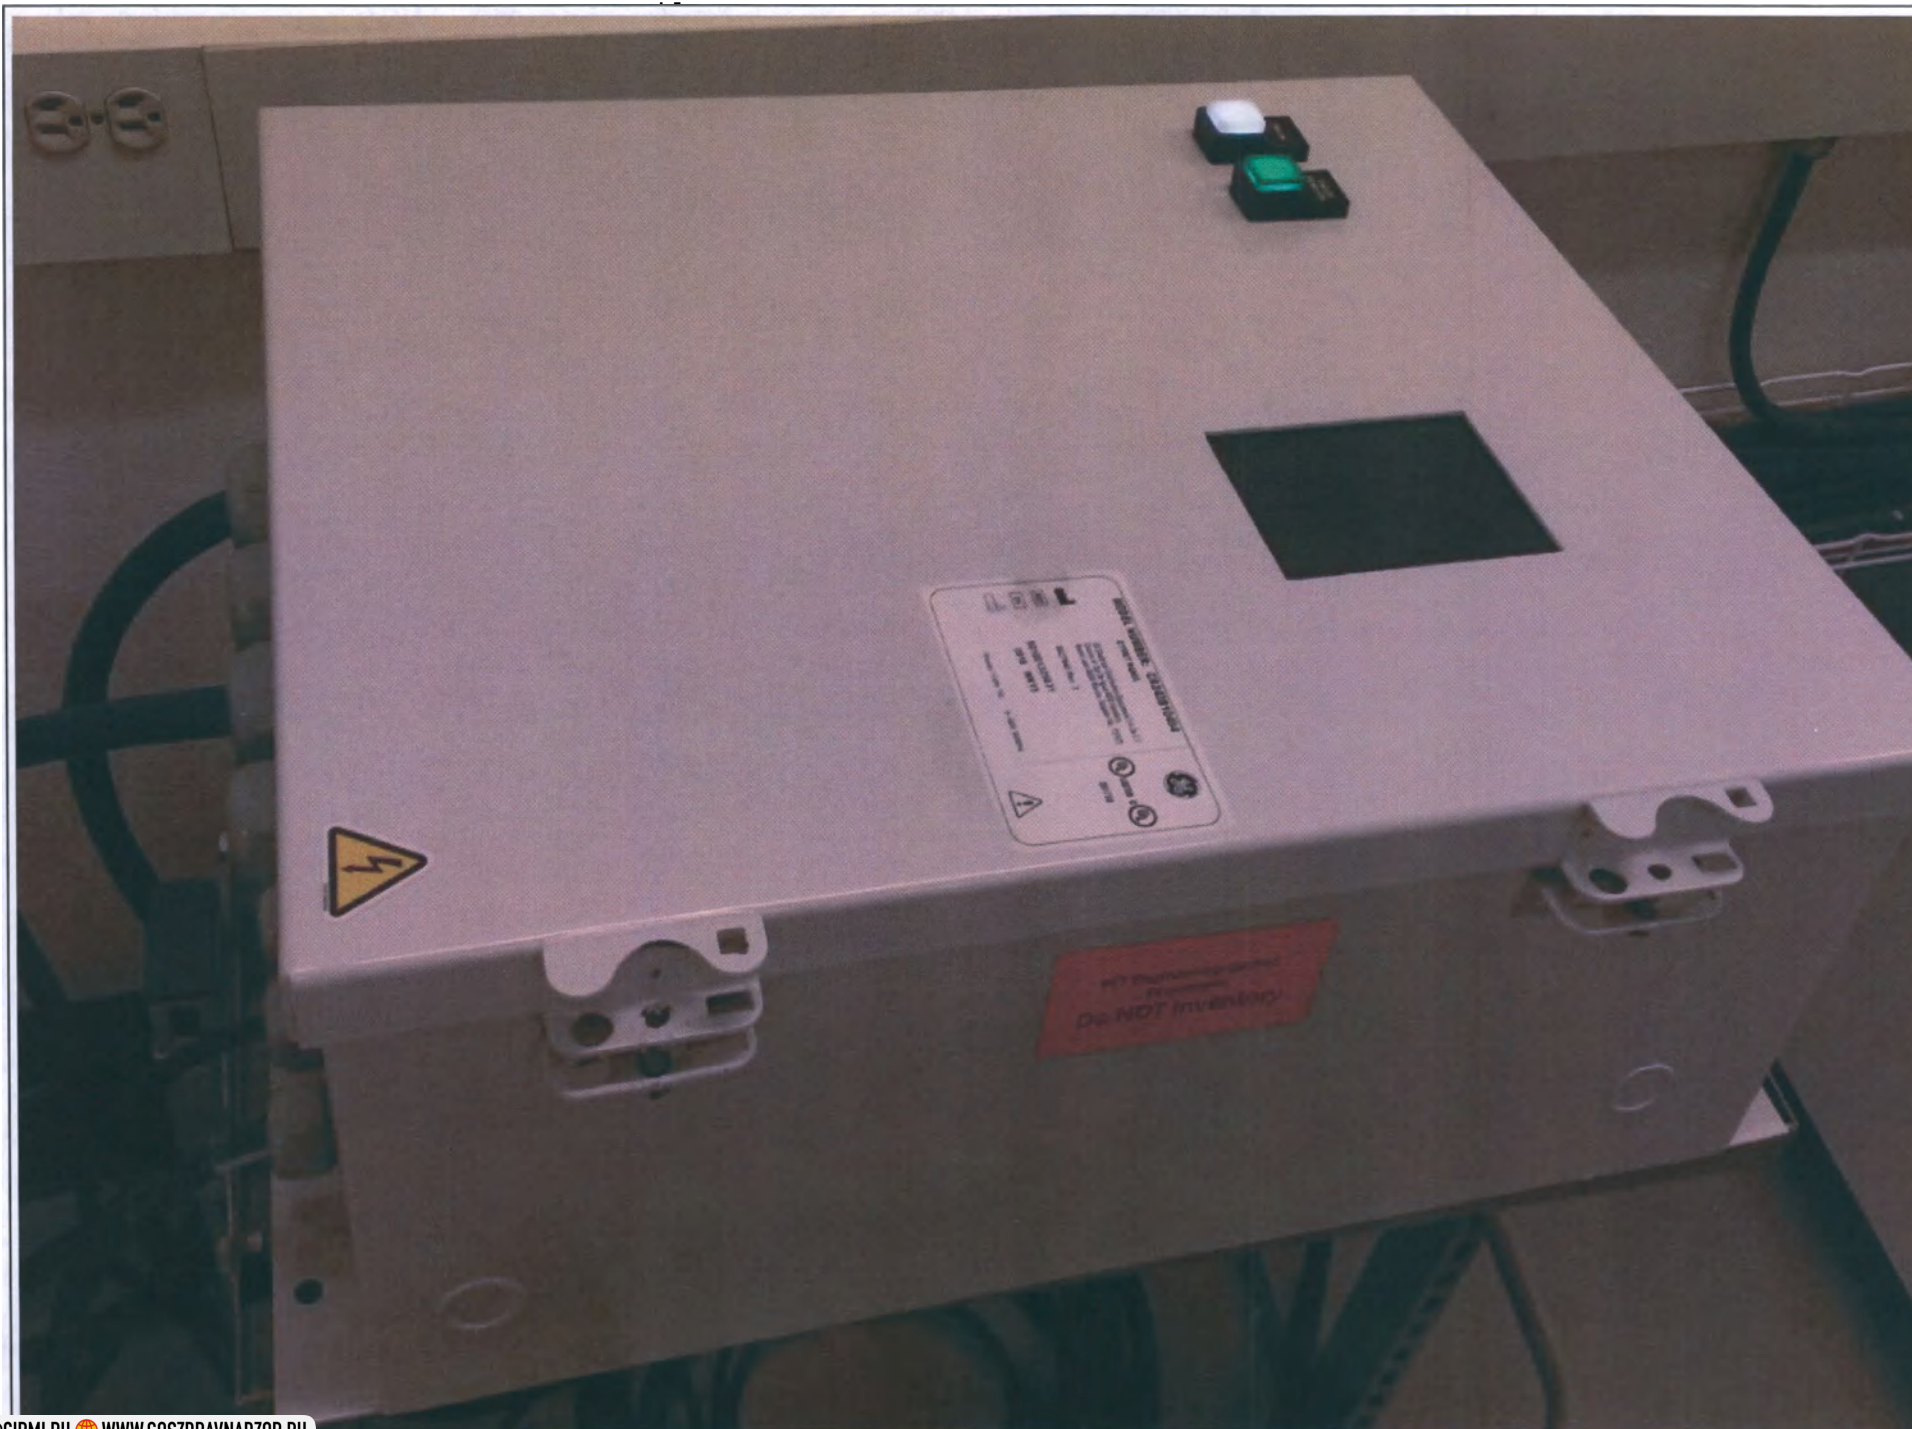

10. Щит электрораспределительный для охладителя комплекса.

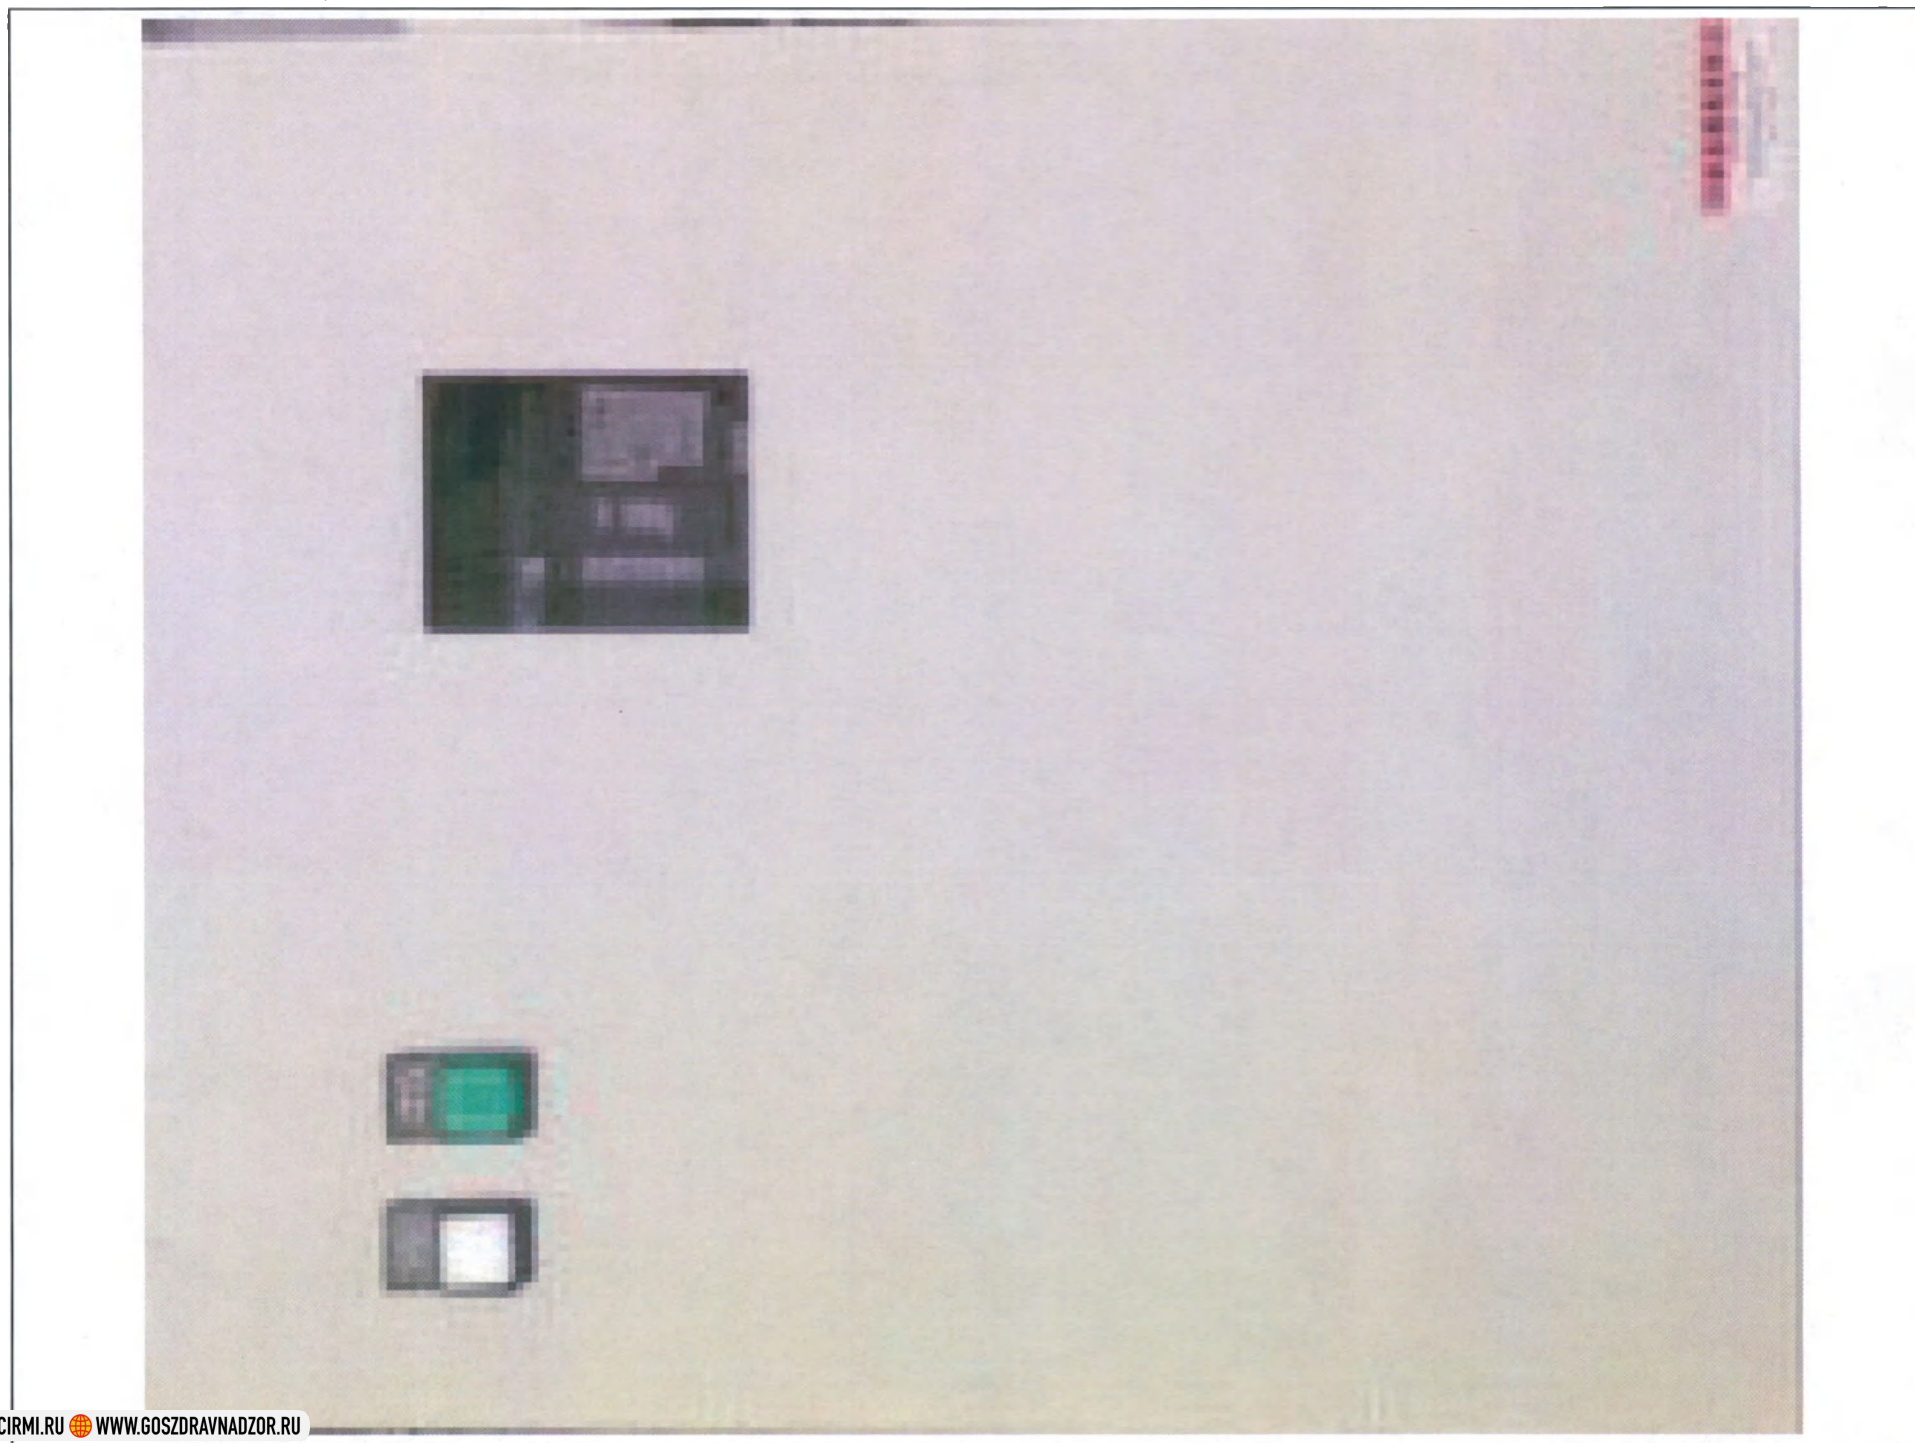


10. Щит электрораспределительный для охладителя комплекса.

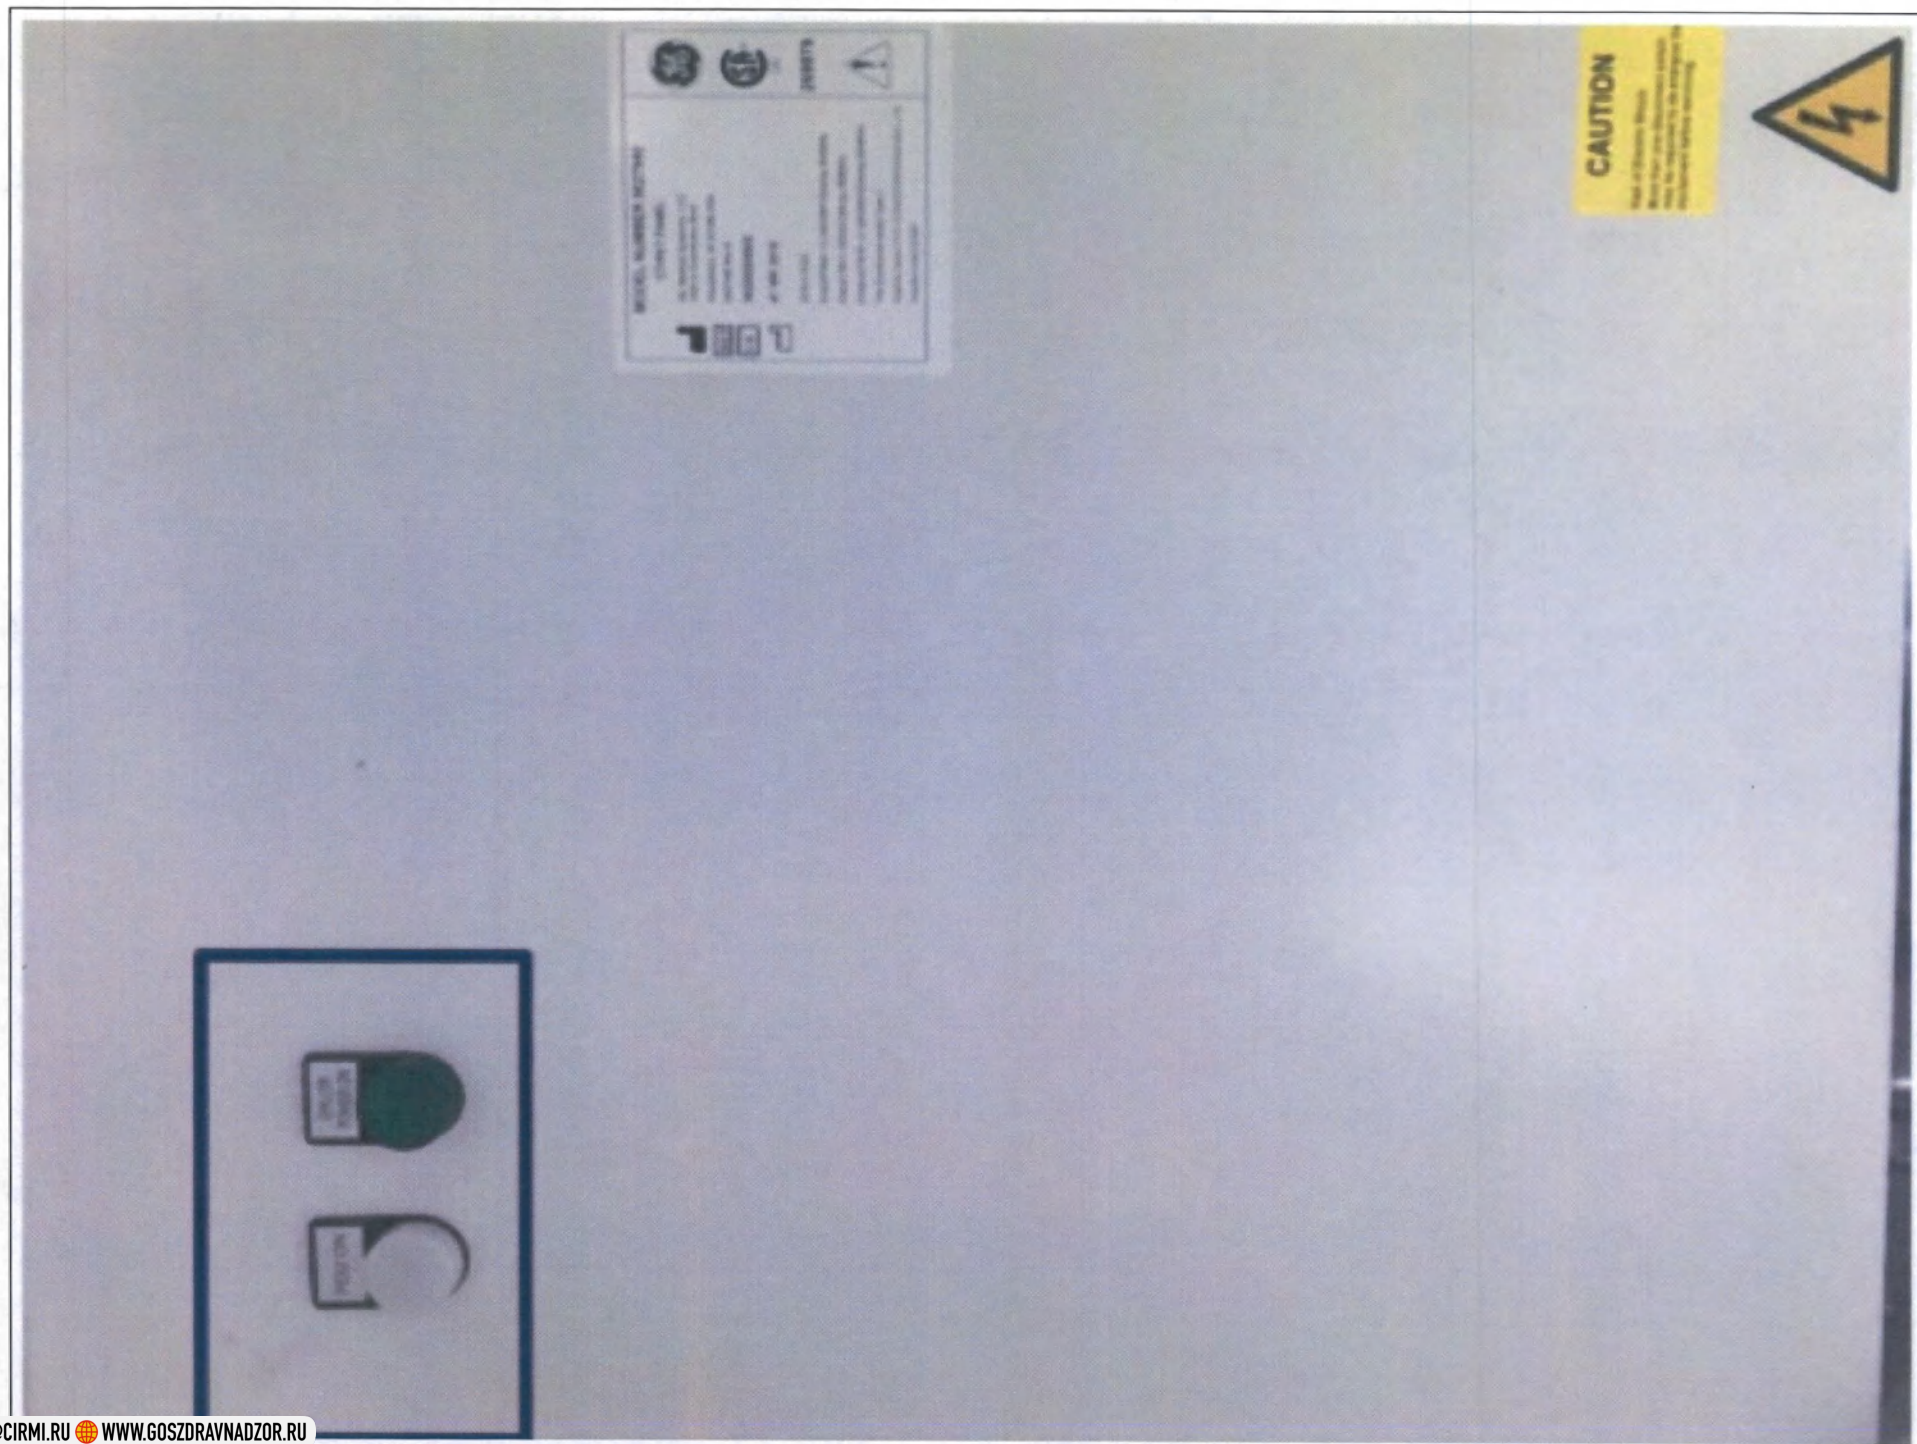


10. Щит электрораспределительный для охладителя комплекса.



11. Трубка рентгеновская.

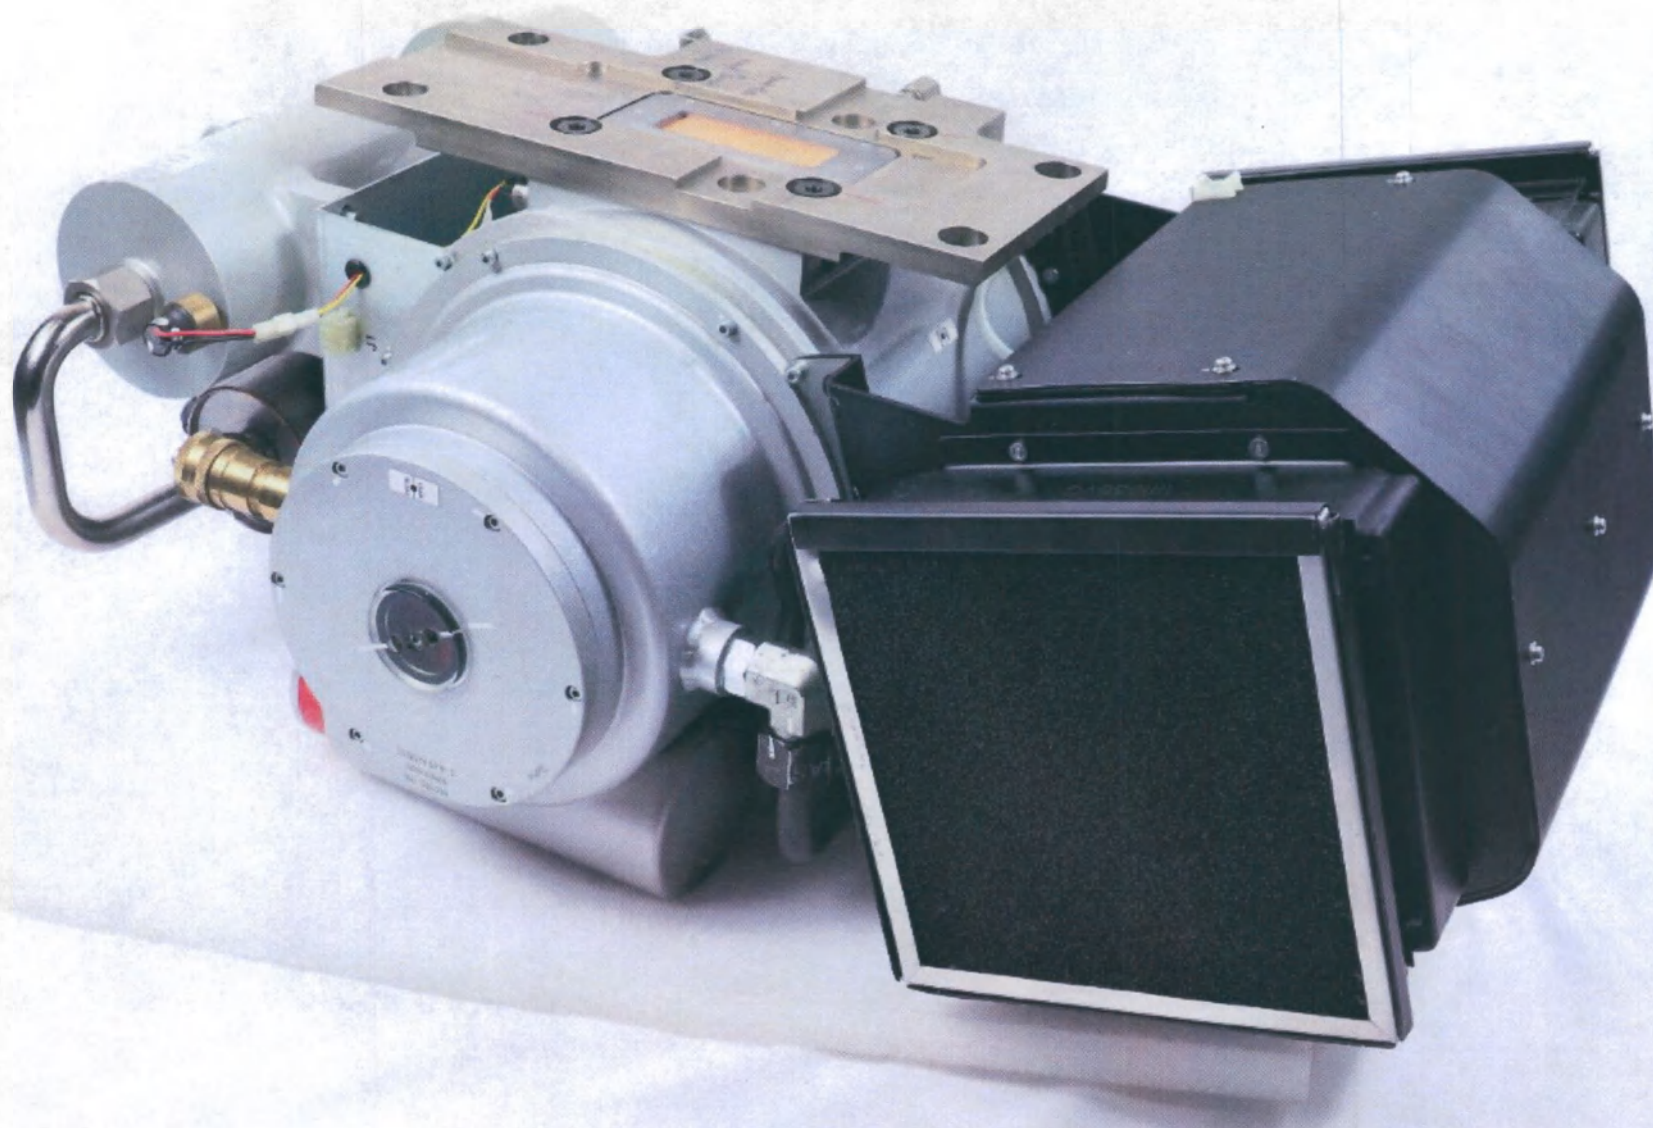

12. Станции рабочие (не более 10 шт.) (при необходимости).

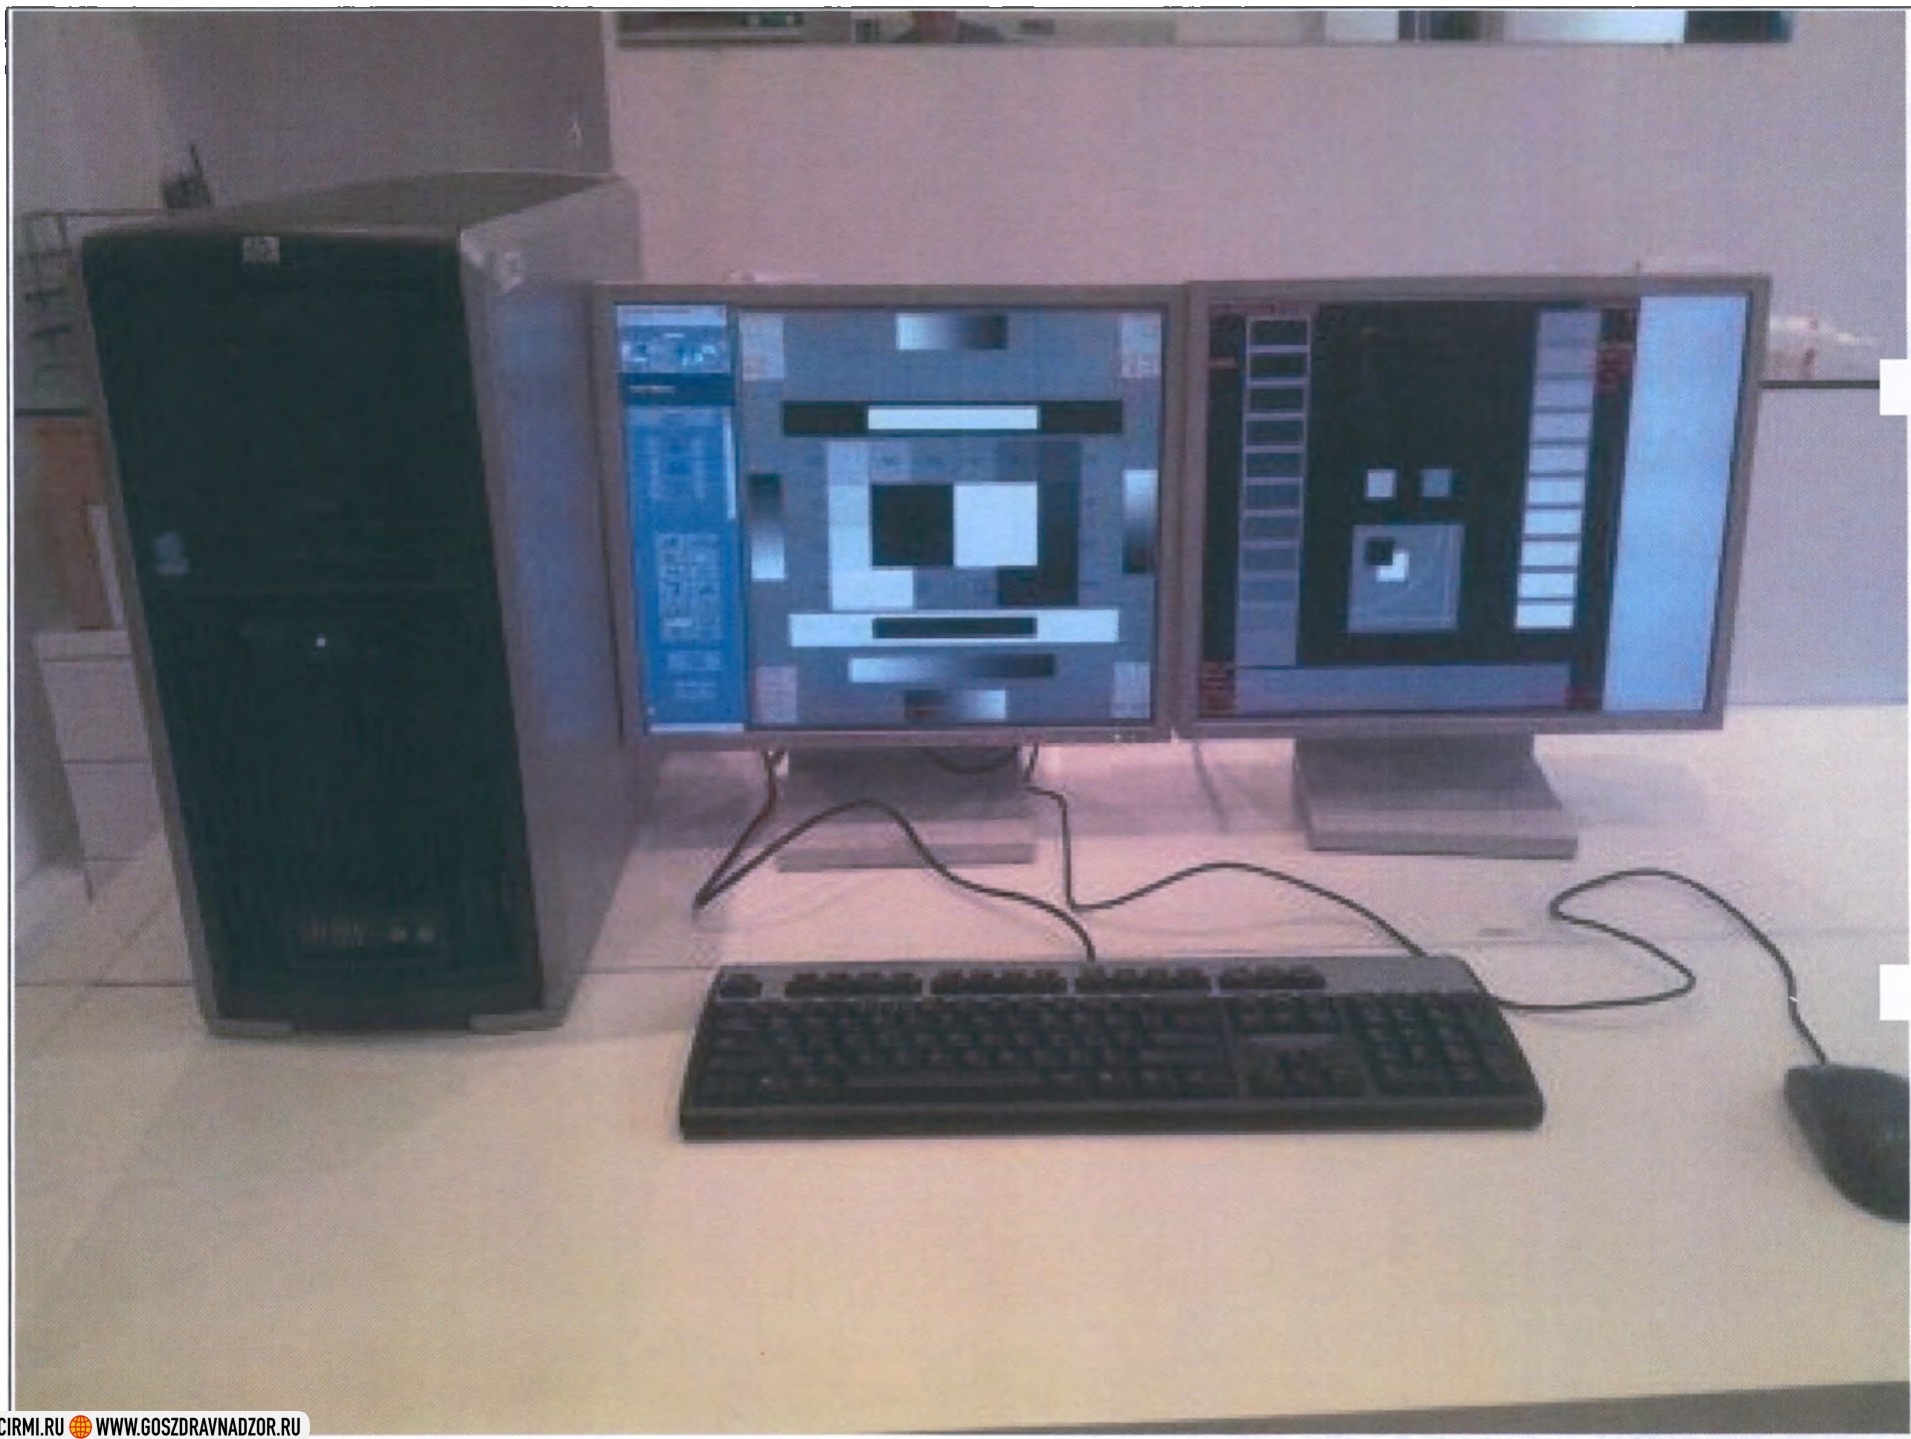

12. Станции рабочие (не более 10 шт.) (при необходимости).




12. Станции рабочие (не более 10 шт.) (при необходимости).



12. Станции рабочие (не более 10 шт.) (при необходимости).



13. Сервера рабочей станции (не более 4 шт.) (при необходимости).

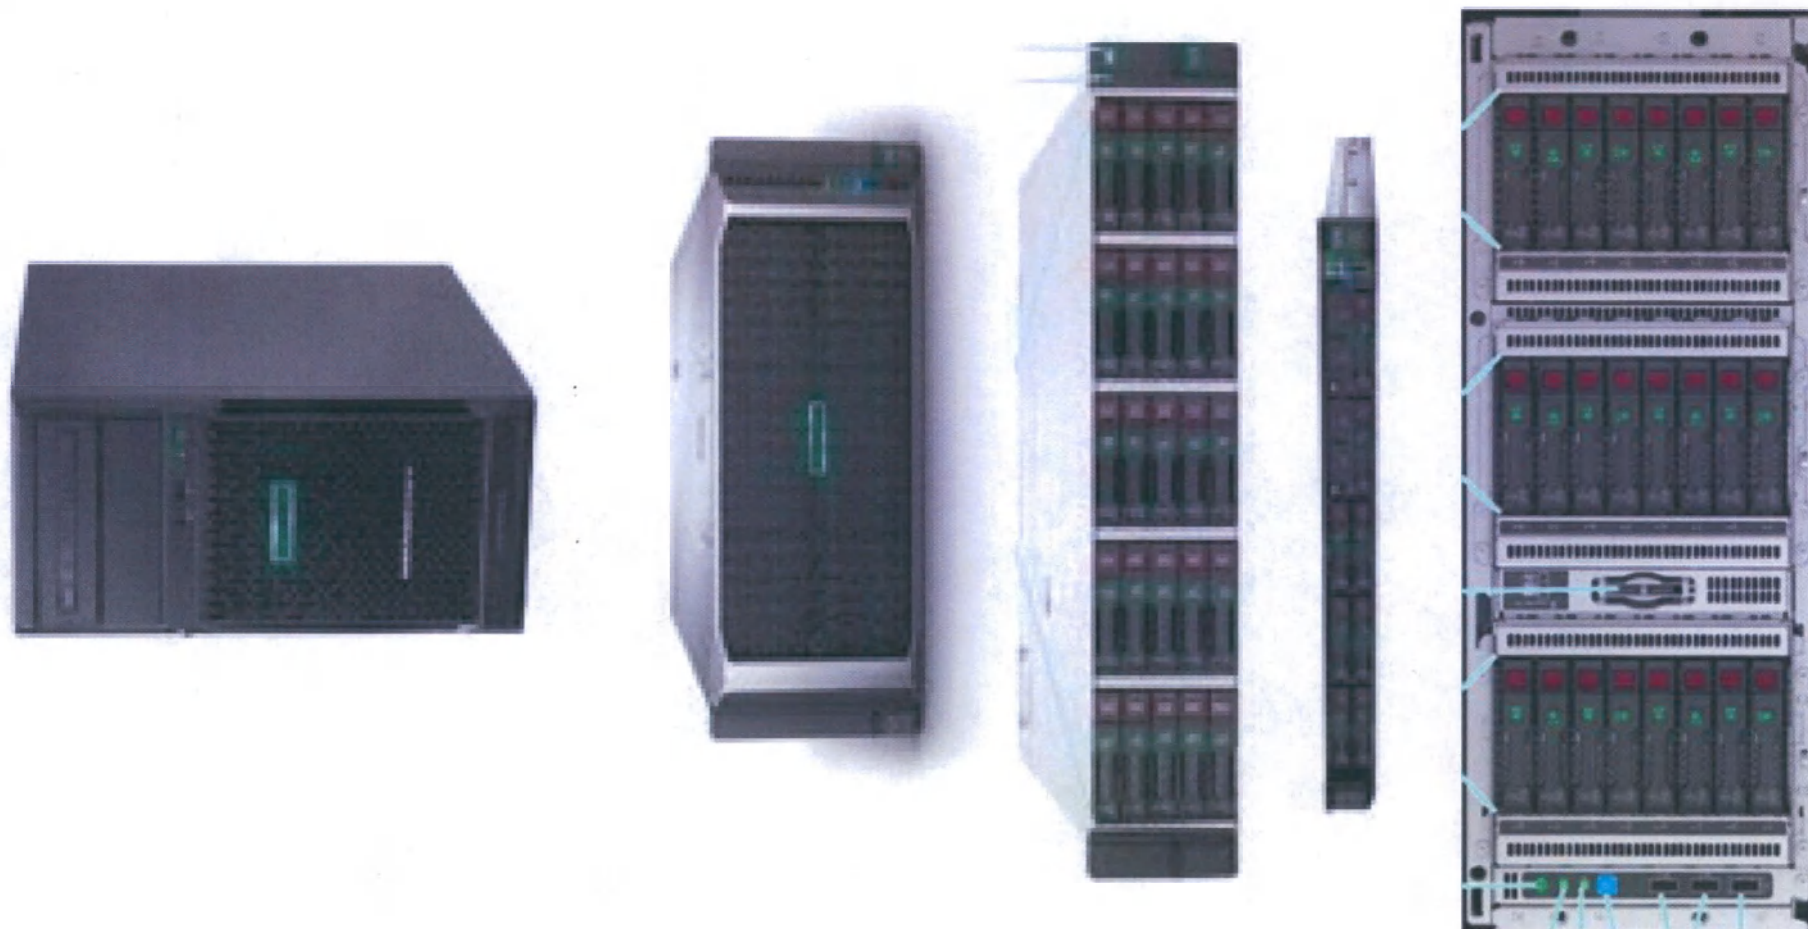

14. Мониторы для станции рабочей (не более 10 шт.) (при необходимости).



14. Мониторы для станции рабочей (не более 10 шт.) (при необходимости).




14. Мониторы для станции рабочей (не более 10 шт.) (при необходимости).



15. Блоки реконструкции (не более 6 шт.) (при необходимости).




15. Блоки реконструкции (не более 6 шт.) (при необходимости).

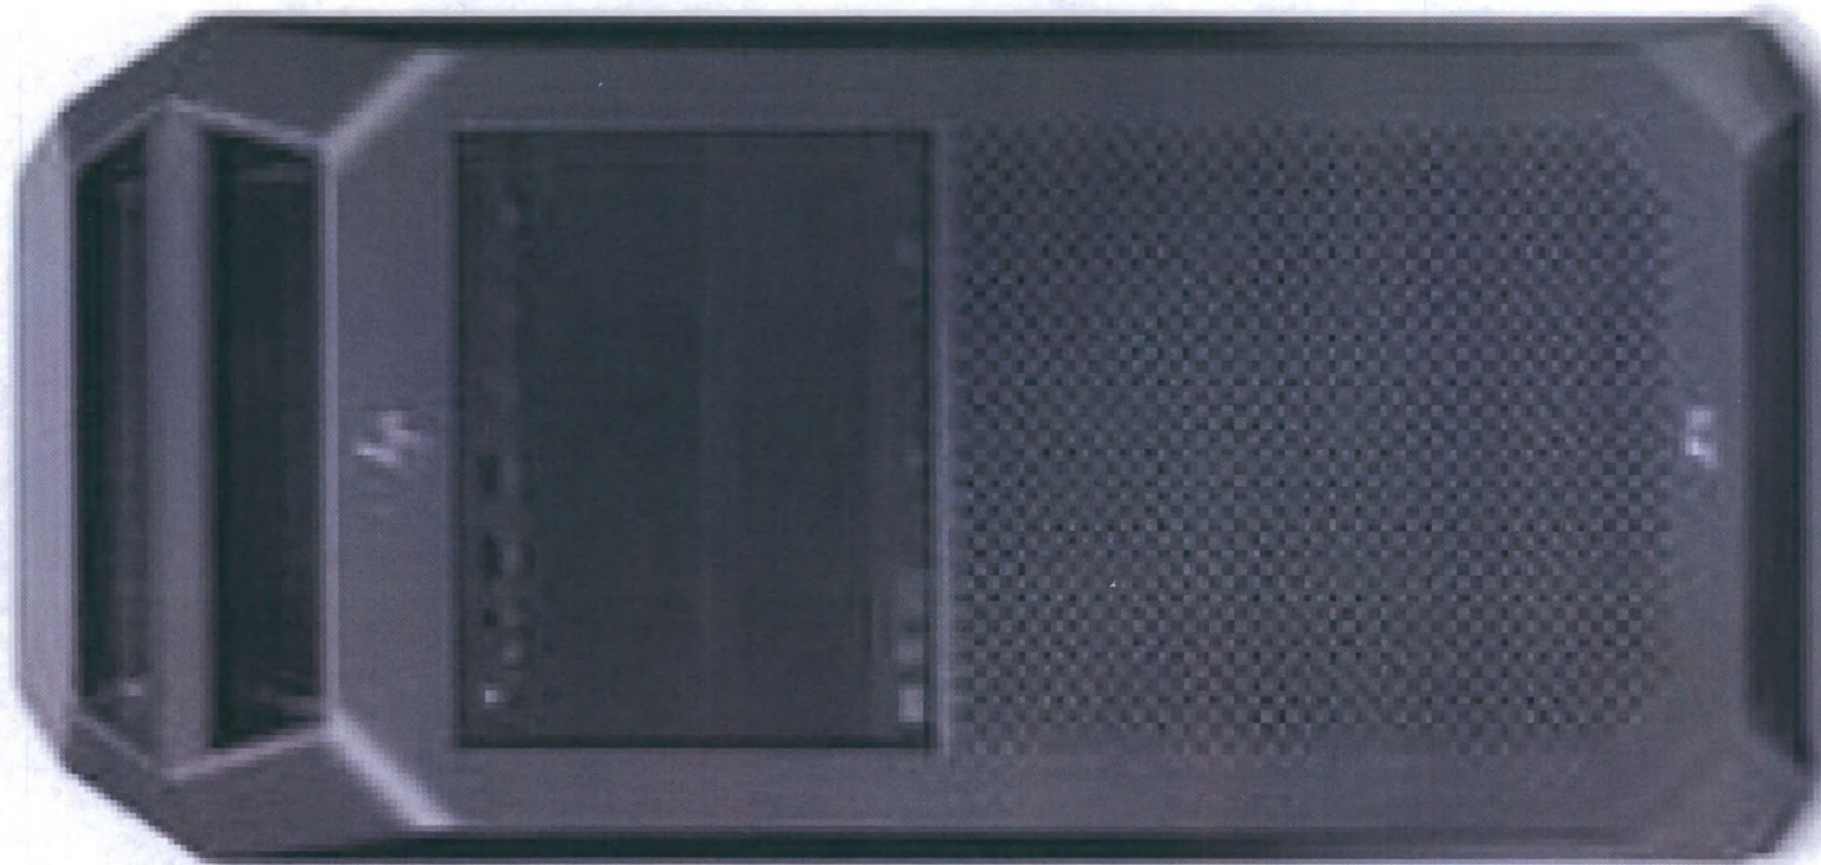


15. Блоки реконструкции (не более 6 шт.) (при необходимости).




15. Блоки реконструкции (не более 6 шт.) (при необходимости).

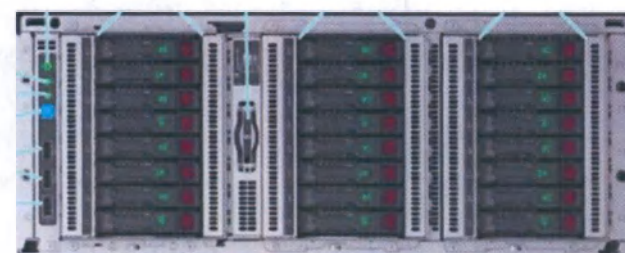

15. Блоки реконструкции (не более 6 шт.) (при необходимости).

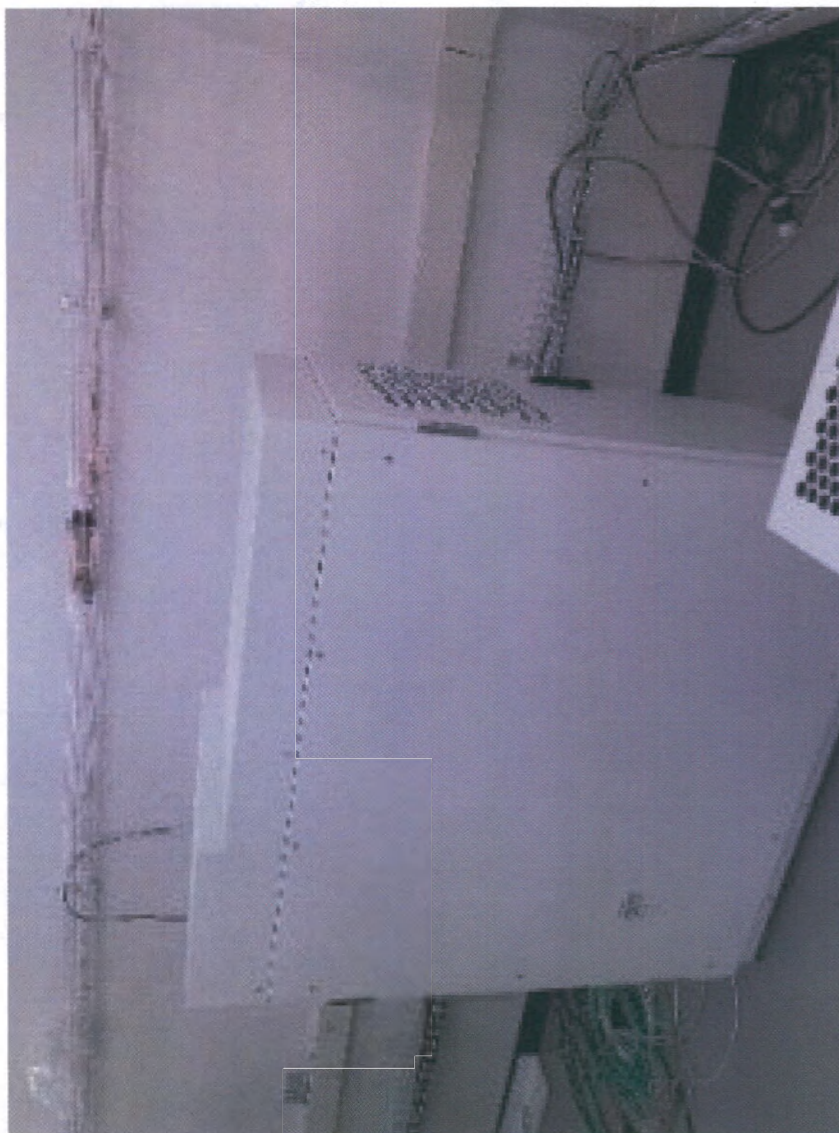

16. Коробки распределительные (не более 4 шт.) (при необходимости).

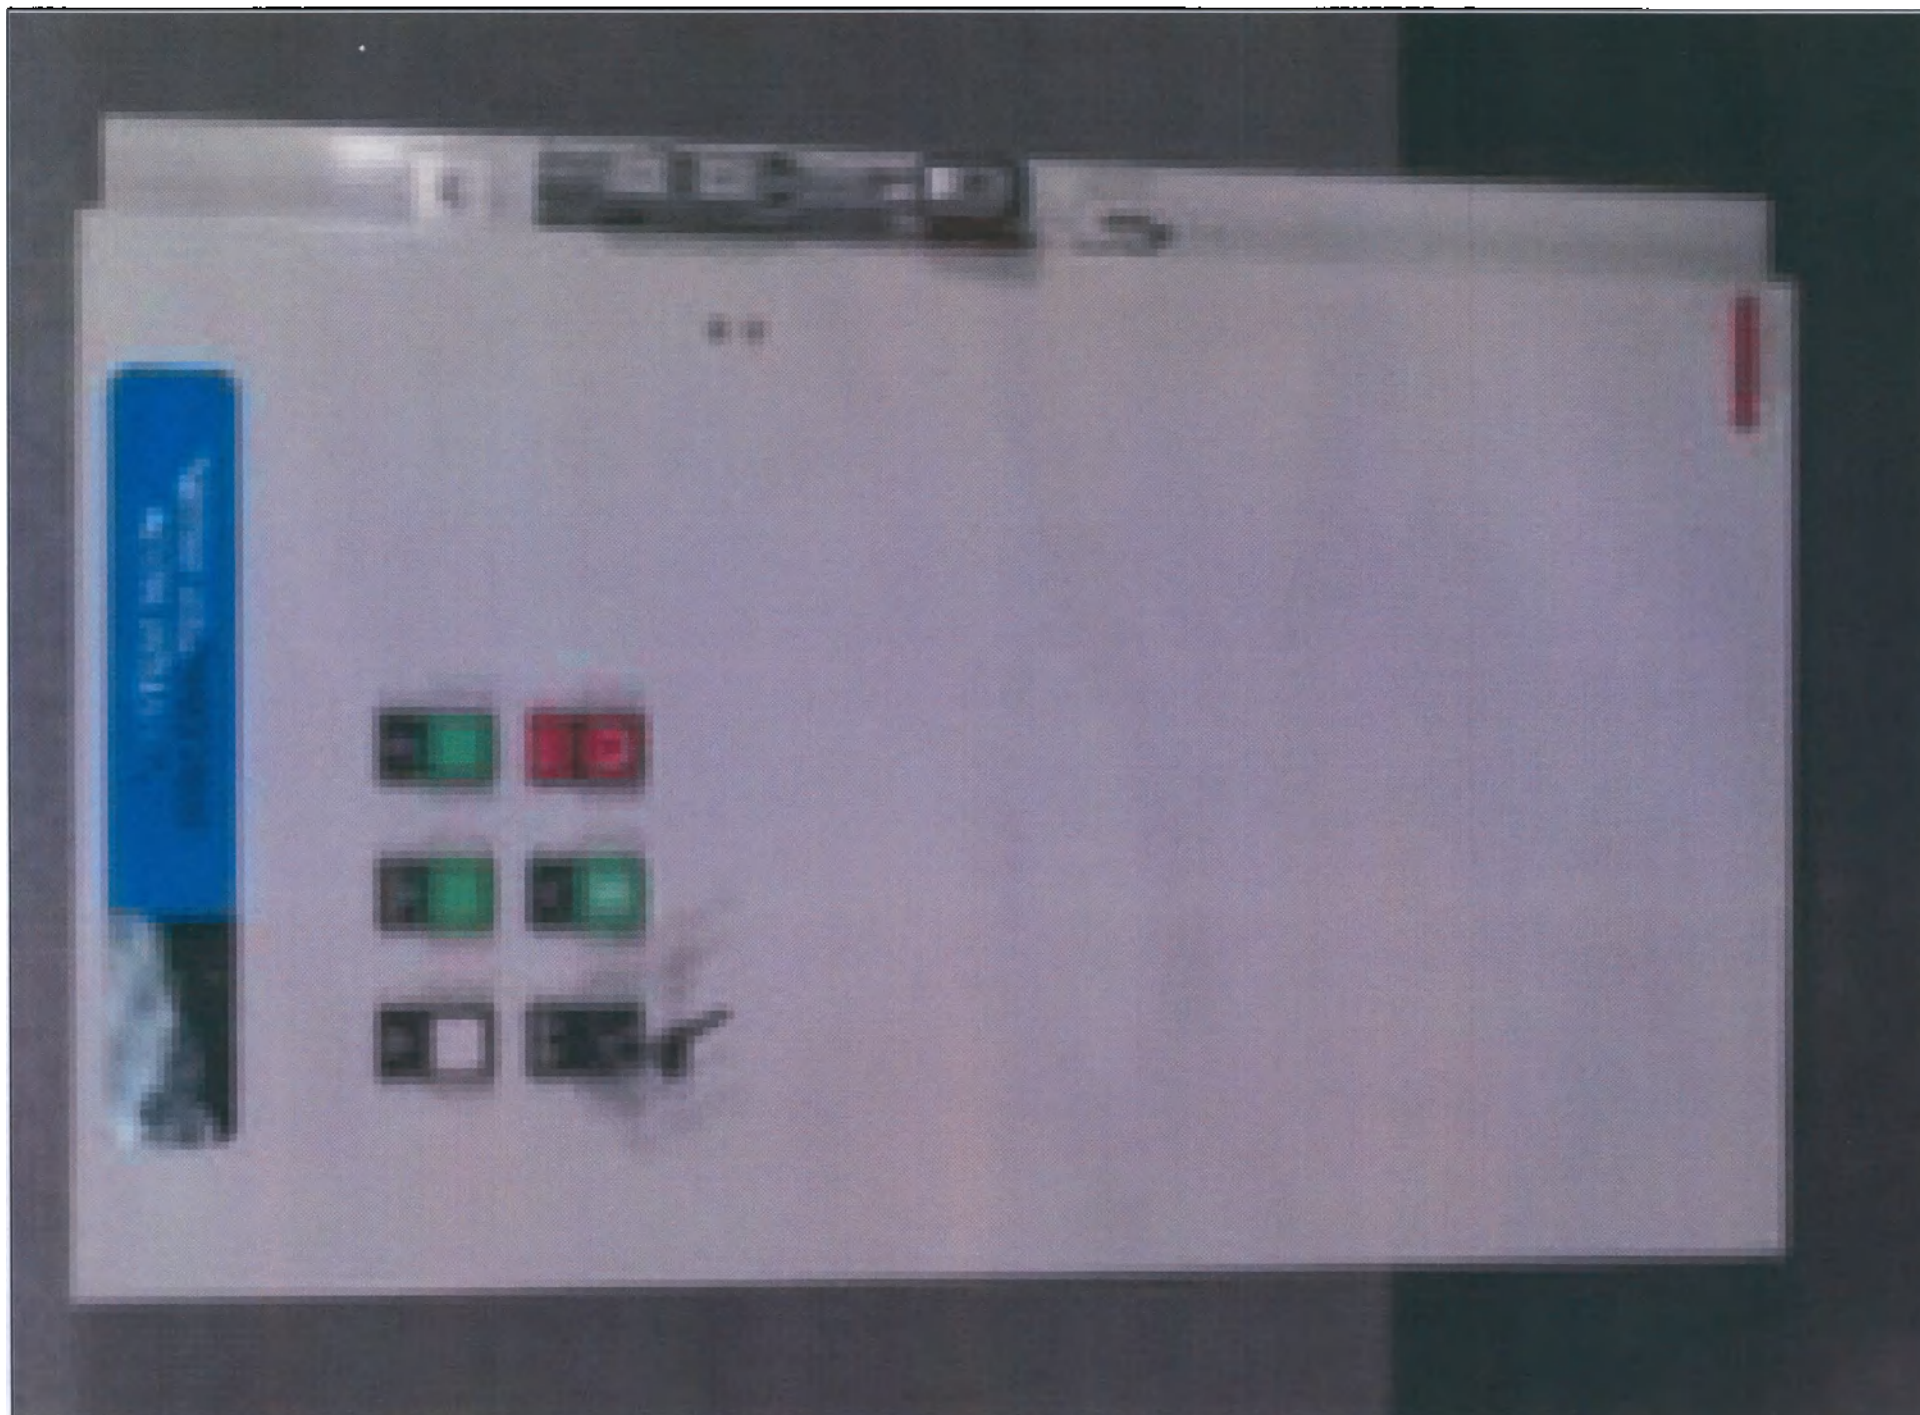


16. Коробки распределительные (не более 4 шт.) (при необходимости).




17. Программные пакеты для консоли управления (не более 60 шт.) (при необходимости).




18. Программные пакеты для рабочей станции (не более 60 шт.) (при необходимости).

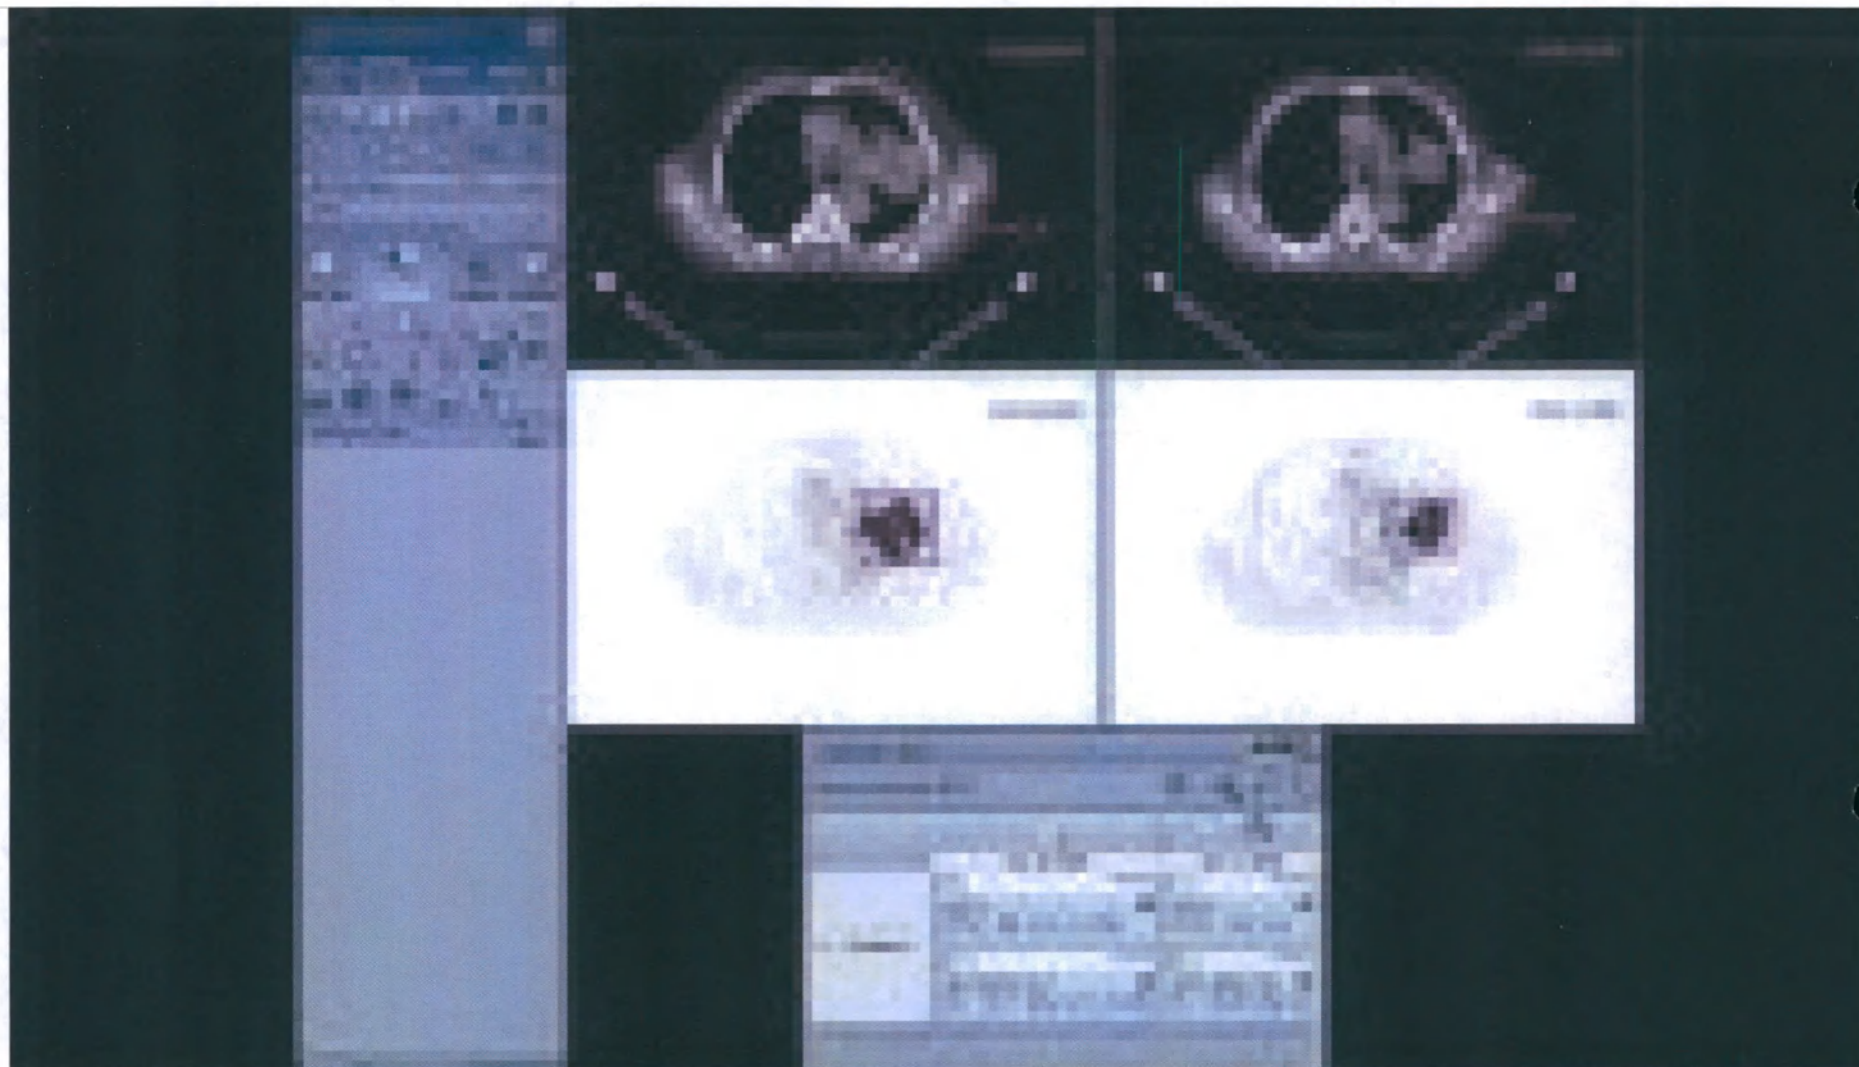


18. Программные пакеты для рабочей станции (не более 60 шт.) (при необходимости).

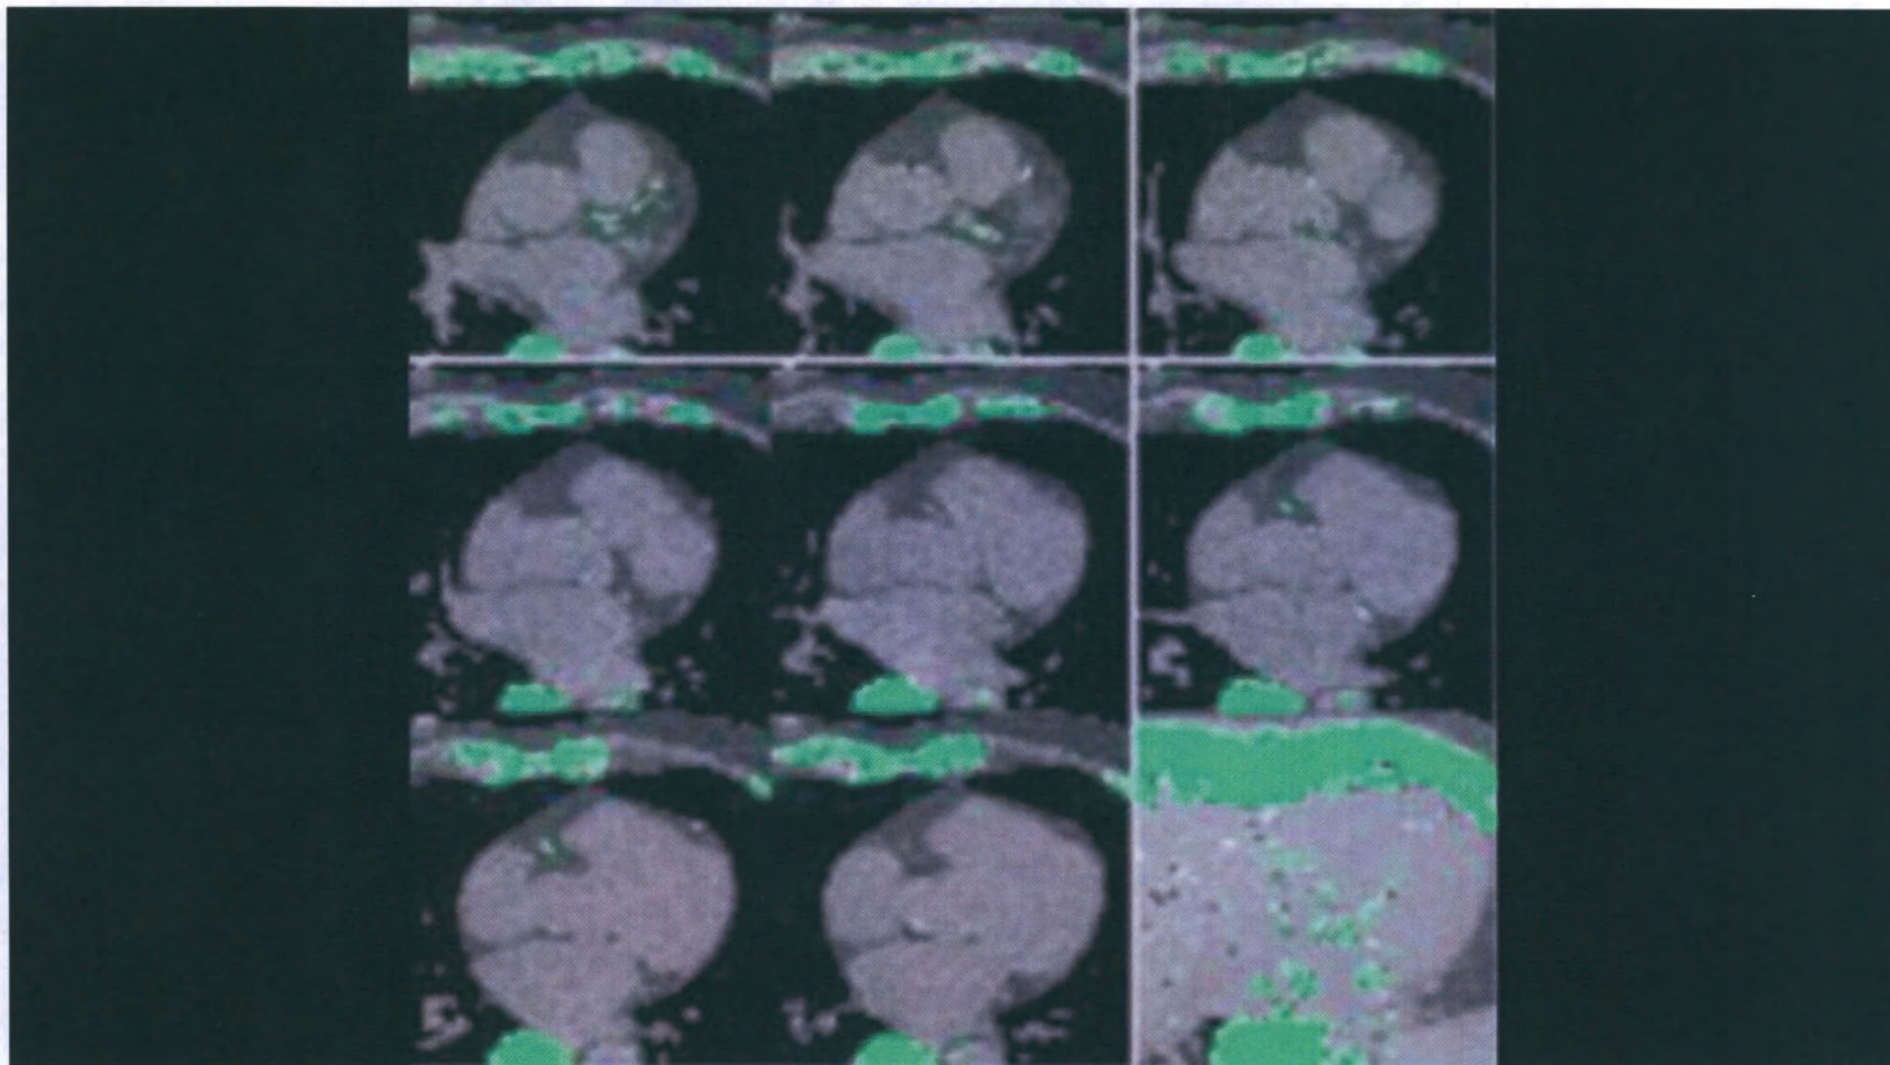


18. Программные пакеты для рабочей станции (не более 60 шт.) (при необходимости).

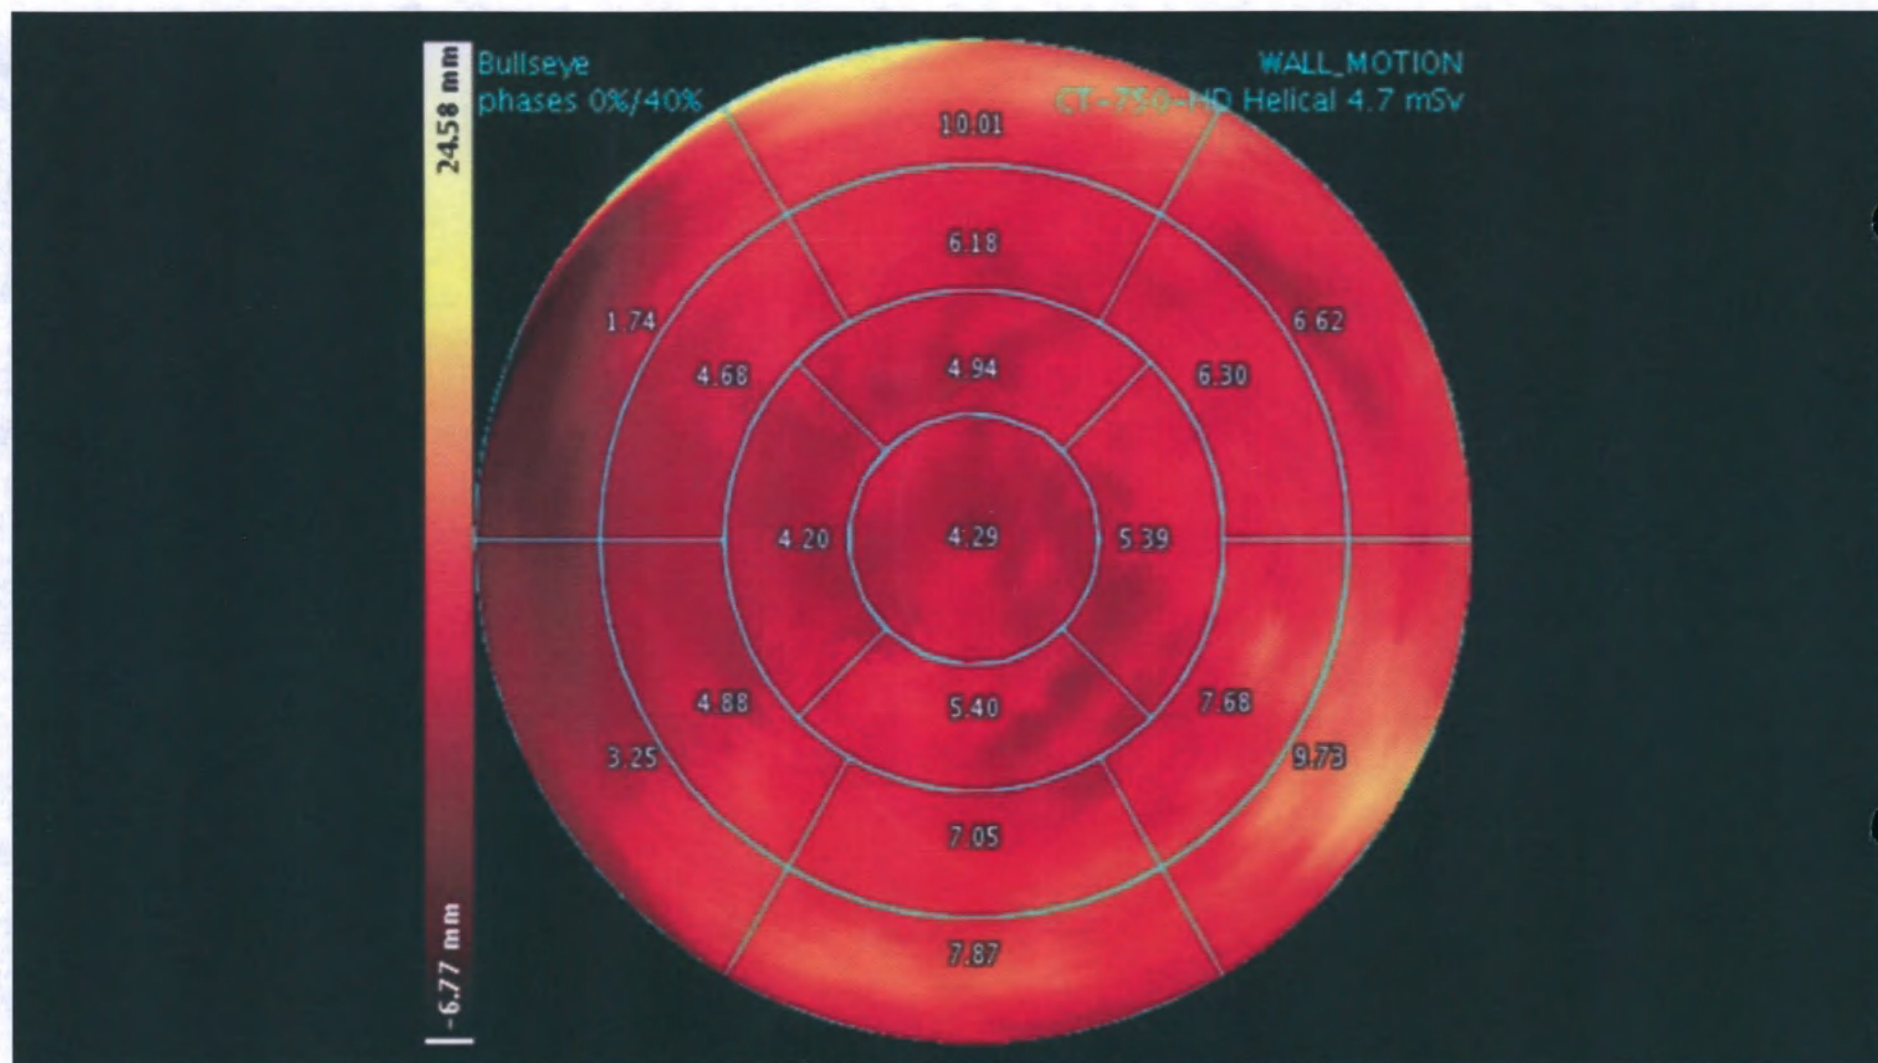


18. Программные пакеты для рабочей станции (не более 60 шт.) (при необходимости).

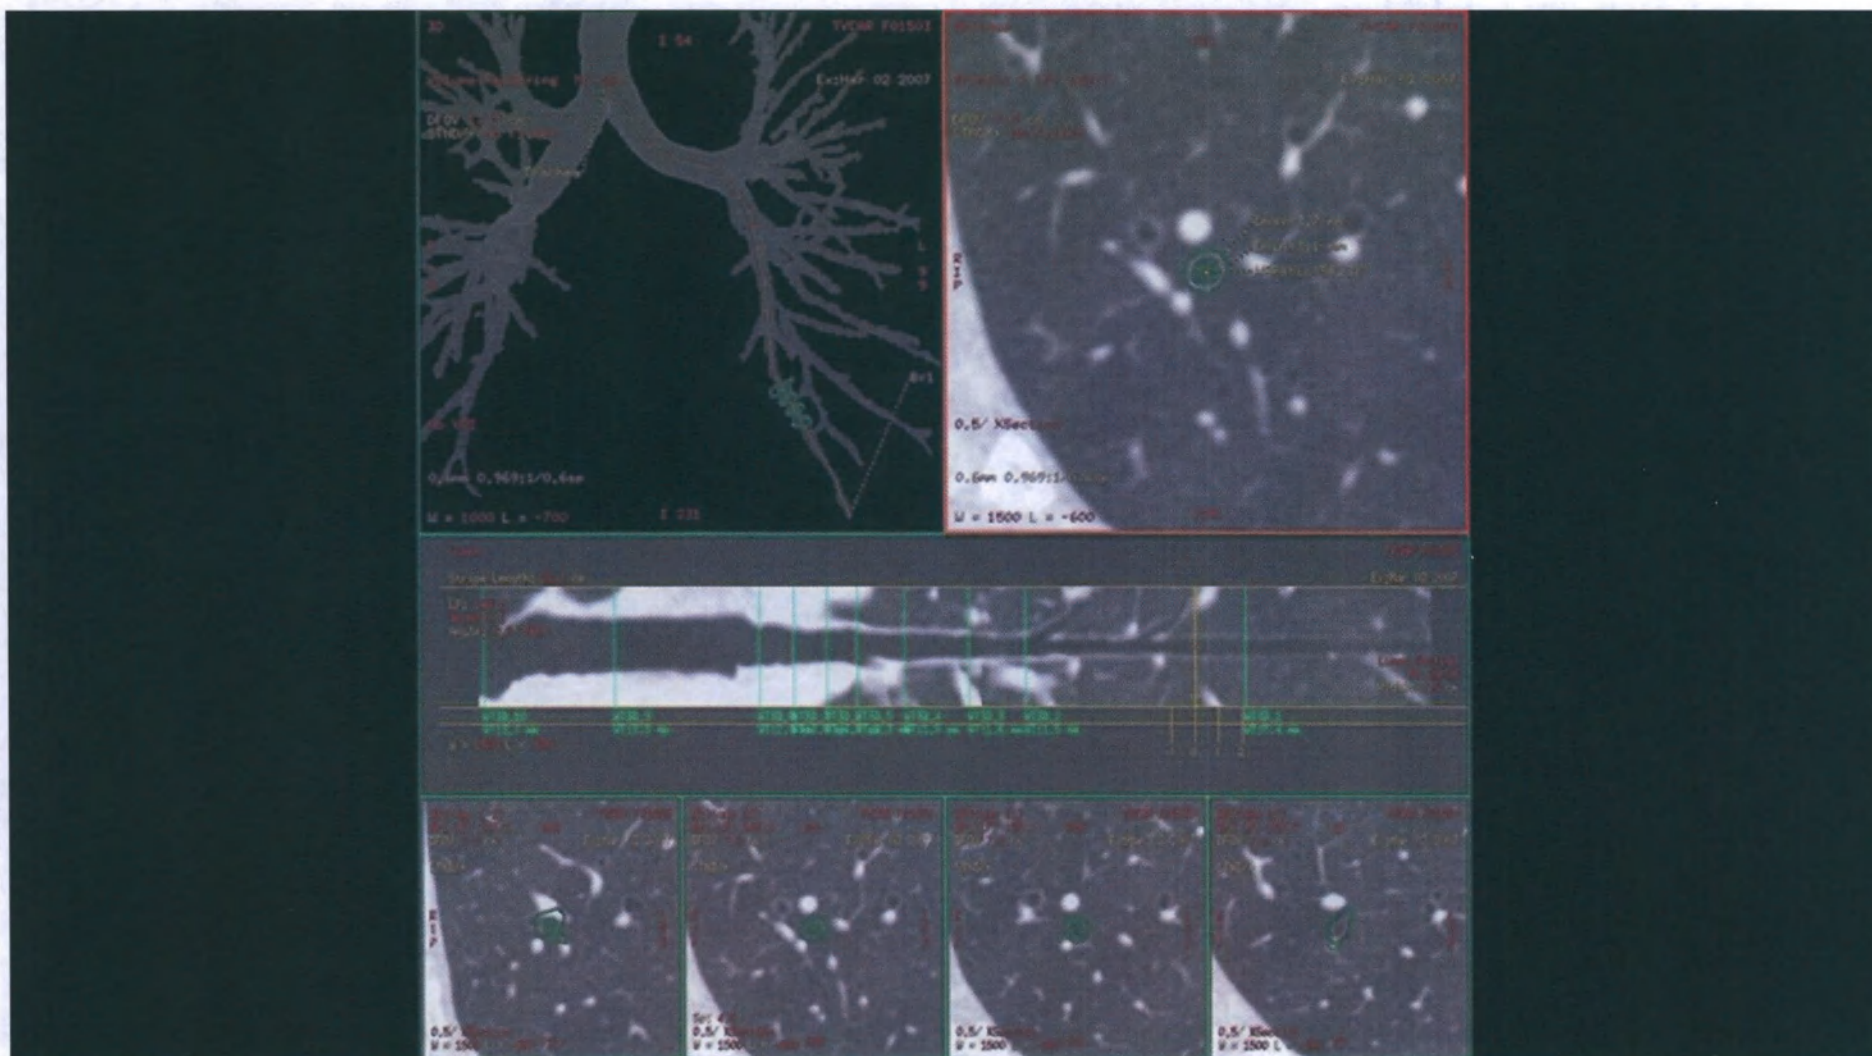


18. Программные пакеты для рабочей станции (не более 60 шт.) (при необходимости).

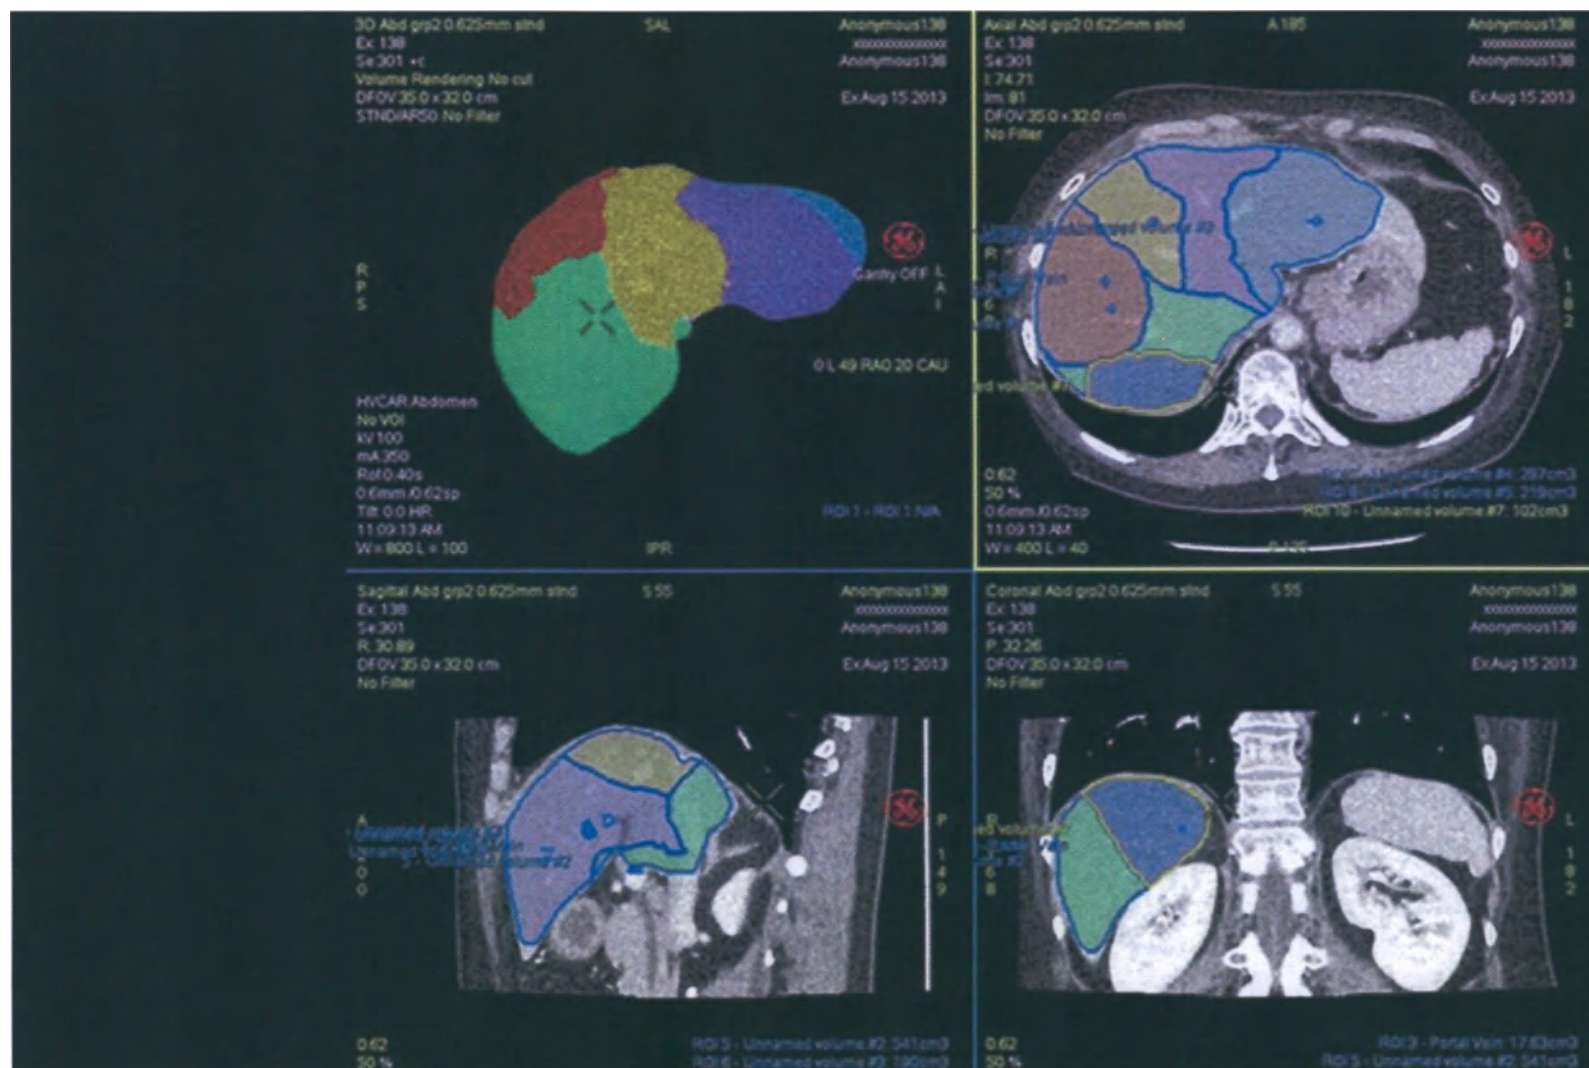


18. Программные пакеты для рабочей станции (не более 60 шт.) (при необходимости).

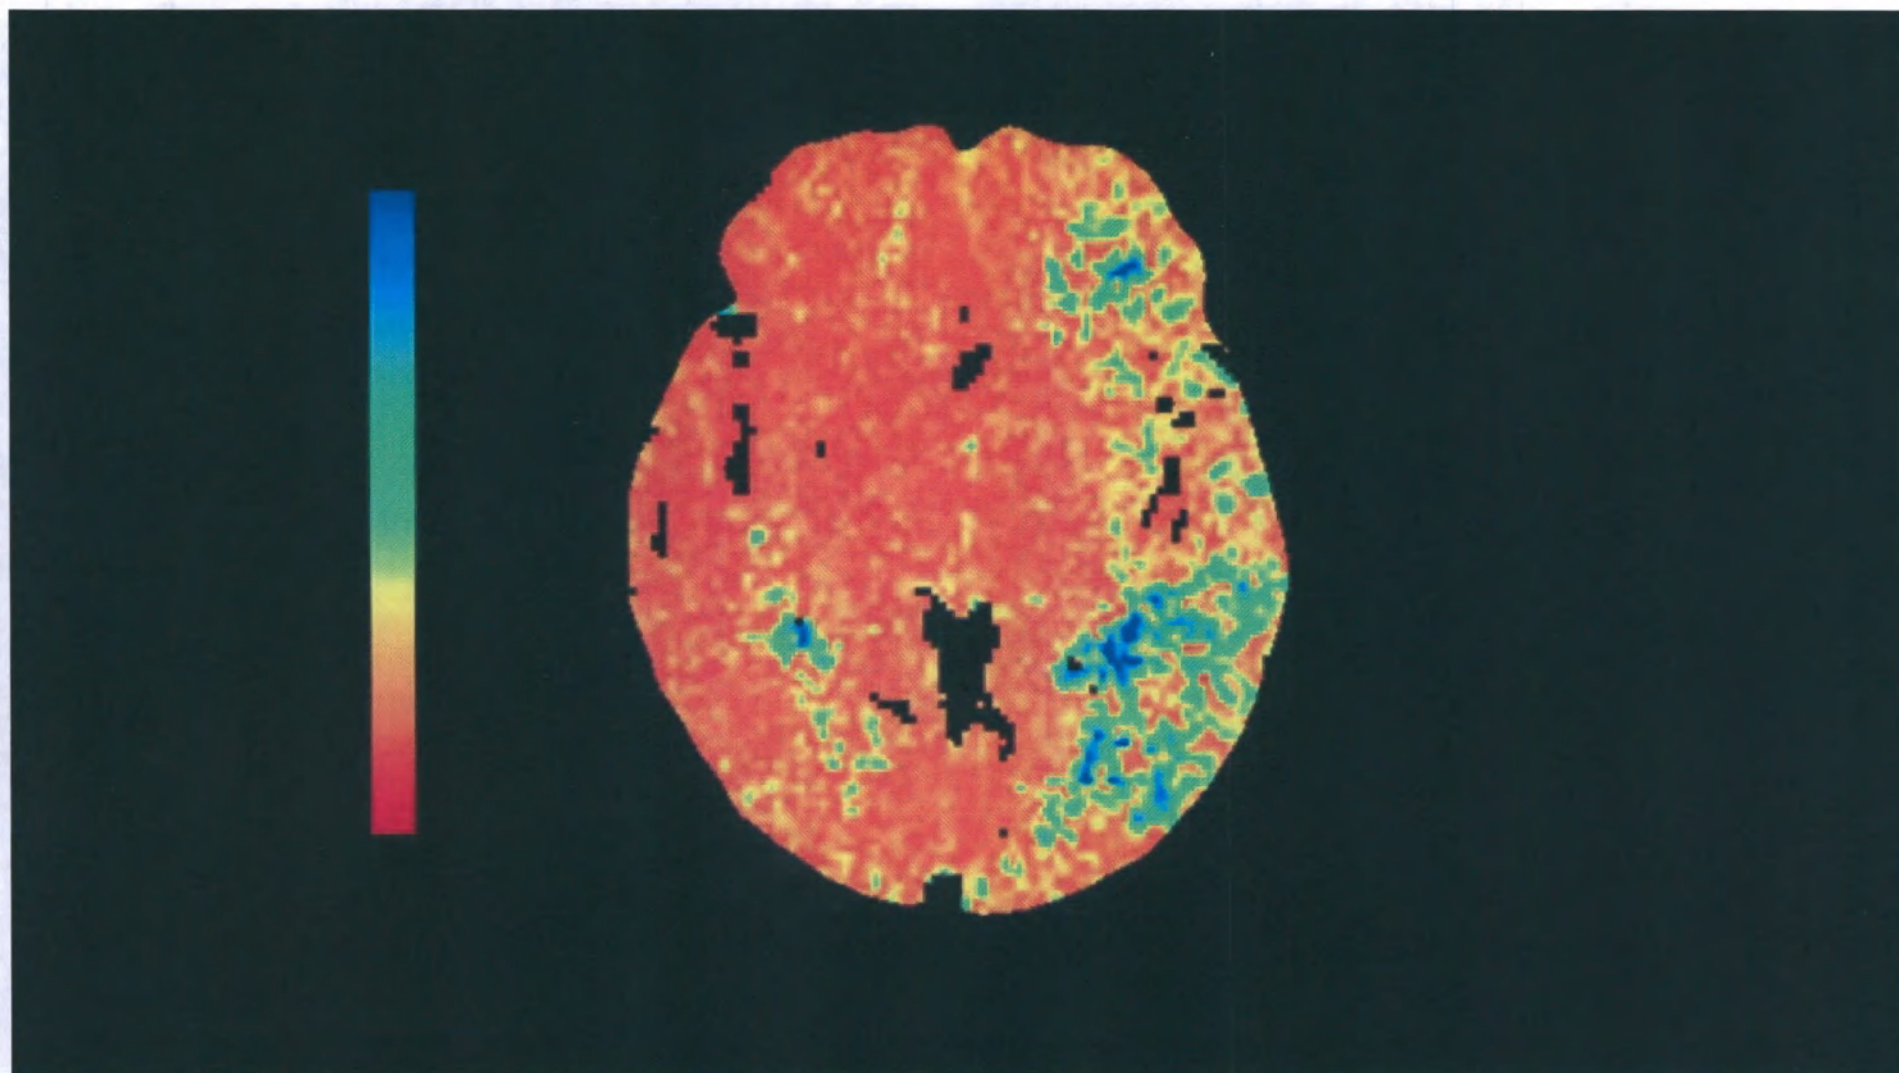


18. Программные пакеты для рабочей станции (не более 60 шт.) (при необходимости).

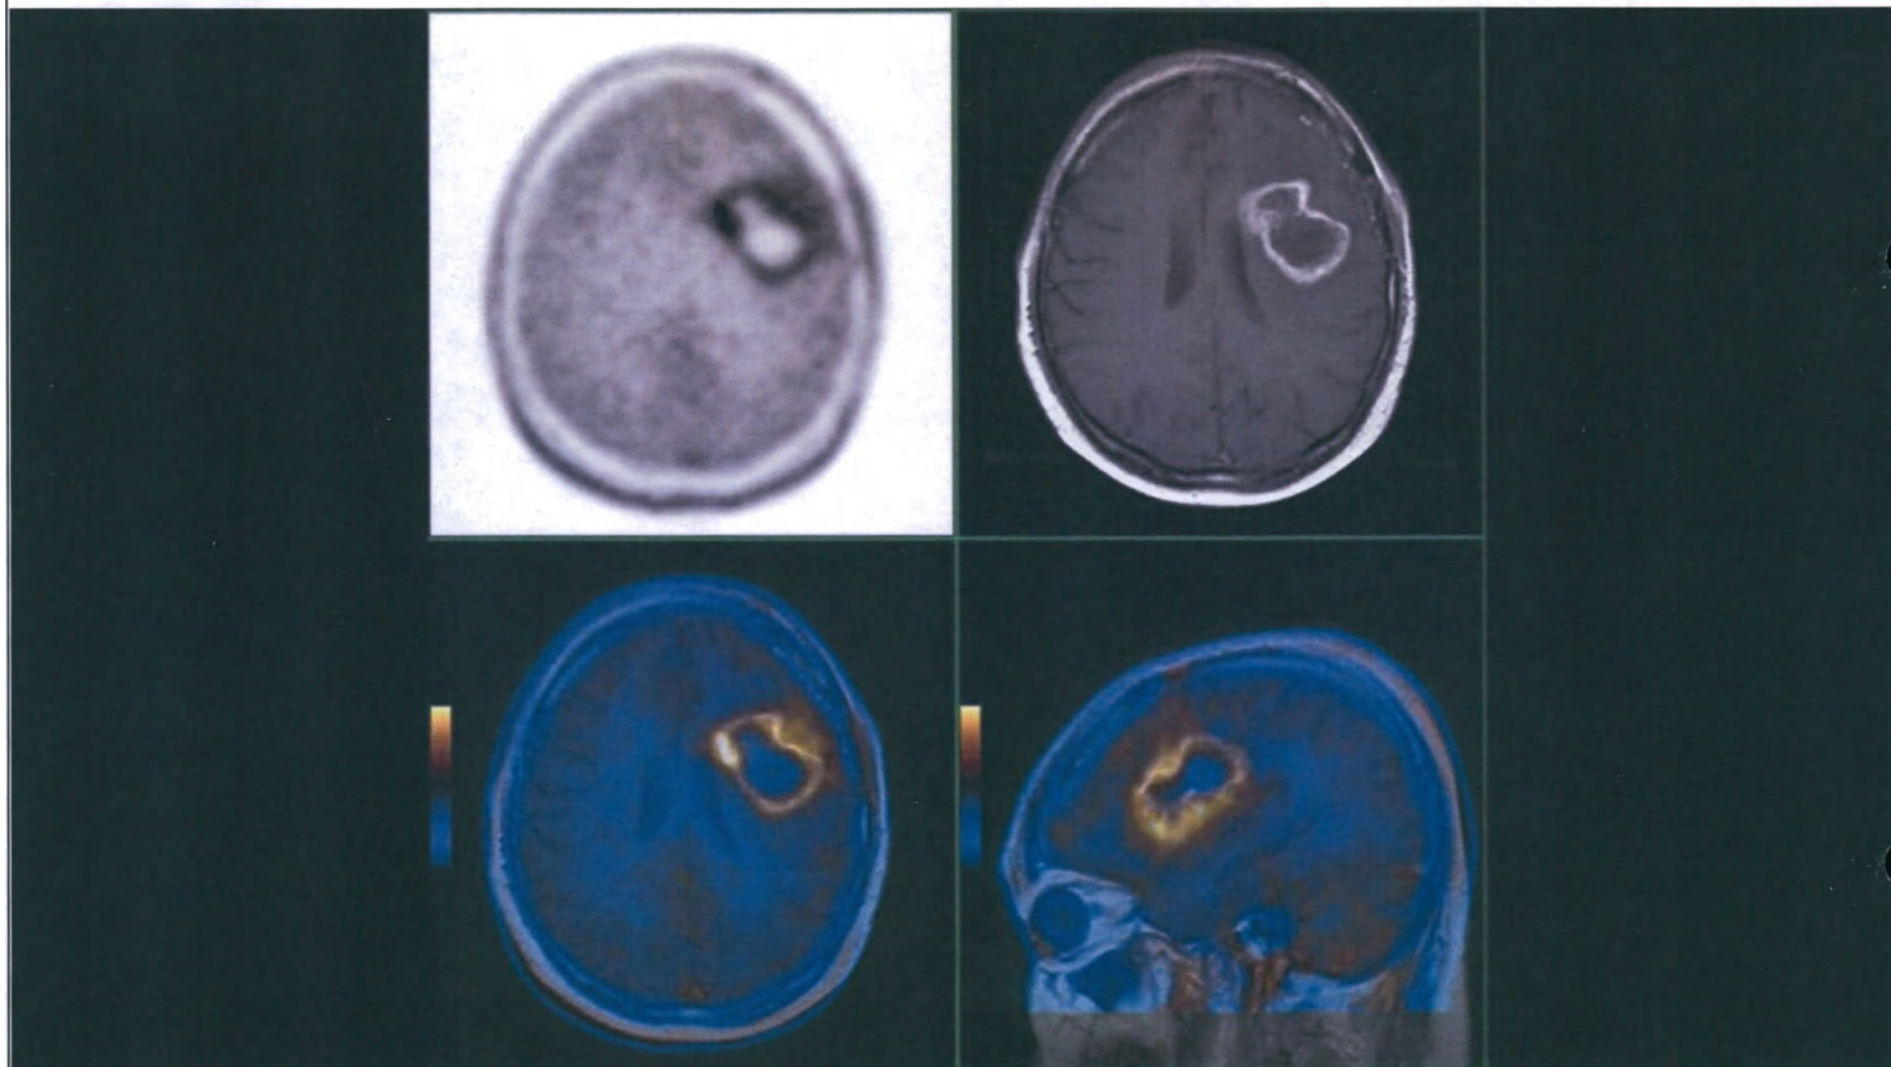


18. Программные пакеты для рабочей станции (не более 60 шт.) (при необходимости).

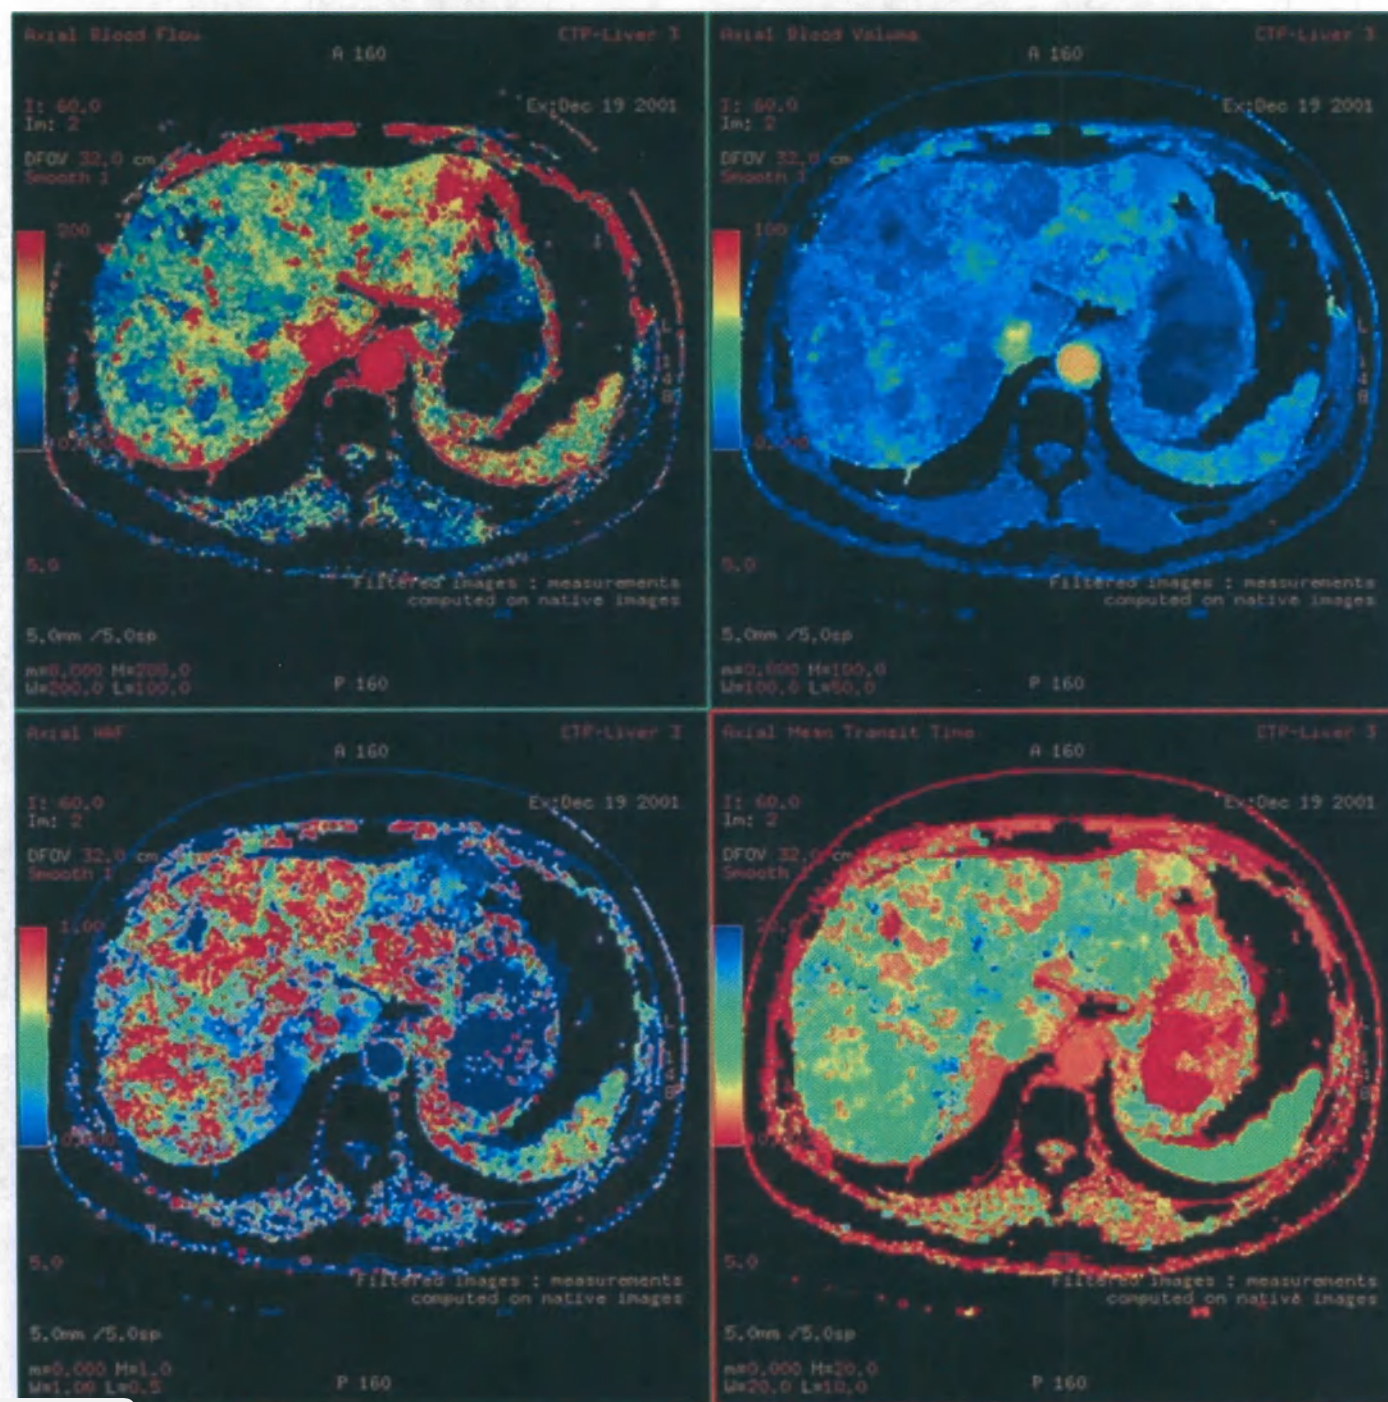


18. Программные пакеты для рабочей станции (не более 60 шт.) (при необходимости).

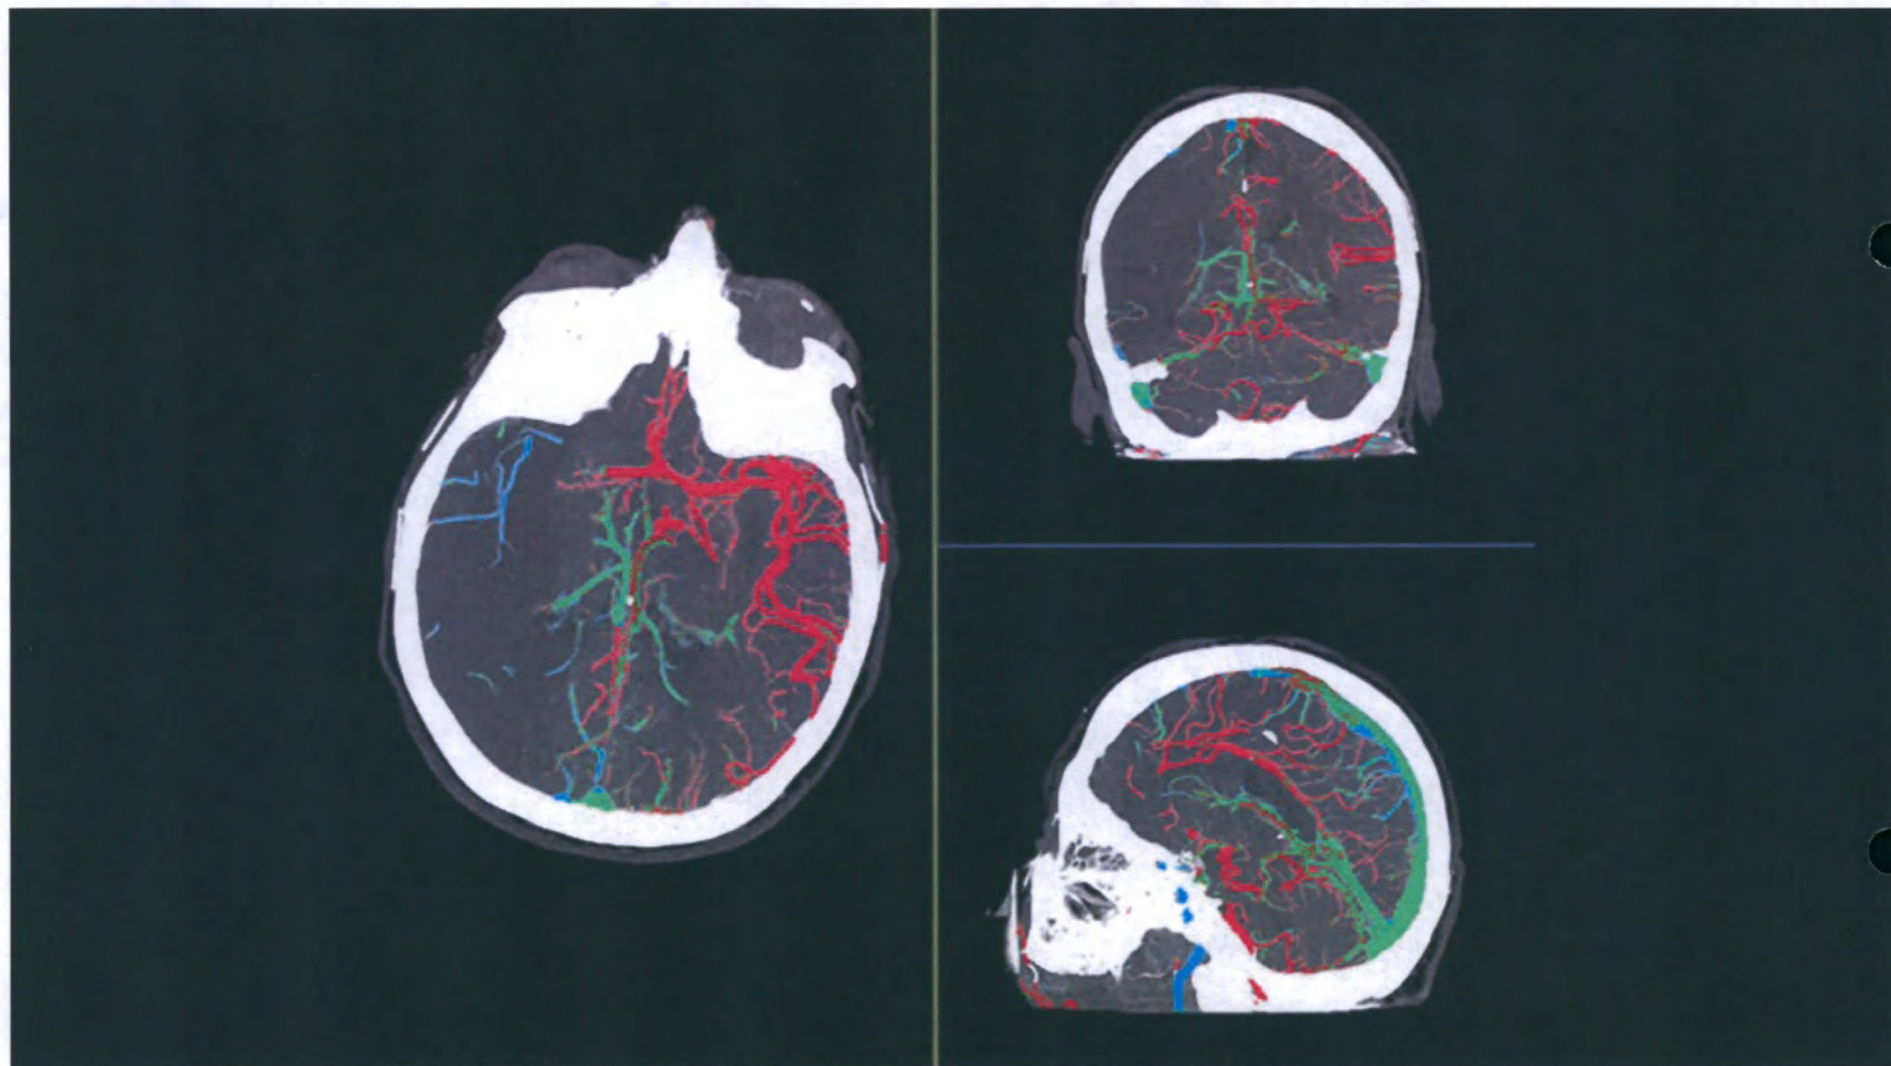


18. Программные пакеты для рабочей станции (не более 60 шт.) (при необходимости).

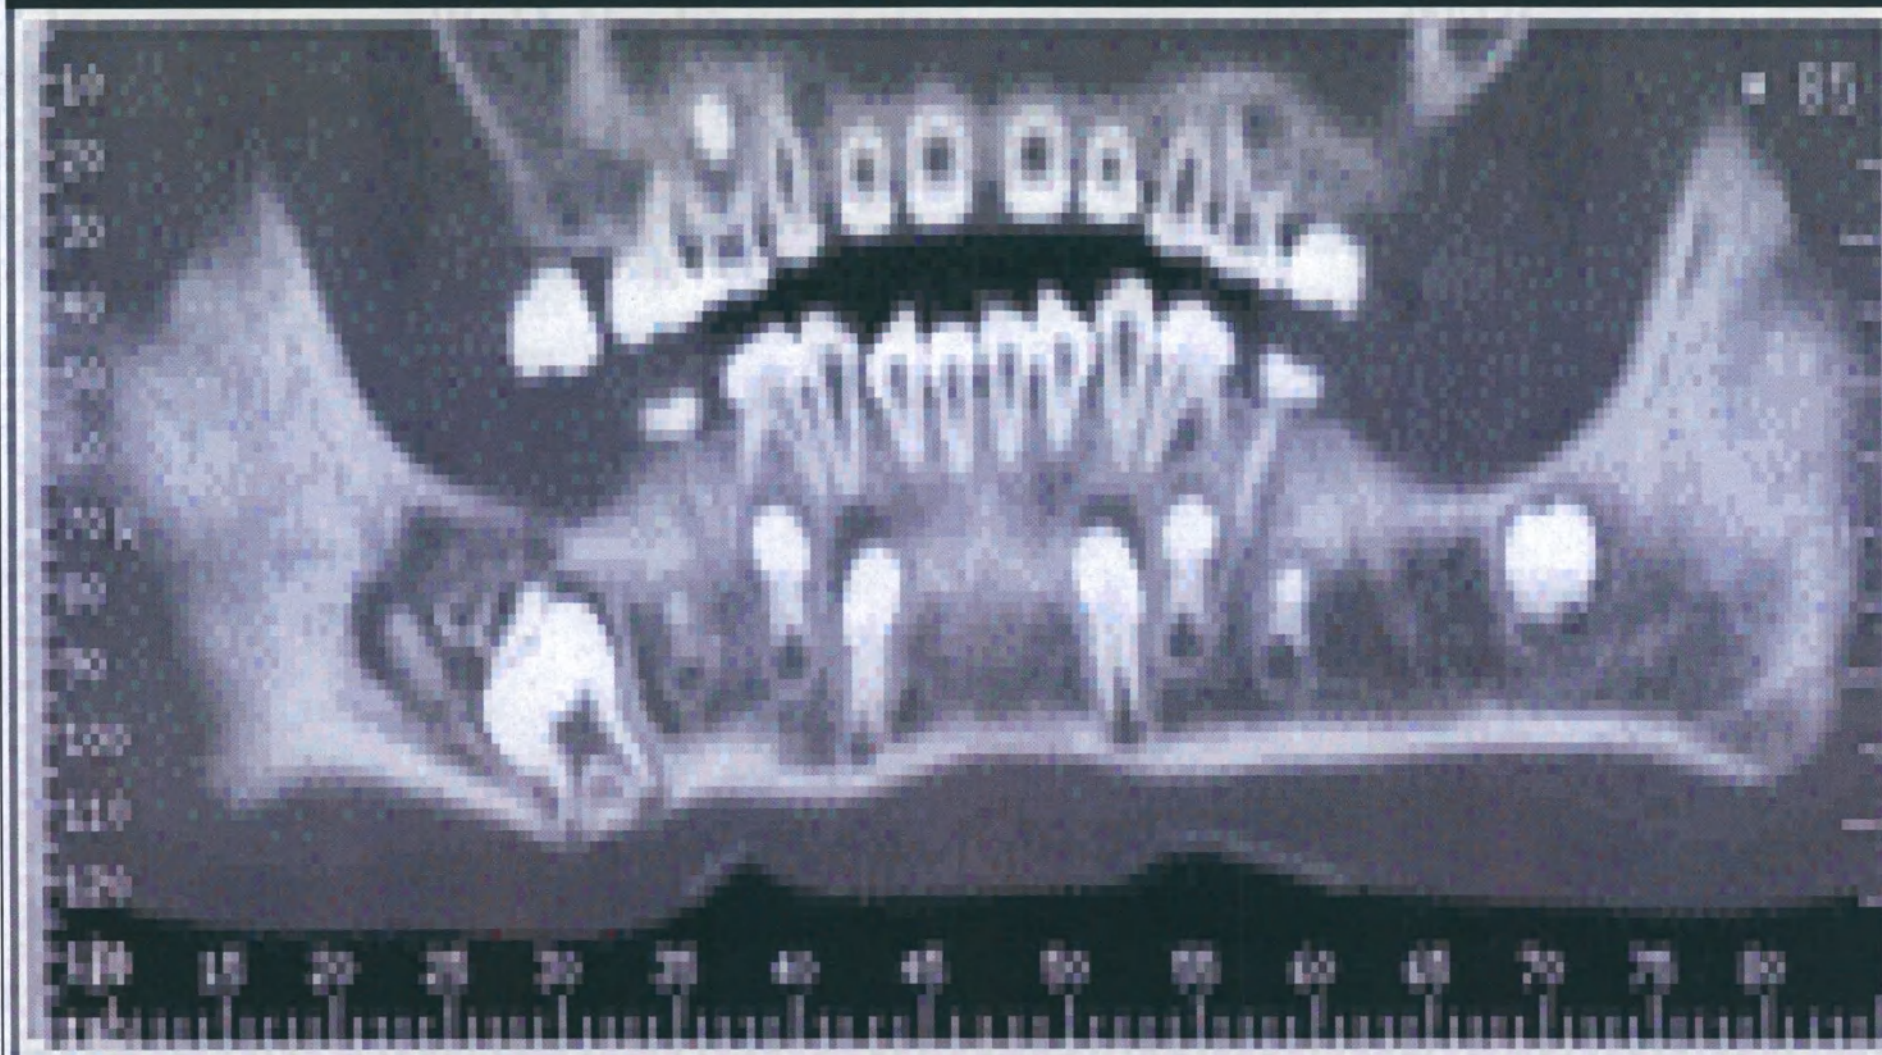


18. Программные пакеты для рабочей станции (не более 60 шт.) (при необходимости).

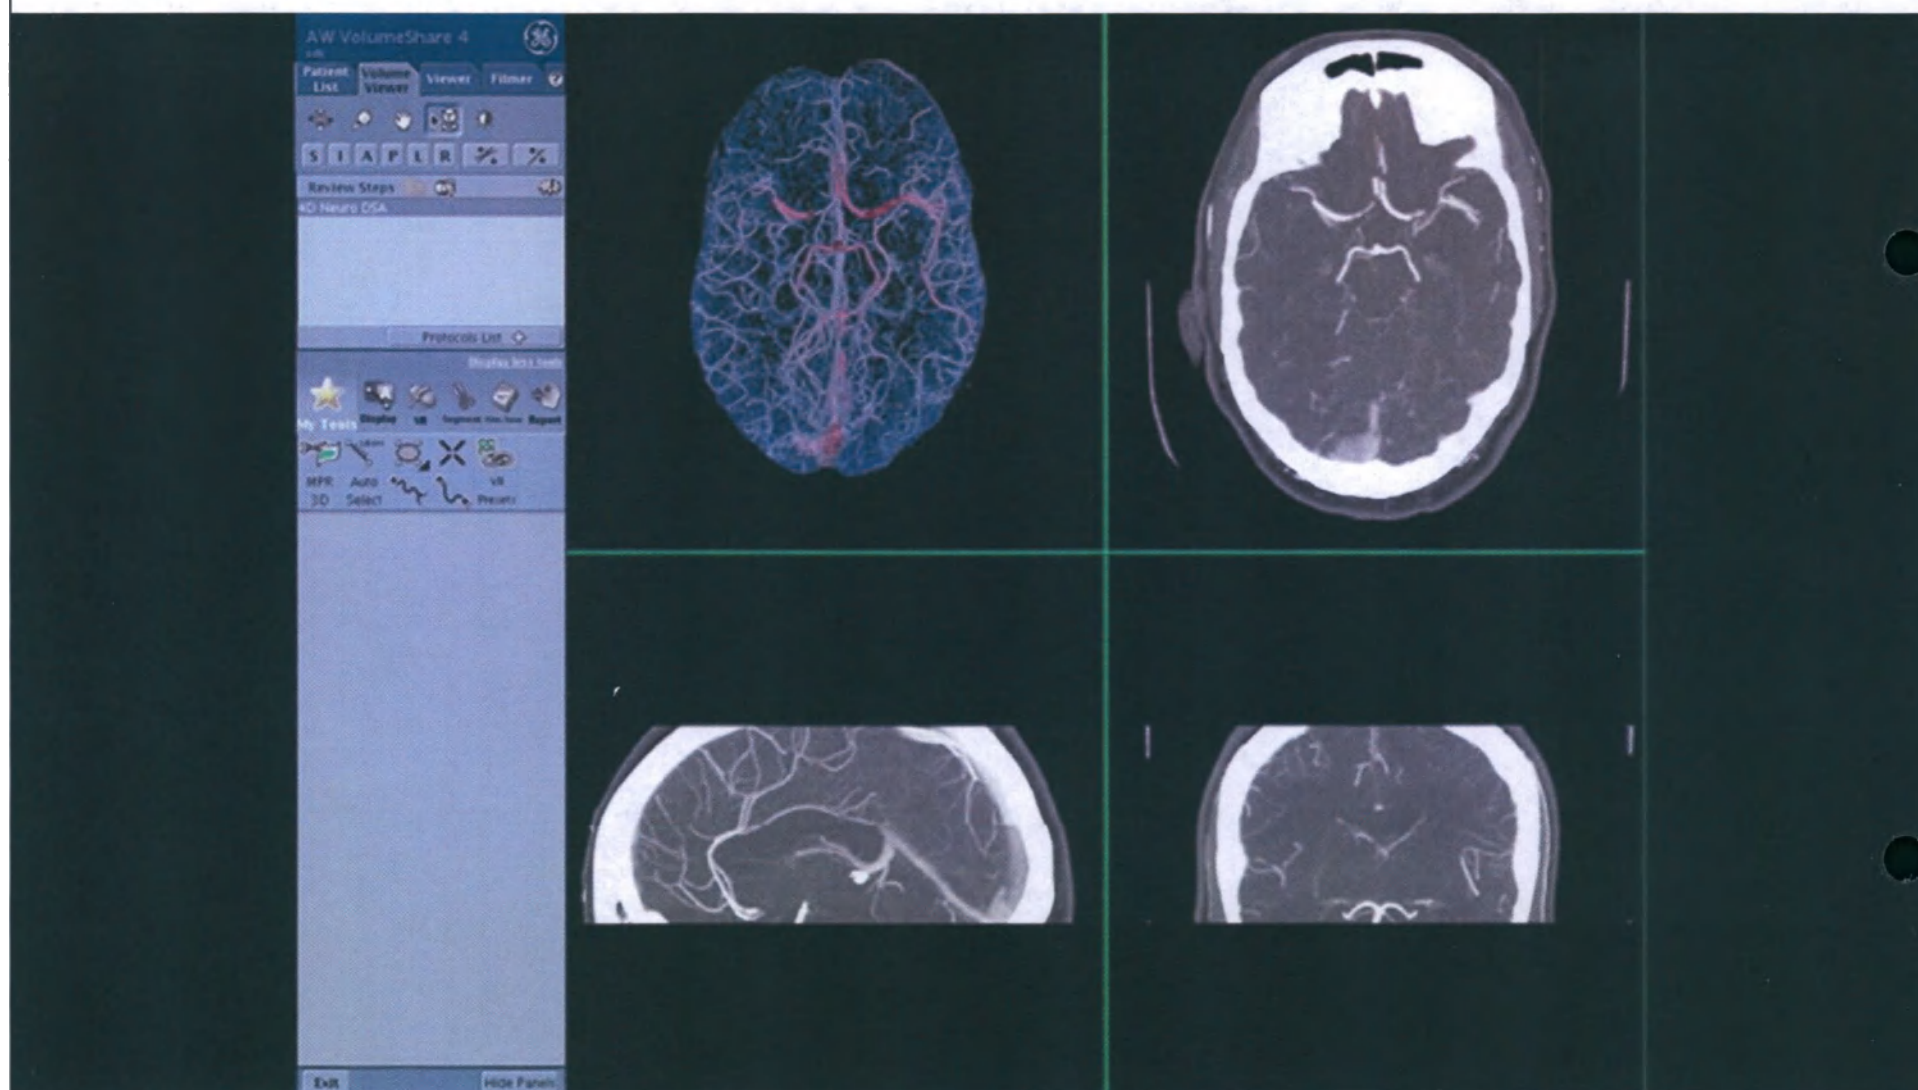


18. Программные пакеты для рабочей станции (не более 60 шт.) (при необходимости).

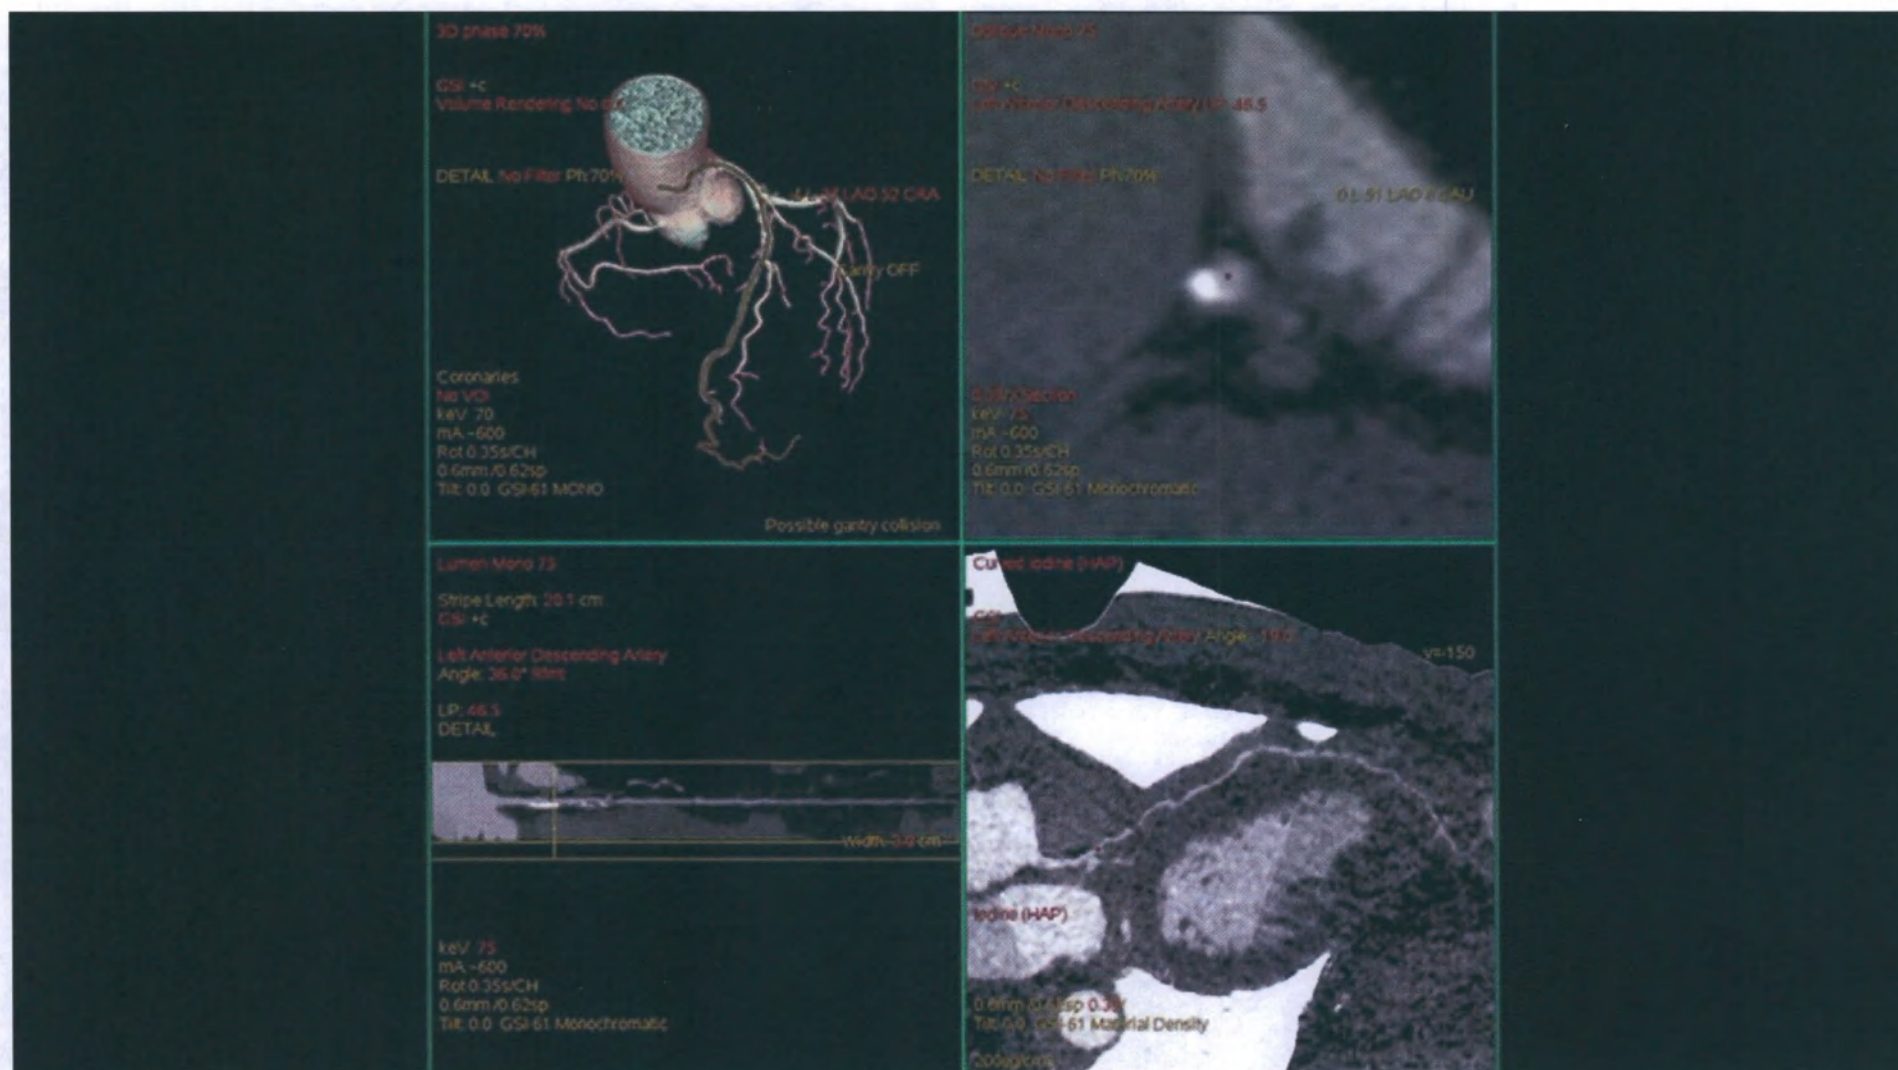


18. Программные пакеты для рабочей станции (не более 60 шт.) (при необходимости).

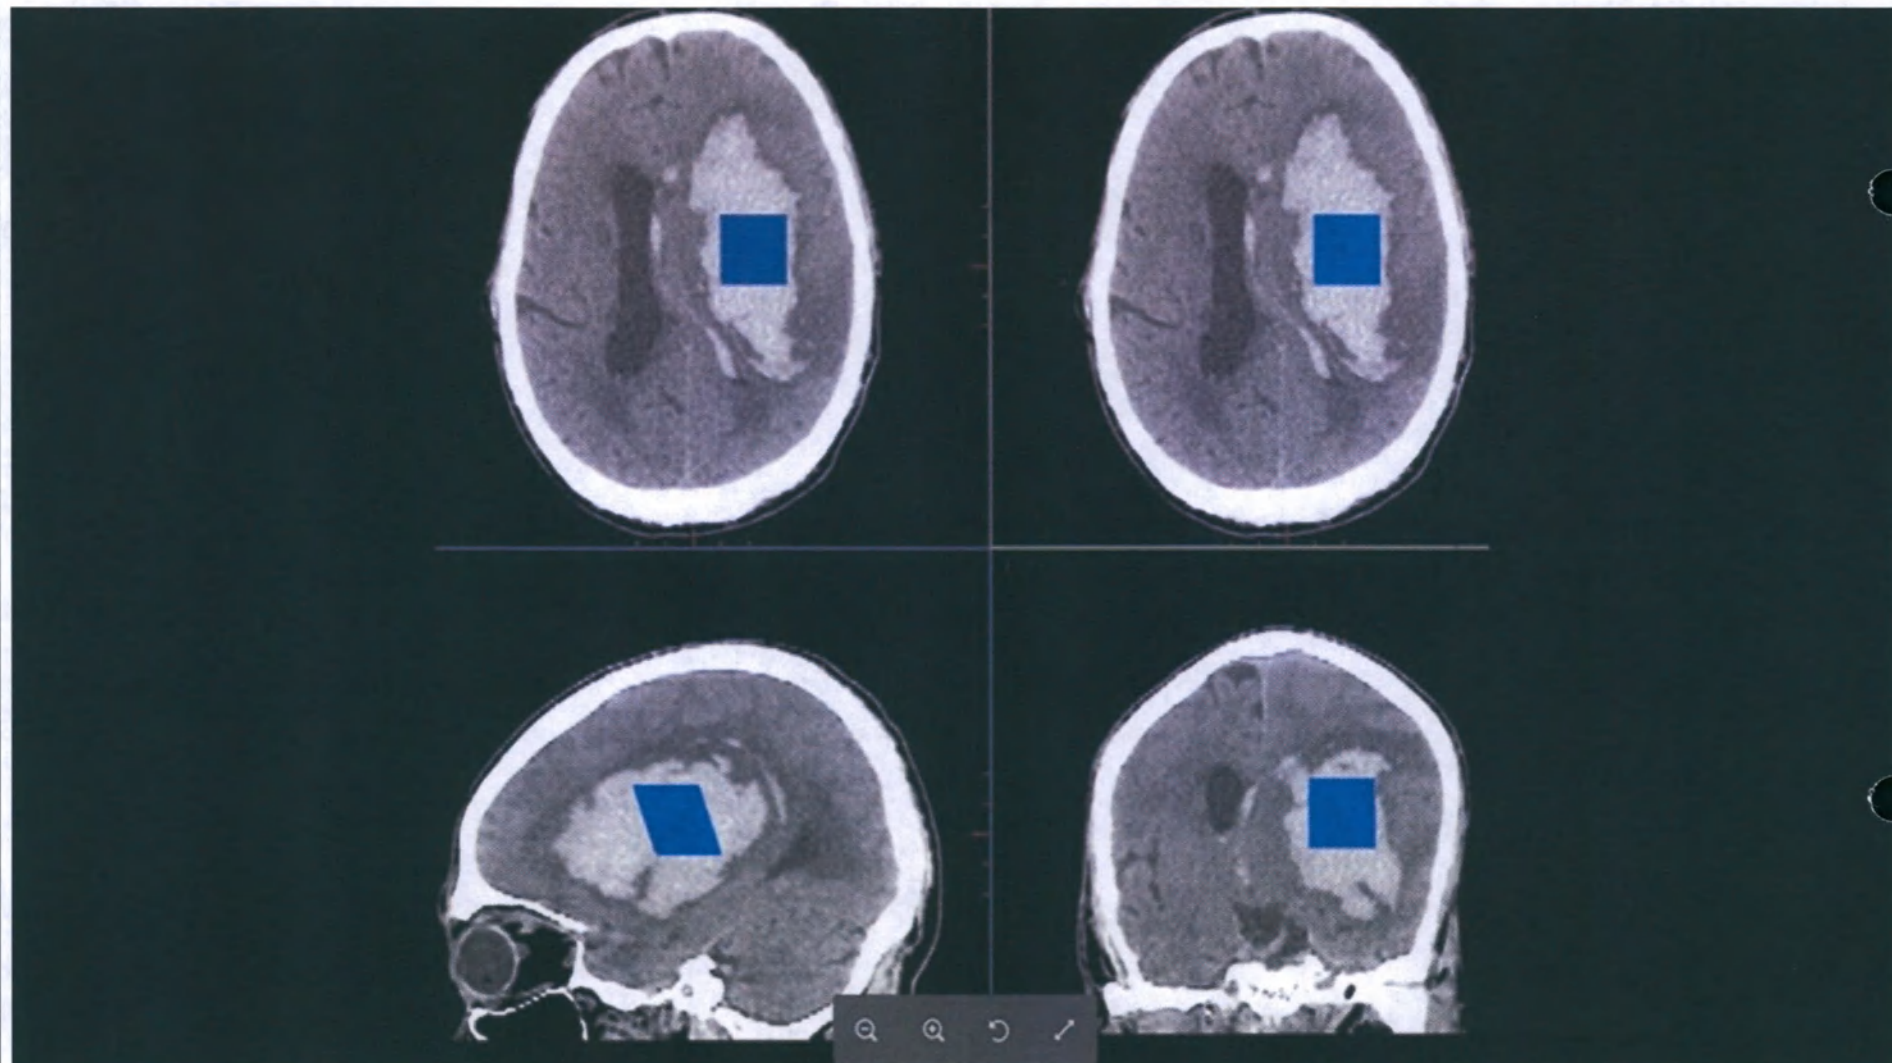


18. Программные пакеты для рабочей станции (не более 60 шт.) (при необходимости).

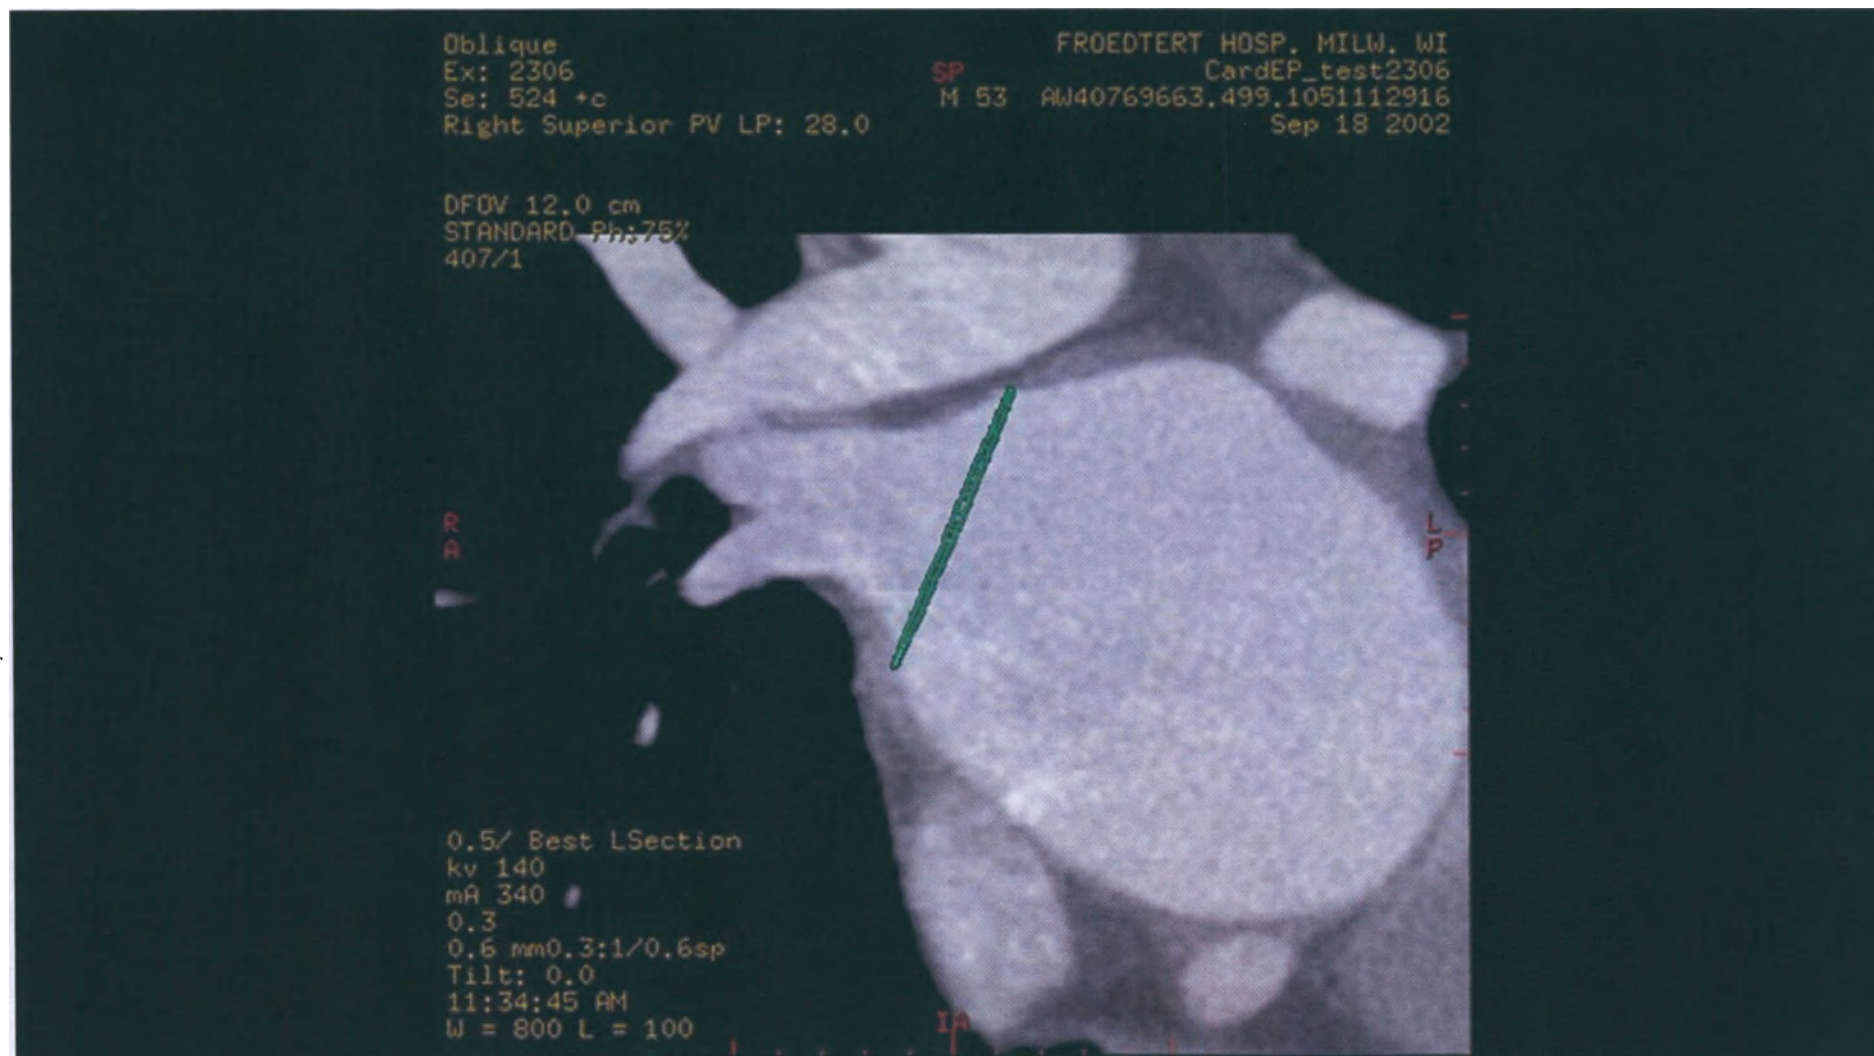


19. Программные пакеты для реконструкции ПЭТ изображений (не более 30 шт.) (при необходимости).

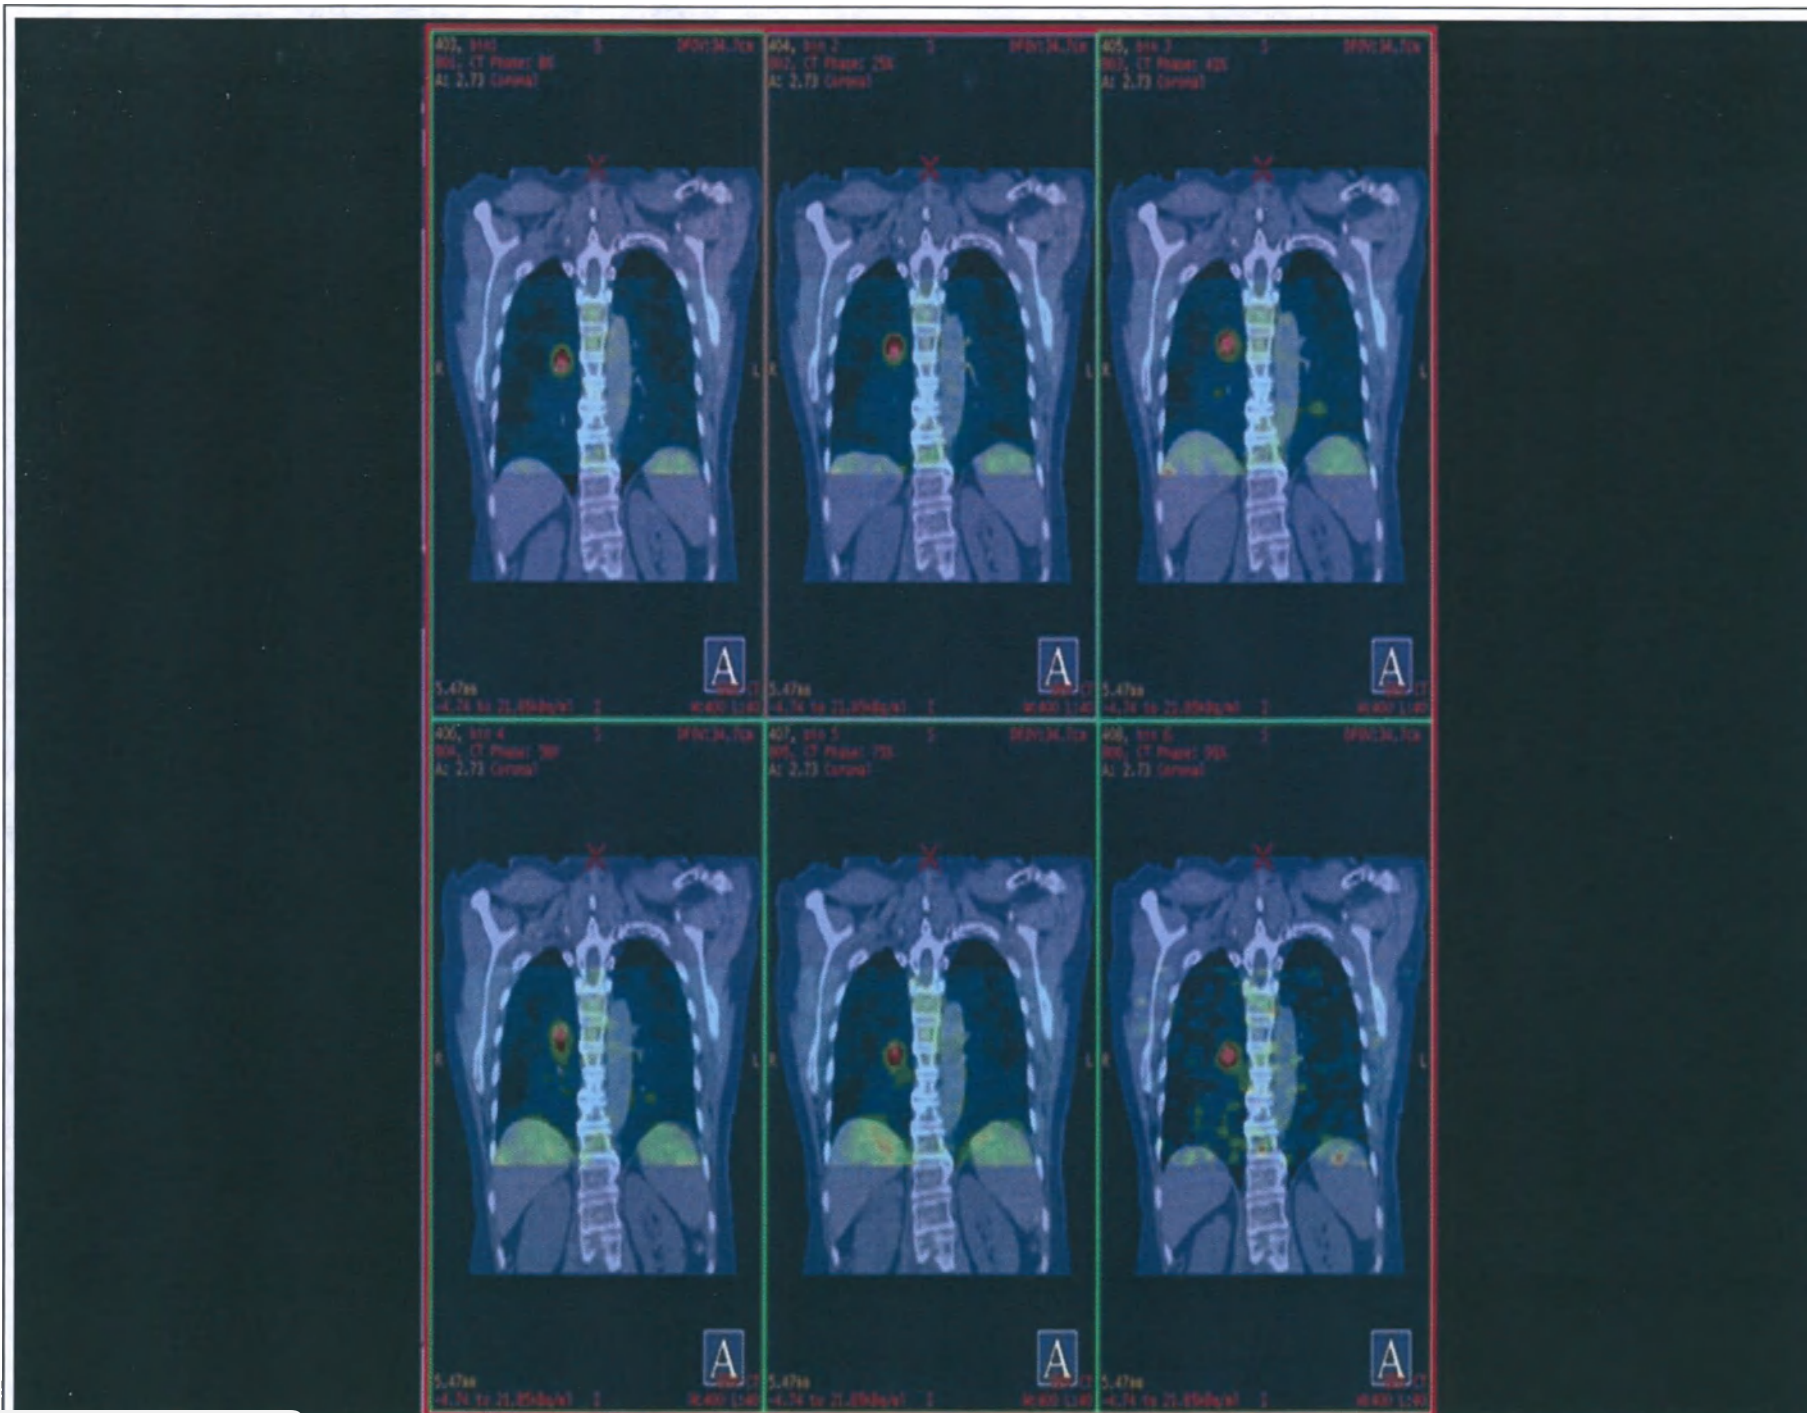


19. Программные пакеты для реконструкции ПЭТ изображений (не более 30 шт.) (при необходимости).

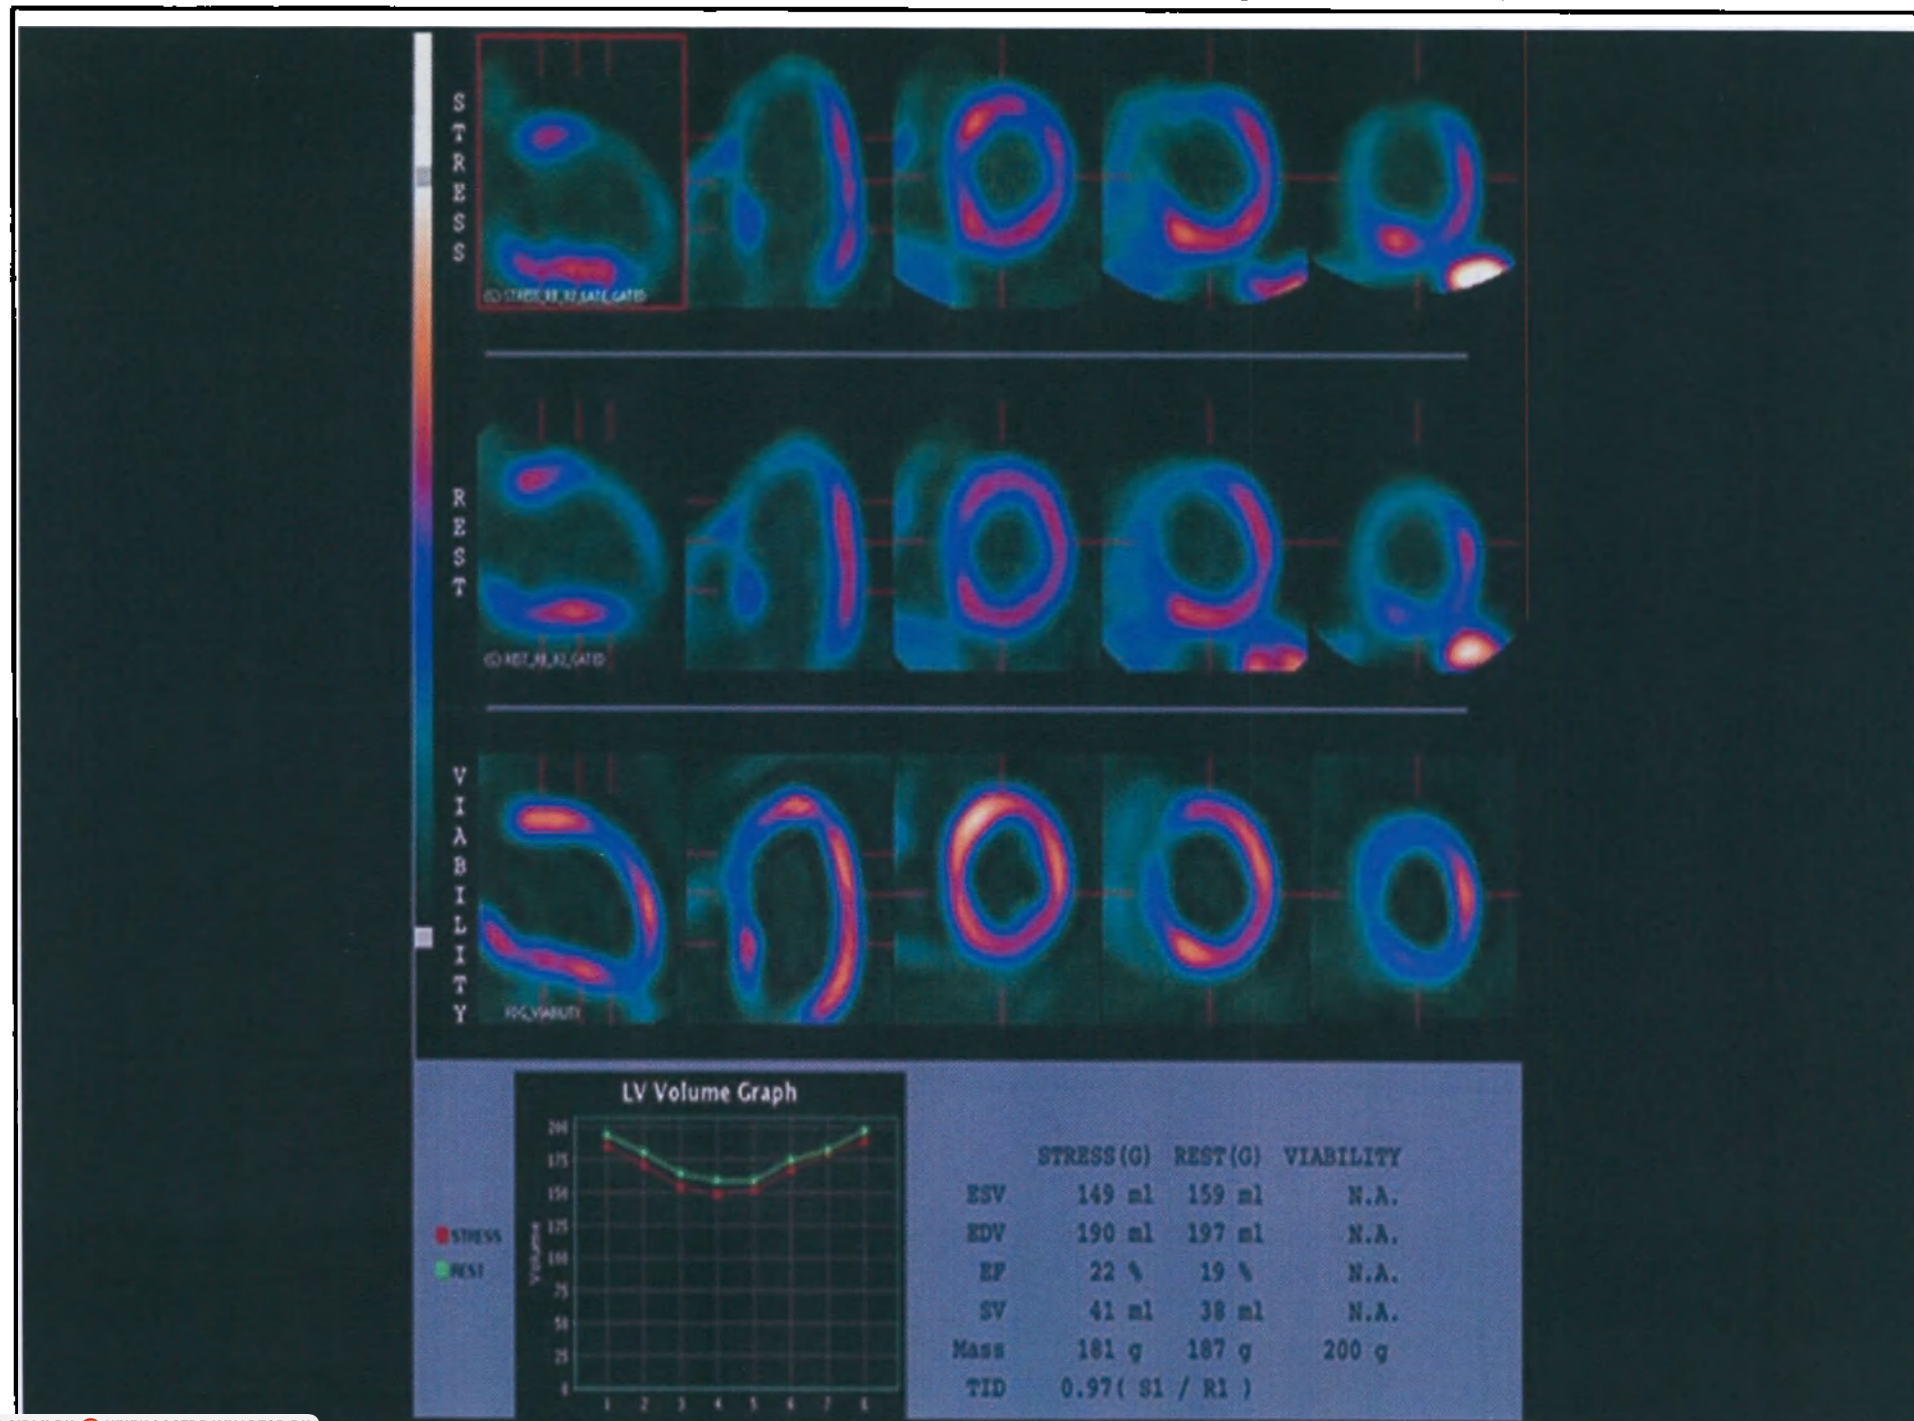


20. Программные пакеты для онкологических исследований (не более 6 шт.) (при необходимости).

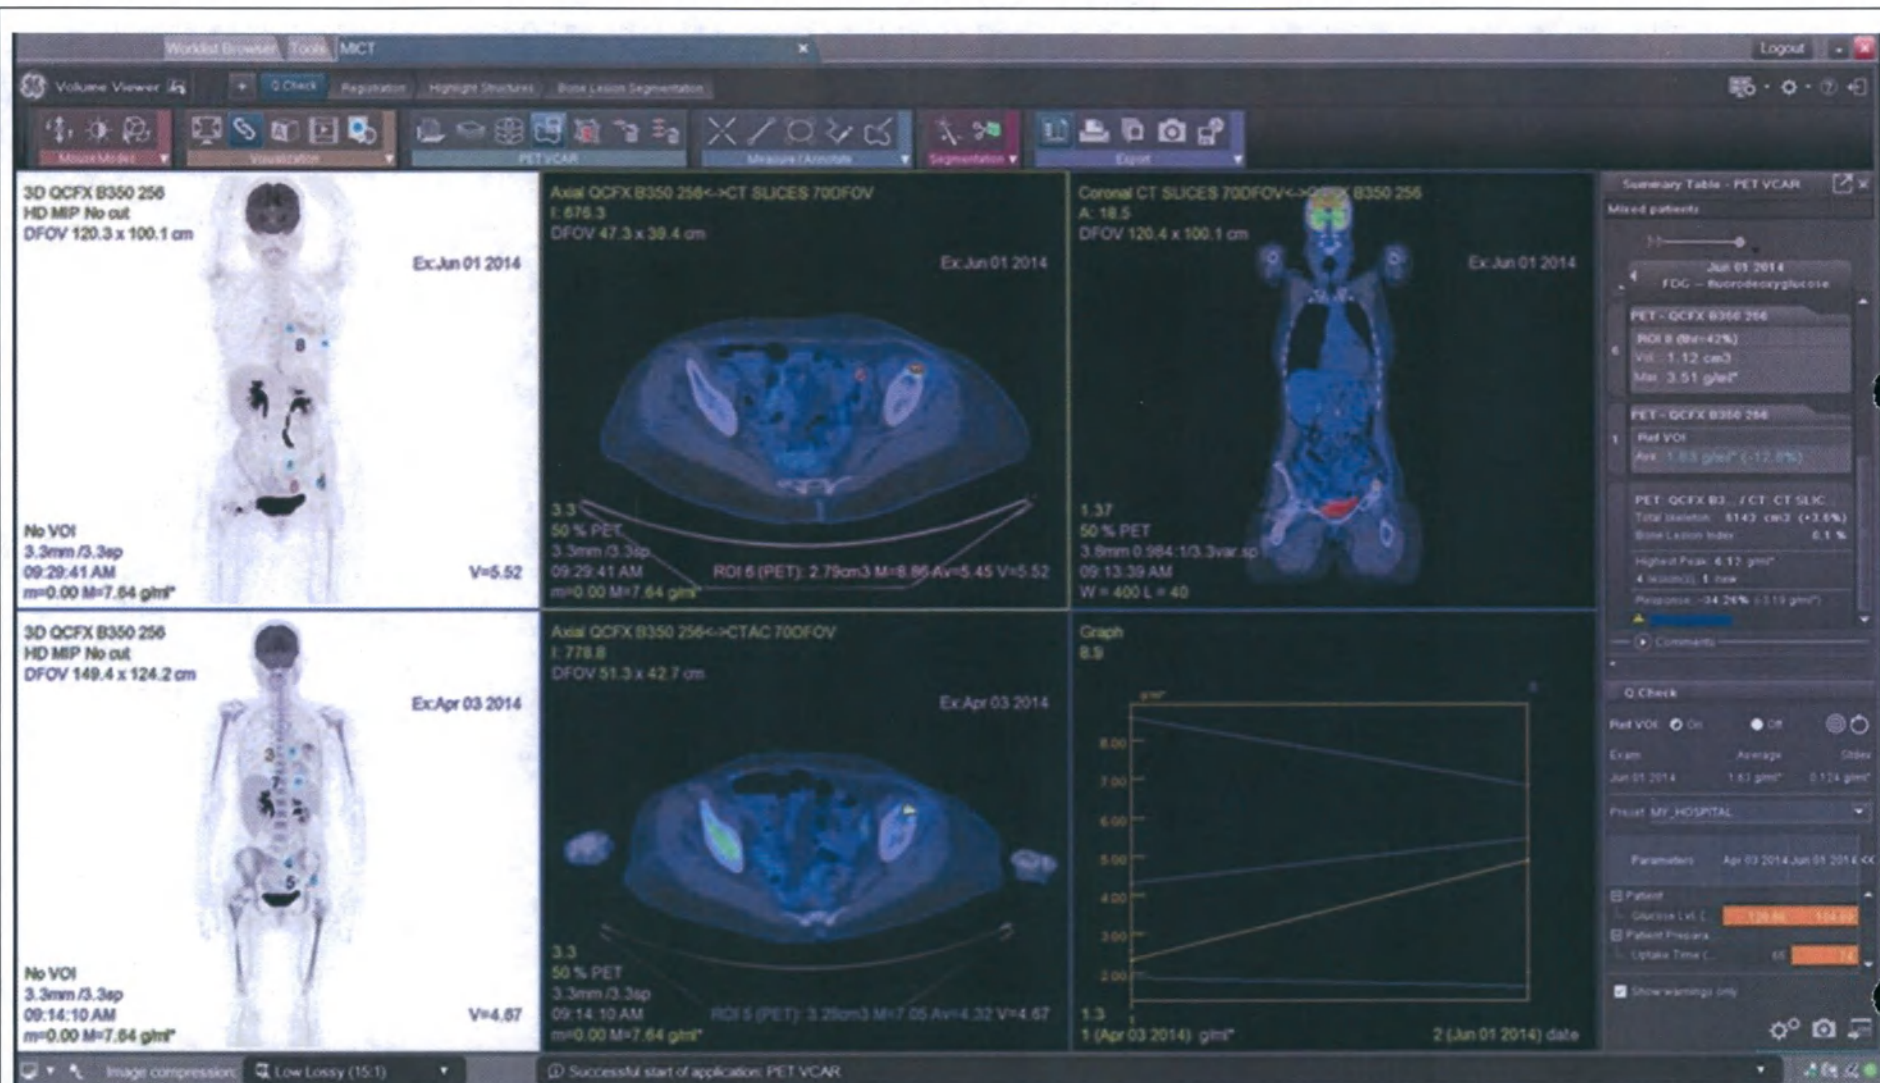


21. Программные пакеты для планирования терапии (не более 6 шт.) (при необходимости).

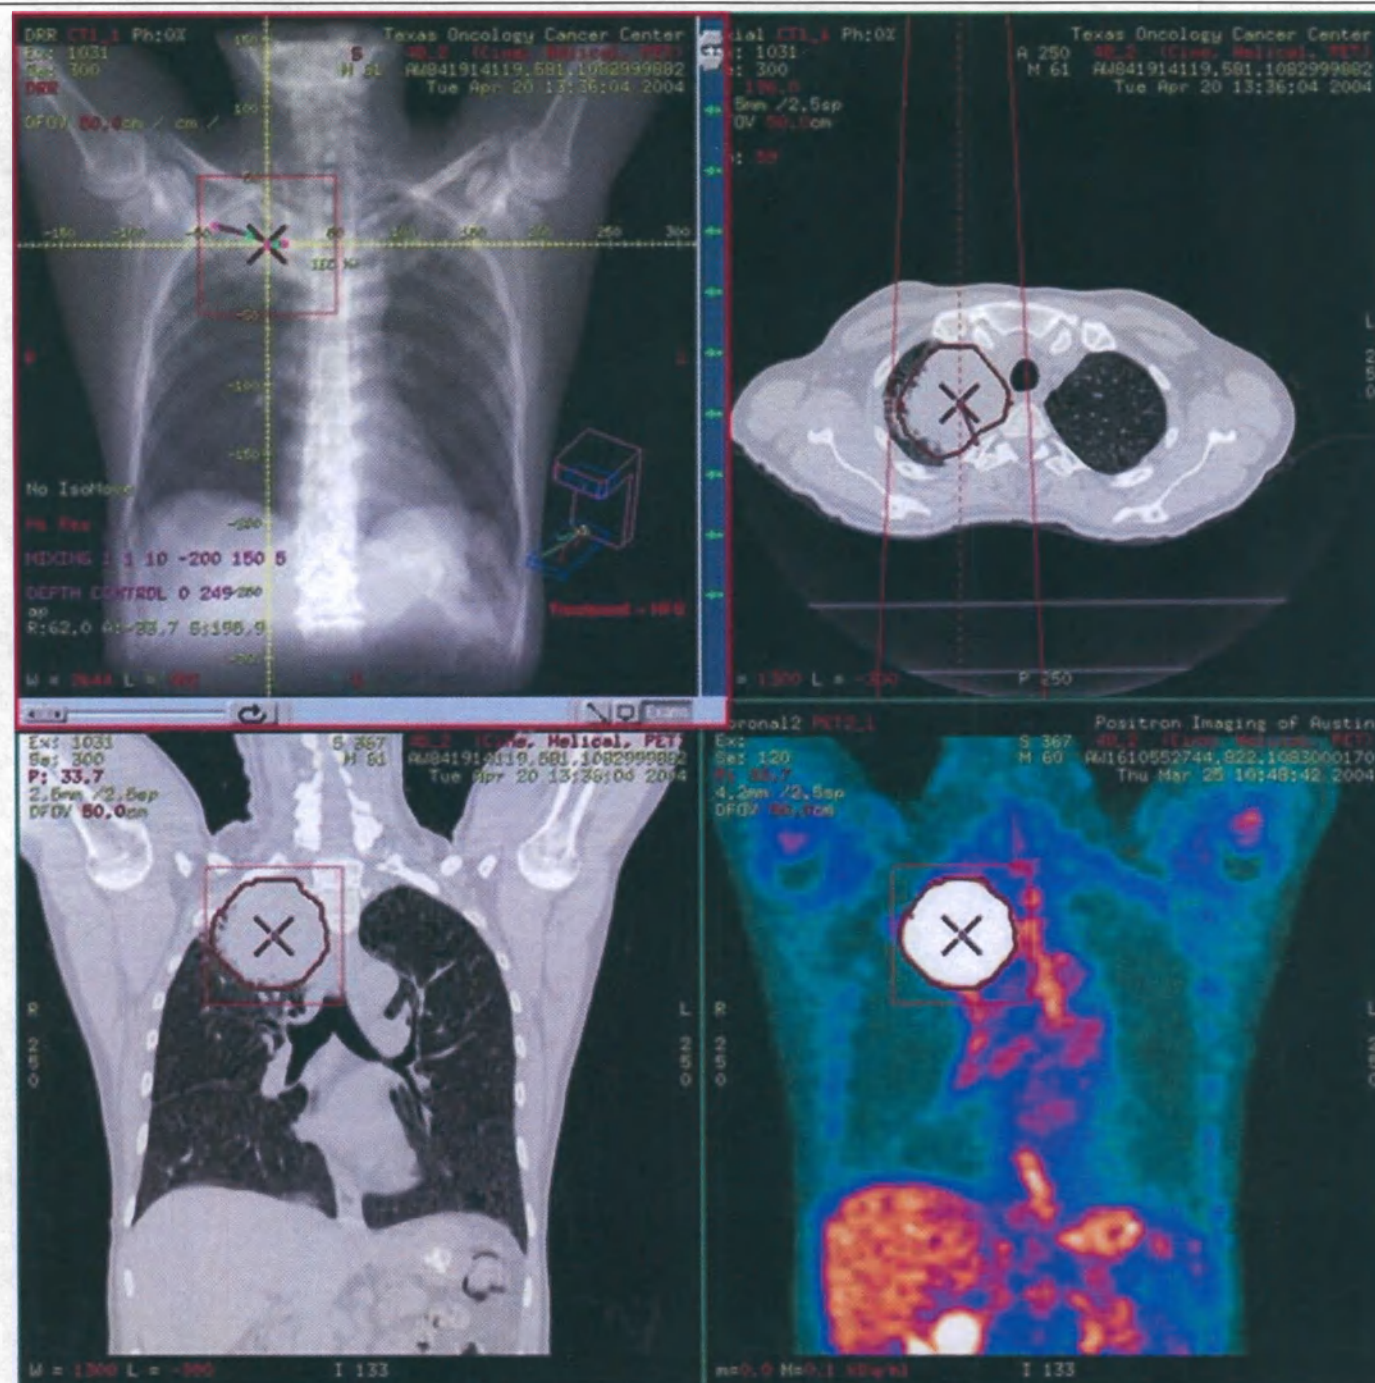


22. Программные пакеты для кардиологических исследований (не более 20 шт.) (при необходимости).

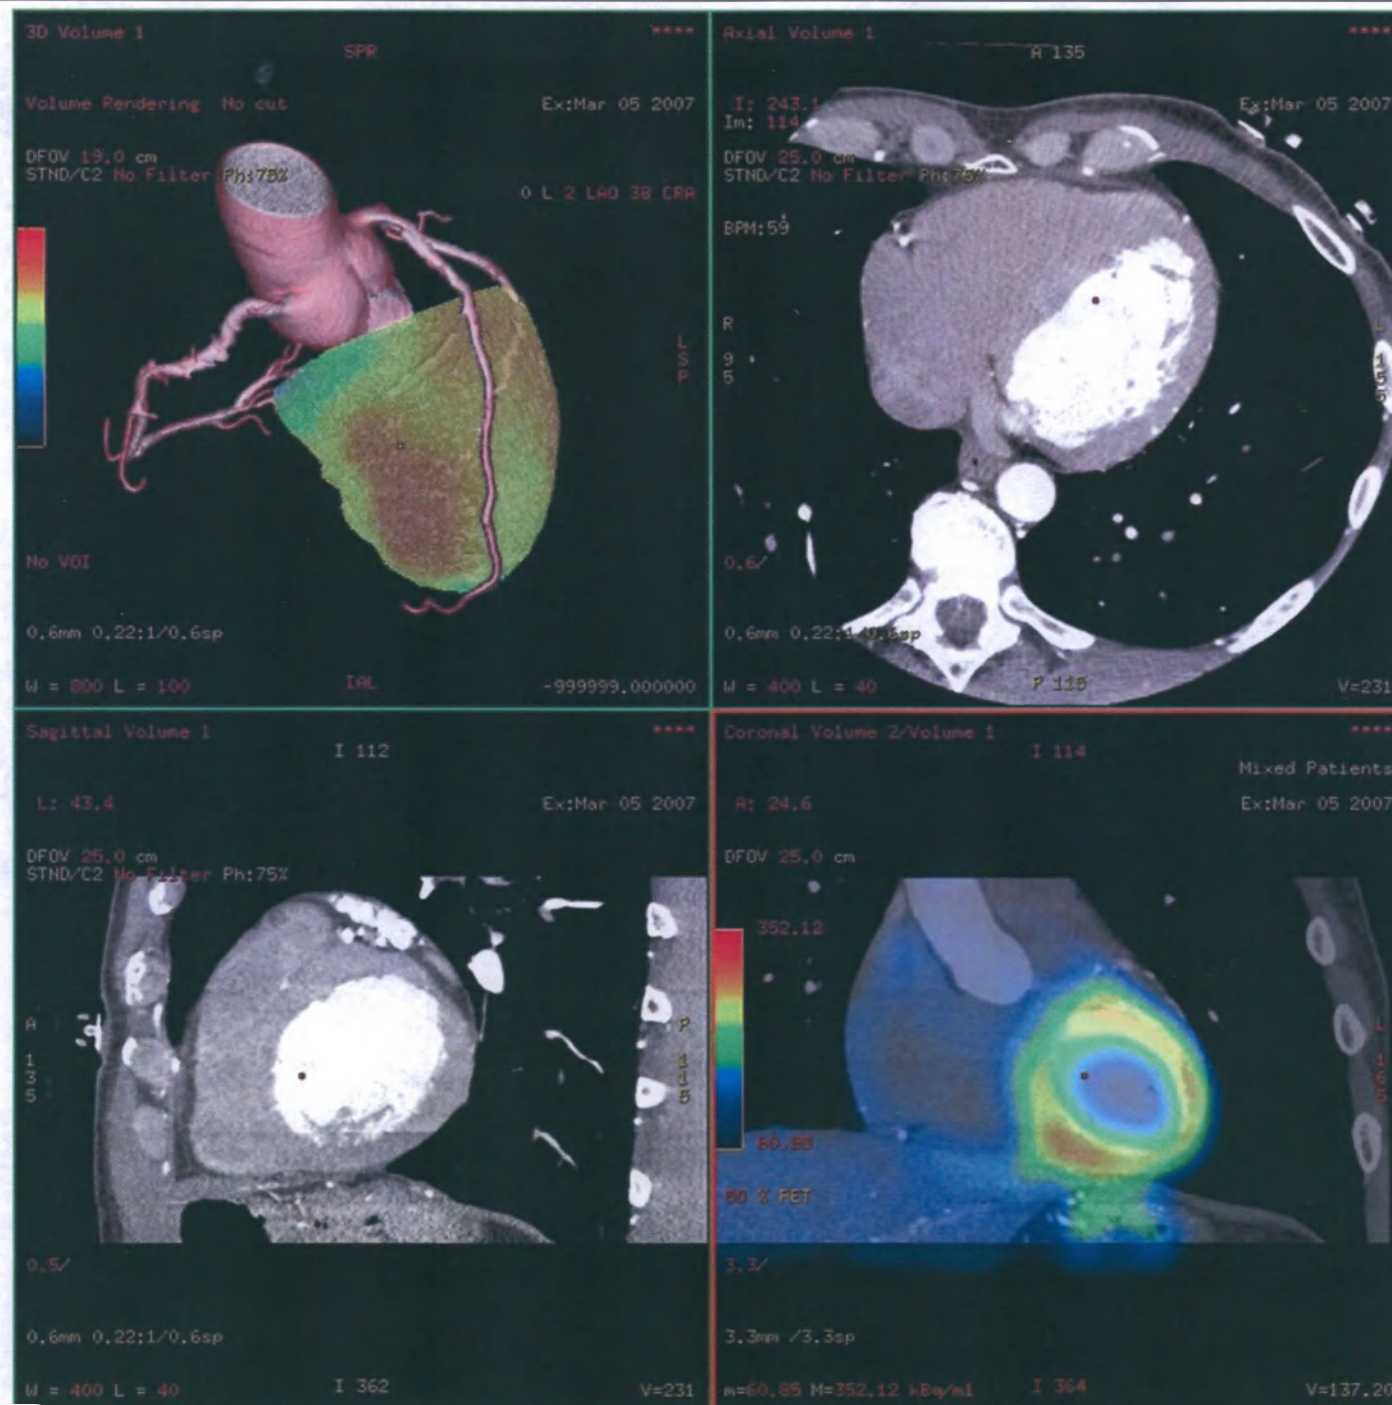


22. Программные пакеты для кардиологических исследований (не более 20 шт.) (при необходимости).

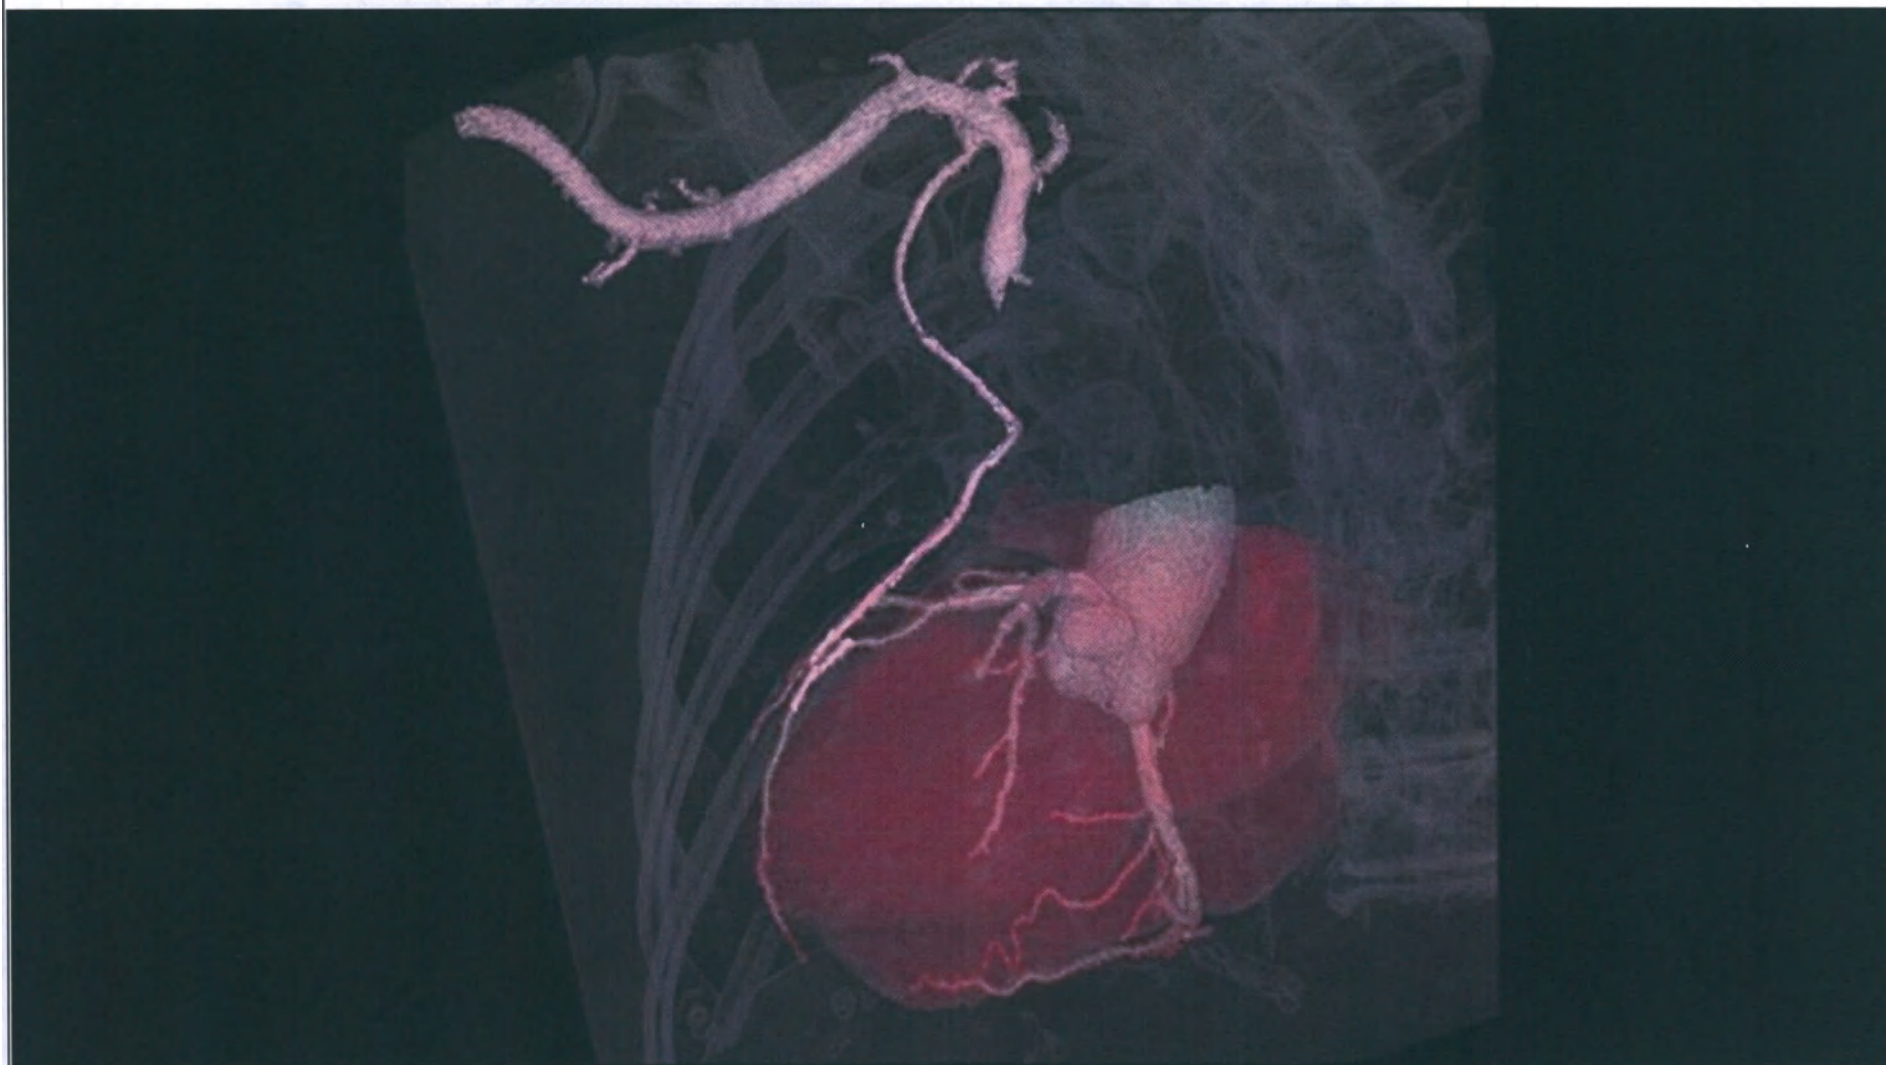

23. Программные пакеты для исследований сосудов (не более 6 шт.) (при необходимости).

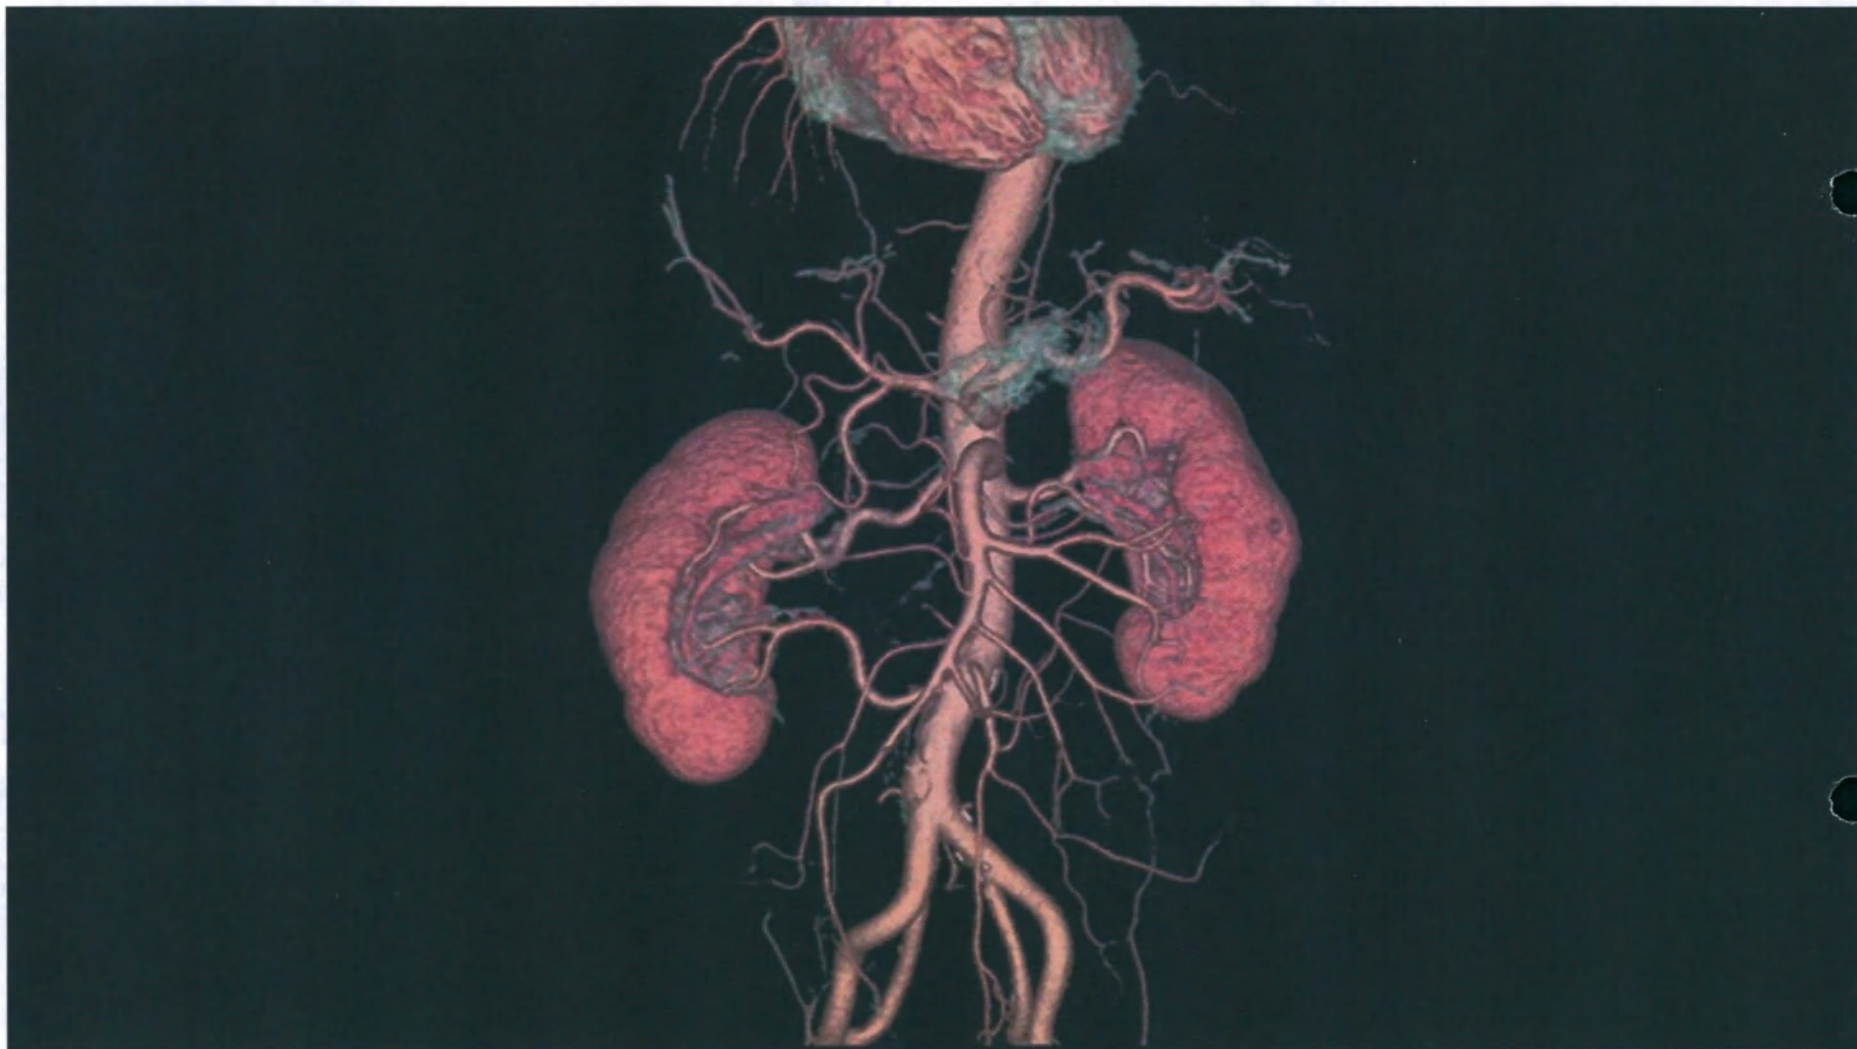


23. Программные пакеты для исследований сосудов (не более 6 шт.) (при необходимости).

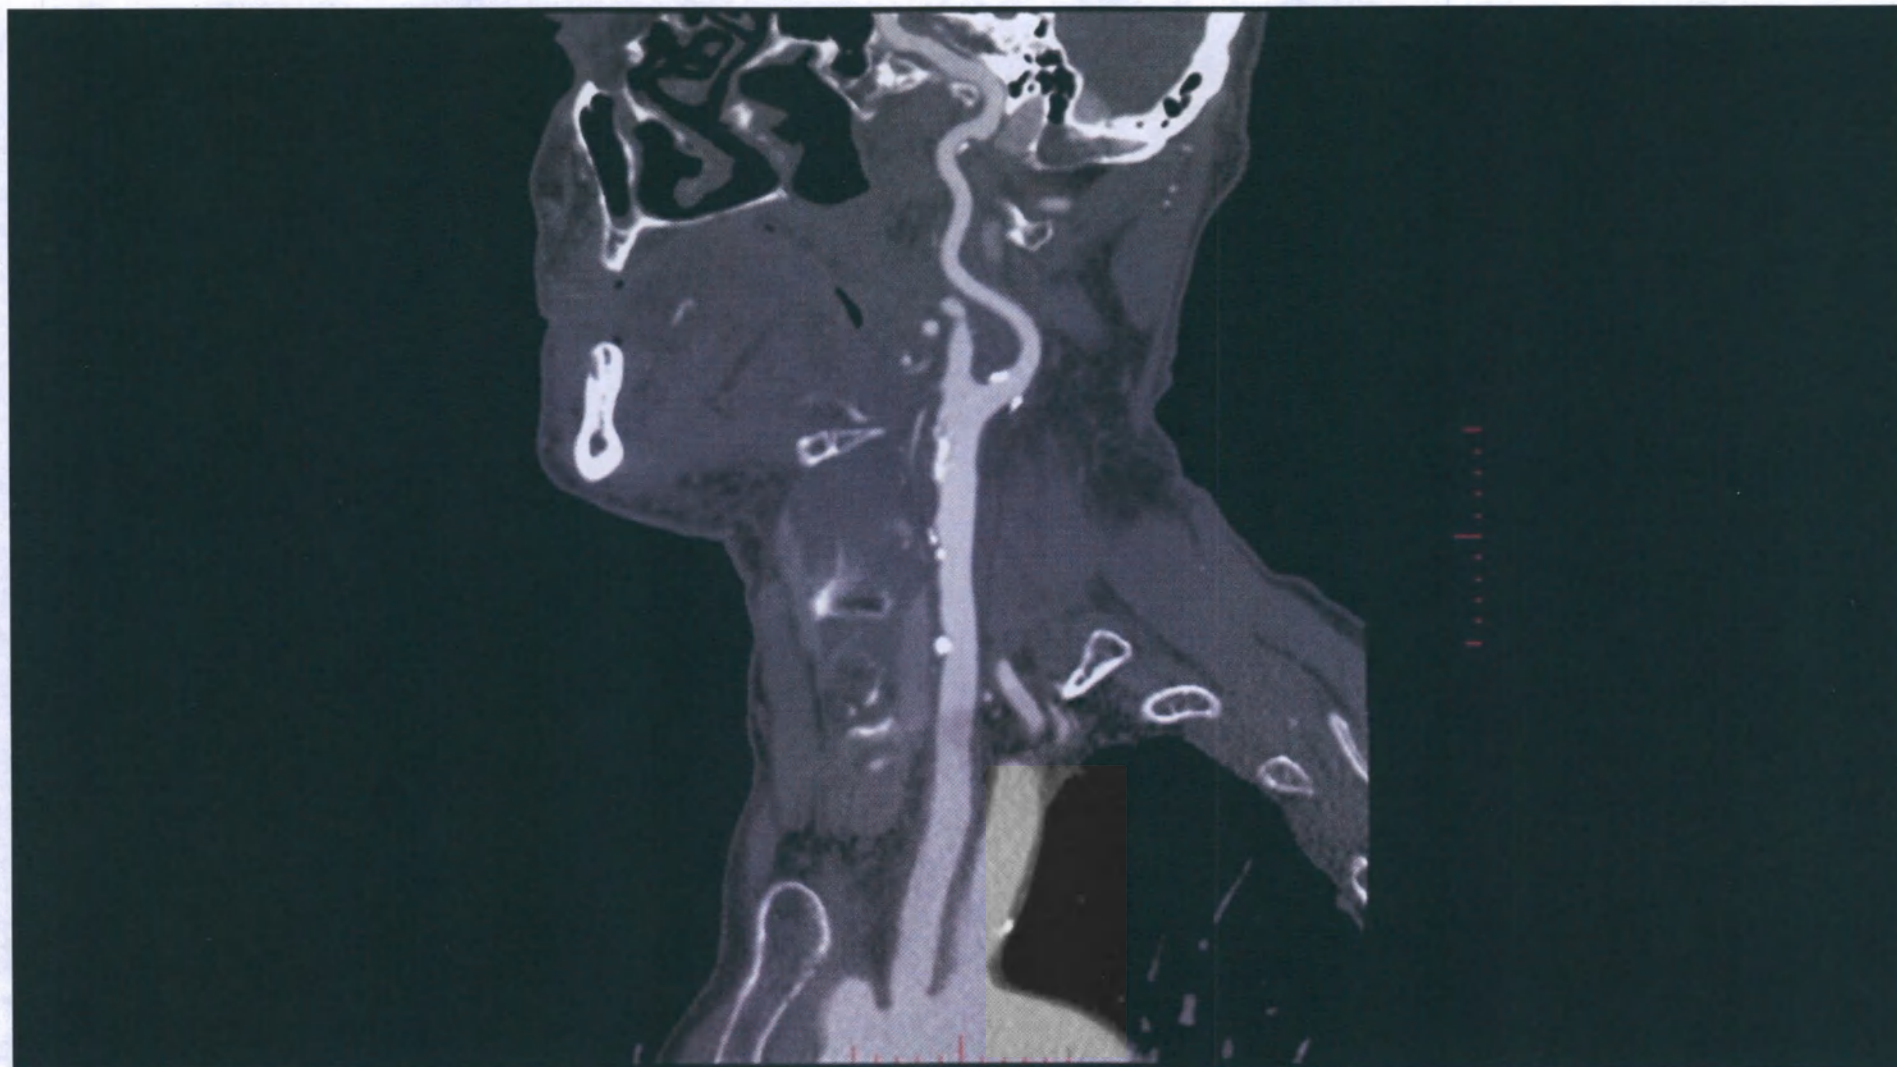





24. Программные пакеты для неврологических исследований (не более 6 шт.) (при необходимости).

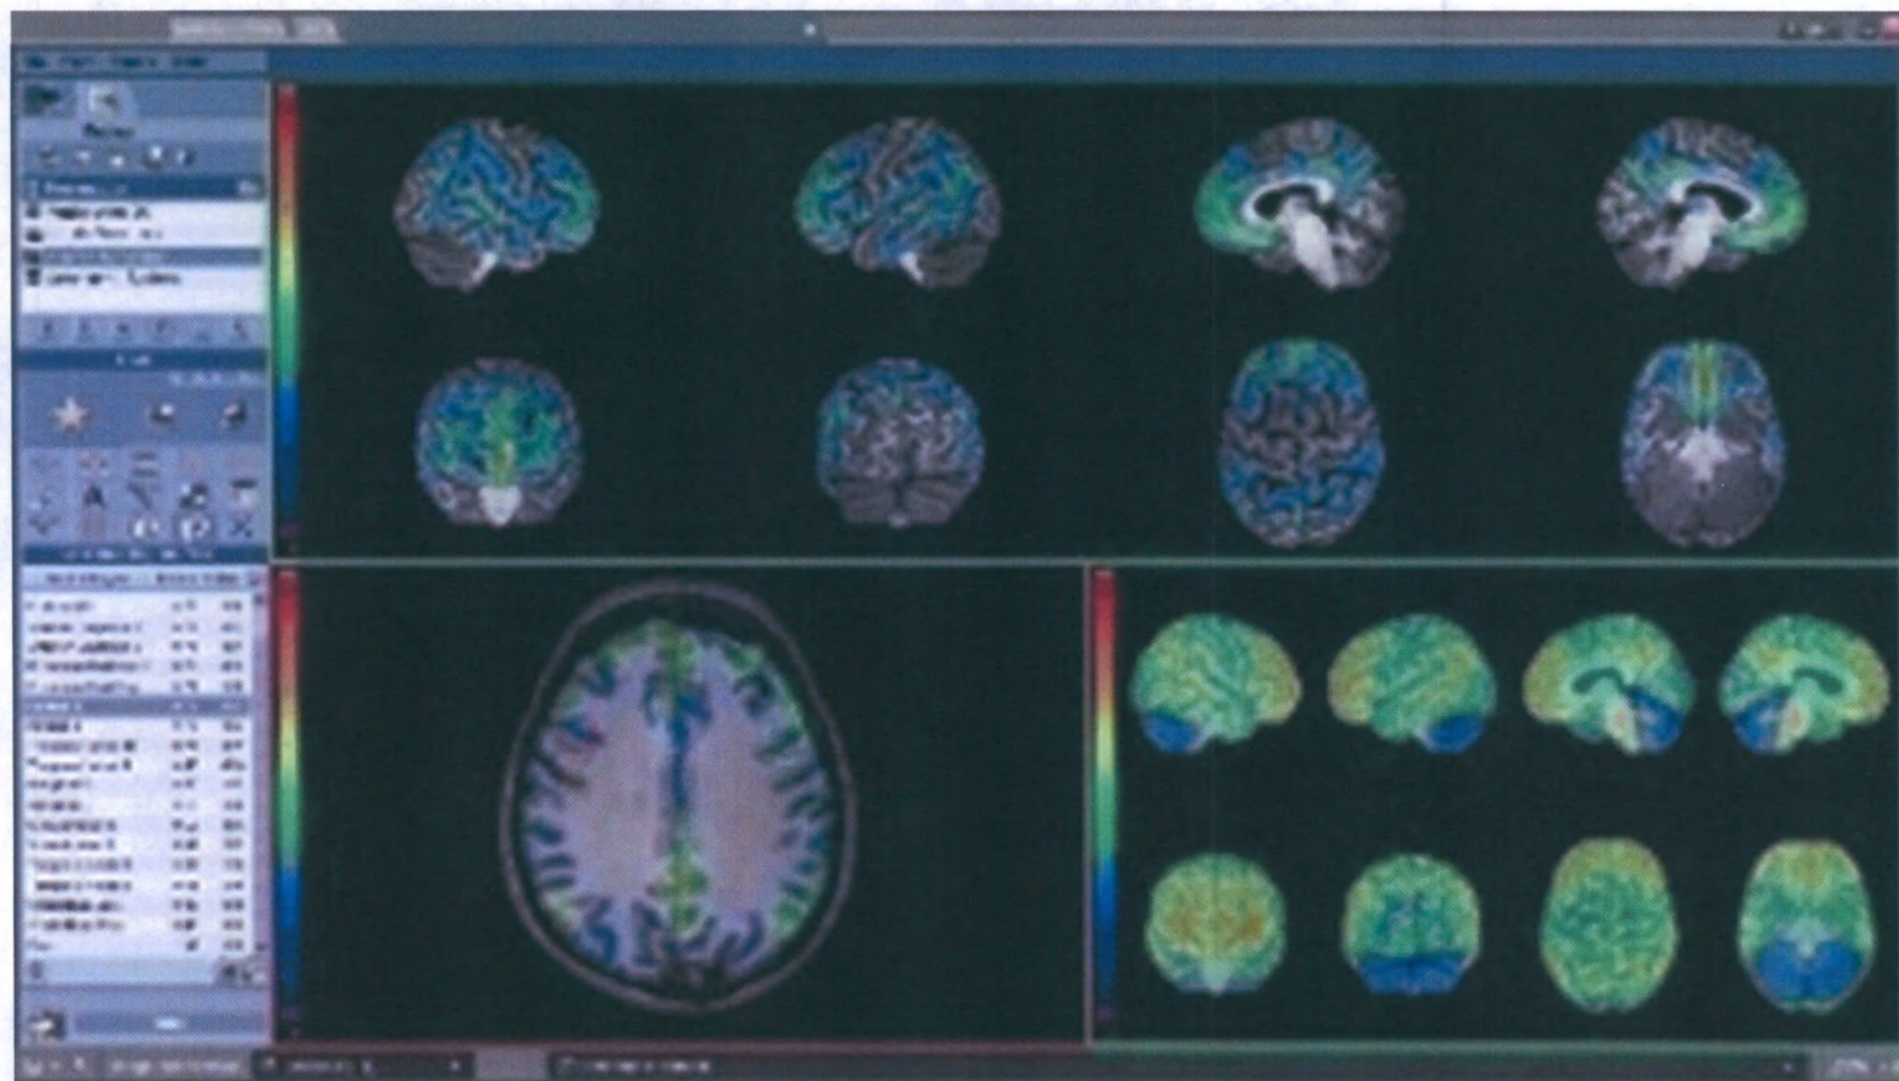


25. Программные пакеты для исследований органов грудной клетки и брюшной полости (не более 6 шт.) (при необходимости).

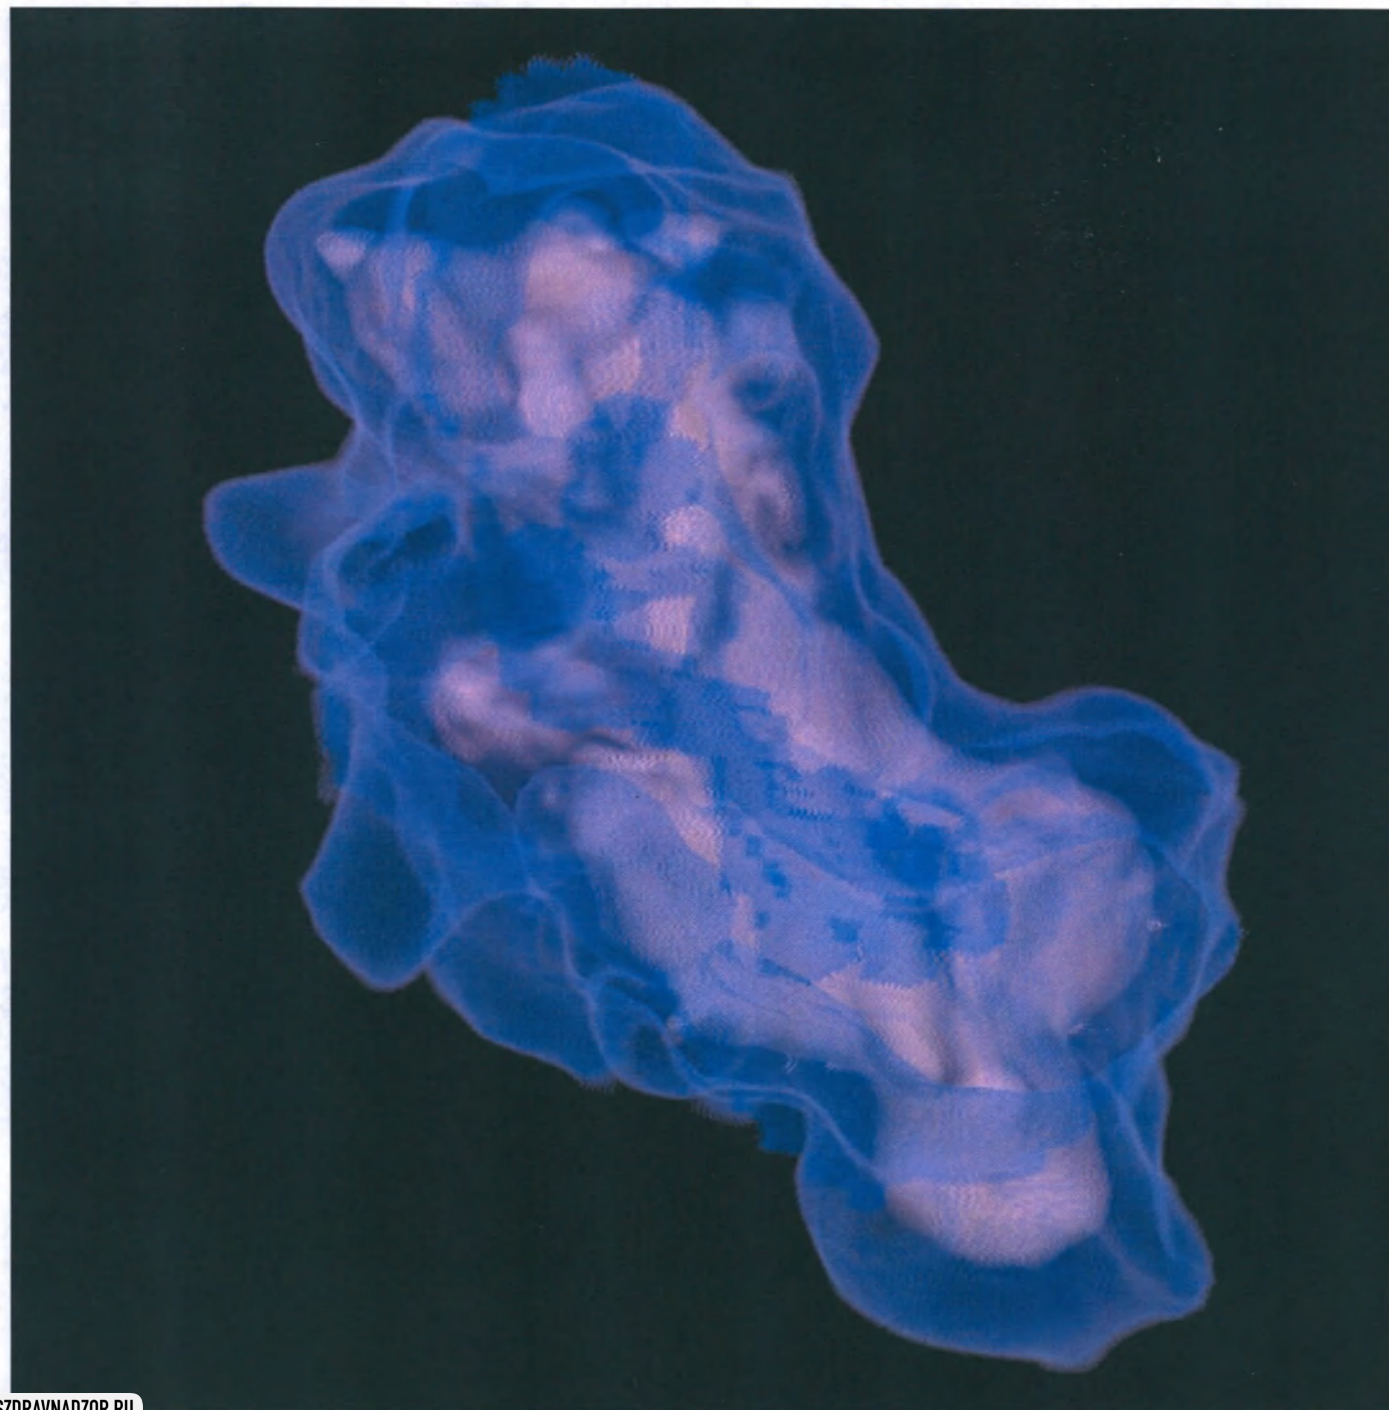


25. Программные пакеты для исследований органов грудной клетки и брюшной полости (не более 6 шт.) (при необходимости).

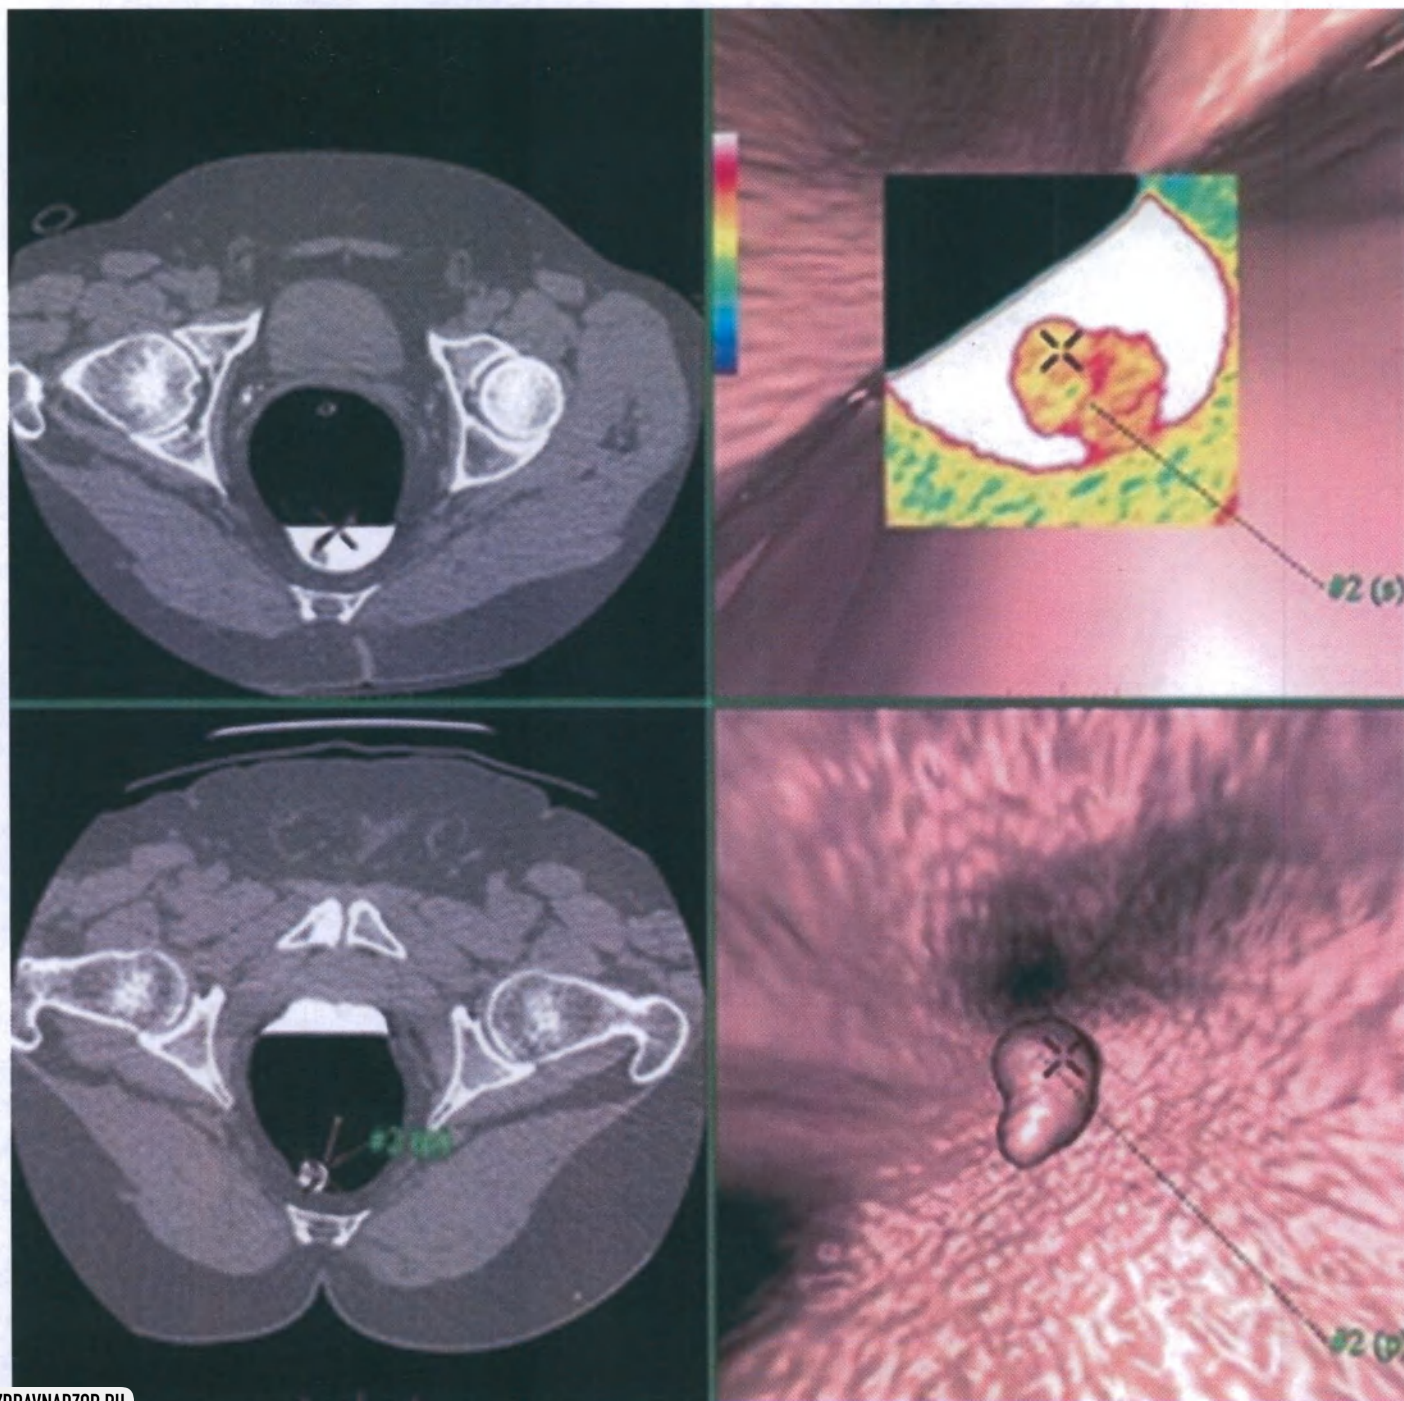

26. Программные пакеты для количественной оценки (не более 30 шт.) (при необходимости).

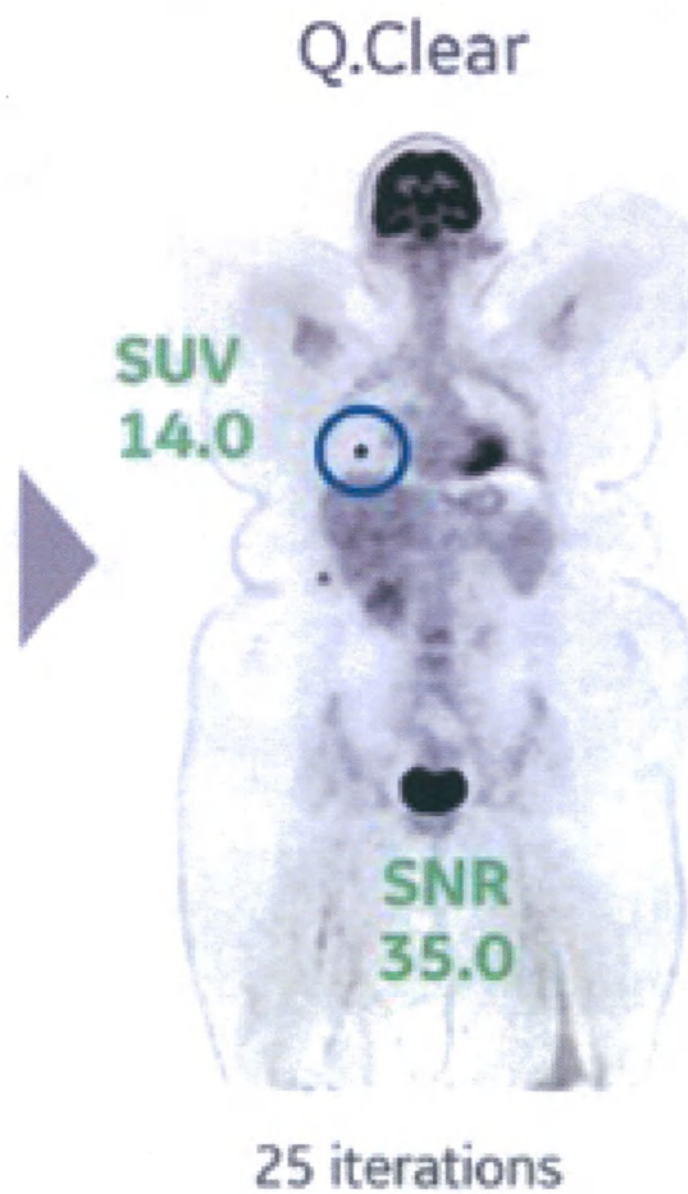


26. Программные пакеты для количественной оценки (не более 30 шт.) (при необходимости).

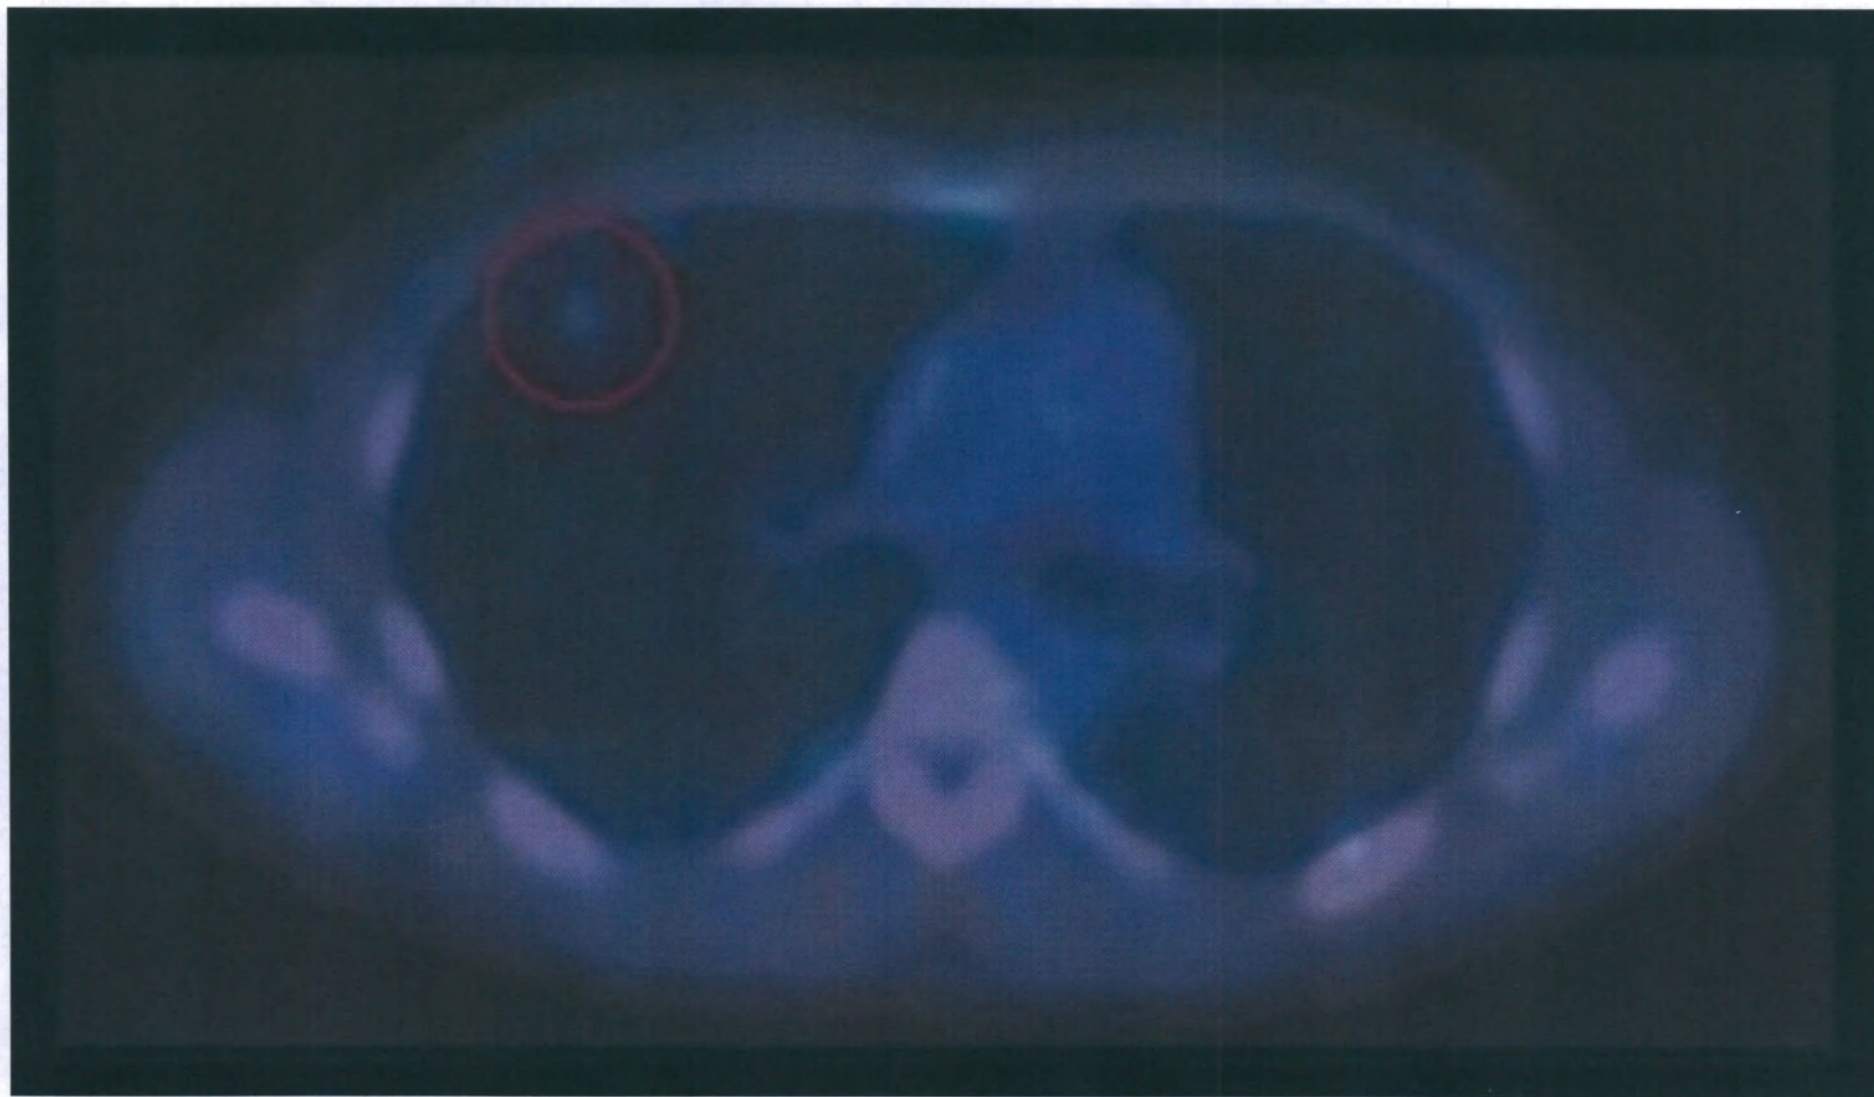

26. Программные пакеты для количественной оценки (не более 30 шт.) (при необходимости).



27. Программные пакеты реконструкции КТ изображений (не более 30 шт.) (при необходимости).

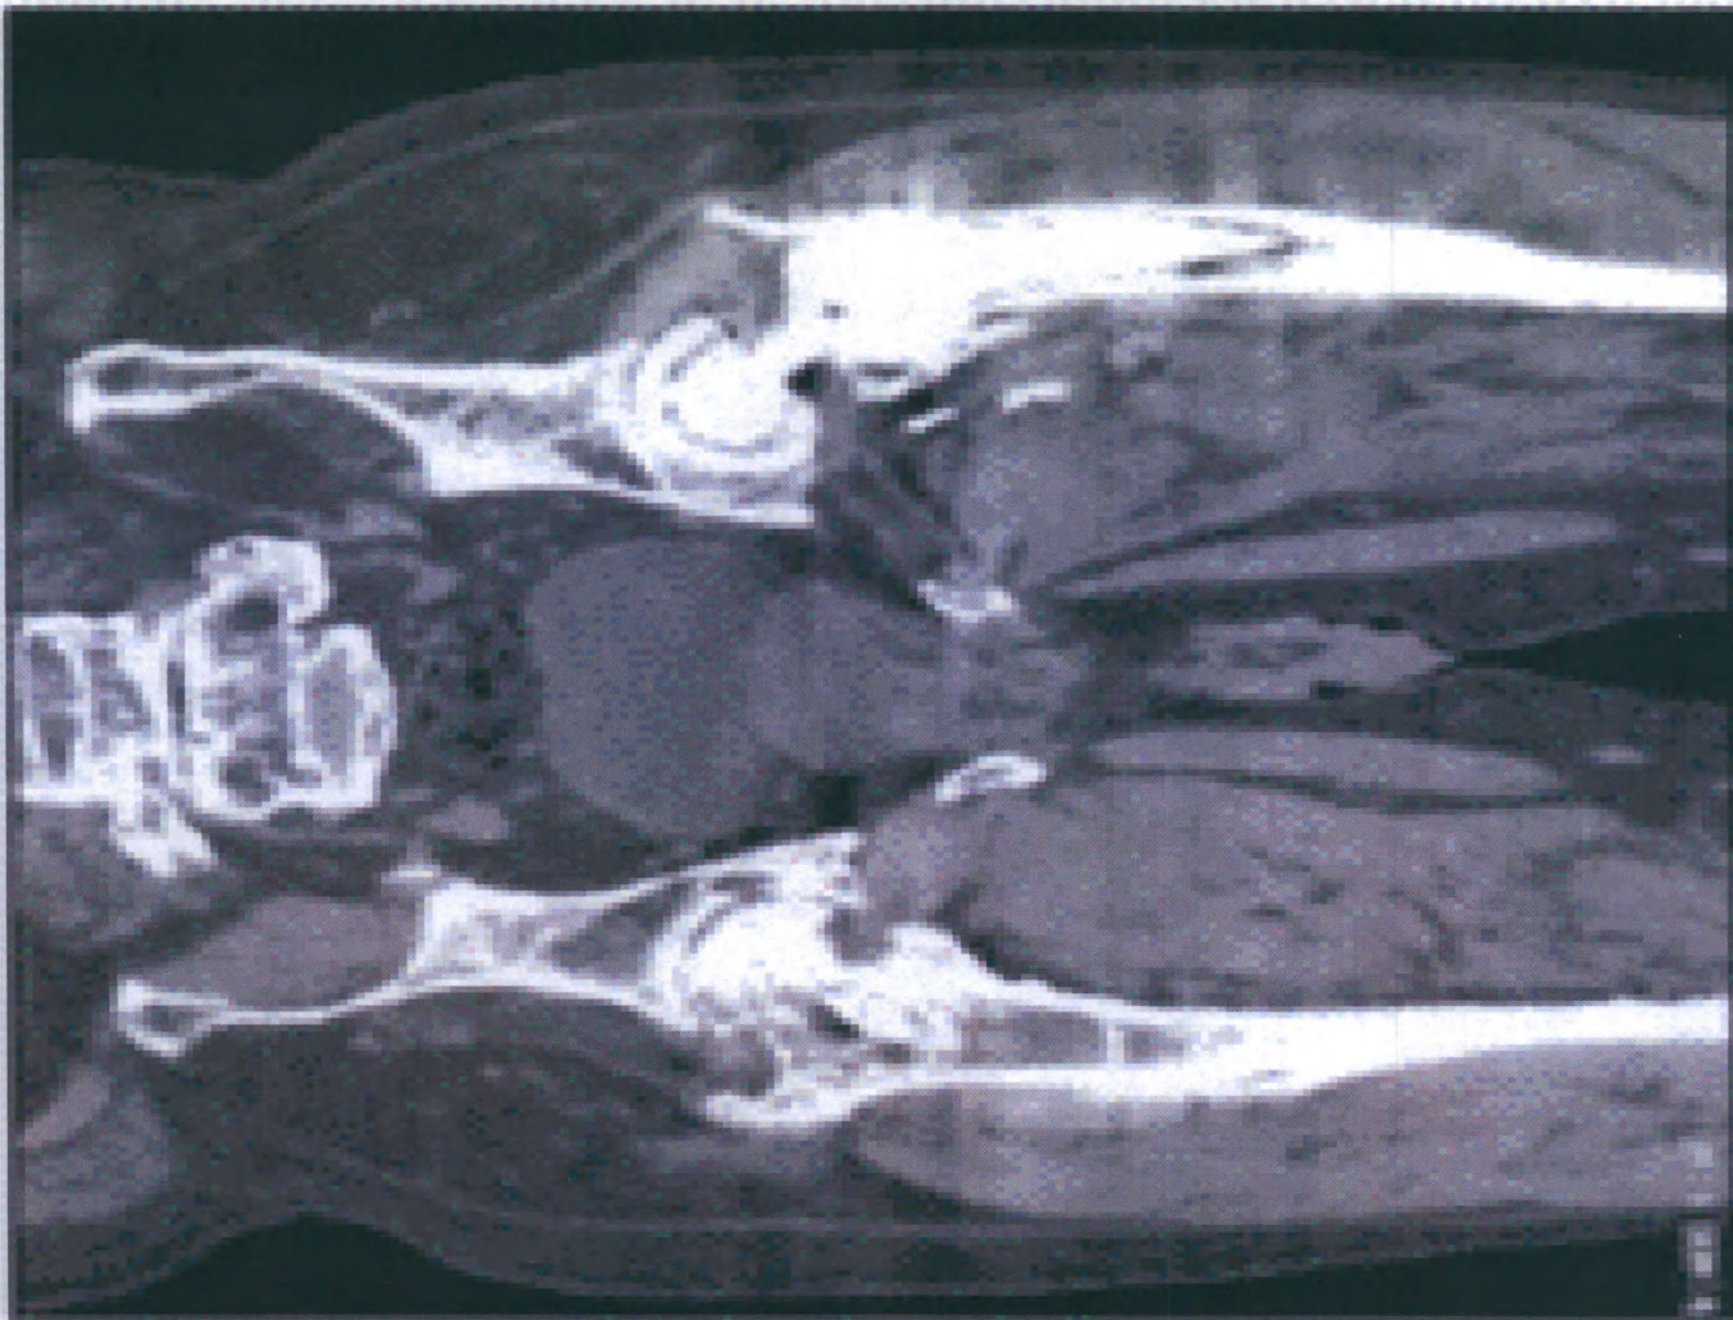

28. Программные пакеты для работы с иньектором (не более 6 шт.) (при необходимости).



29. Программные пакеты для модернизации (не более 6 шт.) (при необходимости).



II. Принадлежности:

1. Панели управления гентри (не более 4 шт.).



2. Дисплей гентри (не более 2 шт.).



3. Крышки гентри (не более 10 шт.).




4. Крышки стола для пациента (не более 20 шт.).




5. Крышки декоративные (не более 8 шт.).

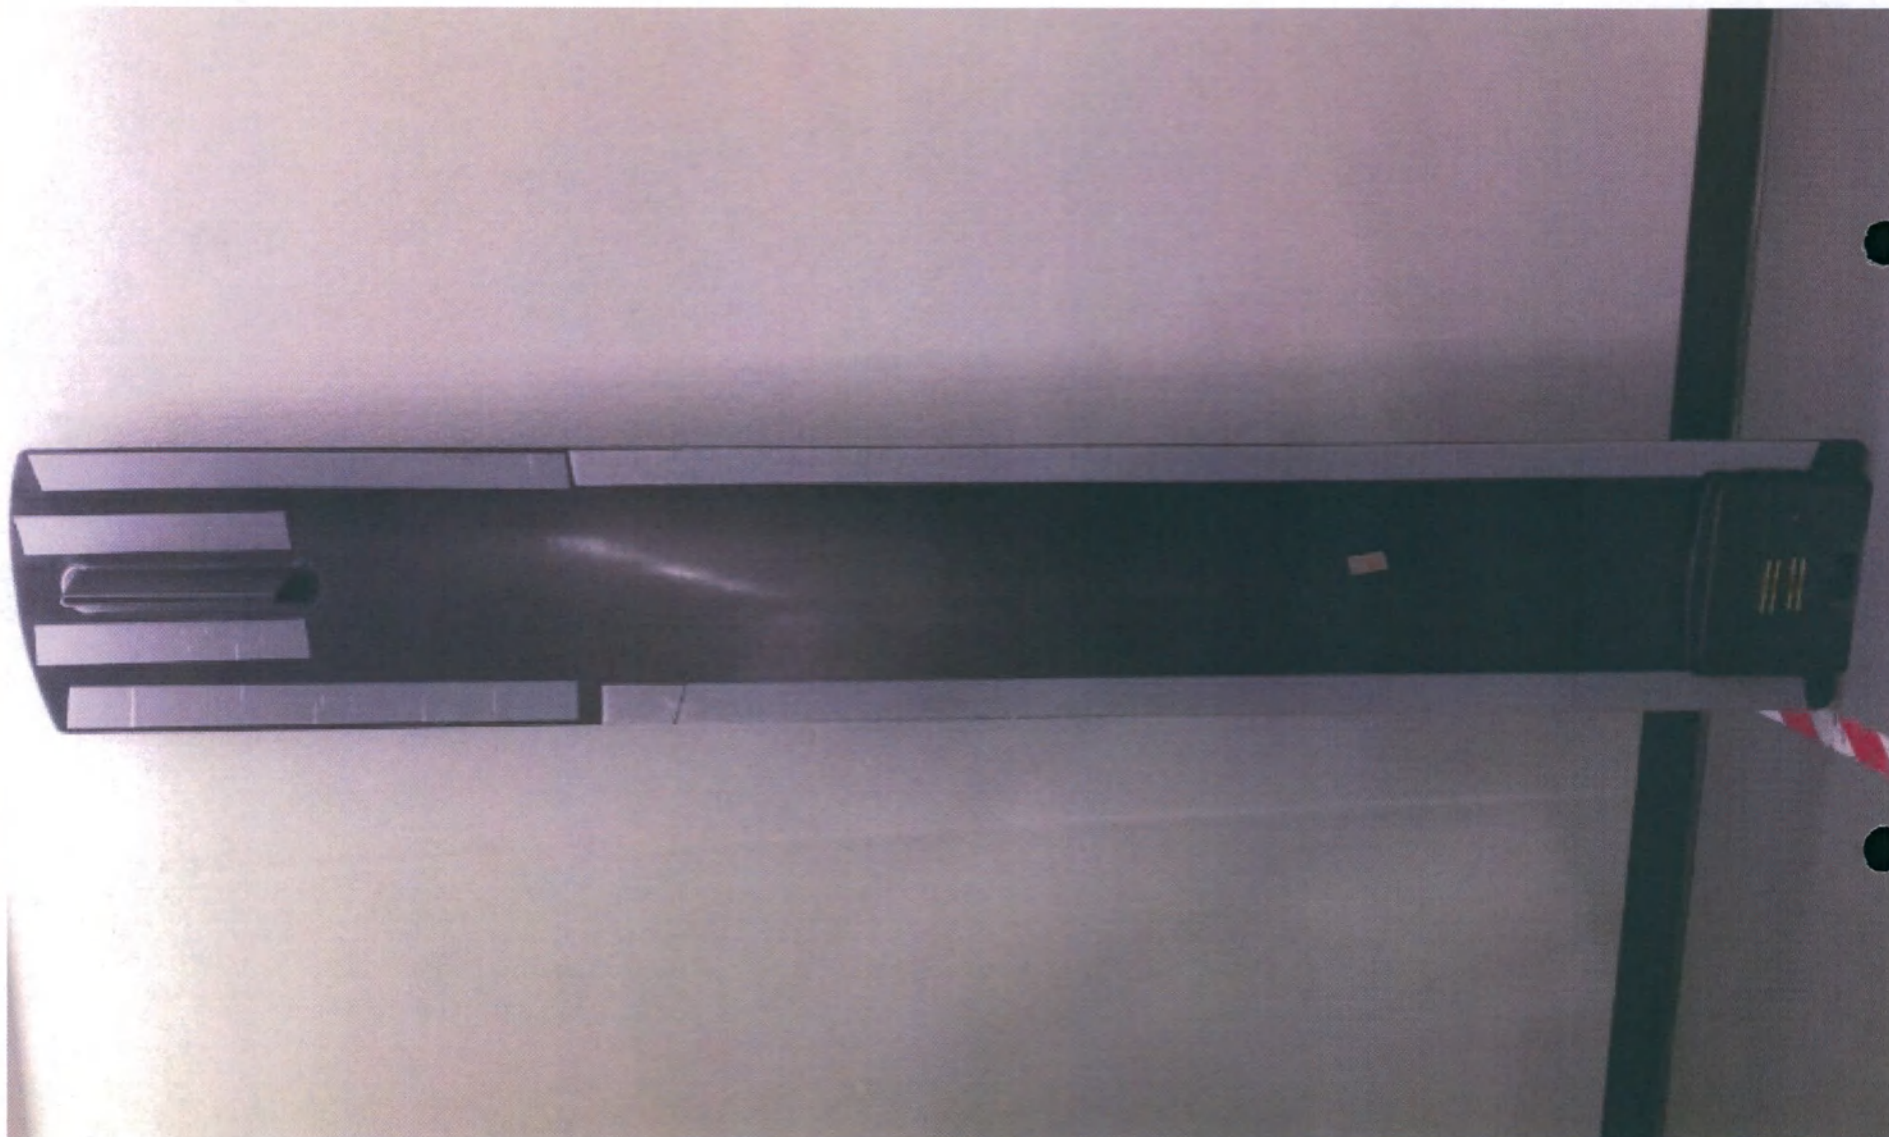

6. Дека стола.

7. Деки стола плоские (не более 10 шт.).

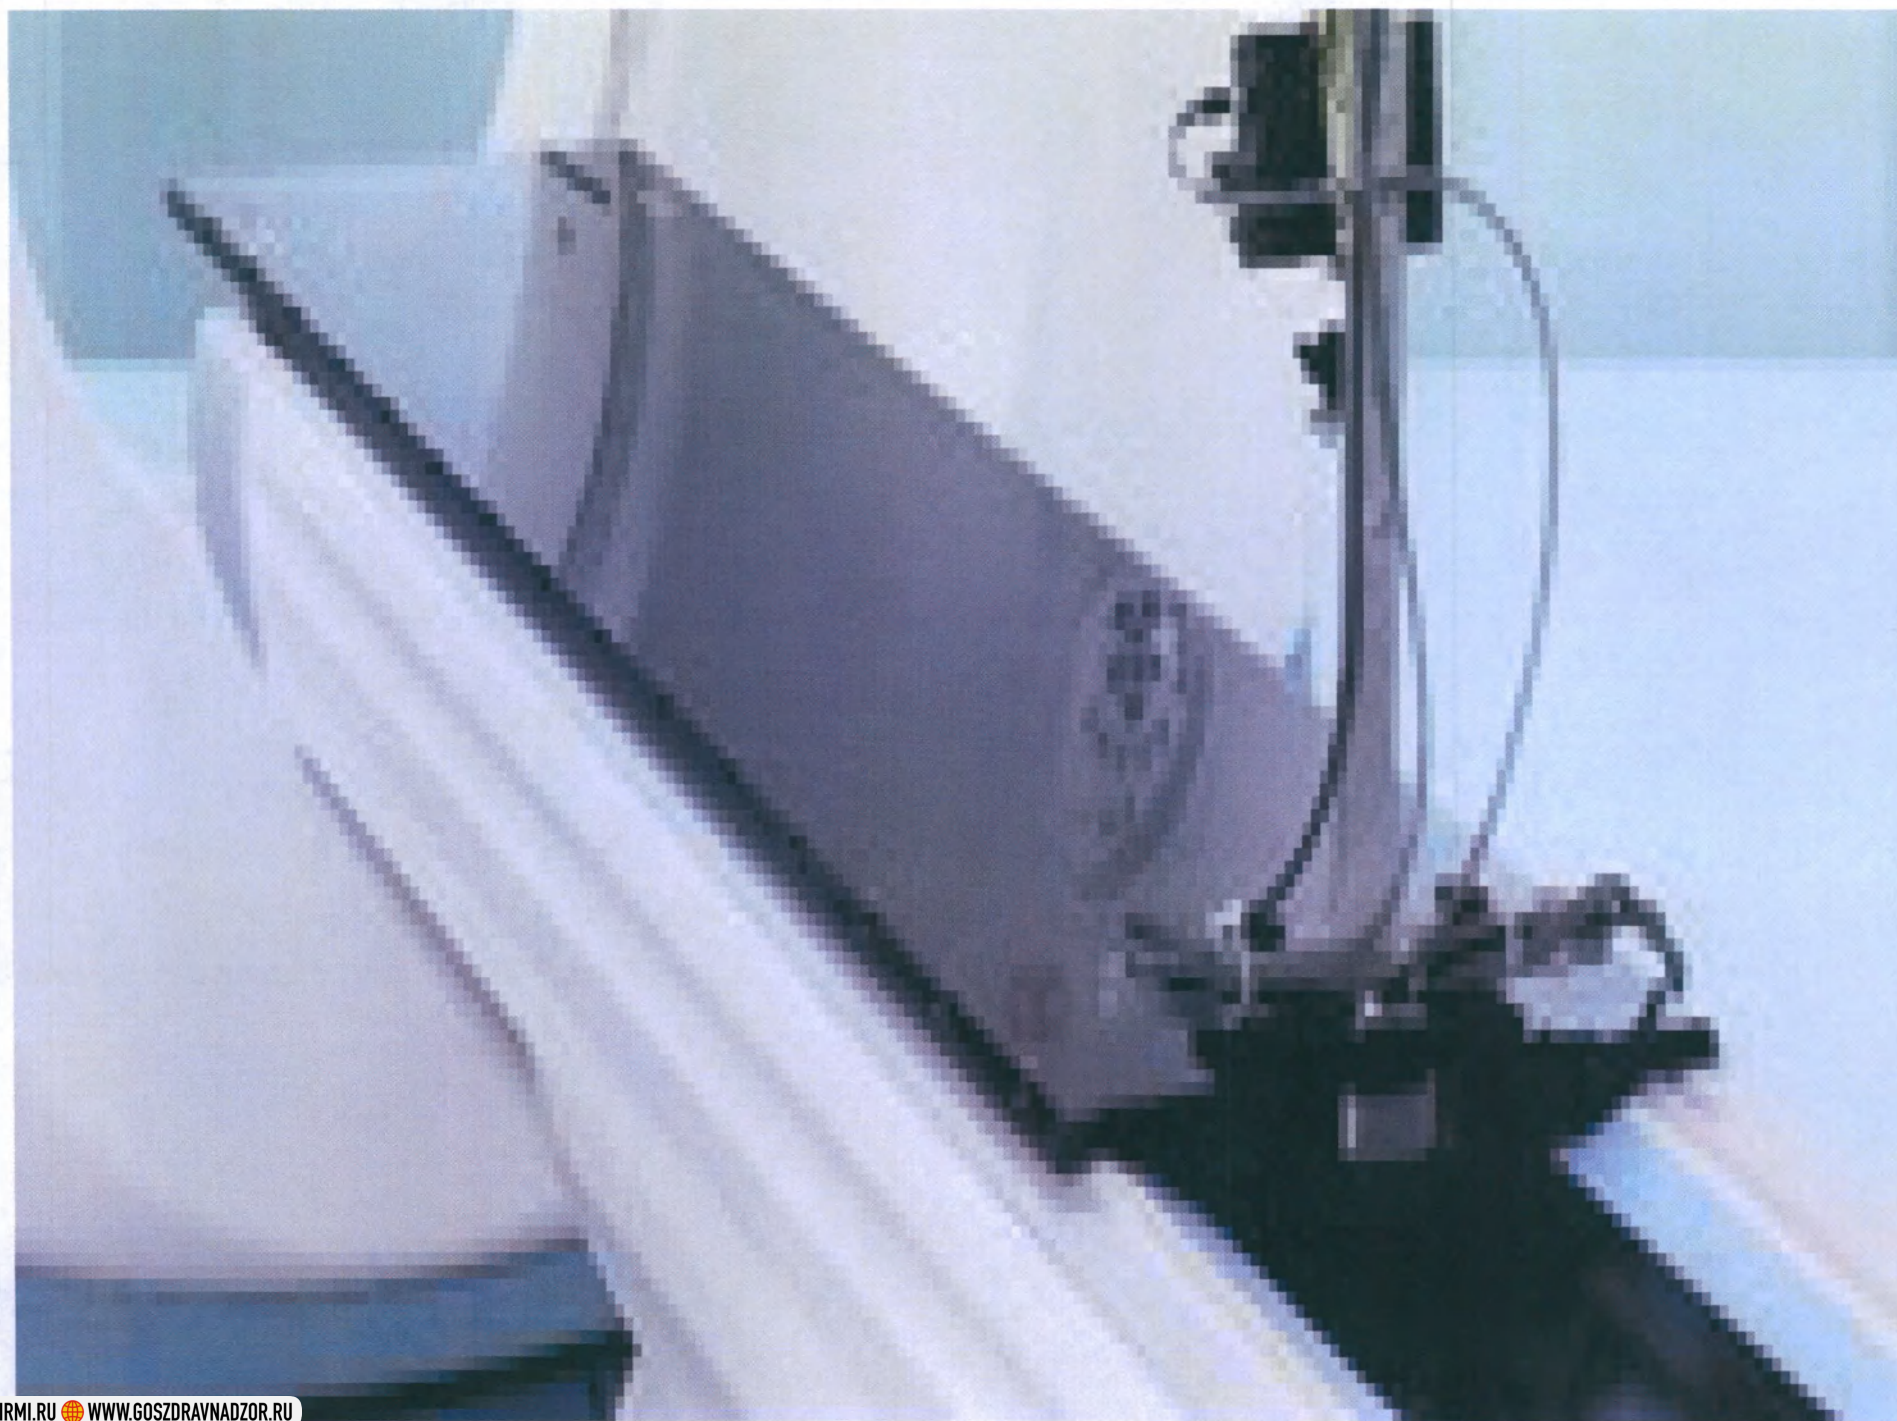


7. Деки стола плоские (не более 10 шт.).




7. Декн стола плоские (не более 10 шт.).




8. Устройства для крепления к столу (не более 4 шт.).

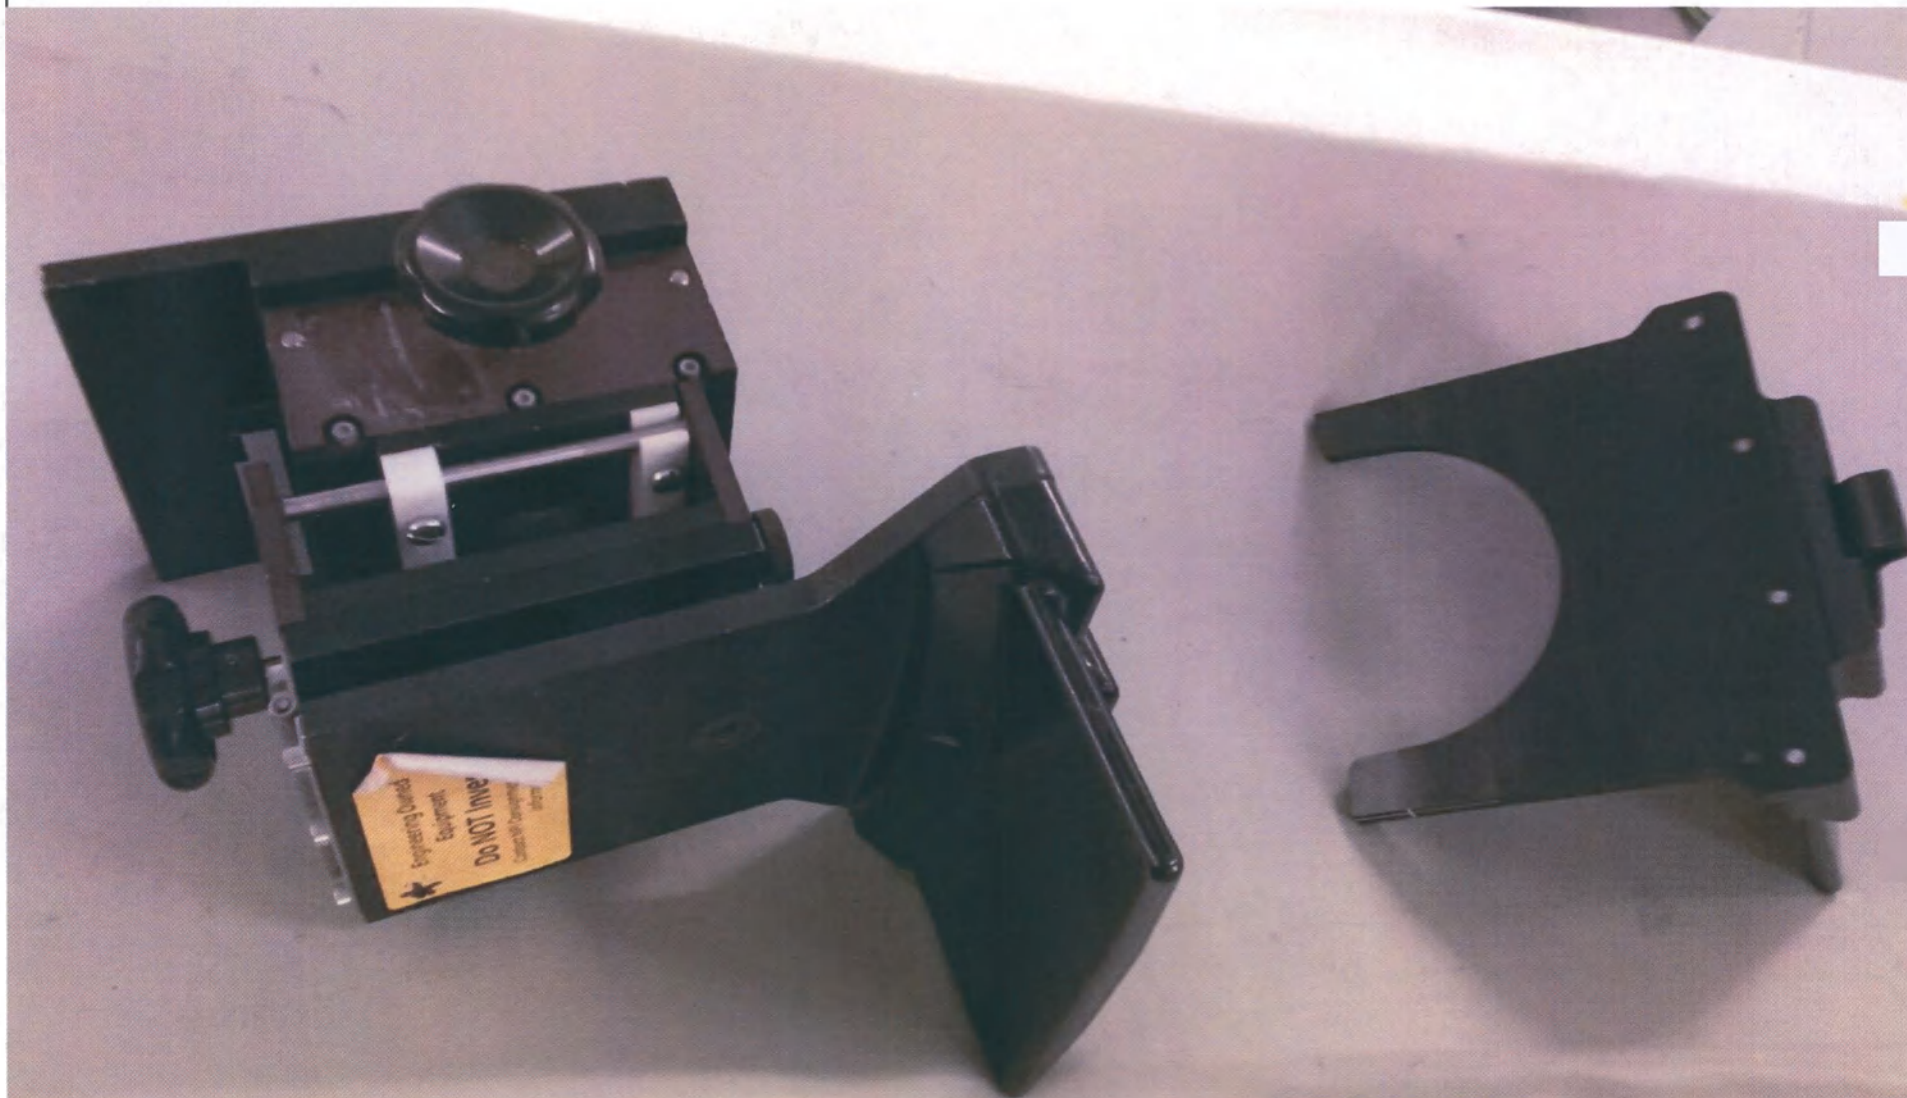


8. Устройства для крепления к столу (не более 4 шт.).

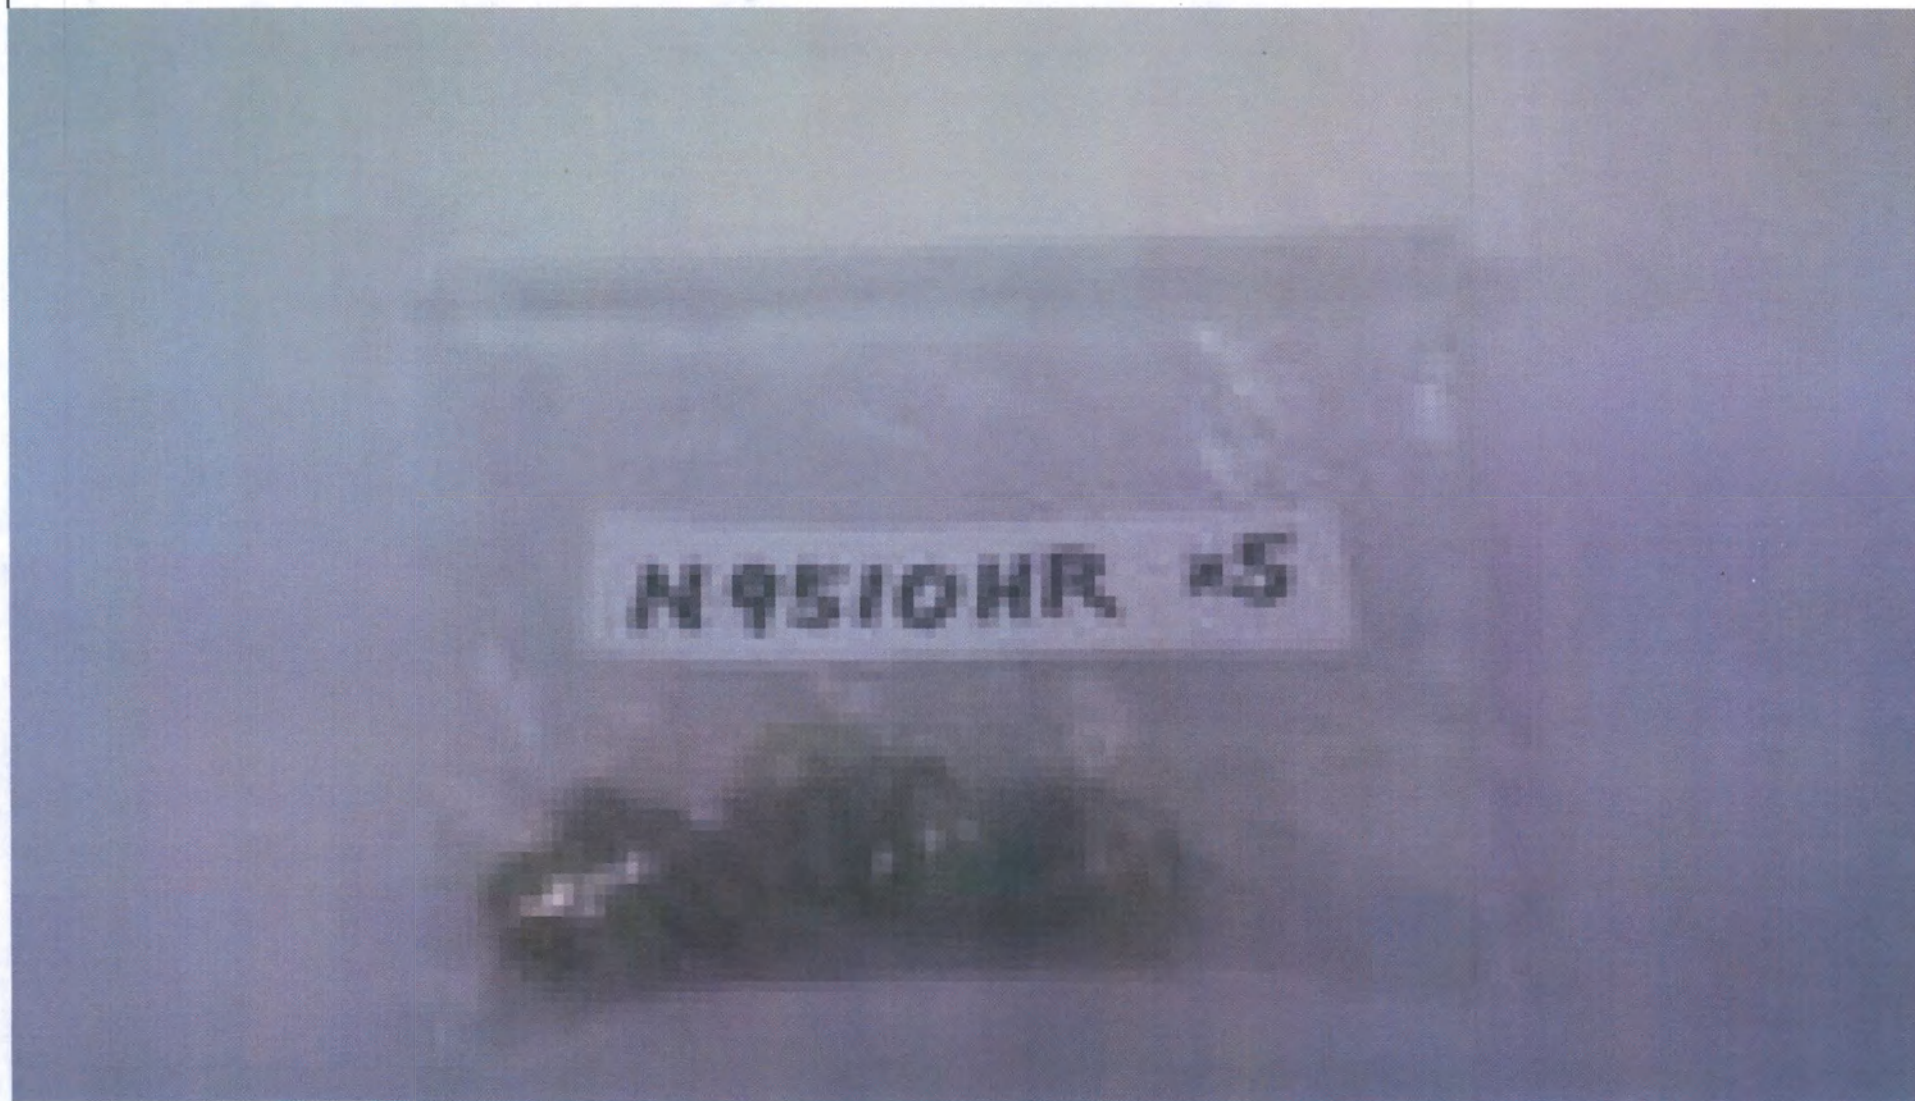


9. Удлинитель стола для пациента (не более 10 шт.).

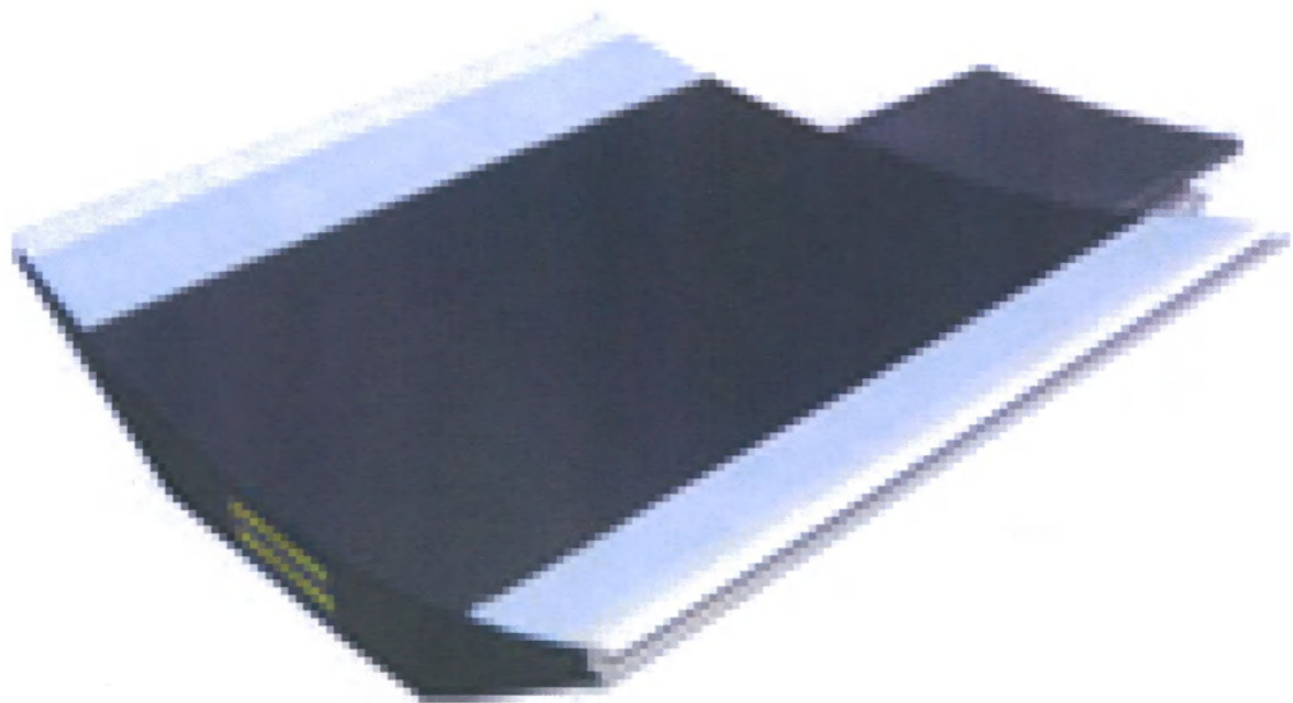


9. Удлинитель стола для пациента (не более 10 шт.).

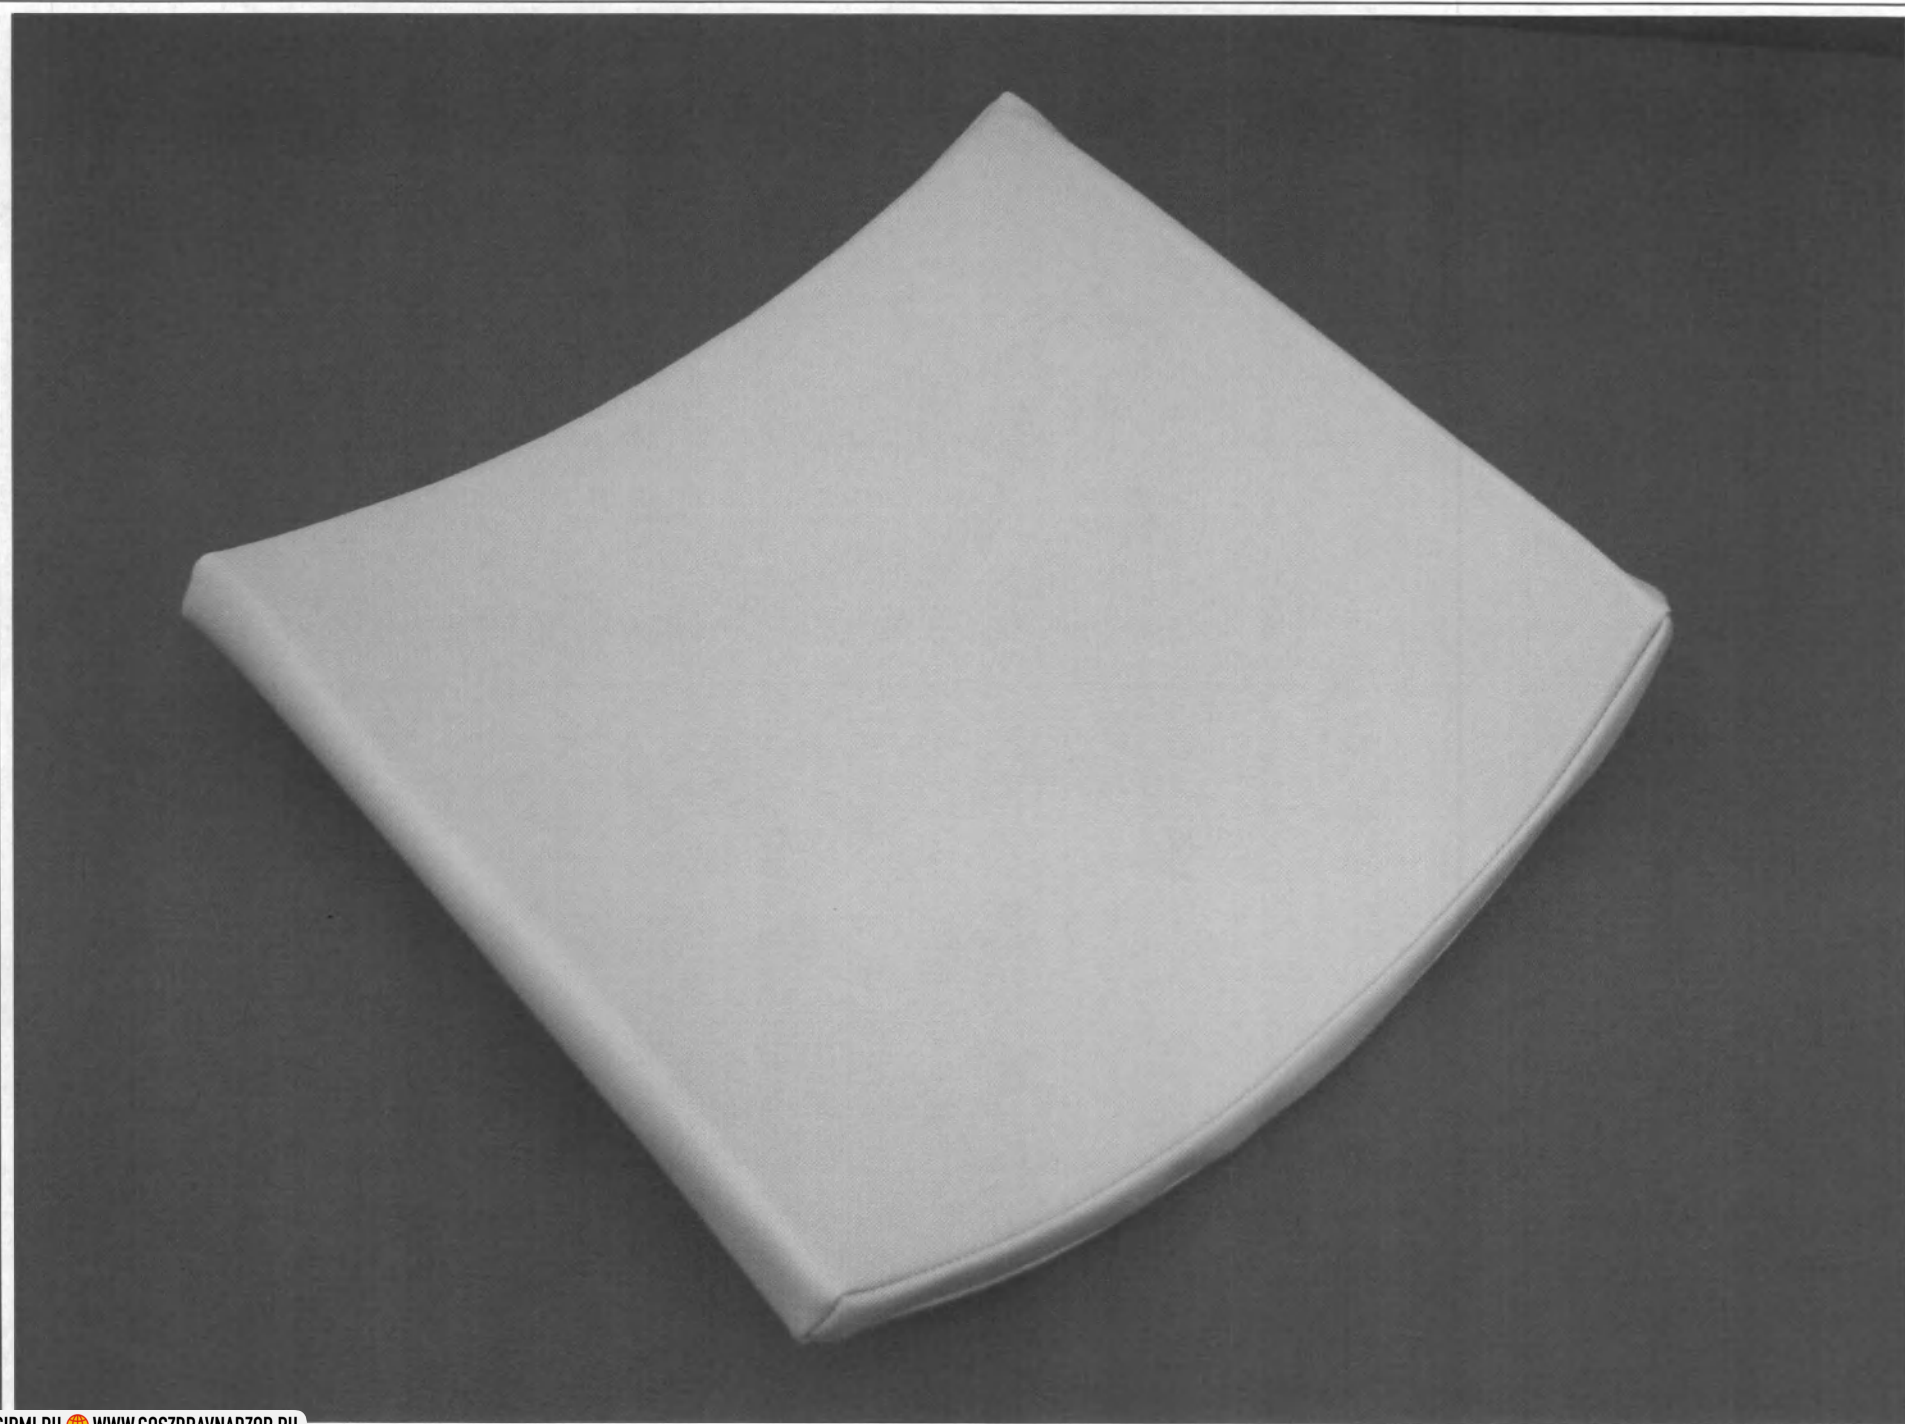

9. Удлинитель стола для пациента (не более 10 шт.).

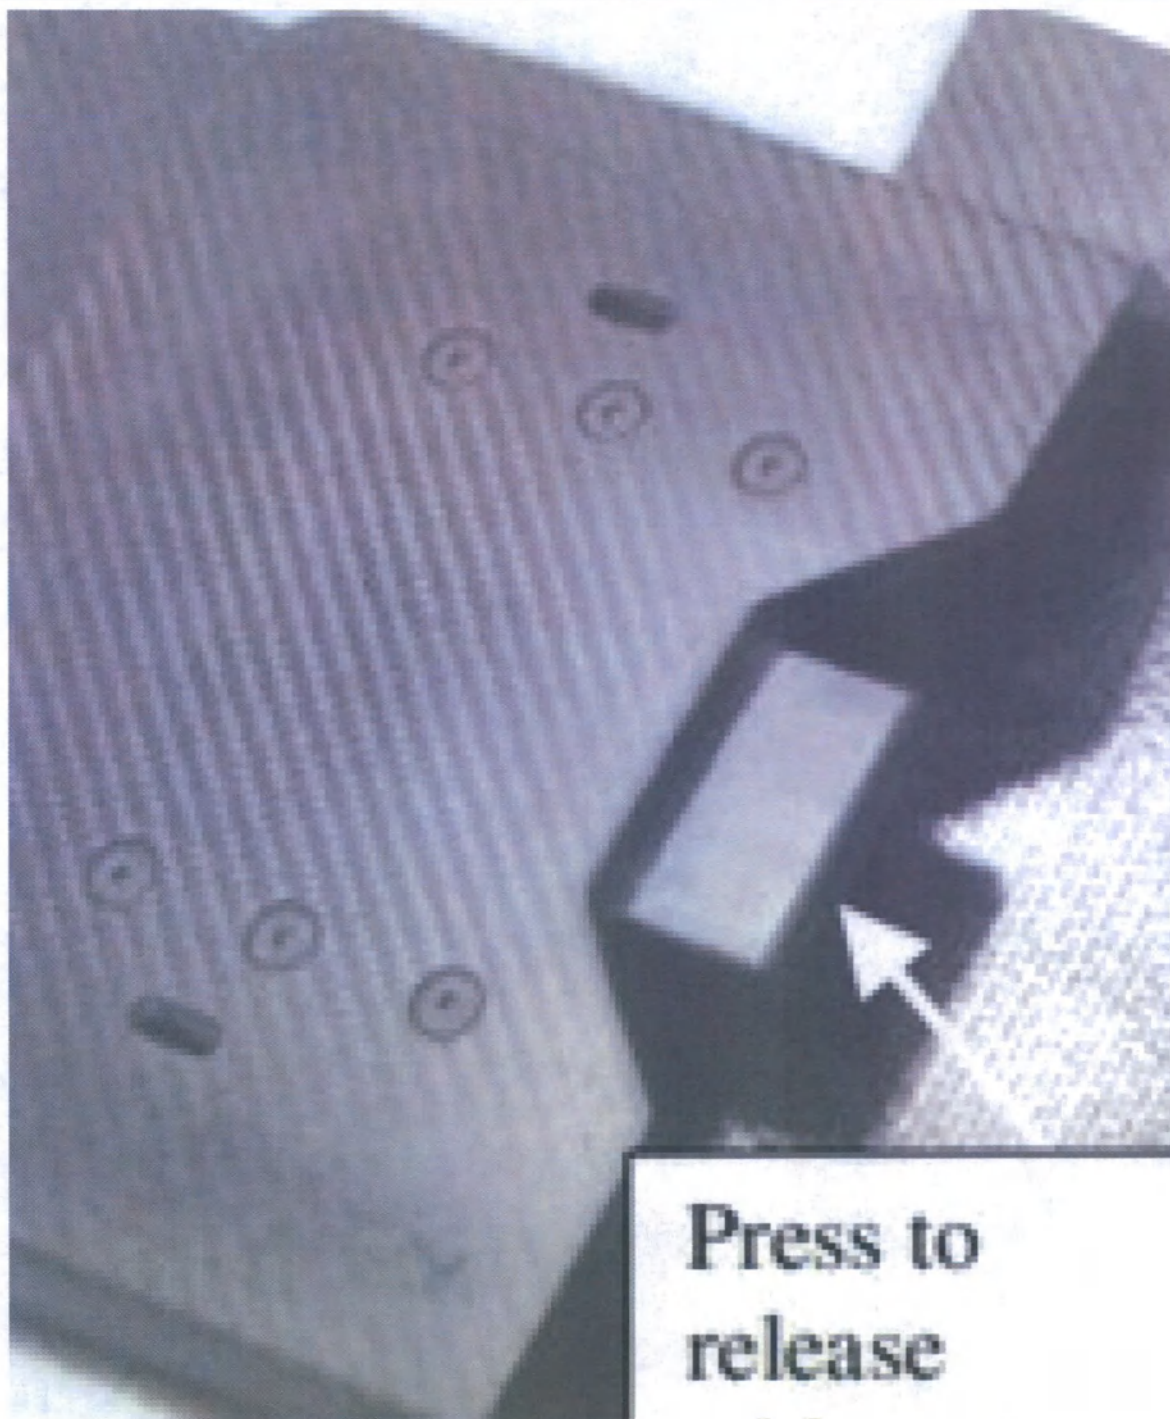


10. Приспособления для фиксации и позиционирования пациентов (не более 10 шт.).

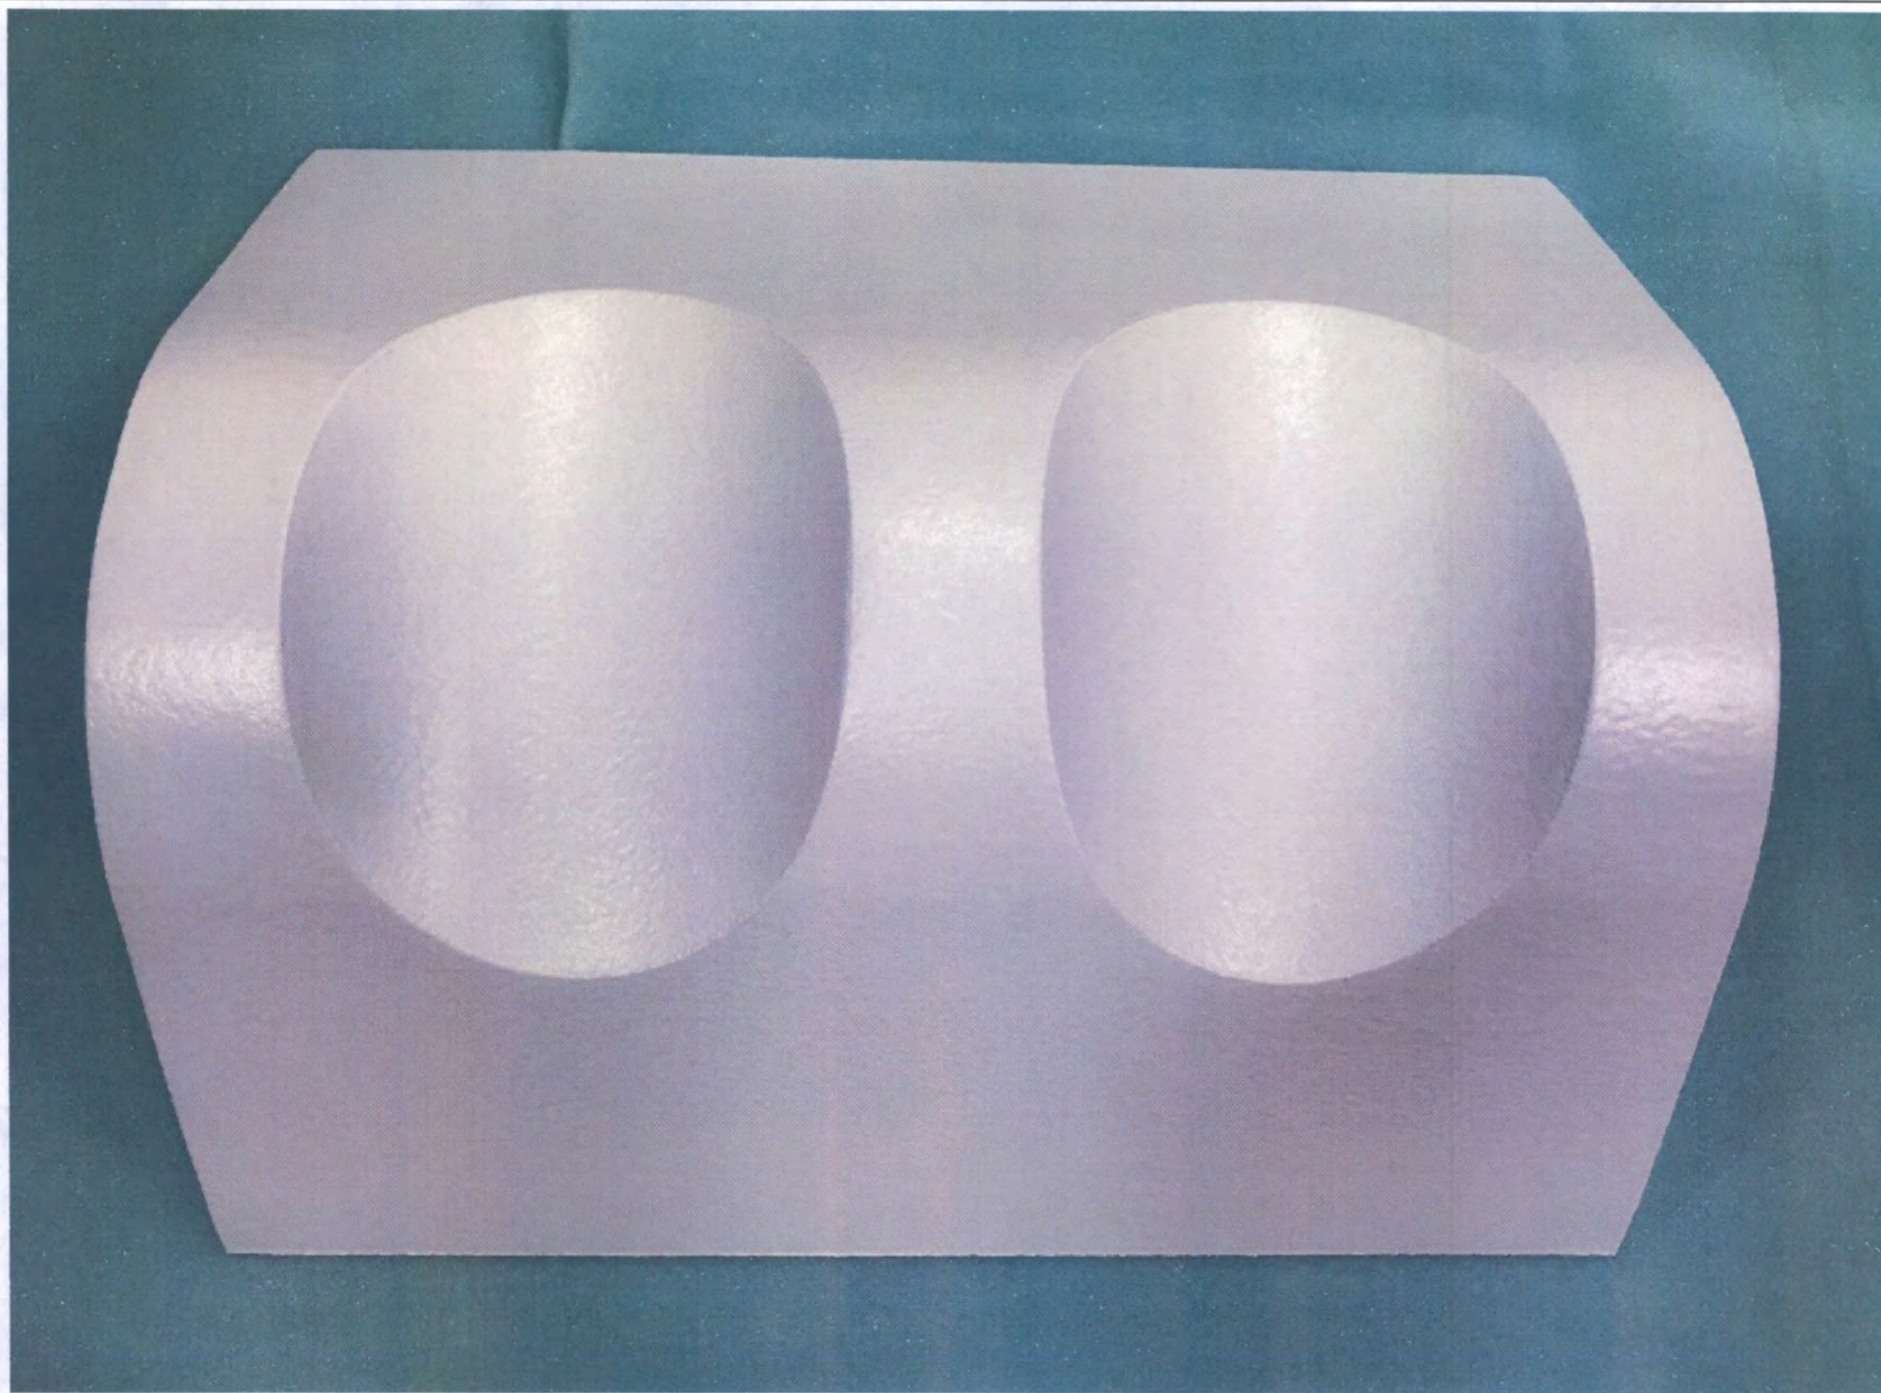


10. Приспособления для фиксации и позиционирования пациентов (не более 10 шт.).




10. Приспособления для фиксации и позиционирования пациентов (не более 10 шт.).

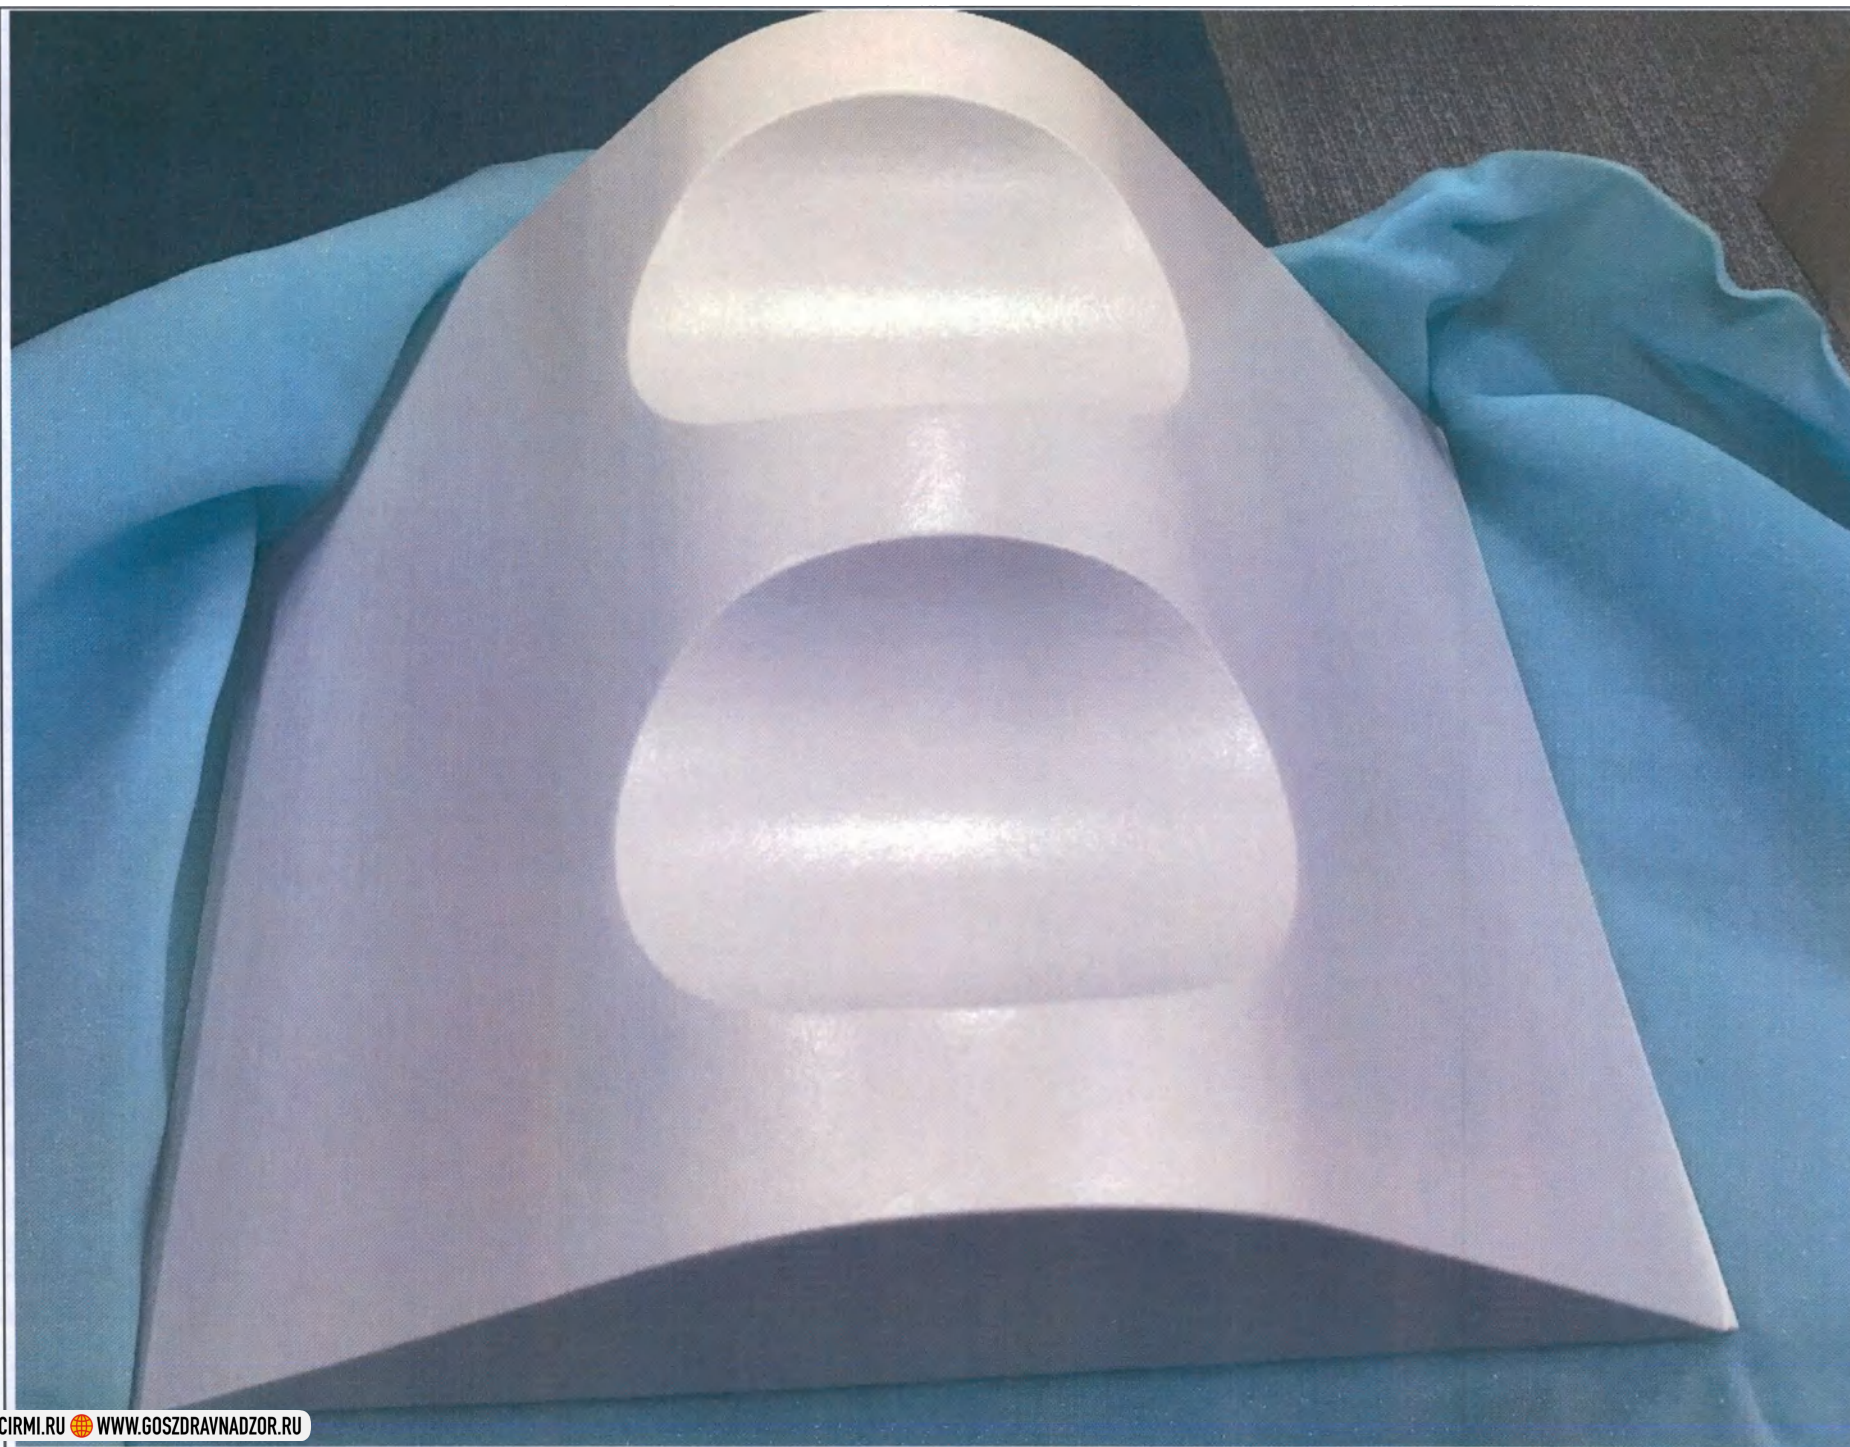


11. Ремни для фиксации пациента (не более 20 шт.).

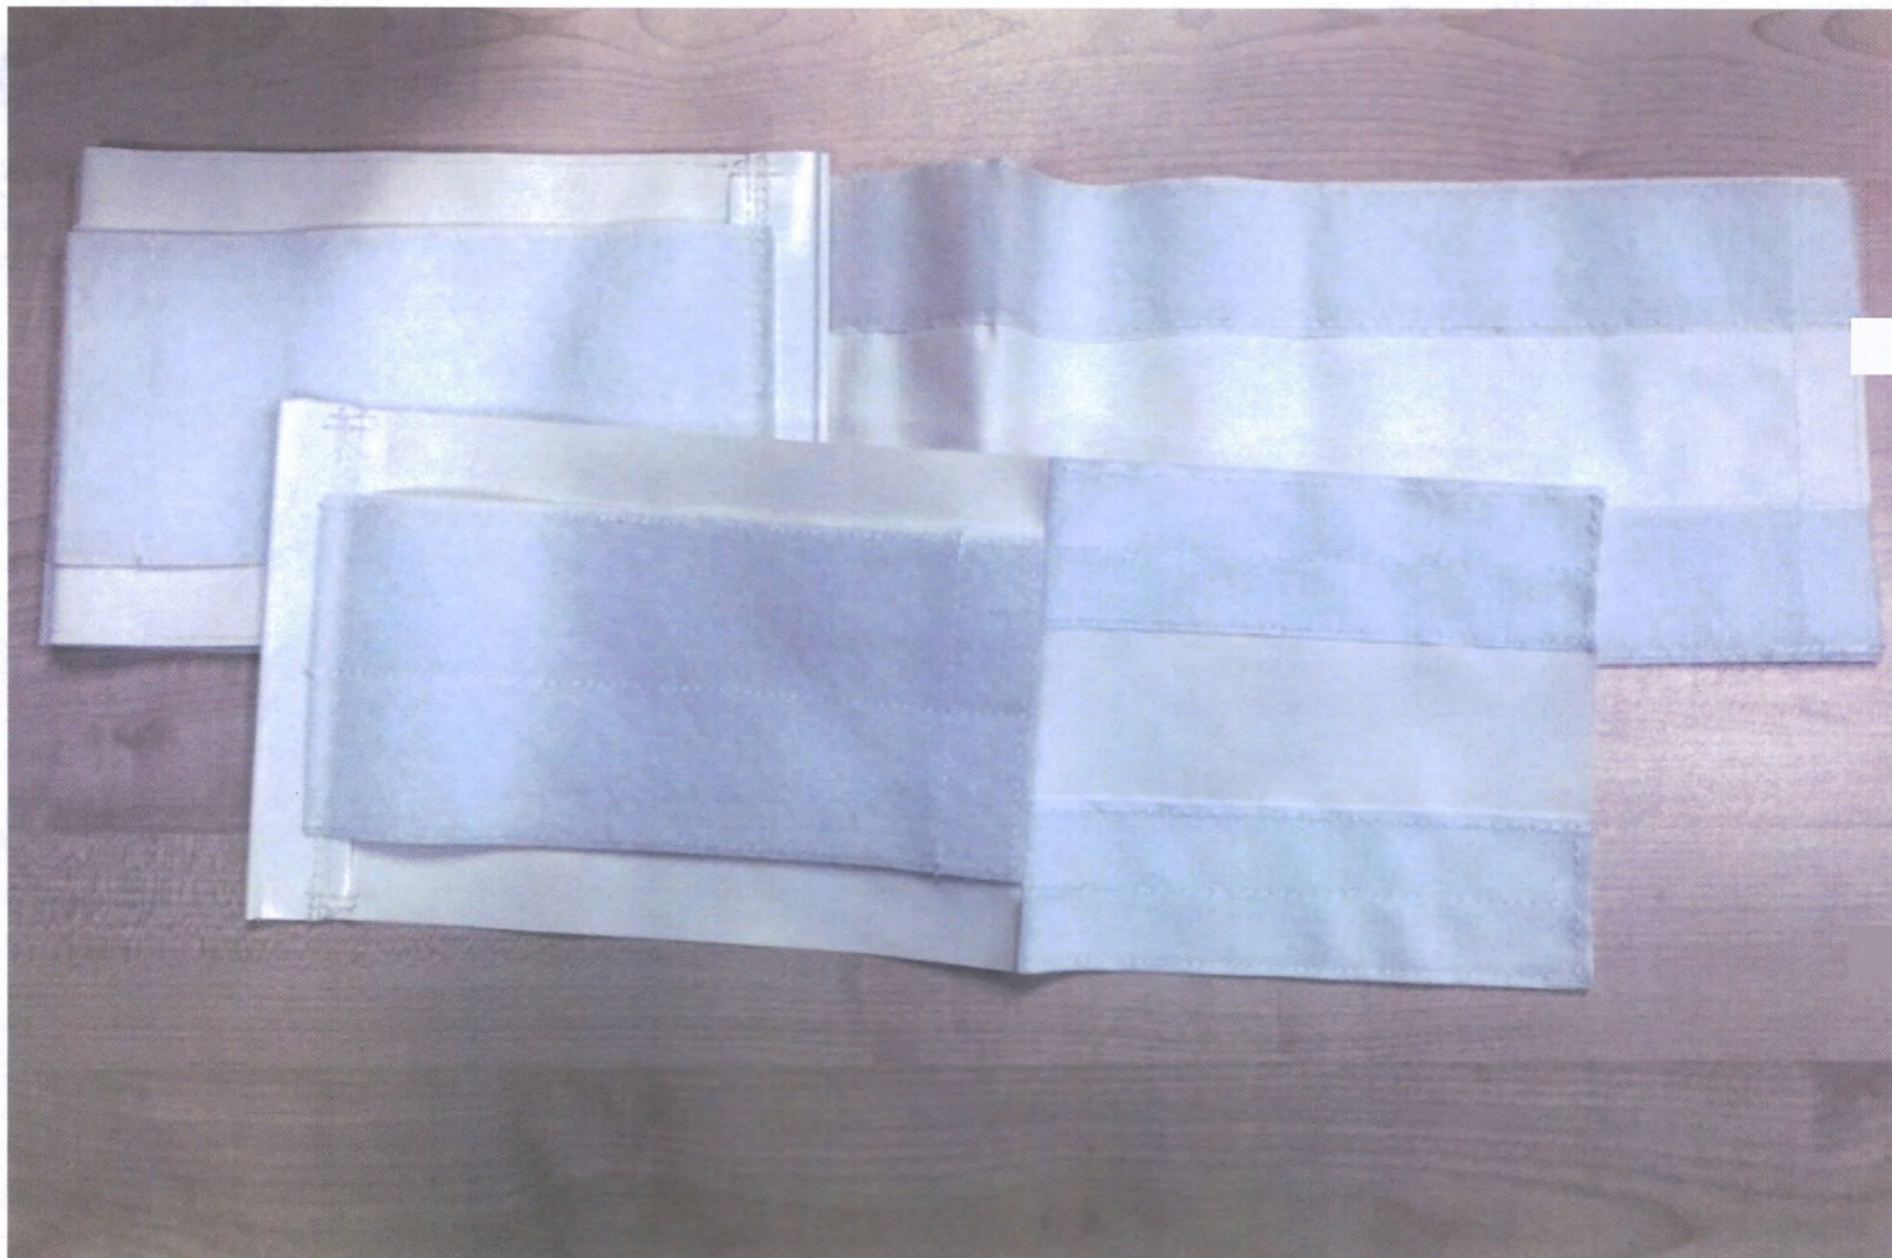

11. Ремни для фиксации пациента (не более 20 шт.).

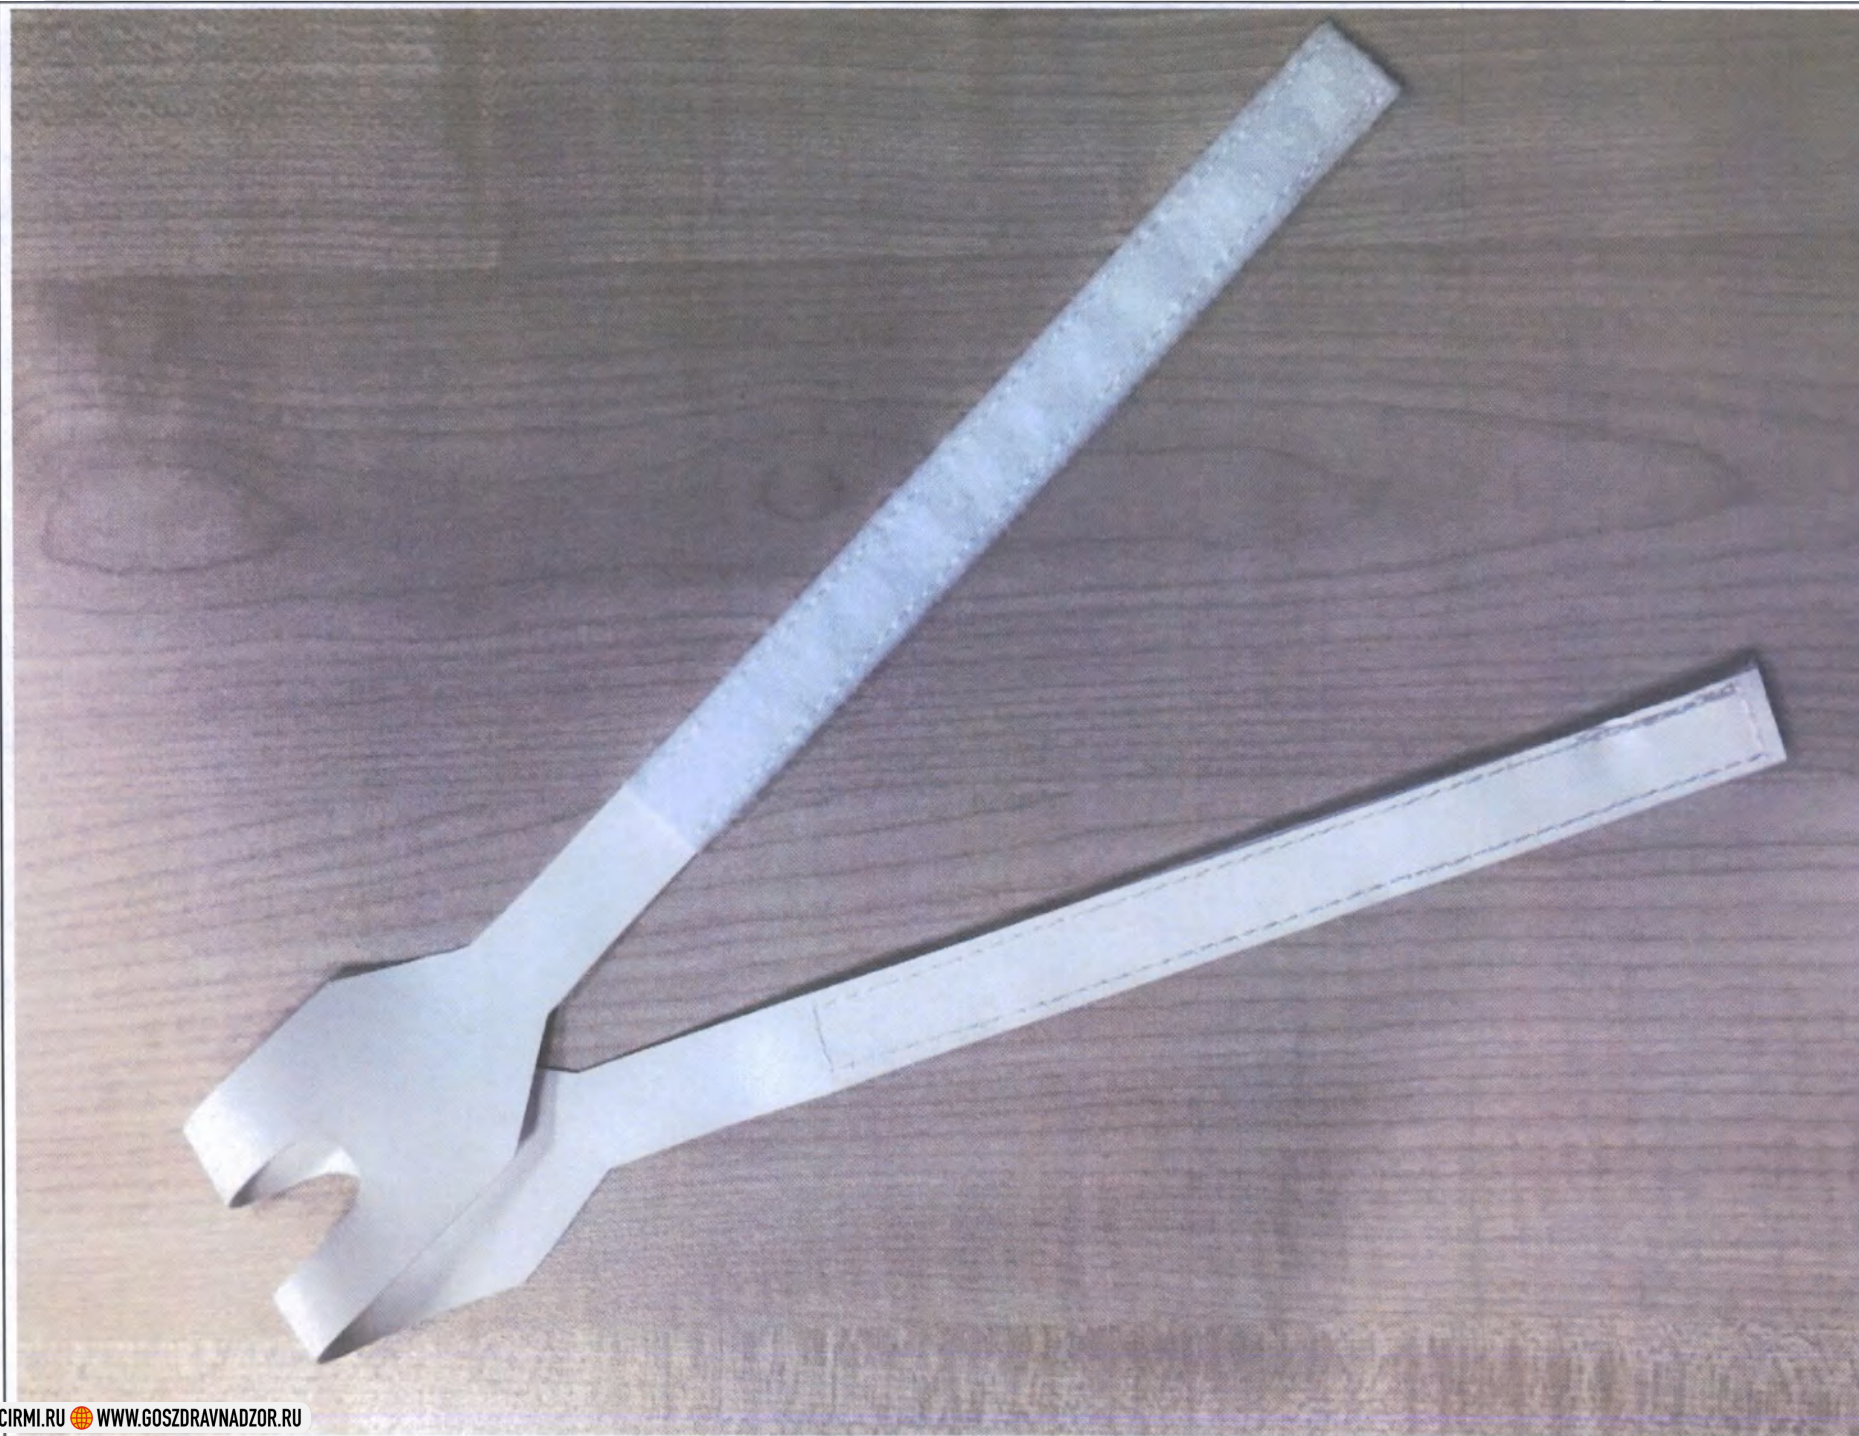


11. Ремни для фиксации пациента (не более 20 шт.).

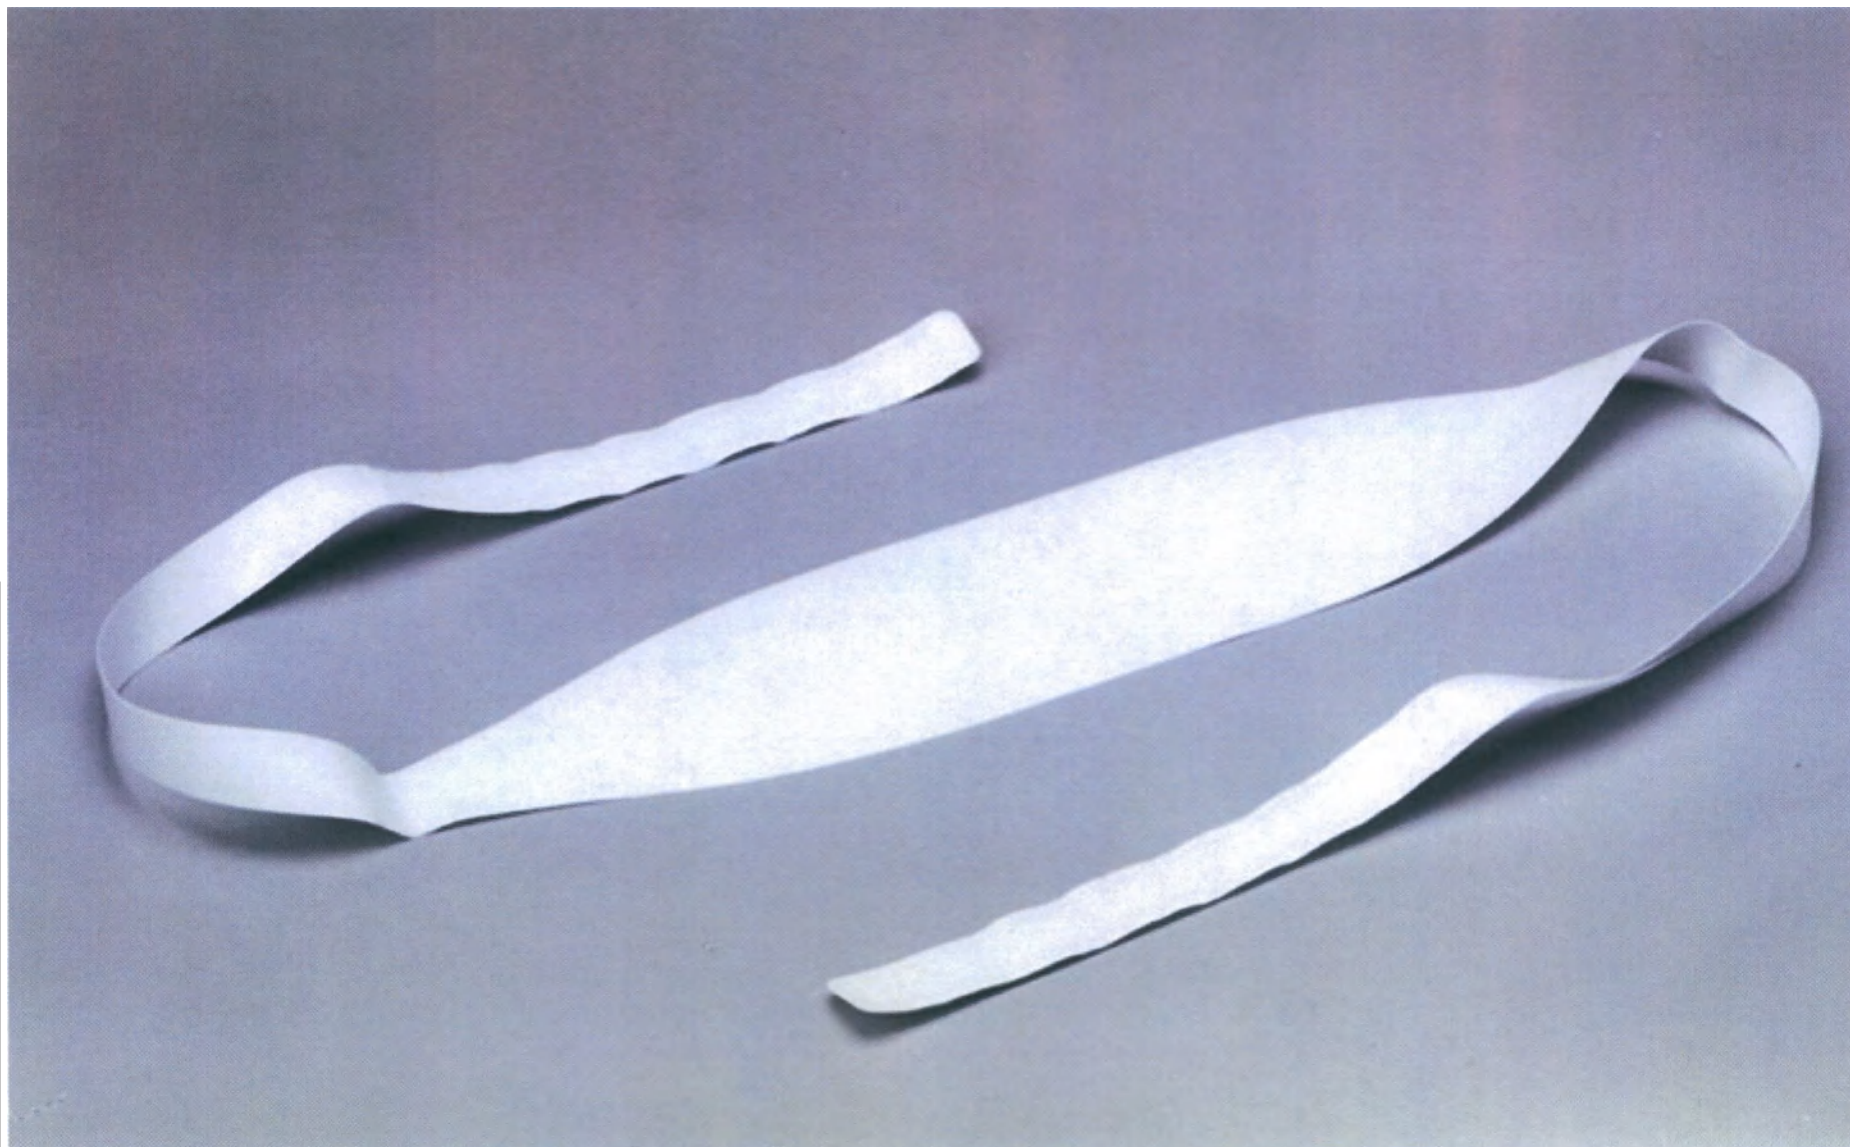


11. Ремни для фиксации пациента (не более 20 шт.).




11. Ремни для фиксации пациента (не более 20 шт.).

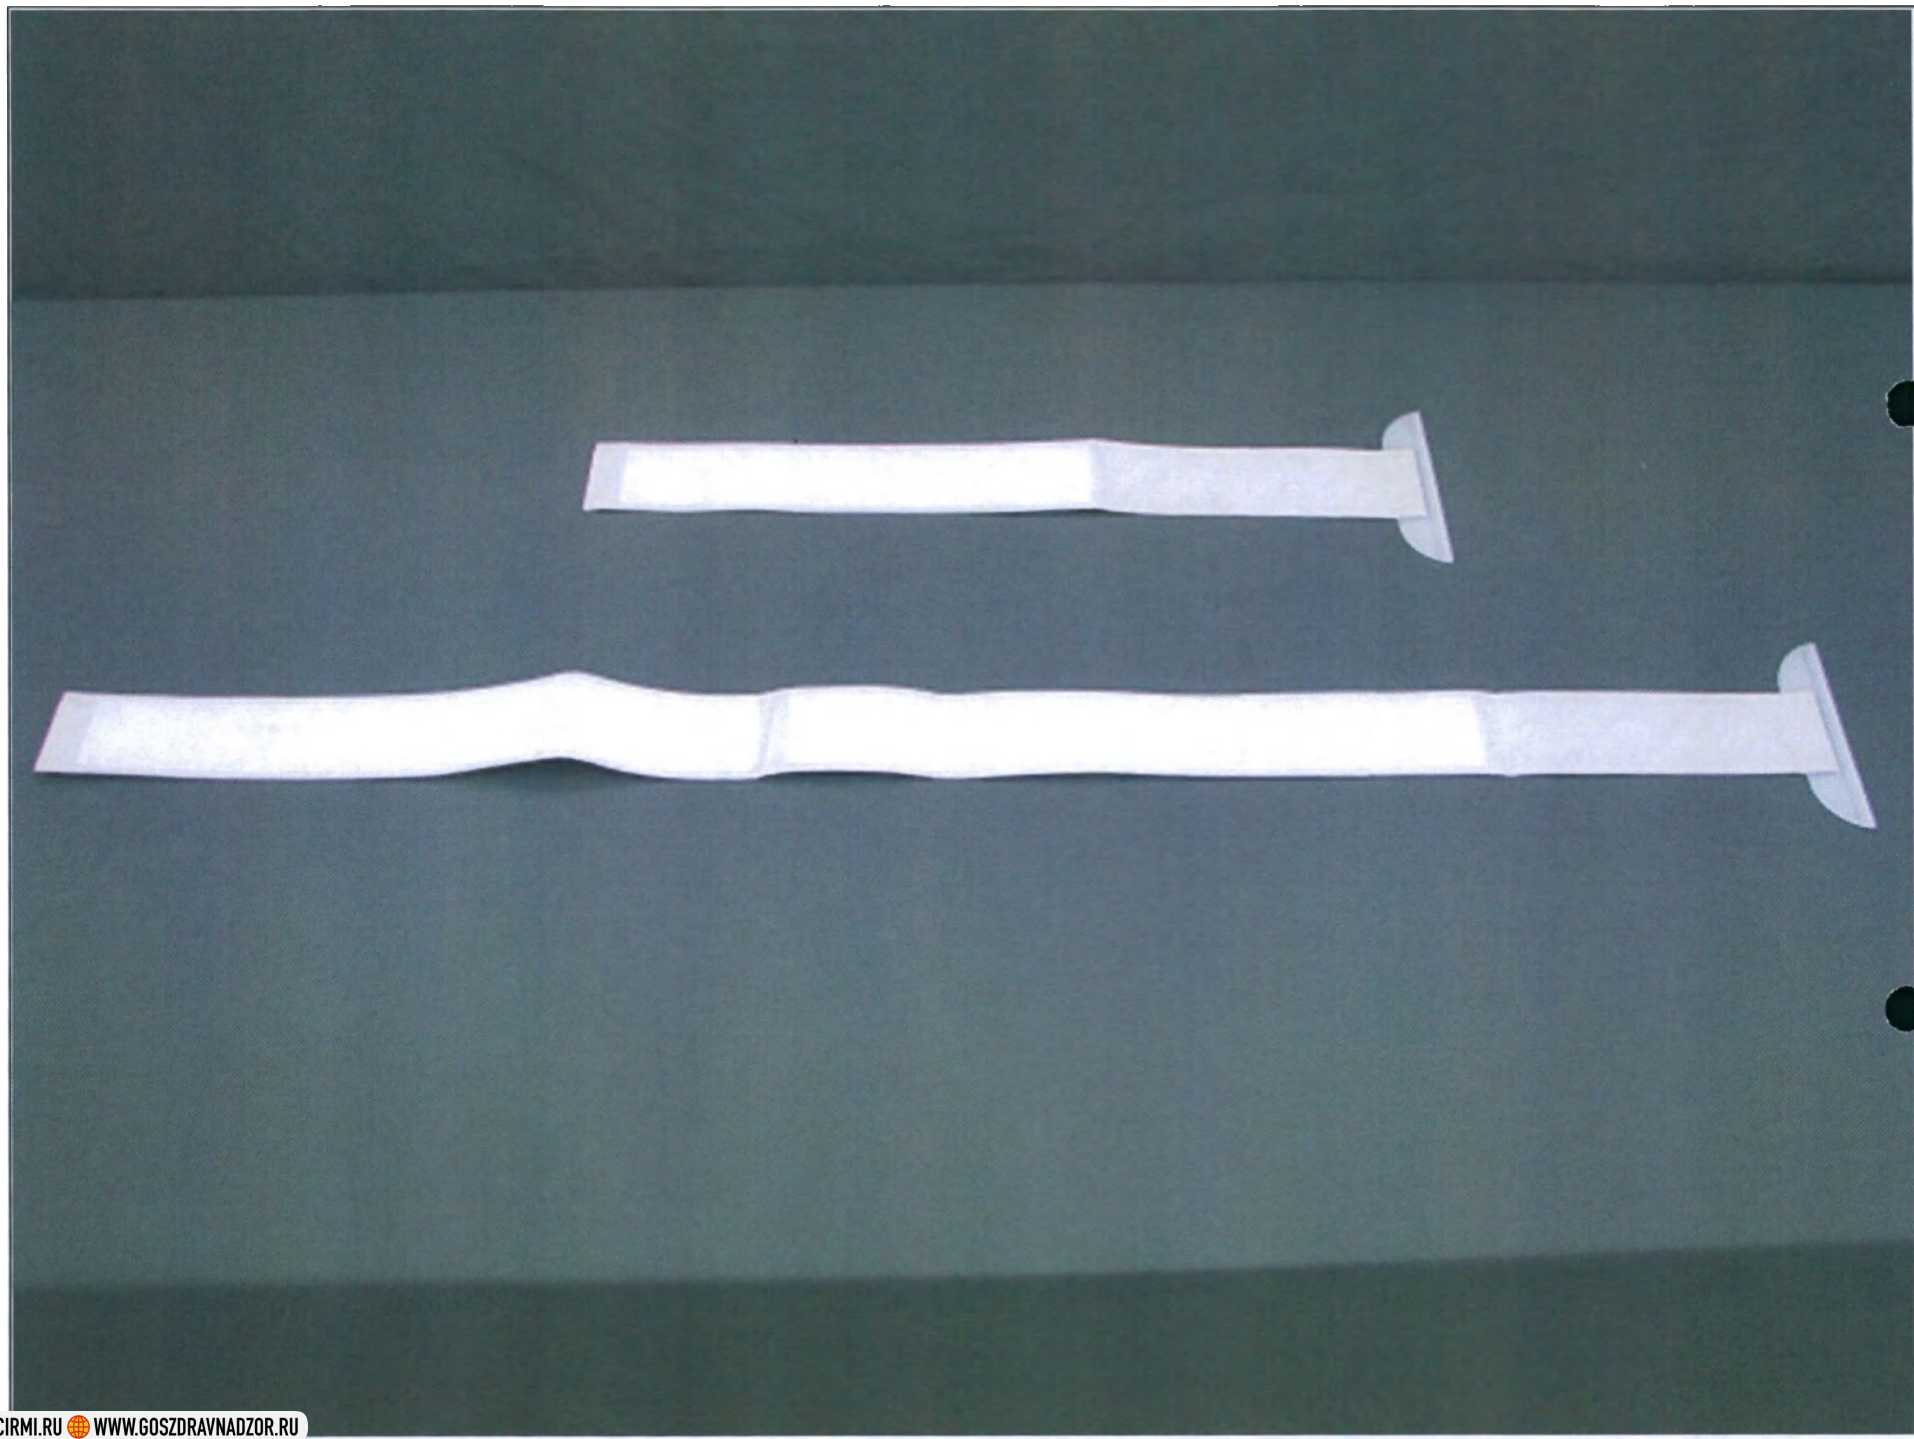


11. Ремни для фиксации пациента (не более 20 шт.).

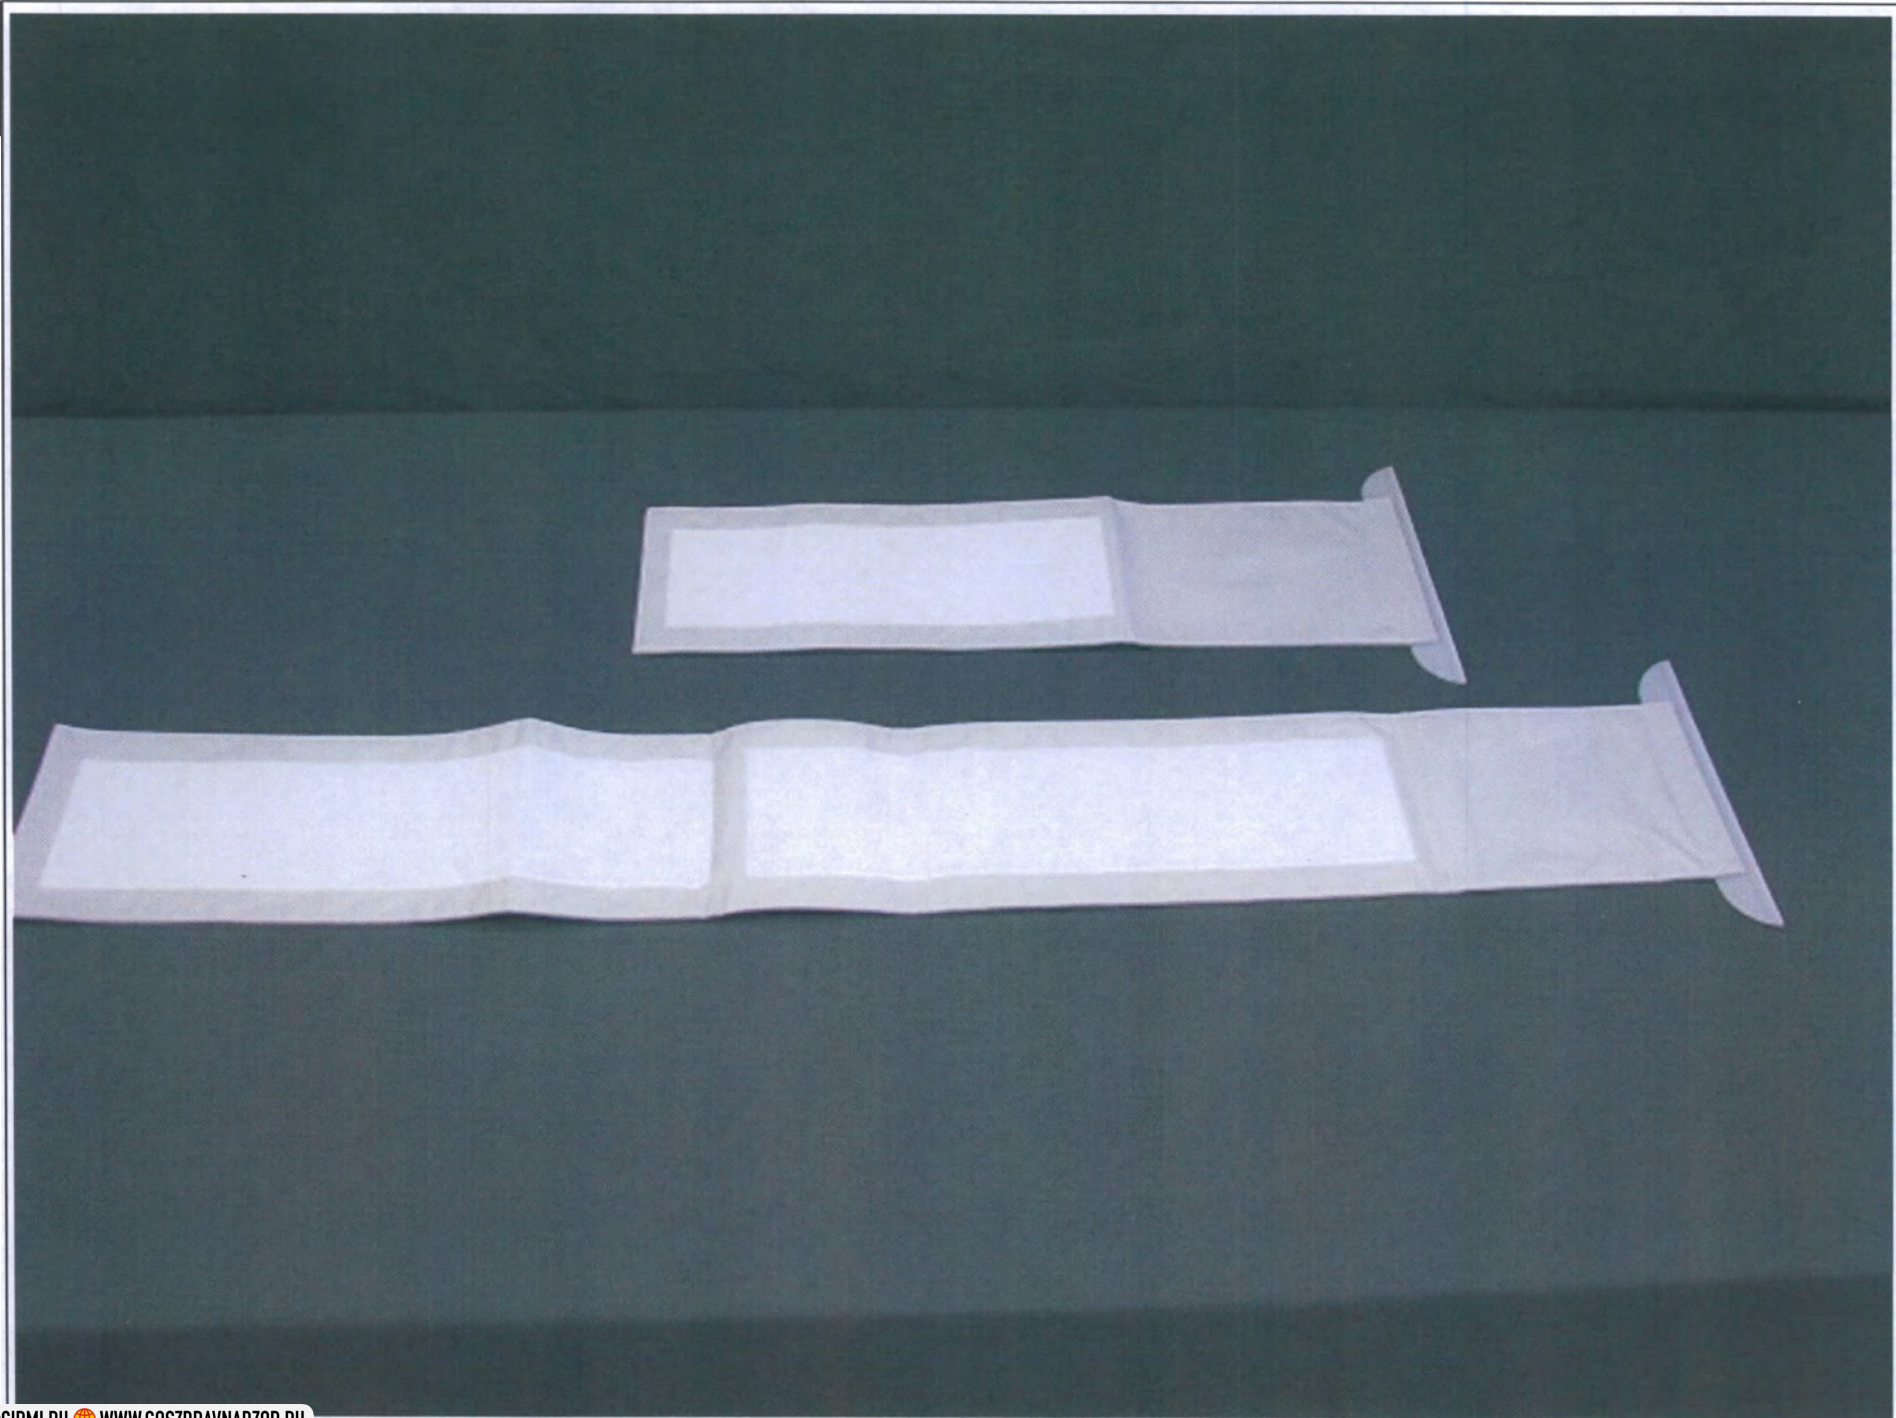

11. Ремни для фиксации пациента (не более 20 шт.).

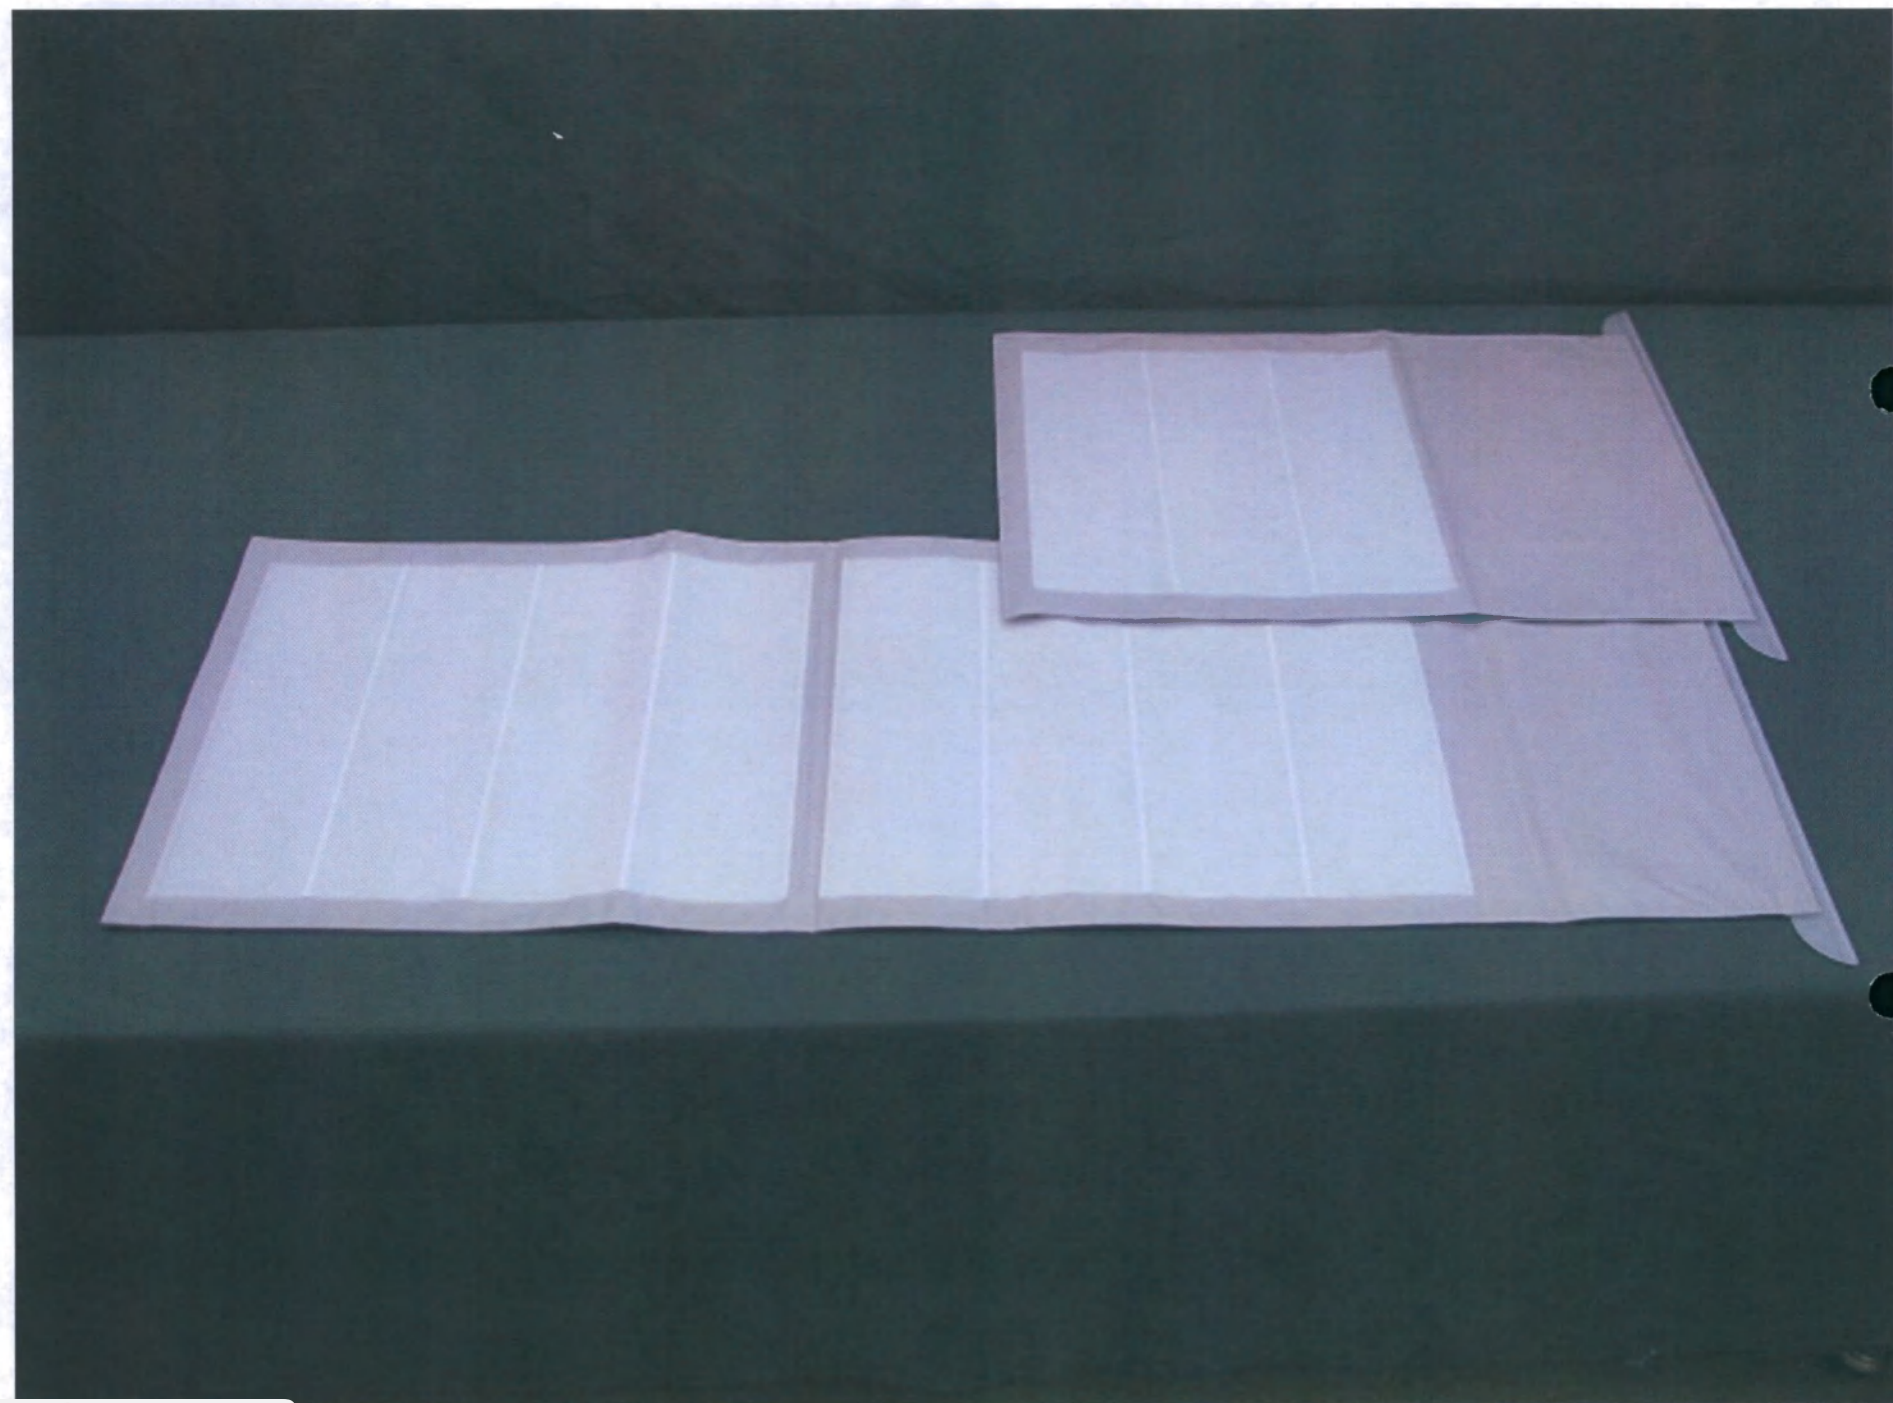


11. Ремни для фиксации пациента (не более 20 шт.).

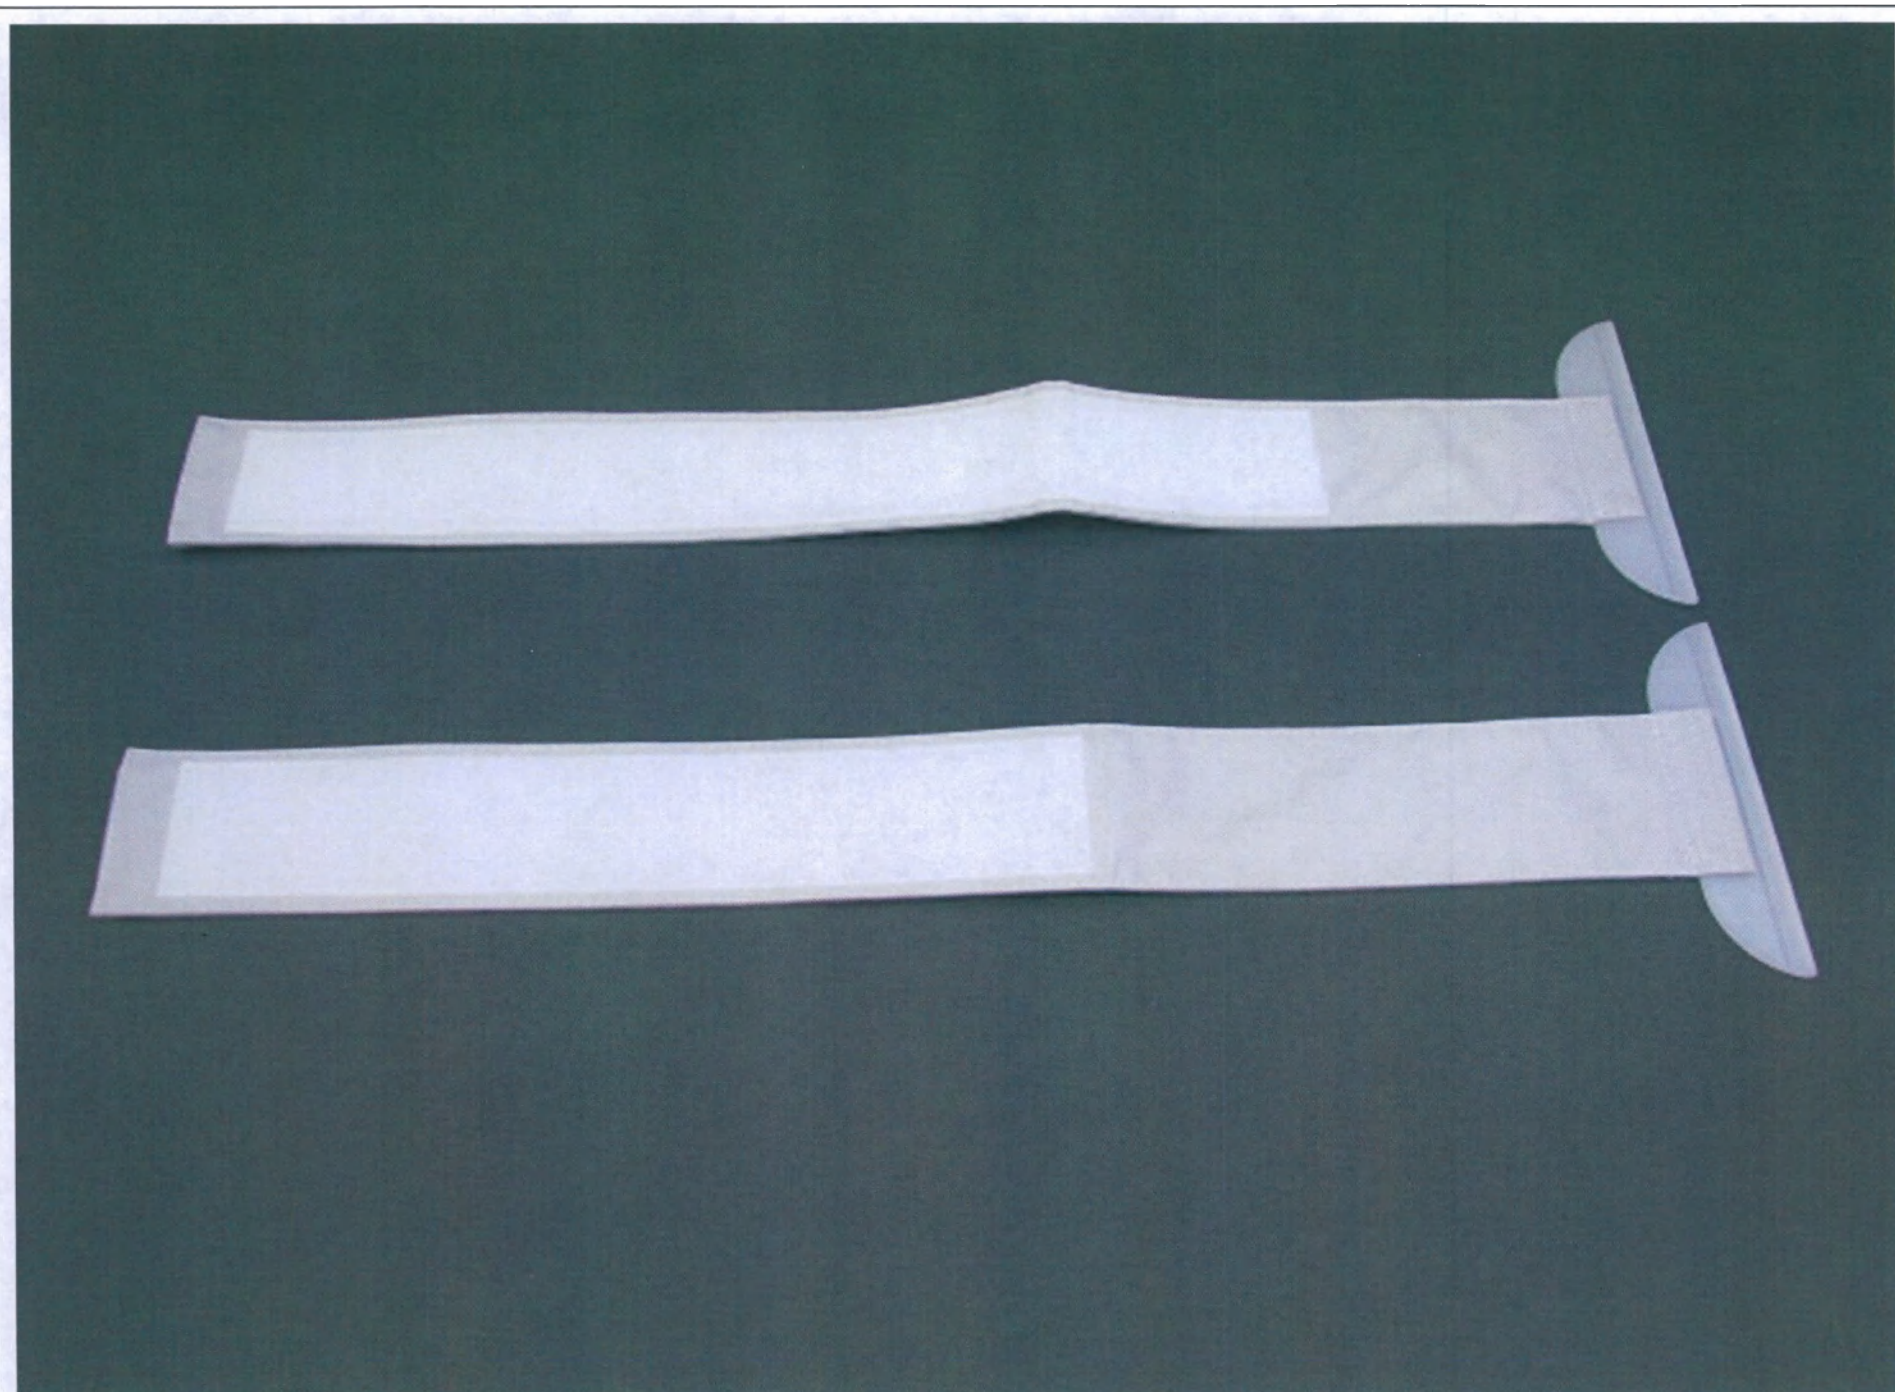


12. Подголовники (не более 4 шт.).

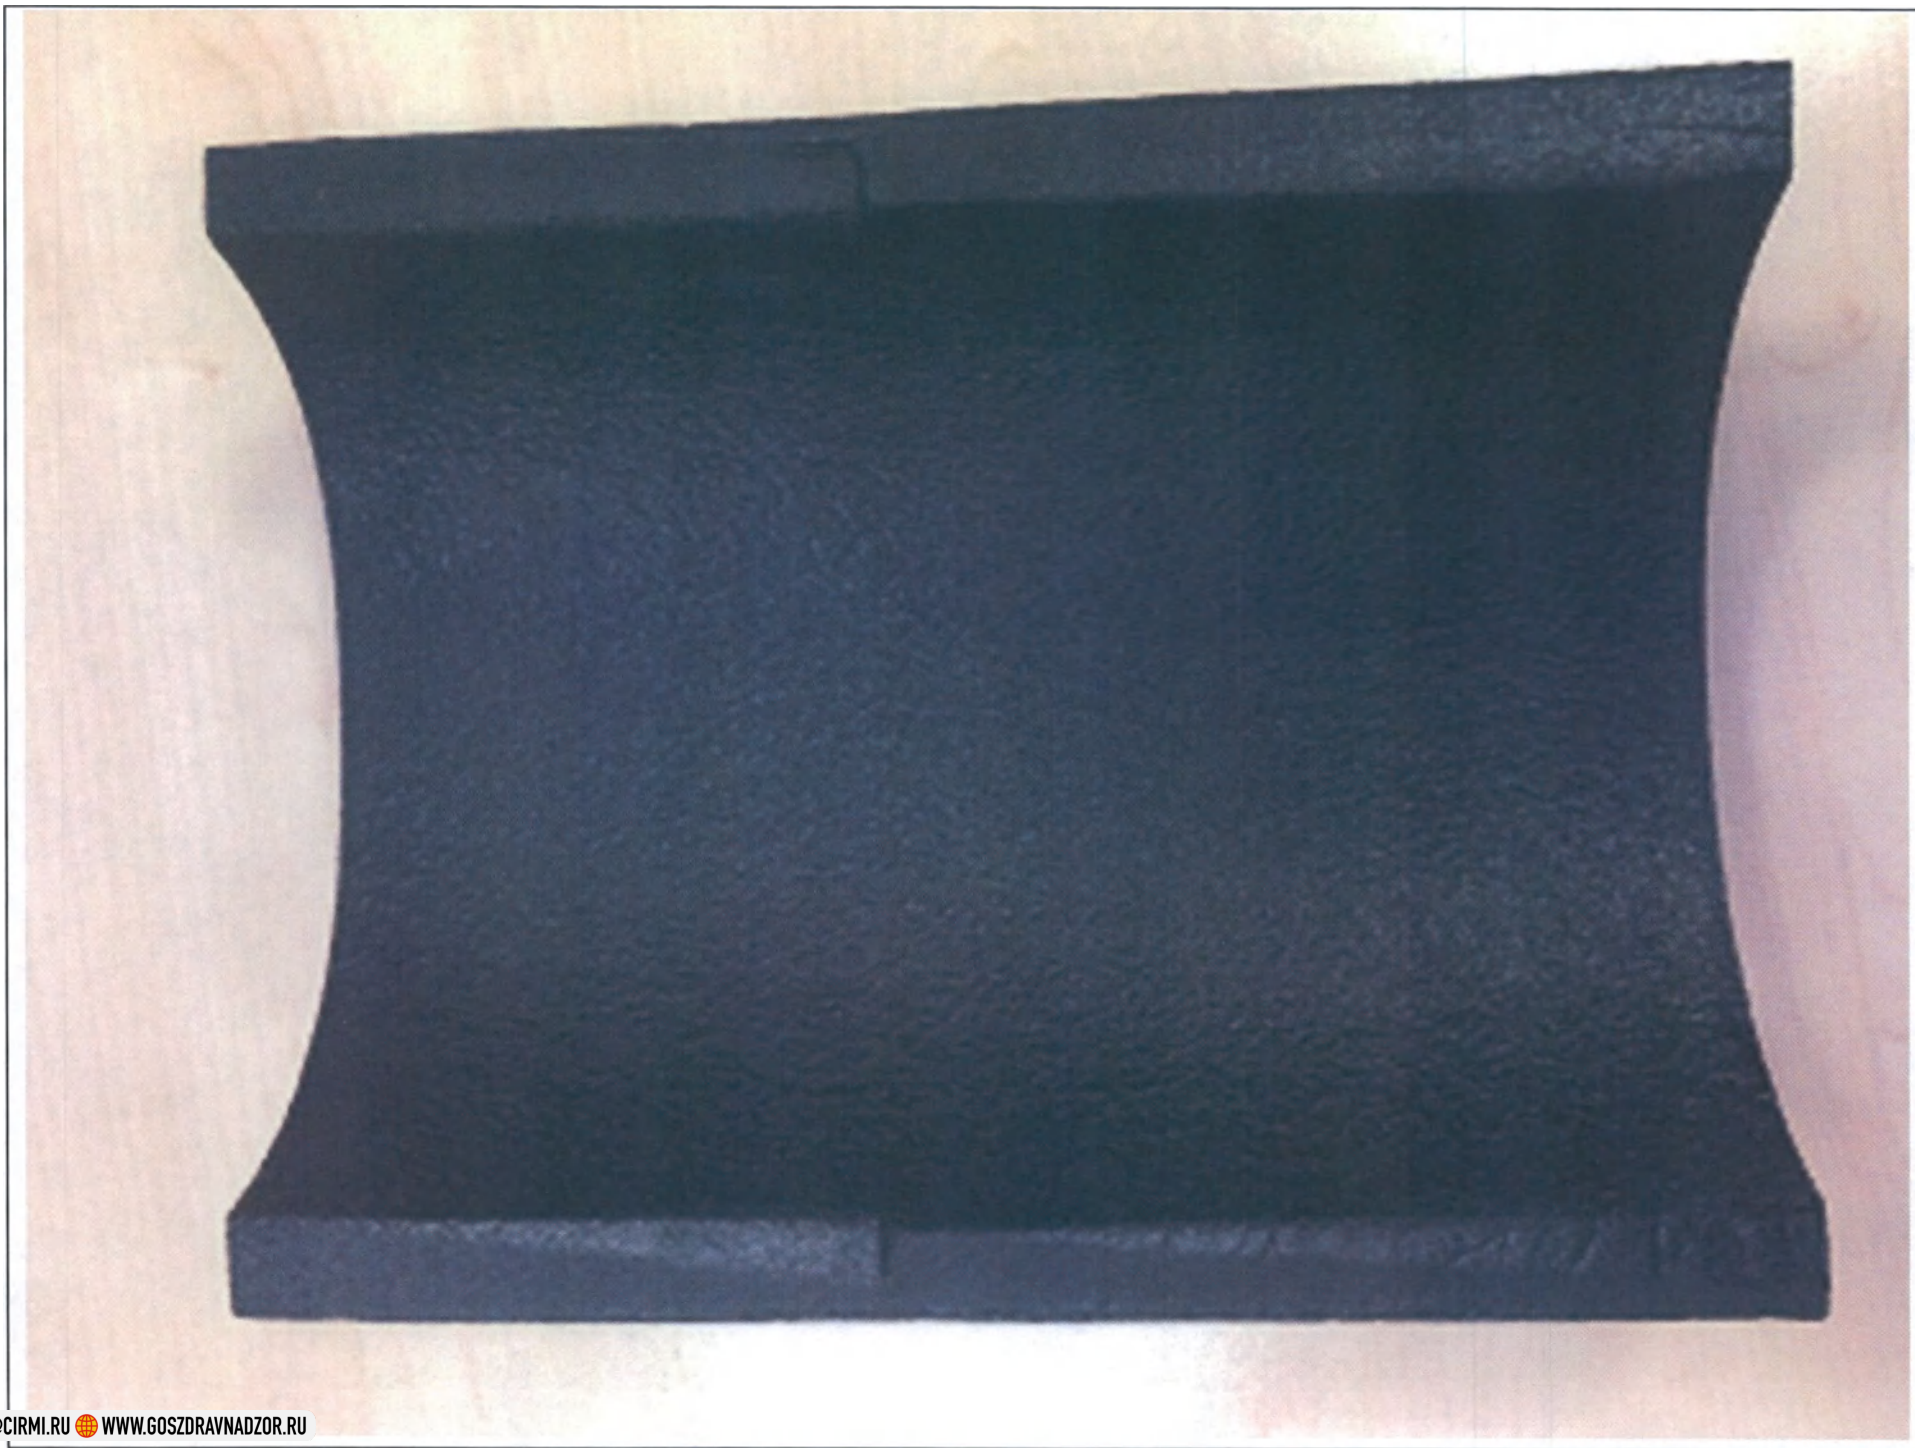


12. Подголовники (не более 4 шт.).

12. Подголовники (не более 4 шт.).


13. Опоры для рук пациента (не более 4 шт.).

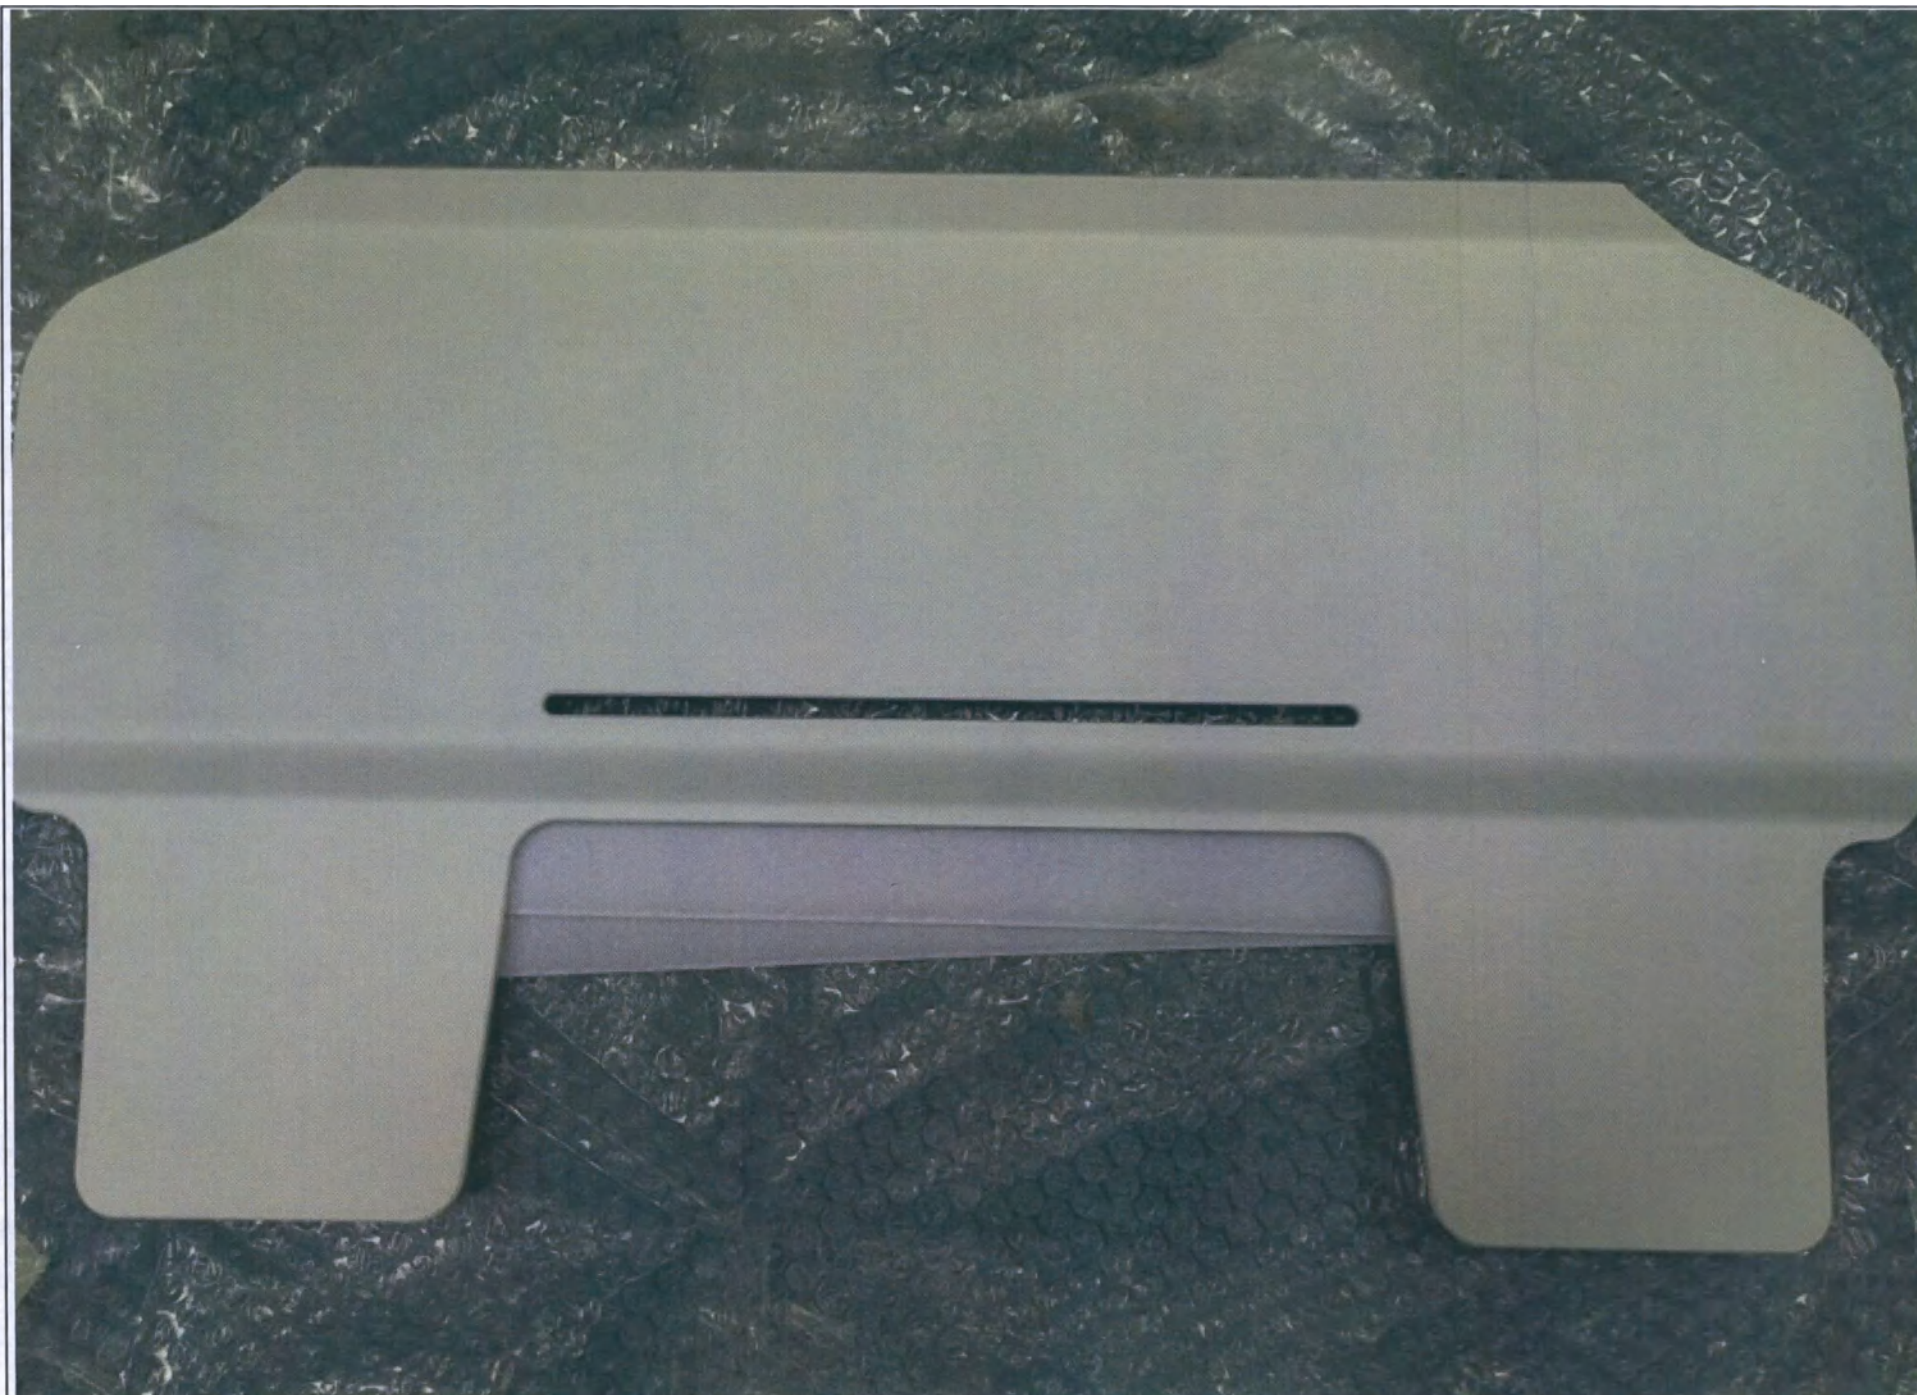


14. Опоры для ног пациента (не более 6 шт.).

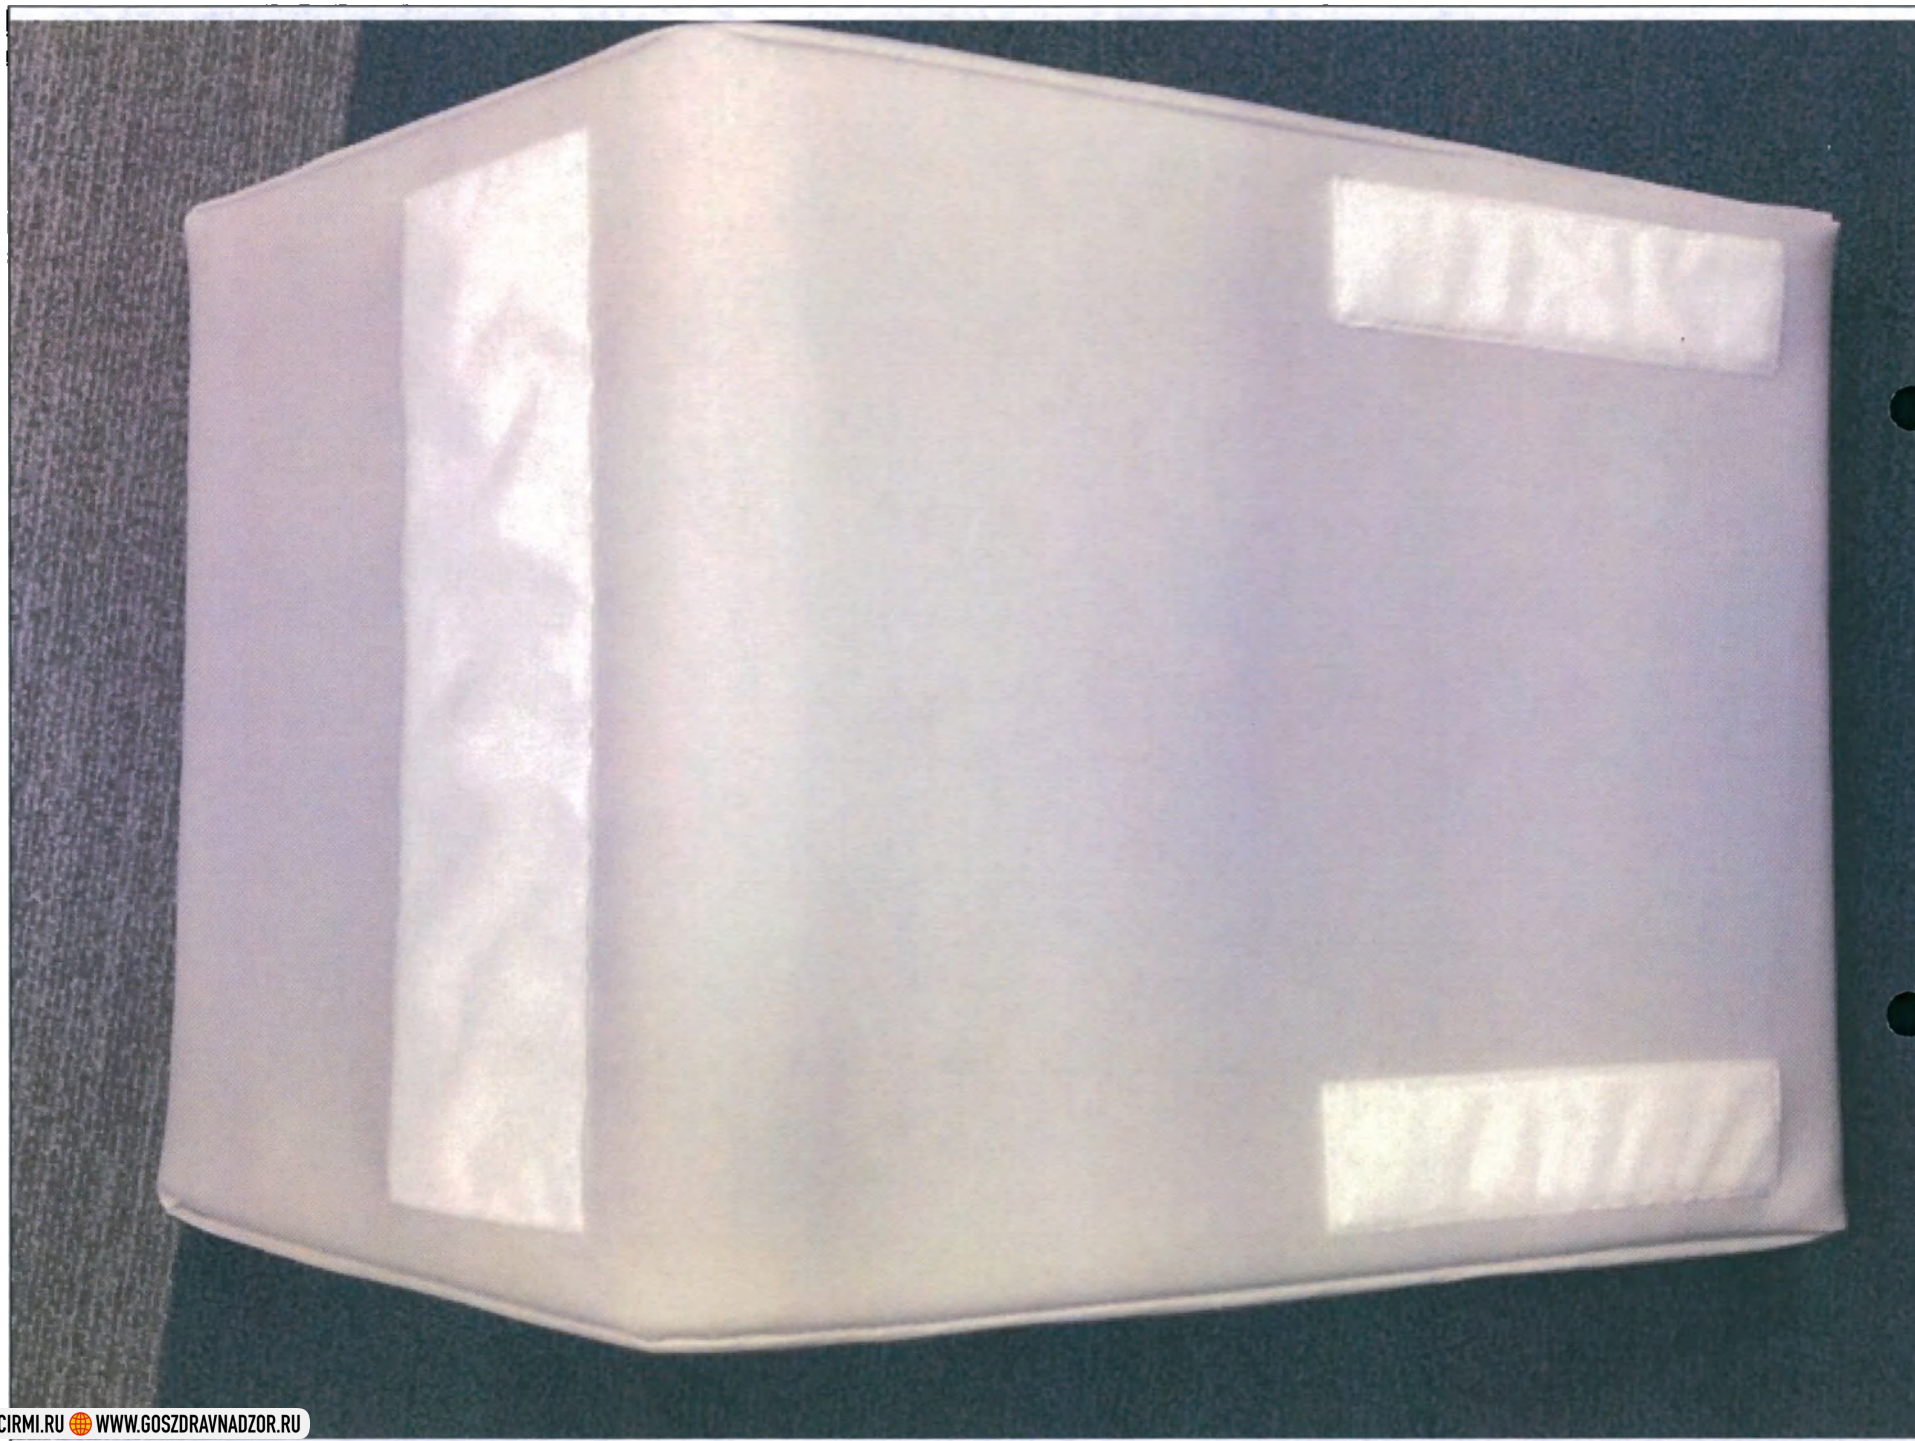


15. Приспособления для позиционирования детей (не более 20 шт.).

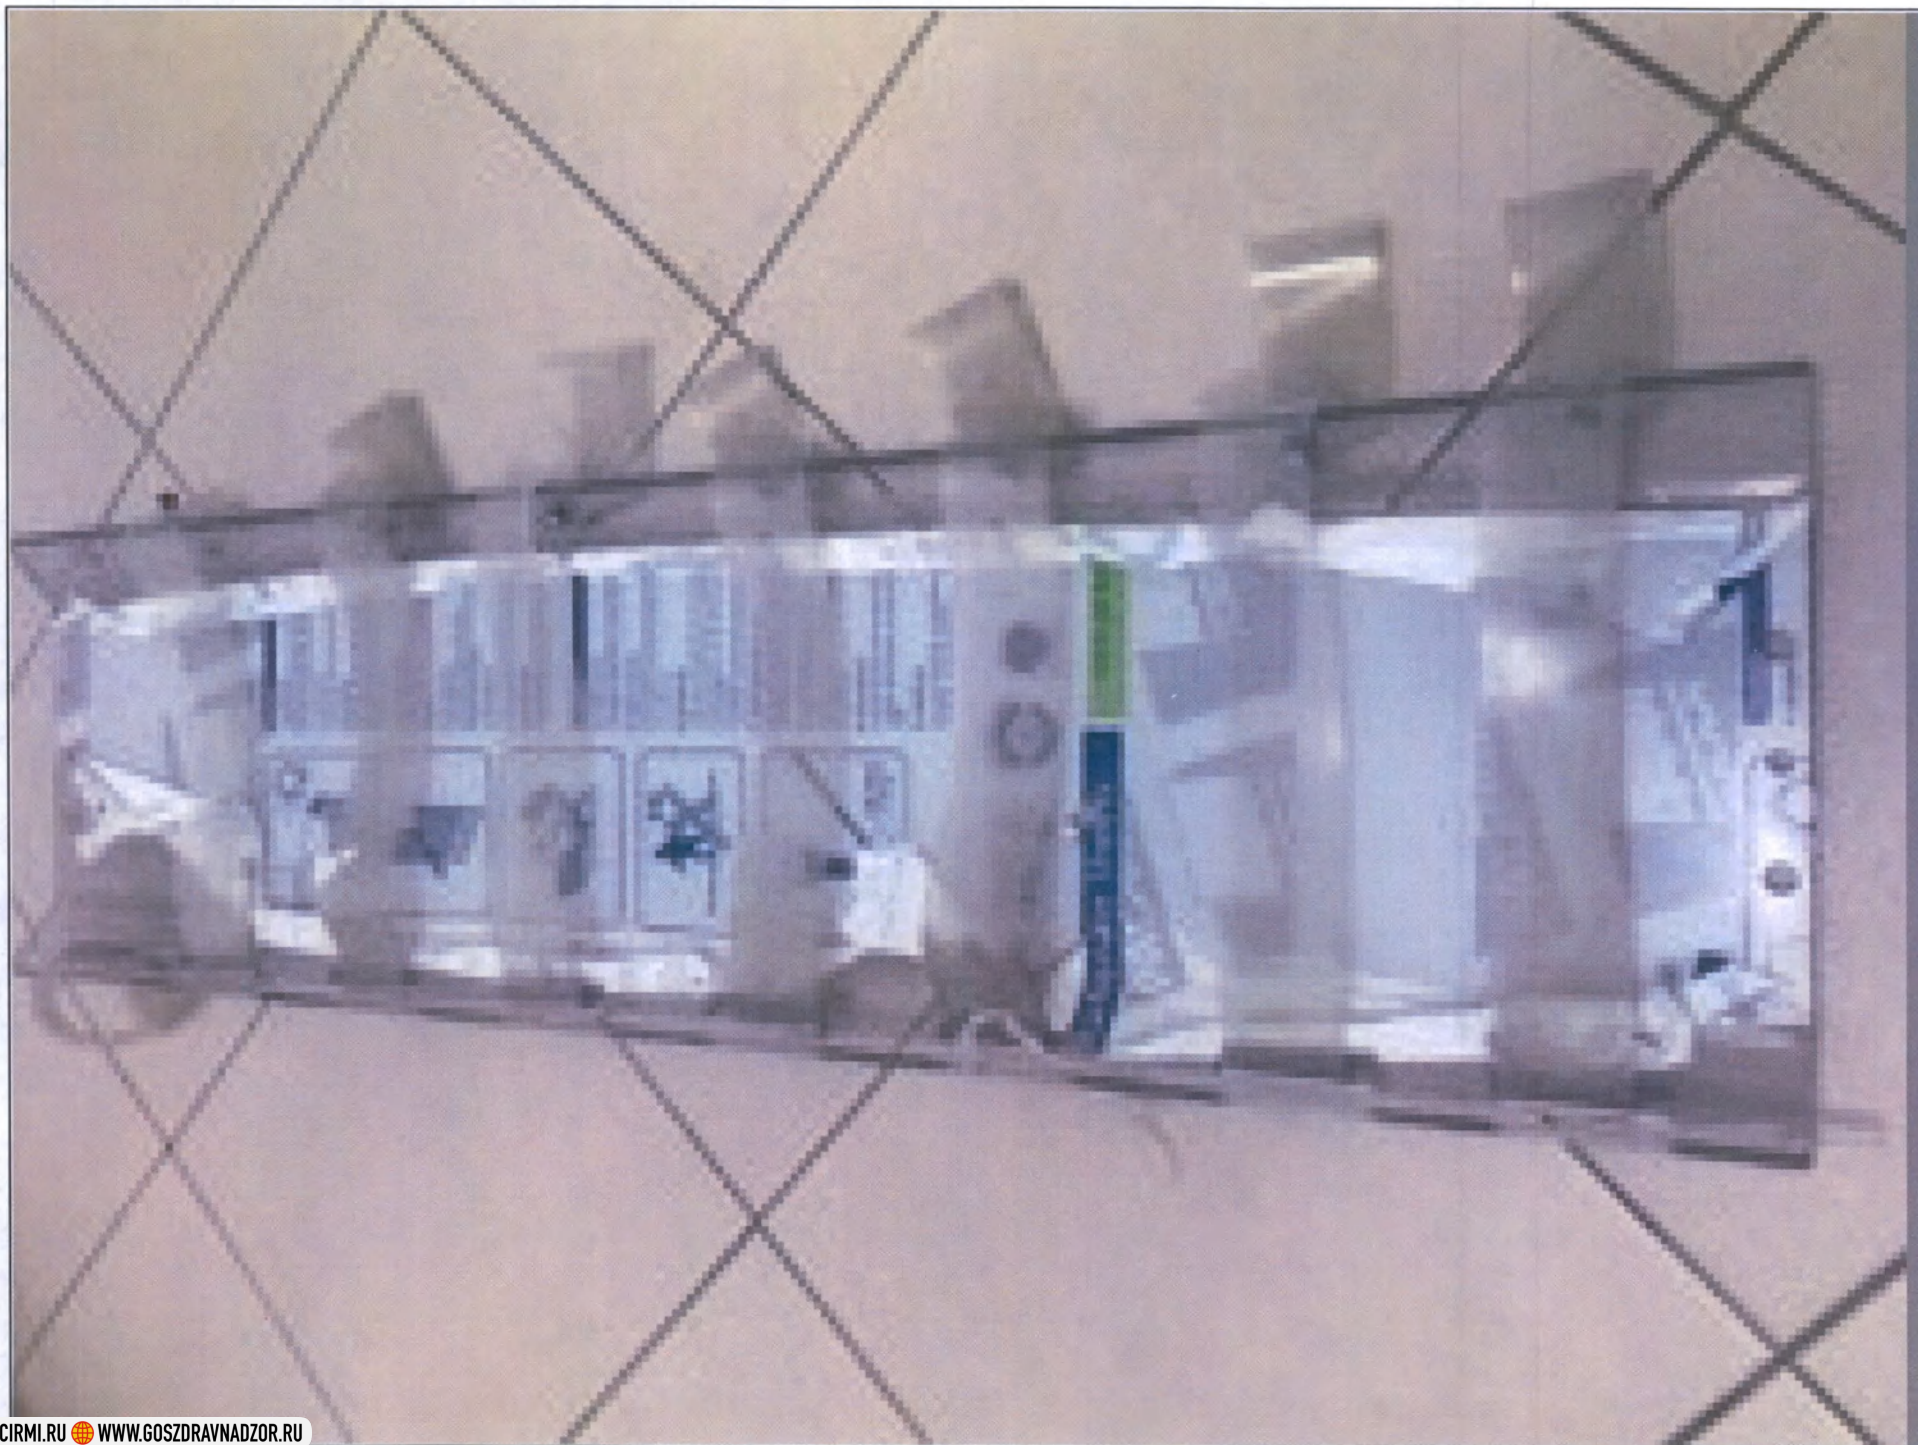


16. Держатели катетеров (не более 10 шт.).

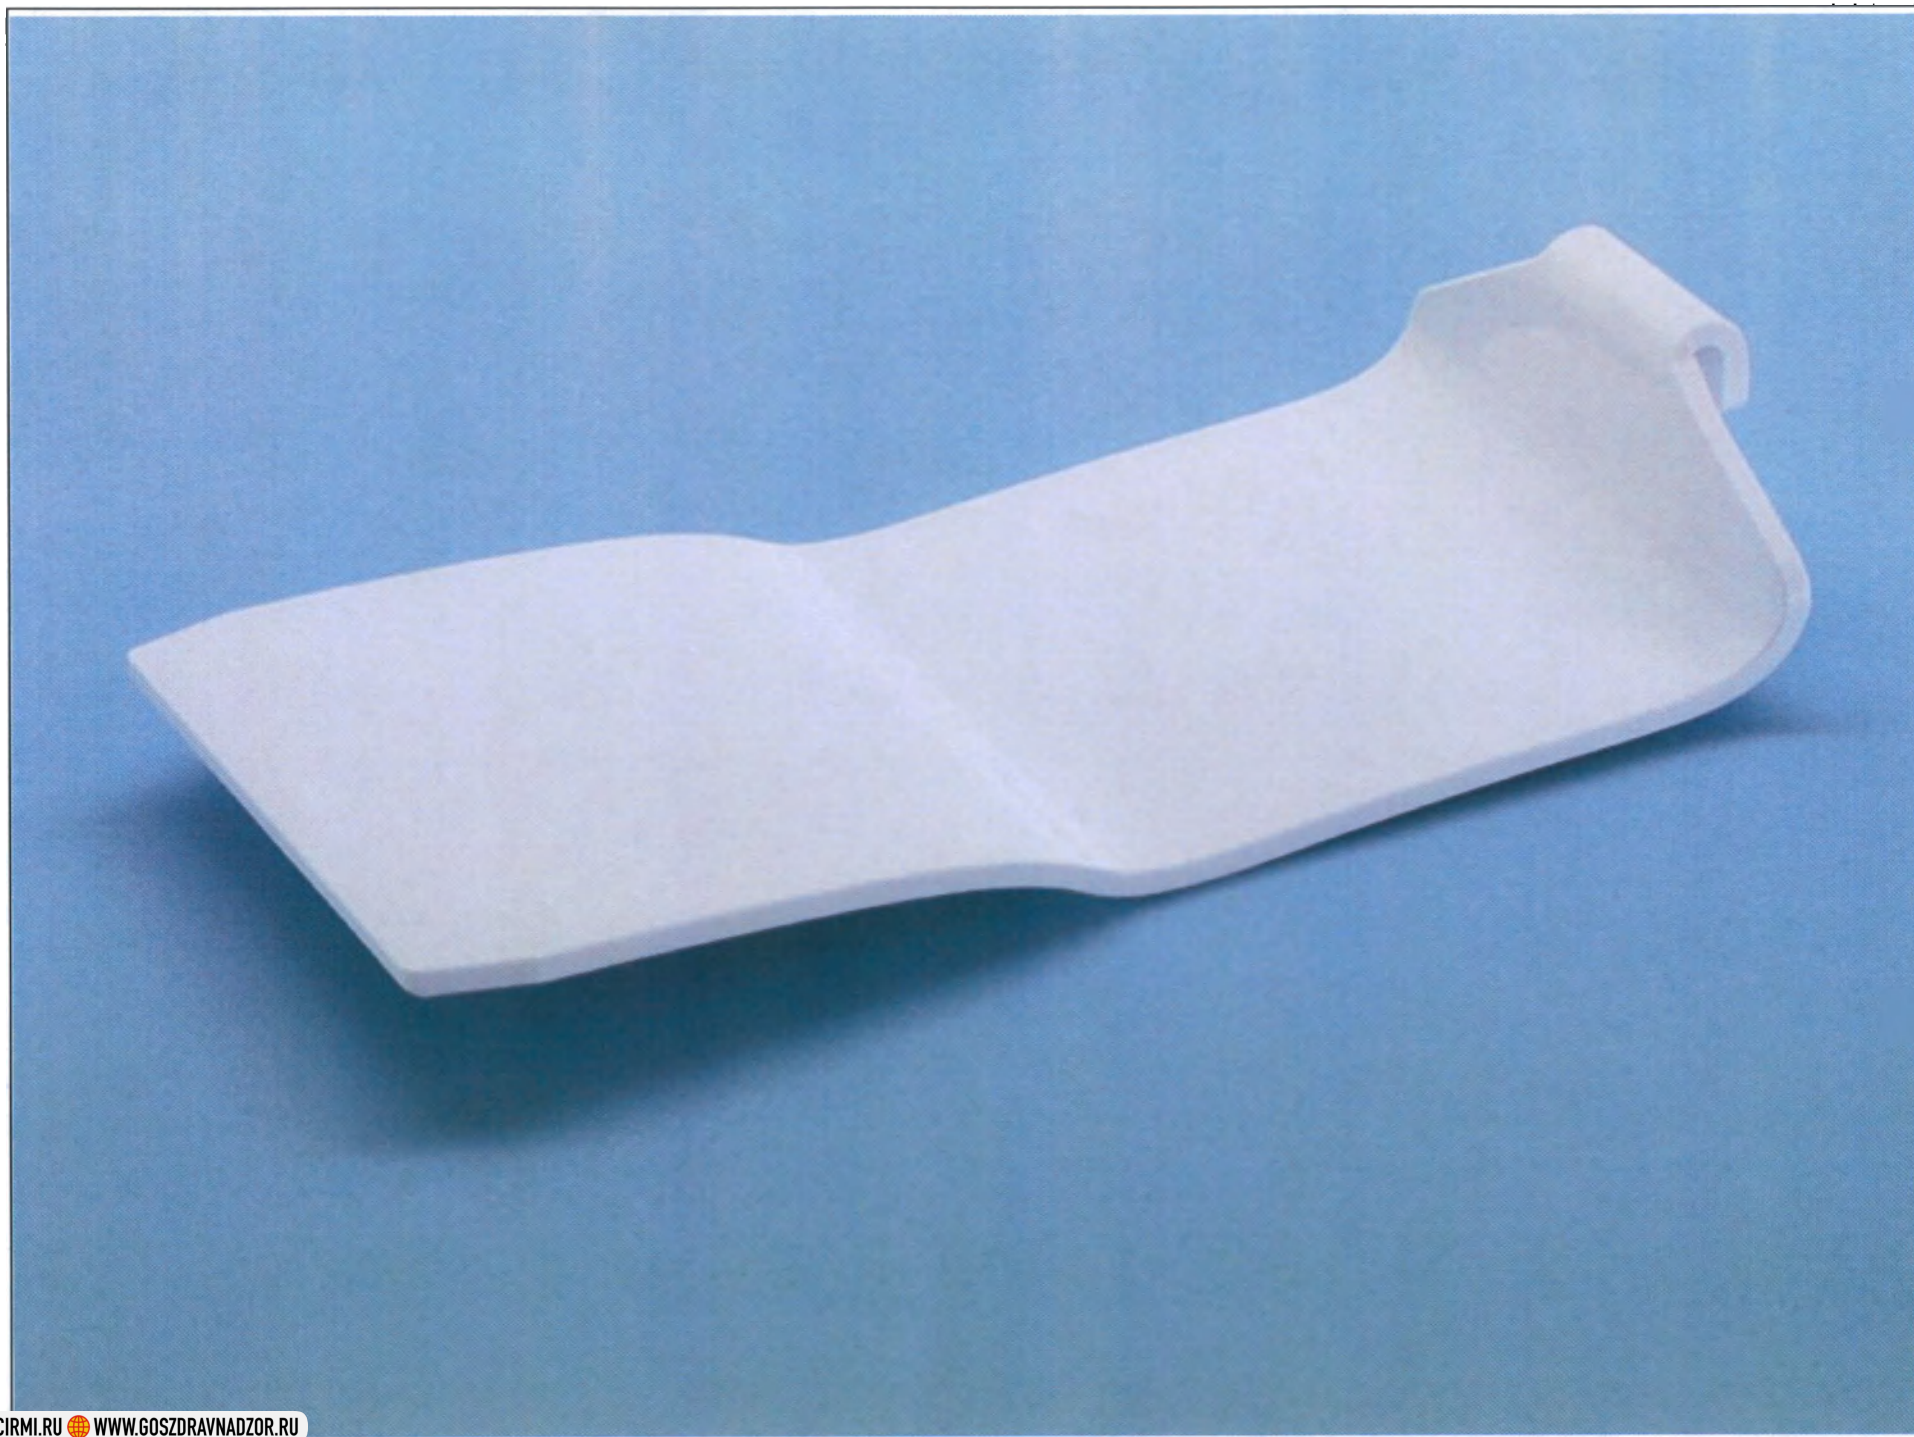

16. Держатели катетеров (не более 10 шт.).

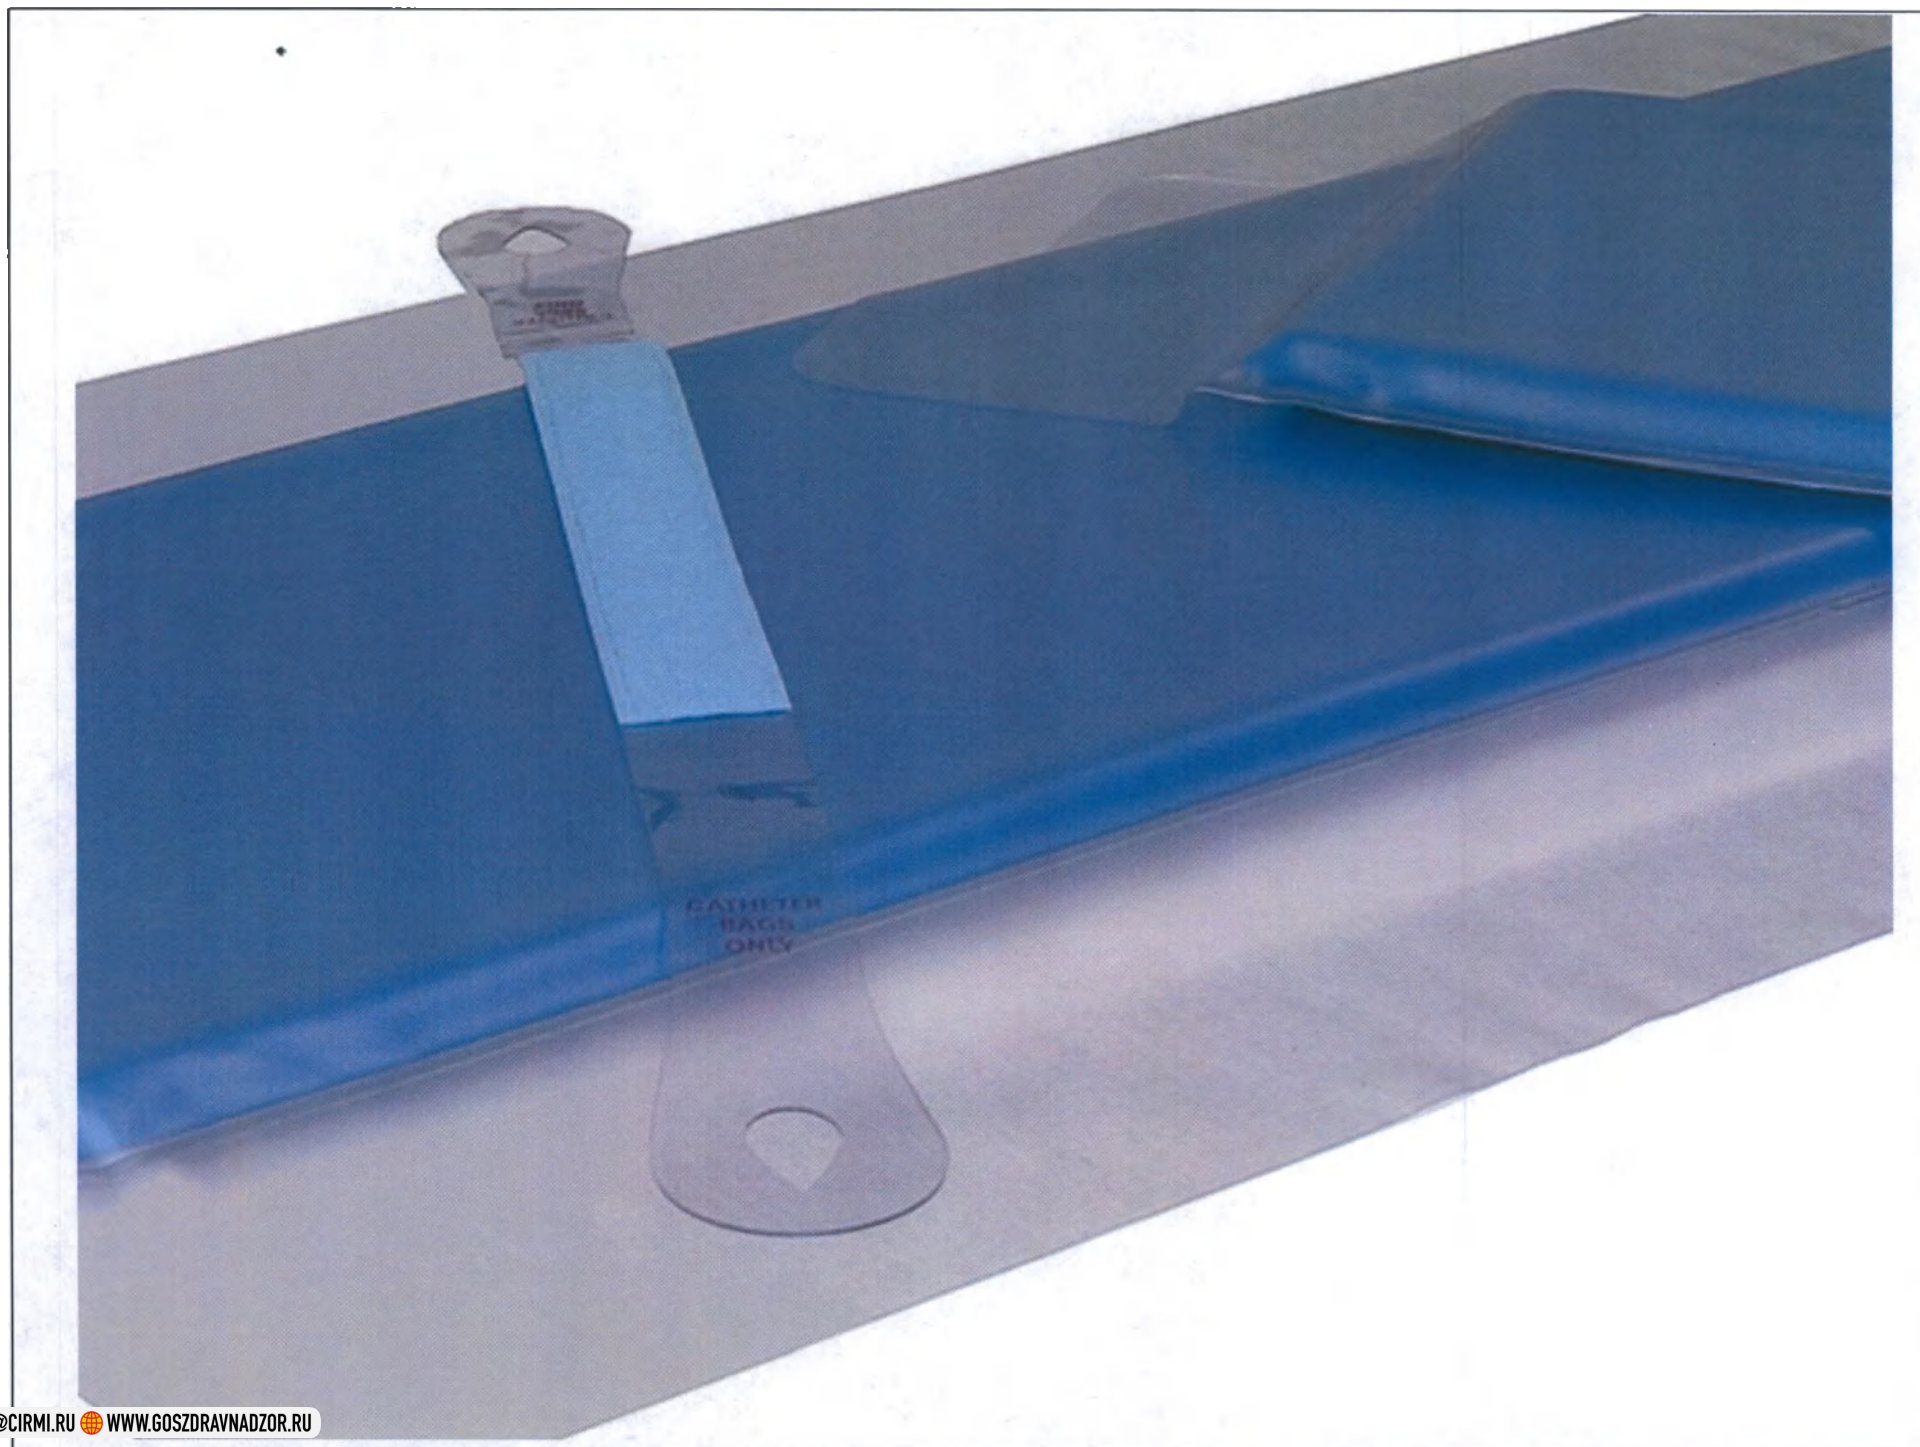


17. Накладки на педали стола комплекса (не более 10 шт.).

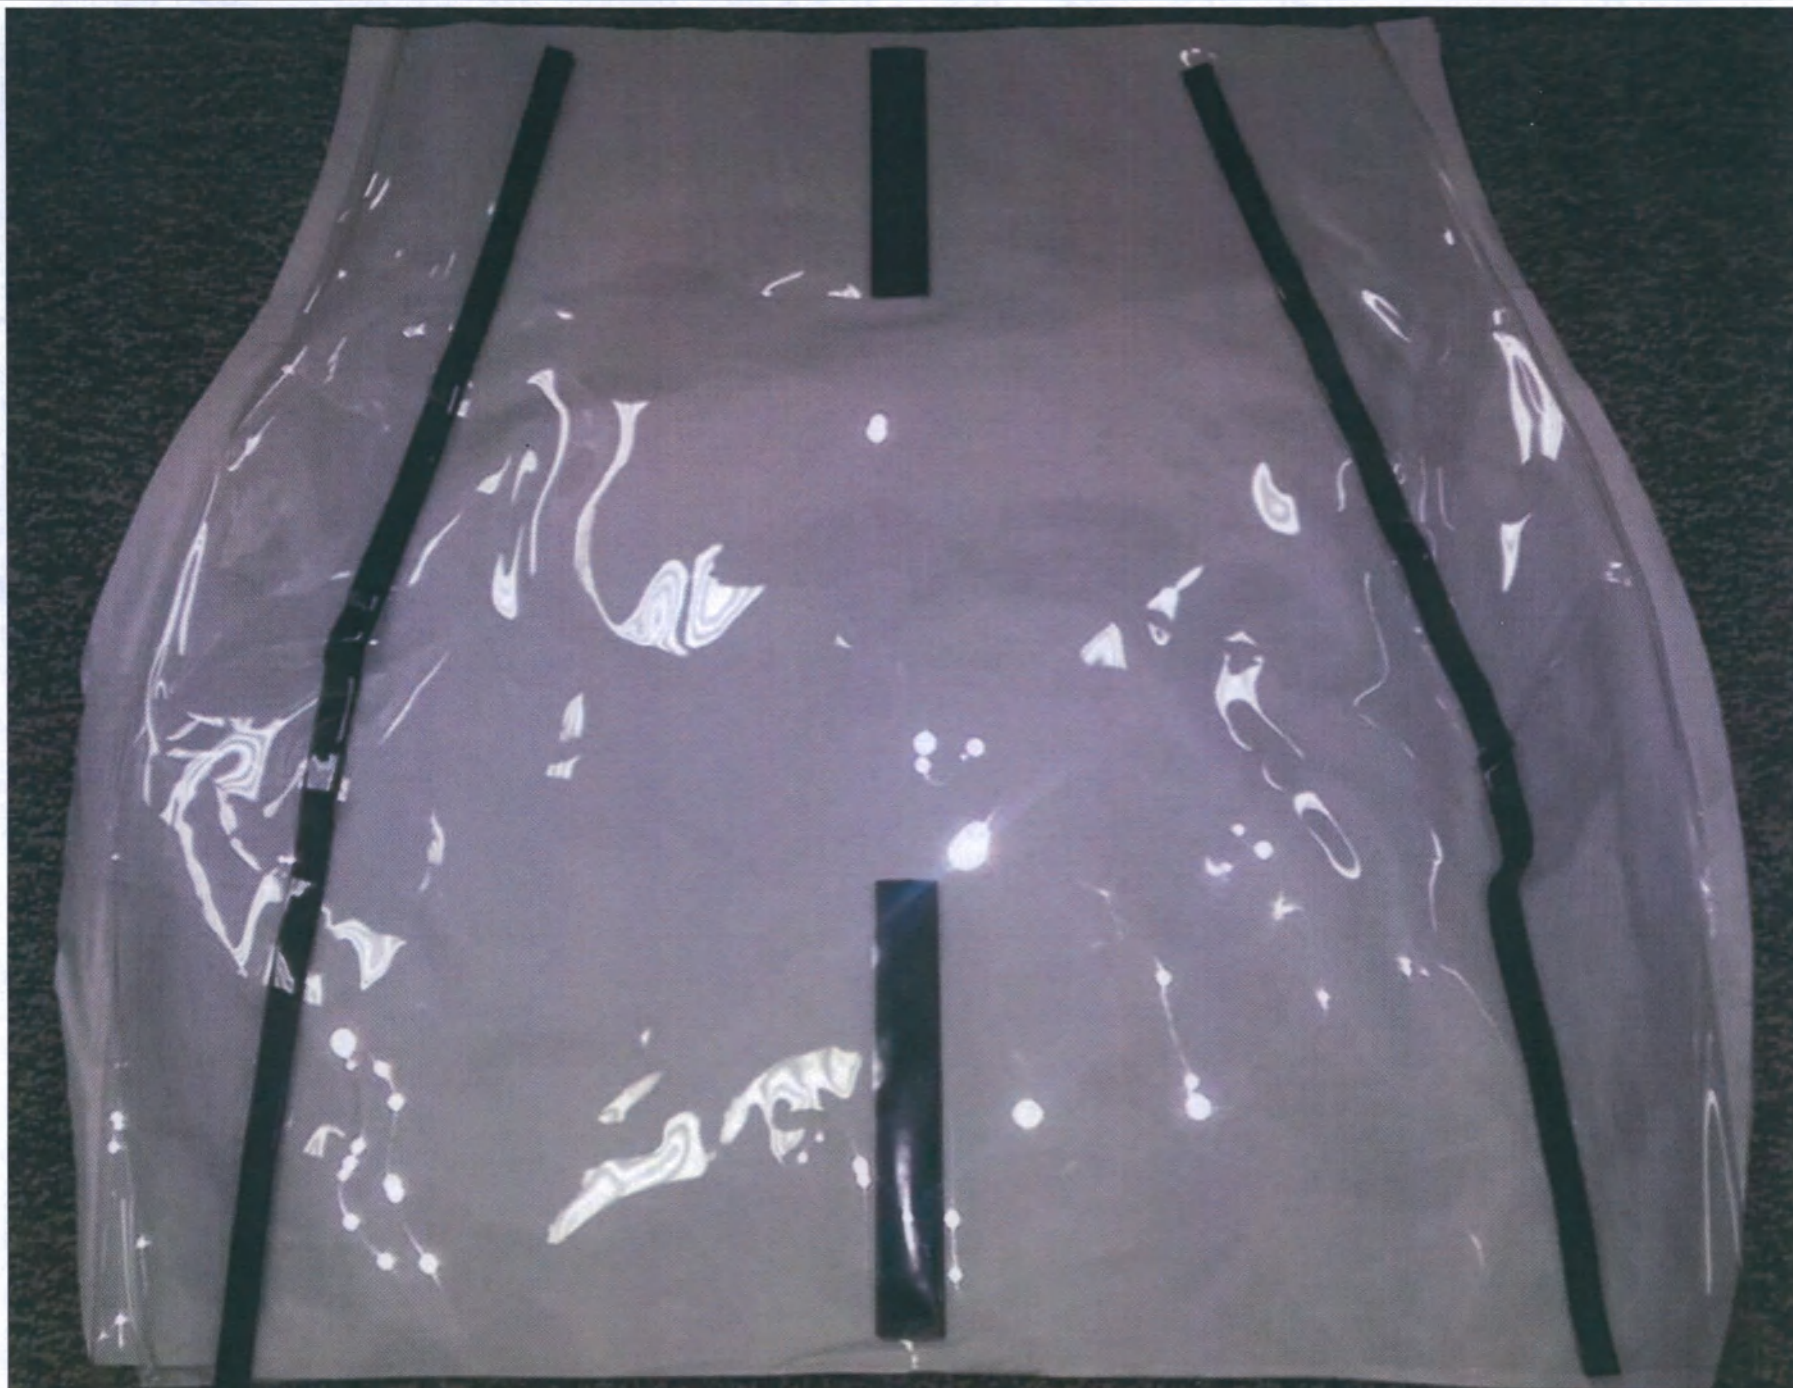


18. Стойки инфузионные (не более 4 шт.).




18. Стойки инфузионные (не более 4 шт.).

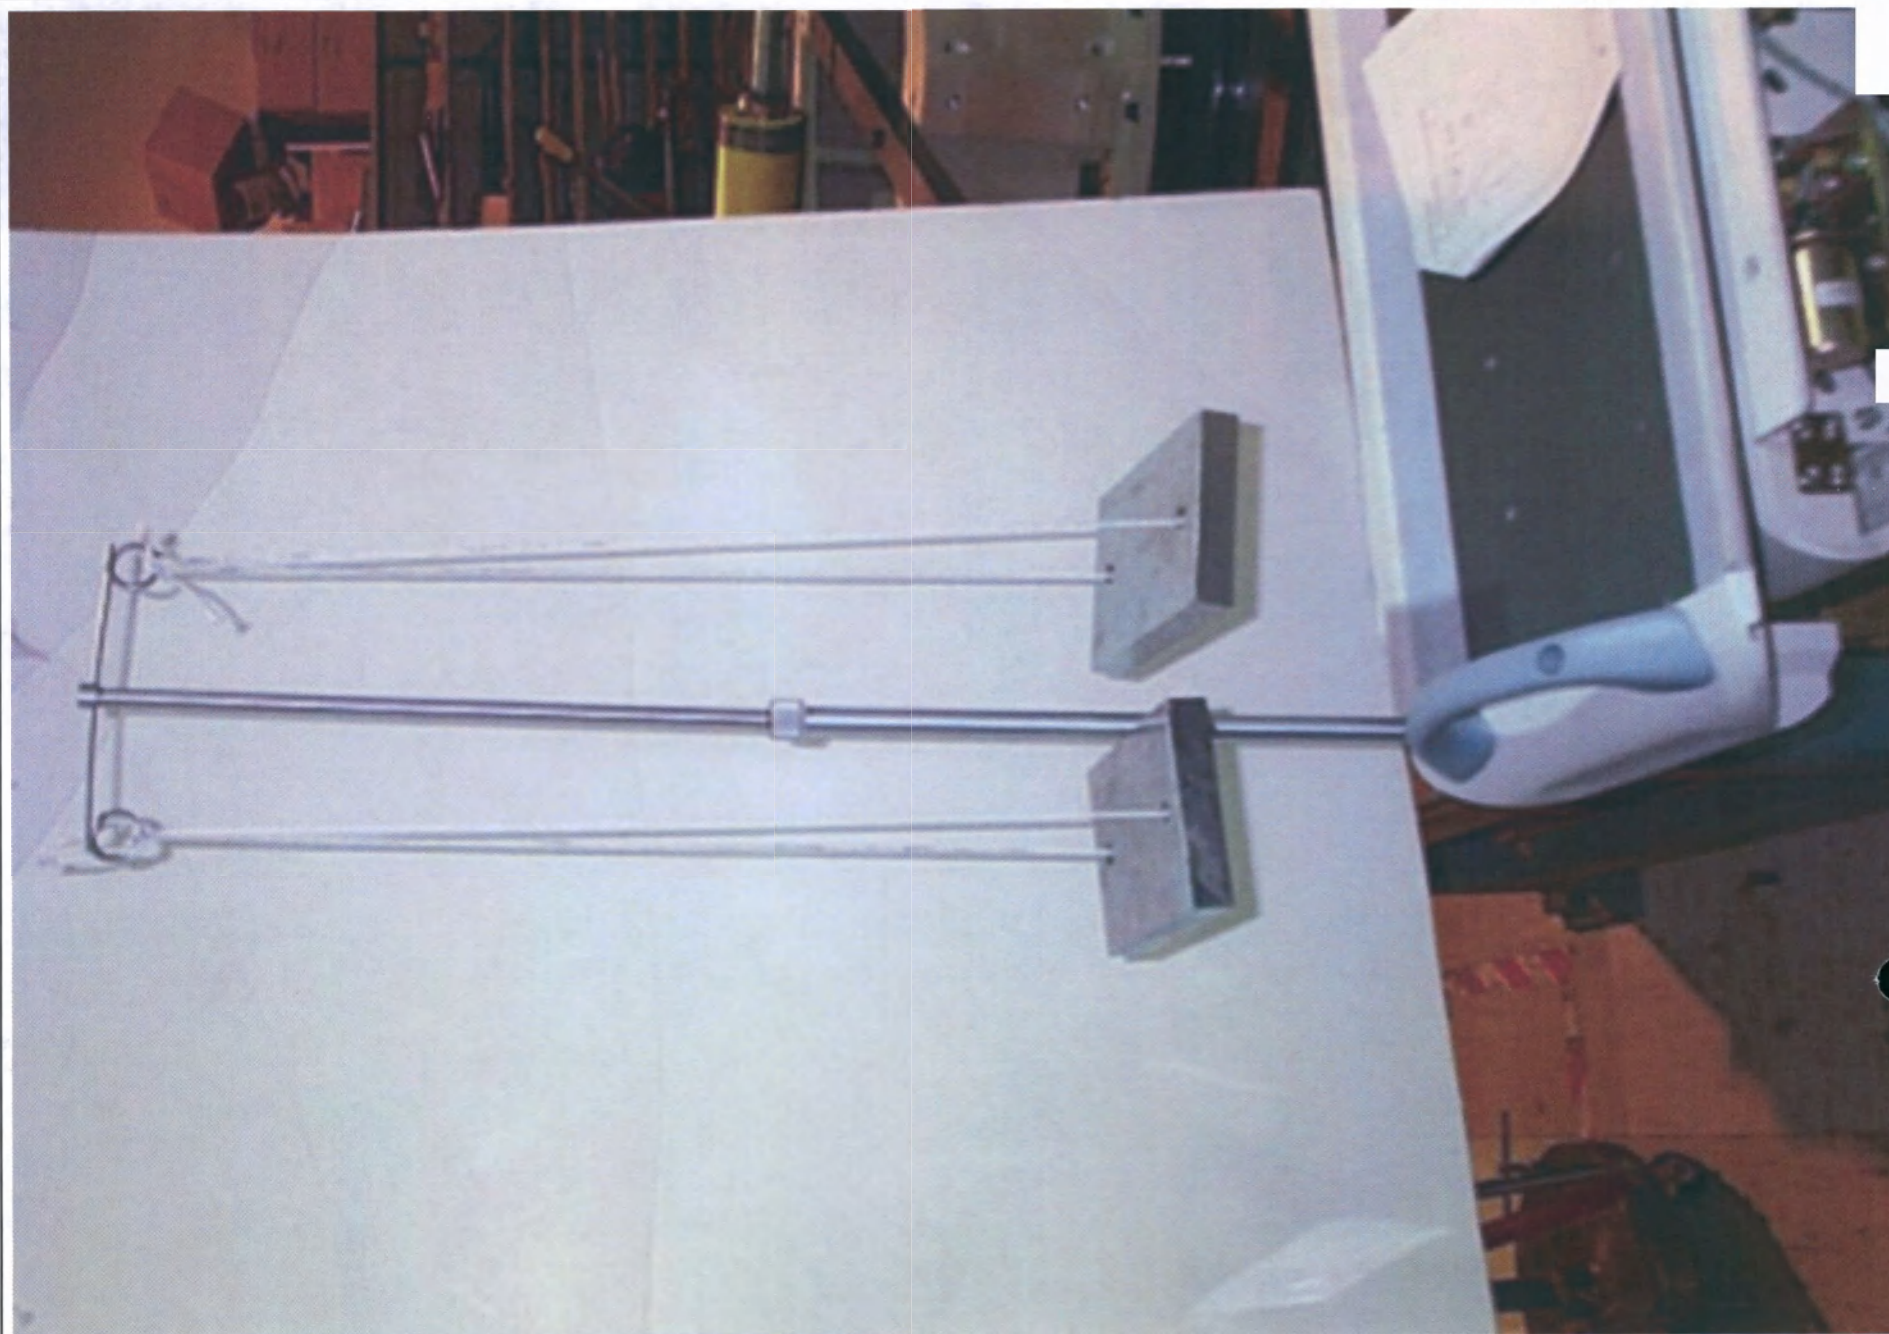


19. Фантомы (не более 20 шт.).

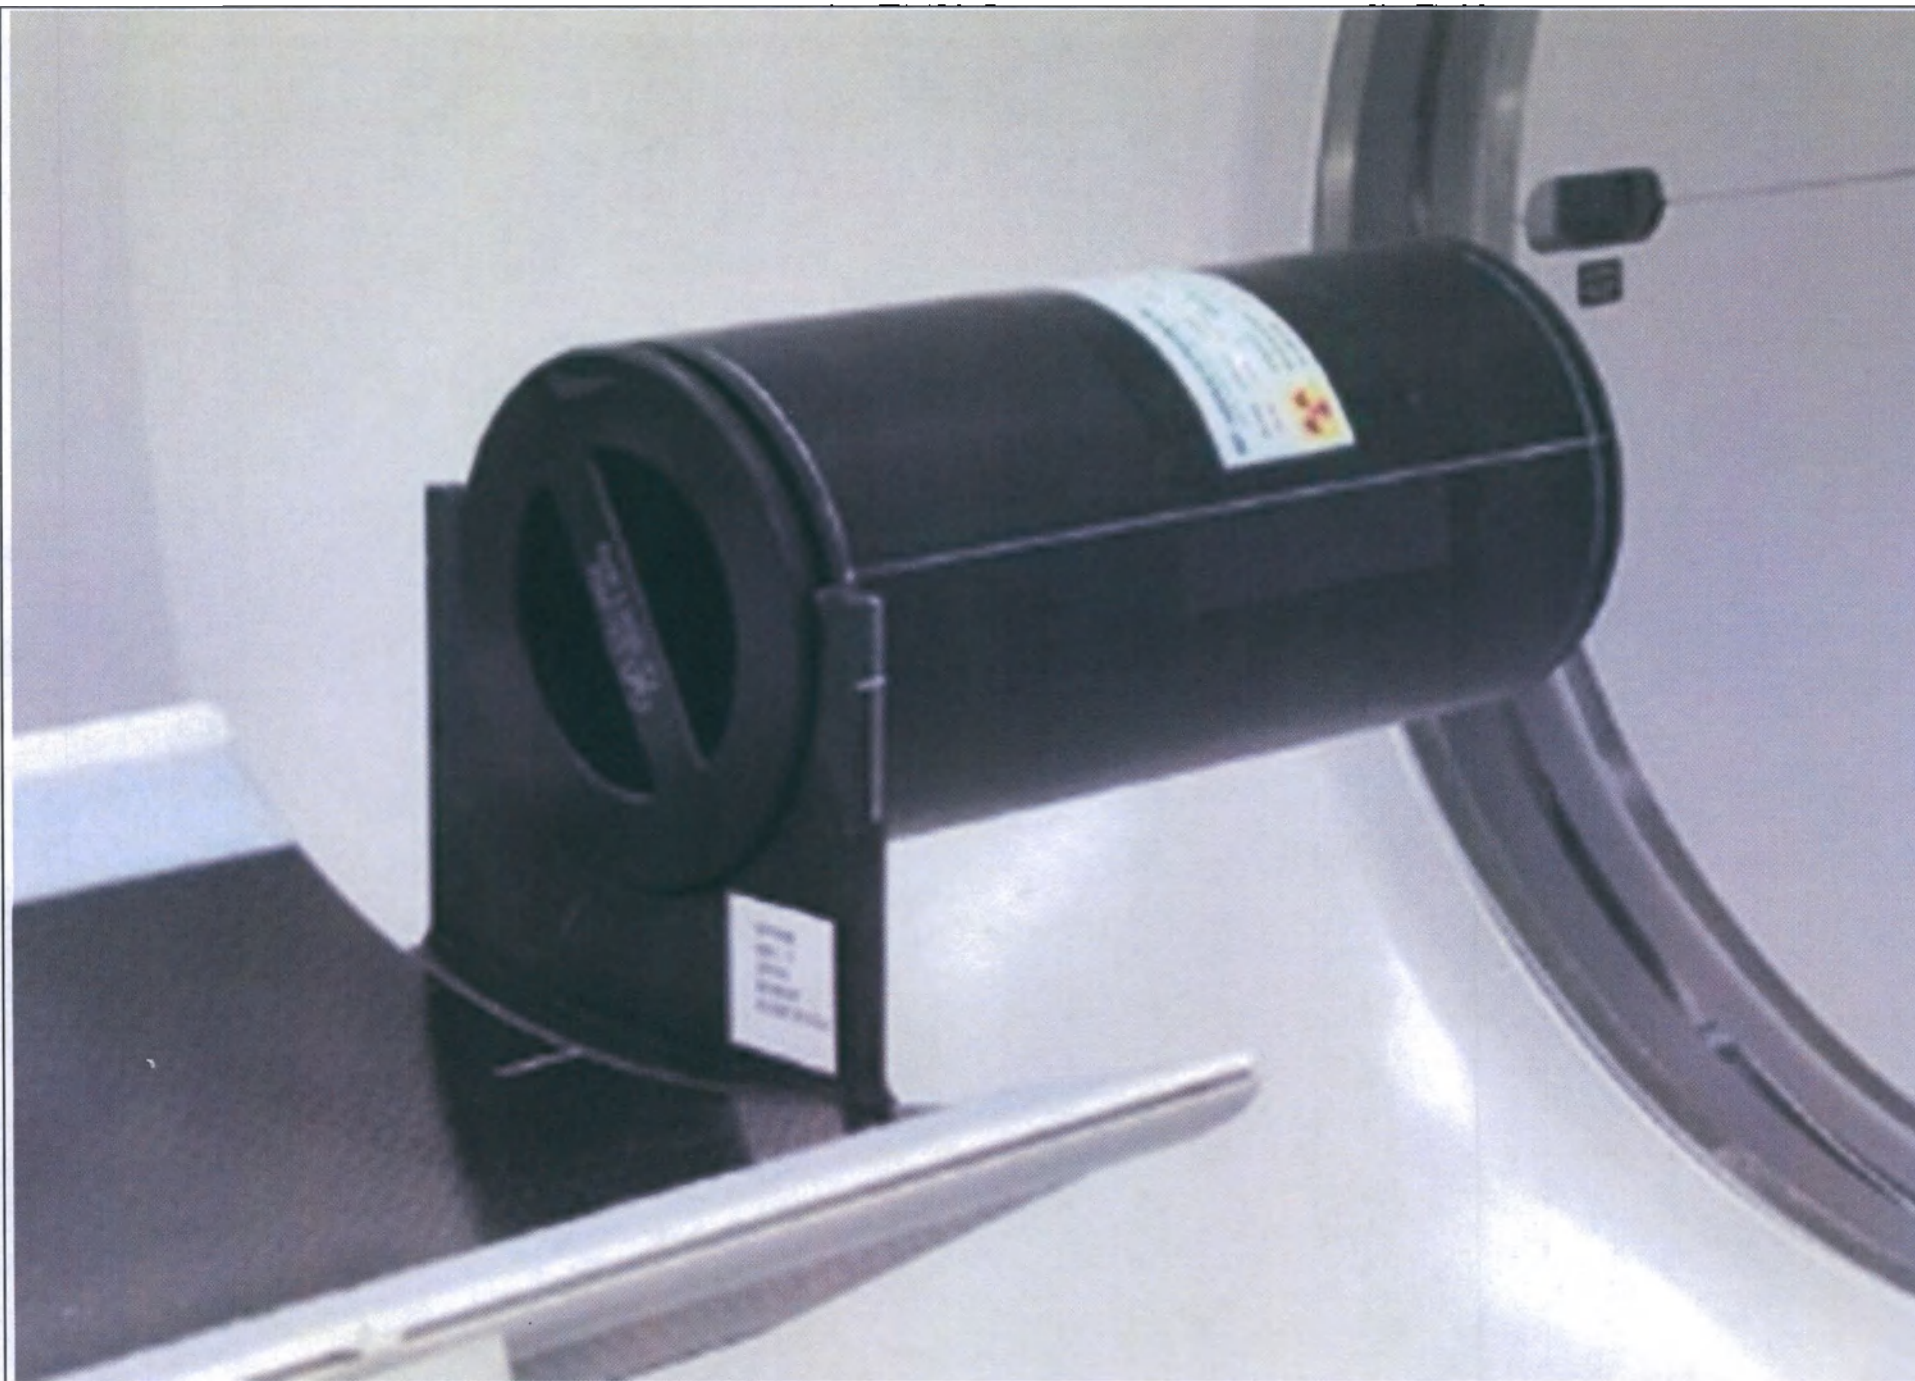

19. Фантомы (не более 20 шт.).

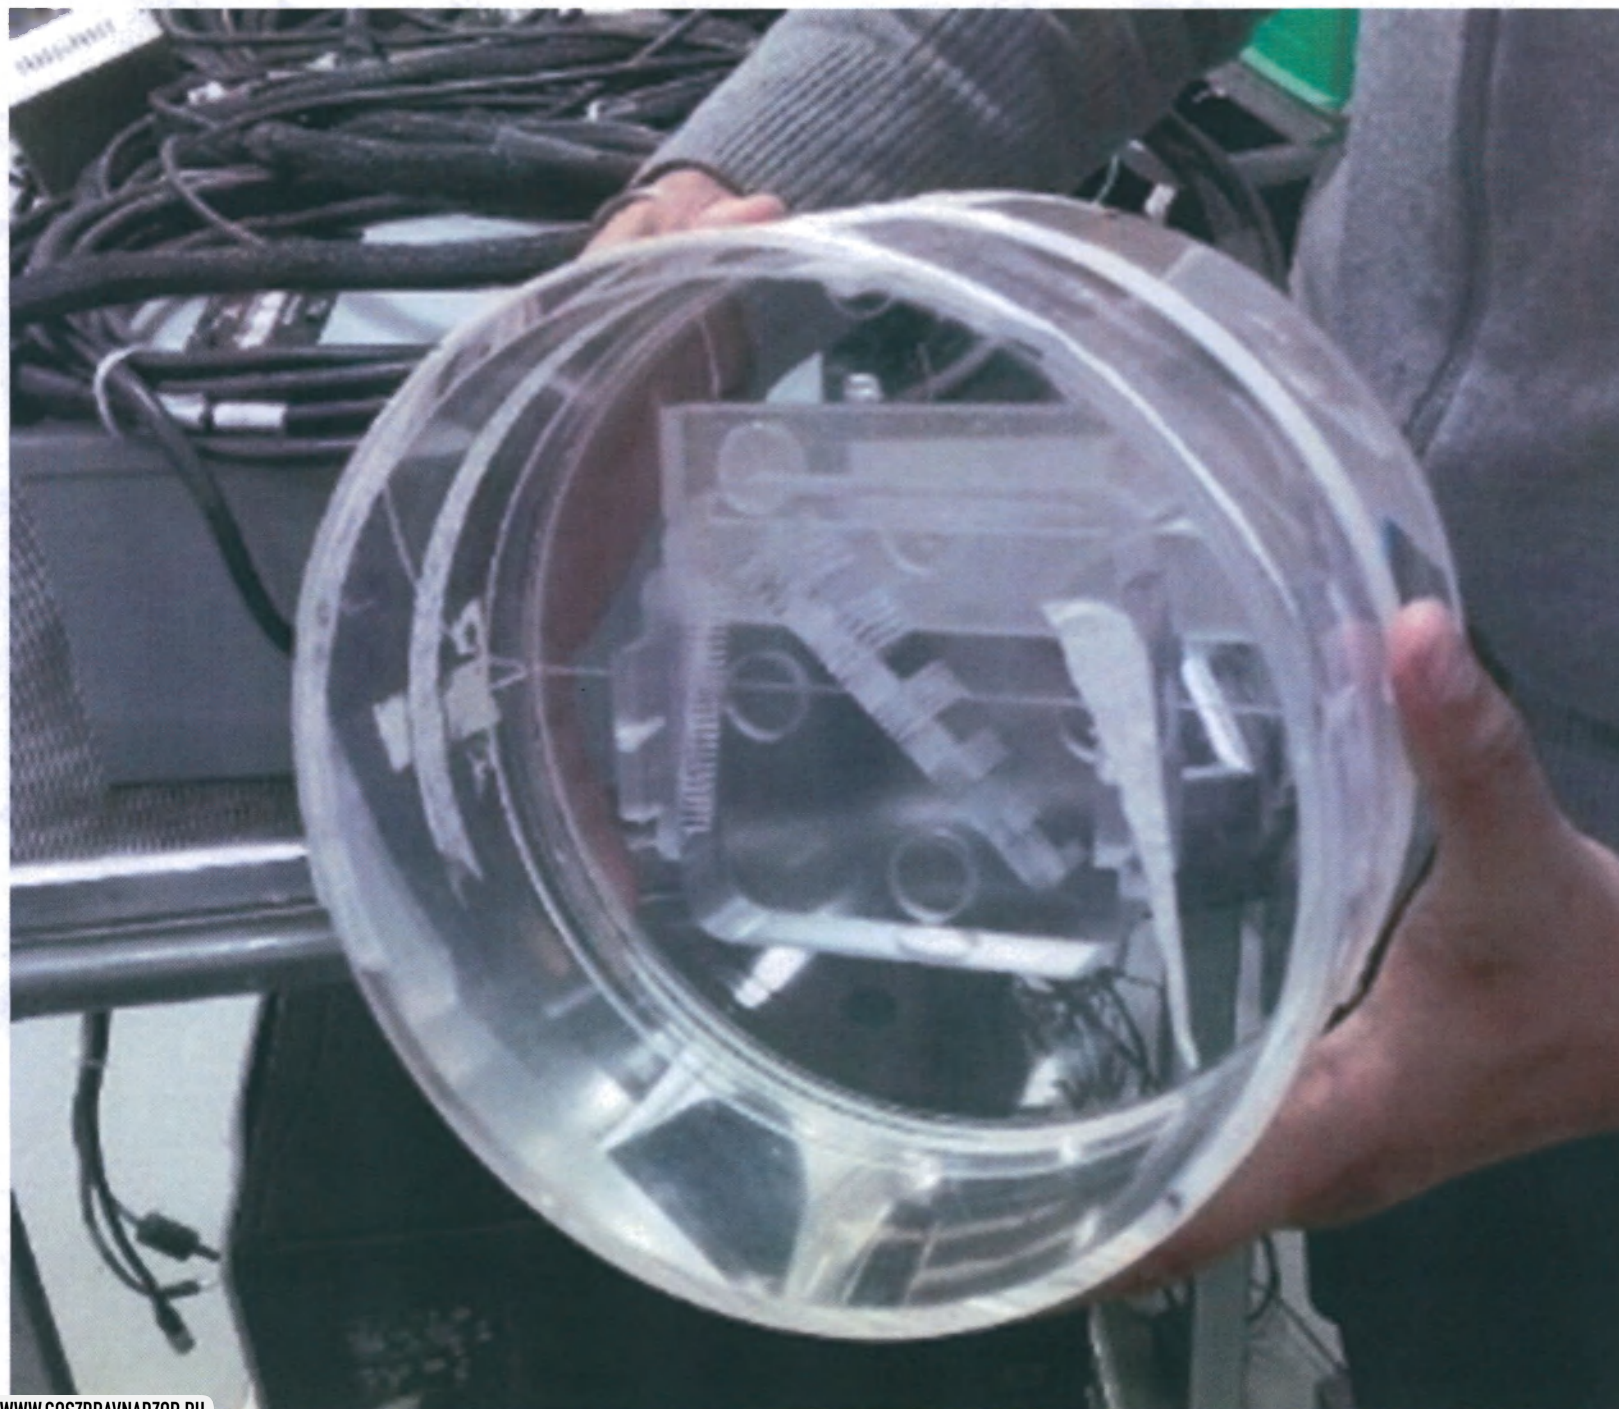

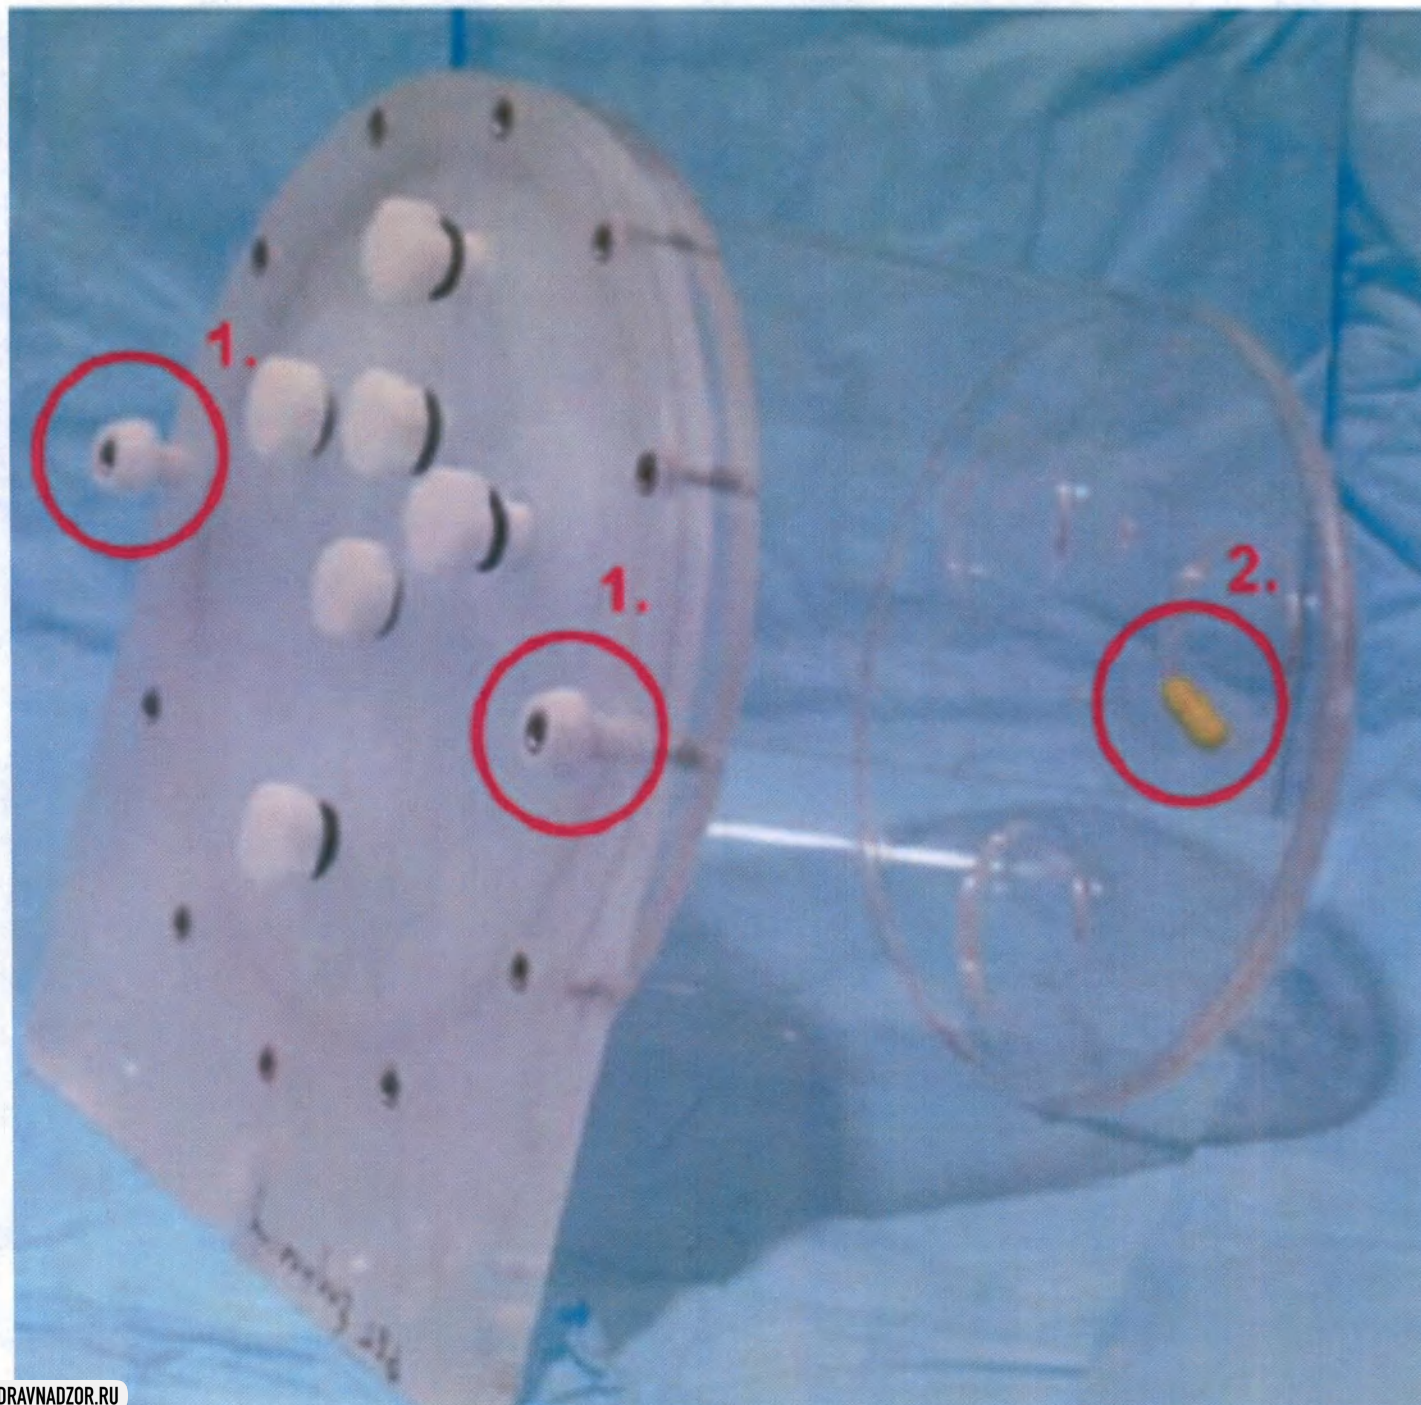19. Фантомы (не более 20 шт.).


19. Фантомы (не более 20 шт.).



20. Держатели фантомов (не более 4 шт.).



20. Держатели фантомов (не более 4 шт.).

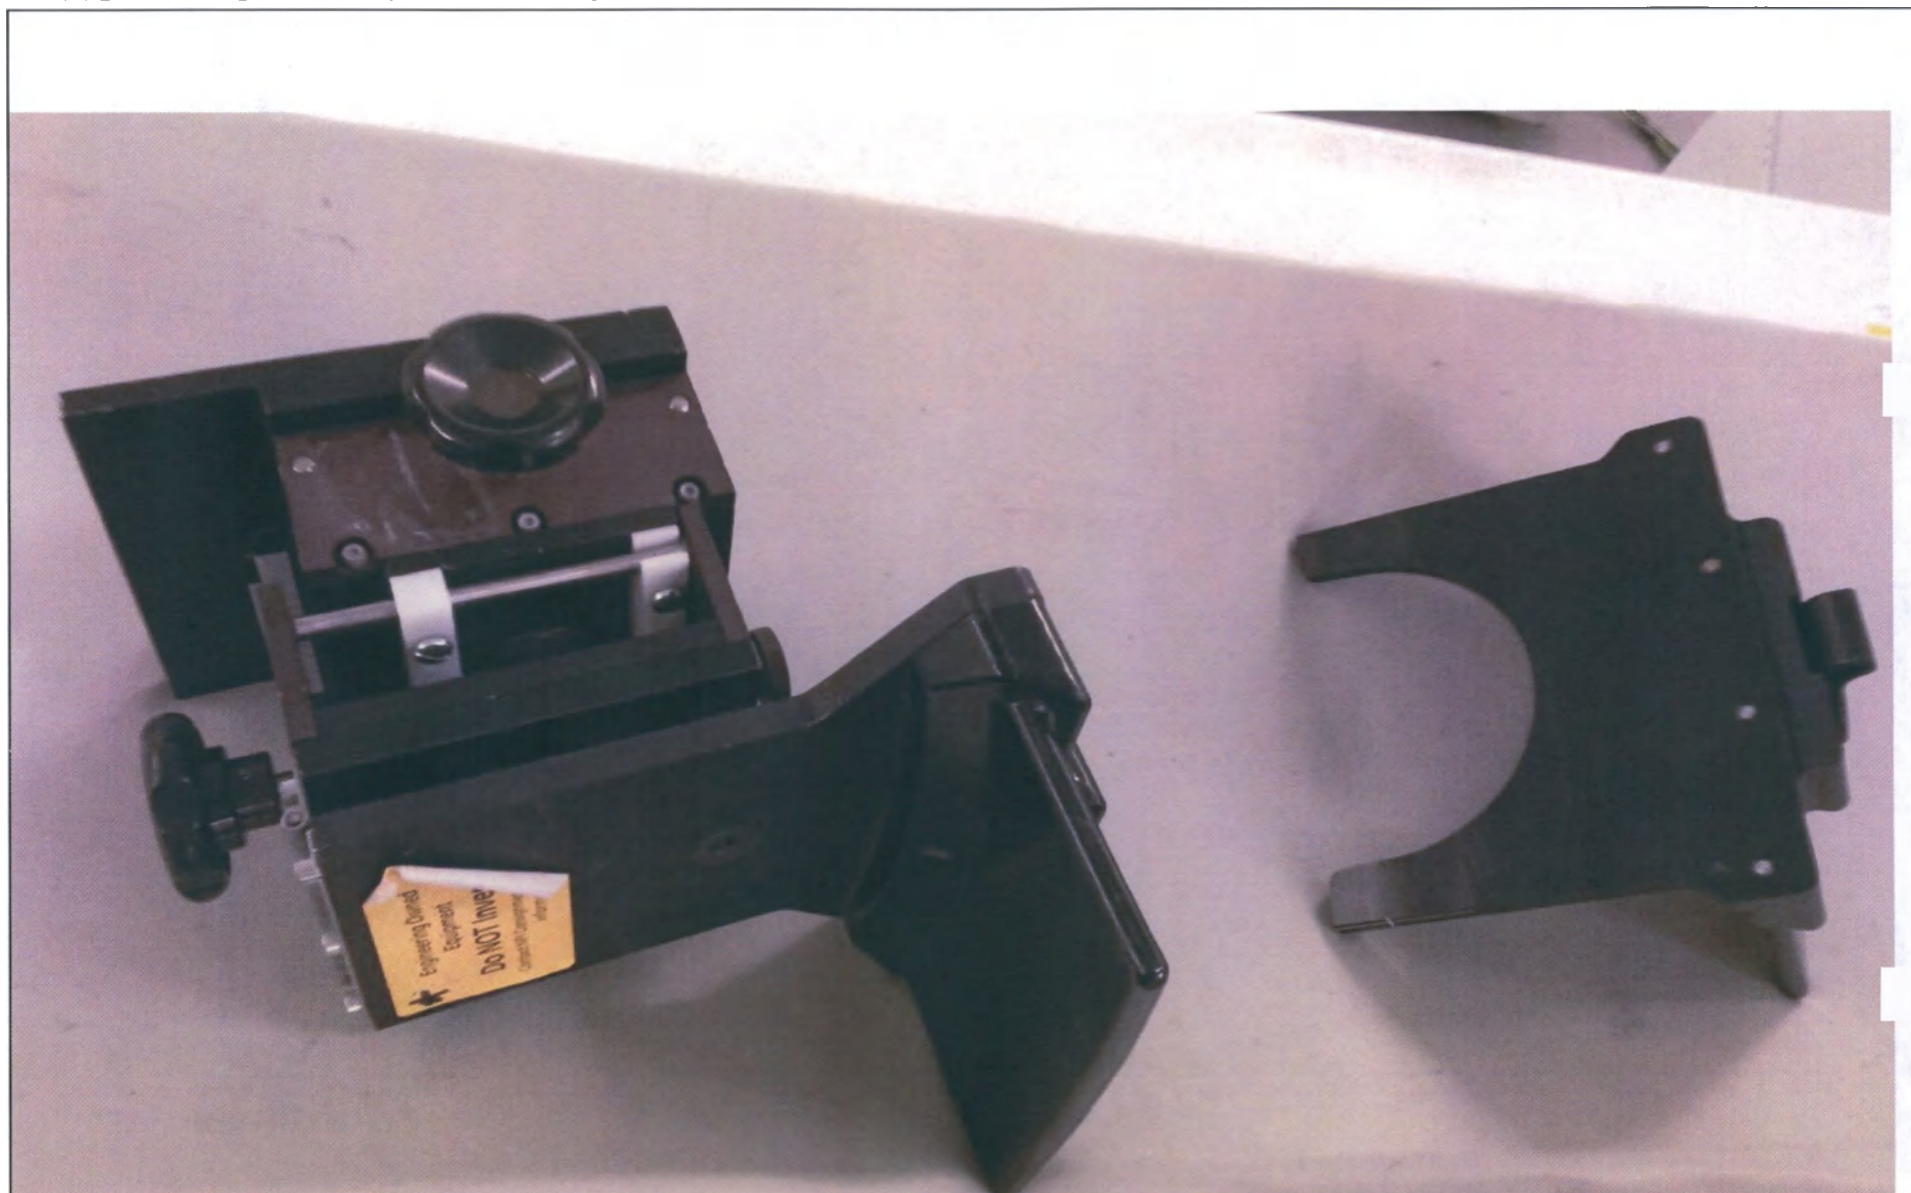

21. Источники калибровочные (не более 4 шт.).




22. Контейнеры для хранения источника калибровочного (не более 4 шт.).



23. Стекла рентгенозащитные (не более 4 шт.).

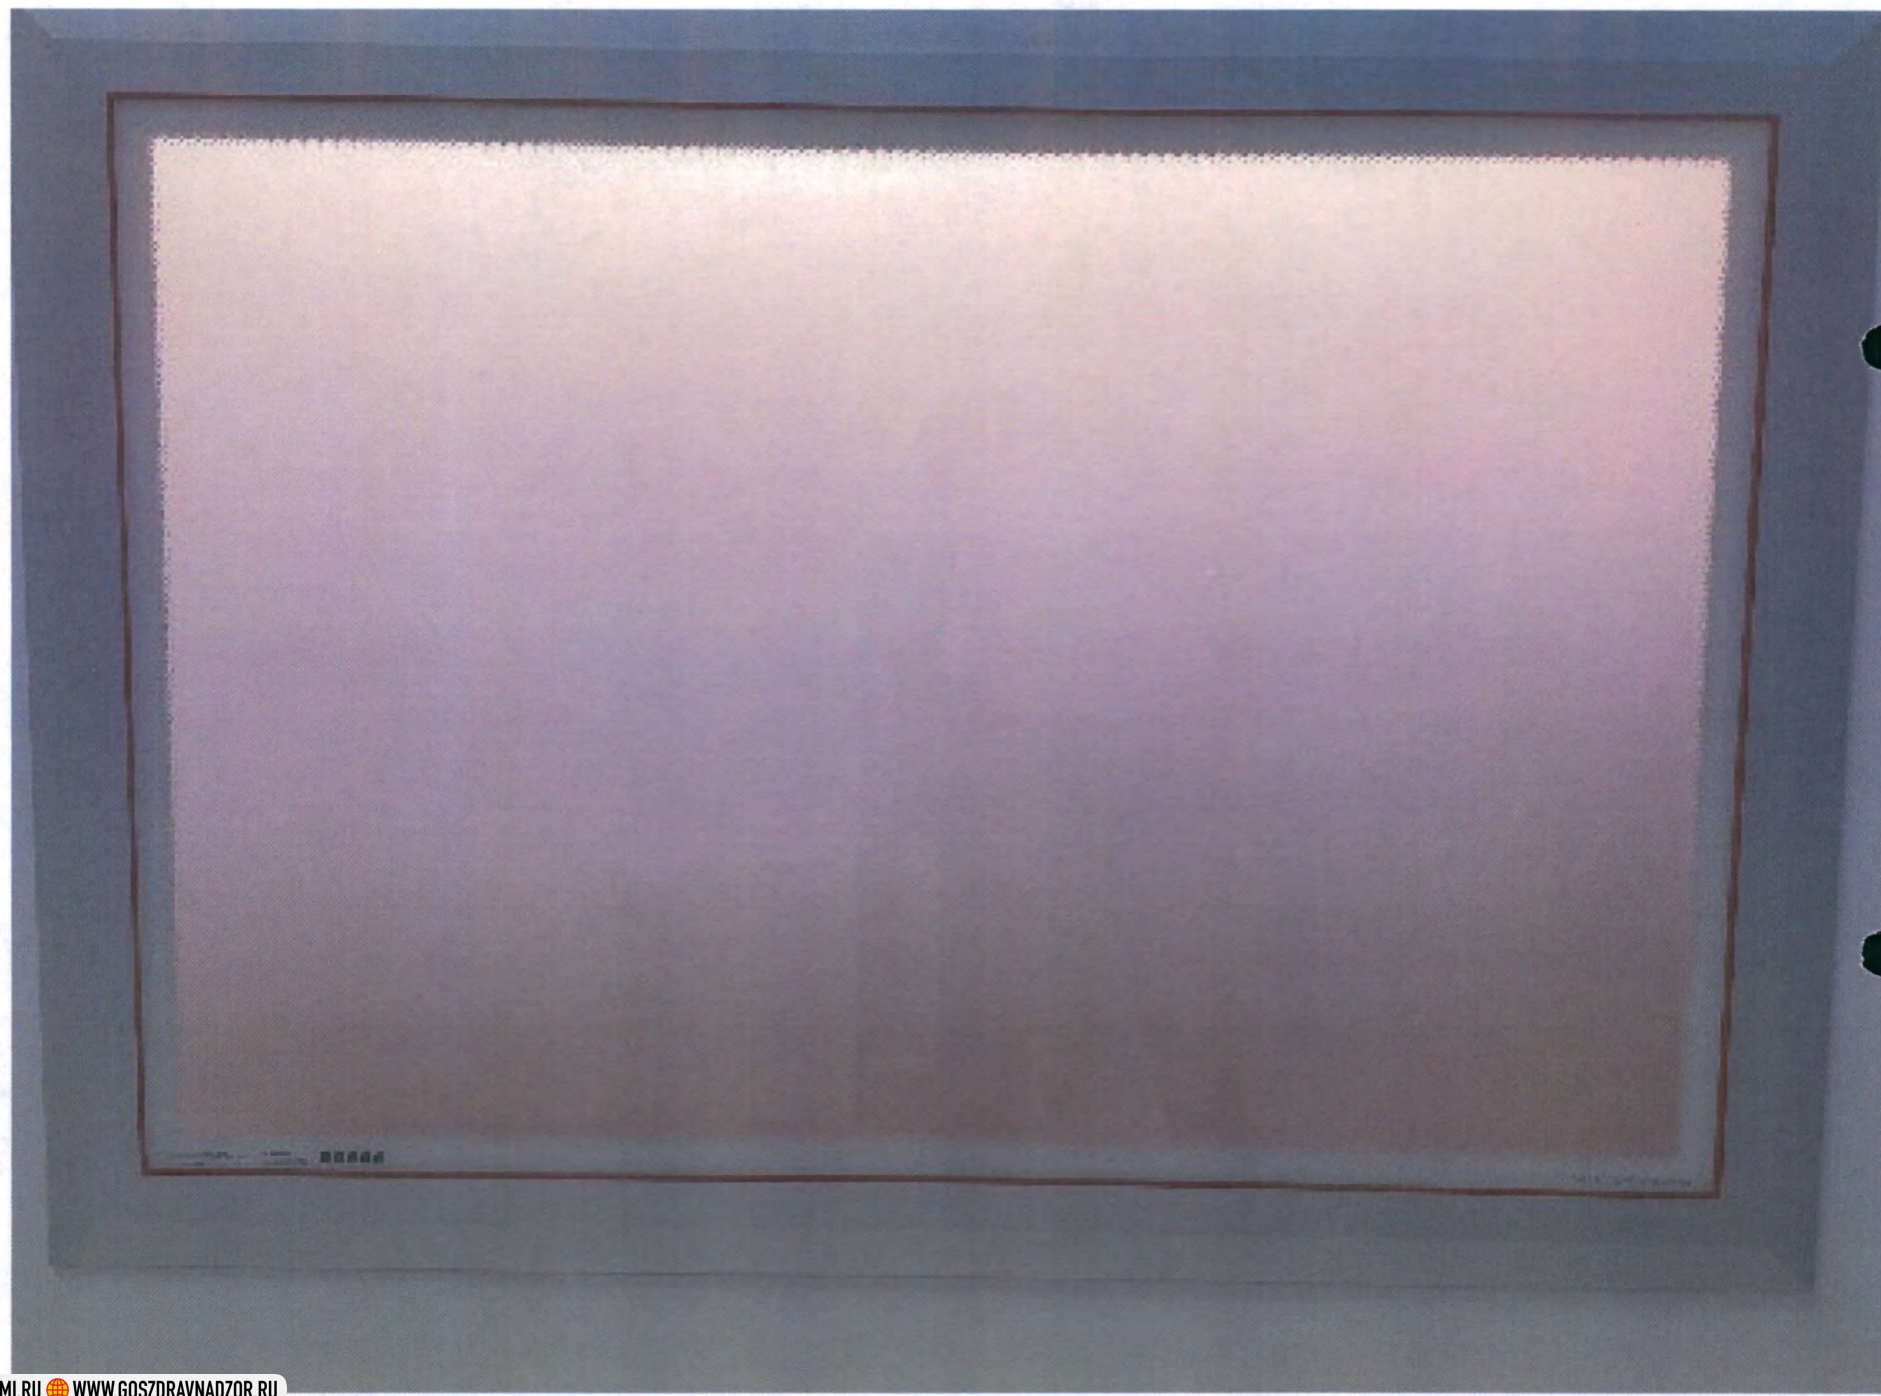

23. Стекла рентгенозащитные (не более 4 шт.).

23. Стекла рентгенозащитные (не более 4 шт.).




23. Стекла рентгенозащитные (не более 4 шт.).



23. Стекла рентгенозащитные (не более 4 шт.).



24. Столы оператора (не более 2 шт.).

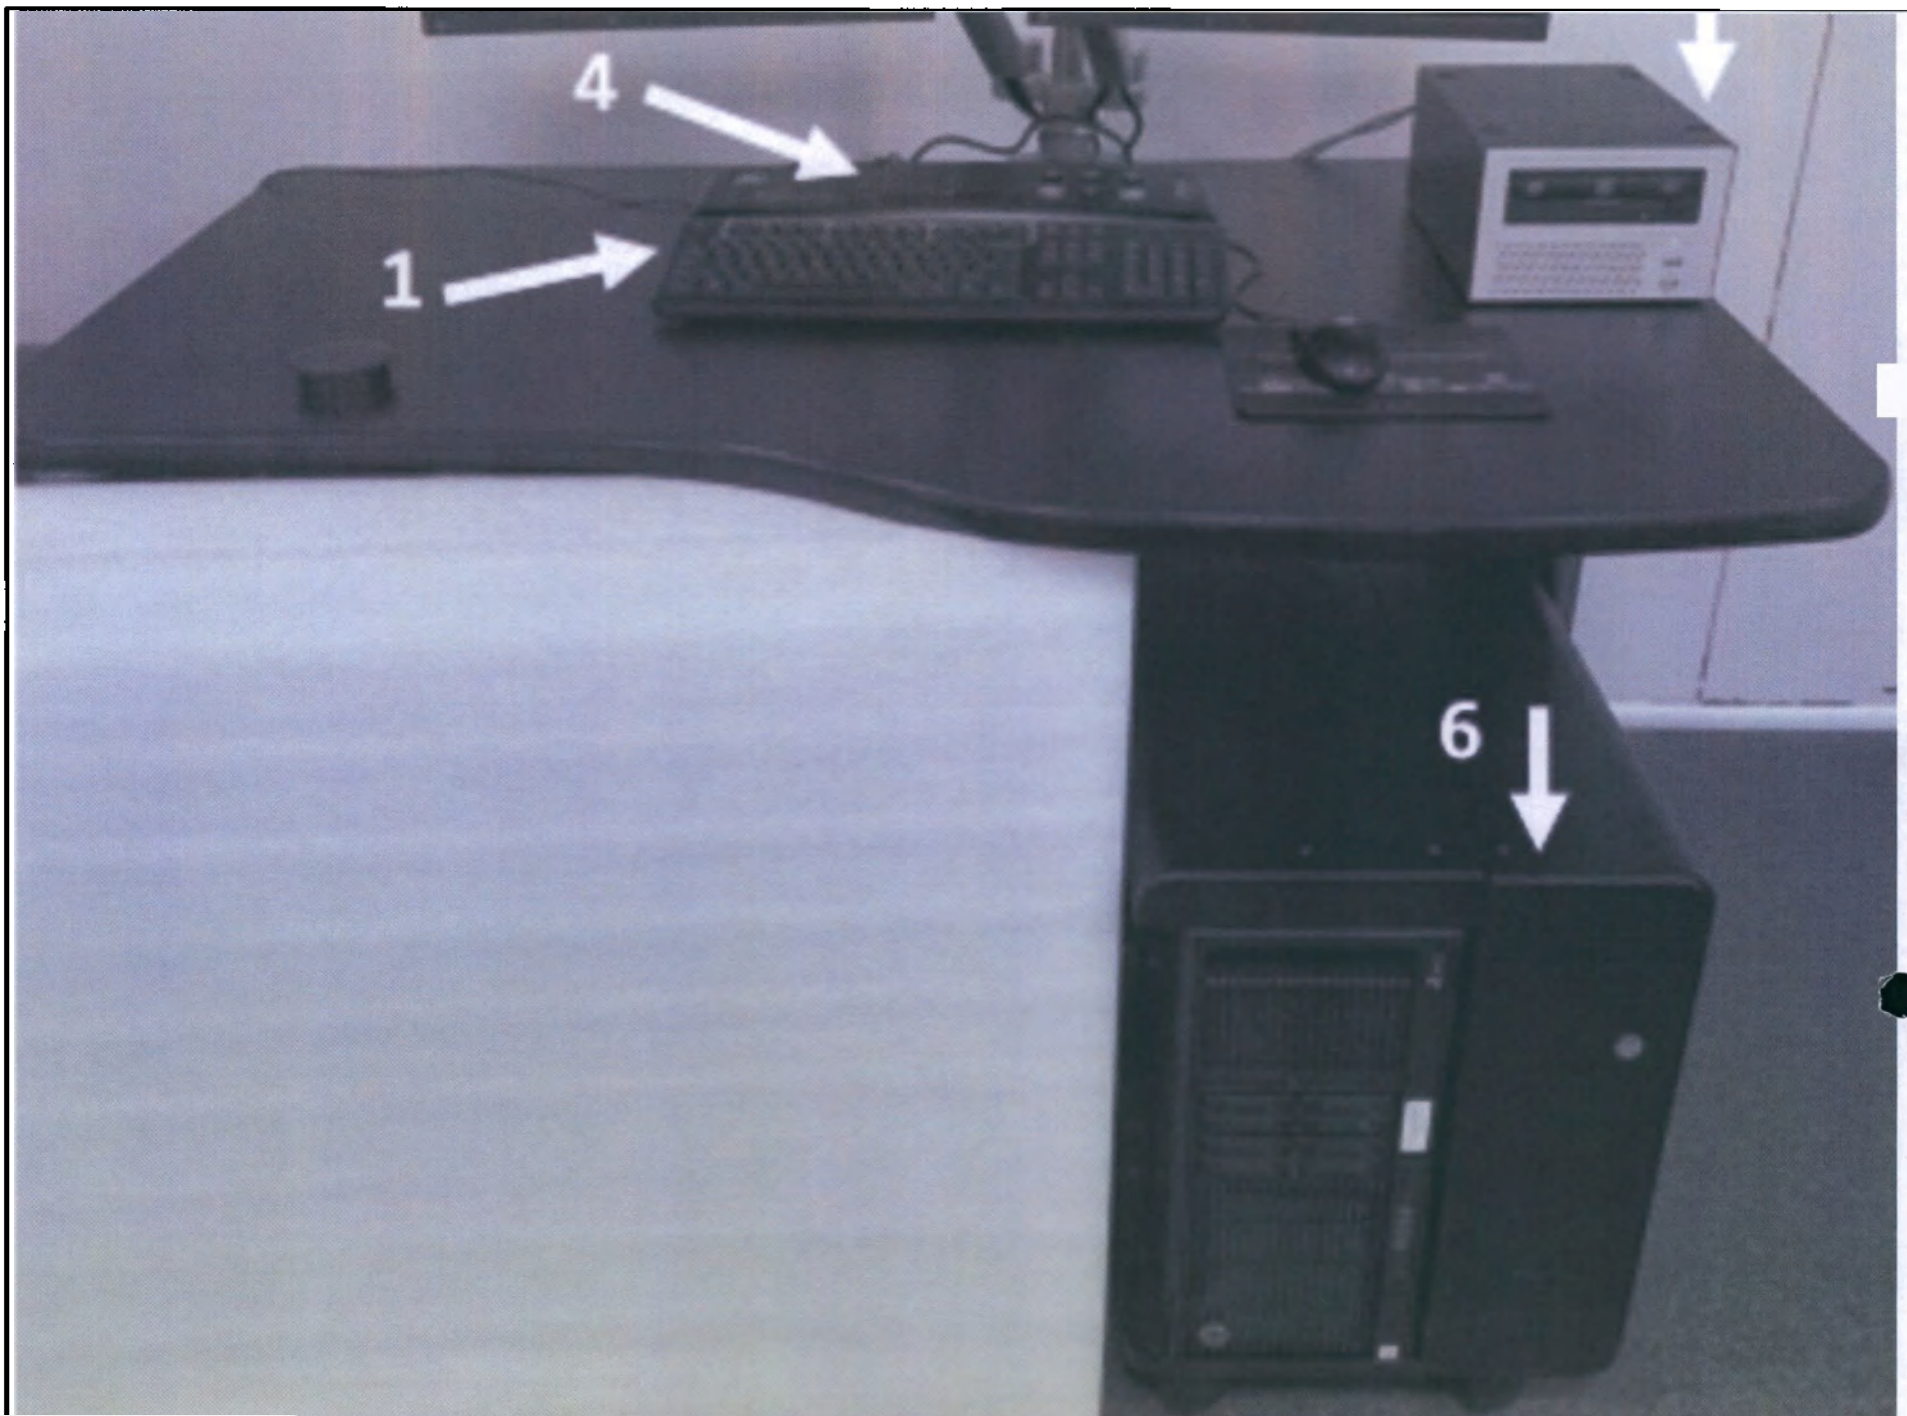

25. Стулья оператора (не более 2 шт.).




26. Монитор для операционной.




27. Источники бесперебойного питания для рабочей станции и (или) консоли (не более 10 шт.).



27. Источники бесперебойного питания для рабочей станции и (или) консоли (не более 10 шт.).

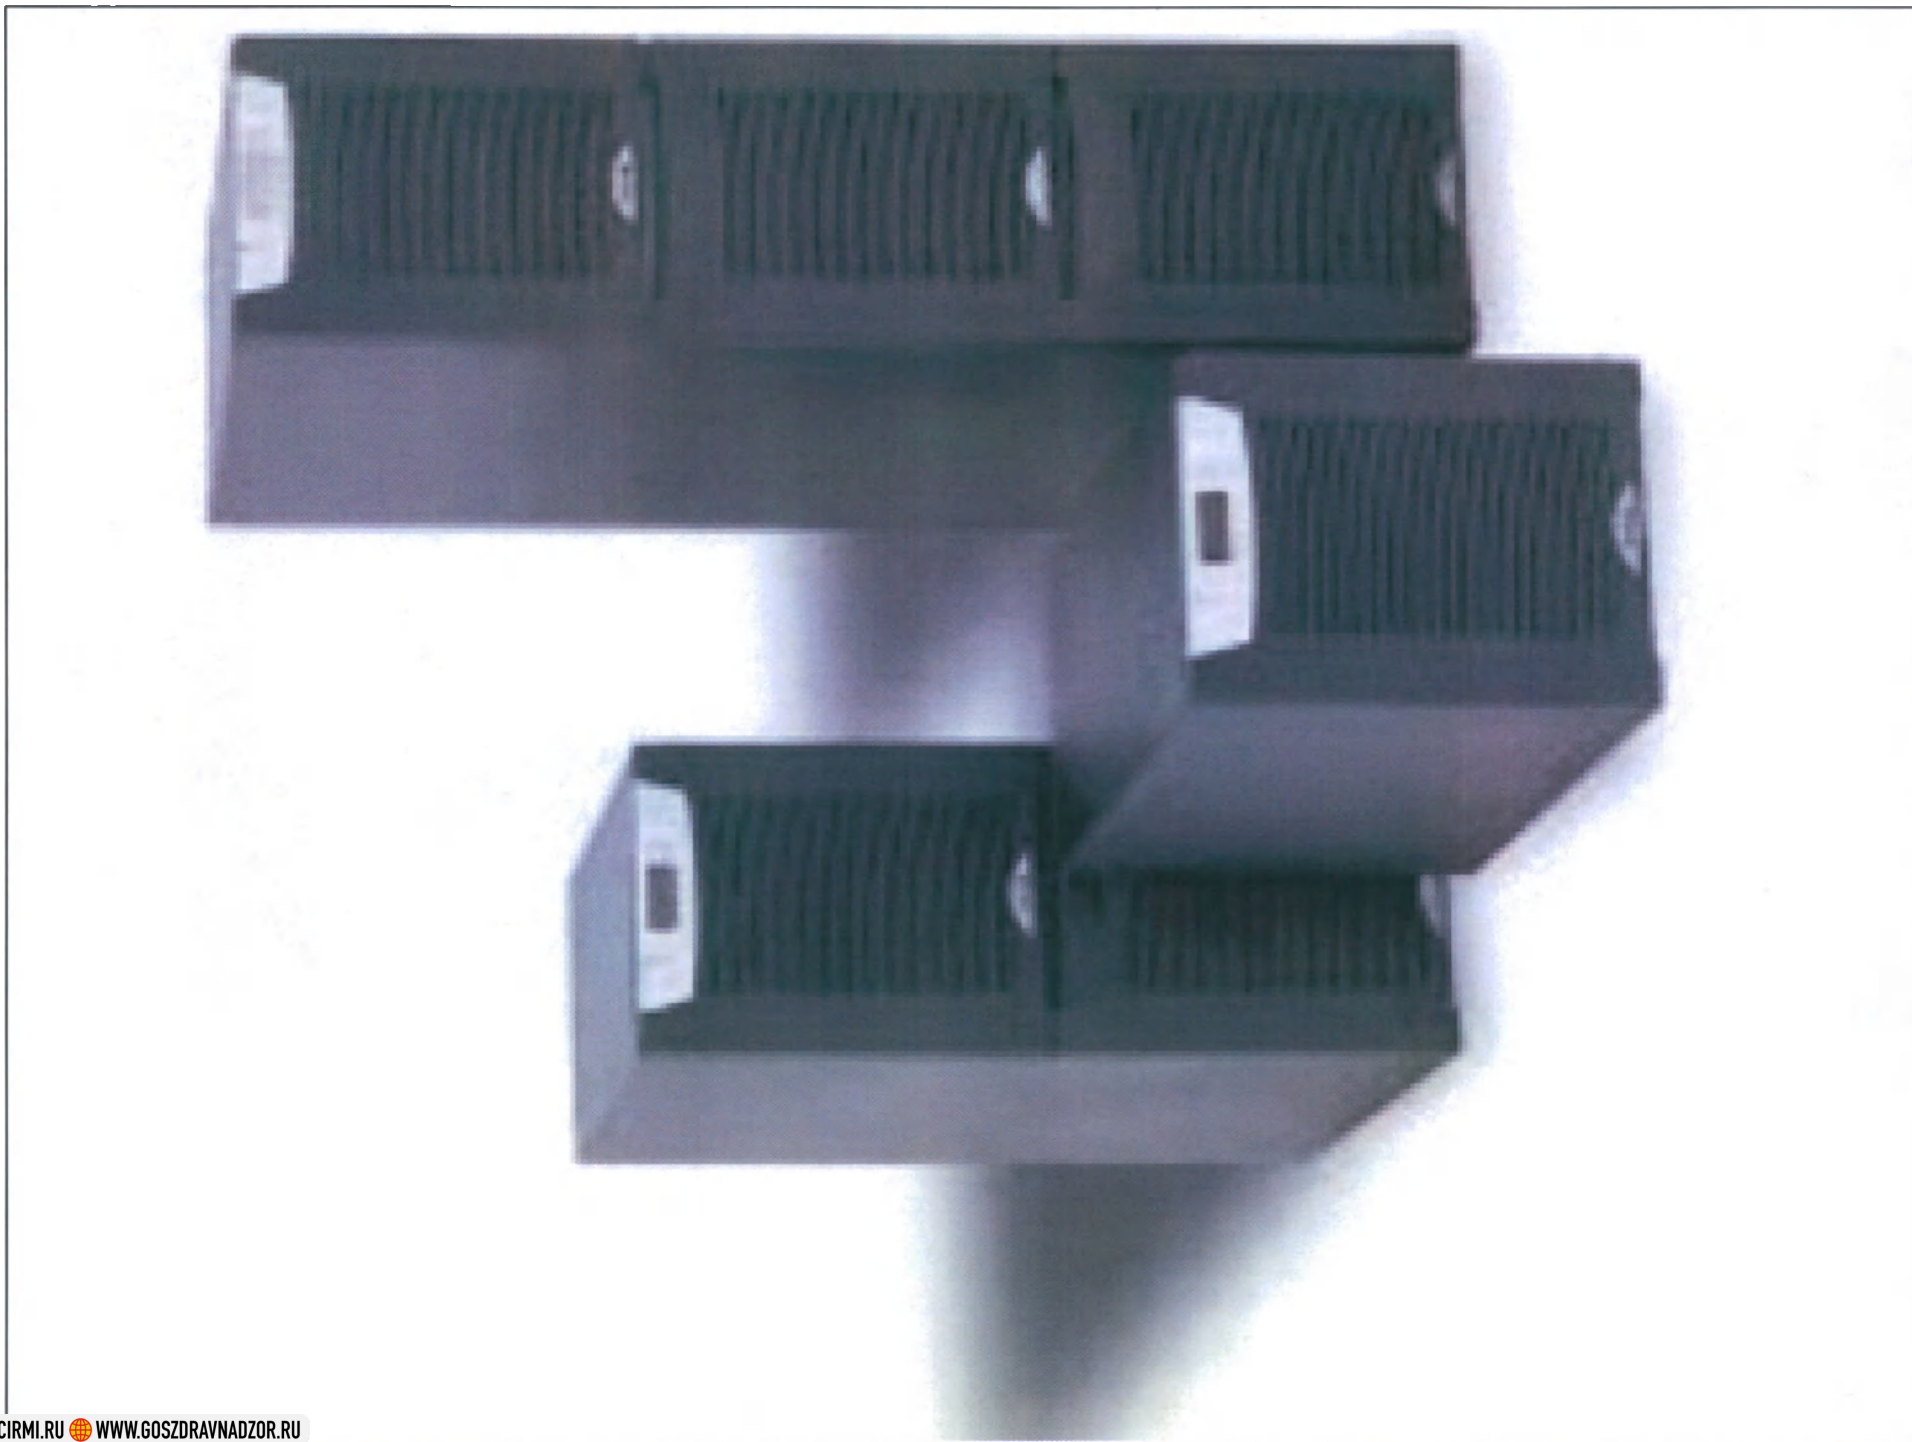

27. Источники бесперебойного питания для рабочей станции и (или) консоли (не более 10 шт.).

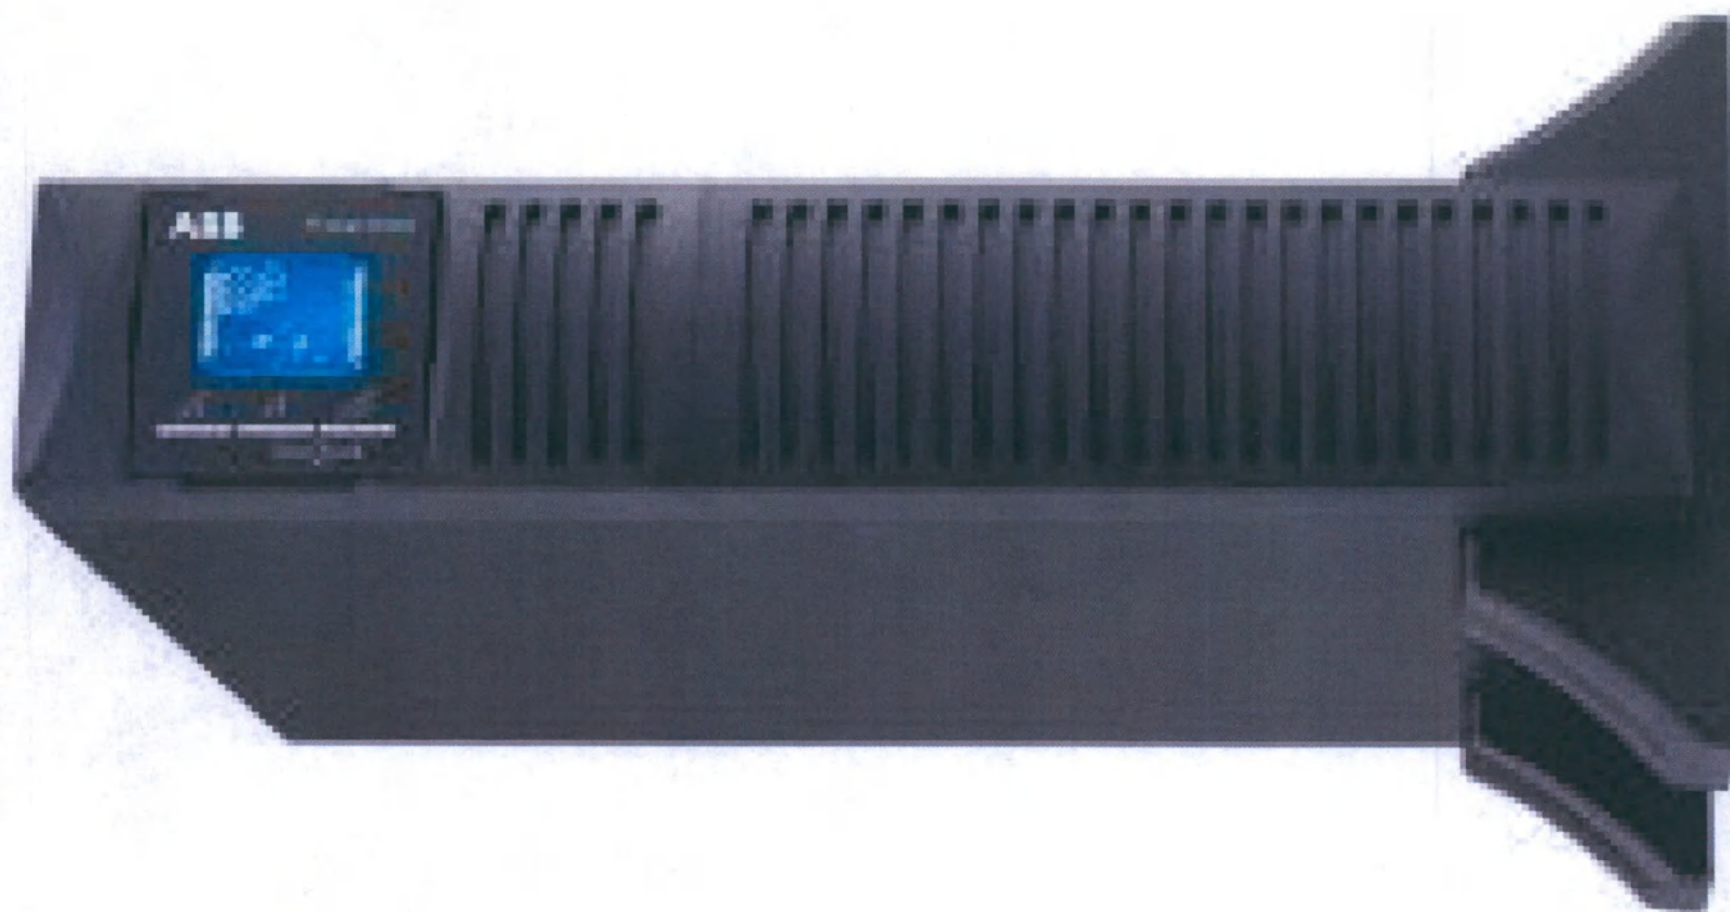

27. Источники бесперебойного питания для рабочей станции и (или) консоли (не более 10 шт.).



28. Модули хранения для рабочей станции (не более 4 шт.).



28. Модули хранения для рабочей станции (не более 4 шт.).



29. Дискн жесткне (не более 4 шт.).



30. Диски жесткие съемные с портом USB (не более 4 шт.).



30. Диски жесткие съемные с портом USB (не более 4 шт.).




30. Диски жесткие съемные с портом USB (не более 4 шт.).



31. Блоки оперативной памяти (не более 4 шт.).

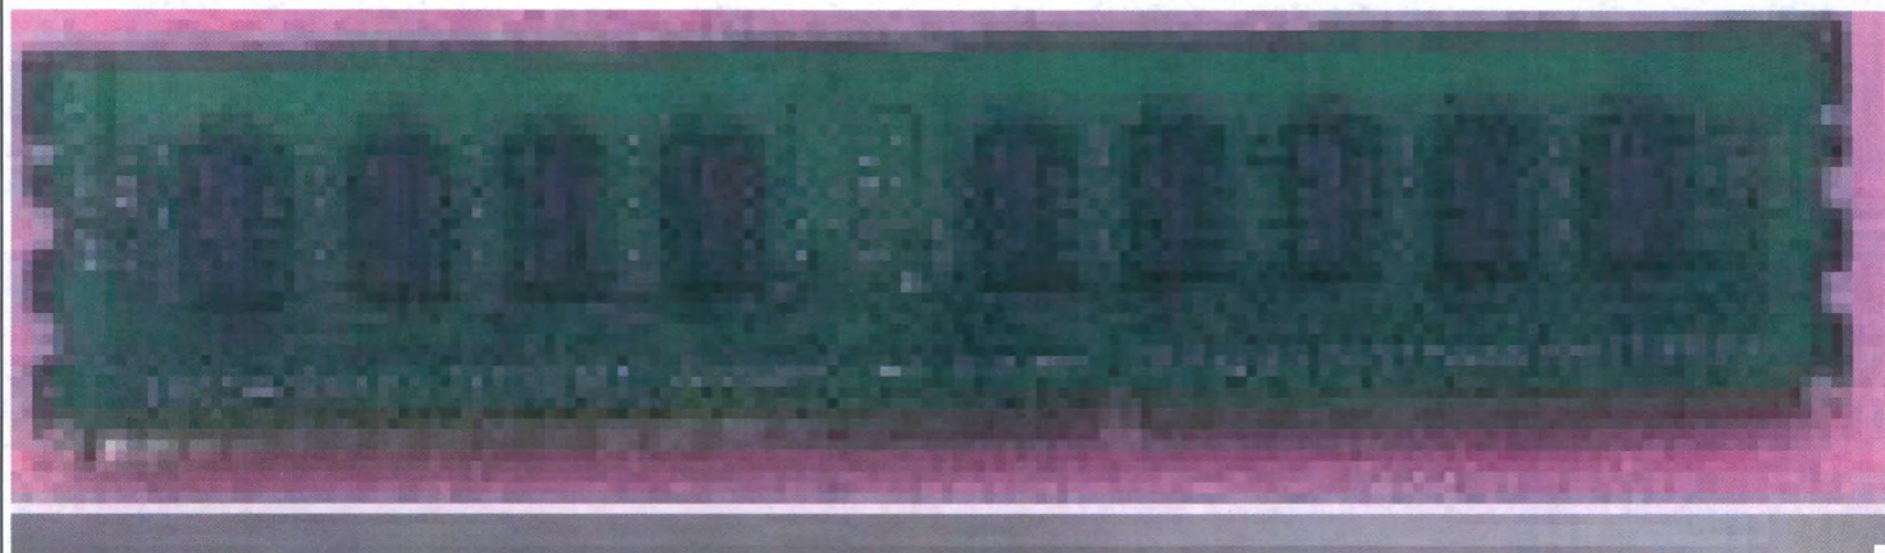


31. Блоки оперативной памяти (не более 4 шт.).


31. Блоки оперативной памяти (не более 4 шт.).




32. Блоки реконструкции дополнительные (не более 6 шт.).

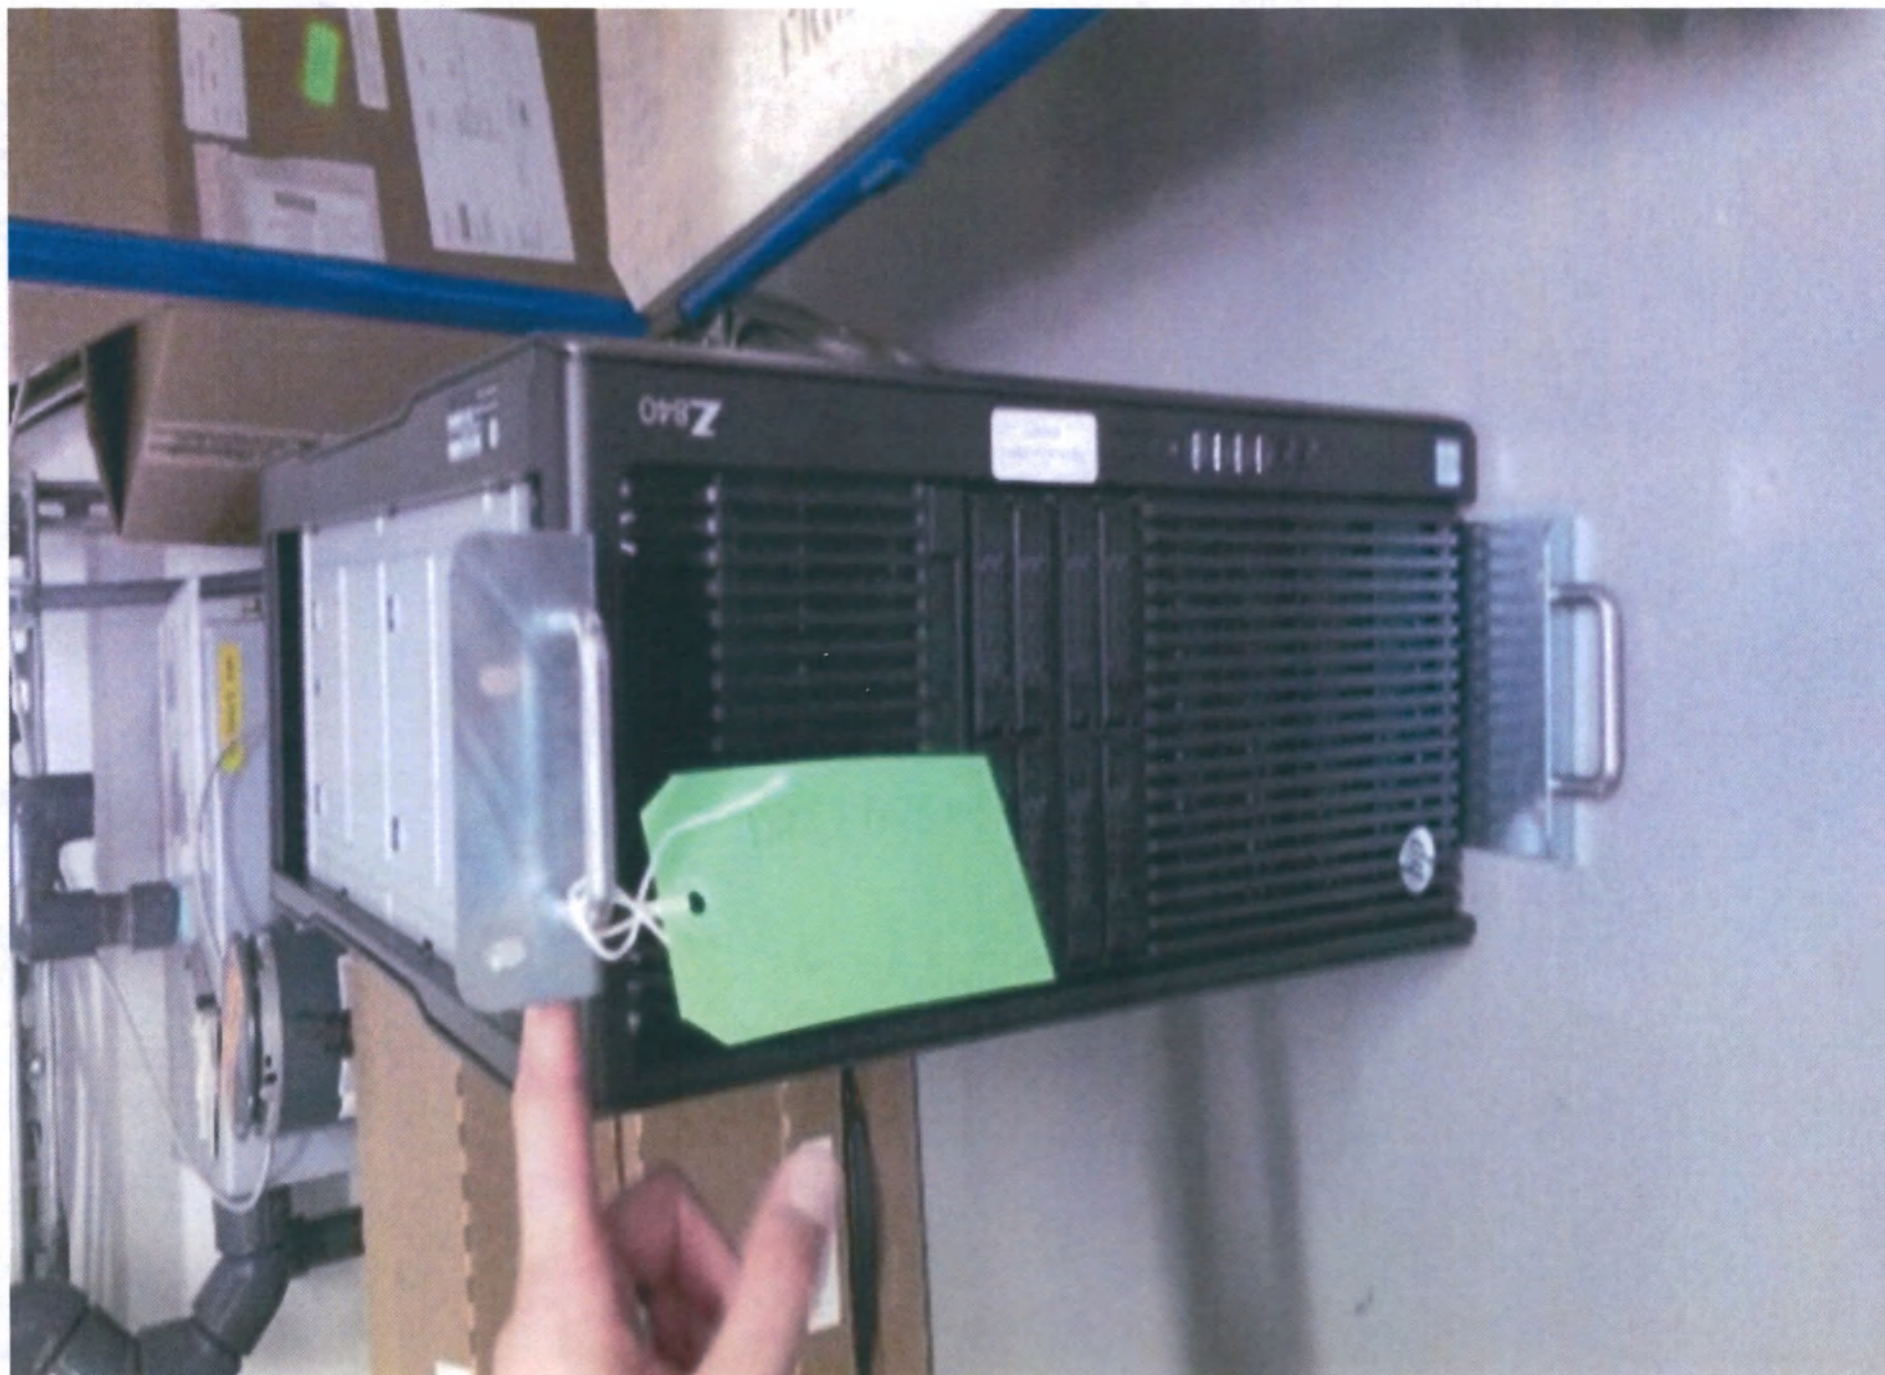

32. Блоки реконструкции дополнительные (не более 6 шт.).

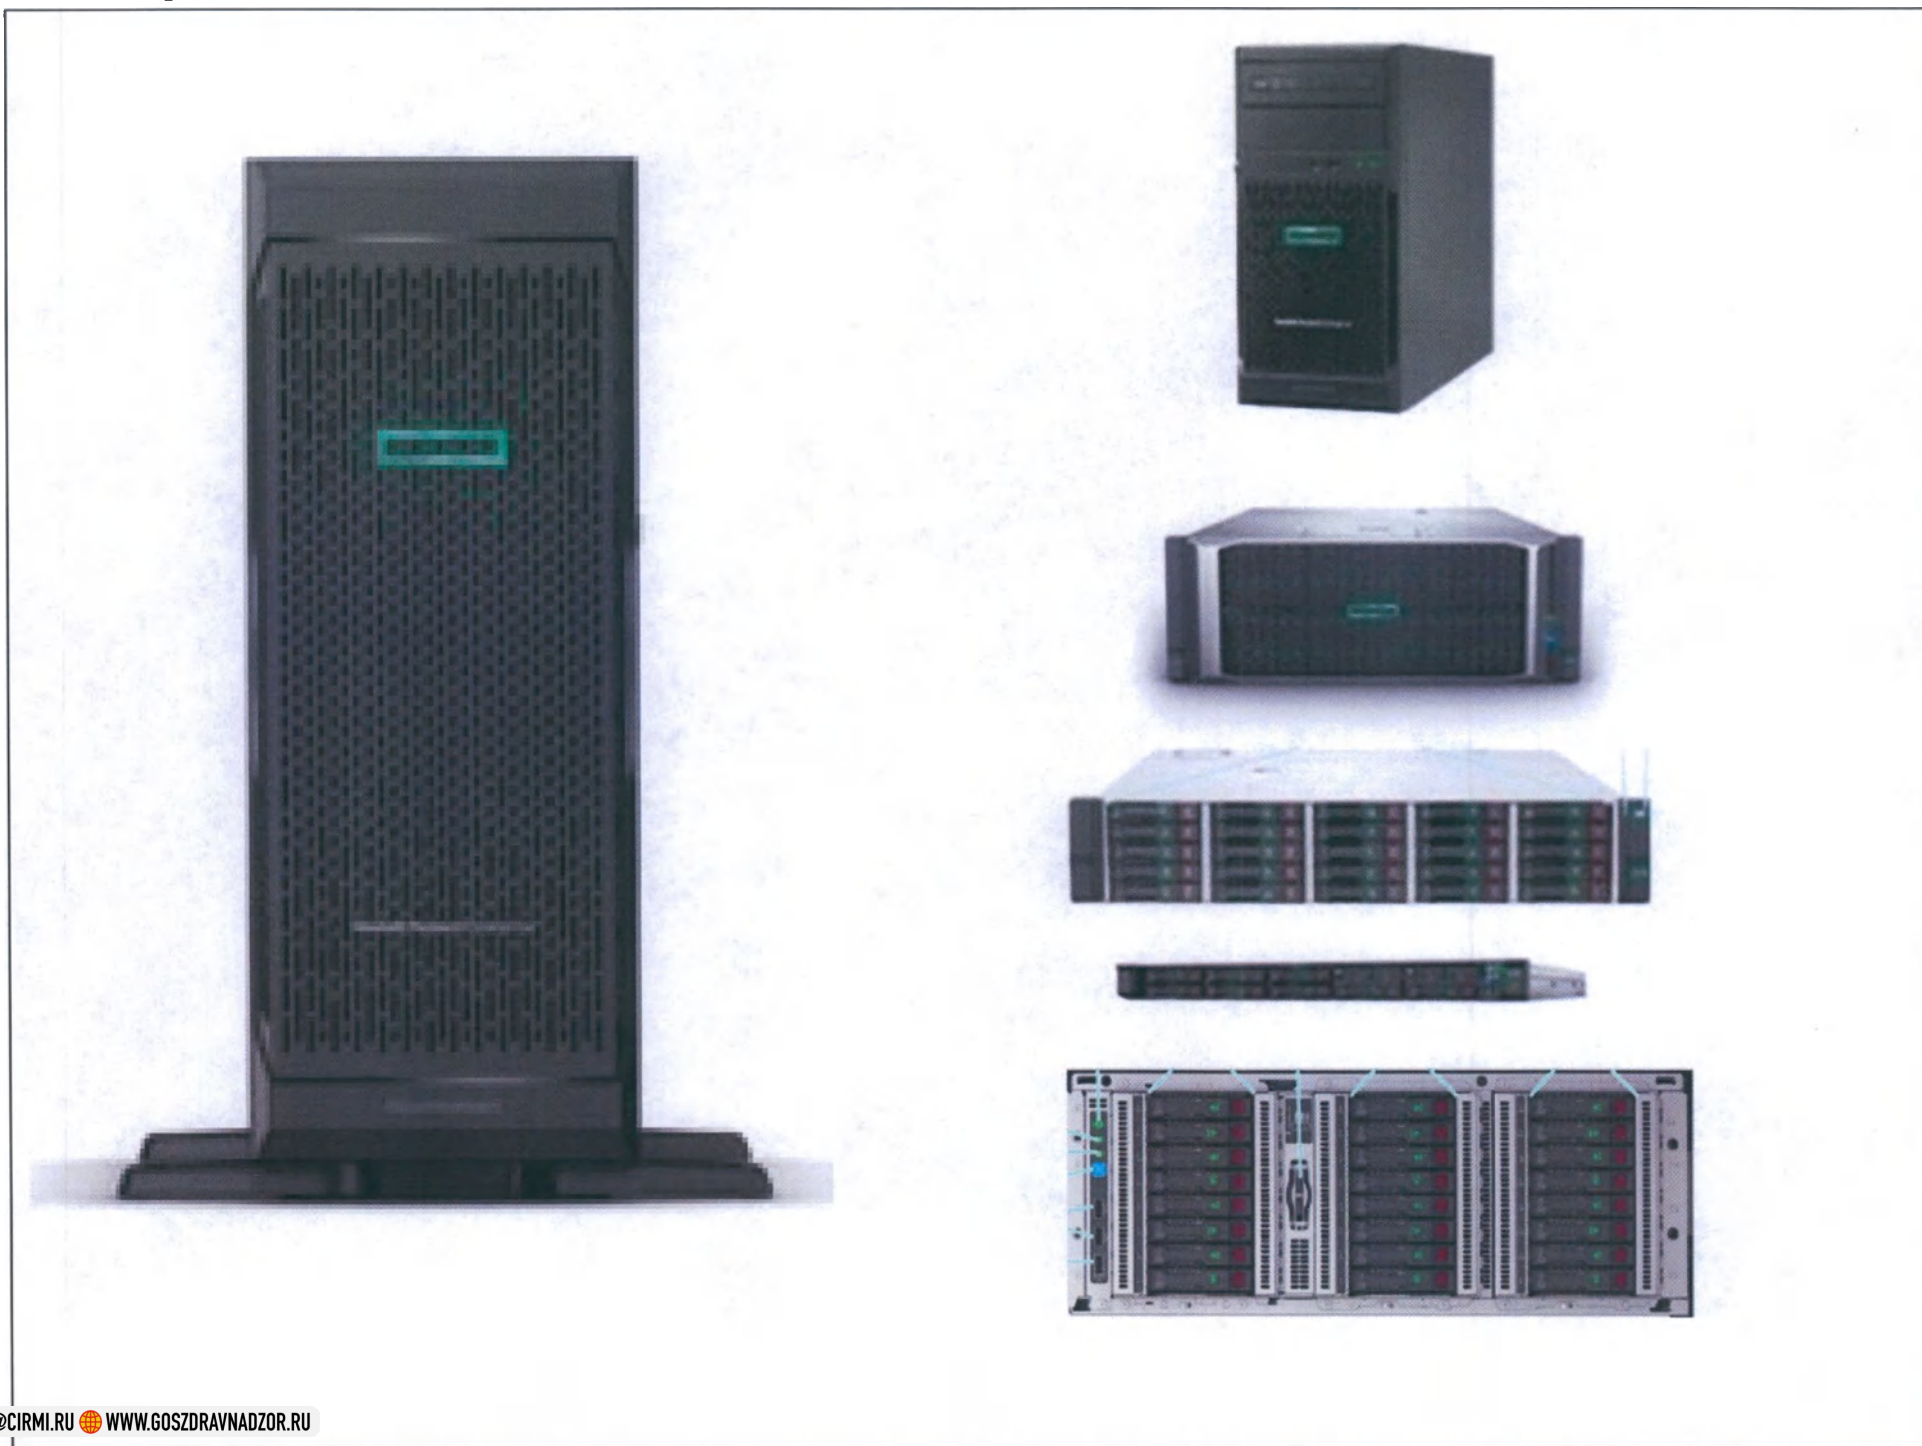


32. Блоки реконструкции дополнительные (не более 6 шт.).

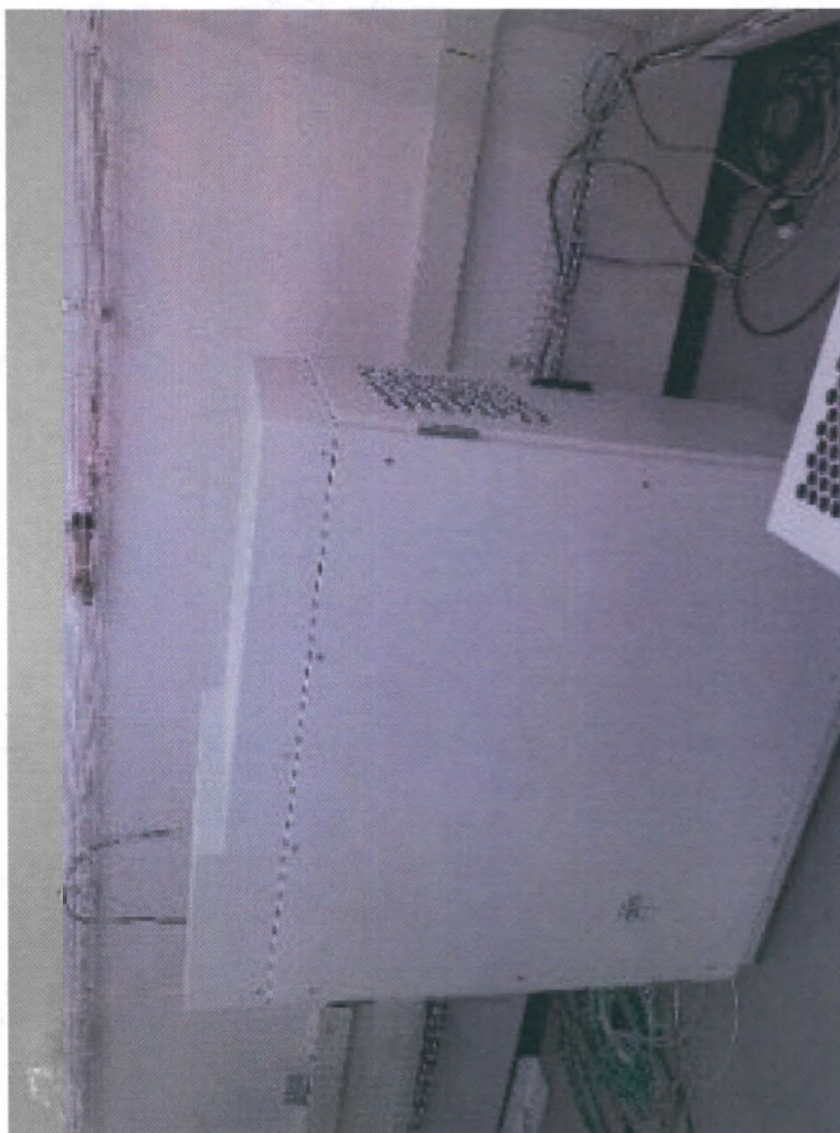

32. Блоки реконструкции дополнительные (не более 6 шт.).



32. Блоки реконструкции дополнительные (не более 6 шт.).

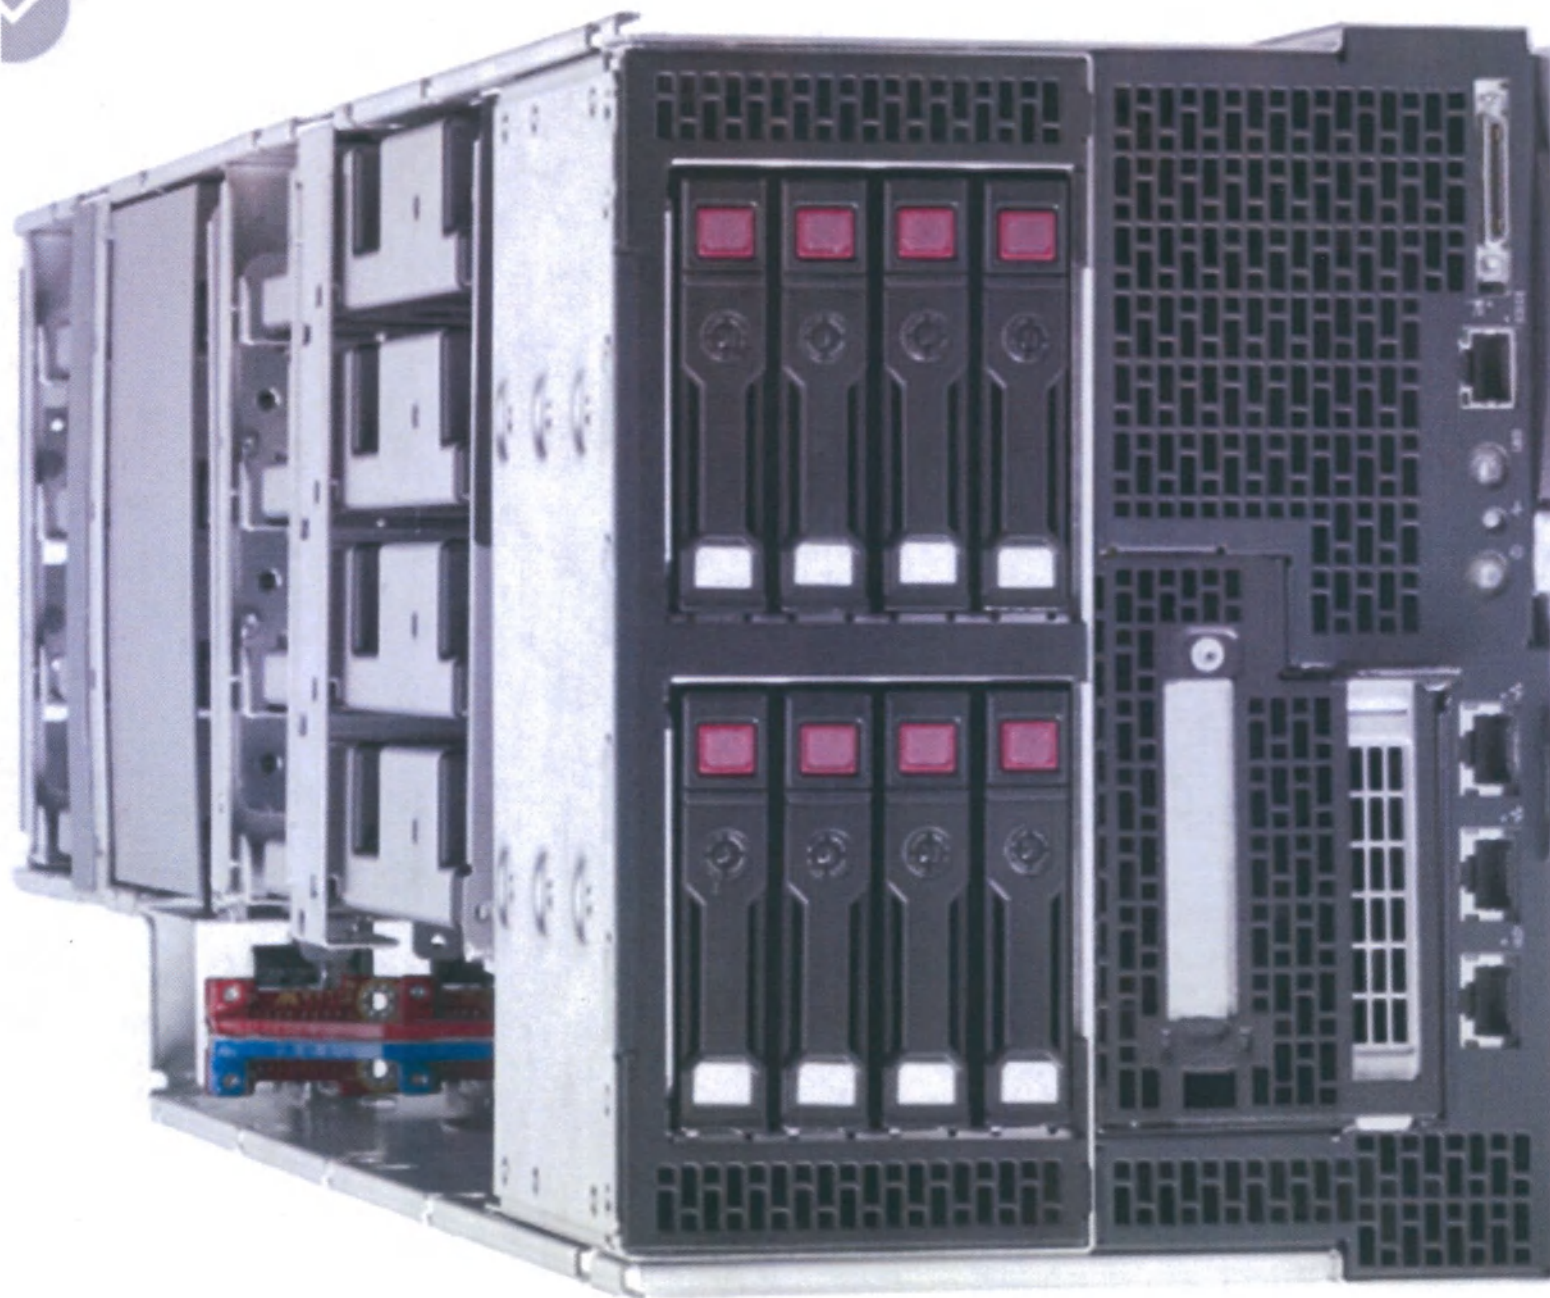

33. Дискководы (не более 4 шт.).



33. Дисководы (не более 4 шт.).



34. Мыши (не более 4 шт.).




35. Клавиатуры (не более 4 шт.).



36. Клавиатуры специальные (не более 4 шт.).




37. Трекболы (не более 4 шт.).

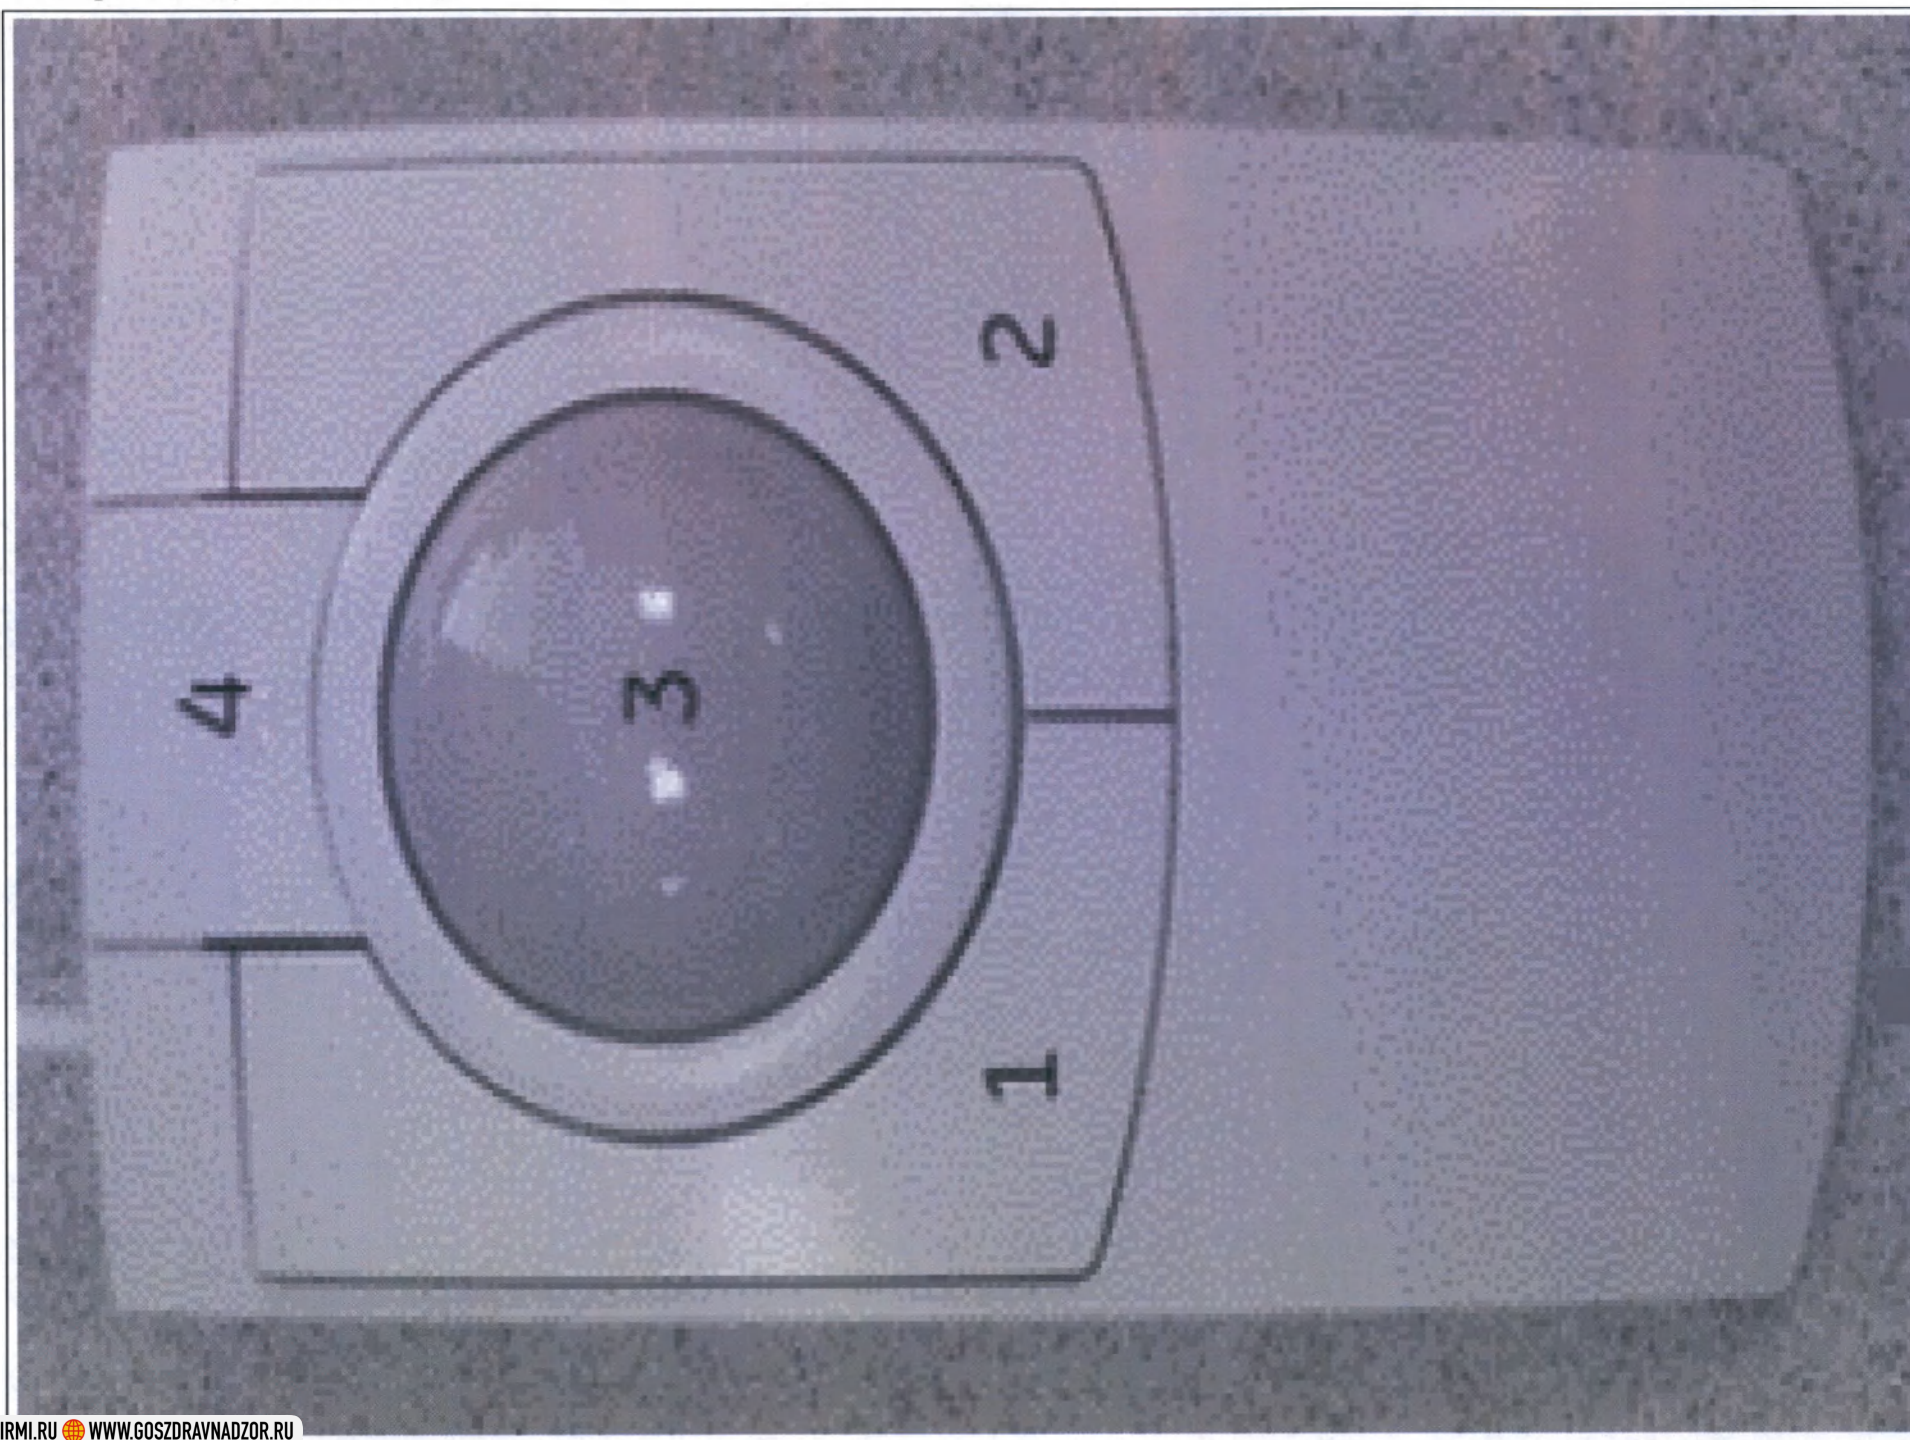


38. Наклейки для клавиатуры (не более 4 шт.).




39. Источники бесперебойного питания комплекса (не более 10 шт.).

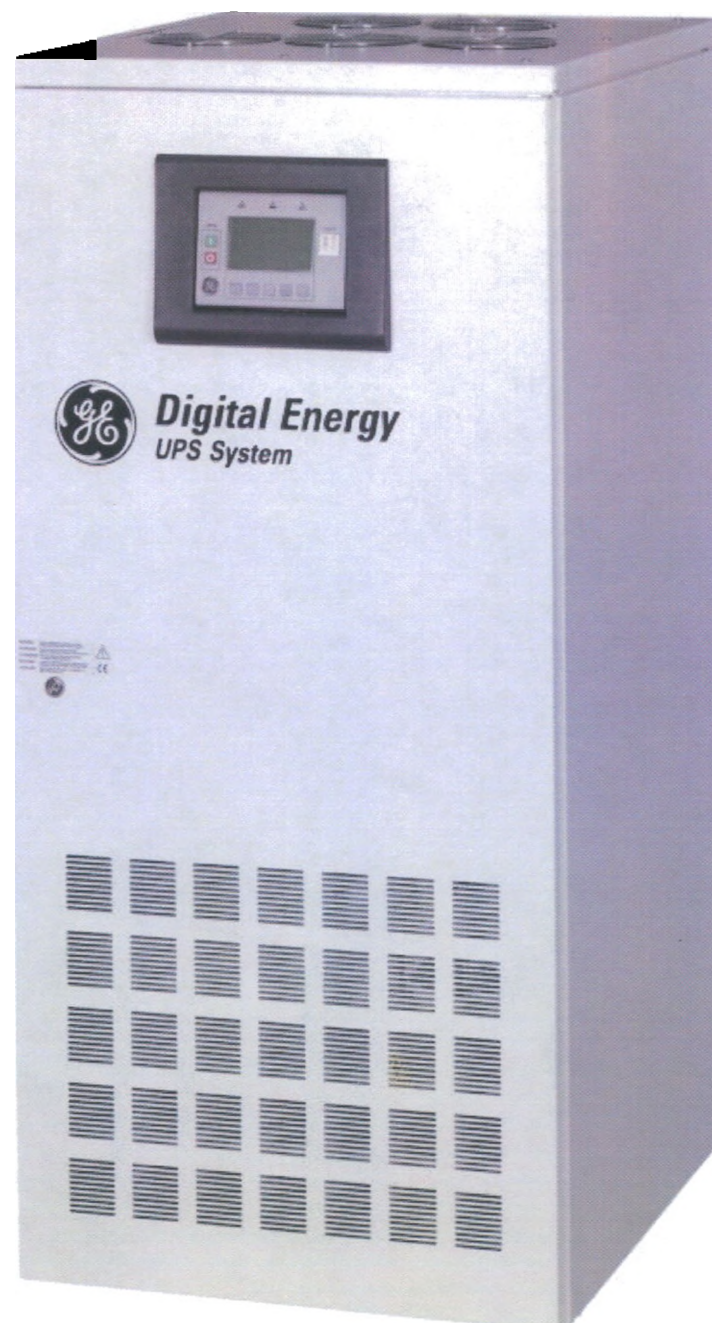


39. Источники бесперебойного питания комплекса (не более 10 шт.).

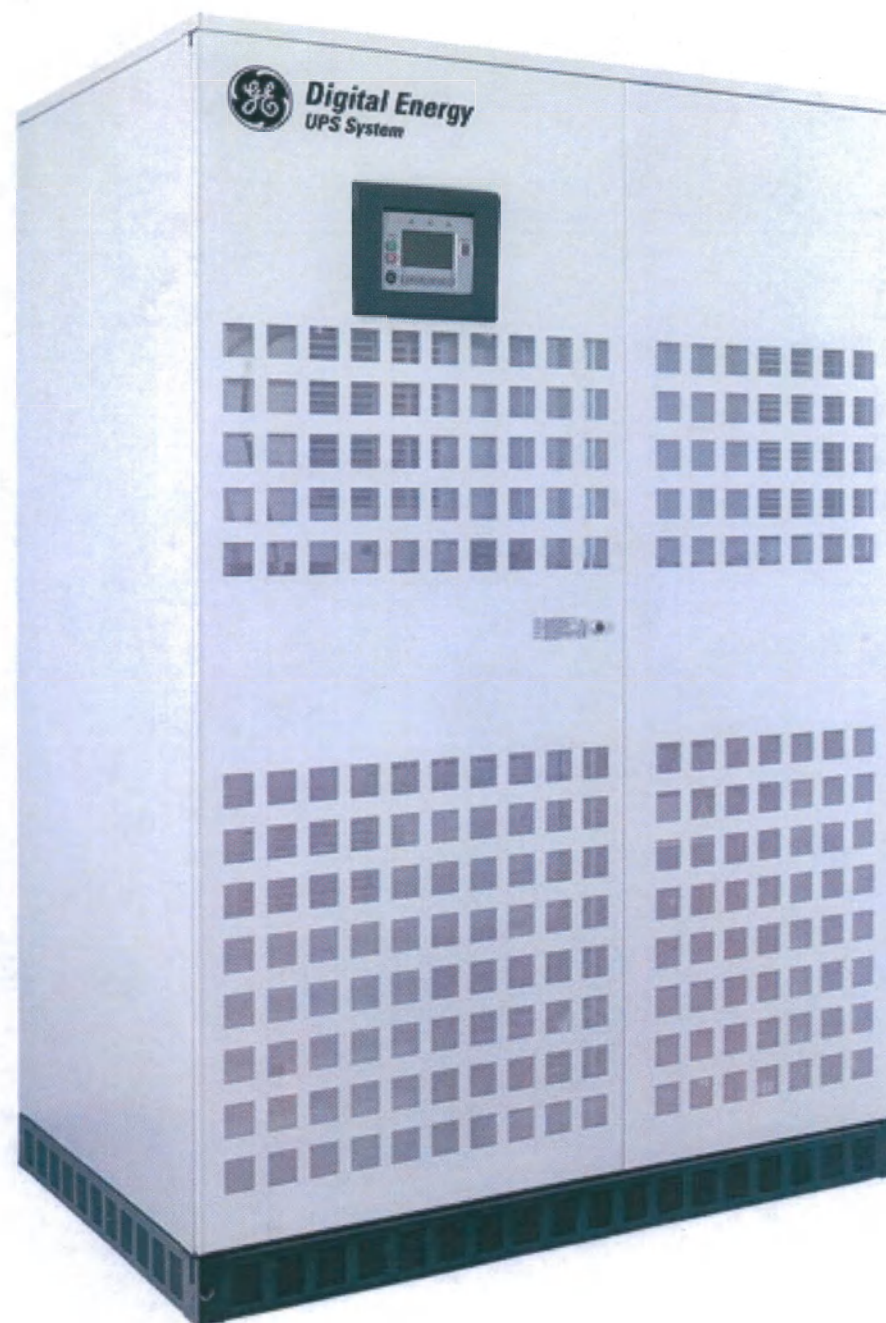


39. Источники бесперебойного питания комплекса (не более 10 шт.).

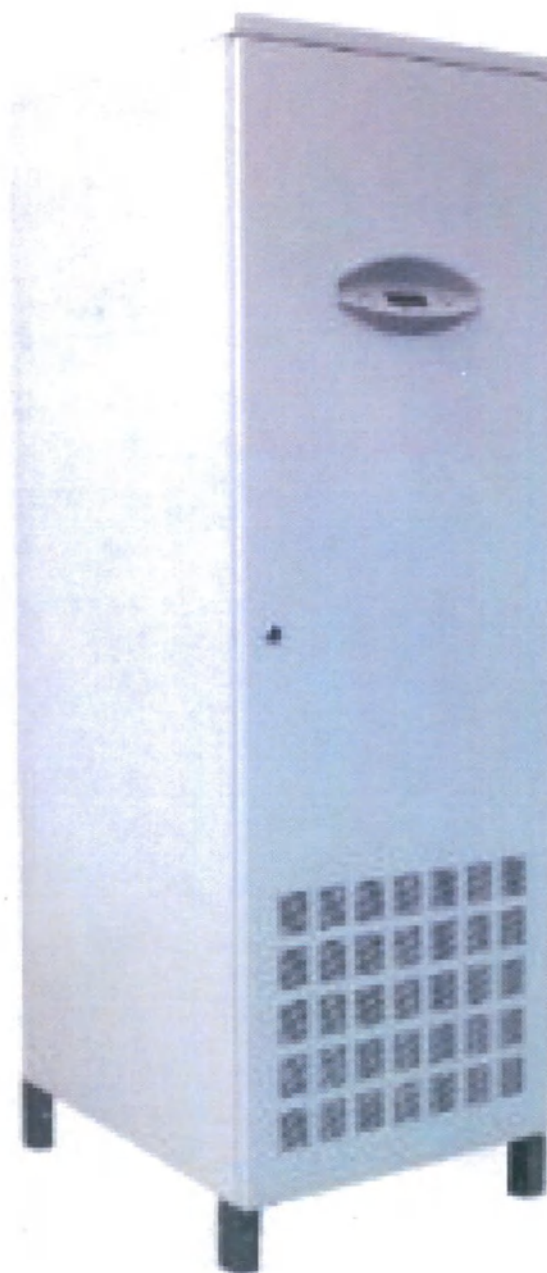

39. Источники бесперебойного питания комплекса (не более 10 шт.).

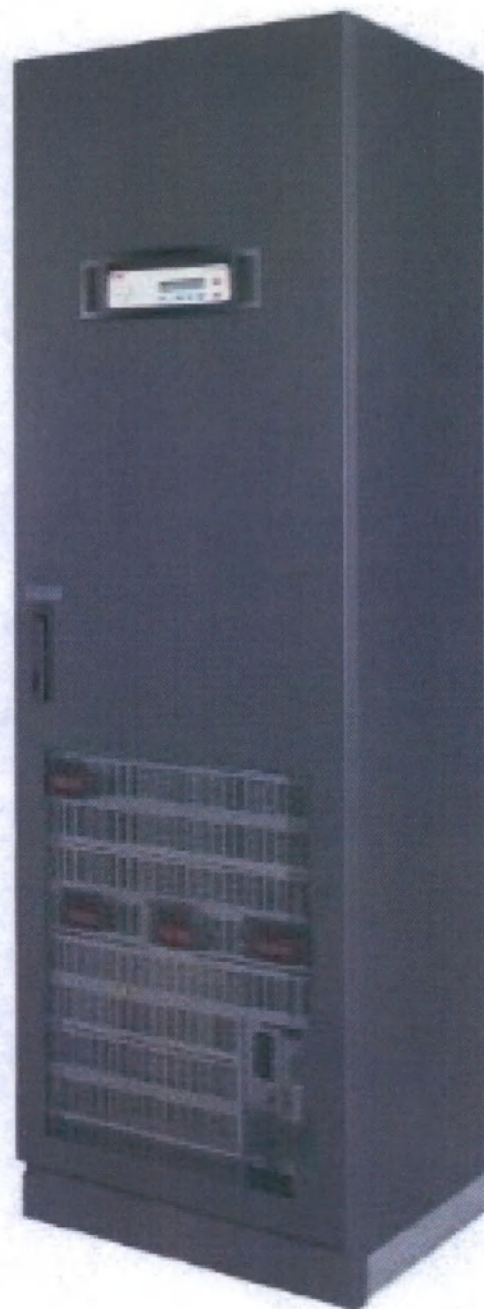

39. Источники бесперебойного питания комплекса (не более 10 шт.).

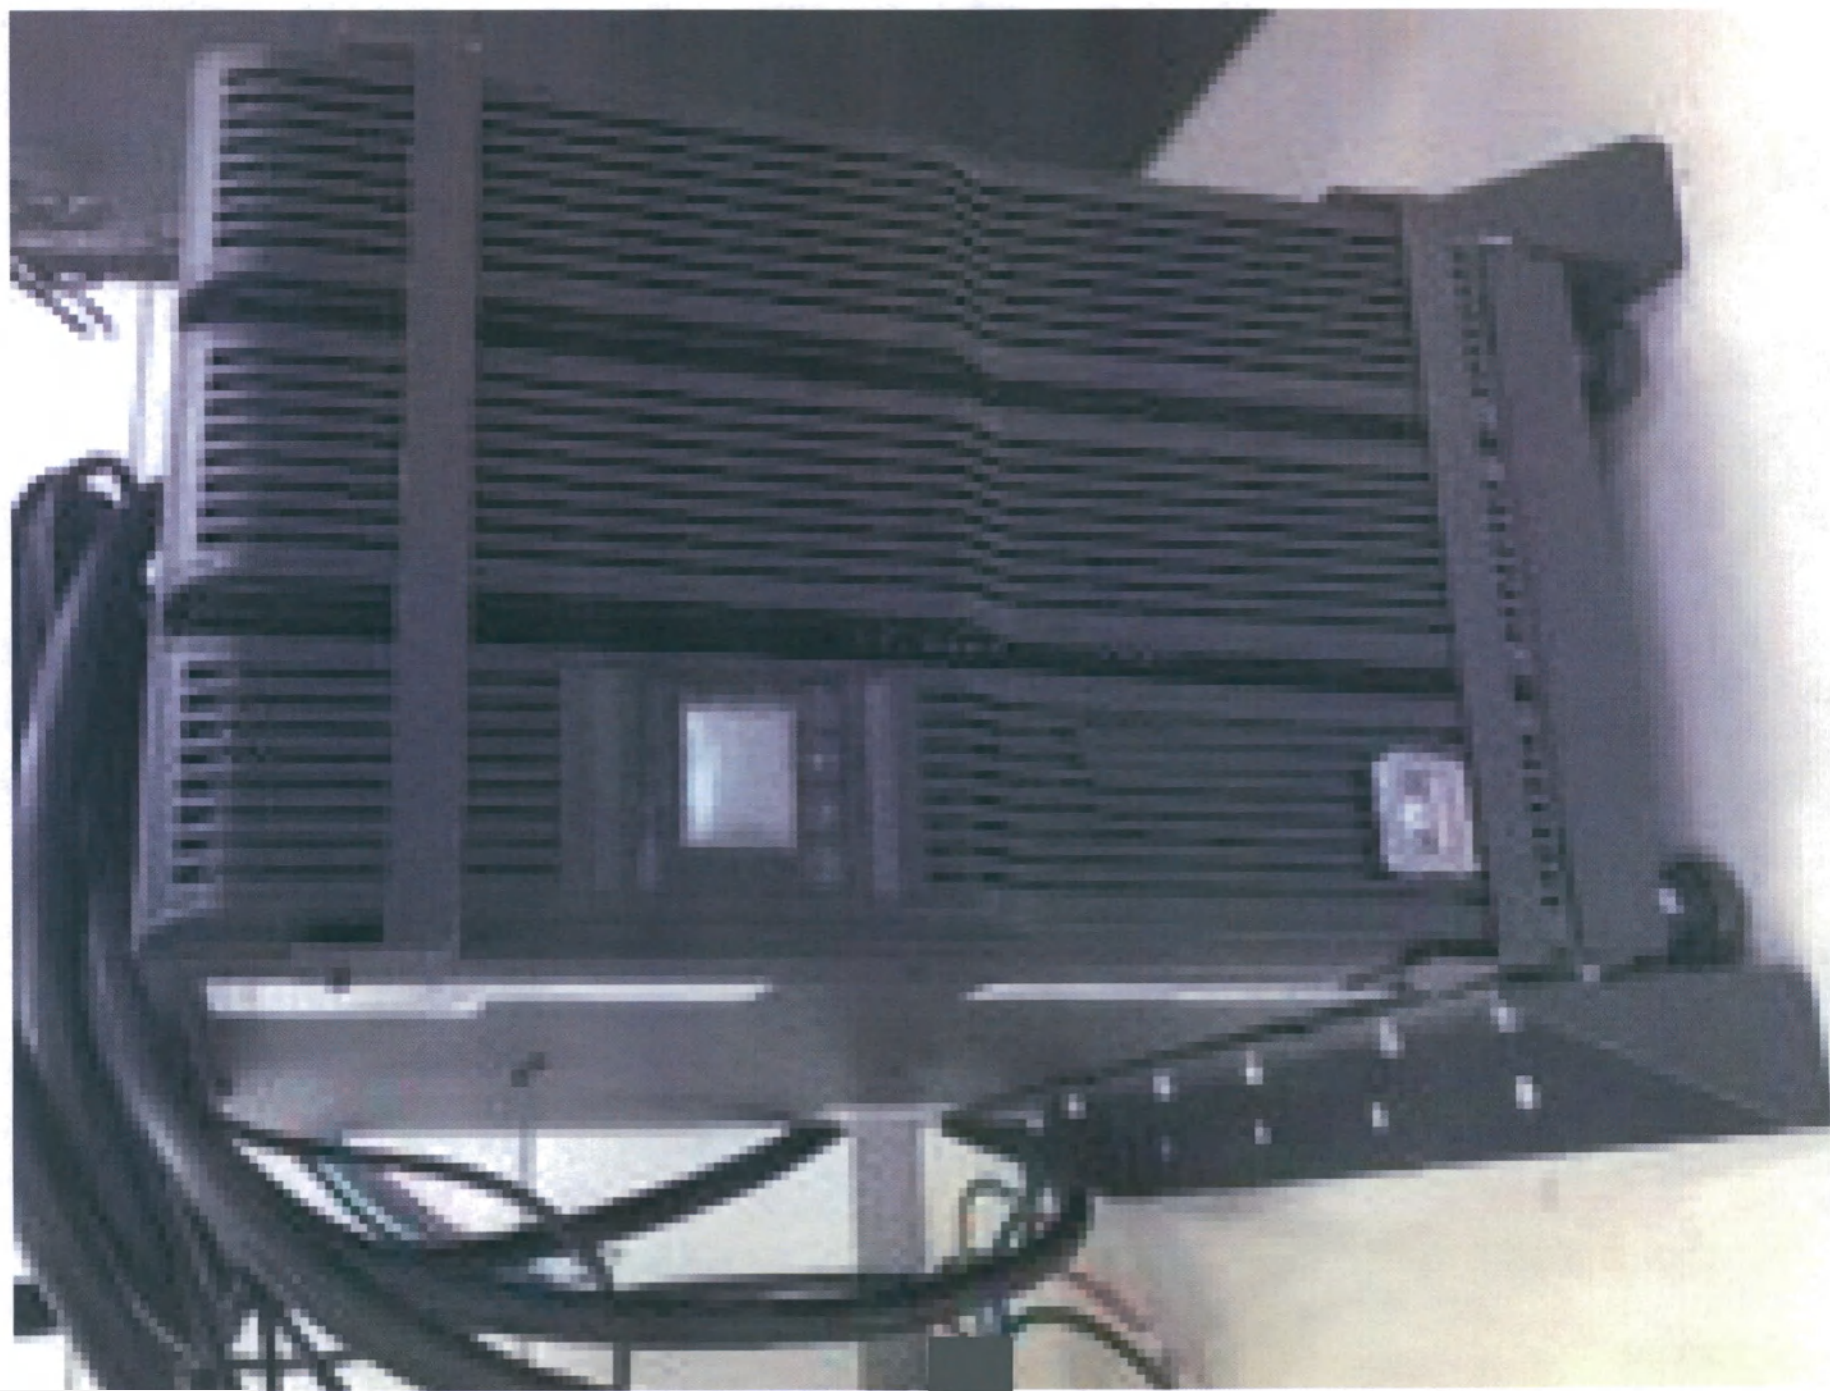


39. Источники бесперебойного питания комплекса (не более 10 шт.).




39. Источники бесперебойного питания комплекса (не более 10 шт.).

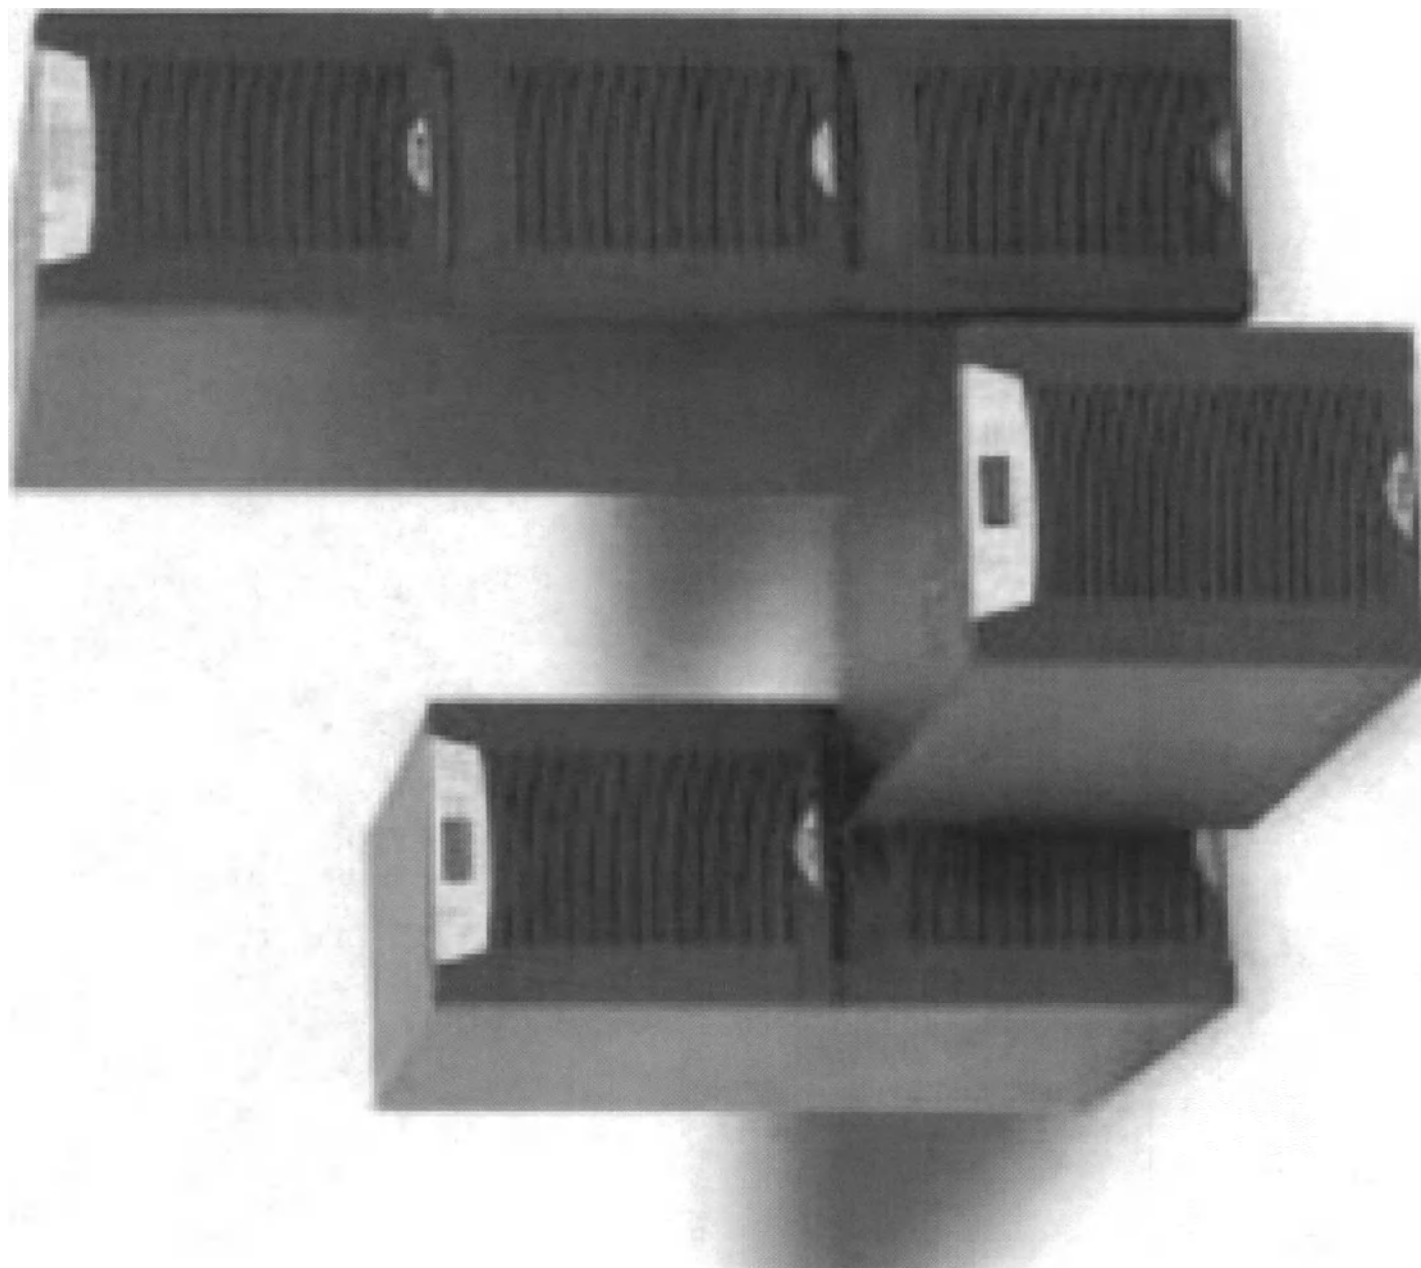


39. Источники бесперебойного питания комплекса (не более 10 шт.).

39. Источники бесперебойного питания комплекса (не более 10 шт.).

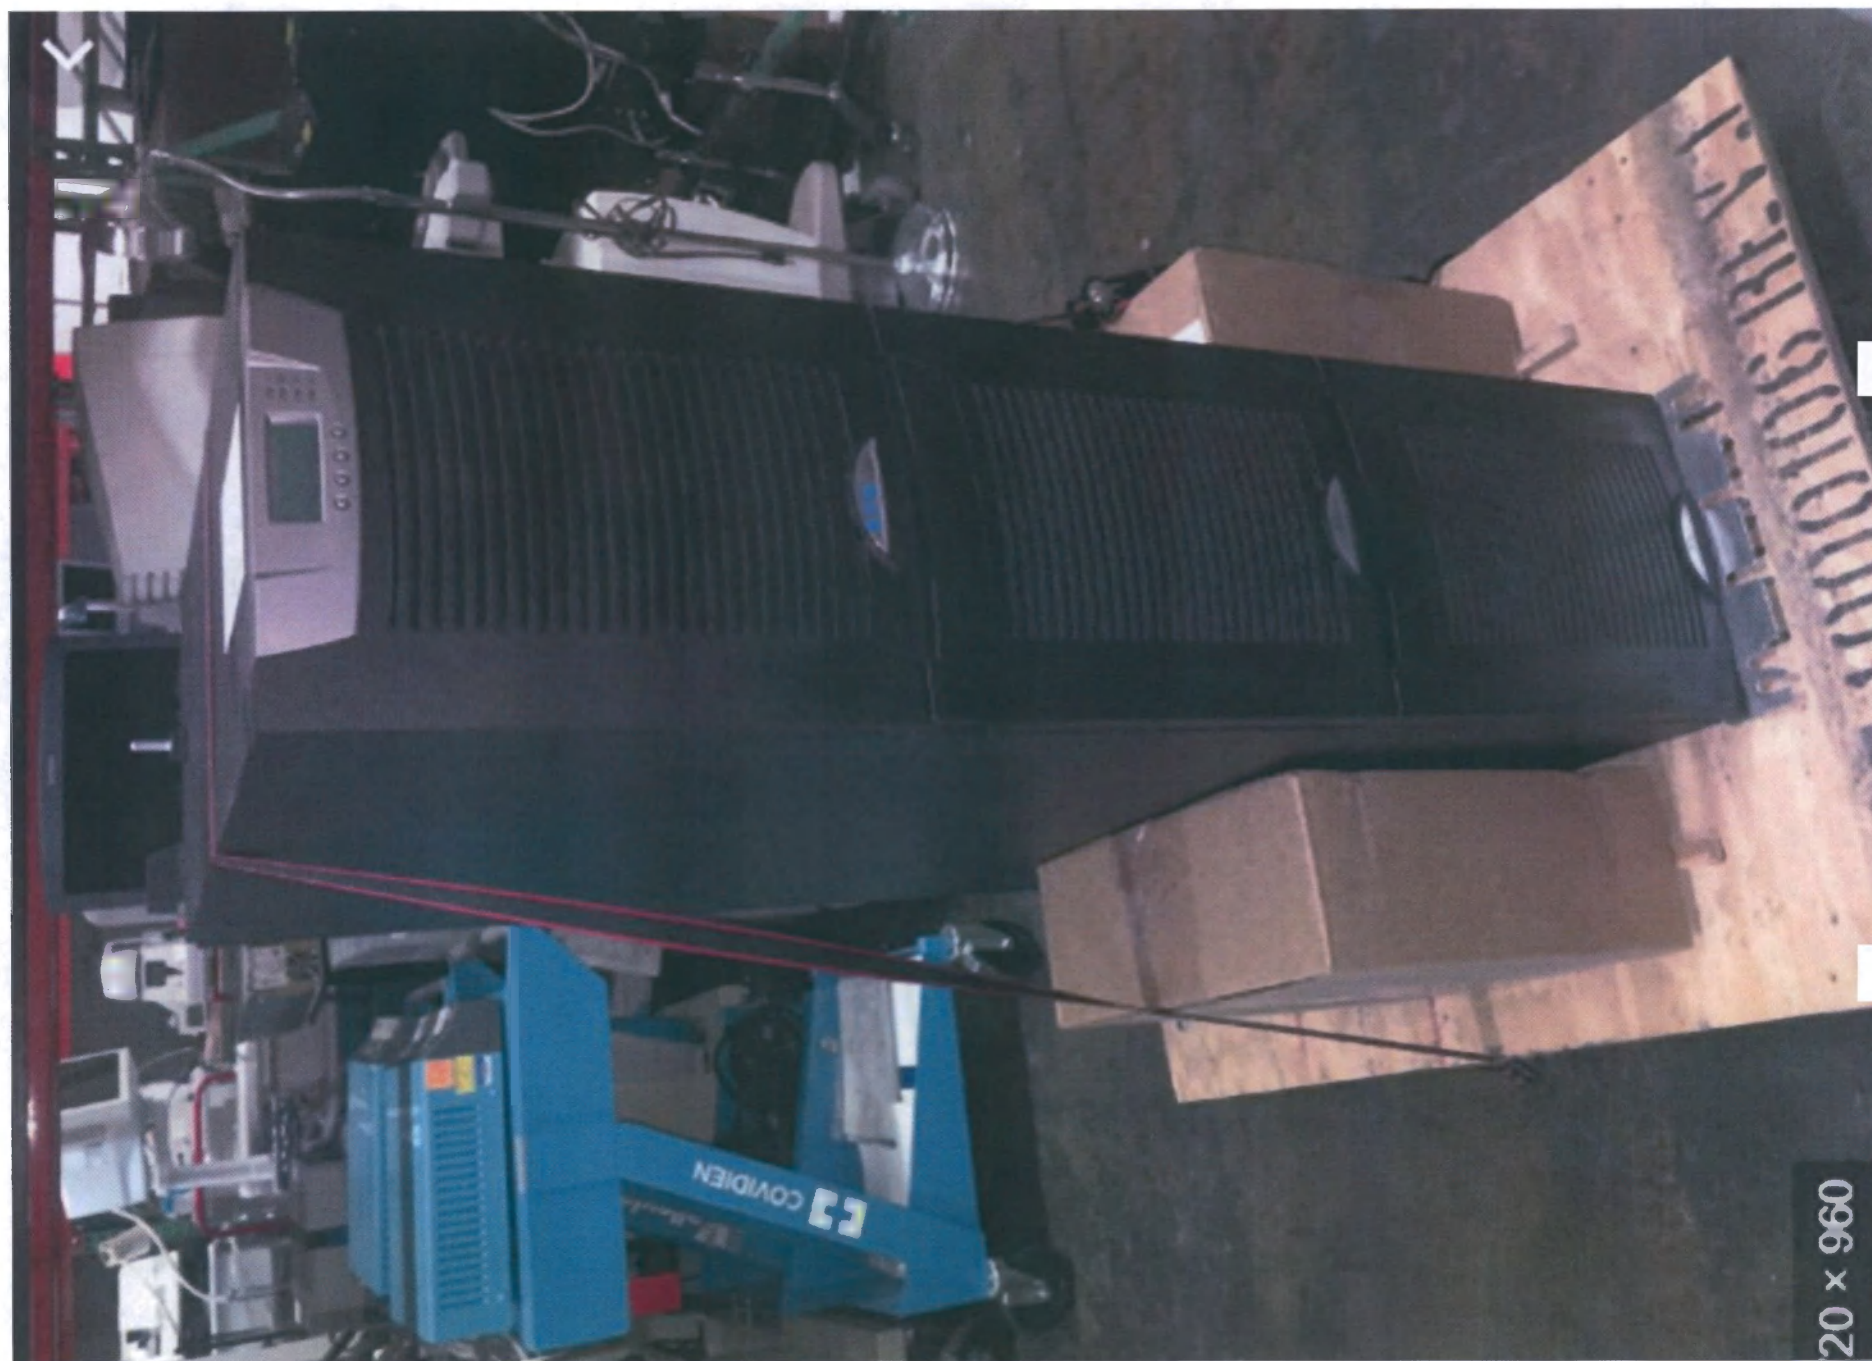

20 × 960

40. Инъекторы для введения контрастного вещества (не более 4 шт.).

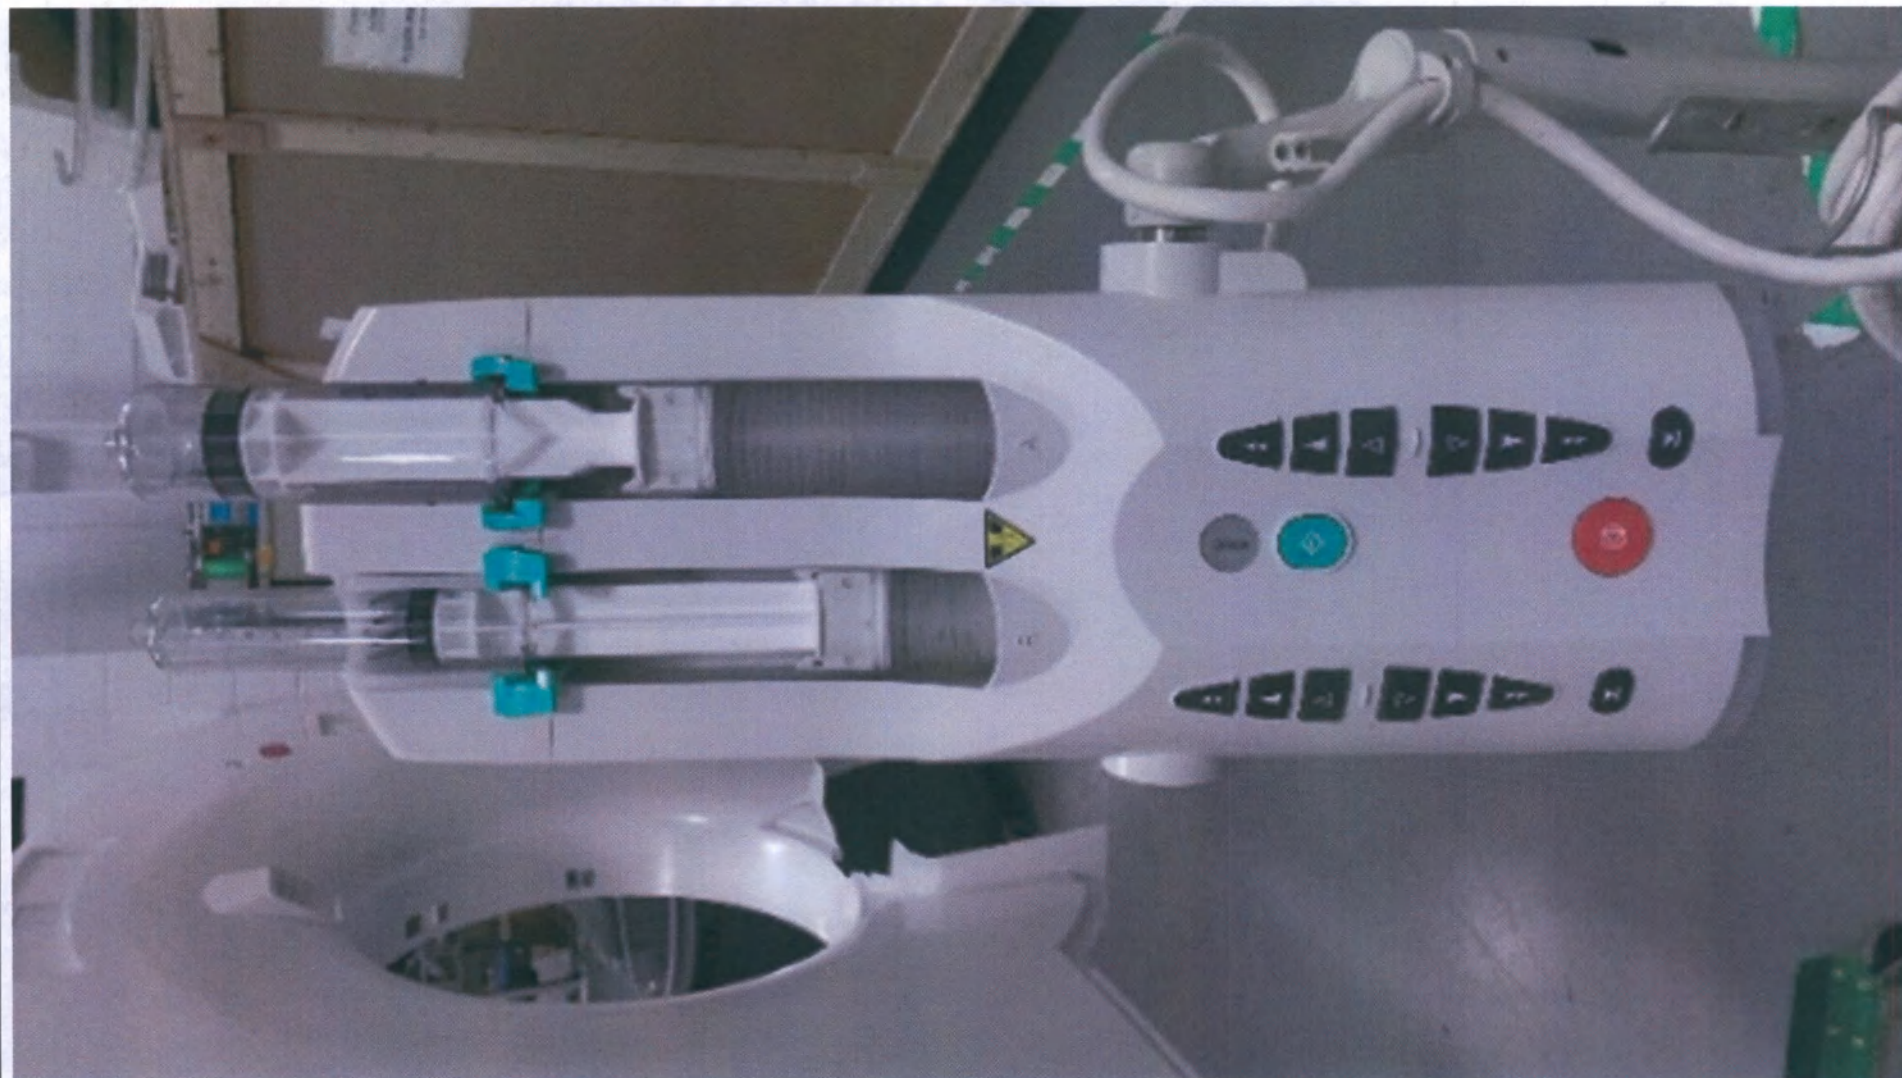

40. Инъекторы для введения контрастного вещества (не более 4 шт.).




40. Инъекторы для введения контрастного вещества (не более 4 шт.).



41. Монитор кардиосинхронизации.

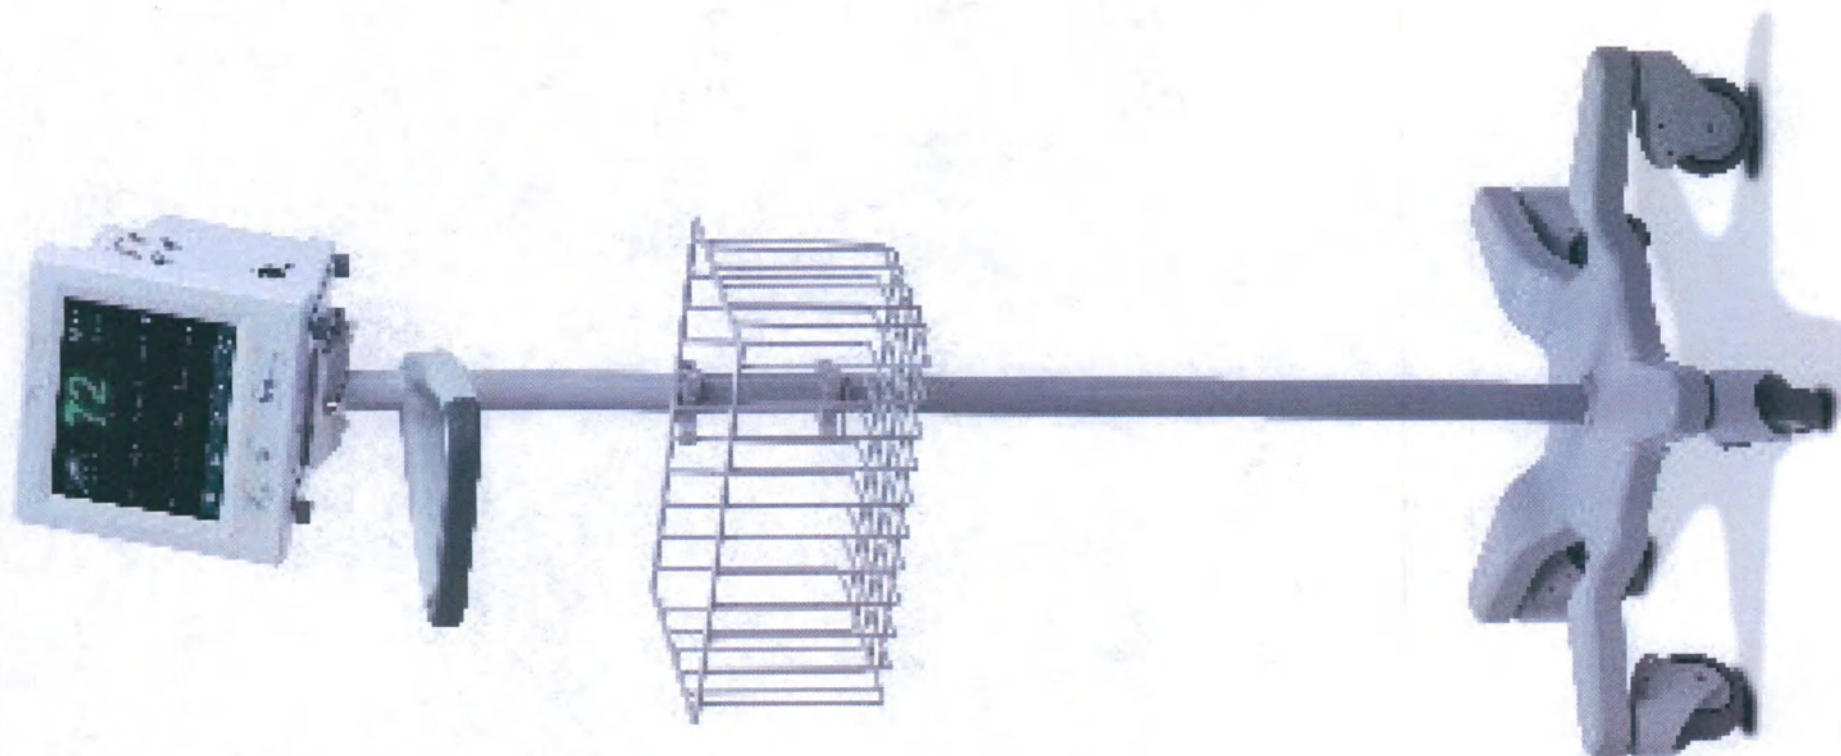

41. Монитор кардиосинхронизации.


42. Кабели для монитора кардиосинхронизации (не более 5 шт.).



42. Кабели для монитора кардиосинхронизации (не более 5 шт.).



43. Устройства планирующие для радиотерапии (не более 4 шт.).

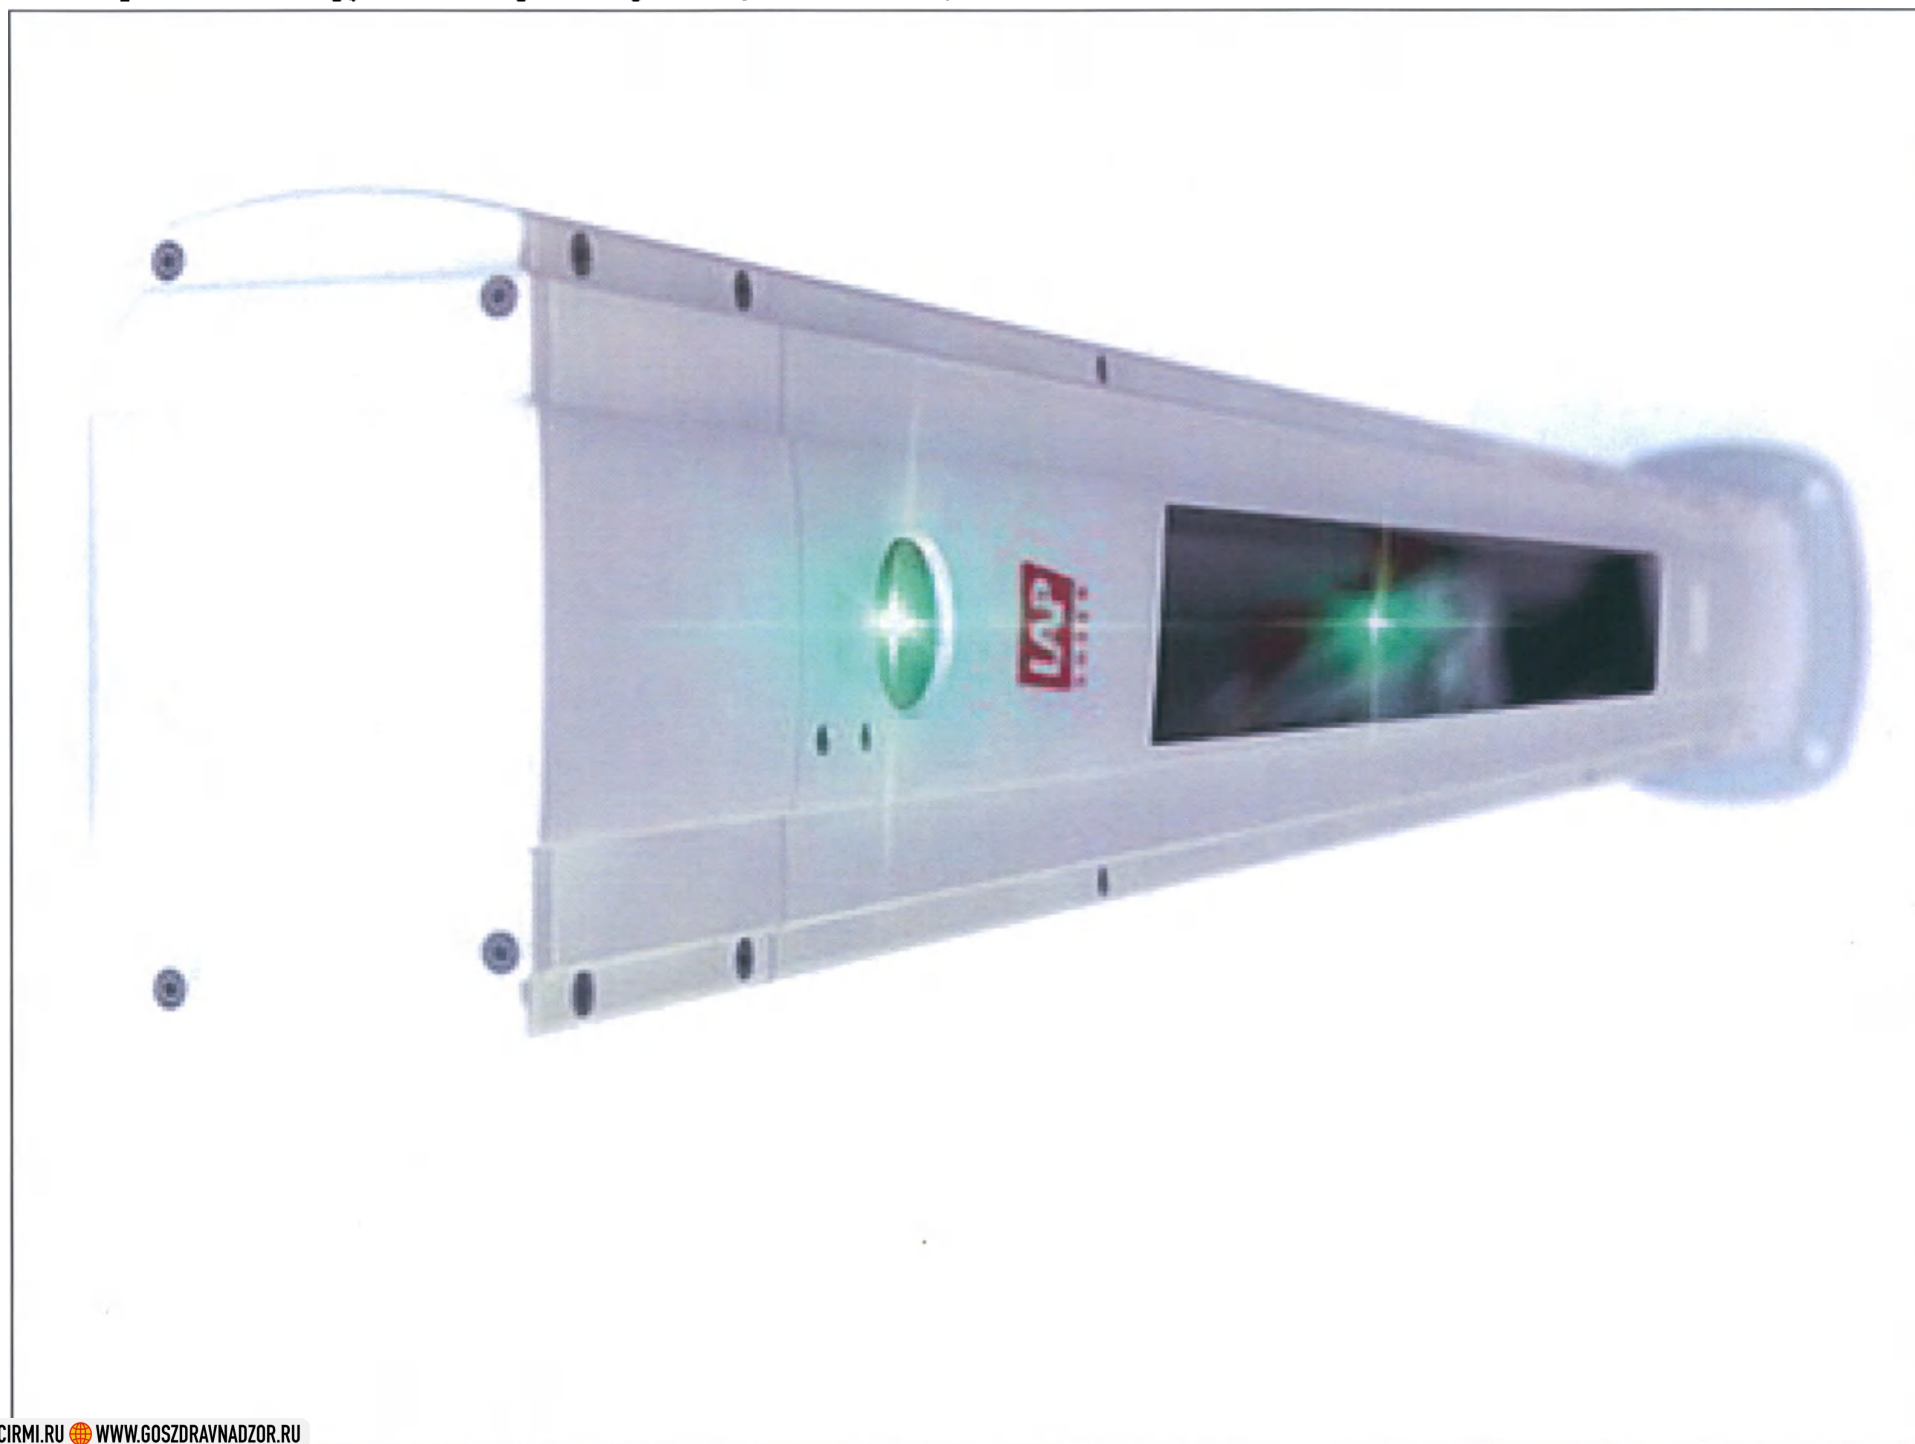

43. Устройства планирующие для радиотерапии (не более 4 шт.).



44. Сканер штрихкодов.



45. Принтеры для печати медицинских изображений (не более 4 шт.).



46. Пленка для принтеров для печати медицинских изображений (не более 100 шт.).



46. Пленка для принтеров для печати медицинских изображений (не более 100 шт.).



46. Пленка для принтеров для печати медицинских изображений (не более 100 шт.).





47. Компоненты для транспортировки, монтажа и настройки комплекса (не более 100 шт.).



47. Компоненты для транспортировки, монтажа и настройки комплекса (не более 100 шт.).



47. Компоненты для транспортировки, монтажа и настройки комплекса (не более 100 шт.).



48. Приспособления для монтажа комплекса (не более 4 шт.).



48. Приспособления для монтажа комплекса (не более 4 шт.).



49. Инструменты для сервисного обслуживания комплекса (не более 4 шт.).



49. Инструменты для сервисного обслуживания комплекса (не более 4 шт.).


49. Инструменты для сервисного обслуживания комплекса (не более 4 шт.).




50. Тележки мобильные для транспортировки комплекса (не более 6 шт.).



51. Устройства для модернизации комплекса (не более 25 шт.).

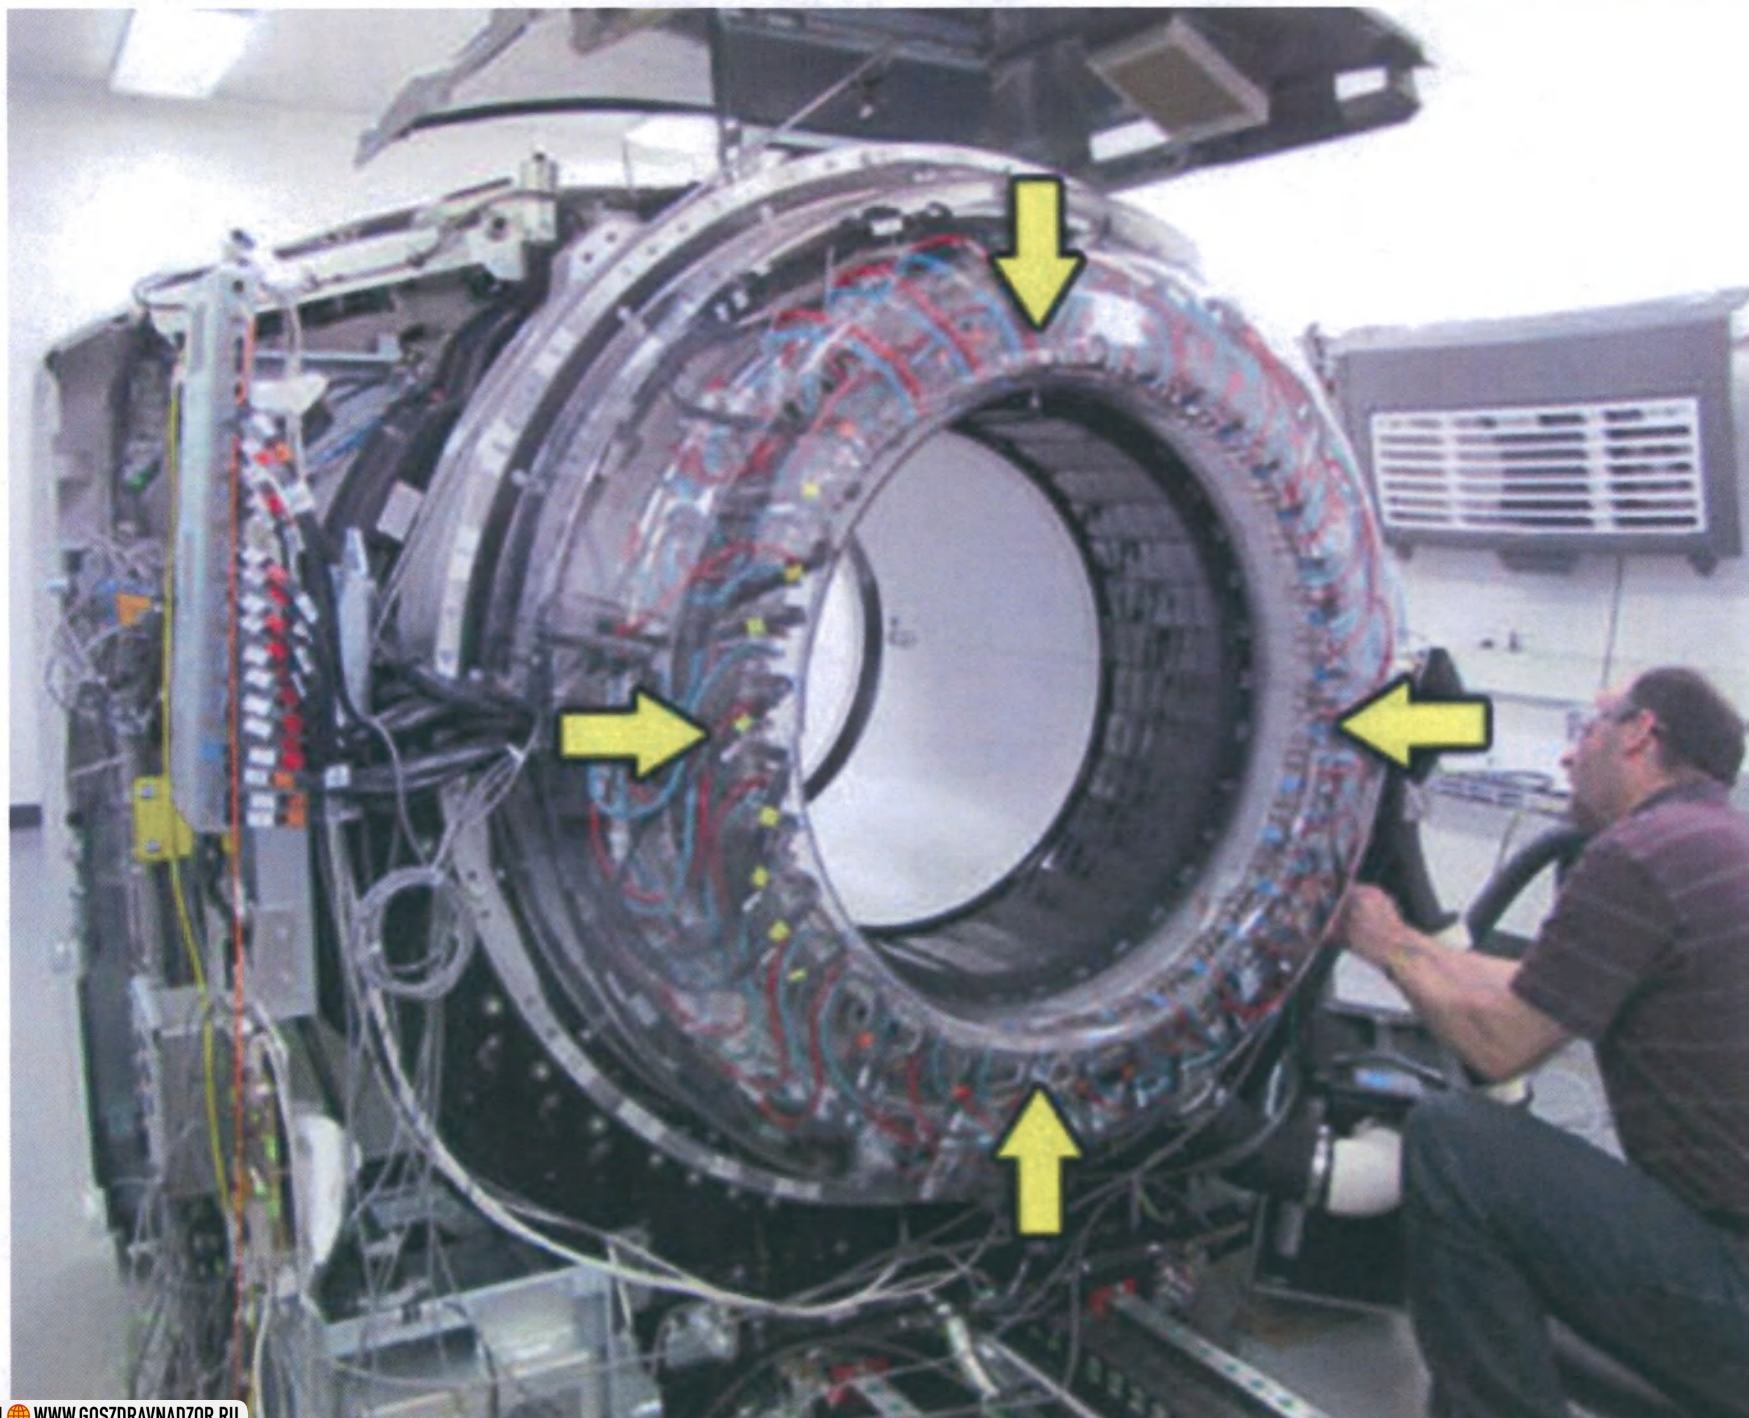


51. Устройства для модернизации комплекса (не более 25 шт.).

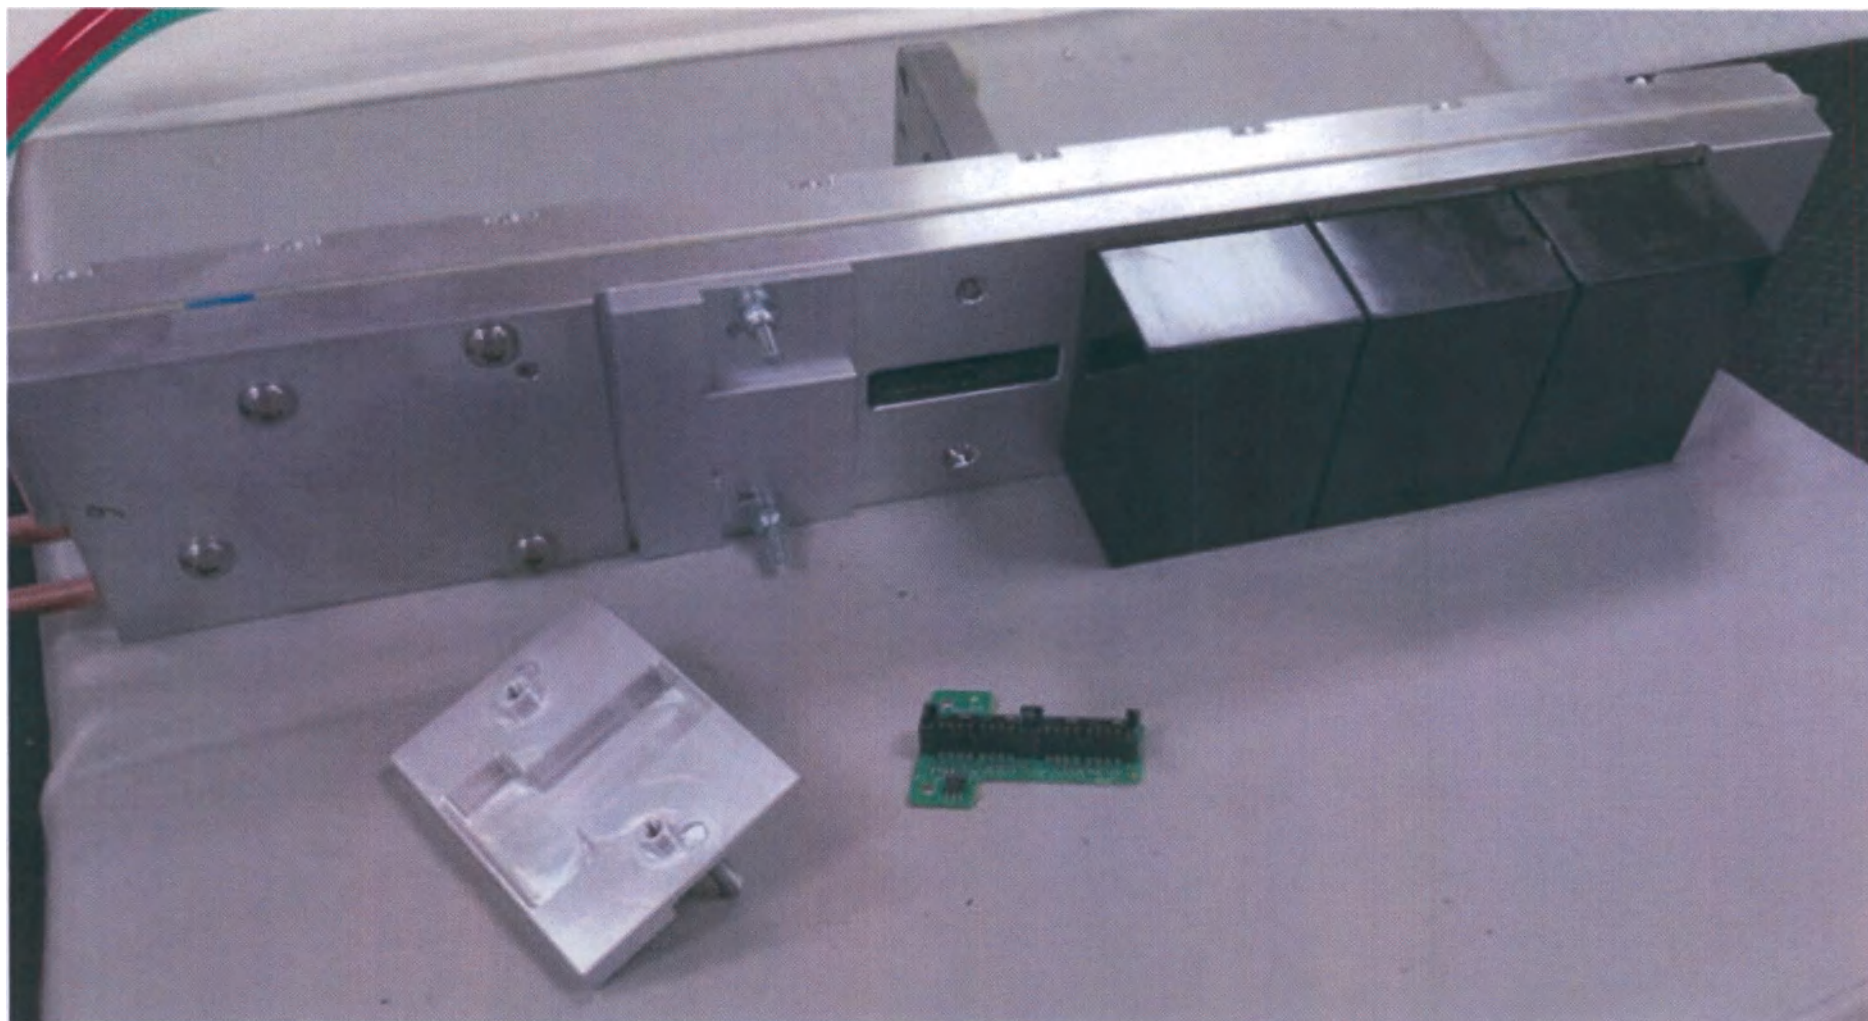


52. Кабели соединительные (не более 10 шт.).



53. Кабели питания (не более 10 шт.).

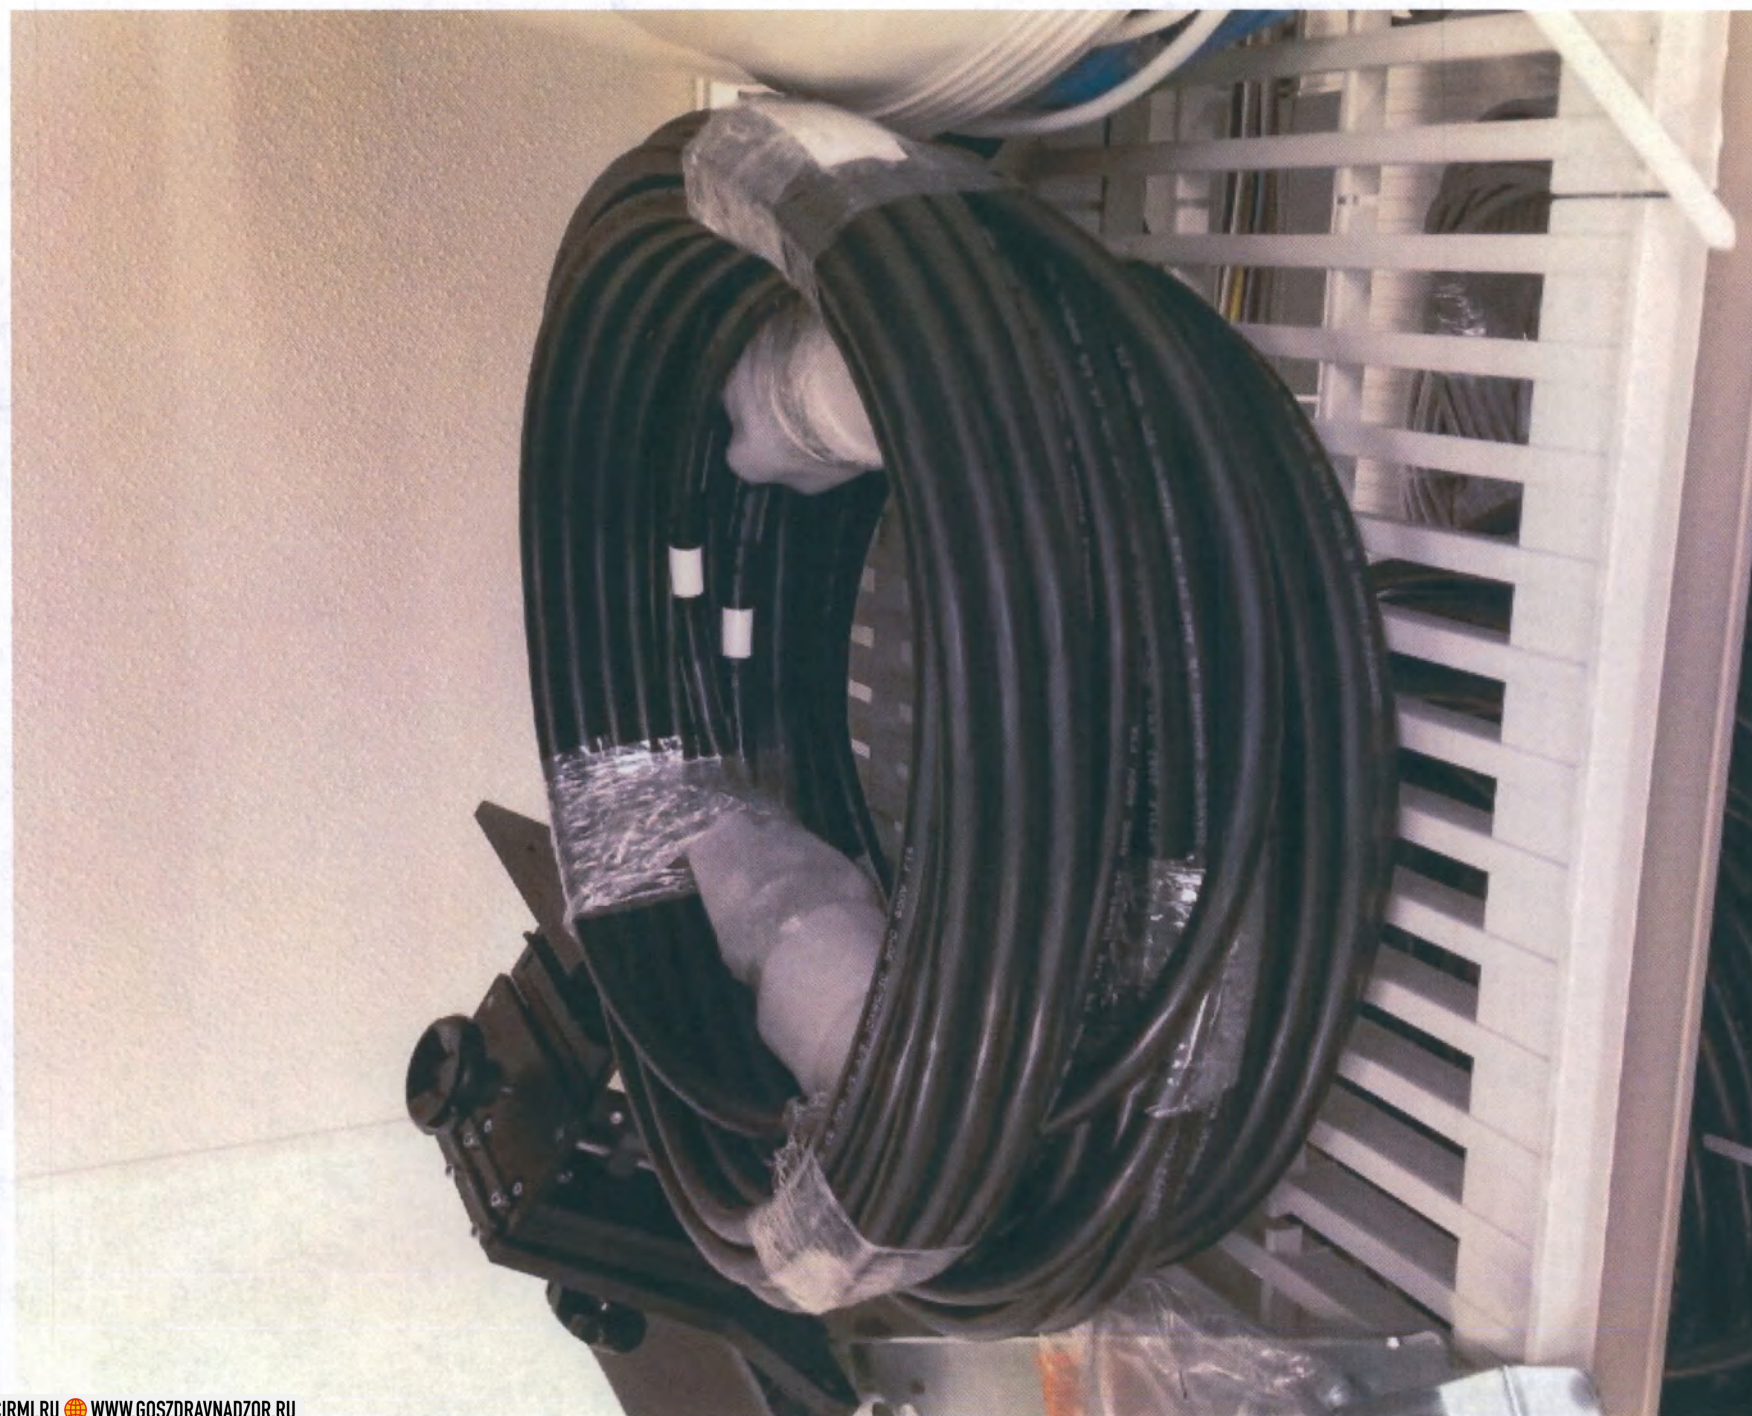


54. Чехлы для кабелей (не более 10 шт.).

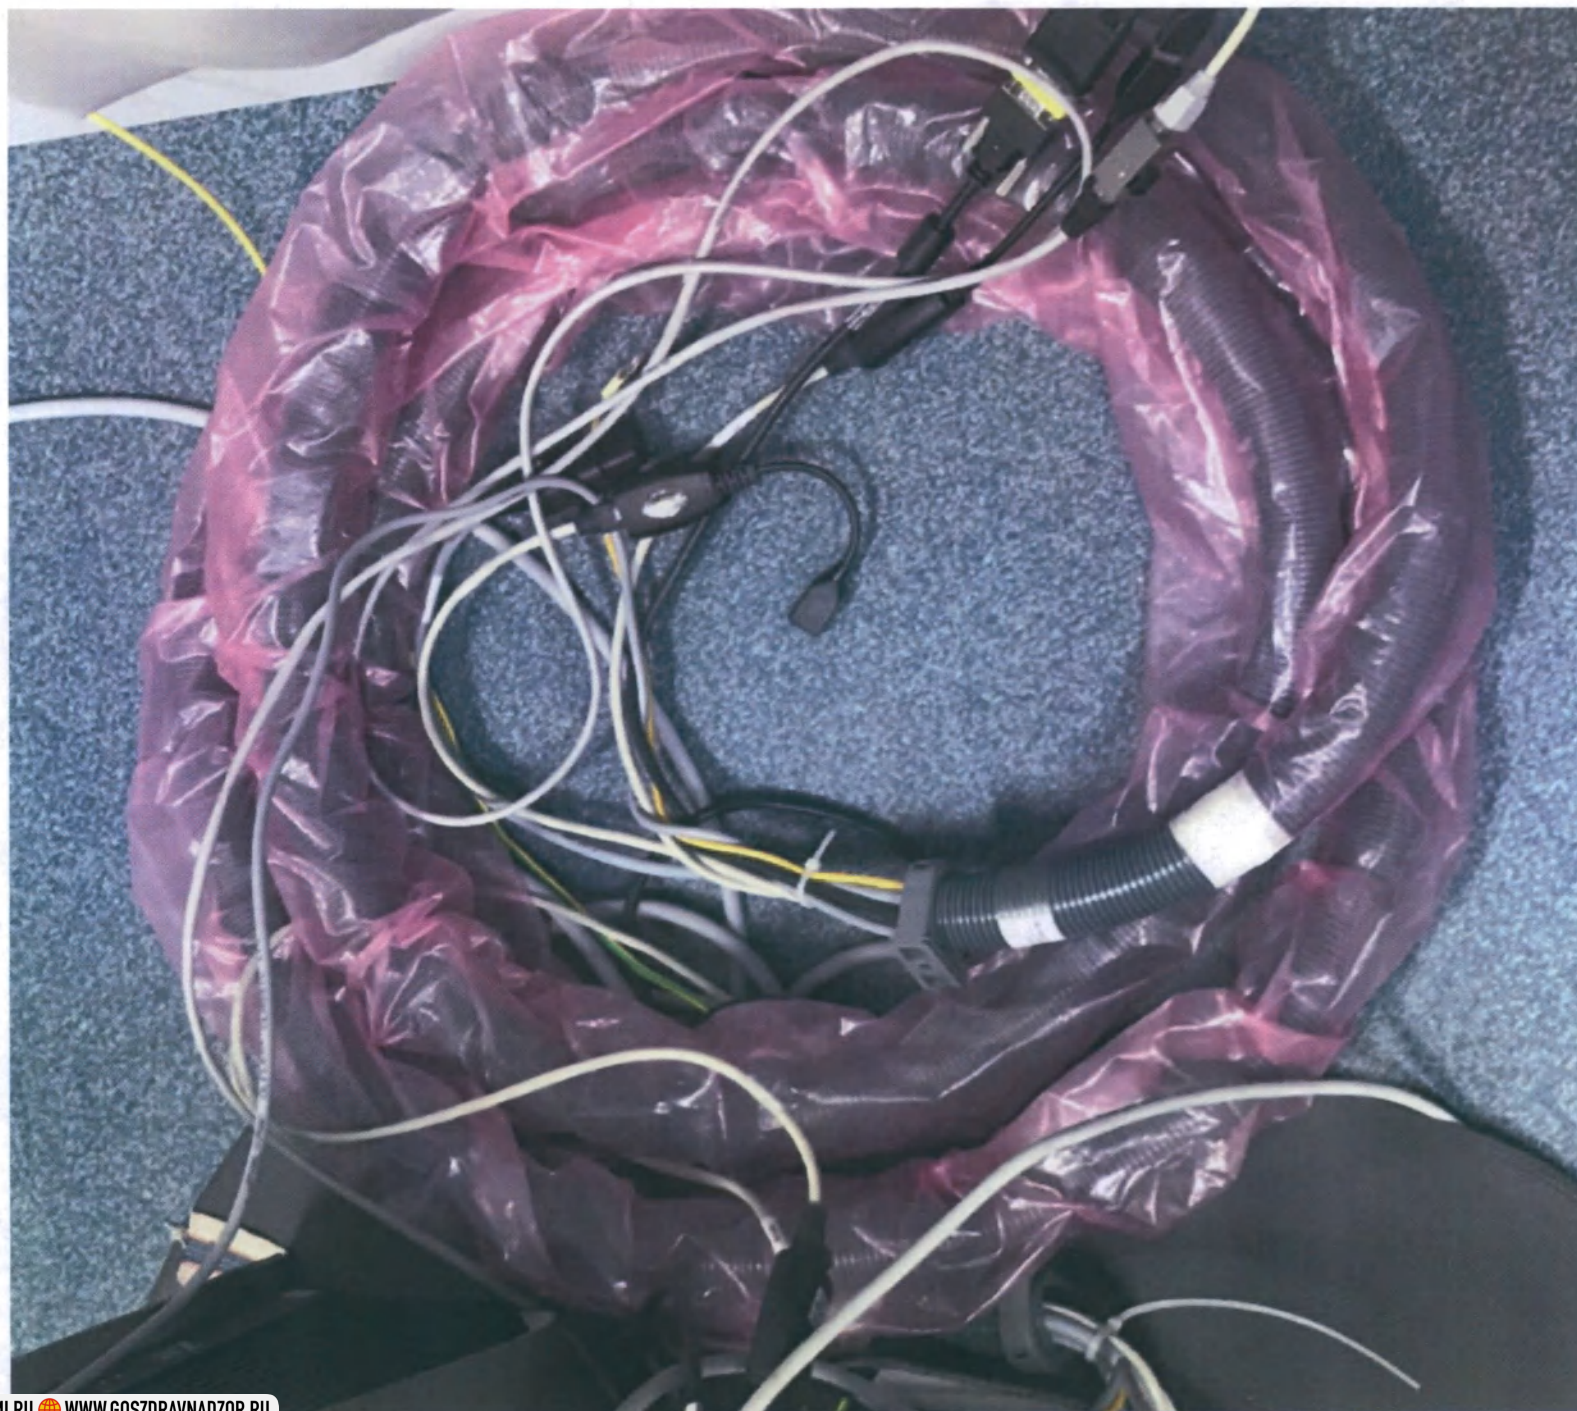


55. Наклейки декоративные (не более 20 шт.).



56. Шкафы для хранения принадлежностей (не более 4 шт.).

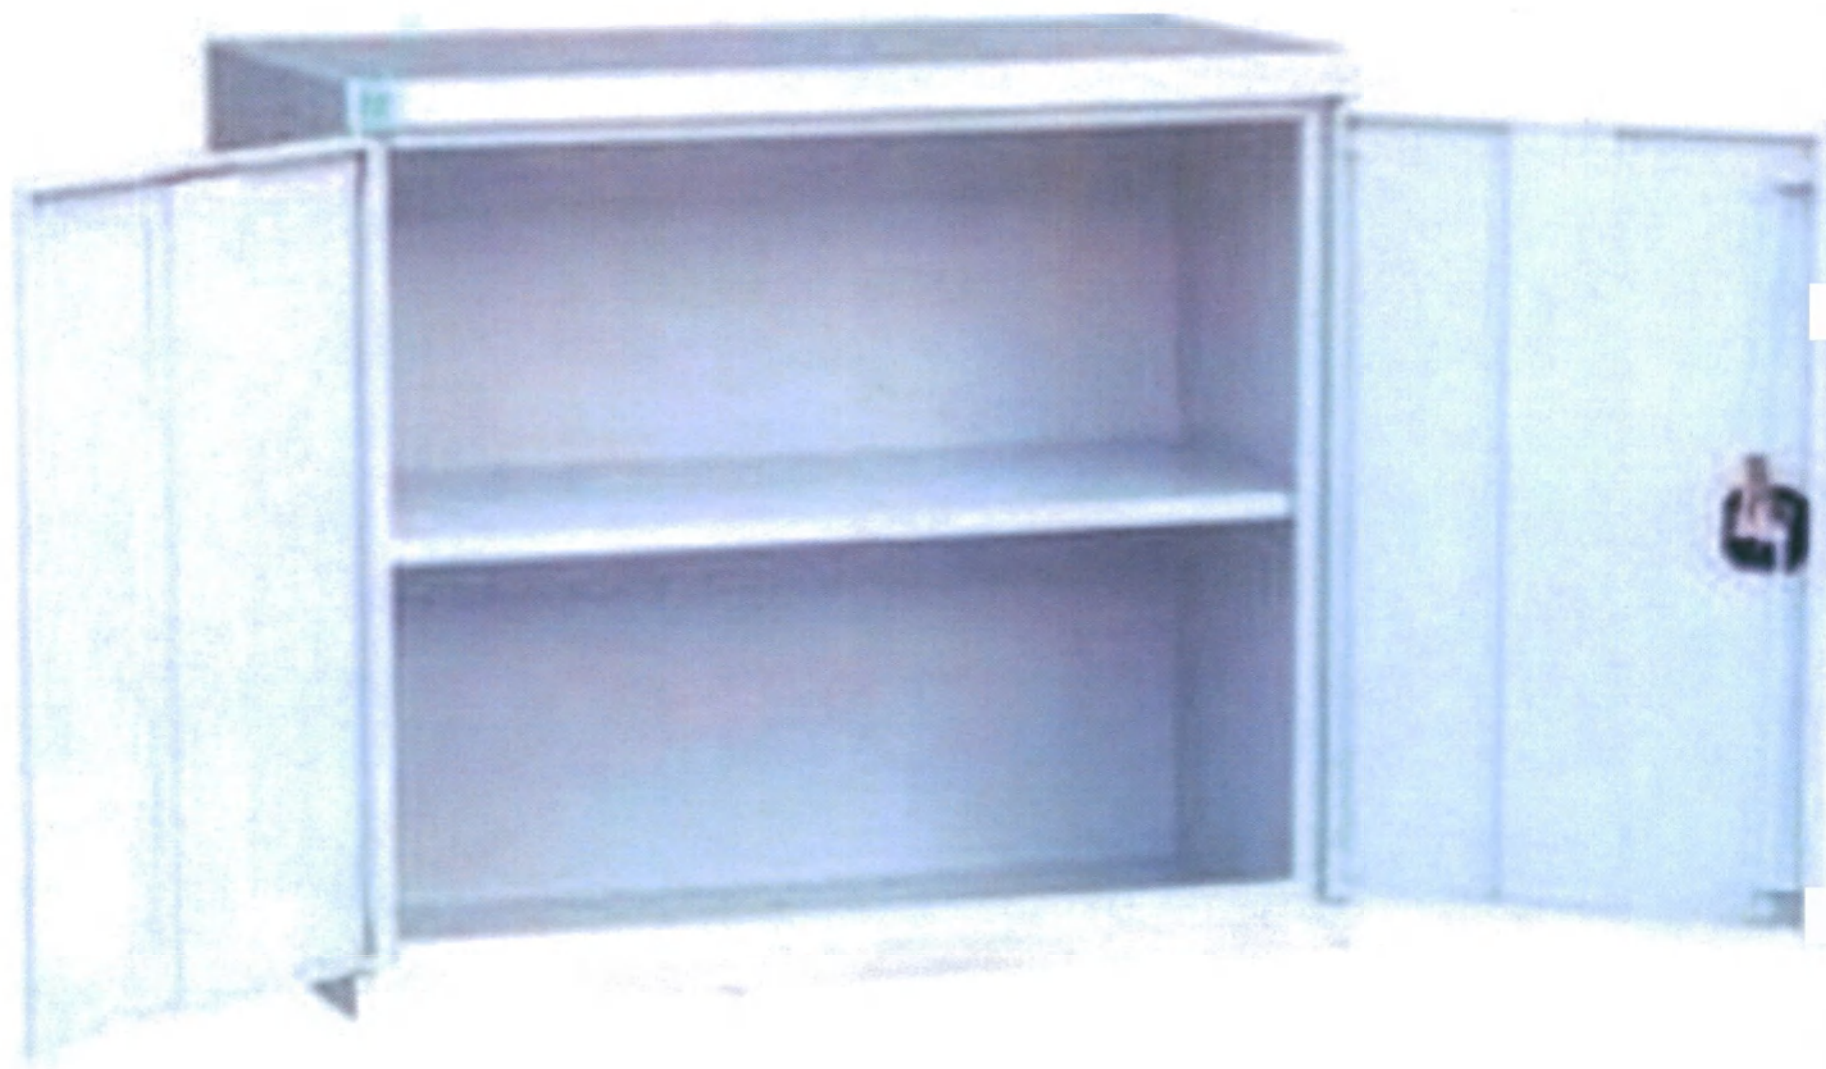


57. Устройства для синхронизации по дыханию (не более 10 шт.).

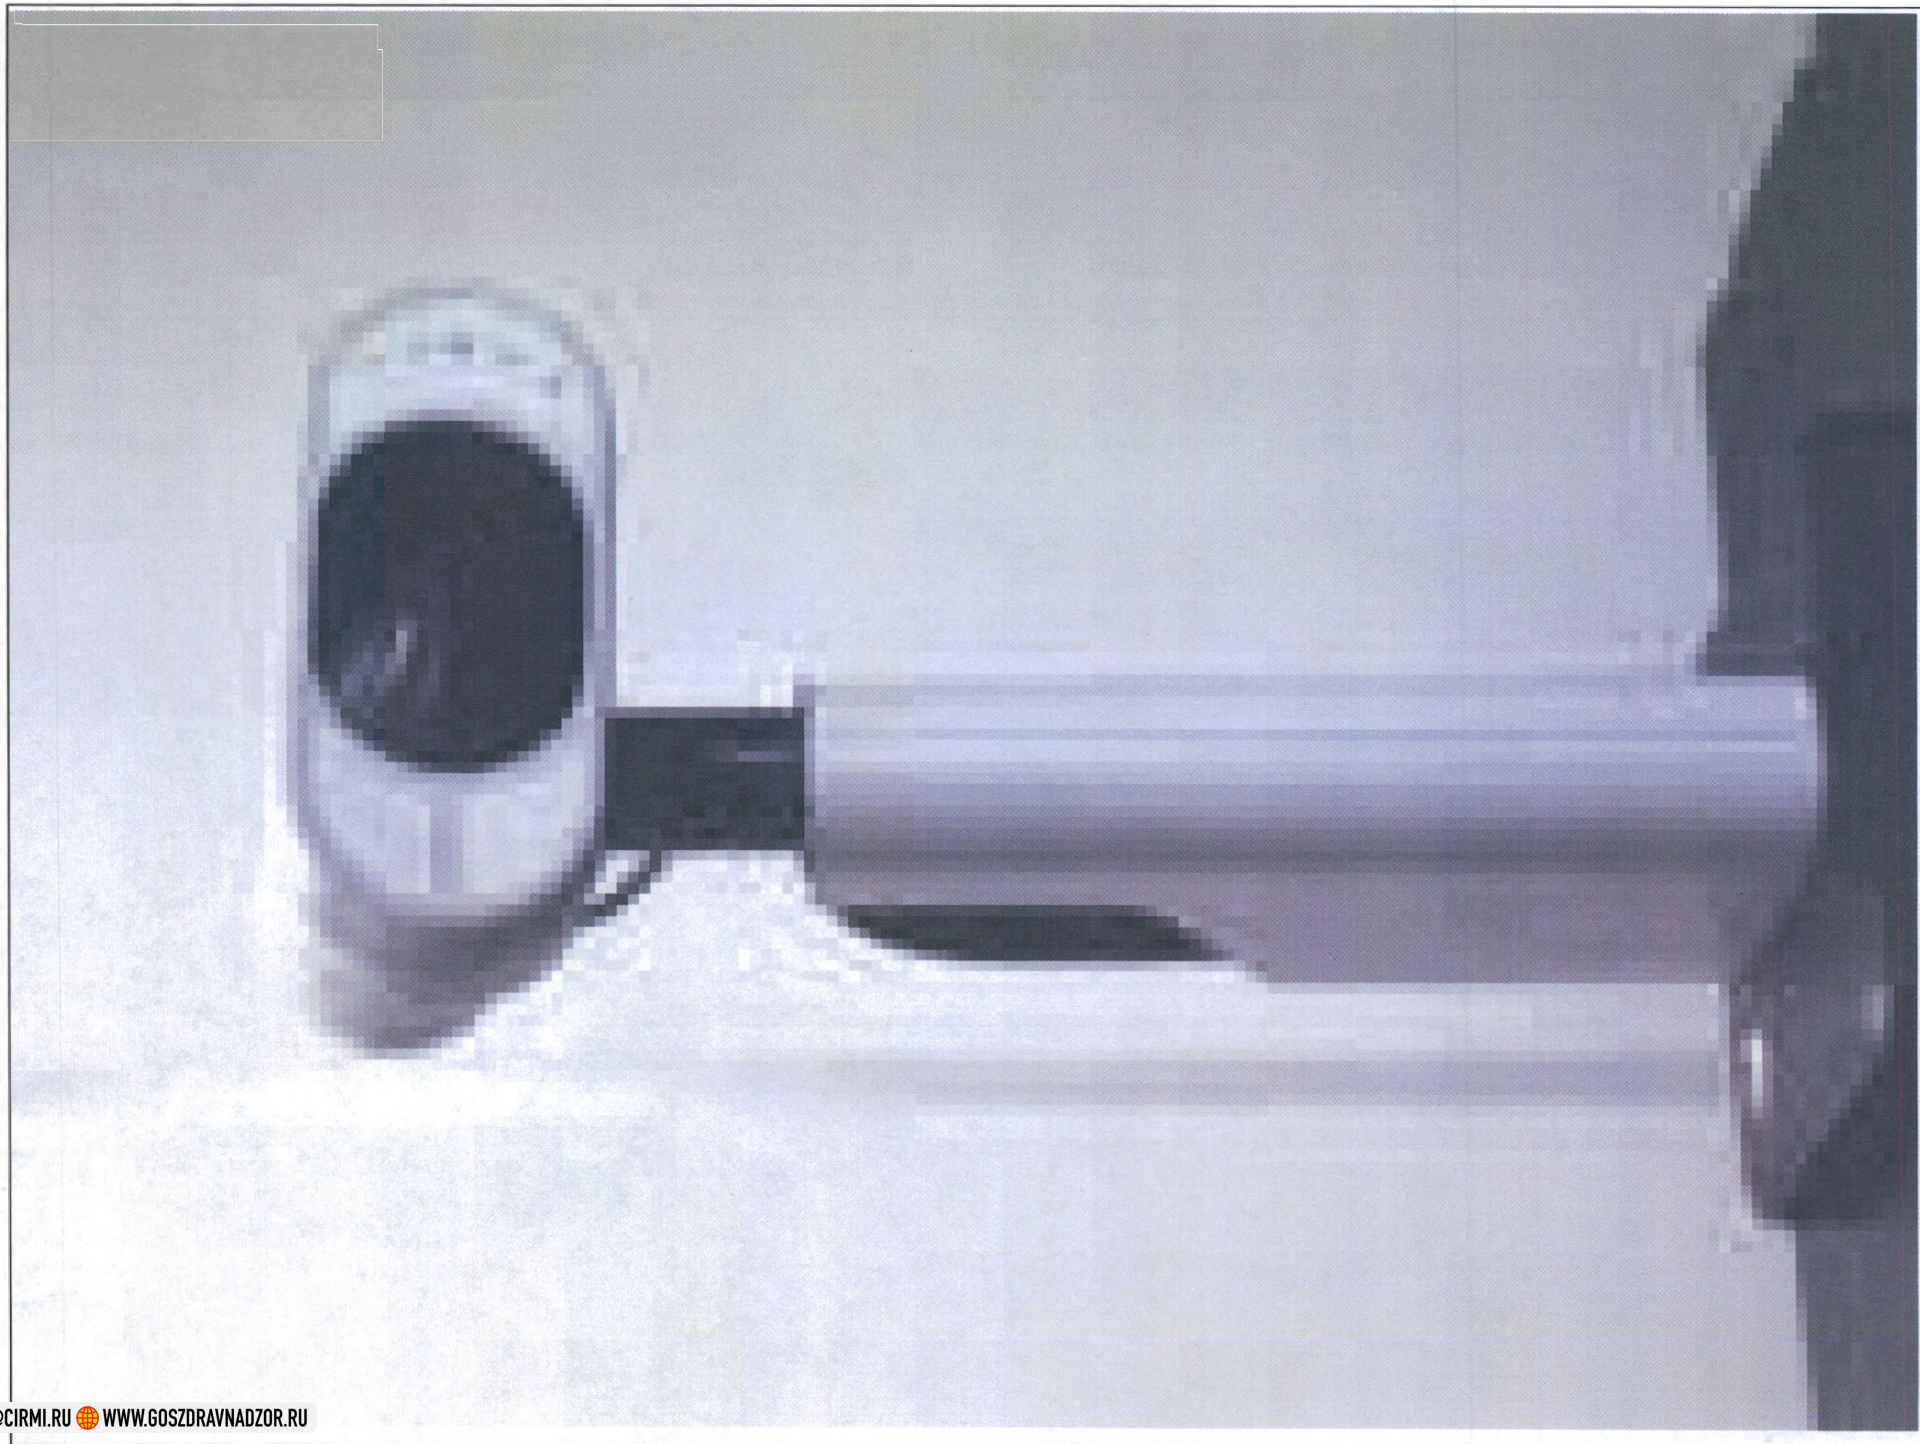

57. Устройства для синхронизации по дыханию (не более 10 шт.).



57. Устройства для синхронизации по дыханию (не более 10 шт.).

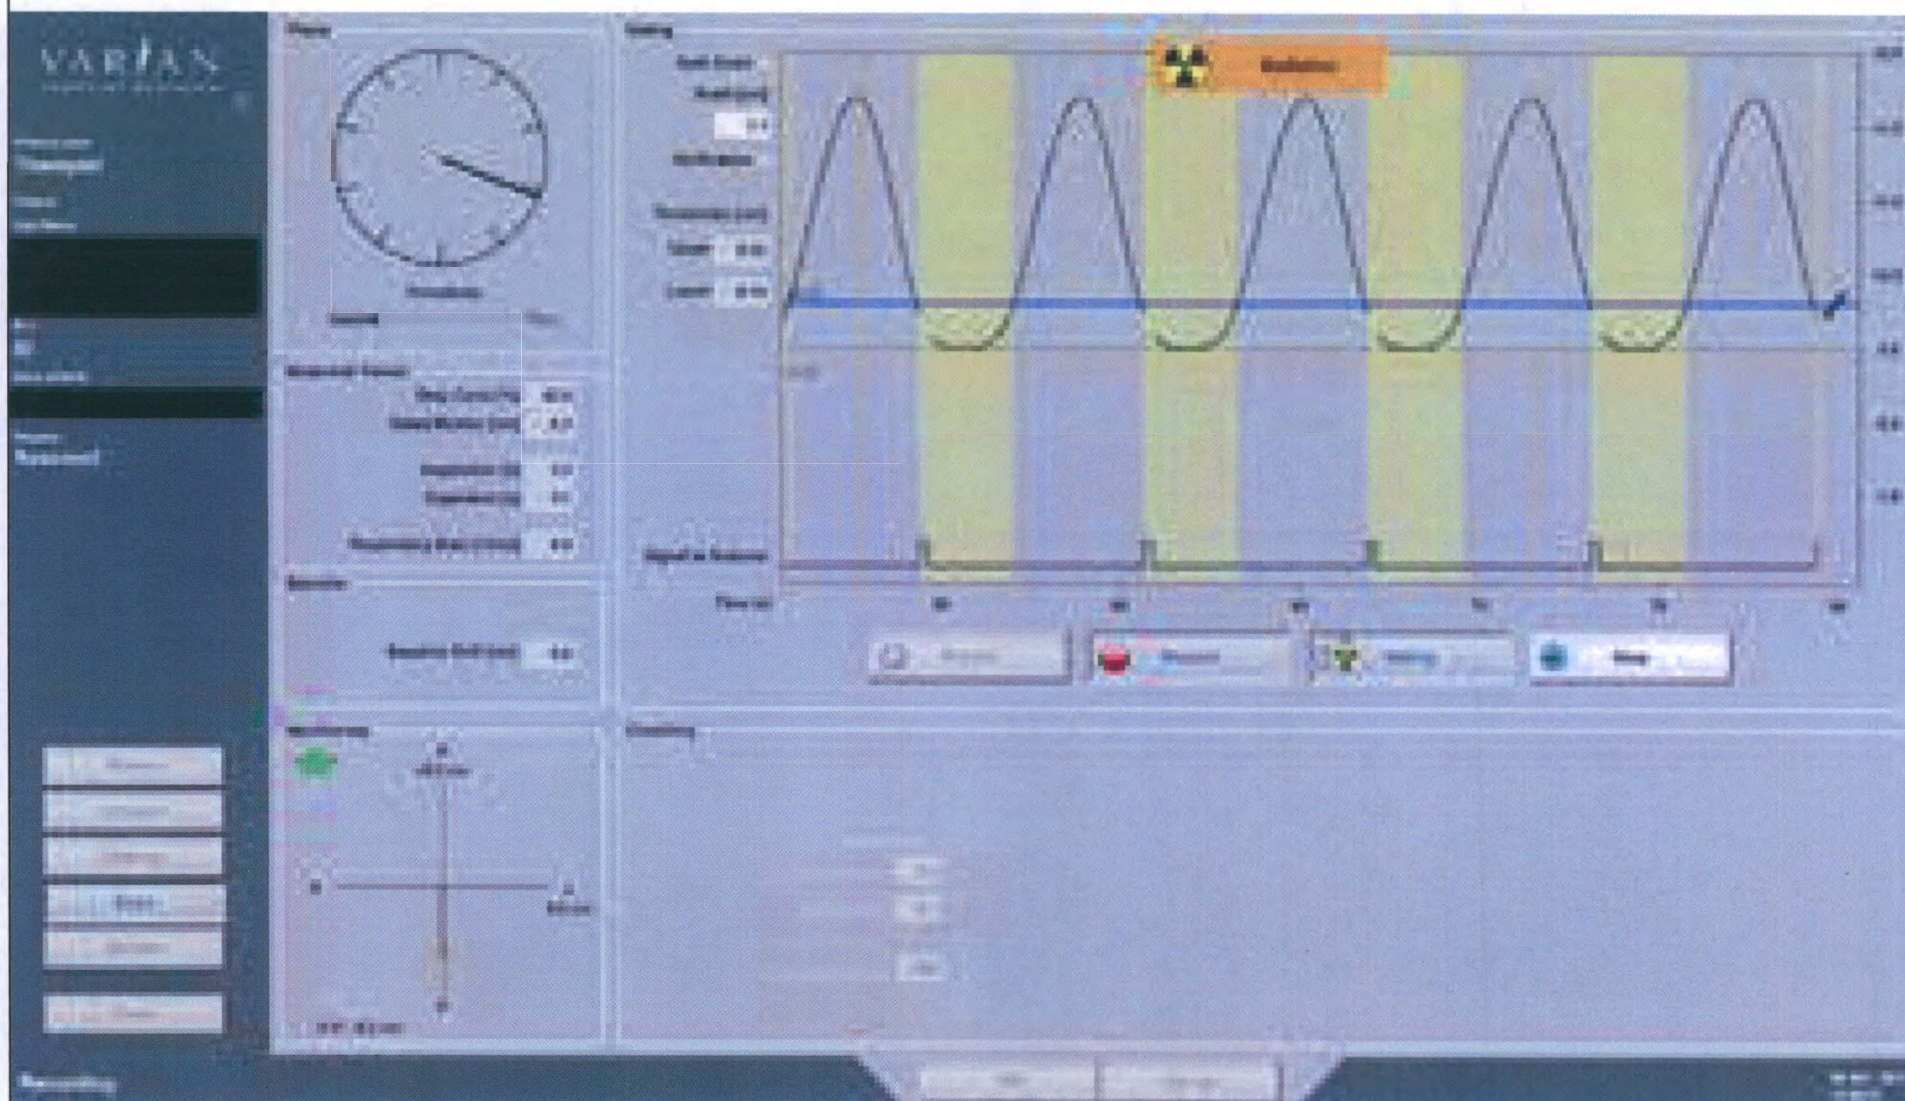

57. Устройства для синхронизации по дыханию (не более 10 шт.).

МАКЕТЫ МАРКИРОВКИ

Discovery MI Gen2

Маркировка: Discovery MI Gen2.



GE MEDICAL SYSTEMS, LCC

3000N, GRANDVIEW BLVD, WAUKESHA, WI, U.S.A.

Discovery MI Gen2



GE MEDICAL SYSTEMS, LLC

3000 N, GRANDVIEW BLVD, WAUKESHA, WI, U.S.A.

Model:

Discovery MI Gen2

VOLTS: 380/400/420/440/460/480V, 3~

FREQUENCY: 50/60Hz

MAX. POWER INPUT:

MOMENTARY: 100KVA@0.85PF

CONTINUOUS: 30KVA



**CLASS I
IPX0**



GEHealthcare.com

Маркировка: Discovery MI Gen2: с шириной ПЭТ детектора: 15 см.




GE Medical Systems, LLC
3000 N. Grandview Blvd.,
Waukesha, WI 53188, USA

Комплекс комбинированный для получения медицинских изображений методом ПЭТ/КТ Discovery MI Gen2, вариант исполнения: с шириной ПЭТ детектора: 15 см.



XXXXXXXX



XXXXXXXX



XX-XX-XXXX



Класс 1
IPX0

Номинальное напряжение: 3 ~, 380 / 400 / 420 / 440 / 460 / 480 V

Частота: 50 / 60 Hz

Кратковременная / длительная мощность: 100 kVA / 30 kVA

Маркировка: Discovery MI Gen2: с шириной ПЭТ детектора: 20 см.



GE Medical Systems, LLC
3000 N. Grandview Blvd.,
Waukesha, WI 53188, USA

Комплекс комбинированный для получения медицинских изображений методом ПЭТ/КТ Discovery MI Gen2,
вариант исполнения: с шириной ПЭТ детектора: 20 см.



XXXXXXX



XXXXXXX



XX-XX-XXXX



Класс 1
IPX0

Номинальное напряжение: 3 ~, 380 / 400 / 420 / 440 / 460 / 480 V

Частота: 50 / 60 Hz

Кратковременная / длительная мощность: 100 kVA / 30 kVA

Маркировка: Discovery MI Gen2: с шириной ПЭТ детектора: 25 см.



GE Medical Systems, LLC

3000 N. Grandview Blvd.,

Waukesha, WI 53188, USA

Комплекс комбинированный для получения медицинских изображений методом ПЭТ/КТ Discovery MI Gen2, вариант исполнения: с шириной ПЭТ детектора: 25 см.

REF

XXXXXXXX

SN

XXXXXXXX



XX-XX-XXXX



**Класс 1
IPX0**

Номинальное напряжение: 3 ~, 380 / 400 / 420 / 440 / 460 / 480 V

Частота: 50 / 60 Hz

Кратковременная / длительная мощность: 100 kVA / 30 kVA

Всего прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 101 (сто один) листа(ов)

Руководитель отдела регистрации
и сертификации России и СНГ

ООО «ДжиИ Хэлскеа»

 А.И. Харитонов Харитонов А.И.