

ФОТО

Манипулятор стереотаксический роботизированный с периферийными устройствами МСР
«Орбита» по ТУ ДНІЯ.941619.033ТУ
Производства: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОНЦЕРН "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ "ЭЛЕКТРОПРИБОР"

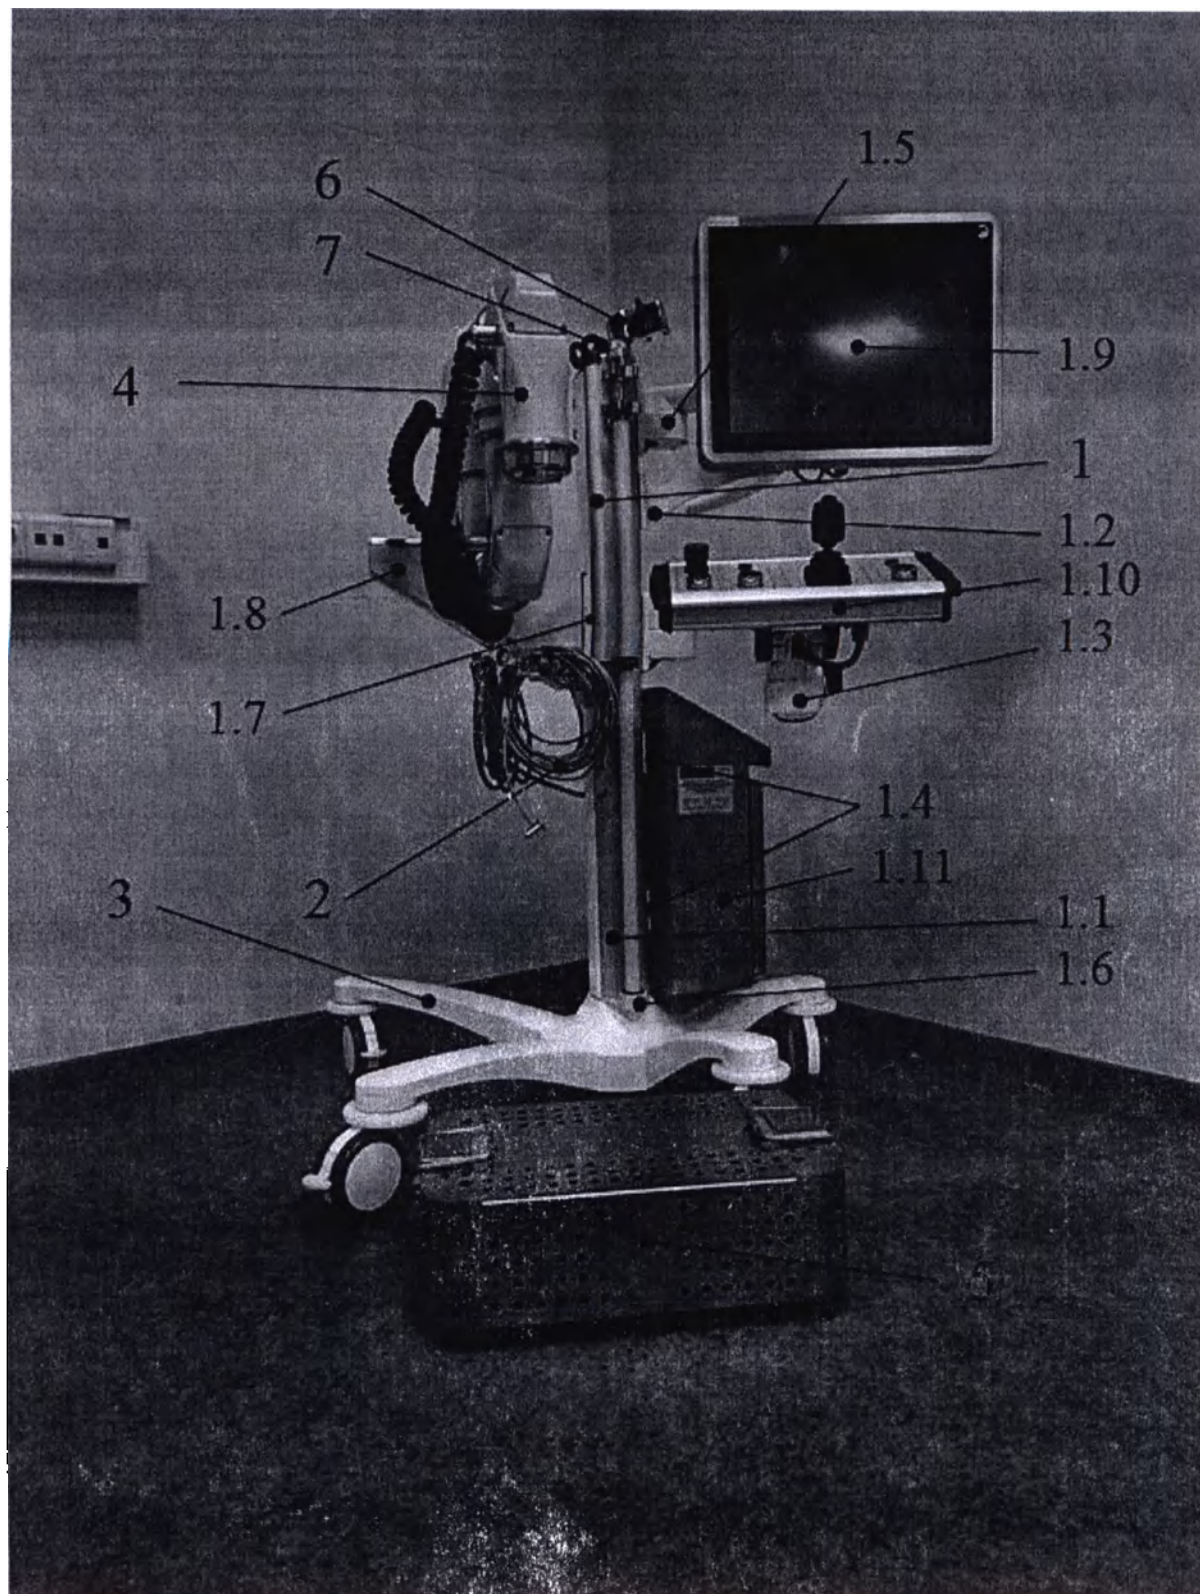


Рисунок 1 - Манипулятор стереотаксический роботизированный с периферийными устройствами МСР «ОРБИТА» с принадлежностями, условные обозначения пояснены в таблице 1

Таблица 1. Условные обозначения комплектности поставки манипулятора стереотаксического роботизированного с периферийными устройствами МСР «ОРБИТА» ДНИЯ.941619.033 на рис. 1

Условное обозначение	Наименование и обозначение комплекта поставки
1	1 Стойка прибора без основания
1.1	Стойка ДНИЯ.746459.002 (1 шт.)
1.2	Ручка Z-HD-4.wl "CIM med GmbH" 63700000001639 (1 шт.)
1.3	Кронштейн A-73130G-4V.gr1_95 "CIM med GmbH" 63700000001636 (1 шт.)
1.4	Кронштейн K-AH-4Z.1 "CIM med GmbH" 63700000001635 (2 шт.);
1.5	Кронштейн A-230G-4V.gr1 "CIM med GmbH" 63700000001634 (1 шт.)
1.6	Упор ДНИЯ.741474.092 (1 шт.)
1.7	Кронштейн ДНИЯ.301569.072 (1 шт.)
1.8	Кронштейн ДНИЯ.301569.070 (1 шт.)
1.9	Компьютер FRONT Station 532.505 00-06127706 ТУ 4013-001-50042096-2005 401360000000008 (1 шт.)
1.10	Пульт управления ДНИЯ.301176.089 (1 шт.)
1.11	Шкаф с ЭРИ ДНИЯ.301176.090 (1 шт.)
2	2 Кабель ДНИЯ.685639.371 (1 шт.)
3	3 Основание стойки прибора (1 шт.)
4	4 Манипулятор ДНИЯ.941619.031 (1 шт.)
5	5 Стерилизуемые компоненты прибора
6	6 Распорка ДНИЯ.301712.032 (1 шт.)
7	7 Распорка ДНИЯ.301712.032-01 (1 шт.)

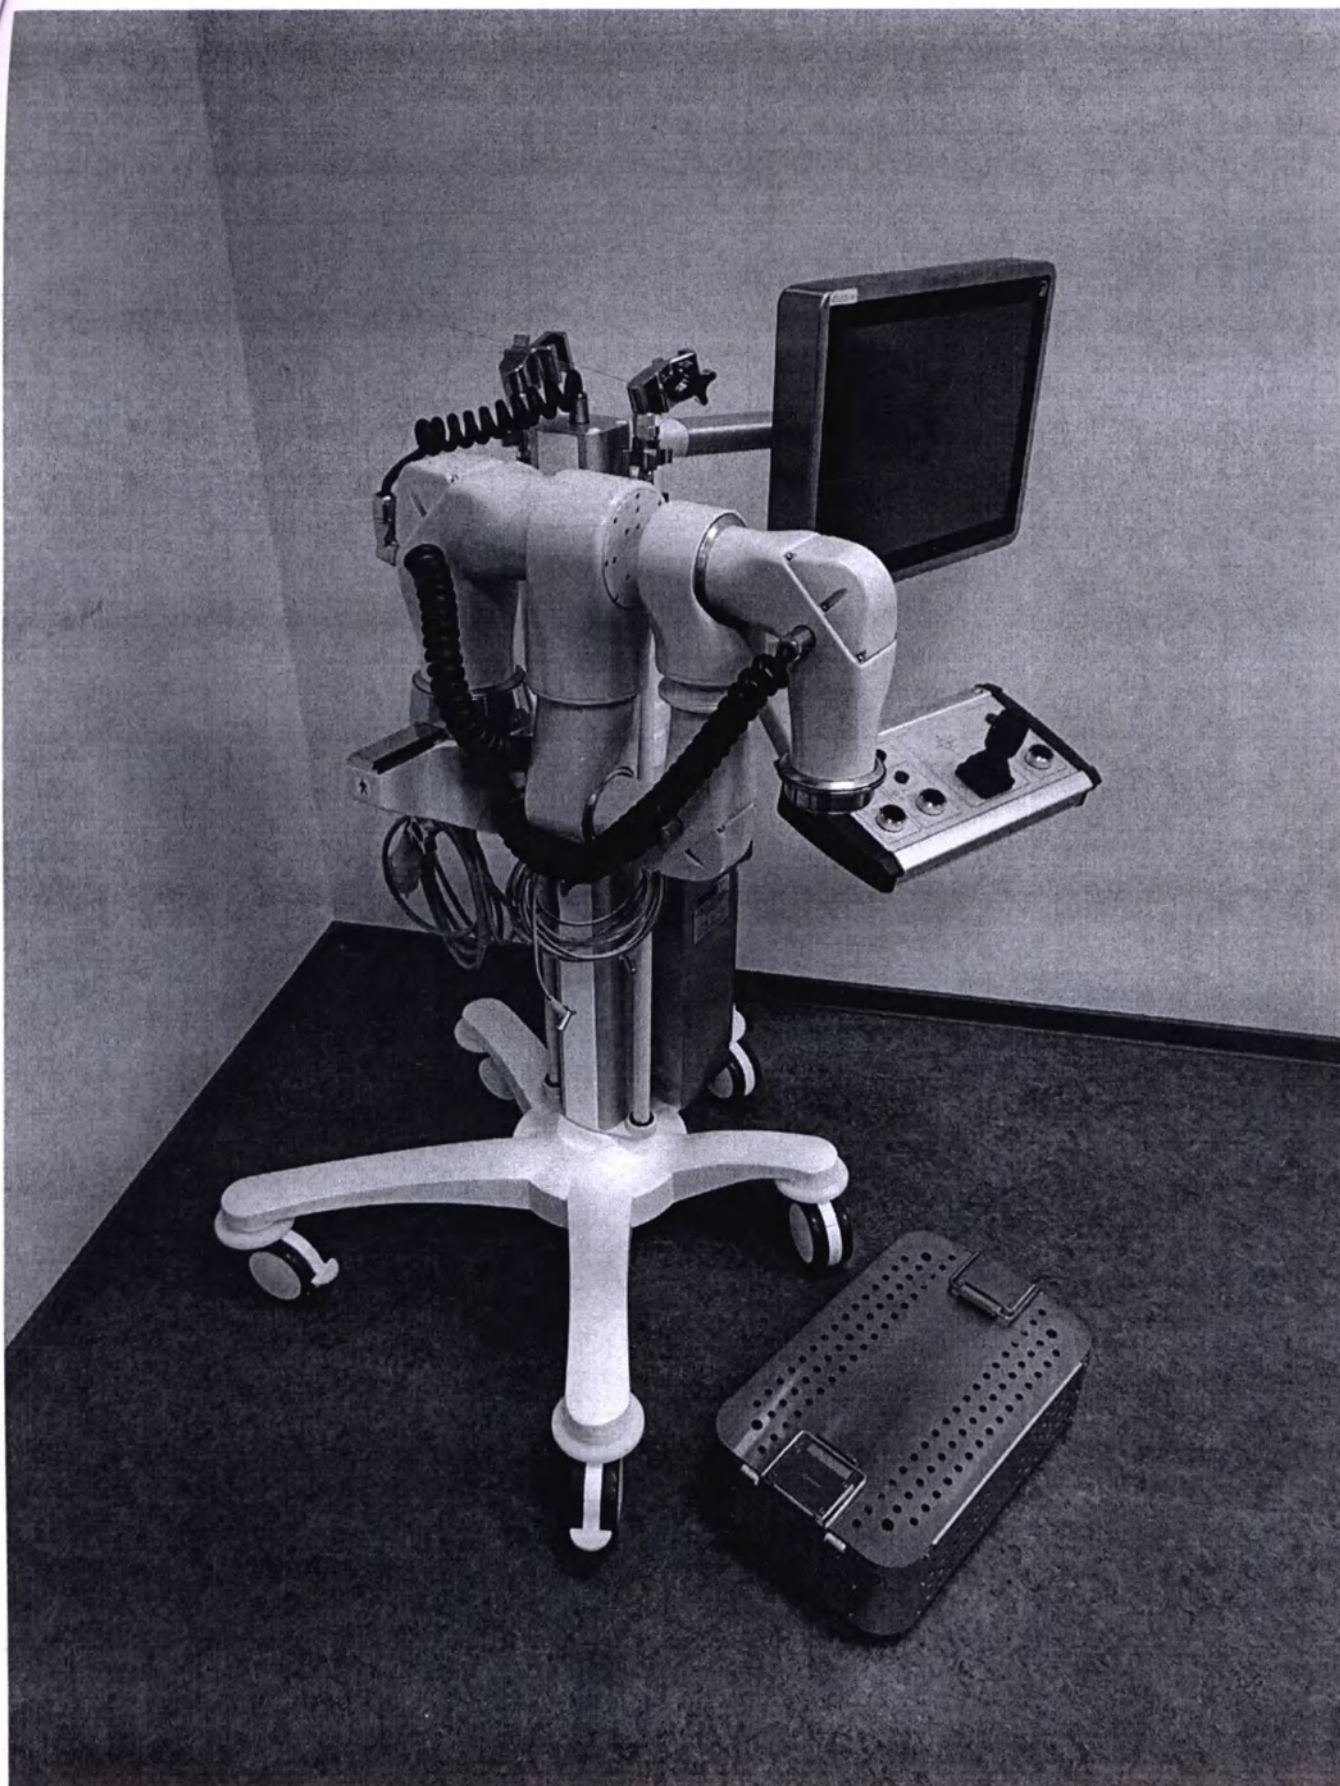


Рисунок 2 - Манипулятор стереотаксический роботизированный с периферийными устройствами МСР «ОРБИТА» с принадлежностями

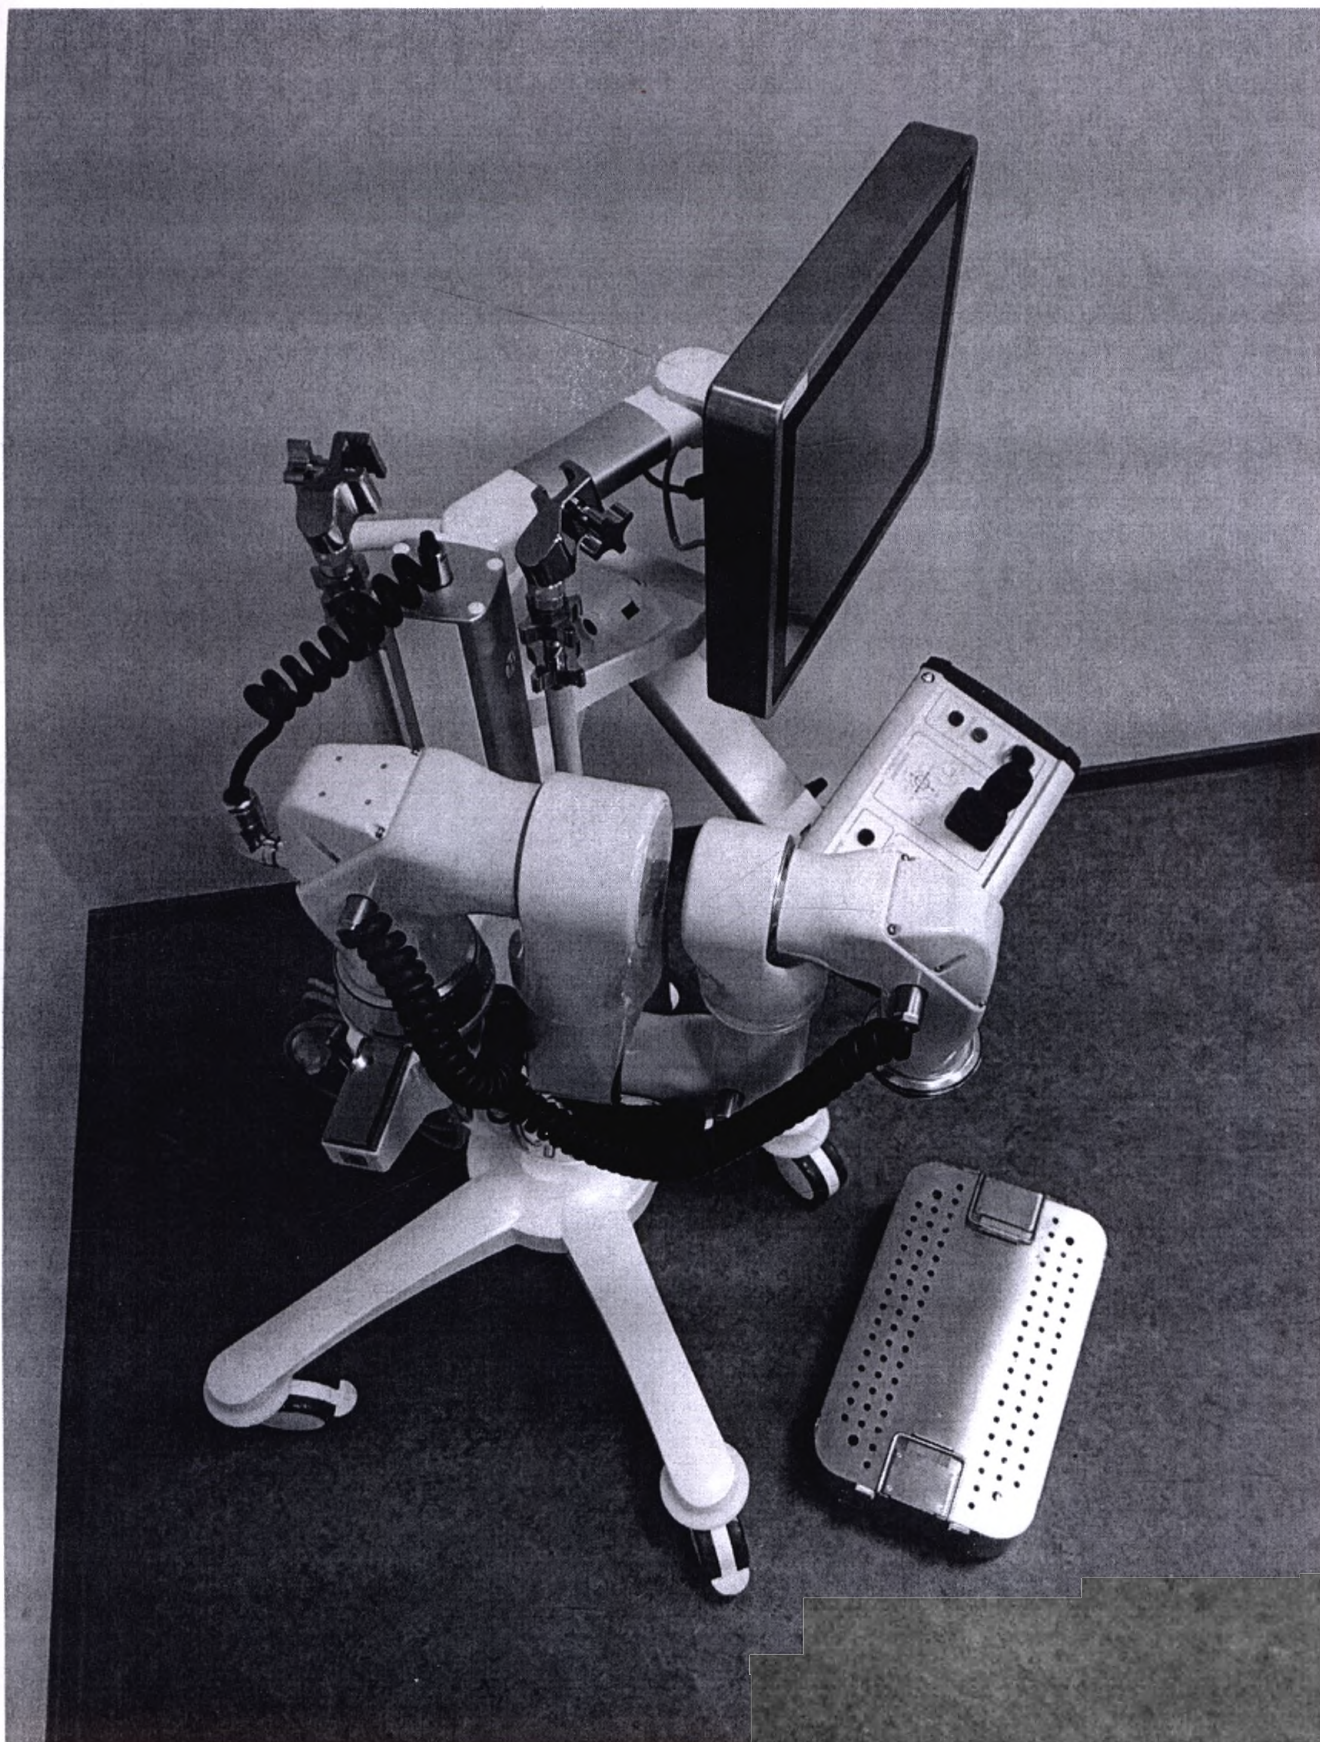


Рисунок 3 - Манипулятор стереотаксический роботизированный с периферийными устройствами МСР «ОРБИТА» с принадлежностями

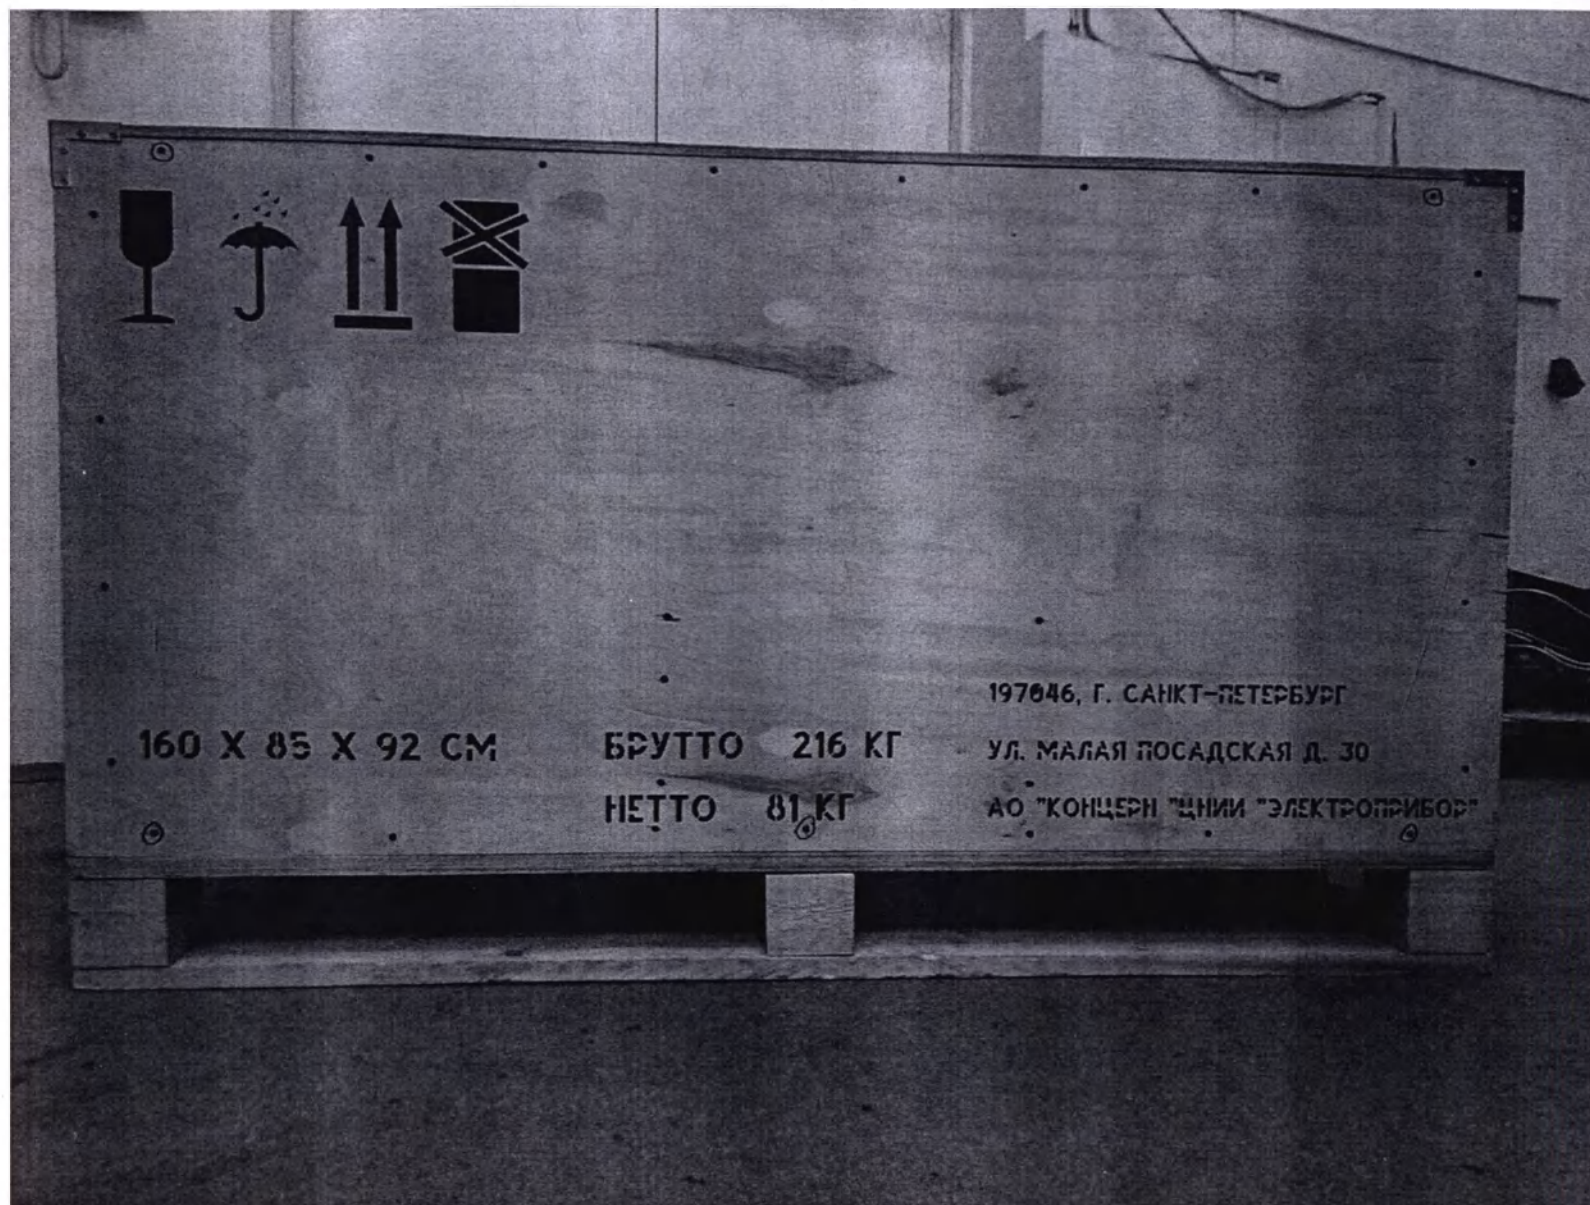


Рисунок 4 - Манипулятор стереотаксический роботизированный с периферийными устройствами МСР «ОРБИТА» в транспортной упаковке



Рисунок 5 - Манипулятор стереотаксический роботизированный с периферийными устройствами МСР «ОРБИТА» в транспортной упаковке



Рисунок 6 - Манипулятор стереотаксический роботизированный с периферийными устройствами МСР «ОРБИТА» в транспортной упаковке

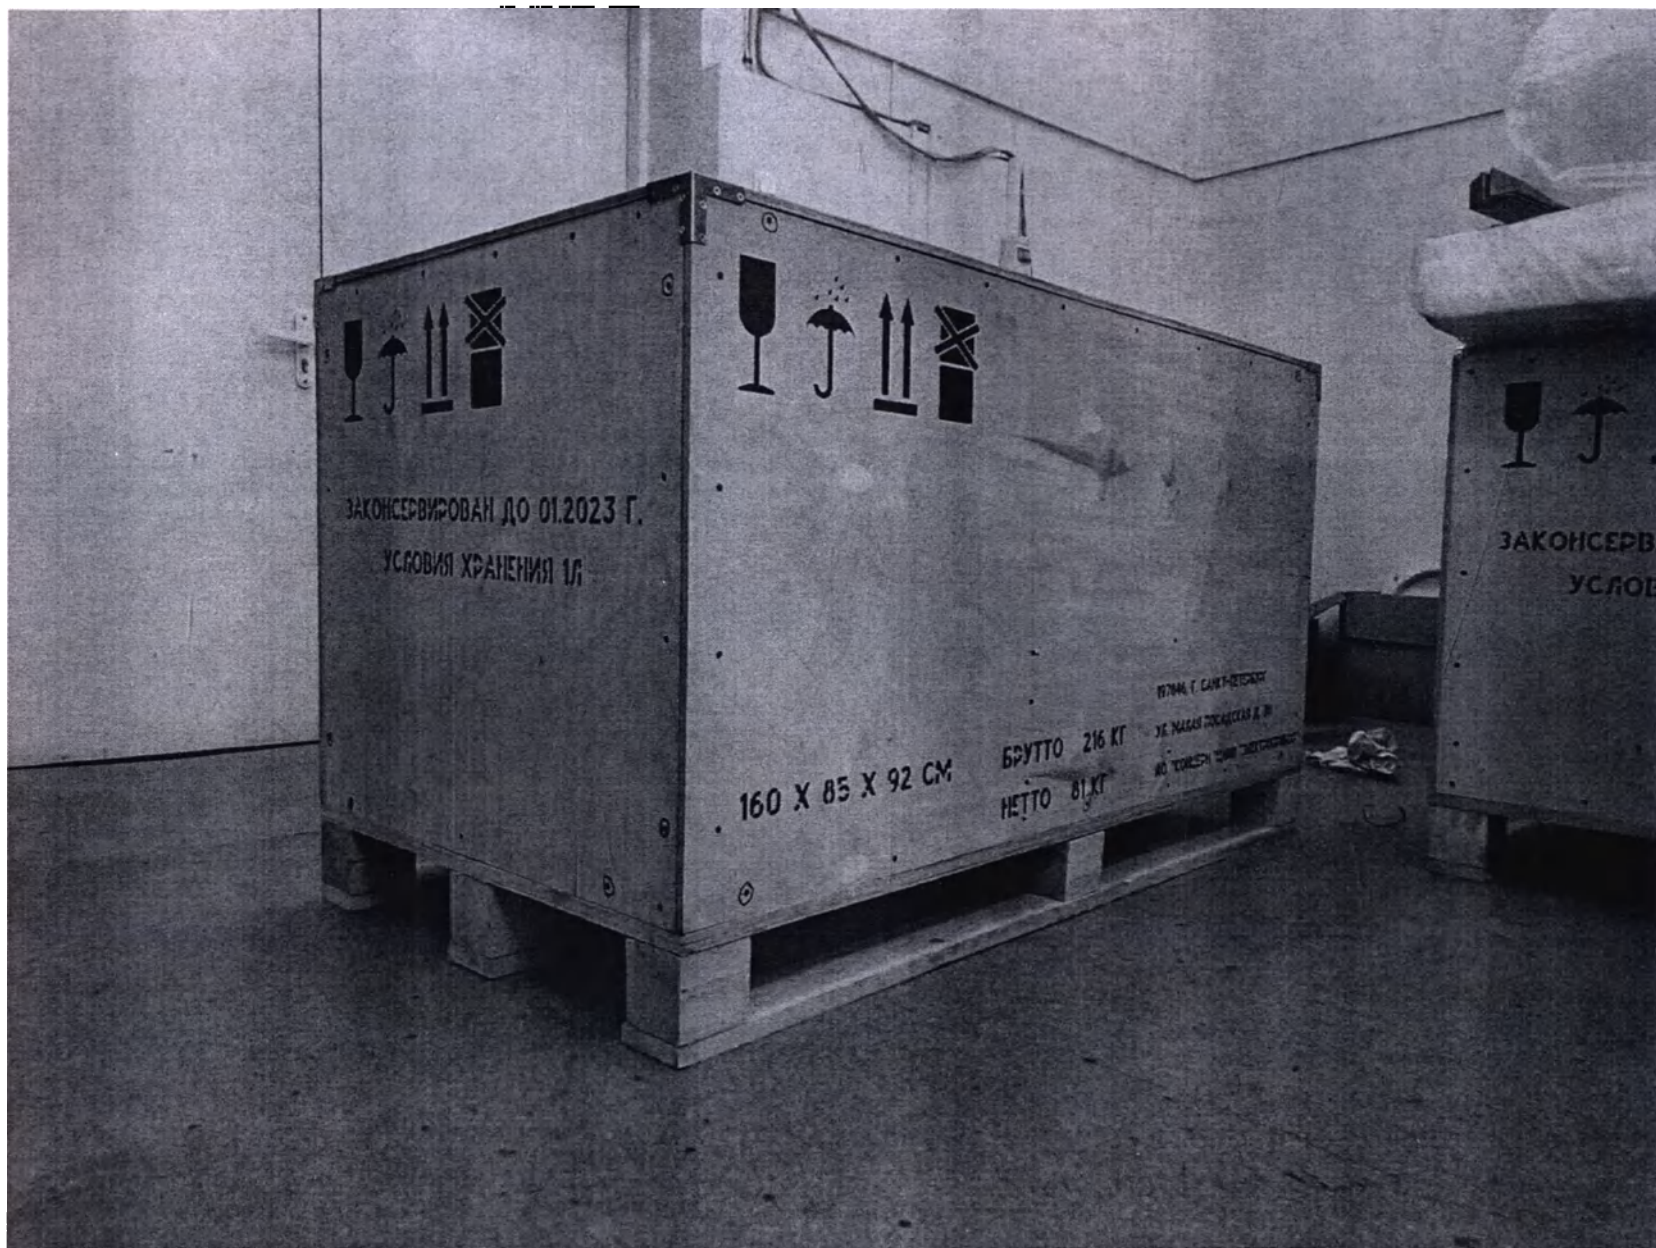


Рисунок 7 - Манипулятор стереотаксический роботизированный с периферийными устройствами МСР «ОРБИТА» в транспортной упаковке

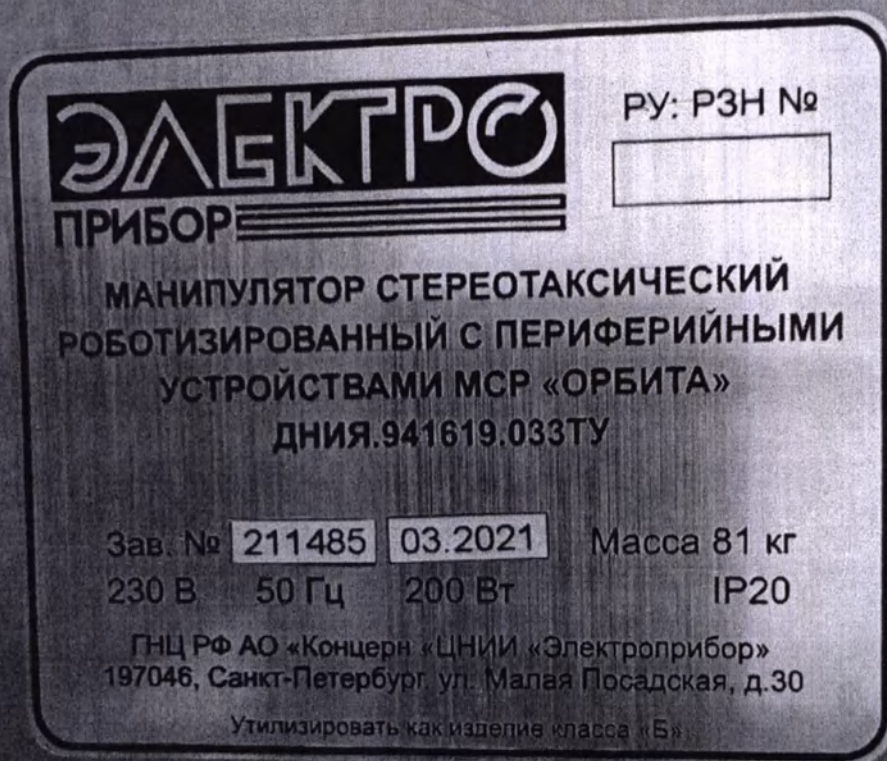


Рисунок 8 - Маркировка манипулятора стереотаксического роботизированного с периферийными устройствами МСР «ОРБИТА»

Генеральный директор



Соколов А.В

М.П.



Всего прошито и скреплено

печатью 9 листов

Генеральный директор

Соколов А.В.

