

Фотографические изображения
медицинского изделия

Эндоскопы гибкие с принадлежностями

УТВЕРЖДАЮ




Генеральный директор

ООО «Олимпас Москва »

Ондрей Типольт


I. Колоноскопы: Колонофиброскопы CF-40I, CF-40L, PCF-20, CF-P20S, CF-1T20L, стандартная комплектация:

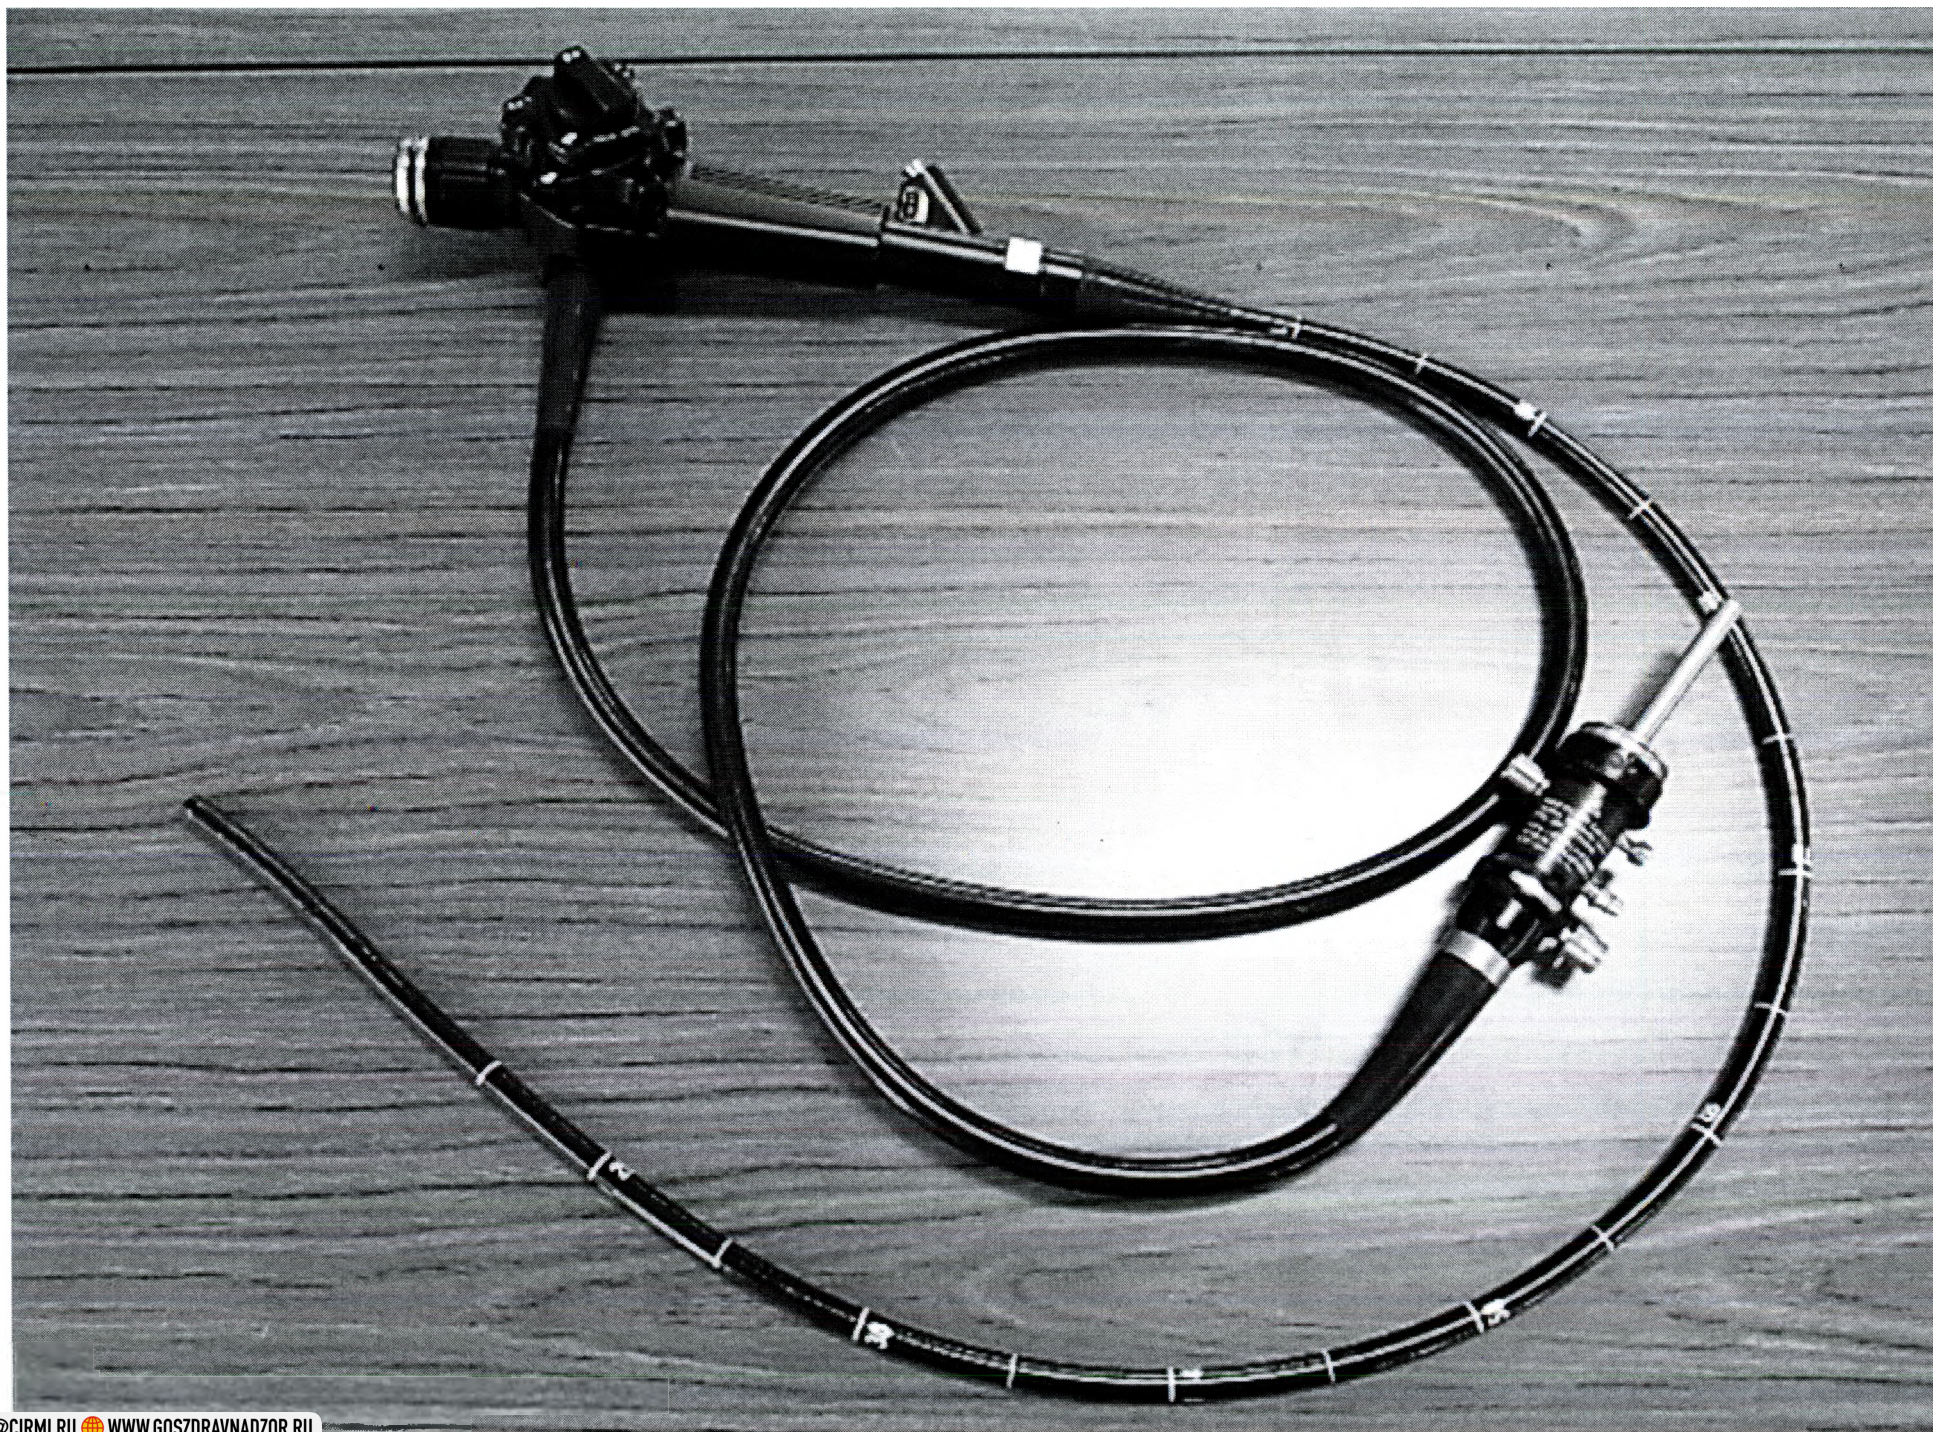

I. Колоноскопы: Колонофиброскопы CF-40I, CF-40L, PCF-20, CF-P20S, CF-1T20L макет маркировки:

Артикул	CF-40I
Наименование	Эндоскопы гибкие с принадлежностями Колоноскопы: Колонофиброскопы
Производитель	«Олимпас Медикал Системс Корп.»
Адрес производителя	43-2, Хатагая 2-Чоум, Шибуйя-ку, Токио,
Страна происхождения	Япония
Регистрационное удостоверение	Эндоскопы гибкие с принадлежностями РУ № РЗН 2015/3464 от 30 мая 2017 года
Уполномоченный представитель	ООО «Олимпас Москва», 107023, г. Москва ,ул. Электро- заводская, д.27, стр.8, т. 8-495-926-7077
	зав. № 2765851
	Номер партии см. на упаковке (опционально)
	дата производства – 2017 г.,
	Место производства, см. на упаковке
	Срок годности см. на упаковке (опционально)
	Технические характеристики продукта и его количество см. на упаковке
Дополнительная информация, опционально, см. на упаковке.	
	Не использовать повторно
	Метод стерилизации
	Не стерилизовать повторно
	Не использовать при поврежденной упаковке
	Соблюдение интервала температур
	Беречь от влаги
	максимальная ширина рабочей части
	минимальная ширина инструментального канала
	рабочая длина
	поле зрения и /или направление наблюдения
 	Ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации

I. Колоноскопы: Колоновидеоскопы - CF-H185L, CF-H185I, PCF-H190DL, PCF-H190DI ; стандартная комплектация:

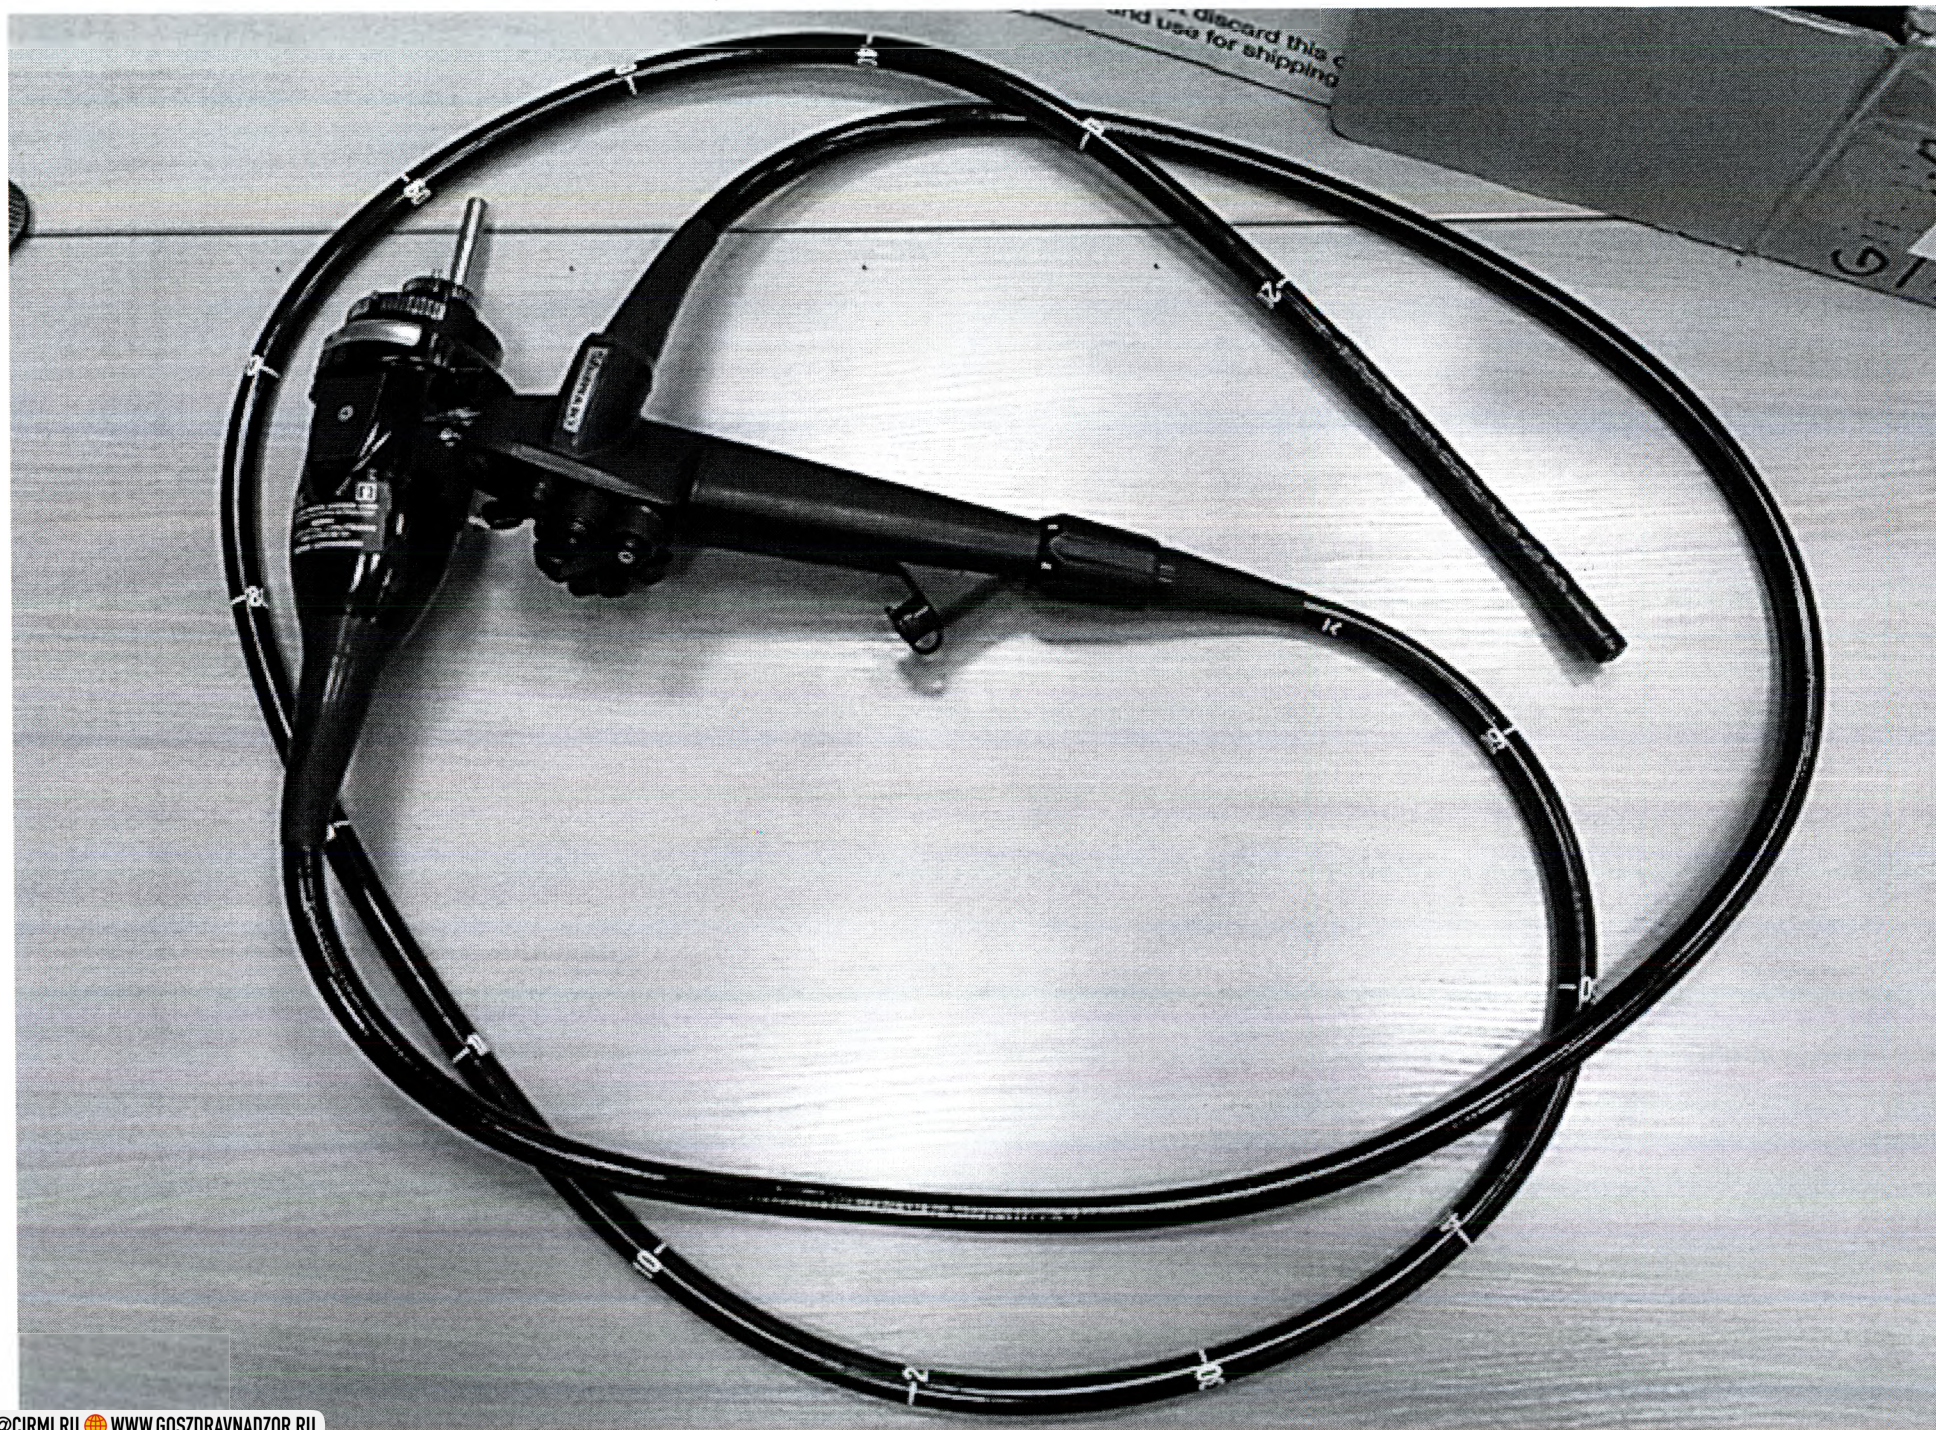

I. Колоноскопы: Колоновидеоскопы - CF-H185L, CF-H185I, PCF-H190DL, PCF-H190DI ; макет маркировки:


Артикул	CF-H185L
Наименование	Эндоскопы гибкие с принадлежностями Колоноскопы: Колоновидеоскопы
Производитель	“Олимпас Медикал Системс Корп.»
Адрес производителя	43-2, Хатагая 2-Чоум, Шибуйя-ку, Токио,
Страна происхождения	Япония
Регистрационное удостоверение	Эндоскопы гибкие с принадлежностями РУ № РЗН 2015/3464 от 30 мая 2017 года
Уполномоченный представитель	ООО «Олимпас Москва», 107023, г. Москва ,ул. Электро- заводская, д.27, стр.8, т. 8-495-926-7077
	зав. № 2765851
	Номер партии см. на упаковке (опционально)
	дата производства – 2017 г.,
	Место производства, см. на упаковке
	Срок годности см. на упаковке (опционально)
	Технические характеристики продукта и его количество см. на упаковке
Дополнительная информация, опционально, см. на упаковке.	
	Не использовать повторно
	Метод стерилизации
	Не стерилизовать повторно
	Не использовать при поврежденной упаковке
	Соблюдение интервала температур
	Беречь от влаги
	максимальная ширина рабочей части
	минимальная ширина инструментального канала
	рабочая длина
	поле зрения и /или направление наблюдения
Ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации	

●




1. Колоноскопы: Колоновидеоскопы CF-V /01,CF-V /0L,CF-Q150L,CF-Q150I,PCF-160AI,PCF-160AL,CF-Q160I,CF-Q160L,CF-Q160AI,CF-Q160AL,CF-Q160ZL,CF-Q160ZL,CF-Q160S,CF-2T160I,CF-2T160L,CF-Q165L,CF-Q165I,PCF-Q180AL,PCF-Q180AI,CF-Q180AL,CF-Q180AI,CF-H180AL,CF-H180AI,CF-H180DL,

Артикул	CF-Q165L
Наименование	Эндоскопы гибкие с принадлежностями Колоноскопы: Колоновидеоскопы
Производитель	«Олимпас Медикал Системс Корп.»
Адрес производителя	43-2, Хатагая 2-Чоум, Шибую-ку, Токио,
Страна происхождения	Япония
Регистрационное удостоверение	Эндоскопы гибкие с принадлежностями РУ № РЗН 2015/3464 от 30 мая 2017 года
Уполномоченный представитель	ООО «Олимпас Москва», 107023, г. Москва ,ул. Электровзаводская, д.27, стр.8, т. 8-495-926-7077
	зав. № 2765851
	Номер партии см. на упаковке (опционально)
	дата производства – 2017 г.,
	Место производства, см. на упаковке
	Срок годности см. на упаковке (опционально)
	Технические характеристики продукта и его количество см. на упаковке
Дополнительная информация, опционально, см. на упаковке.	
	Не использовать повторно
	Метод стерилизации
	Не стерилизовать повторно
	Не использовать при поврежденной упаковке
	Соблюдение интервала температур
	Беречь от влаги
	максимальная ширина рабочей части
	минимальная ширина инструментального канала
	рабочая длина
	поле зрения и /или направление наблюдения
	Ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации

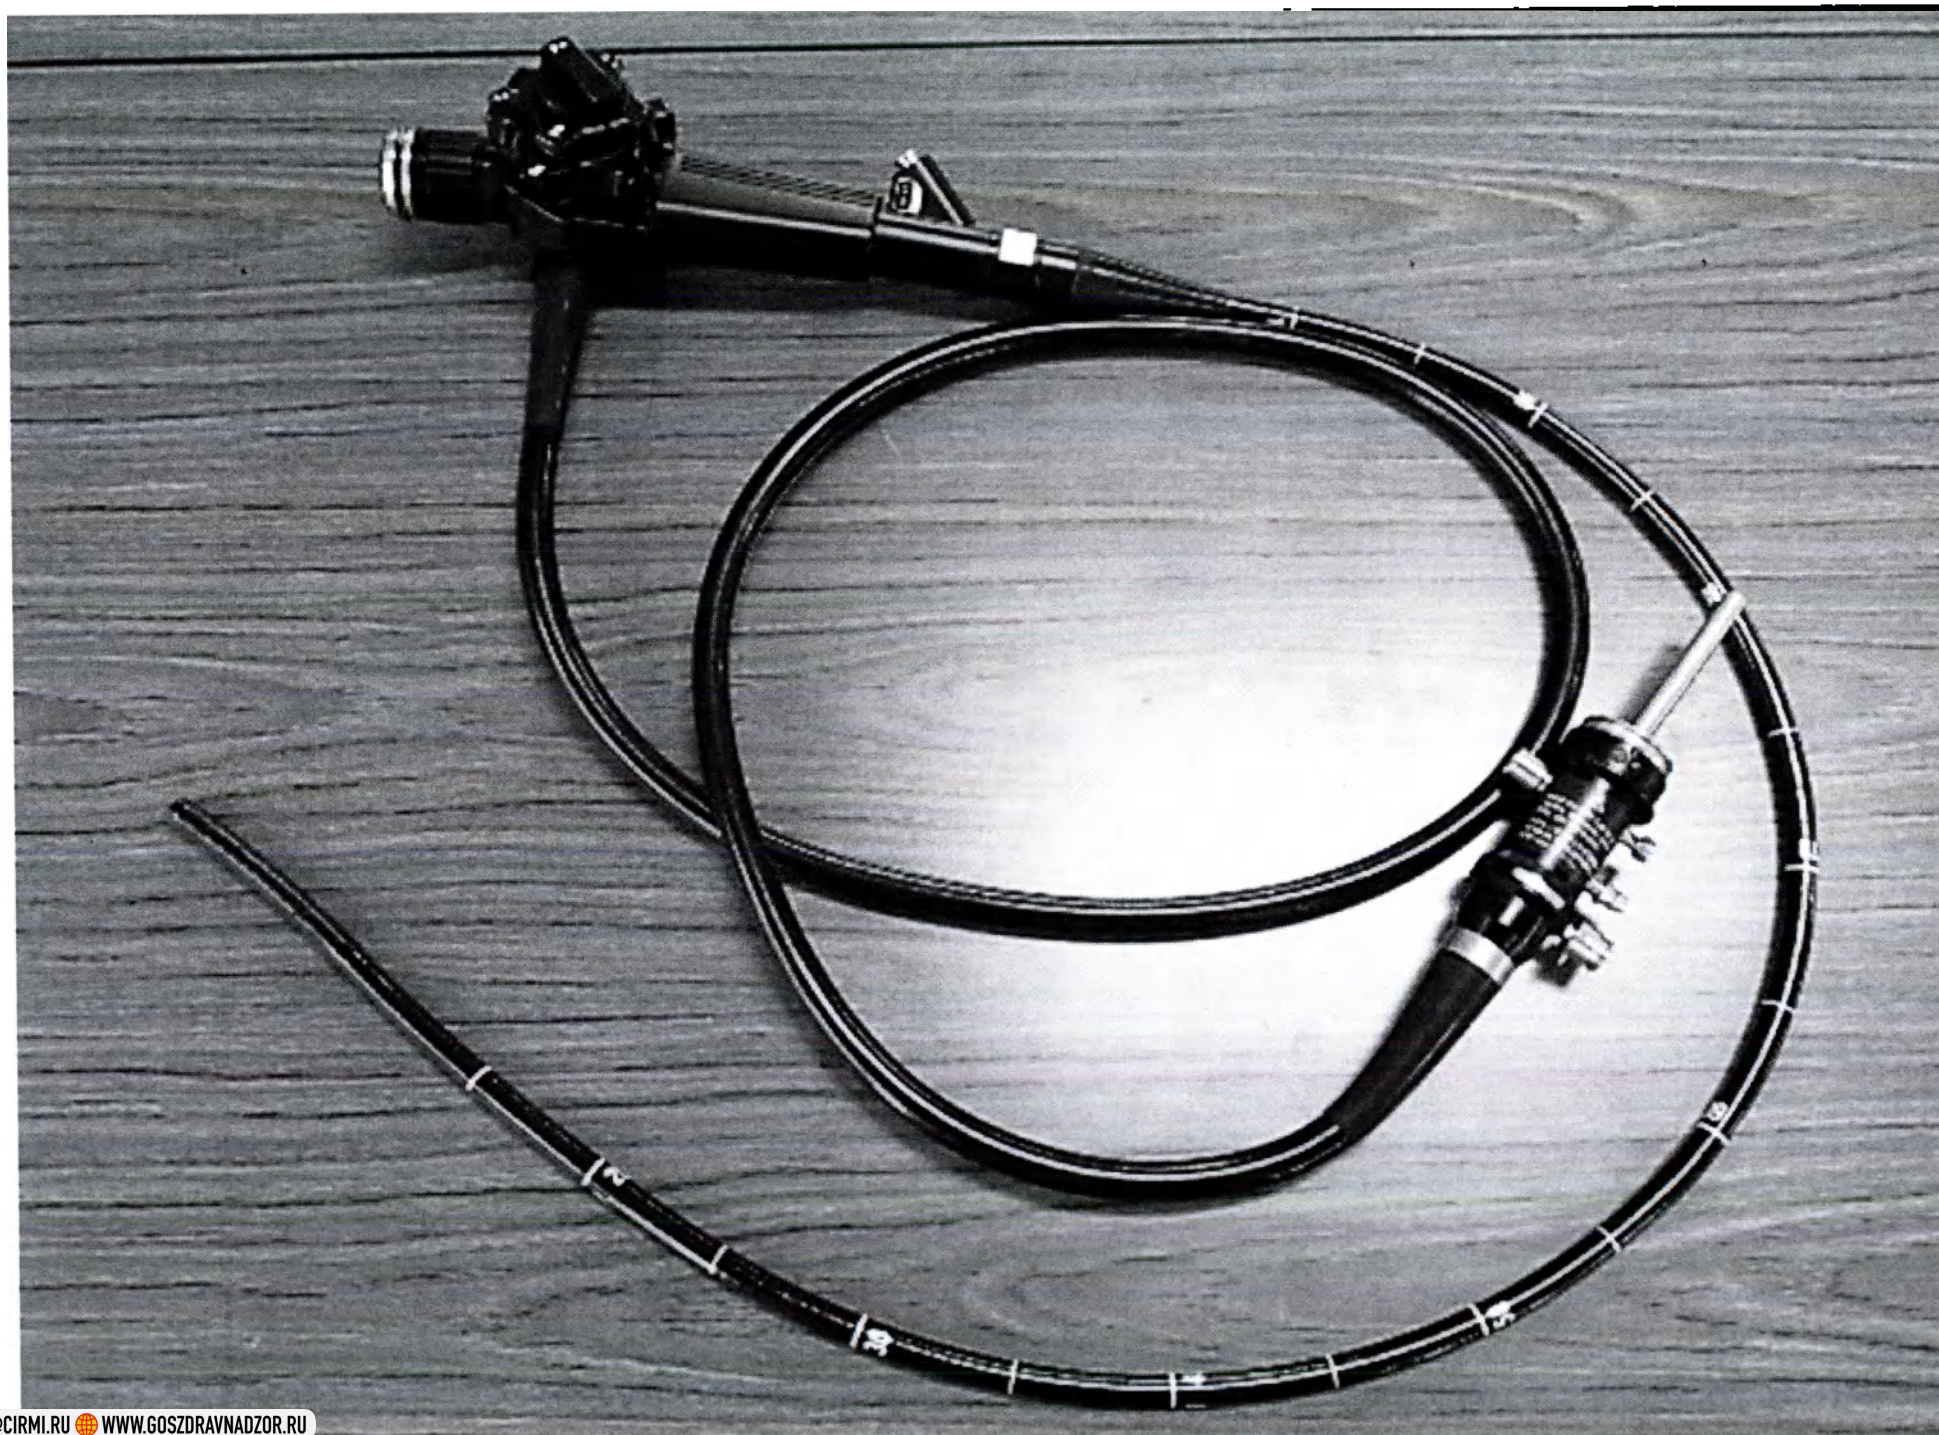

Артикул	GIF-Q40
Наименование	Эндоскопы гибкие с принадлежностями Гастроскопы: Гастрофиброскопы
Производитель	«Олимпас Медикал Системс Корп.»
Адрес производителя	43-2, Хатагая 2-Чоум, Шибую-ку, Токио,
Страна происхождения	Япония
Регистрационное удостоверение	Эндоскопы гибкие с принадлежностями РУ № РЗН 2015/3464 от 30 мая 2017 года
Уполномоченный представитель	ООО «Олимпас Москва», 107023, г. Москва ,ул. Электрозаводская, д.27, стр.8, т. 8-495-926-7077
	зав. № 2765851
	Номер партии см. на упаковке (опционально)
	дата производства – 2017 г.,
	Место производства, см. на упаковке
	Срок годности см. на упаковке (опционально)
	Технические характеристики продукта и его количество см. на упаковке
Дополнительная информация, опционально, см. на упаковке.	
	Не использовать повторно
	Метод стерилизации
	Не стерилизовать повторно
	Не использовать при поврежденной упаковке
	Соблюдение интервала температур
	Беречь от влаги
	максимальная ширина рабочей части
	минимальная ширина инструментального канала
	рабочая длина
	поле зрения и /или направление наблюдения
 	Ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации


II. Гастроскопы: Гастровидеоскопы GIF-1TH190, GIF-H185 ; стандартная комплектация:

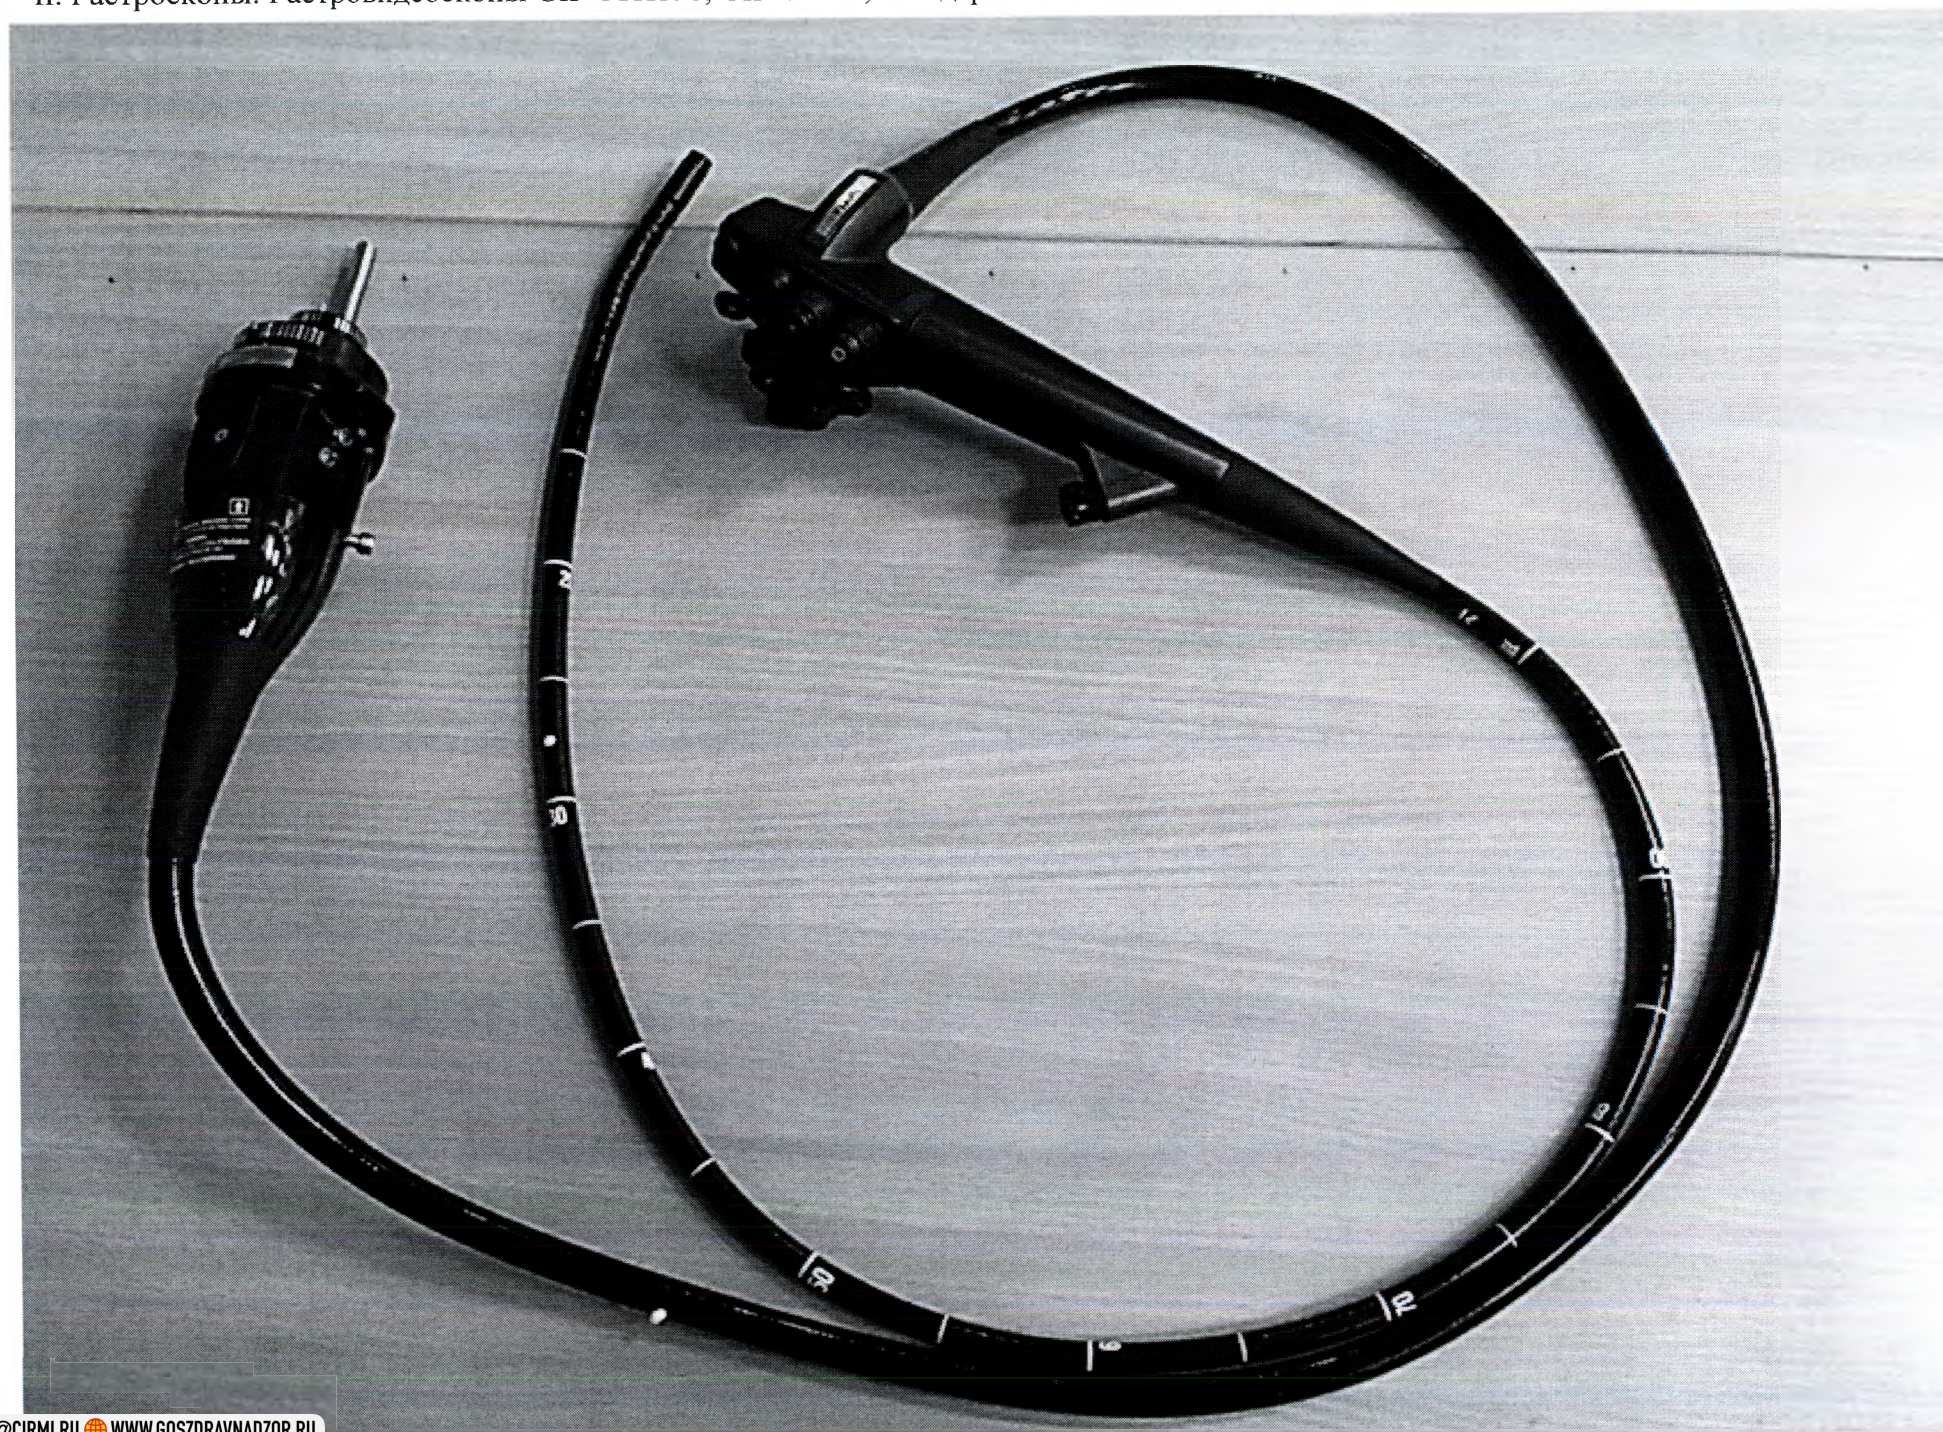


II. Гастроскопы: Гастровидеоскопы GIF-1TH190, GIF-H185 ; макет маркировки:

Артикул	GIF-H185
Наименование	Эндоскопы гибкие с принадлежностями Гастроскопы: Гастровидеоскопы
Производитель	«Олимпас Медикал Системс Корп.»
Адрес производителя	43-2, Хатагая 2-Чоум, Шибую-ку, Токио,
Страна происхождения	Япония
Регистрационное удостоверение	Эндоскопы гибкие с принадлежностями РУ № РЗН 2015/3464 от 30 мая 2017 года
Уполномоченный представитель	ООО «Олимпас Москва», 107023, г. Москва ,ул. Электровзаводская, д.27, стр.8, т. 8-495-926-7077
 SN	зав. № 2765851
 LOT	Номер партии см. на упаковке (опционально)
	дата производства – 2017 г.,
	Место производства, см. на упаковке
	Срок годности см. на упаковке (опционально)
	Технические характеристики продукта и его количество см. на упаковке
Дополнительная информация, опционально, см. на упаковке.	
	Не использовать повторно
	Метод стерилизации
	Не стерилизовать повторно
	Не использовать при поврежденной упаковке
	Соблюдение интервала температур
	Беречь от влаги
	максимальная ширина рабочей части
	минимальная ширина инструментального канала
	рабочая длина
	поле зрения и /или направление наблюдения
 	Ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации

11. 1 астрооскопы: 1 астровидеоскопы GIF-V 70, GIF-160, **GIF-Q160**, **GIF-11Q160**, GIF-Q160Z, GIF-21160, GIF-XP160, GIF-X1Q160, GIF-N1780,

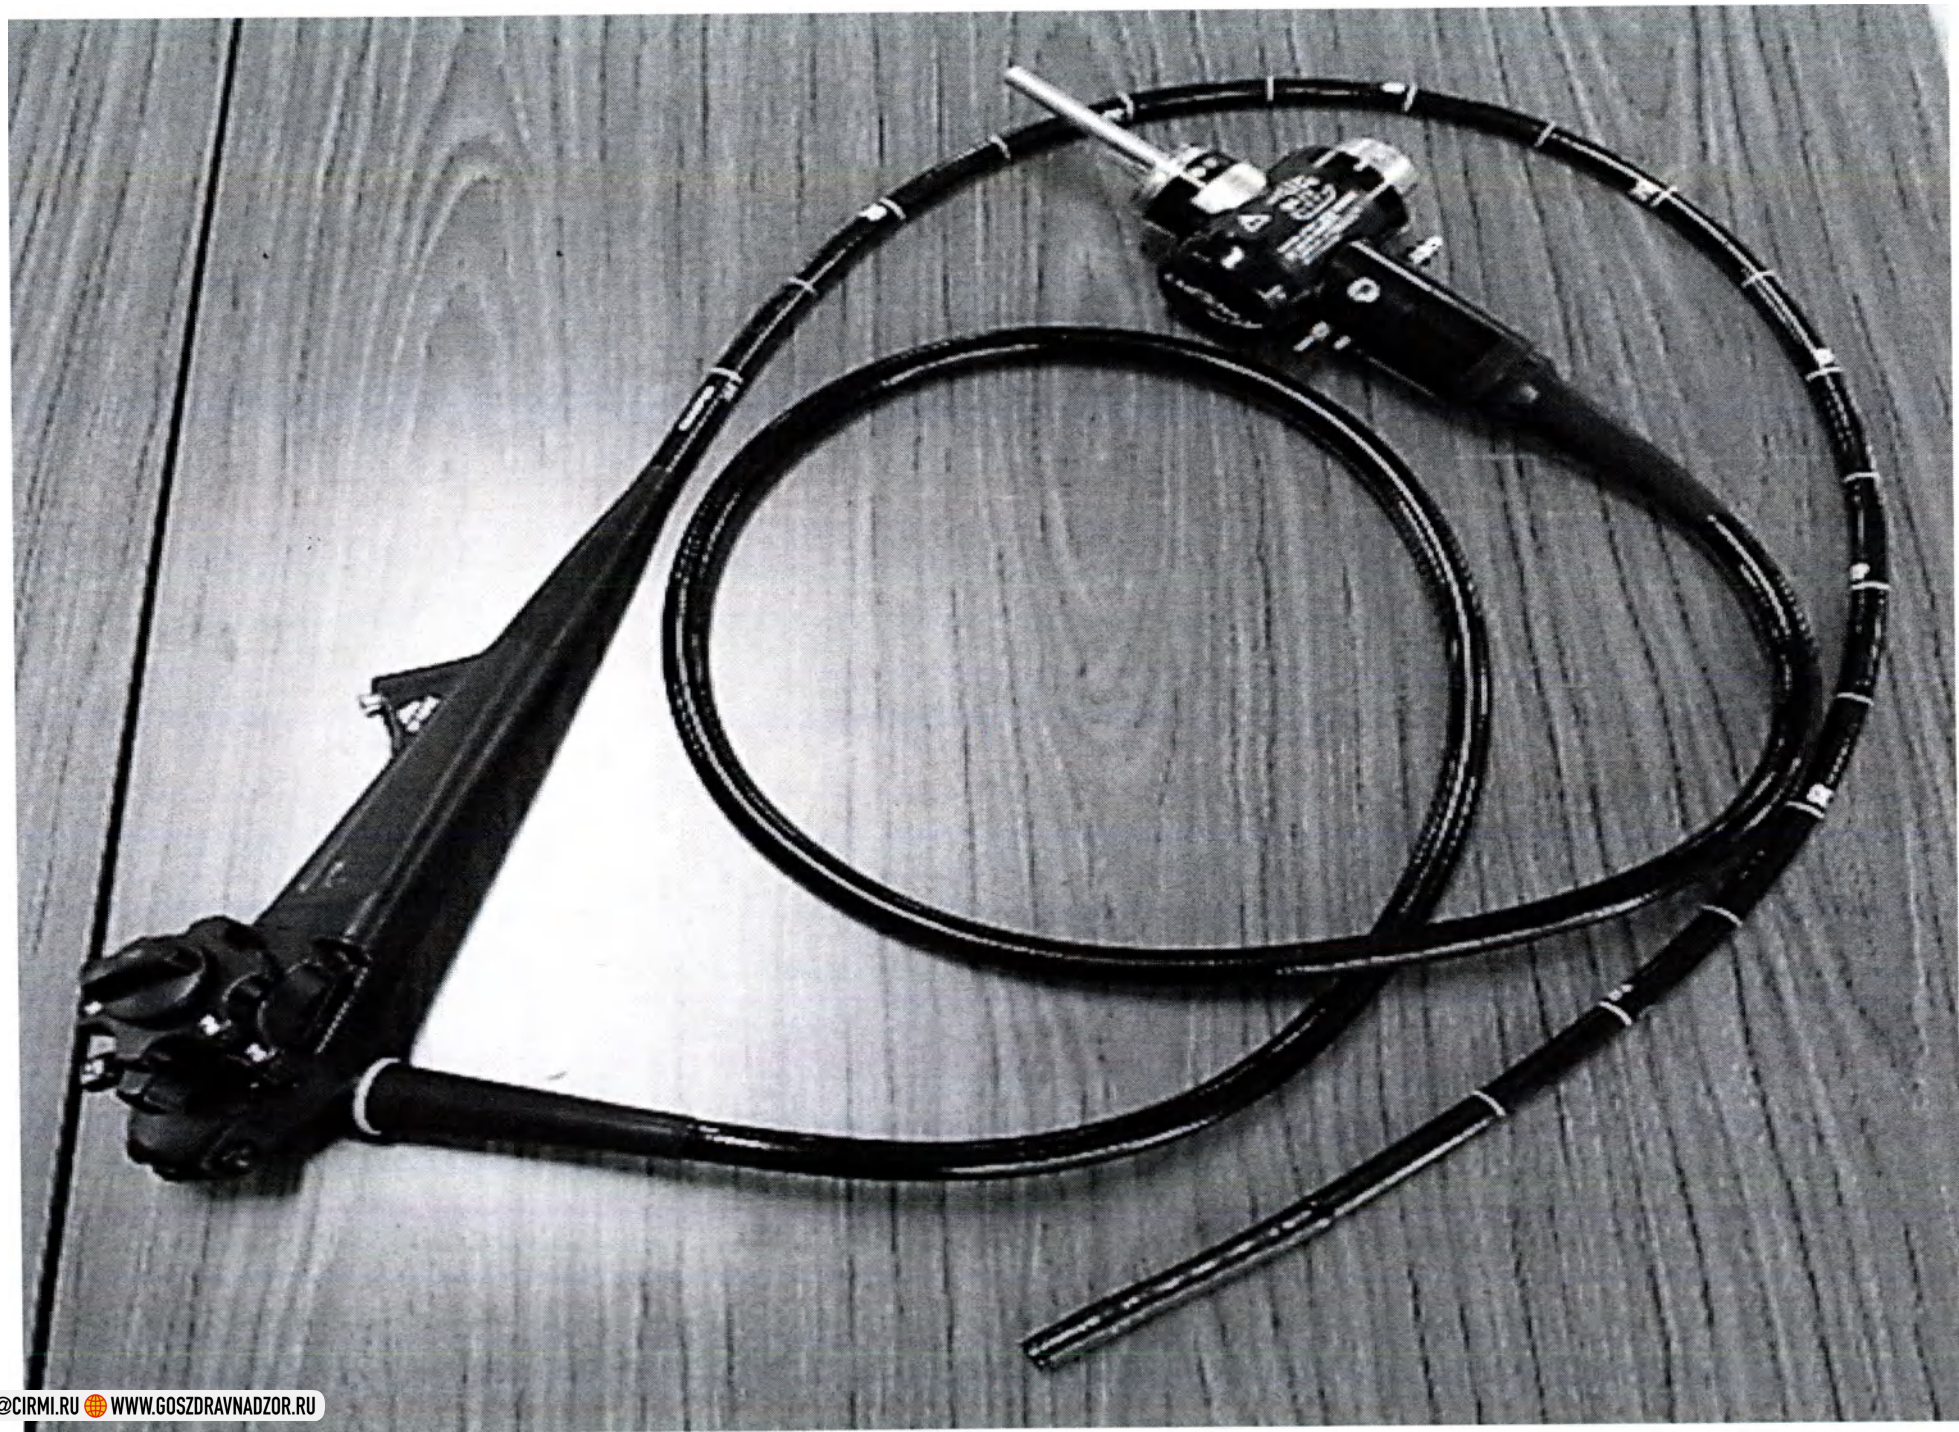


II. 1 астрооскопы: 1 астровидеооскопы ультразвуковые GF-UM160, GF-UE160-AL5, GF-UC160P-OL5, GF-UC1160-OL5, GF-UC140P-AL5, 13
GF-UCT140-AL5 TGF-UC180J ; стандартная комплектация:

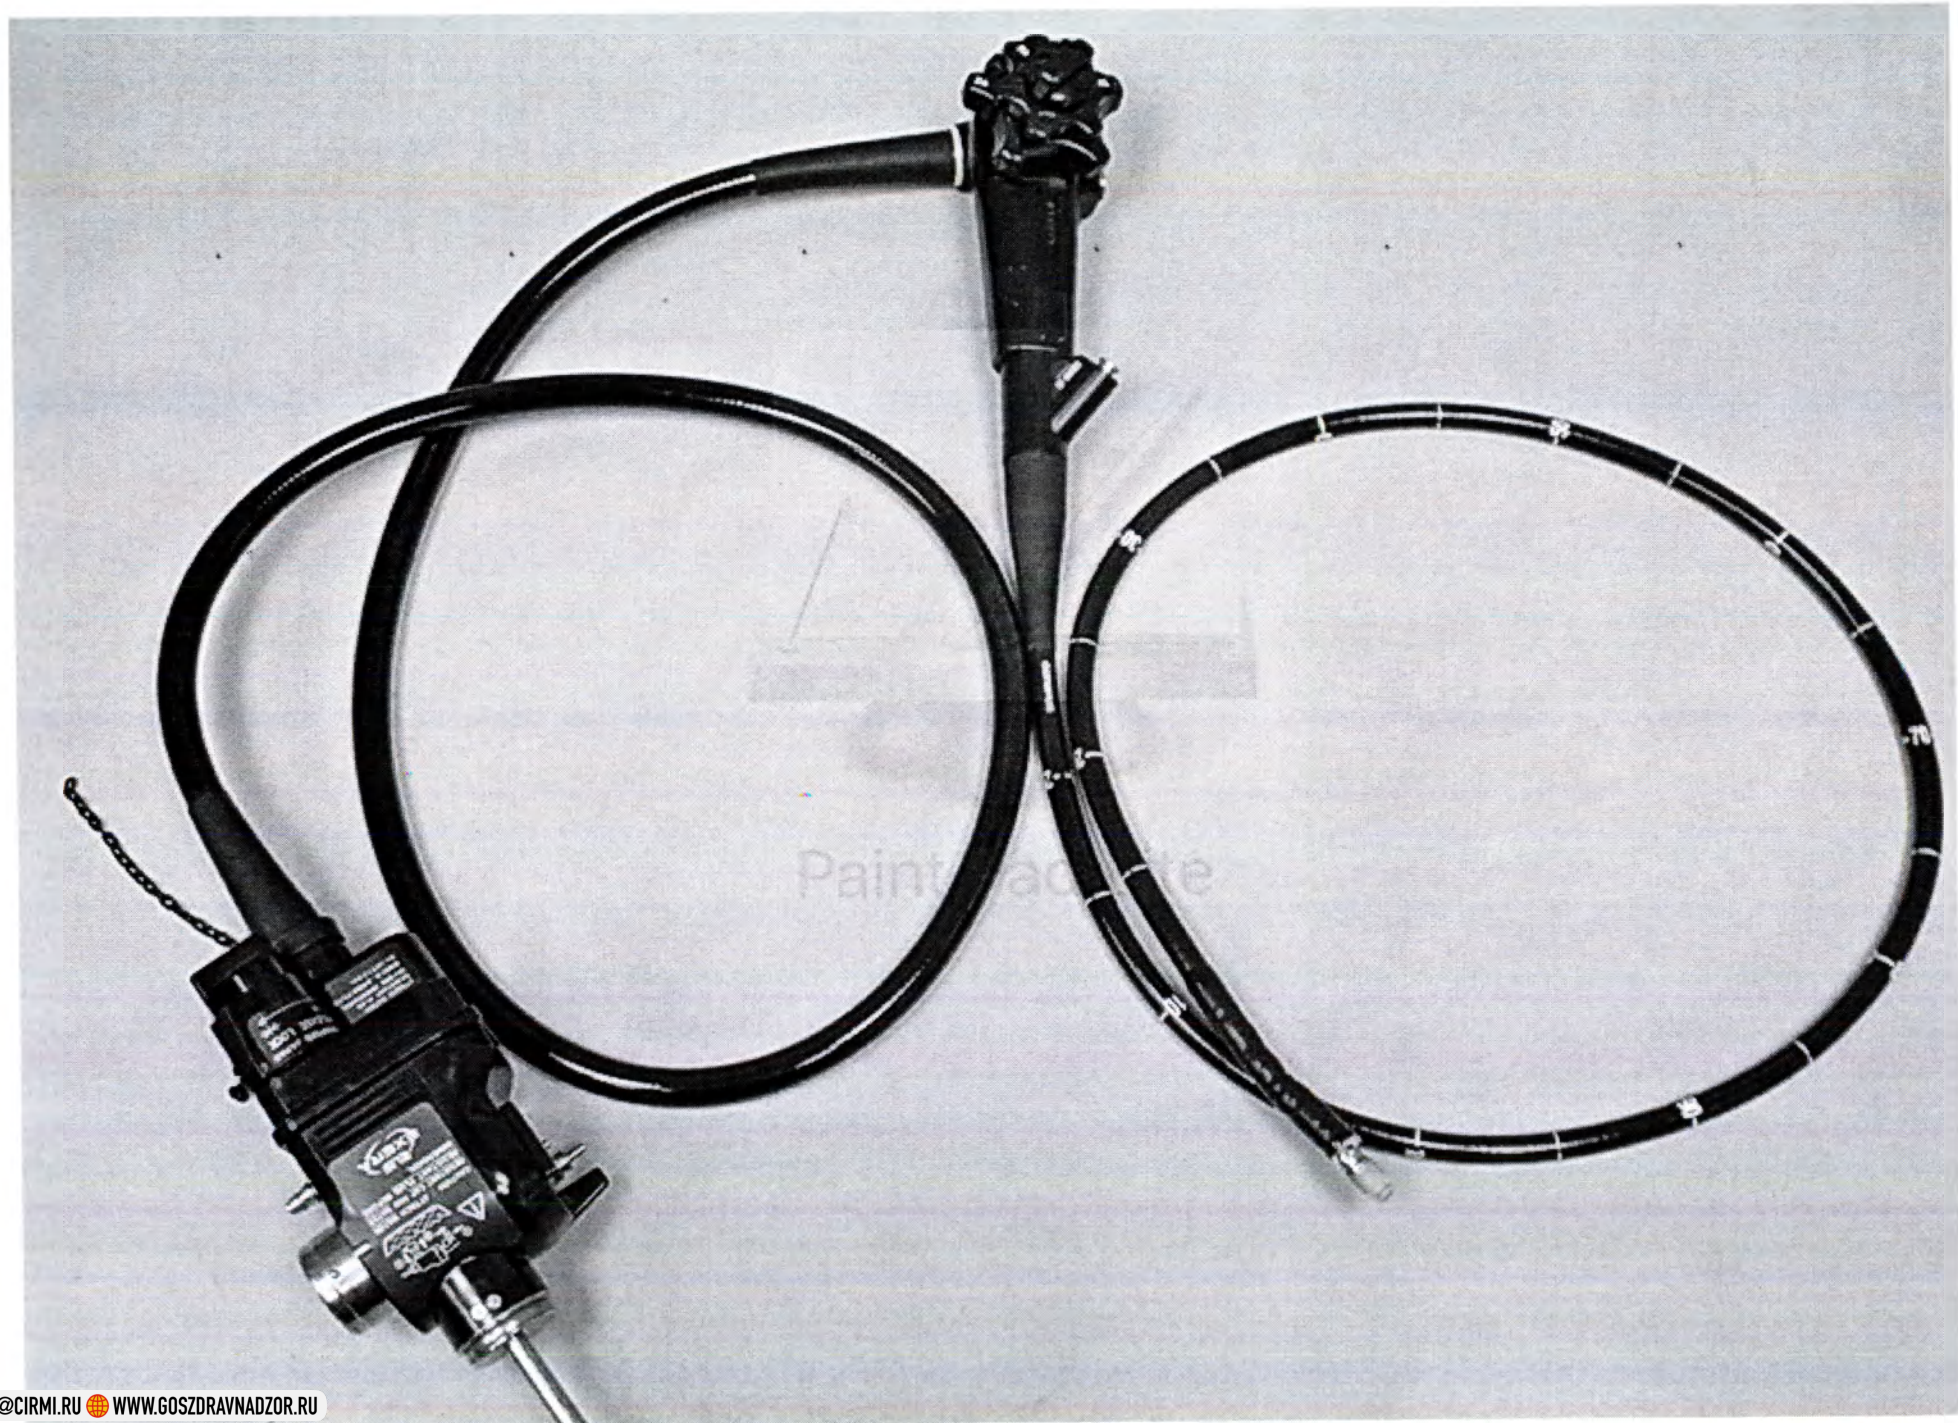

II. Гастроскопы: 1 астровидеоскопы ультразвуковые GF-UM160, GF-UE160-AL5, GF-UC160P-OL5, GF-UC1160-OL5, GF-UC140P-AL5, 14
GF-UCT140-AL5 TGF-UC180J ; макет маркировки:


Артикул	GF-UM160
Наименование	Эндоскопы гибкие с принадлежностями Гастроскопы: Гастровидеоскопы ультразвуковые
Производитель	«Олимпас Медикал Системс Корп.»
Адрес производителя	43-2, Хатагая 2-Чоум, Шибую-ку, Токио,
Страна происхождения	Япония
Регистрационное удостоверение	Эндоскопы гибкие с принадлежностями РУ № РЗН 2015/3464 от 30 мая 2017 года
Уполномоченный представитель	ООО «Олимпас Москва», 107023, г. Москва ,ул. Электрозаводская, д.27, стр.8, т. 8-495-926-7077
 SN	зав. № 2765851
 LOT	Номер партии см. на упаковке (опционально)
	дата производства – 2017 г.,
	Место производства, см. на упаковке
	Срок годности см. на упаковке (опционально)
	Технические характеристики продукта и его количество см. на упаковке
Дополнительная информация, опционально, см. на упаковке.	
	Не использовать повторно
	Метод стерилизации
	Не стерилизовать повторно
	Не использовать при поврежденной упаковке
	Соблюдение интервала температур
	Беречь от влаги
	максимальная ширина рабочей части
	минимальная ширина инструментального канала
	рабочая длина
	поле зрения и /или направление наблюдения
	Ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации

III. Бронхоскопы: Бронхофиброскопы BF-40, BF-P40 BF-3C40 BF-1140 BF-X140, BF-N20, BF-XP60, BF-MP160F, BF-1160, BF-MP60, BF-P60, BF-PE2, BF-XP60; стандартная комплектация:

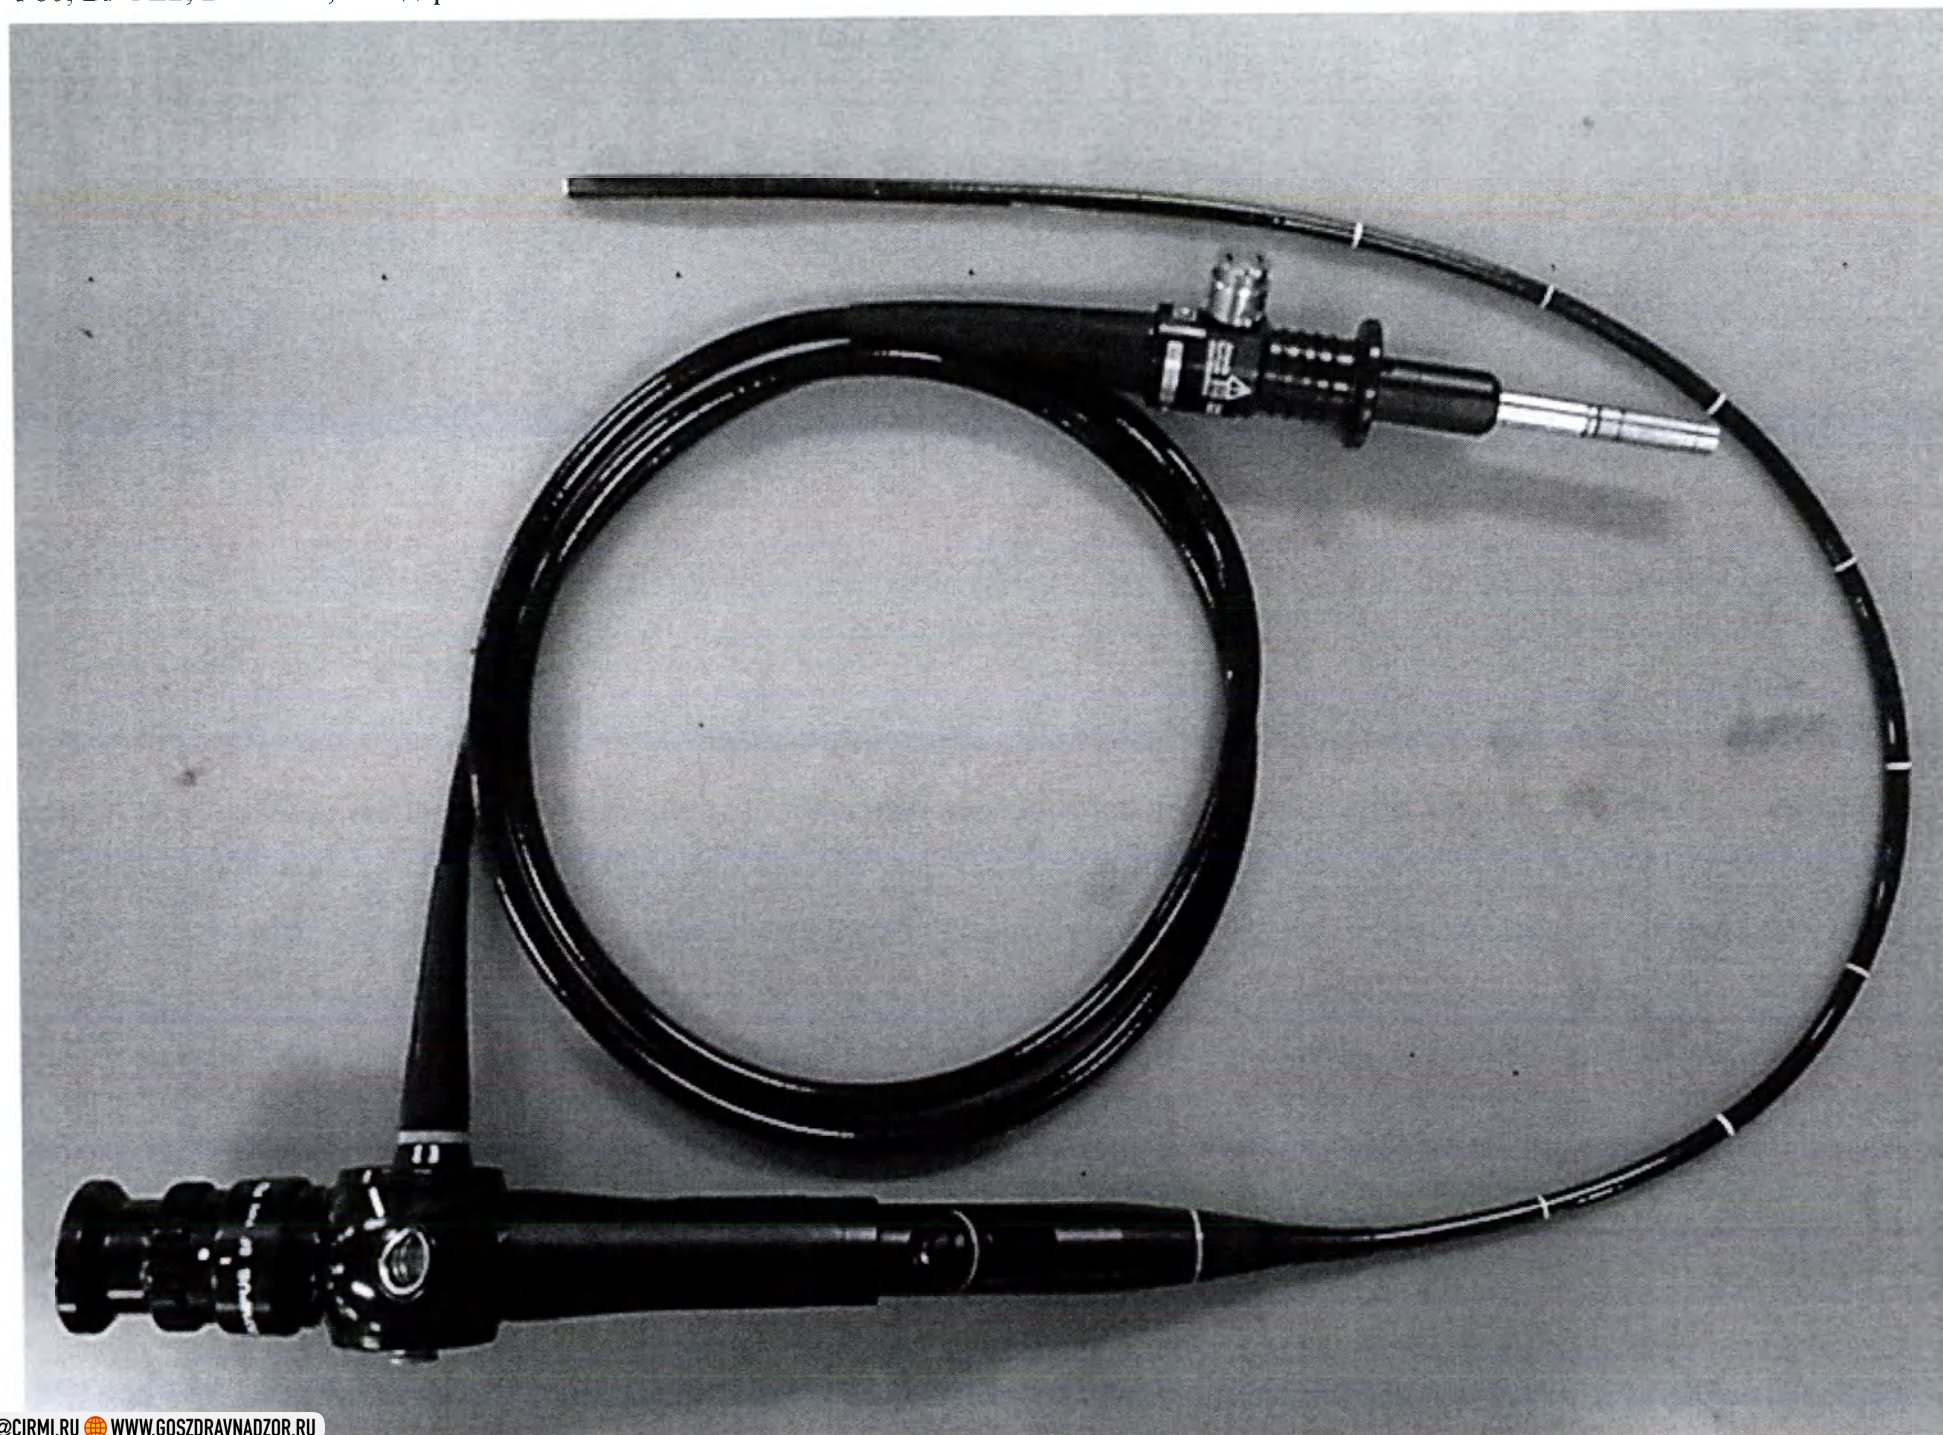


III. Бронхоскопы: Бронхофиброскопы BF-40, BF-P40 BF-3C40 BF-1140 BF-X140, **BF-N20**, BF-XP60, BF-MP160F, BF-1160, BF-MP60, BF-P60, BF-PE2, BF-XP60; макет маркировки:

Артикул	BF-PE2
Наименование	Эндоскопы гибкие с принадлежностями Бронхоскопы: Бронхофиброскопы
Производитель	«Олимпас Медикал Системс Корп.»
Адрес производителя	43-2, Хатагая 2-Чоум, Шибую-ку, Токио,
Страна происхождения	Япония
Регистрационное удостоверение	Эндоскопы гибкие с принадлежностями РУ № РЗН 2015/3464 от 30 мая 2017 года
Уполномоченный представитель	ООО «Олимпас Москва», 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д.27, стр.8, т. 8-495-926-7077
	зав. № 2765851
	Номер партии см. на упаковке (опционально)
	дата производства – 2017 г.,
	Место производства, см. на упаковке
	Срок годности см. на упаковке (опционально)
	Технические характеристики продукта и его количество см. на упаковке
Дополнительная информация, опционально, см. на упаковке.	
	Не использовать повторно
	Метод стерилизации
	Не стерилизовать повторно
	Не использовать при поврежденной упаковке
	Соблюдение интервала температур
	Беречь от влаги
	максимальная ширина рабочей части
	минимальная ширина инструментального канала
	рабочая длина
	поле зрения и /или направление наблюдения
	Ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации

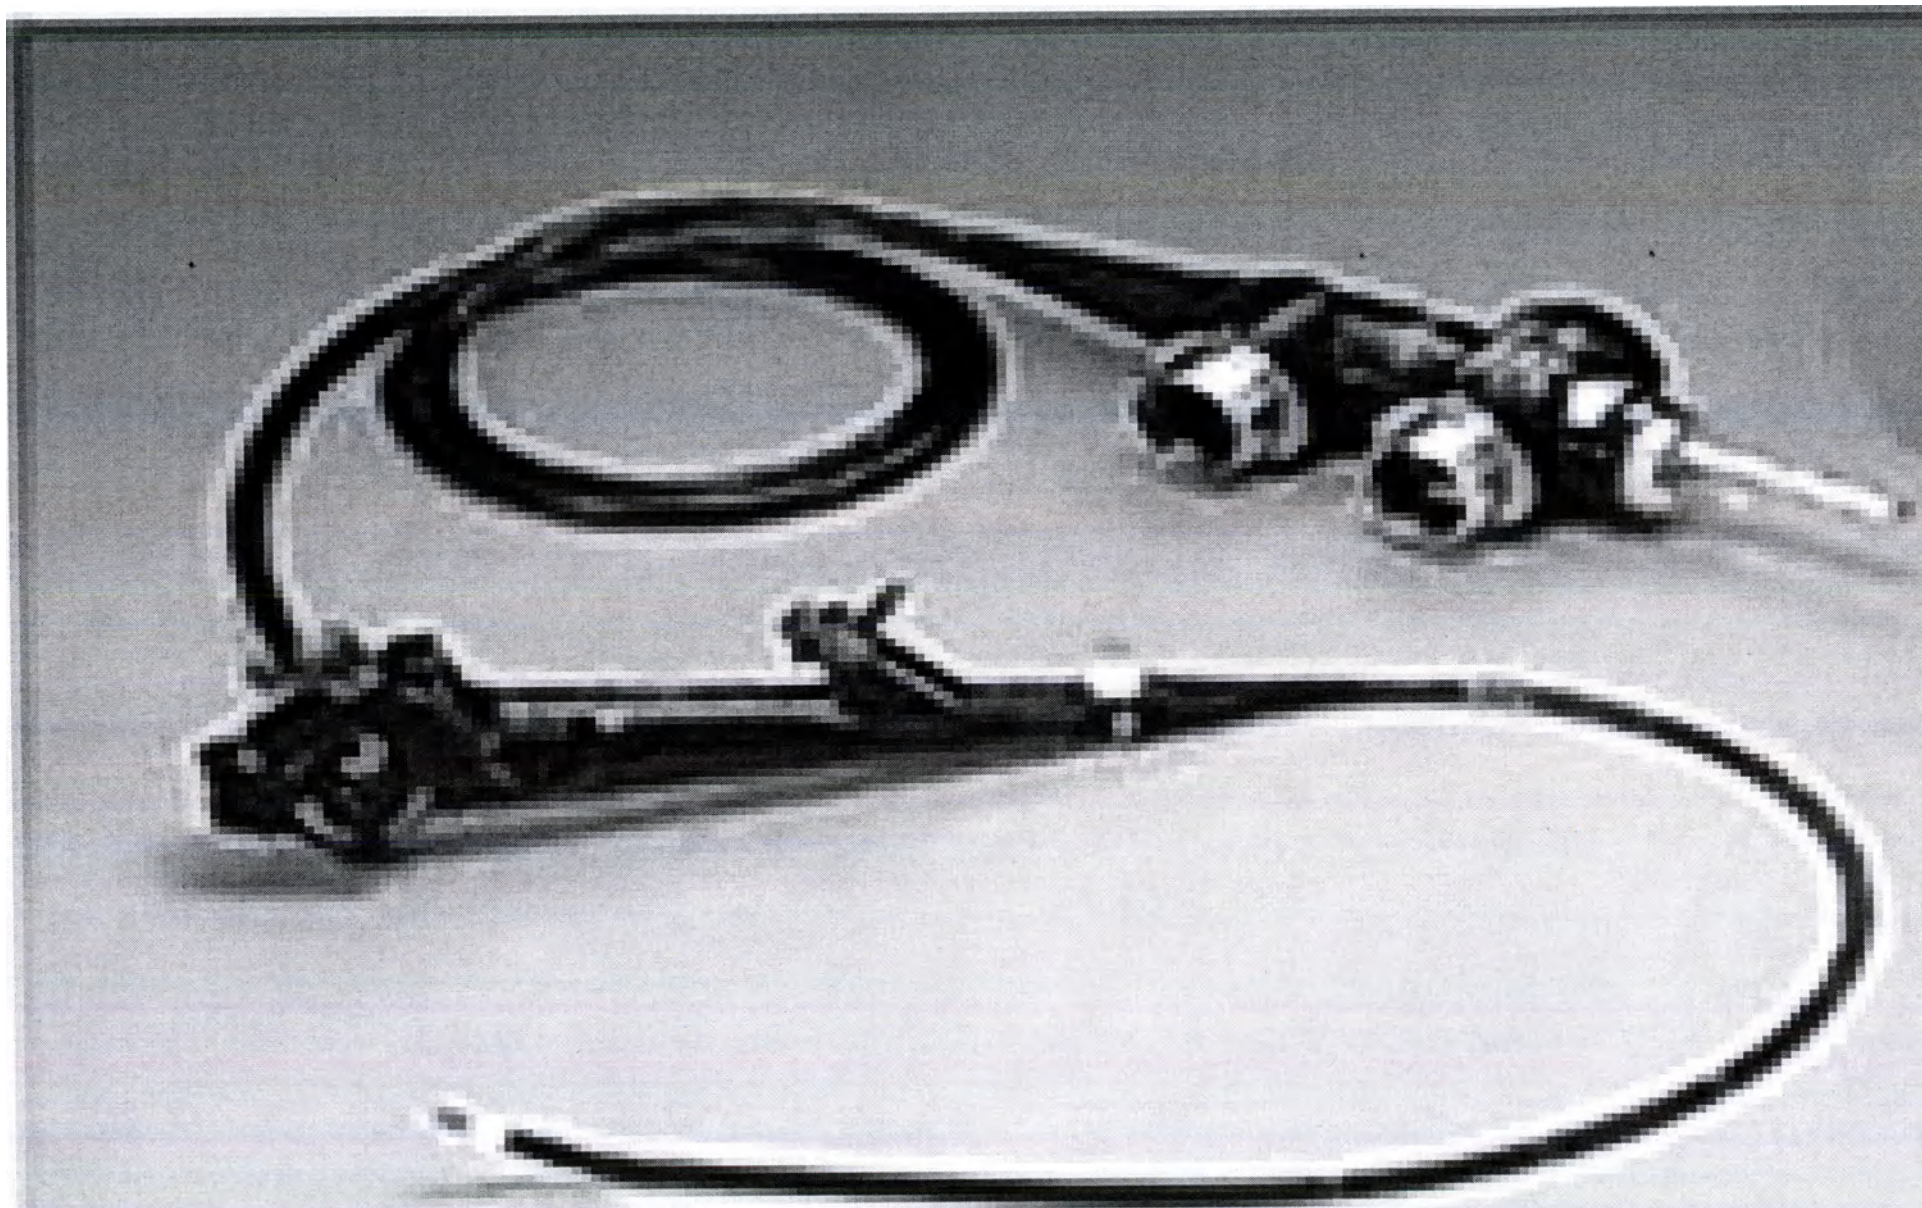

III. Бронхоскопы: Бронховидеоскопы BF-160, BF-P160, BF-X1160, BF-11160, BF-3C160, BF-P150, BF-11150, BF-11180, BF-P180, BF-Q180, BF-P190, BF-XP190, BF-MP190F, BF-XP160F; стандартная комплектация:

18

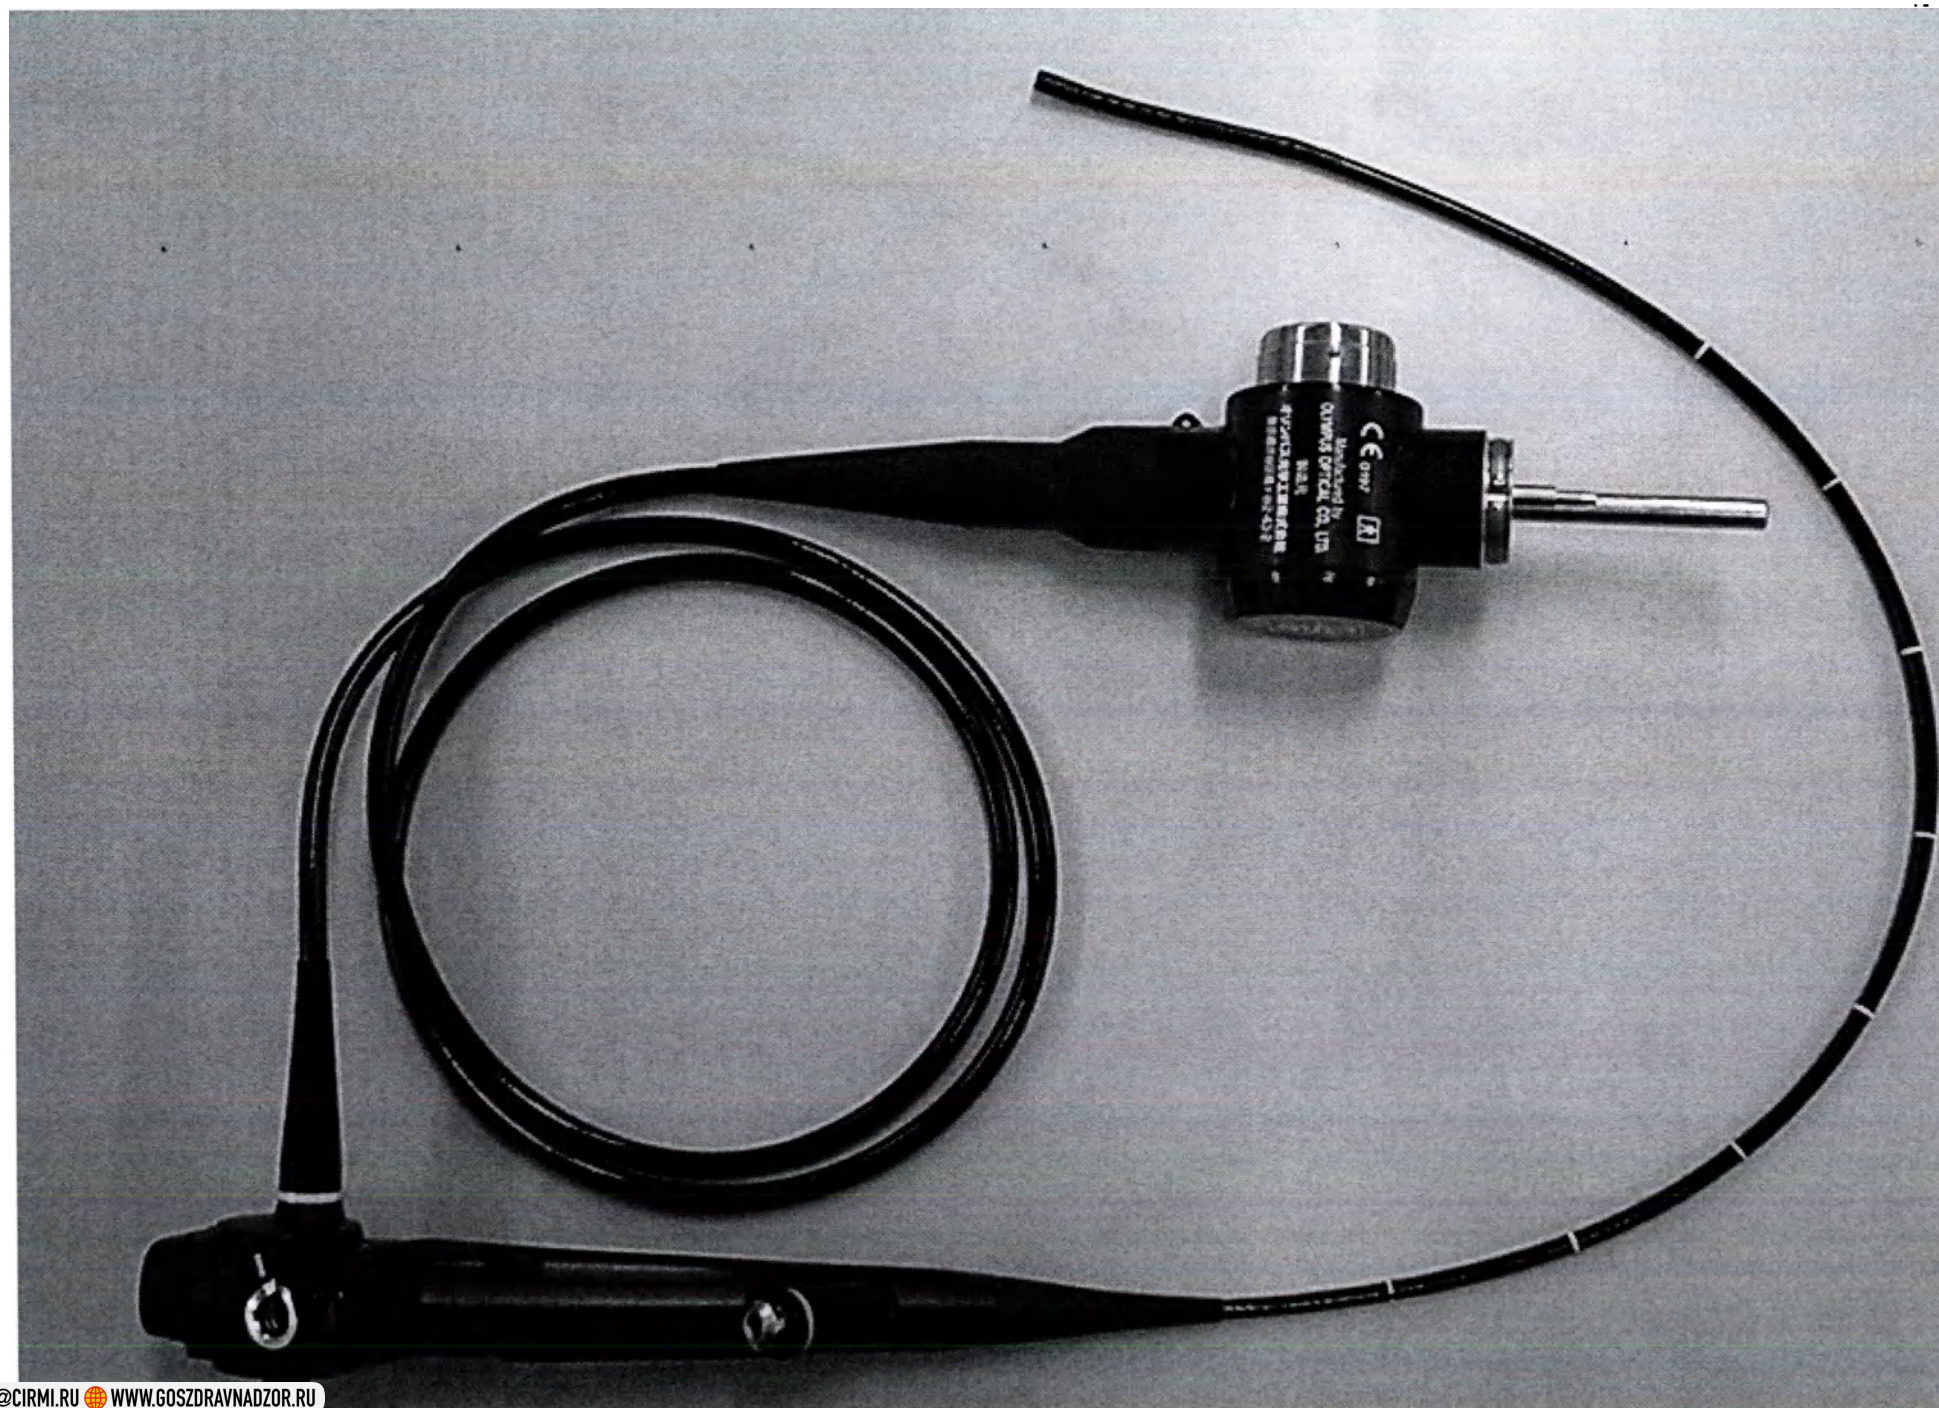


III. Бронхоскопы: Бронховидеоскопы BF-160, BF-P160, BF-X1160, BF-11160, BF-3C160, BF-P150, BF-11150, BF-11180, BF-P180, BF-Q180, BF-P190, BF-XP190, BF-MP190F, BF-XP160F; макет маркировки:

19

Артикул	BF-160
Наименование	Эндоскопы гибкие с принадлежностями Бронхоскопы: Бронховидеоскопы
Производитель	«Олимпас Медикал Системс Корп.»
Адрес производителя	43-2, Хатагая 2-Чоум, Шибую-ку, Токио,
Страна происхождения	Япония
Регистрационное удостоверение	Эндоскопы гибкие с принадлежностями РУ № РЗН 2015/3464 от 30 мая 2017 года
Уполномоченный представитель	ООО «Олимпас Москва», 107023, г. Москва ,ул. Электрозаводская, д.27, стр.8, т. 8-495-926-7077
	зав. № 2765851
	Номер партии см. на упаковке (опционально)
	дата производства – 2017 г.,
	Место производства, см. на упаковке
	Срок годности см. на упаковке (опционально)
	Технические характеристики продукта и его количество см. на упаковке
Дополнительная информация, опционально, см. на упаковке.	
	Не использовать повторно
	Метод стерилизации
	Не стерилизовать повторно
	Не использовать при поврежденной упаковке
	Соблюдение интервала температур
	Беречь от влаги
	максимальная ширина рабочей части
	минимальная ширина инструментального канала
	рабочая длина
	поле зрения и /или направление наблюдения
	Ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации


IV. Дуоденоскопы: Дуоденофиброскопы TJF-30 ; стандартная комплектация:

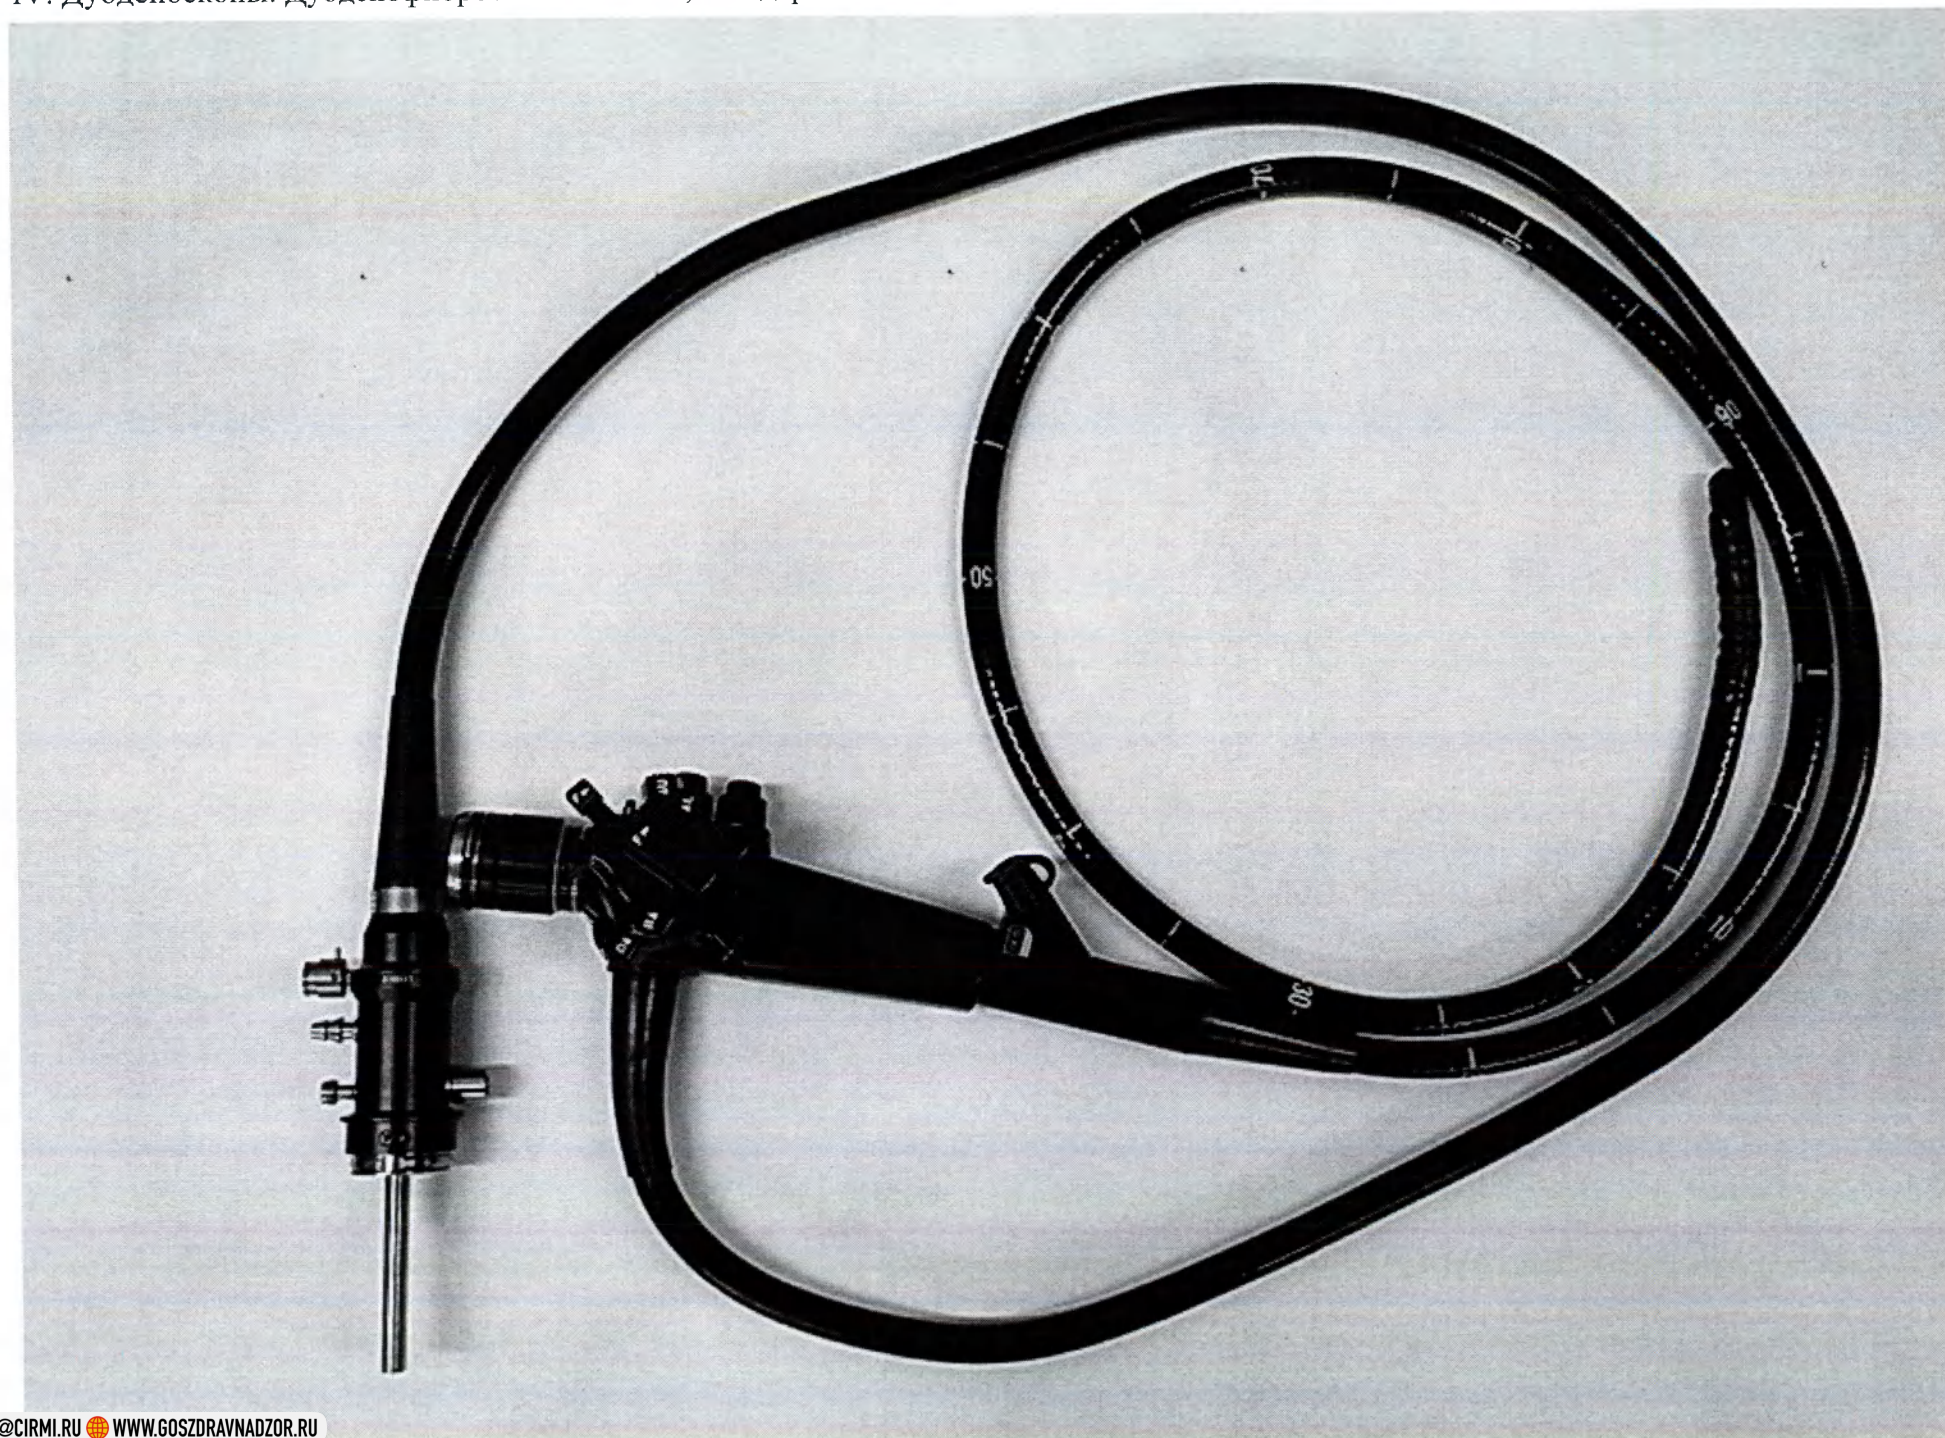

IV. Дуоденоскопы: Дуоденофиброскопы TJF-30 ; макет маркировки:

Артикул	TJF-30
Наименование	Эндоскопы гибкие с принадлежностями Дуоденоскопы: Дуоденофиброскопы
Производитель	«Олимпас Медикал Системс Корп.»
Адрес производителя	43-2, Хатагая 2-Чоум, Шибую-ку, Токио,
Страна происхождения	Япония
Регистрационное удостоверение	Эндоскопы гибкие с принадлежностями РУ № РЗН 2015/3464 от 30 мая 2017 года
Уполномоченный представитель	ООО «Олимпас Москва», 107023, г. Москва ,ул. Электрозаводская, д.27, стр.8, т. 8-495-926-7077
 SN	зав. № 2765851
 LOT	Номер партии см. на упаковке (опционально)
	дата производства – 2017 г.,
	Место производства, см. на упаковке
	Срок годности см. на упаковке (опционально)
	Технические характеристики продукта и его количество см. на упаковке
Дополнительная информация, опционально, см. на упаковке.	
	Не использовать повторно
	Метод стерилизации
	Не стерилизовать повторно
	Не использовать при поврежденной упаковке
	Соблюдение интервала температур
	Беречь от влаги
	максимальная ширина рабочей части
	минимальная ширина инструментального канала
	рабочая длина
	поле зрения и /или направление наблюдения
	Ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации


IV. Дуоденоскопы: Дуоденовидеоскоп TJF-160VR, TJF-150 ; стандартная комплектация:

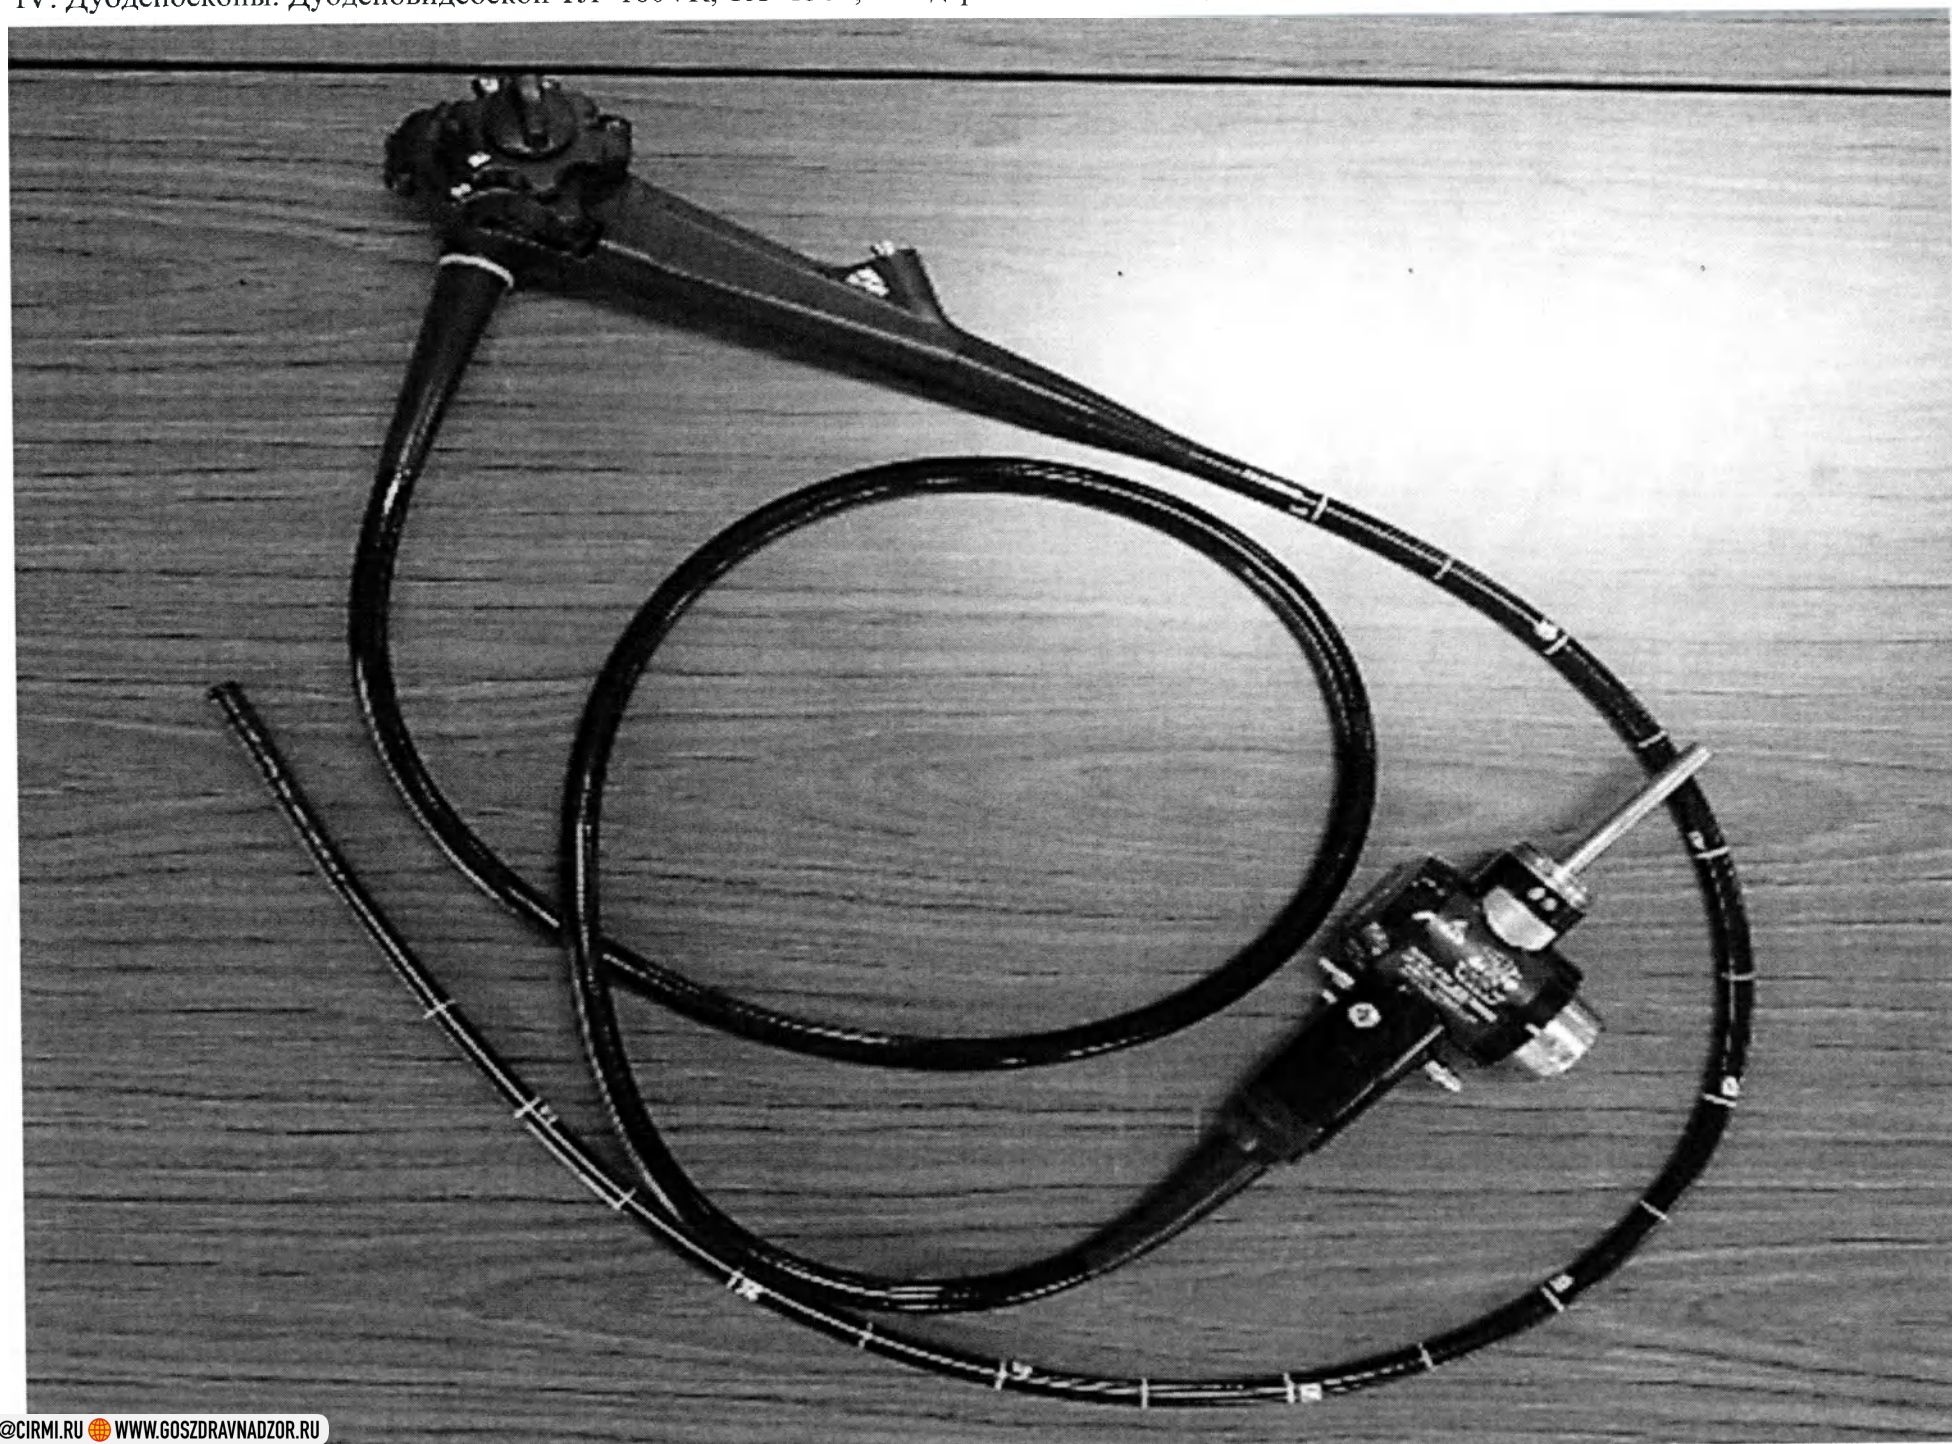

IV. Дуоденоскопы: Дуоденовидеоскоп TJF-160VR, TJF-150 ; макет маркировки:

Артикул	TJF-160VR
Наименование	Эндоскопы гибкие с принадлежностями Дуоденоскопы: Дуоденовидеоскоп
Производитель	«Олимпас Медикал Системс Корп.»
Адрес производителя	43-2, Хатагая 2-Чоум, Шибую-ку, Токио,
Страна происхождения	Япония
Регистрационное удостоверение	Эндоскопы гибкие с принадлежностями РУ № РЗН 2015/3464 от 30 мая 2017 года
Уполномоченный представитель	ООО «Олимпас Москва», 107023, г. Москва ,ул. Электрозаводская, д.27, стр.8, т. 8-495-926-7077
	зав. № 2765851
	Номер партии см. на упаковке (опционально)
	дата производства – 2017 г.,
	Место производства, см. на упаковке
	Срок годности см. на упаковке (опционально)
	Технические характеристики продукта и его количество см. на упаковке
Дополнительная информация, опционально, см. на упаковке.	
	Не использовать повторно
	Метод стерилизации
	Не стерилизовать повторно
	Не использовать при поврежденной упаковке
	Соблюдение интервала температур
	Беречь от влаги
	максимальная ширина рабочей части
	минимальная ширина инструментального канала
	рабочая длина
	поле зрения и /или направление наблюдения
 	Ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации


V. Риноларингофиброскопы ENF-T3, ENF-XP, ENF-P4, ENF-L3; стандартная комплектация:

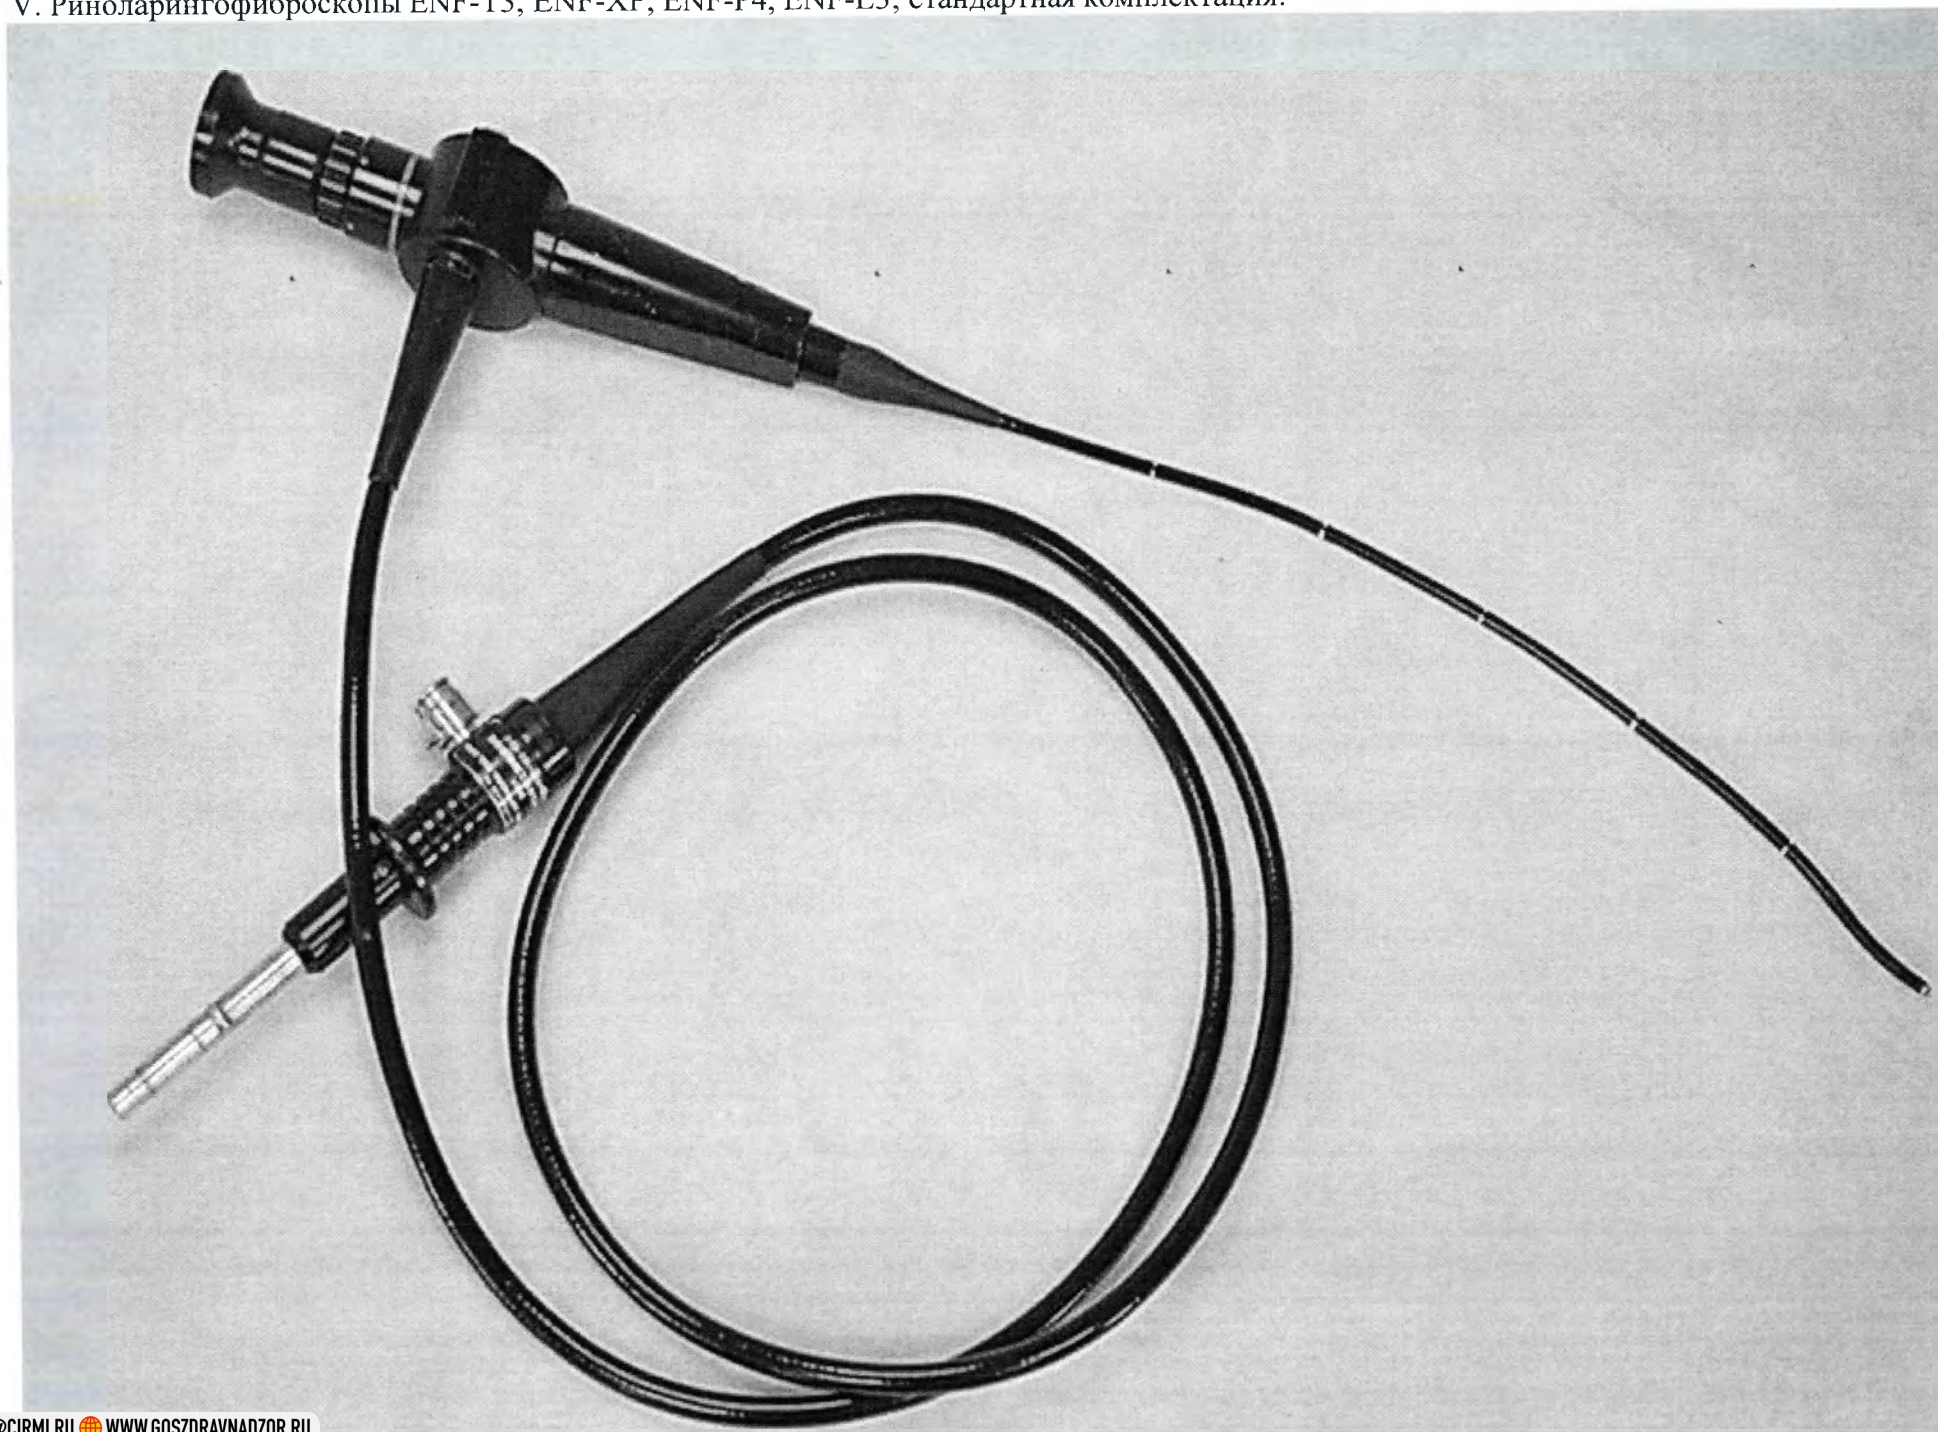

V. Риноларингофиброскопы ENF-T3, ENF-XP, ENF-P4, ENF-L3; макет маркировки:

Артикул	ENF-T3
Наименование	Эндоскопы гибкие с принадлежностями Риноларингофиброскопы
Производитель	«Олимпас Медикал Системс Корп.»
Адрес производителя	43-2, Хатагая 2-Чоум, Шибую-ку, Токио,
Страна происхождения	Япония
Регистрационное удостоверение	Эндоскопы гибкие с принадлежностями РУ № РЗН 2015/3464 от 30 мая 2017 года
Уполномоченный представитель	ООО «Олимпас Москва», 107023, г. Москва, ул. Электrozаводская, д.27, стр.8, т. 8-495-926-7077
 SN	зав. № 2765851
 LOT	Номер партии см. на упаковке (опционально)
	дата производства – 2017 г.,
	Место производства, см. на упаковке
	Срок годности см. на упаковке (опционально)
	Технические характеристики продукта и его количество см. на упаковке
Дополнительная информация, опционально, см. на упаковке.	
	Не использовать повторно
	Метод стерилизации
	Не стерилизовать повторно
	Не использовать при поврежденной упаковке
	Соблюдение интервала температур
	Беречь от влаги
	максимальная ширина рабочей части
	минимальная ширина инструментального канала
	рабочая длина
	поле зрения и /или направление наблюдения
	Ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации

V. Риноларингофиброскопы: Риноларинговидеоскопы ENF-V2, ENF-VH, ENF-V3, ENF-VQ ; стандартная комплектация:

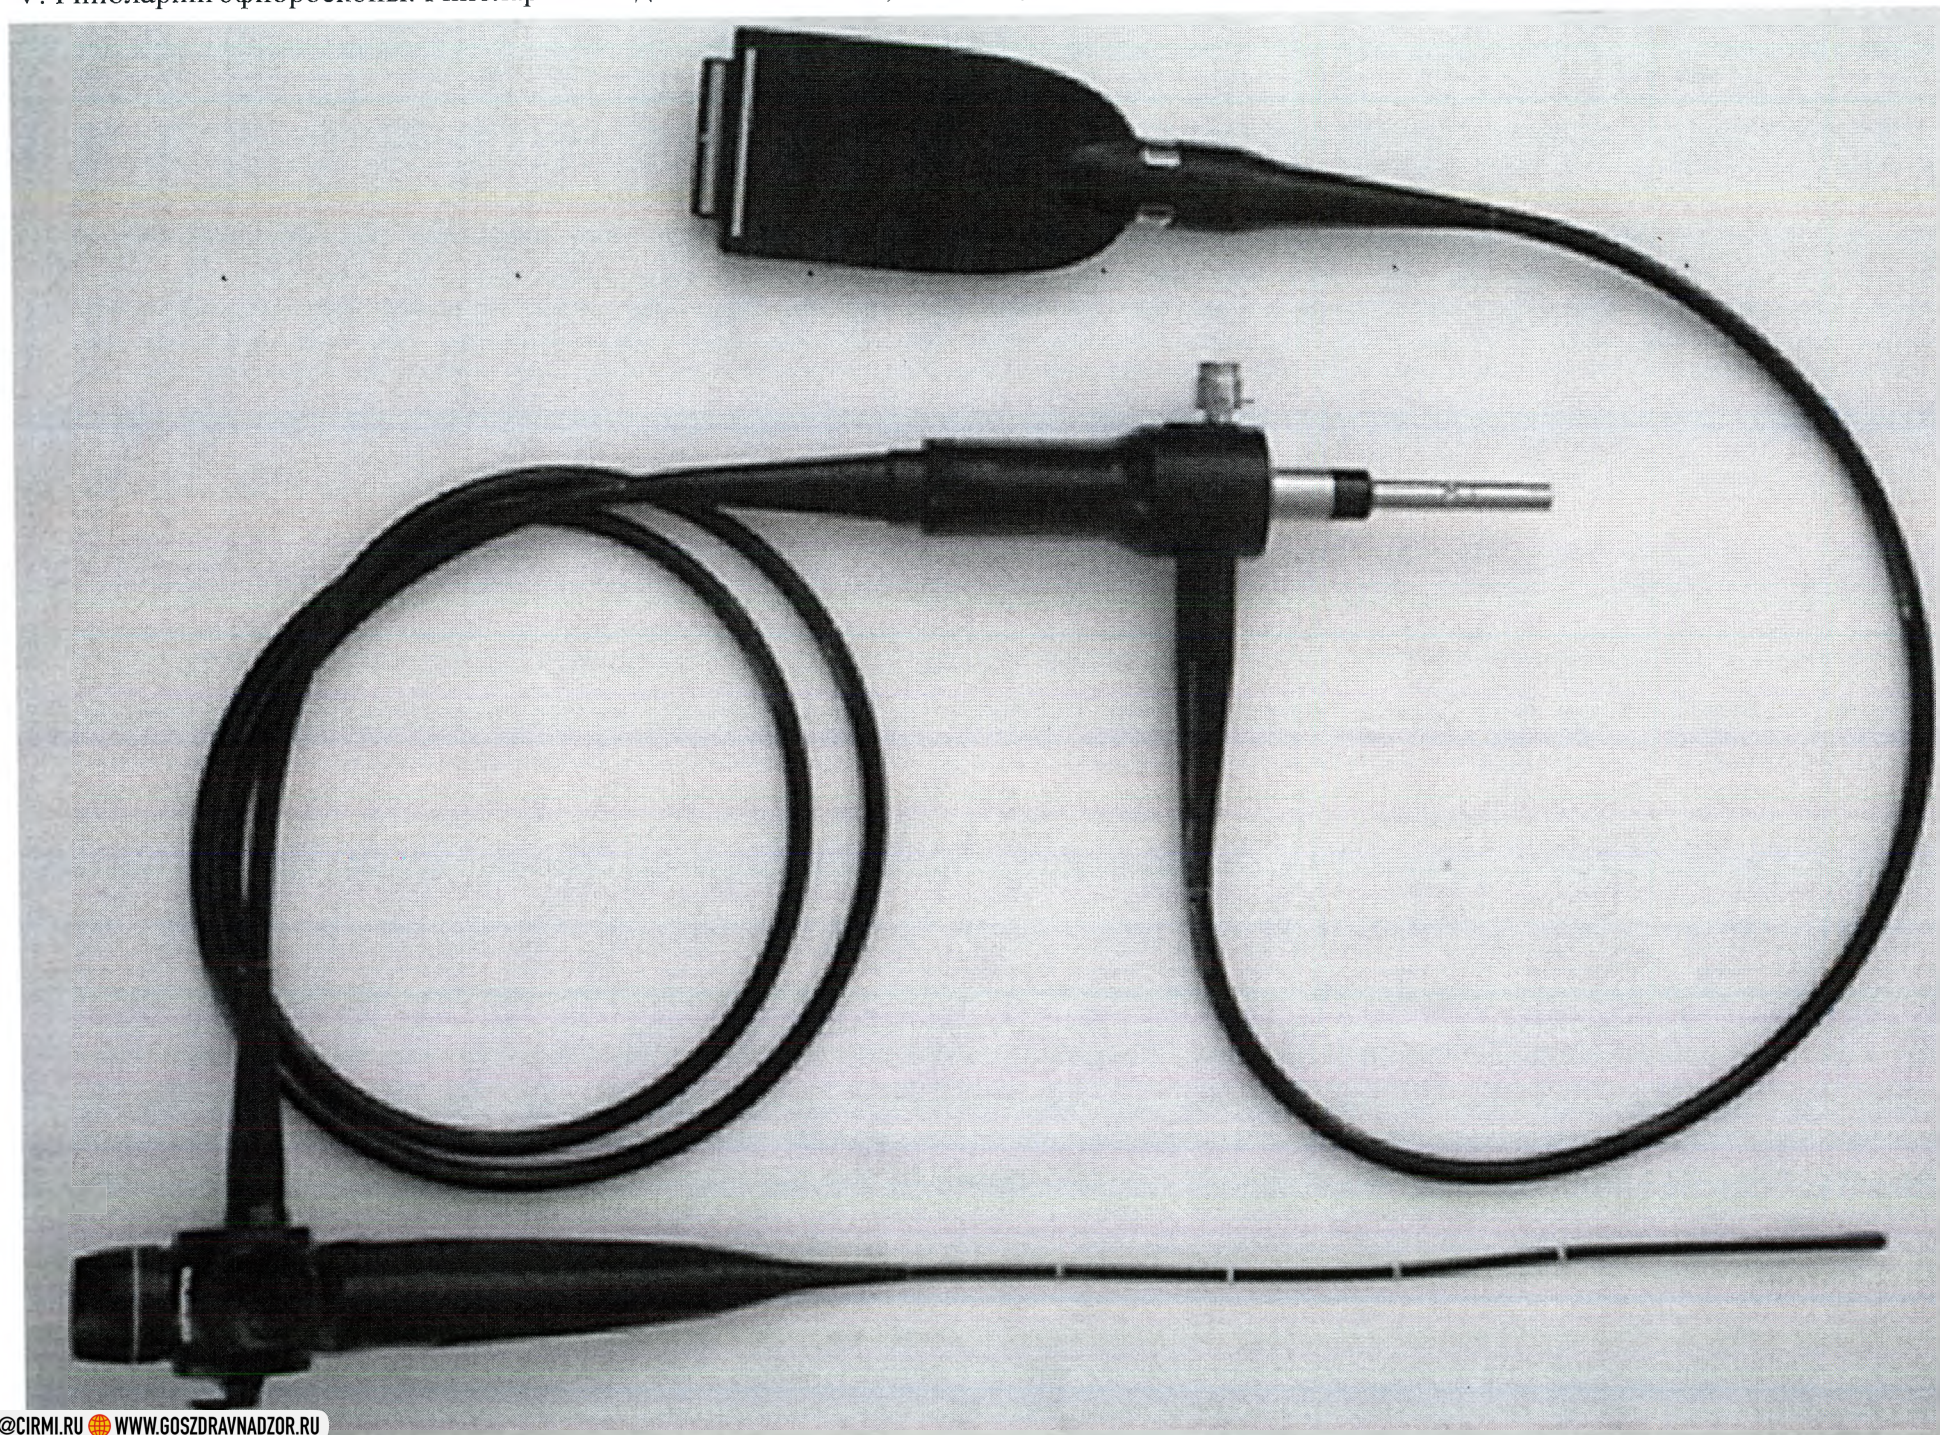

V. Риноларингофиброскопы: Риноларинговидеоскопы ENF-V2, ENF-VH, ENF-V3, ENF-VQ ; макет маркировки:

Артикул	ENF-V2
Наименование	Эндоскопы гибкие с принадлежностями Риноларингофиброскопы: Риноларинговидеоскопы
Производитель	«Олимпас Медикал Системс Корп.»
Адрес производителя	43-2, Хатагая 2-Чоум, Шибую-ку, Токио,
Страна происхождения	Япония
Регистрационное удостоверение	Эндоскопы гибкие с принадлежностями РУ № РЗН 2015/3464 от 30 мая 2017 года
Уполномоченный представитель	ООО «Олимпас Москва», 107023, г. Москва ,ул. Электrozаводская, д.27, стр.8, т. 8-495-926-7077
	зав. № 2765851
	Номер партии см. на упаковке (опционально)
	дата производства – 2017 г.,
	Место производства, см. на упаковке
	Срок годности см. на упаковке (опционально)
	Технические характеристики продукта и его количество см. на упаковке
Дополнительная информация, опционально, см. на упаковке.	
	Не использовать повторно
	Метод стерилизации
	Не стерилизовать повторно
	Не использовать при поврежденной упаковке
	Соблюдение интервала температур
	Беречь от влаги
	максимальная ширина рабочей части
	минимальная ширина инструментального канала
	рабочая длина
	поле зрения и /или направление наблюдения
	Ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации


VI. Ларингофиброскопы интубационные: LF-GP, LF-DP, LF-TP; стандартная комплектация:



VI. Ларингофиброскопы интубационные: LF-GP, LF-DP, LF-TP; макет маркировки:

Артикул	LF-GP
Наименование	Эндоскопы гибкие с принадлежностями Ларингофиброскопы интубационные
Производитель	«Олимпас Медикал Системс Корп.»
Адрес производителя	43-2, Хатагая 2-Чоум, Шибую-ку, Токио,
Страна происхождения	Япония
Регистрационное удостоверение	Эндоскопы гибкие с принадлежностями РУ № РЗН 2015/3464 от 30 мая 2017 года
Уполномоченный представитель	ООО «Олимпас Москва», 107023, г. Москва ,ул. Электровзводская, д.27, стр.8, т. 8-495-926-7077
 SN	зав. № 2765851
 LOT	Номер партии см. на упаковке (опционально)
	дата производства – 2017 г.,
	Место производства, см. на упаковке
	Срок годности см. на упаковке (опционально)
	Технические характеристики продукта и его количество см. на упаковке
Дополнительная информация, опционально, см. на упаковке.	
	Не использовать повторно
	Метод стерилизации
	Не стерилизовать повторно
	Не использовать при поврежденной упаковке
	Соблюдение интервала температур
	Беречь от влаги
	максимальная ширина рабочей части
	минимальная ширина инструментального канала
	рабочая длина
	поле зрения и /или направление наблюдения
 	Ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации


VII. Холедохофиброскопы: CHF-BP30, CHF-CB30S, CHF-CB30L; стандартная комплектация:

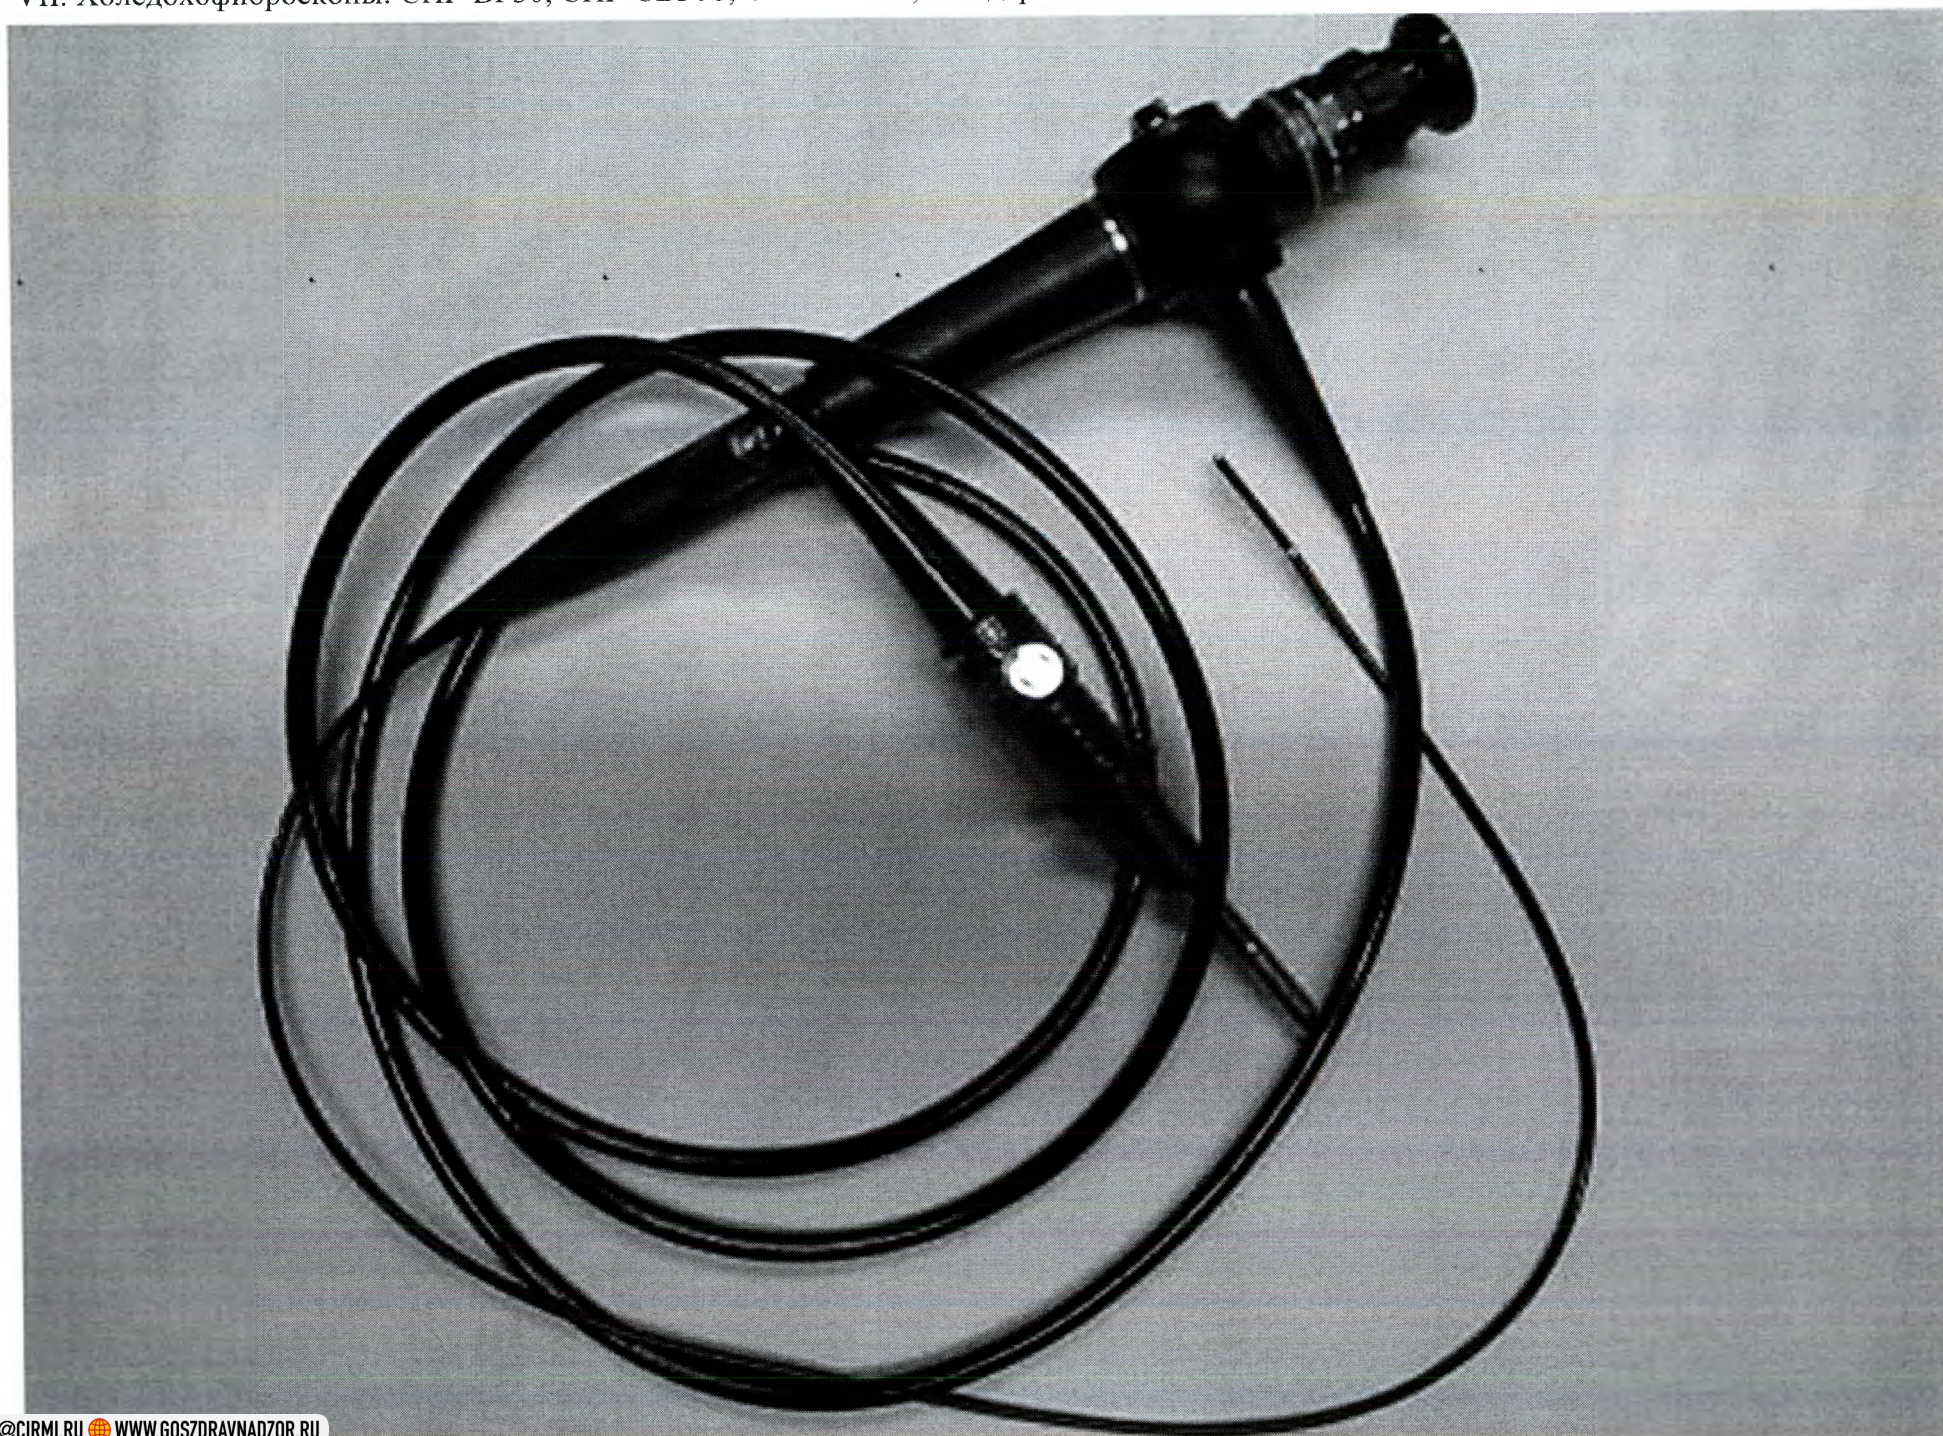

VII. Холедохофиброскопы: CHF-BP30, CHF-CB30S, CHF-CB30L; макет маркировки:

Артикул	CHF-BP30
Наименование	Эндоскопы гибкие с принадлежностями Холедохофиброскопы
Производитель	«Олимпас Медикал Системс Корп.»
Адрес производителя	43-2, Хатагая 2-Чоум, Шибую-ку, Токио,
Страна происхождения	Япония
Регистрационное удостоверение	Эндоскопы гибкие с принадлежностями РУ № РЗН 2015/3464 от 30 мая 2017 года
Уполномоченный представитель	ООО «Олимпас Москва», 107023, г. Москва, ул. Электrozаводская, д.27, стр.8, т. 8-495-926-7077
	зав. № 2765851
	Номер партии см. на упаковке (опционально)
	дата производства – 2017 г.,
	Место производства, см. на упаковке
	Срок годности см. на упаковке (опционально)
	Технические характеристики продукта и его количество см. на упаковке
Дополнительная информация, опционально, см. на упаковке.	
	Не использовать повторно
	Метод стерилизации
	Не стерилизовать повторно
	Не использовать при поврежденной упаковке
	Соблюдение интервала температур
	Беречь от влаги
	максимальная ширина рабочей части
	минимальная ширина инструментального канала
	рабочая длина
	поле зрения и /или направление наблюдения
	Ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации


VIII. Цистоскопы: CYF-5, CYF-5A ; стандартная комплектация:

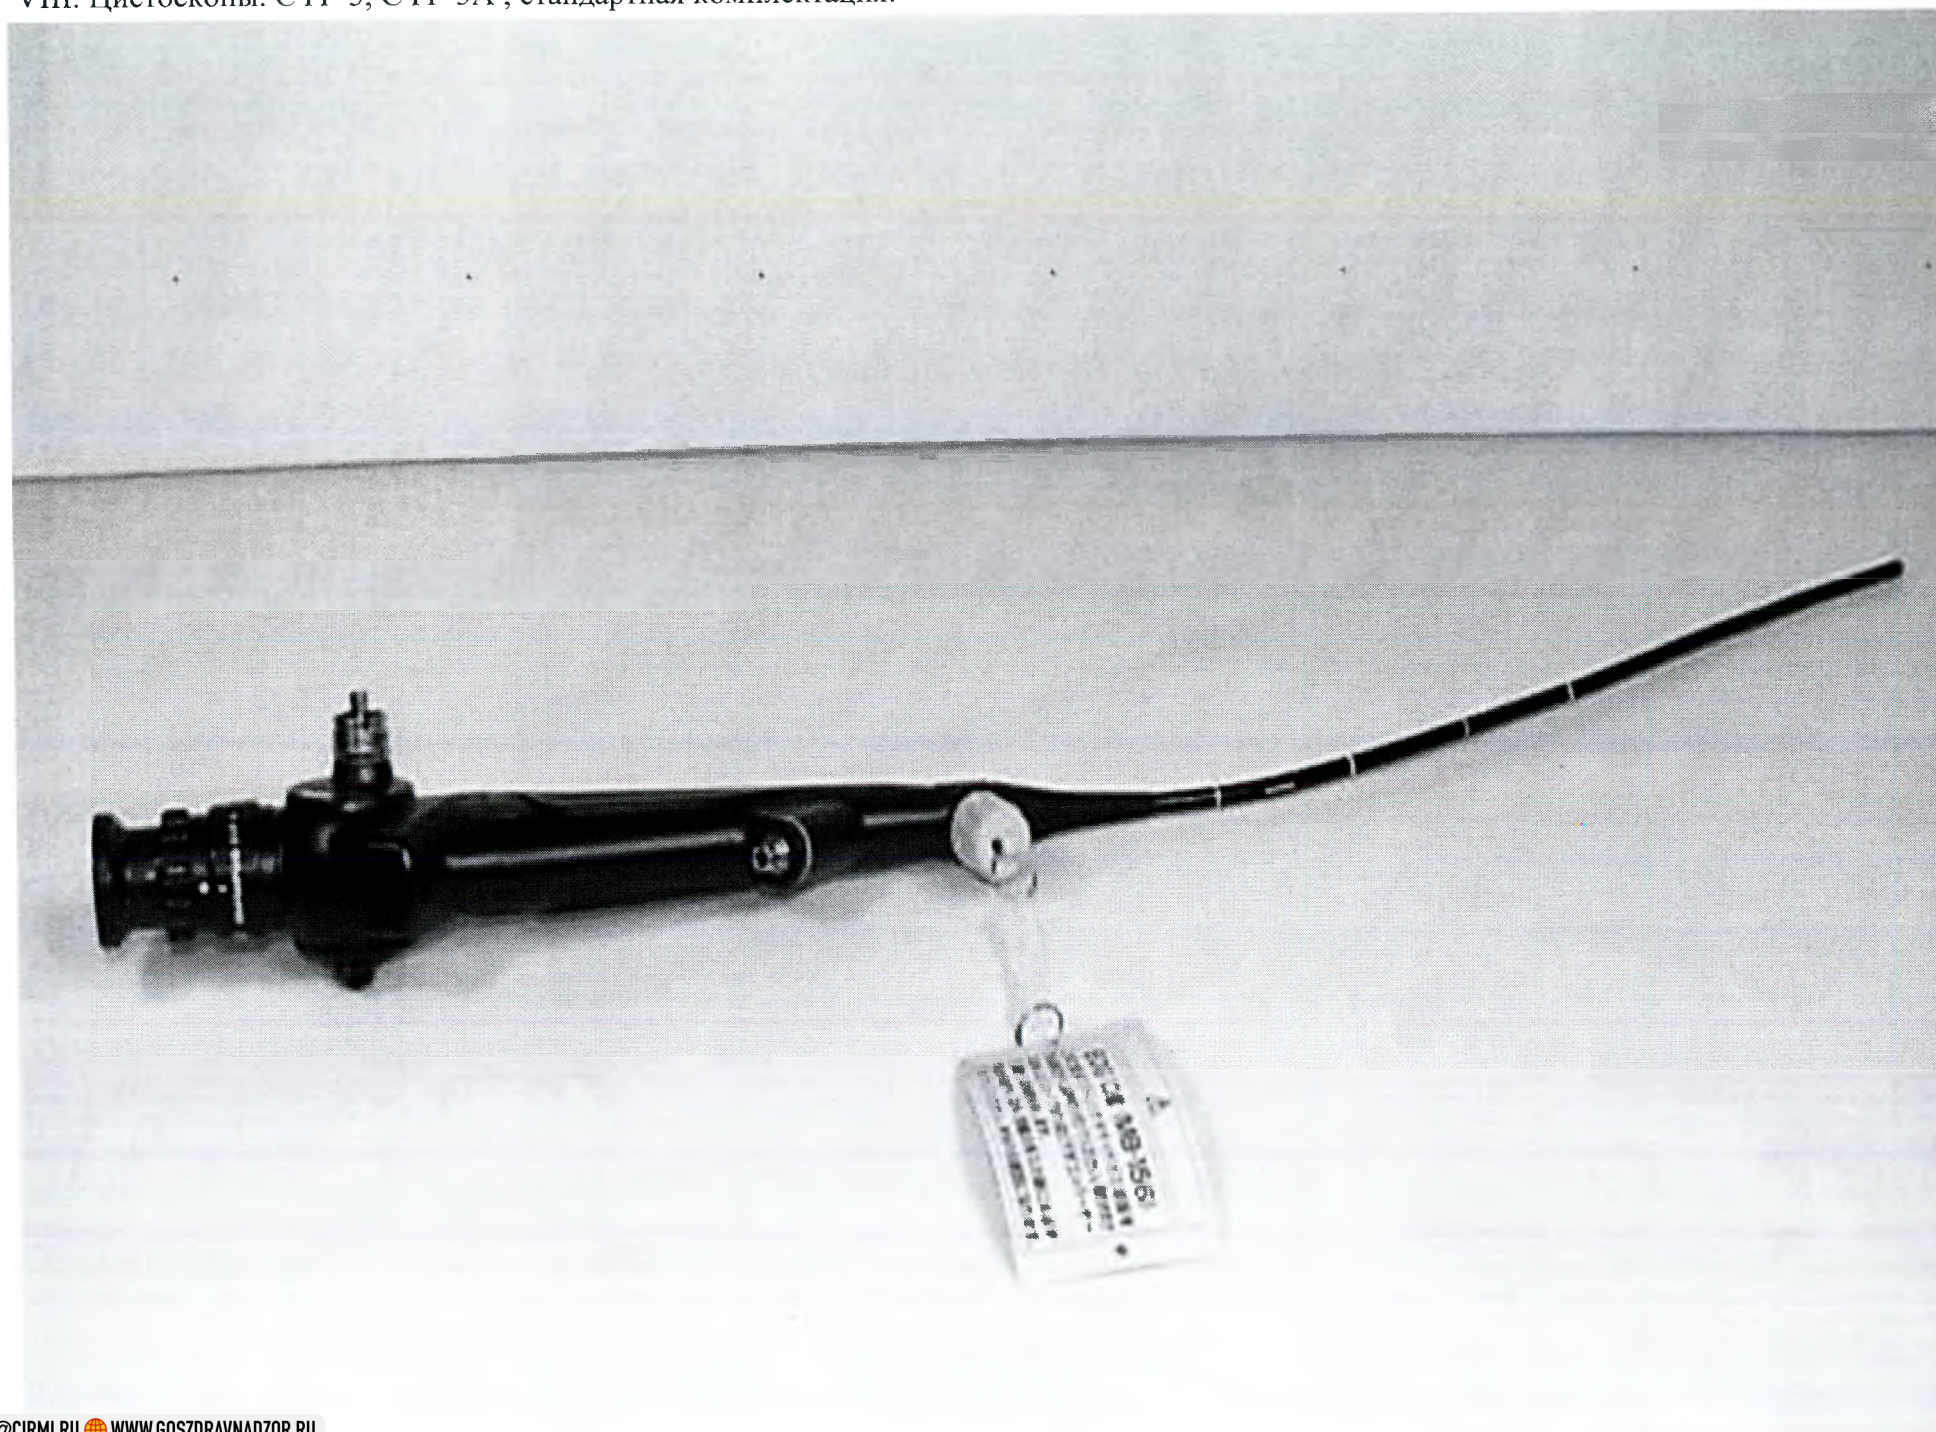

VIII. Цистоскопы: CYF-5, CYF-5A ; макет маркировки:

Артикул	CYF-5
Наименование	Эндоскопы гибкие с принадлежностями Цистоскопы
Производитель	«Олимпас Медикал Системс Корп.»
Адрес производителя	43-2, Хатагая 2-Чоум, Шибую-ку, Токио,
Страна происхождения	Япония
Регистрационное удостоверение	Эндоскопы гибкие с принадлежностями РУ № РЗН 2015/3464 от 30 мая 2017 года
Уполномоченный представитель	ООО «Олимпас Москва», 107023, г. Москва ,ул. Электрозаводская, д.27, стр.8, т. 8-495-926-7077
 SN	зав. № 2765851
 LOT	Номер партии см. на упаковке (опционально)
	дата производства – 2017 г.,
	Место производства, см. на упаковке
	Срок годности см. на упаковке (опционально)
	Технические характеристики продукта и его количество см. на упаковке
Дополнительная информация, опционально, см. на упаковке.	
	Не использовать повторно
	Метод стерилизации
	Не стерилизовать повторно
	Не использовать при поврежденной упаковке
	Соблюдение интервала температур
	Беречь от влаги
	максимальная ширина рабочей части
	минимальная ширина инструментального канала
	рабочая длина
	поле зрения и /или направление наблюдения
	Ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации


VIII. Цистоскопы: Цистовидеоскопы CYF-V2, CYF-VA2, CYF-VH, CYF-VHR, CYF-VHA ; стандартная комплектация:

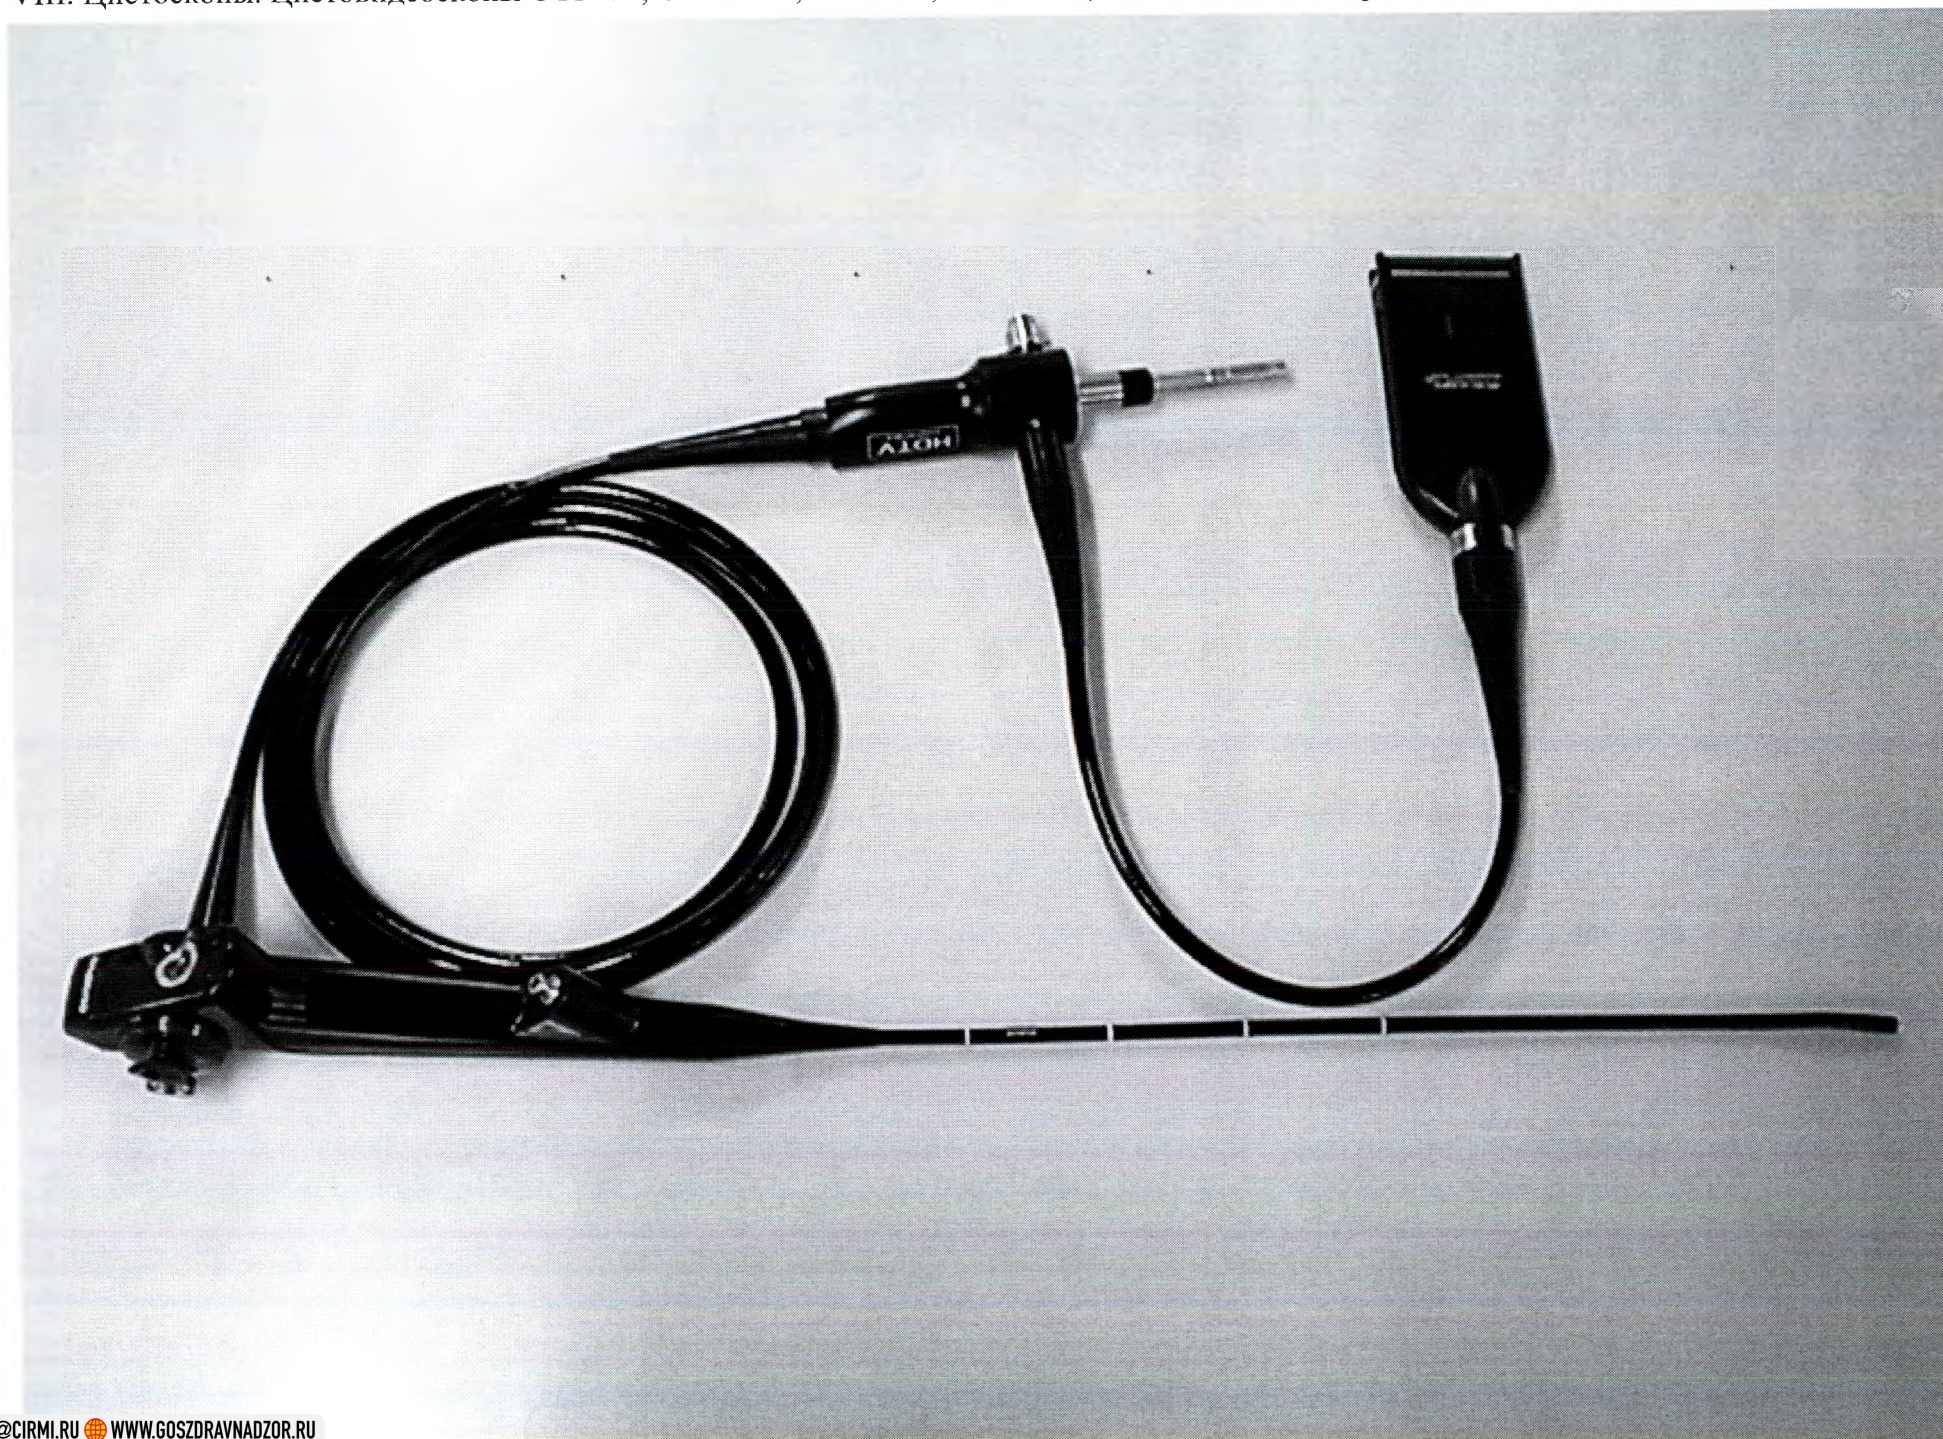

VIII. Цистоскопы: Цистовидеоскопы CYF-V2, CYF-VA2, CYF-VH, CYF-VHR, CYF-VHA ; макет маркировки:

Артикул	CYF-V2
Наименование	Эндоскопы гибкие с принадлежностями Цистоскопы: Цистовидеоскопы
Производитель	«Олимпас Медикал Системс Корп.»
Адрес производителя	43-2, Хатагая 2-Чоум, Шибую-ку, Токио,
Страна происхождения	Япония
Регистрационное удостоверение	Эндоскопы гибкие с принадлежностями РУ № РЗН 2015/3464 от 30 мая 2017 года
Уполномоченный представитель	ООО «Олимпас Москва», 107023, г. Москва ,ул. Электрозаводская, д.27, стр.8, т. 8-495-926-7077
 SN	зав. № 2765851
 LOT	Номер партии см. на упаковке (опционально)
	дата производства – 2017 г.,
	Место производства, см. на упаковке
	Срок годности см. на упаковке (опционально)
	Технические характеристики продукта и его количество см. на упаковке
Дополнительная информация, опционально, см. на упаковке.	
	Не использовать повторно
	Метод стерилизации
	Не стерилизовать повторно
	Не использовать при поврежденной упаковке
	Соблюдение интервала температур
	Беречь от влаги
	максимальная ширина рабочей части
	минимальная ширина инструментального канала
	рабочая длина
	поле зрения и /или направление наблюдения
 	Ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации


IX. Гистерофиброскопы: НУФ-1Т, НУФ-ХР; стандартная комплектация:

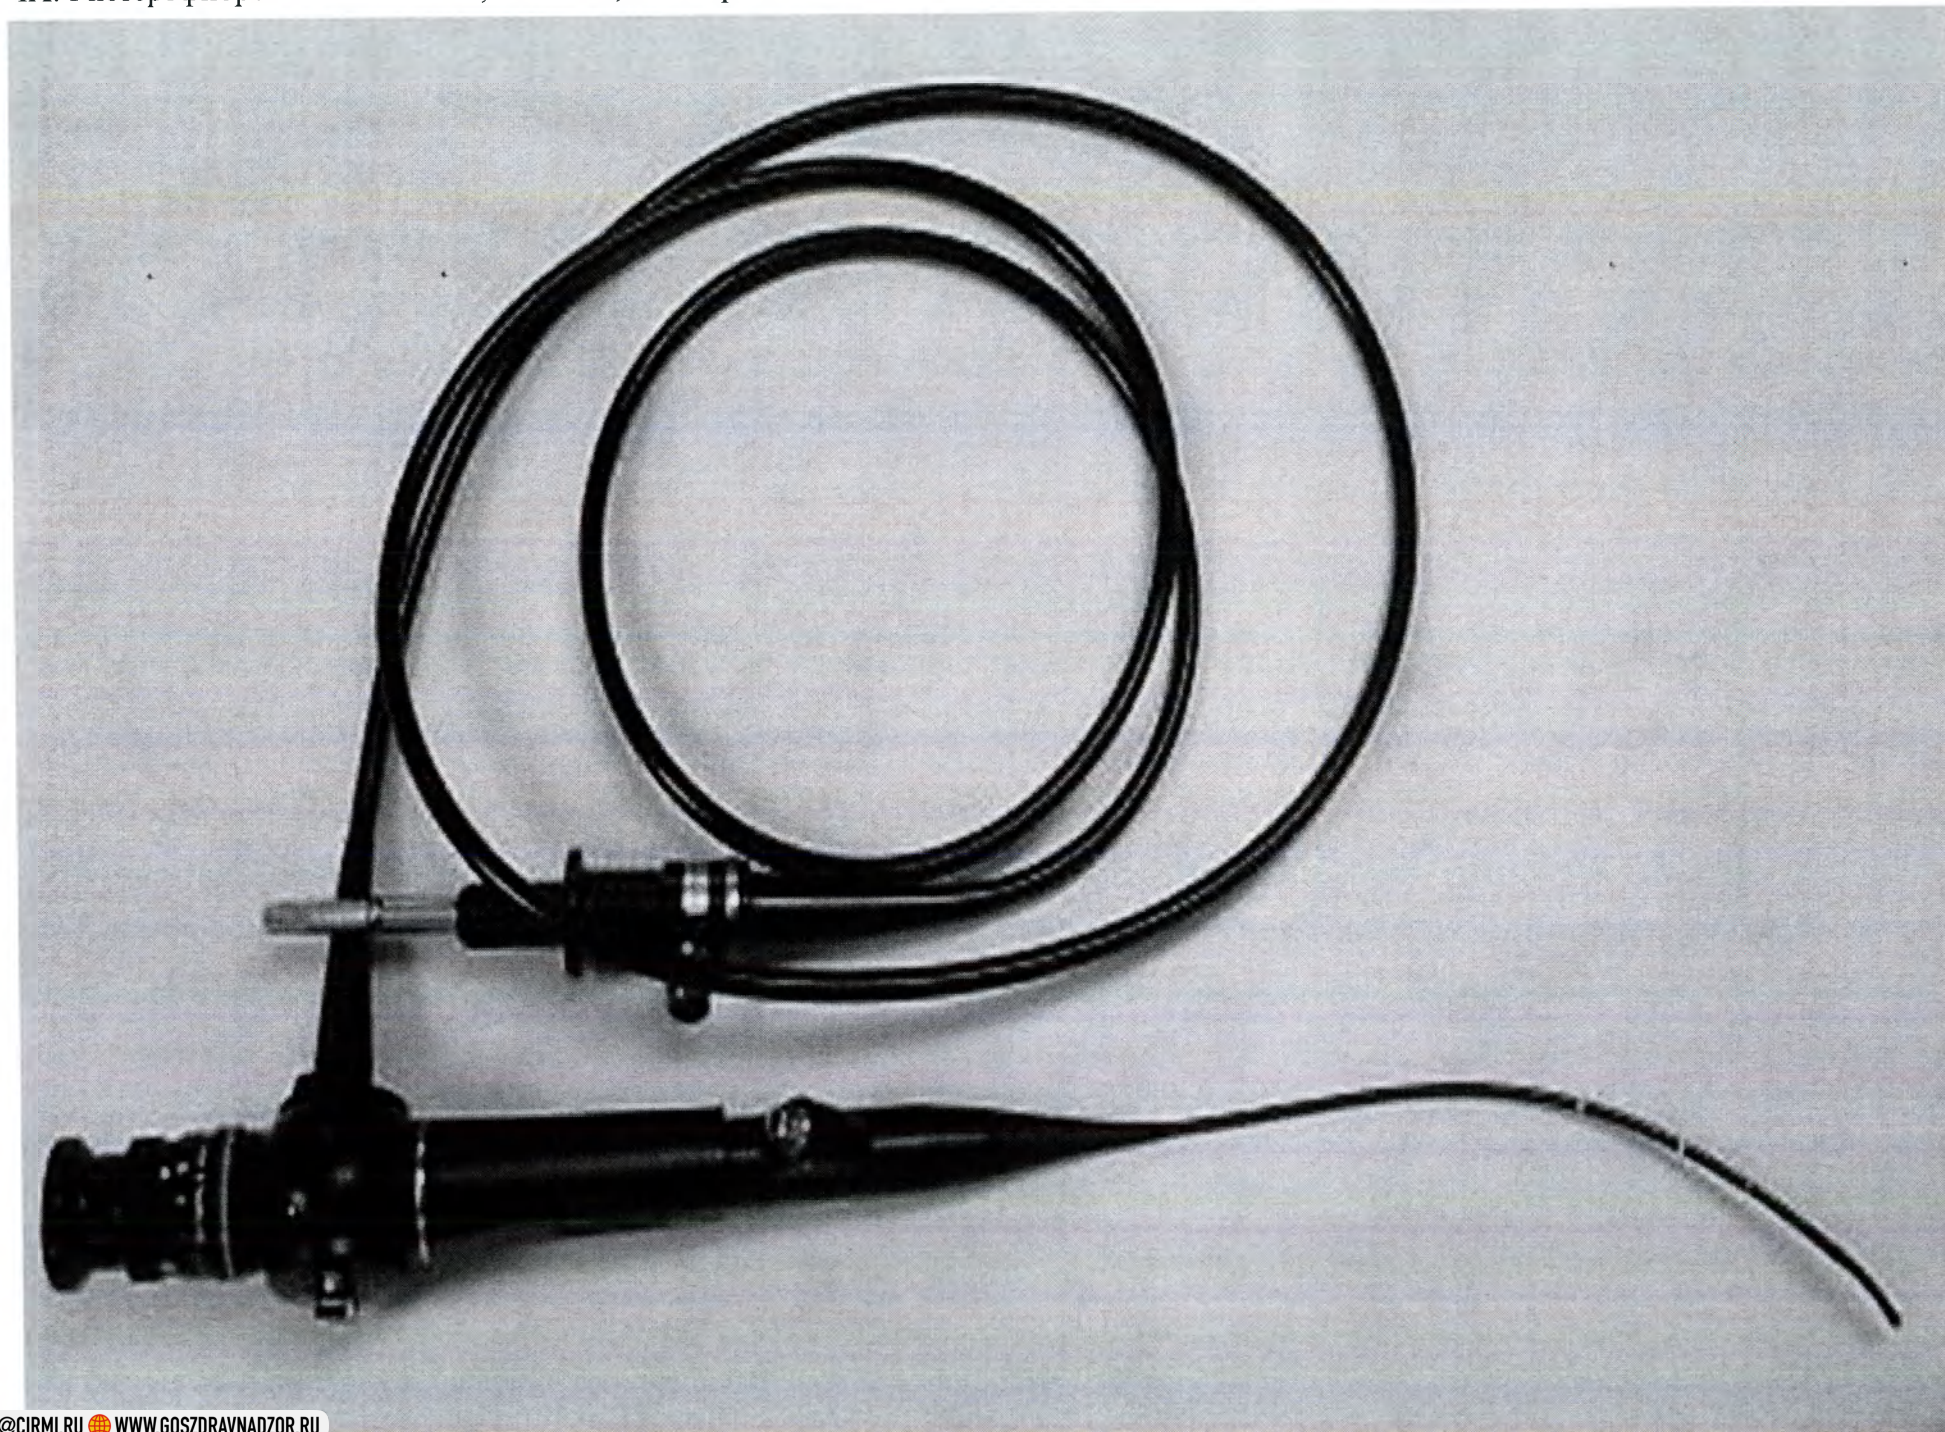

IX. Гистерофиброскопы: НУF-1Т, НУF-ХР; макет маркировки:

Артикул	НУF-1Т
Наименование	Эндоскопы гибкие с принадлежностями Гистерофиброскопы
Производитель	«Олимпас Медикал Системс Корп.»
Адрес производителя	43-2, Хатагая 2-Чоум, Шибую-ку, Токио,
Страна происхождения	Япония
Регистрационное удостоверение	Эндоскопы гибкие с принадлежностями РУ № РЗН 2015/3464 от 30 мая 2017 года
Уполномоченный представитель	ООО «Олимпас Москва», 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д.27, стр.8, т. 8-495-926-7077
 SN	зав. № 2765851
 LOT	Номер партии см. на упаковке (опционально)
	дата производства – 2017 г.,
	Место производства, см. на упаковке
	Срок годности см. на упаковке (опционально)
	Технические характеристики продукта и его количество см. на упаковке
Дополнительная информация, опционально, см. на упаковке.	
	Не использовать повторно
	Метод стерилизации
	Не стерилизовать повторно
	Не использовать при поврежденной упаковке
	Соблюдение интервала температур
	Беречь от влаги
	максимальная ширина рабочей части
	минимальная ширина инструментального канала
	рабочая длина
	поле зрения и /или направление наблюдения
	Ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации

Х. Уретерореноскопы: Уретероренофиброскопы URF-P5, URF-P6, URF-P6R, URF-P7, URF-V3 стандартная комплектация:

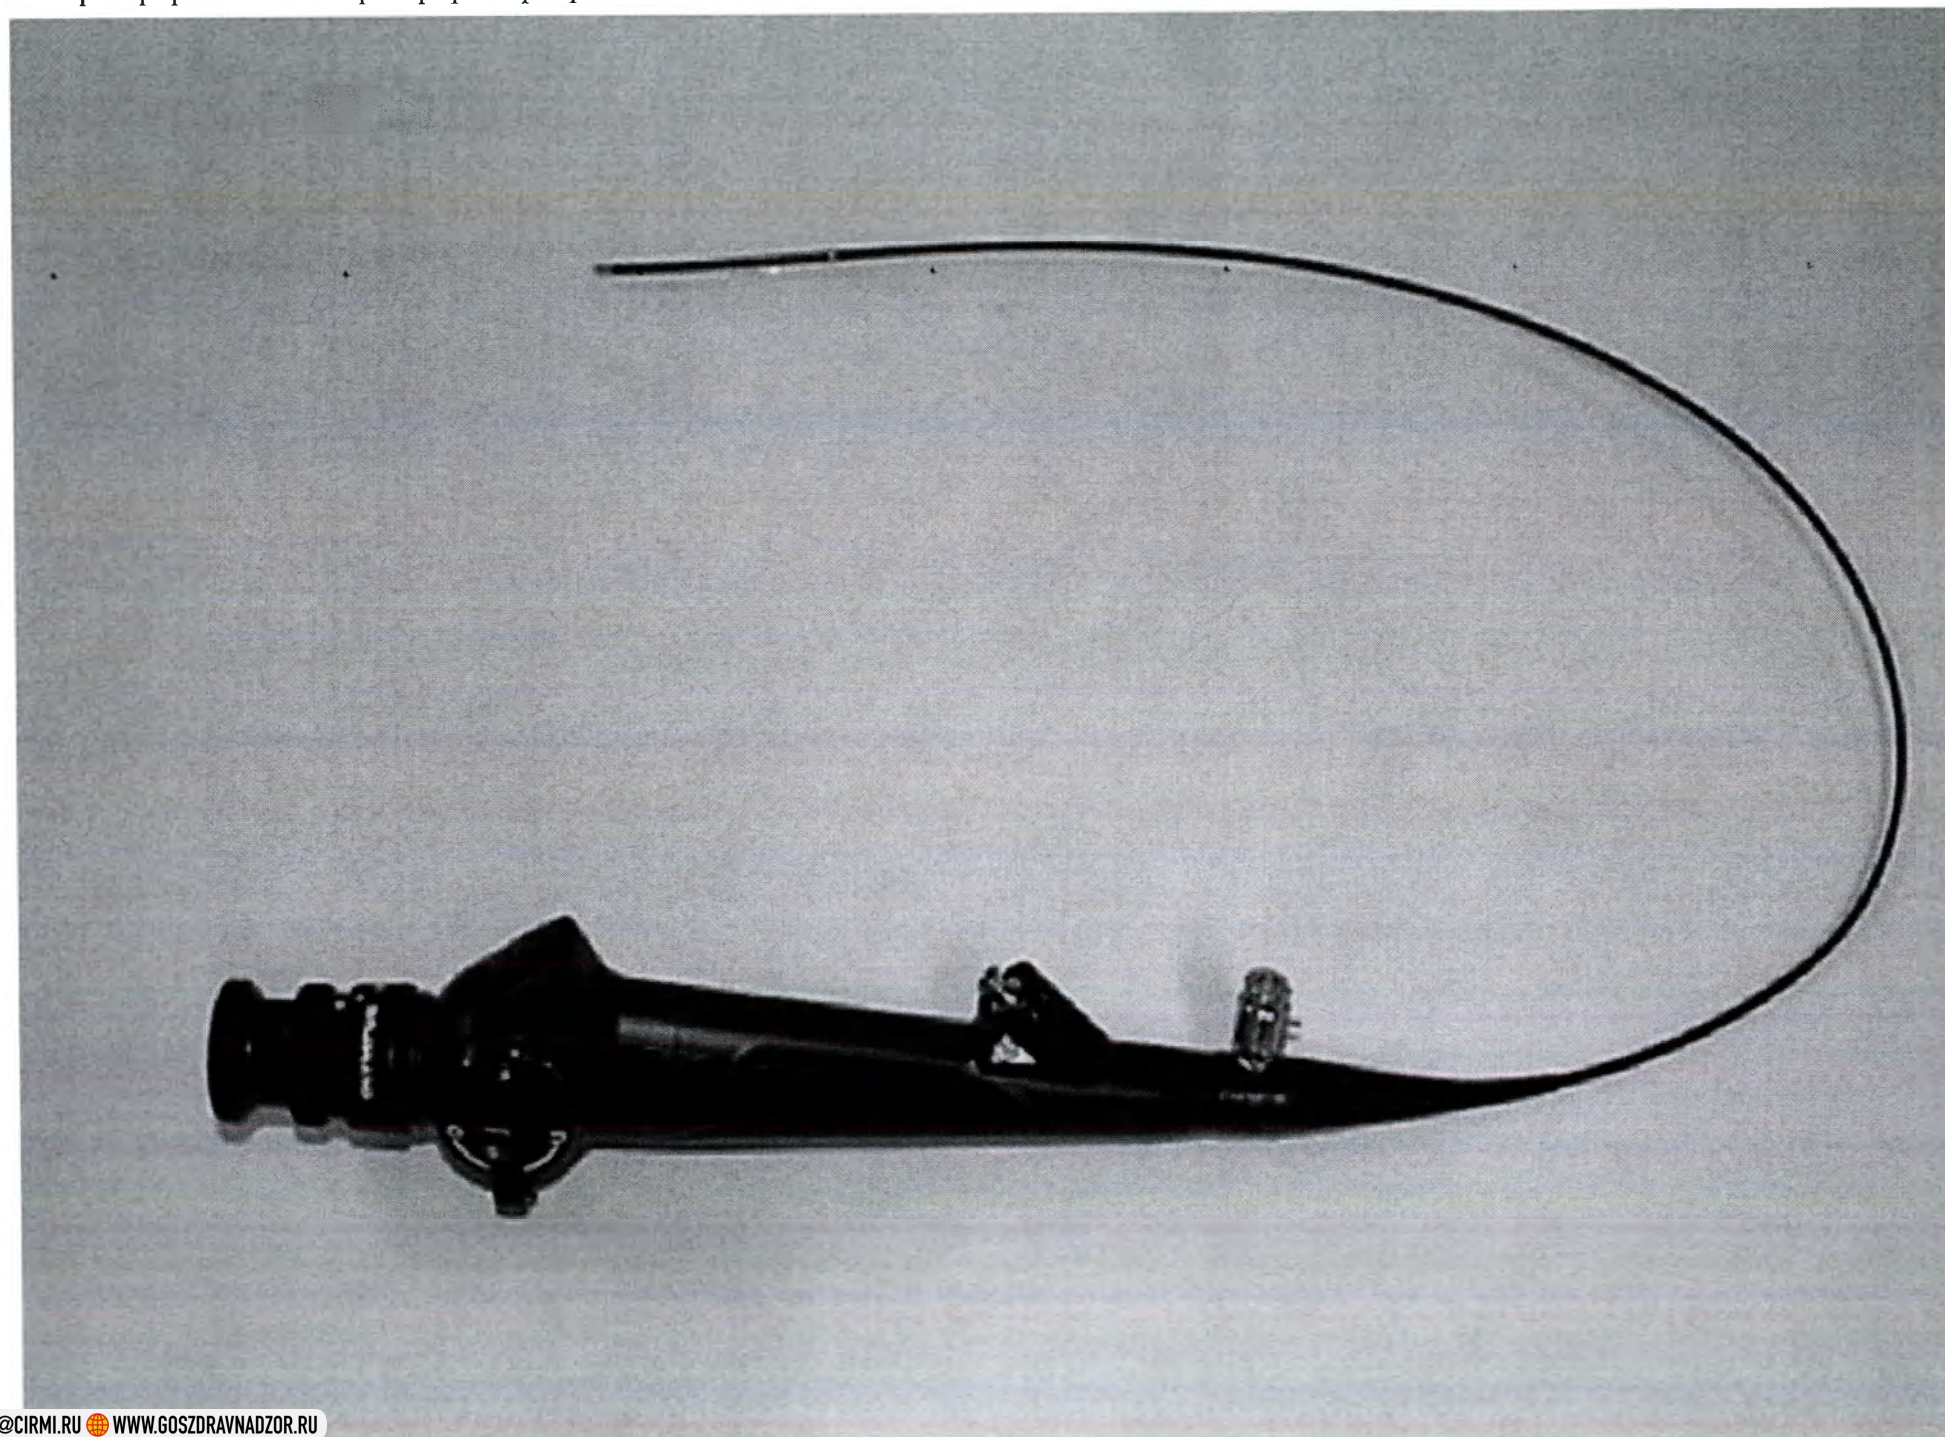


Х. Уретерореноскопы: Уретероренофиброскопы URF-P5, URF-P6, URF-P6R, URF-P7, URF-V3 макет маркировки:

Артикул	URF-P5
Наименование	Эндоскопы гибкие с принадлежностями Уретерореноскопы: Уретероренофиброскопы
Производитель	«Олимпас Медикал Системс Корп.»
Адрес производителя	43-2, Хатагая 2-Чоум, Шибую-ку, Токио,
Страна происхождения	Япония
Регистрационное удостоверение	Эндоскопы гибкие с принадлежностями РУ № РЗН 2015/3464 от 30 мая 2017 года
Уполномоченный представитель	ООО «Олимпас Москва», 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д.27, стр.8, т. 8-495-926-7077
 SN	зав. № 2765851
 LOT	Номер партии см. на упаковке (опционально)
	дата производства – 2017 г.,
	Место производства, см. на упаковке
	Срок годности см. на упаковке (опционально)
	Технические характеристики продукта и его количество см. на упаковке
Дополнительная информация, опционально, см. на упаковке.	
	Не использовать повторно
	Метод стерилизации
	Не стерилизовать повторно
	Не использовать при поврежденной упаковке
	Соблюдение интервала температур
	Беречь от влаги
	максимальная ширина рабочей части
	минимальная ширина инструментального канала
	рабочая длина
	поле зрения и /или направление наблюдения
 	Ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации

Х. Уретерореноскопы: Уретерореновидеоскопы URF-V2, URF-V2R; стандартная комплектация:




XI. Тораковидеоскопы LTF-VP; стандартная комплектация:

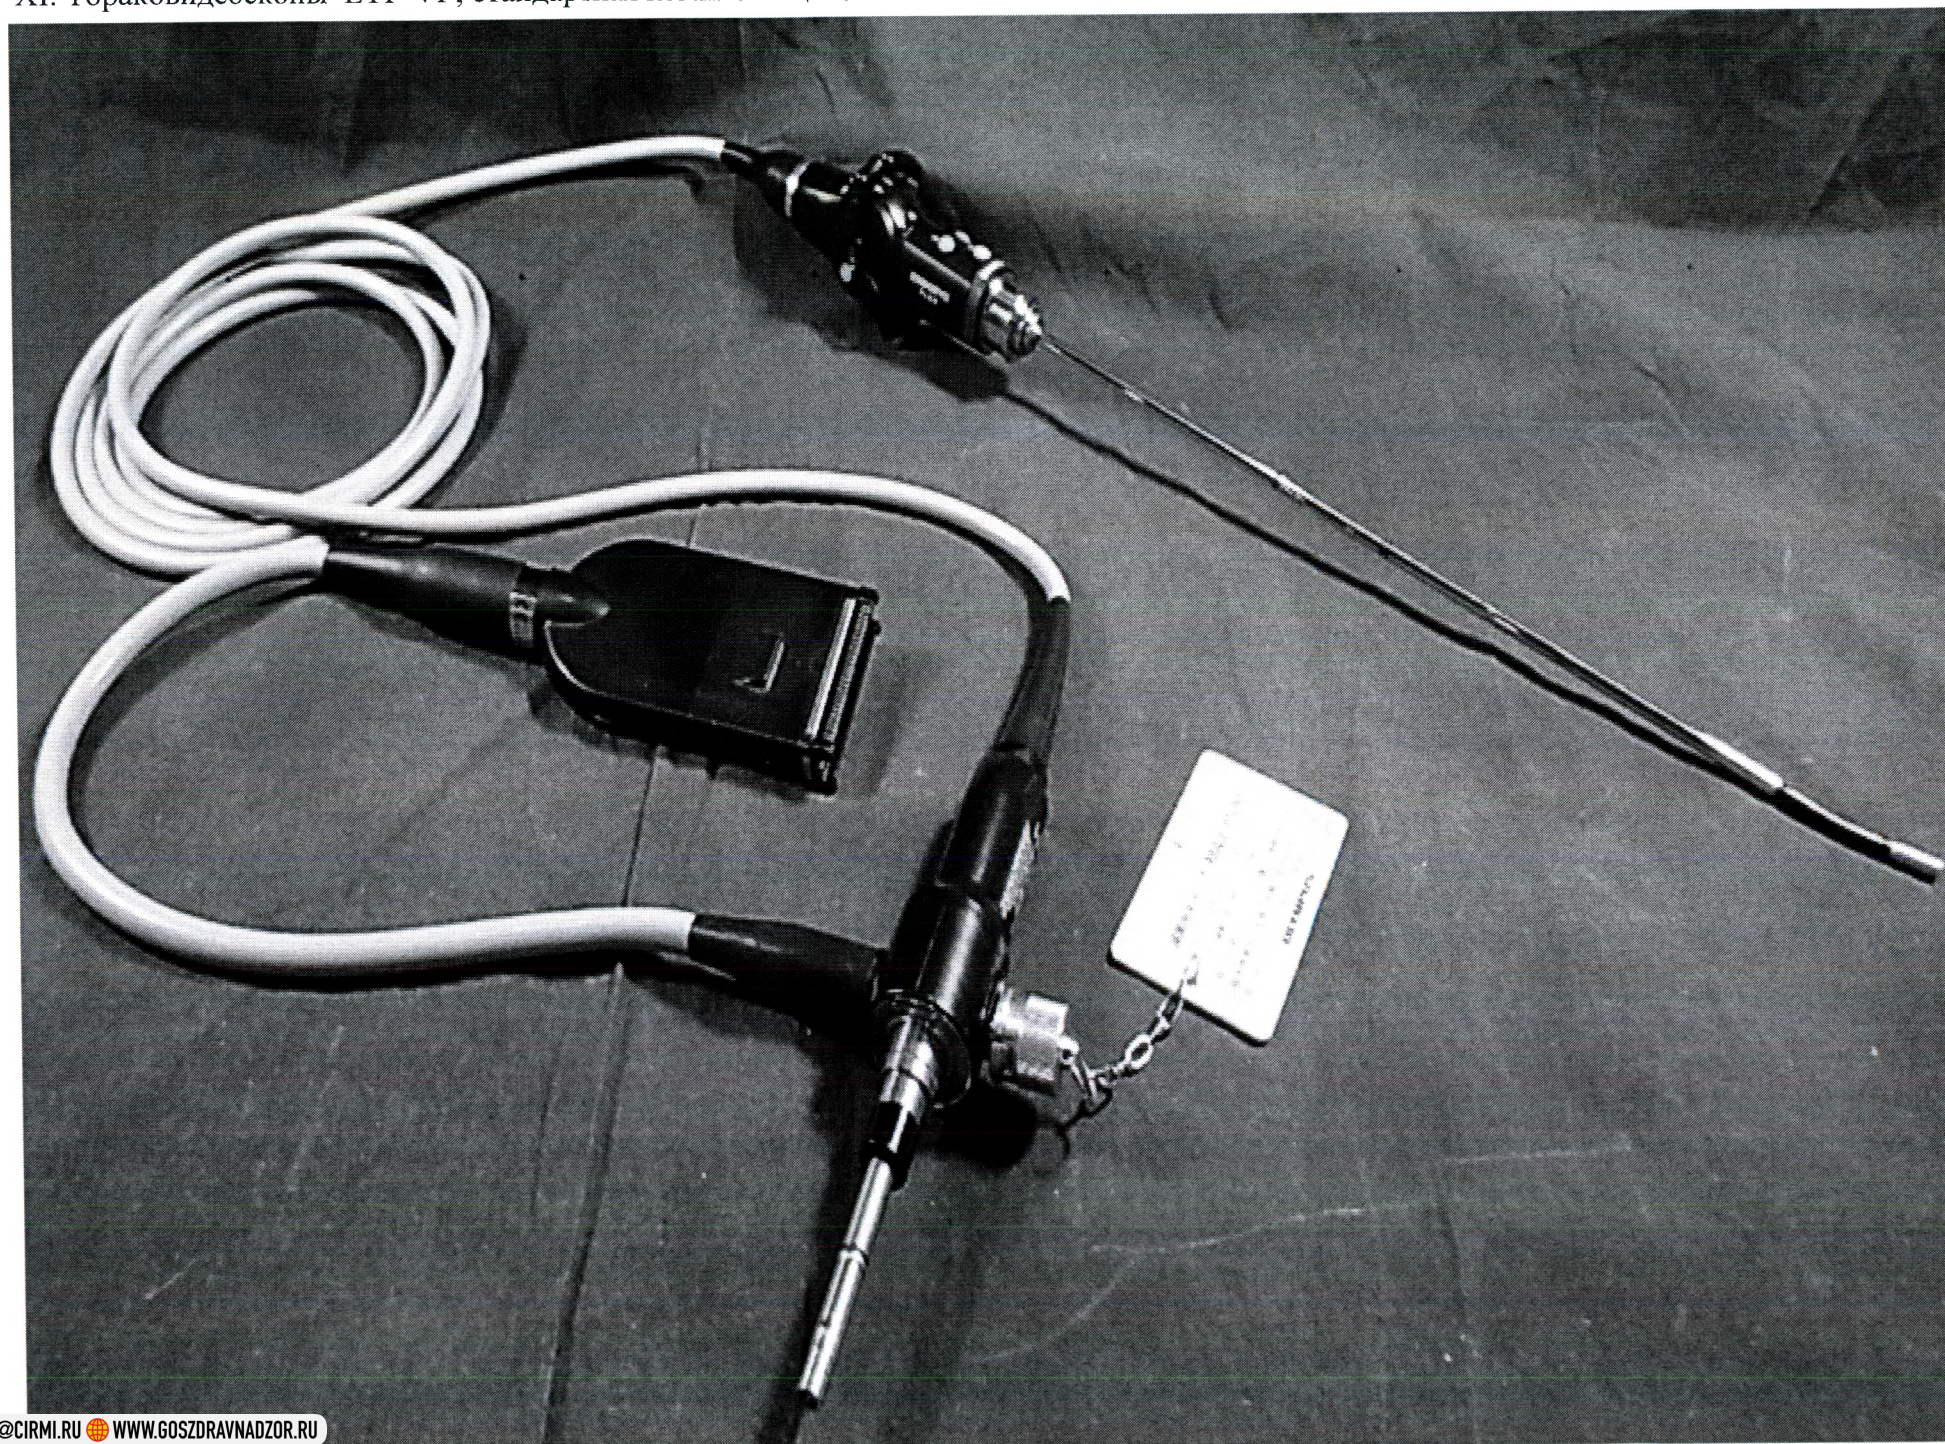

XI. Тораковидеоскопы LTF-VP; макет маркировки:

Артикул	LTF-VP
Наименование	Эндоскопы гибкие с принадлежностями Торакови-деоскопы
Производитель	«Олимпас Медикал Системс Корп.»
Адрес производителя	43-2, Хатагая 2-Чоум, Шибую-ку, Токио,
Страна происхождения	Япония
Регистрационное удостоверение	Эндоскопы гибкие с принадлежностями РУ № РЗН 2015/3464 от 30 мая 2017 года
Уполномоченный представитель	ООО «Олимпас Москва», 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д.27, стр.8, т. 8-495-926-7077
 SN	зав. № 2765851
 LOT	Номер партии см. на упаковке (опционально)
	дата производства – 2017 г.,
	Место производства, см. на упаковке
	Срок годности см. на упаковке (опционально)
	Технические характеристики продукта и его количество см. на упаковке
Дополнительная информация, опционально, см. на упаковке.	
	Не использовать повторно
	Метод стерилизации
	Не стерилизовать повторно
	Не использовать при поврежденной упаковке
	Соблюдение интервала температур
	Беречь от влаги
	максимальная ширина рабочей части
	минимальная ширина инструментального канала
	рабочая длина
	поле зрения и /или направление наблюдения
 	Ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации


ХII. Видеоскопы: LTF-S190-10, LTF-S190-5, LTF-S300-10-3D, LTF-10-3D-JS, LTF-S200-5, LTF-5-JS; стандартная комплектация:

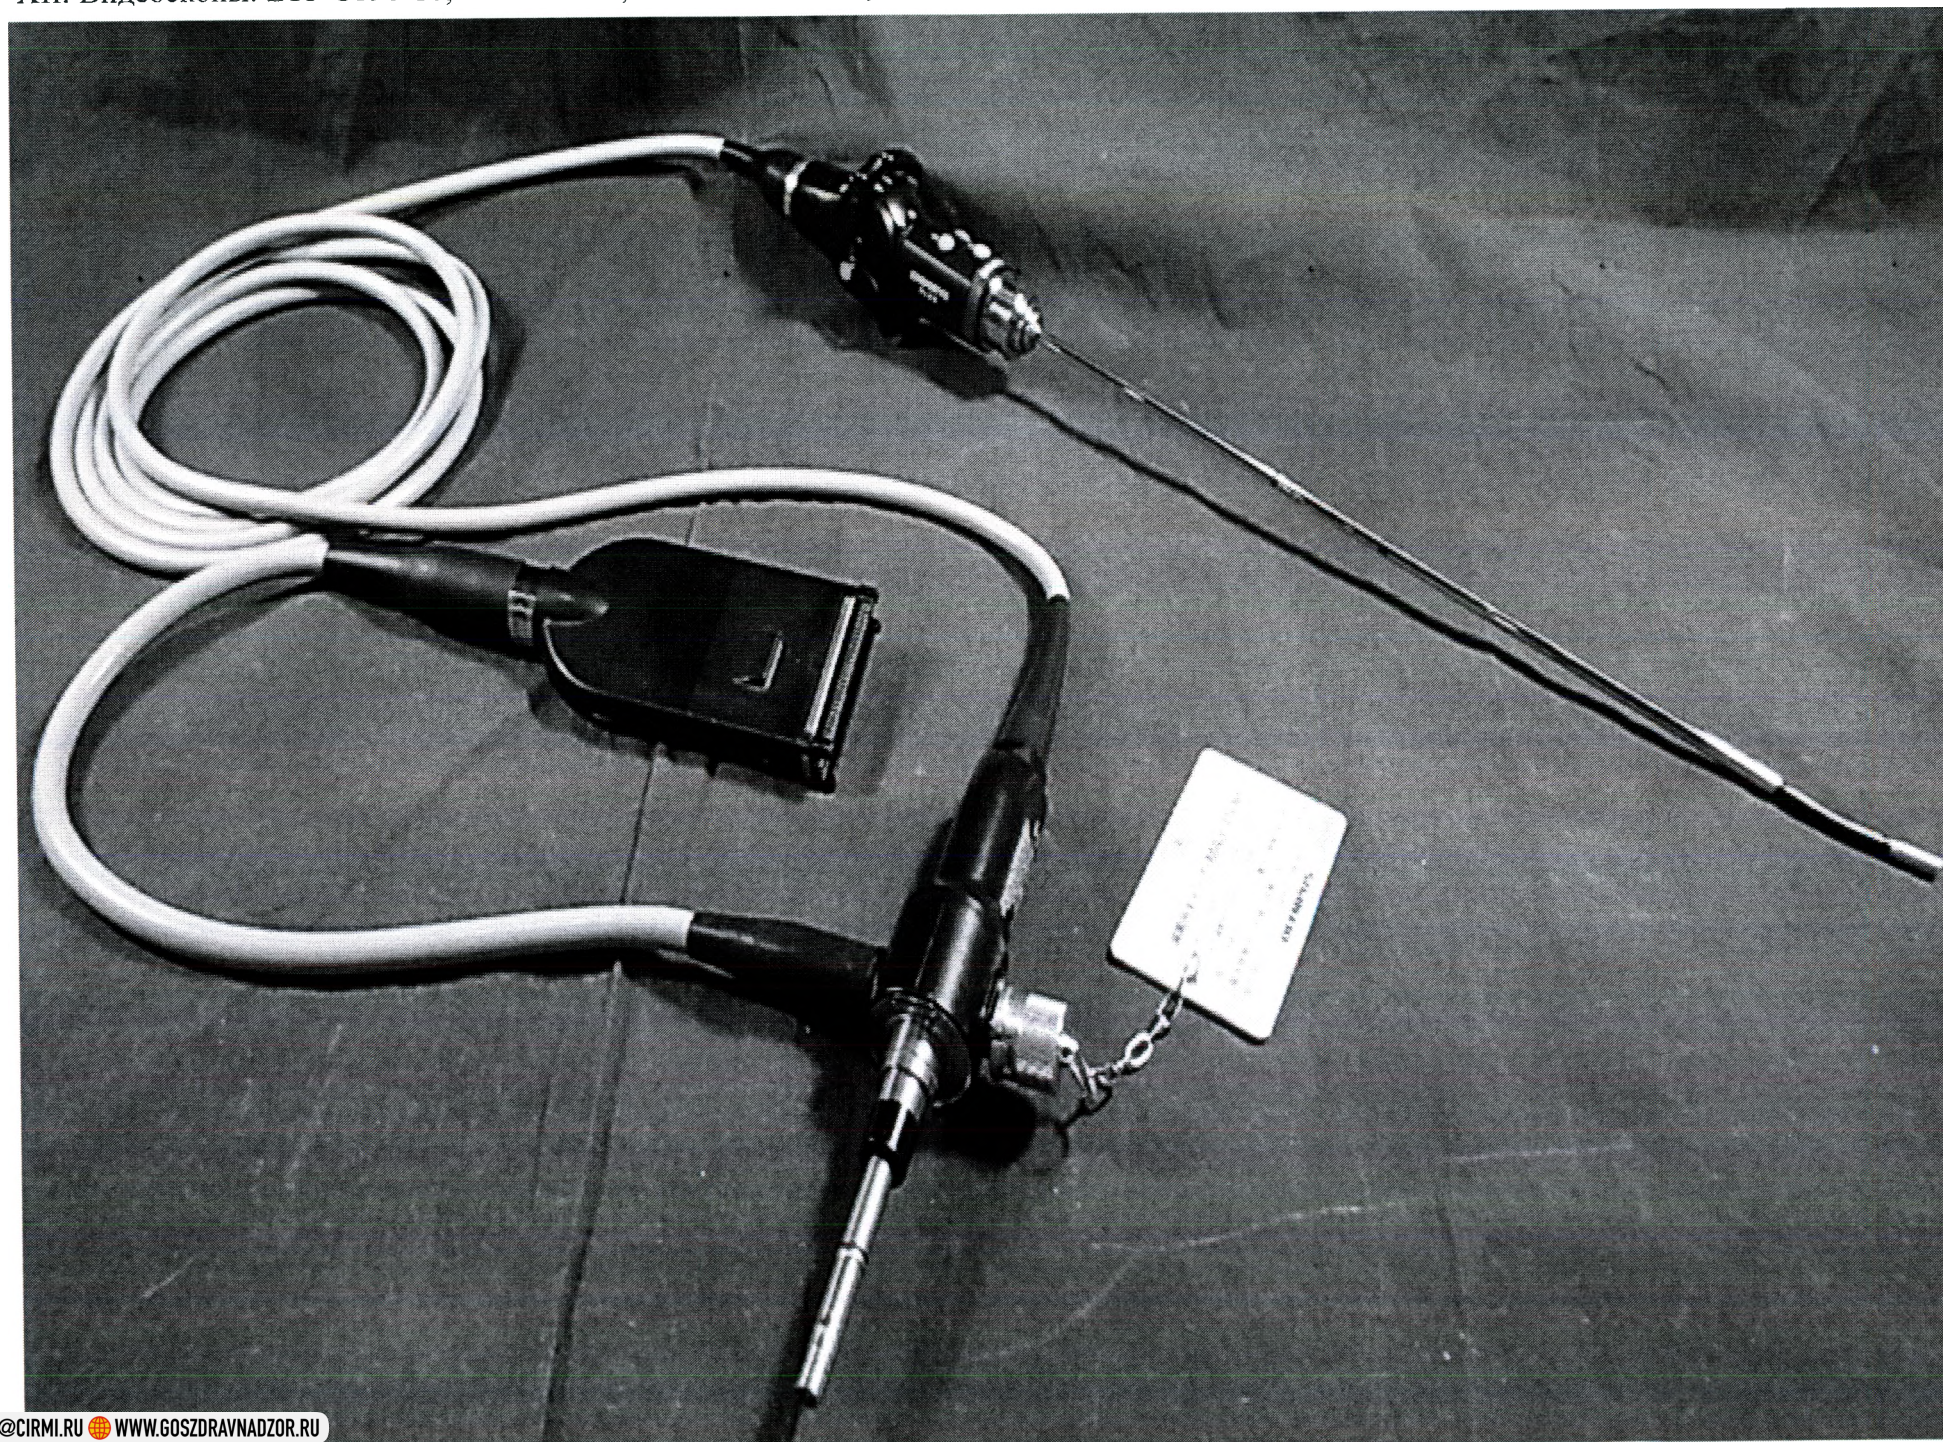

ХII. Видеоскопы: LTF-S190-10, LTF-S190-5, LTF-S300-10-3D, LTF-10-3D-JS, LTF-S200-5, LTF-5-JS; макет маркировки:

Артикул	LTF-S190-10
Наименование	Эндоскопы гибкие с принадлежностями Видеоскопы
Производитель	«Олимпас Медикал Системс Корп.»
Адрес производителя	43-2, Хатагая 2-Чоум, Шибую-ку, Токио,
Страна происхождения	Япония
Регистрационное удостоверение	Эндоскопы гибкие с принадлежностями РУ № РЗН 2015/3464 от 30 мая 2017 года
Уполномоченный представитель	ООО «Олимпас Москва», 107023, г. Москва, ул. Электrozаводская, д.27, стр.8, т. 8-495-926-7077
	зав. № 2765851
	Номер партии см. на упаковке (опционально)
	дата производства – 2017 г.,
	Место производства, см. на упаковке
	Срок годности см. на упаковке (опционально)
	Технические характеристики продукта и его количество см. на упаковке
Дополнительная информация, опционально, см. на упаковке.	
	Не использовать повторно
	Метод стерилизации
	Не стерилизовать повторно
	Не использовать при поврежденной упаковке
	Соблюдение интервала температур
	Беречь от влаги
	максимальная ширина рабочей части
	минимальная ширина инструментального канала
	рабочая длина
	поле зрения и /или направление наблюдения
 	Ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации

XIII. Принадлежности: Оболочка LC-S300-10-F-3D, LC-S190-10-F

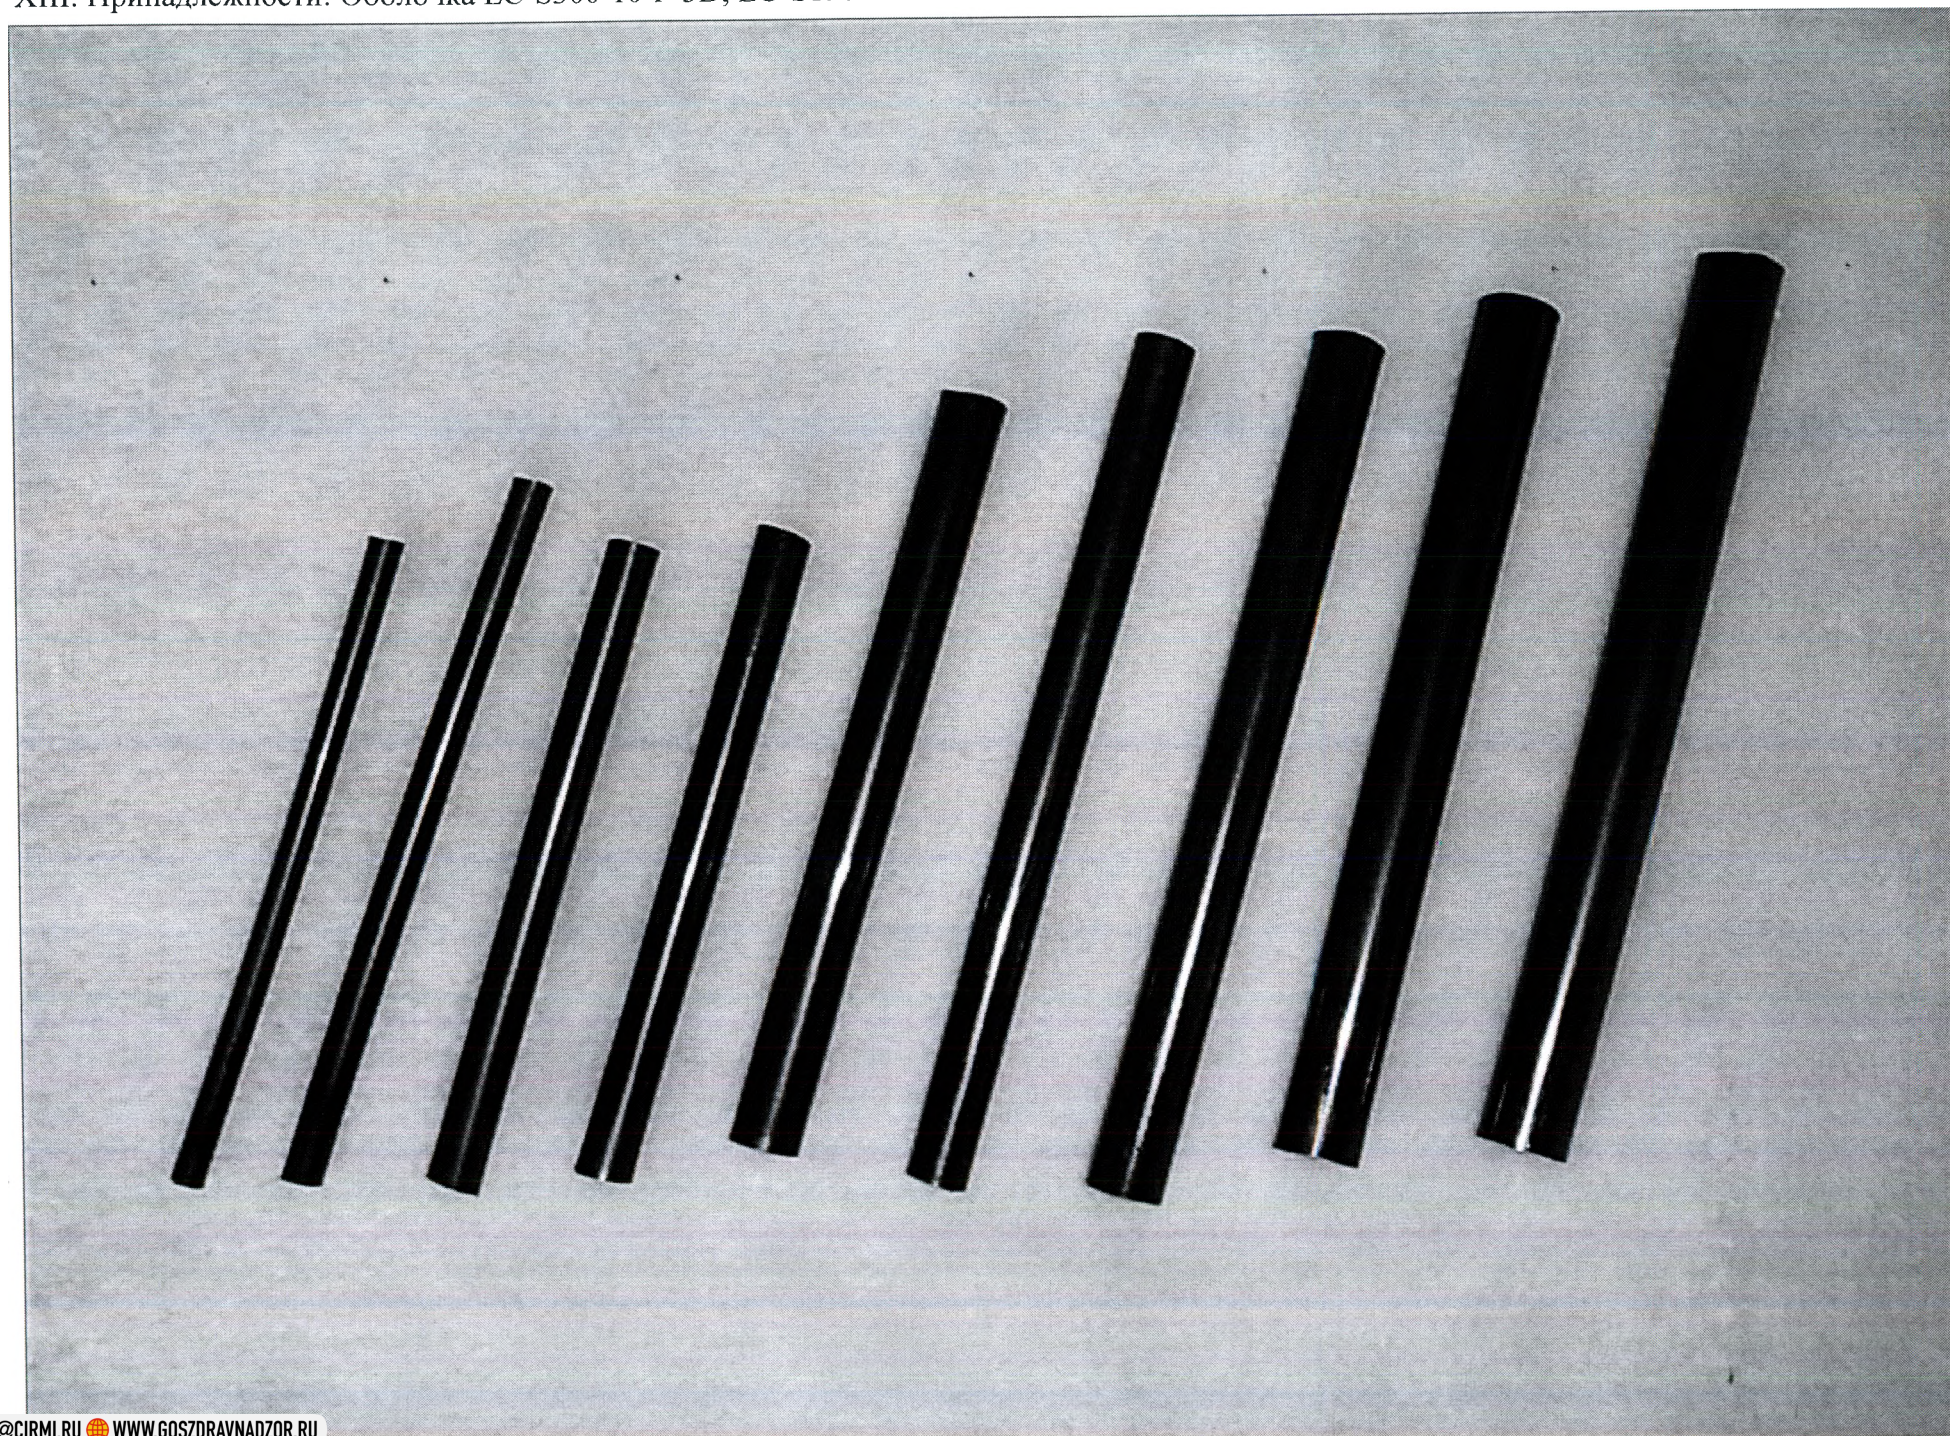

ХIII. Принадлежности: Лампа ксеноновая: MD-631, MAJ-1817.



XIII. Принадлежности: Лампа галогеновая H-lamp: MH-968, MAJ-525.



Пронумеровано, прошнуровано, прошито
и скреплено печатью

47 (срок сессии)

____ листов

Генеральный директор
ООО «Олимпас Москва»

Олег Типольт

