

Руководитель направления по регистрации

ООО «Сименс Здравоохранение»



Е.С. Тисленко

«10» августа 2022 г.

**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

Система ультразвуковая диагностическая ACUSON SC2000 с принадлежностями



Общий вид медицинского изделия «Система ультразвуковая диагностическая ACUSON SC2000 с принадлежностями»

Базовый блок:



1. Система ультразвуковая диагностическая ACUSON SC2000 со встроенной панелью управления с буквенно-цифровой клавиатурой



2. Системное программное обеспечение

SIEMENS

ACUSON SC2000

Диагностическая ультразвуковая система
Инструкция по эксплуатации

US


11147047-01

Siemens Medical Solutions USA, Inc.

11147047-01



3. Документация пользователя на русском языке.

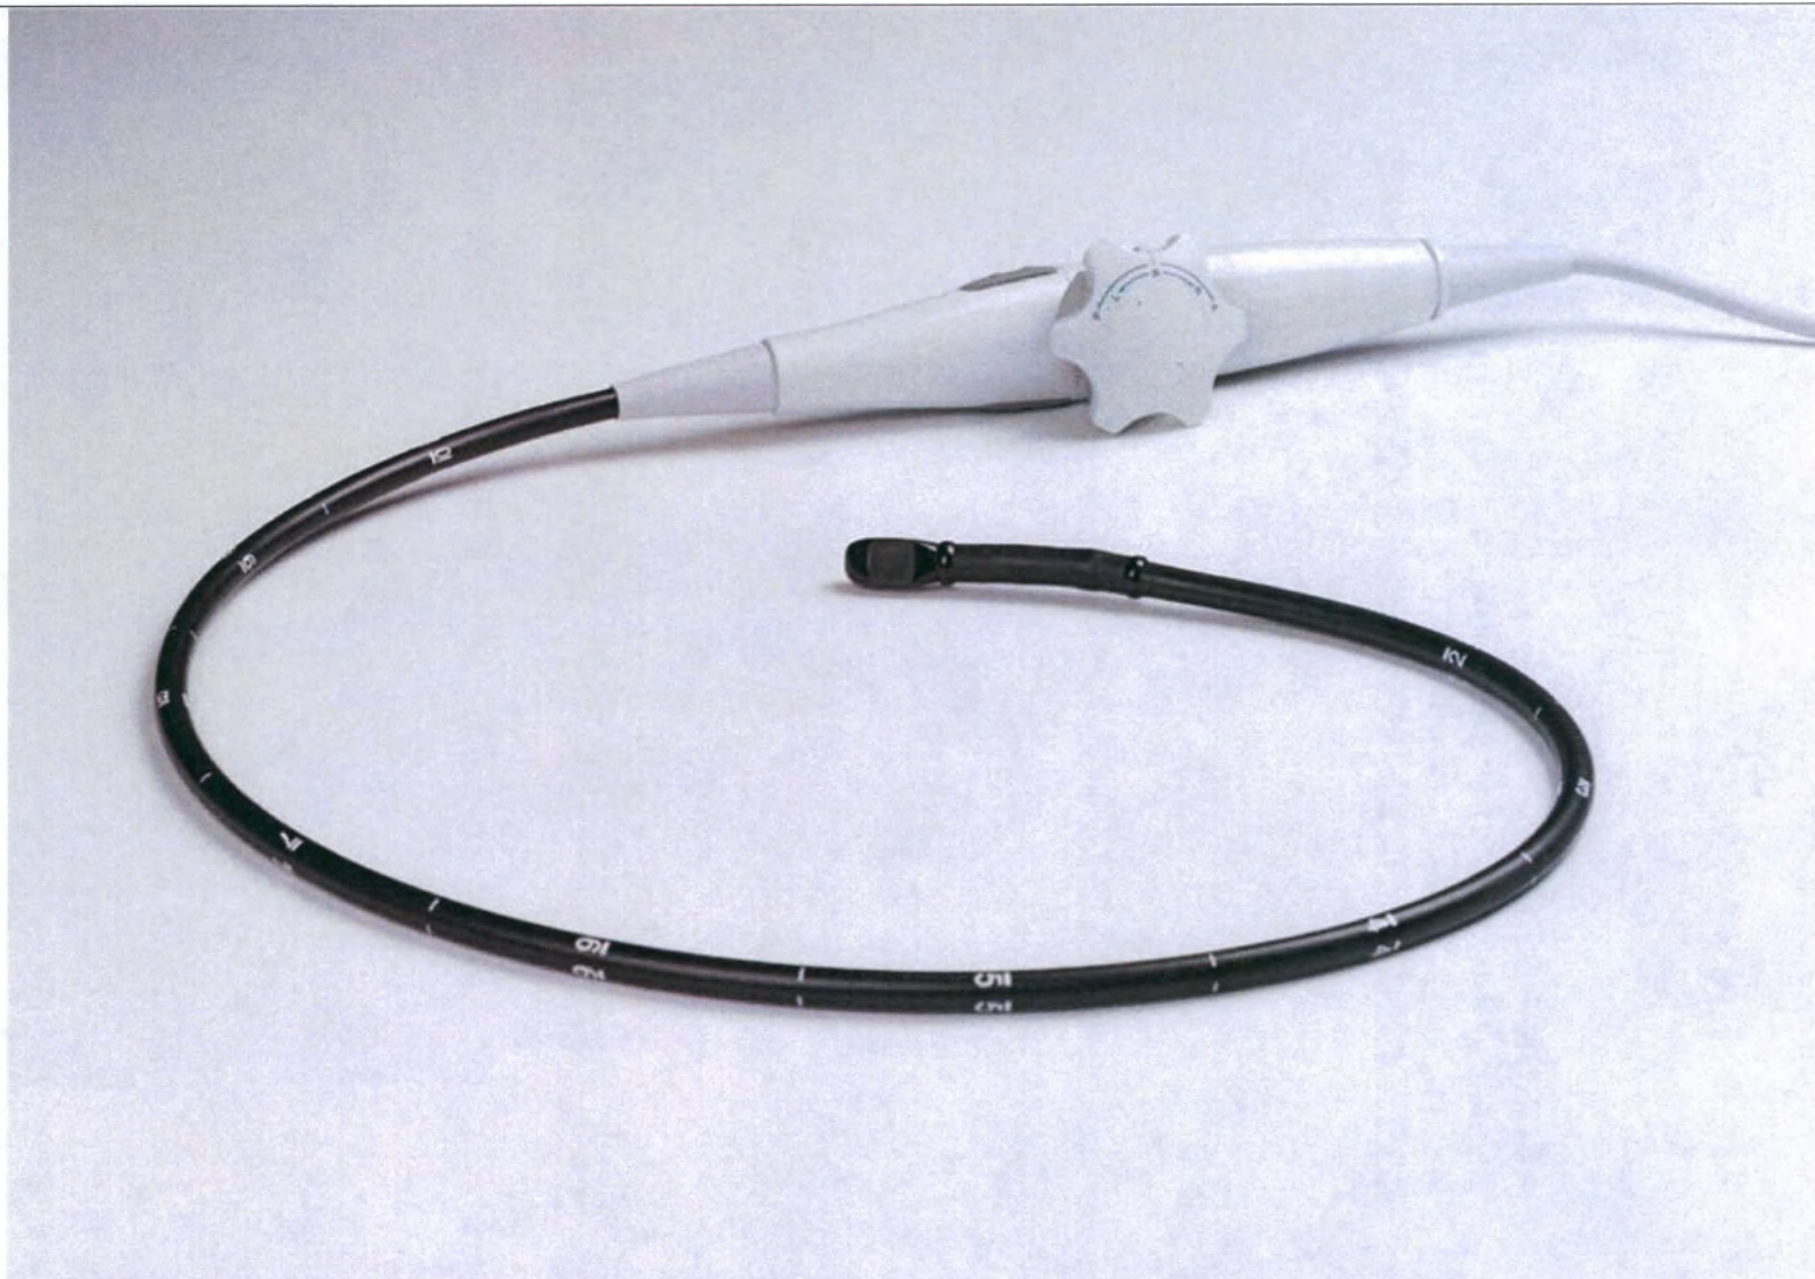


4. Датчик фазированный матричный Z6Ms, для чреспищеводных исследований в 4D



5. Датчик линейный матричный 9L4



6. Датчик фазированный матричный V7M, для чреспищеводных исследований в педиатрии

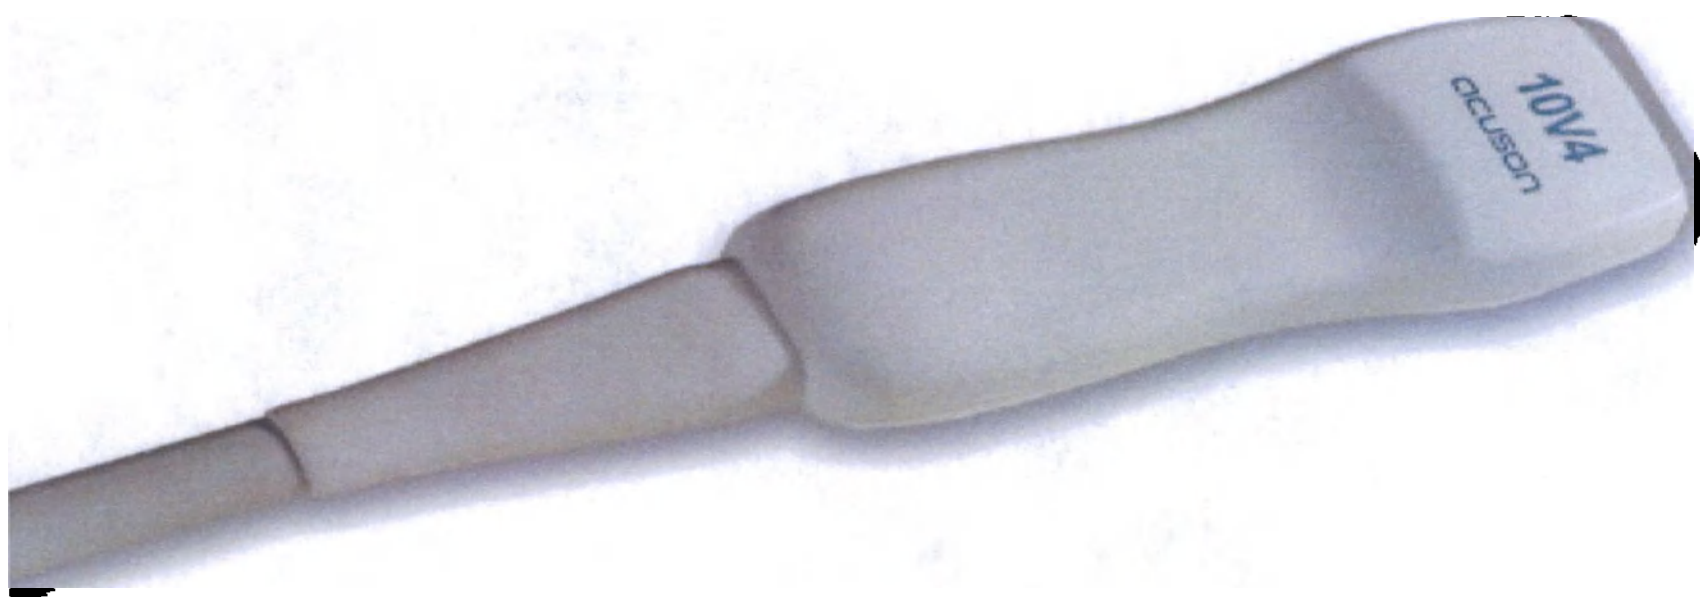


7. Датчик фазированный матричный 10V4




8. Датчик конвексный 6C1 HD



9. Датчик фазированный матричный 4Z1c, для кардиологических исследований в 4D

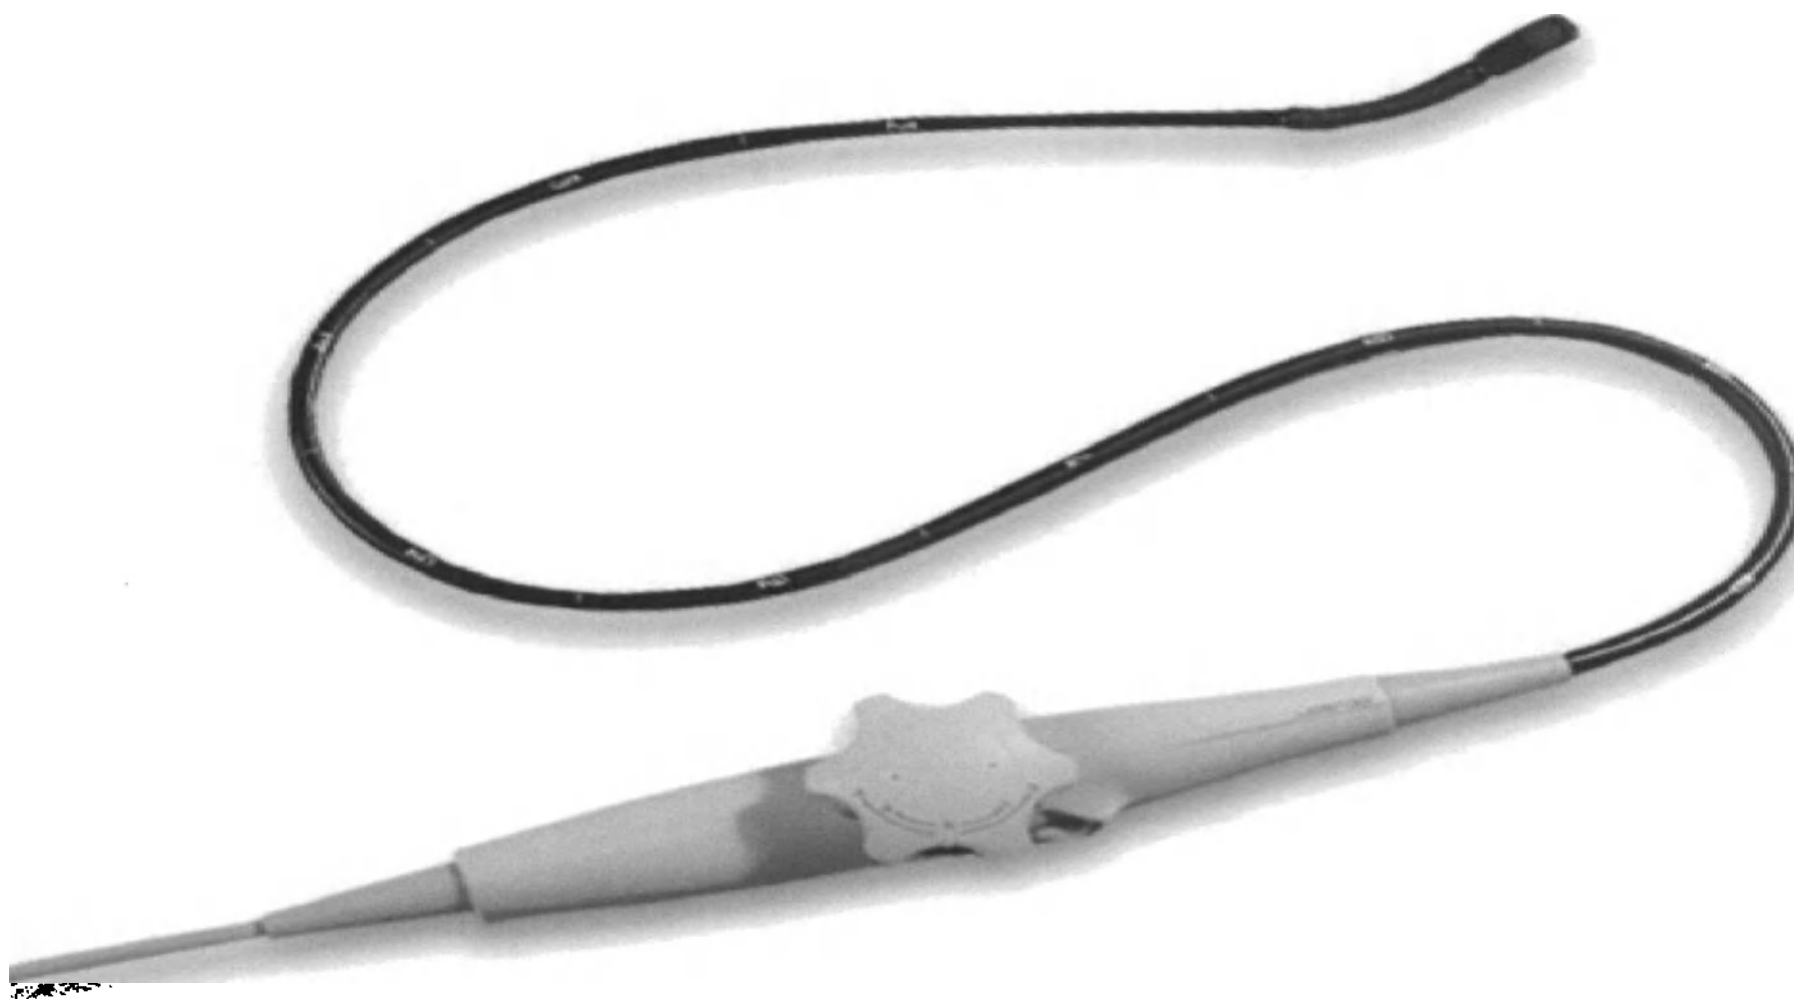


10. Датчик фазированный матричный V5Ms, для чреспищеводных исследований

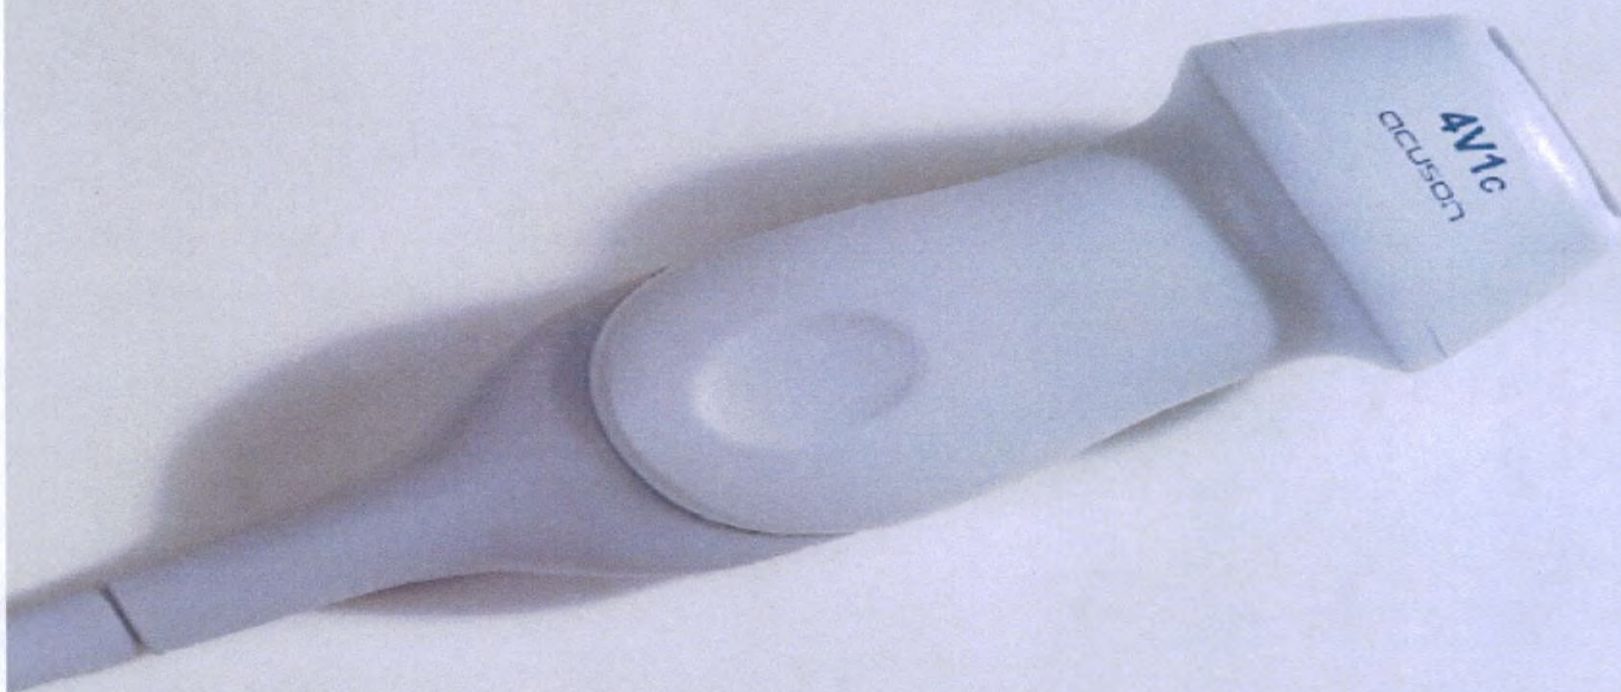


11. Датчик фазированный матричный 4V1c




12. Датчик фазированный матричный 8V3

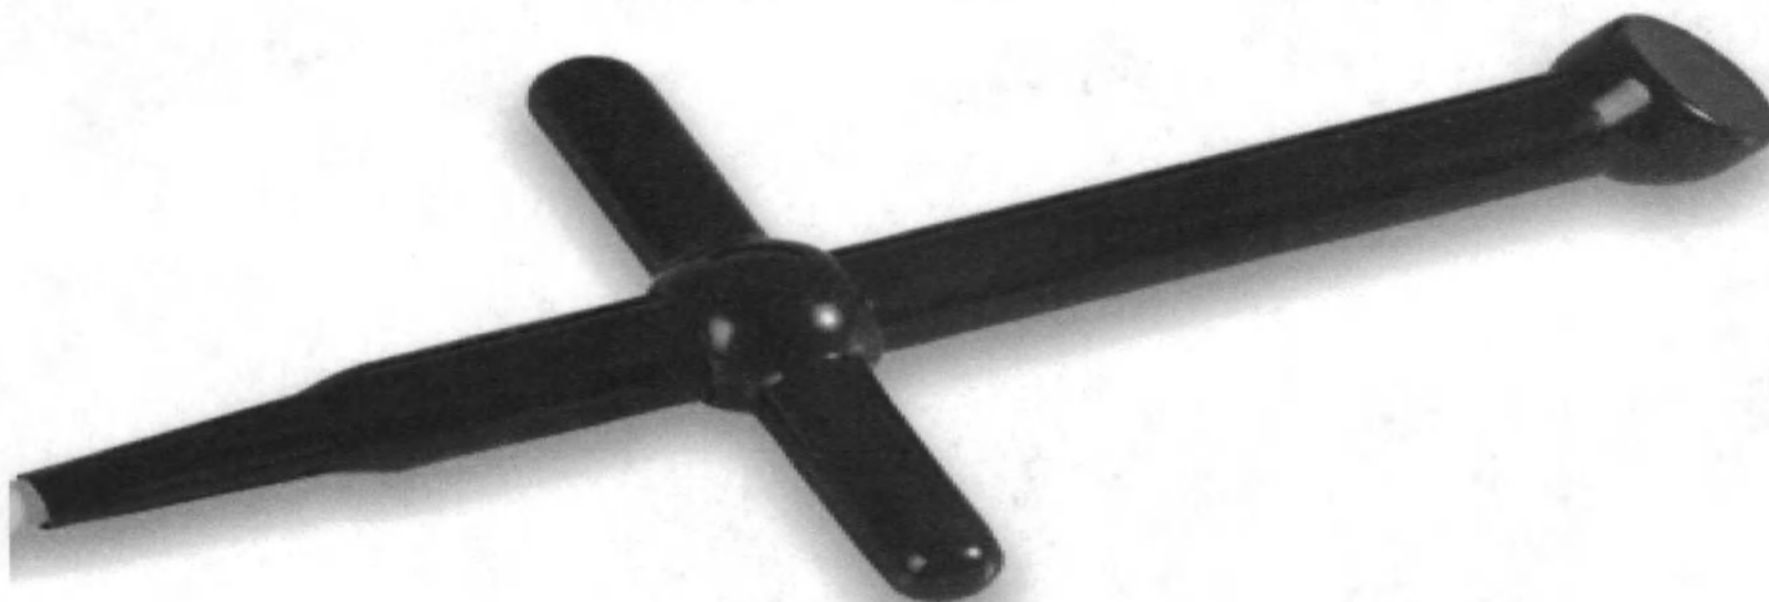

13. Датчик непрерывно-волновой CW2

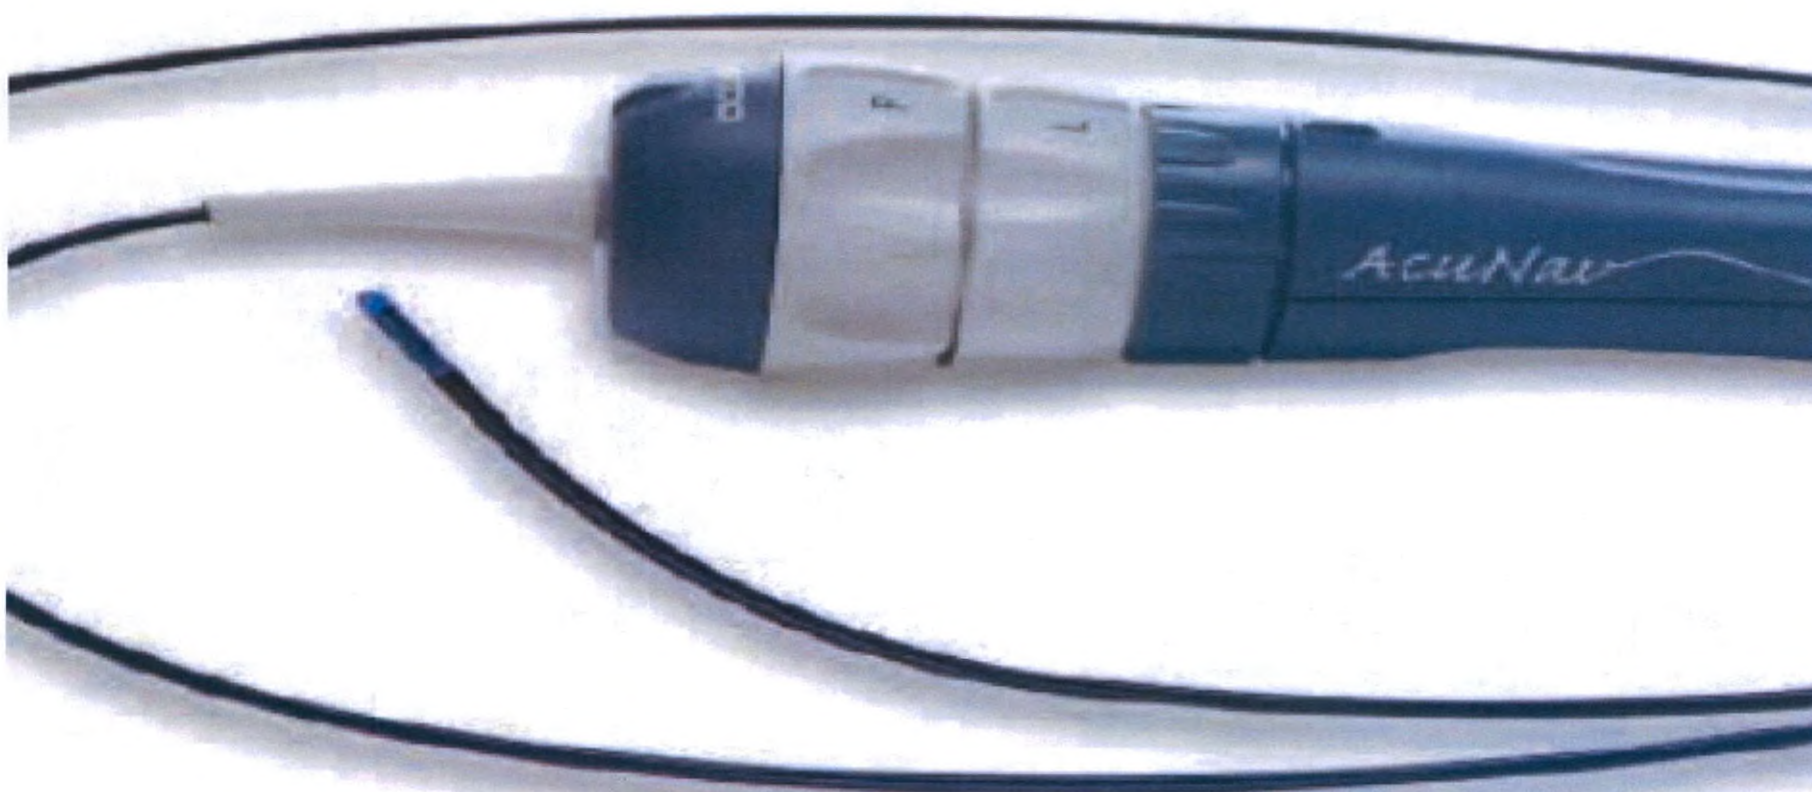


14. Датчик фазированный матричный AcuNav 8F, внутрисердечный

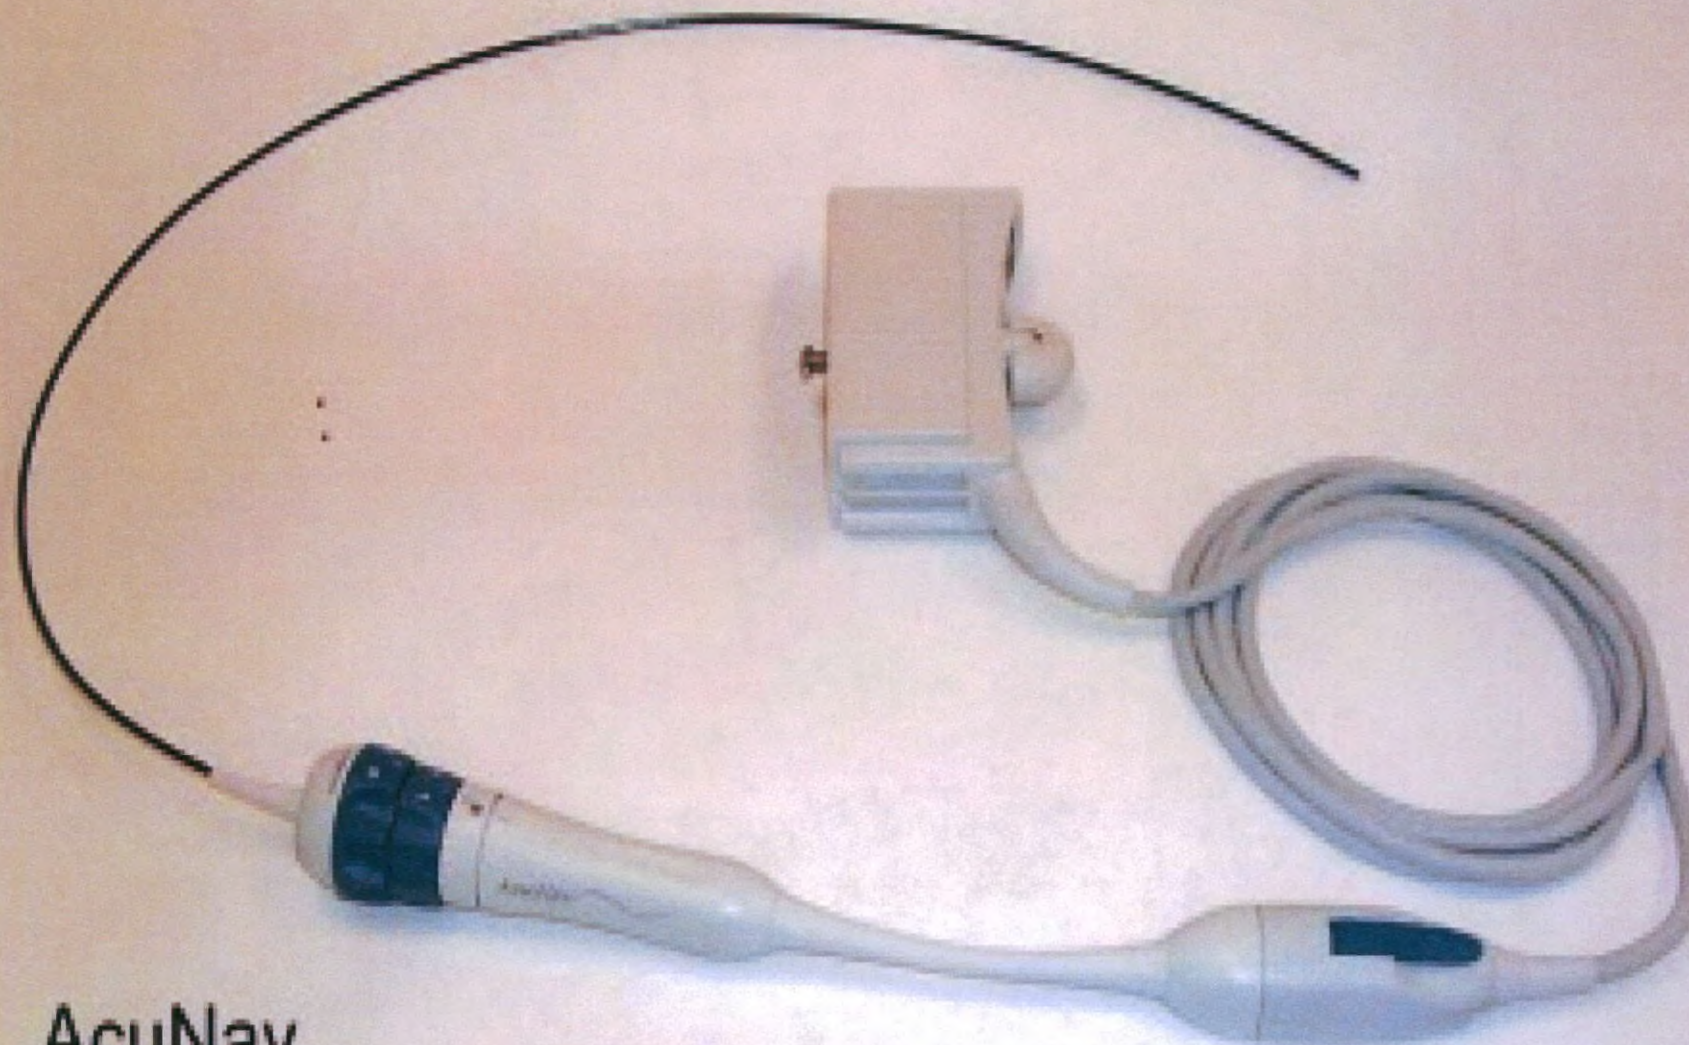


AcuNav

15. Датчик фазированный матричный AcuNav 10F, внутрисердечный

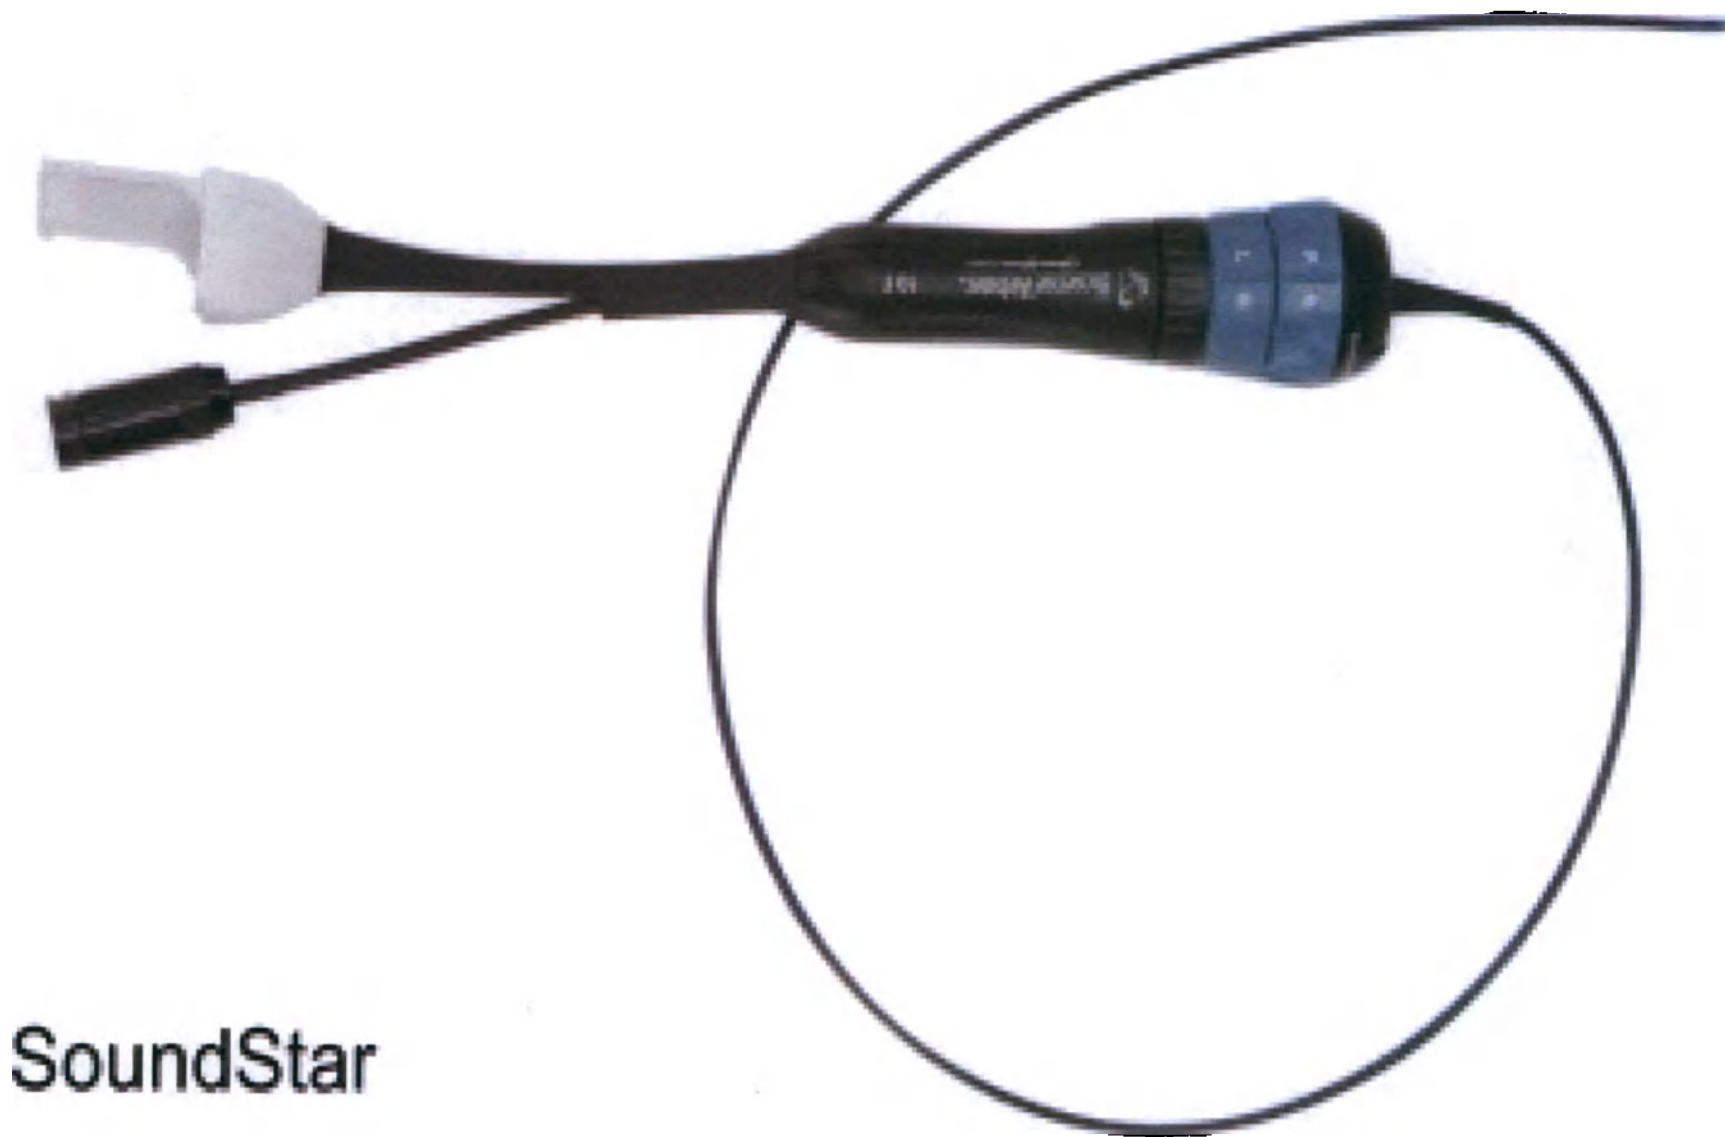


SoundStar

16. Датчик фазированный матричный SoundStar 10F, внутрисердечный

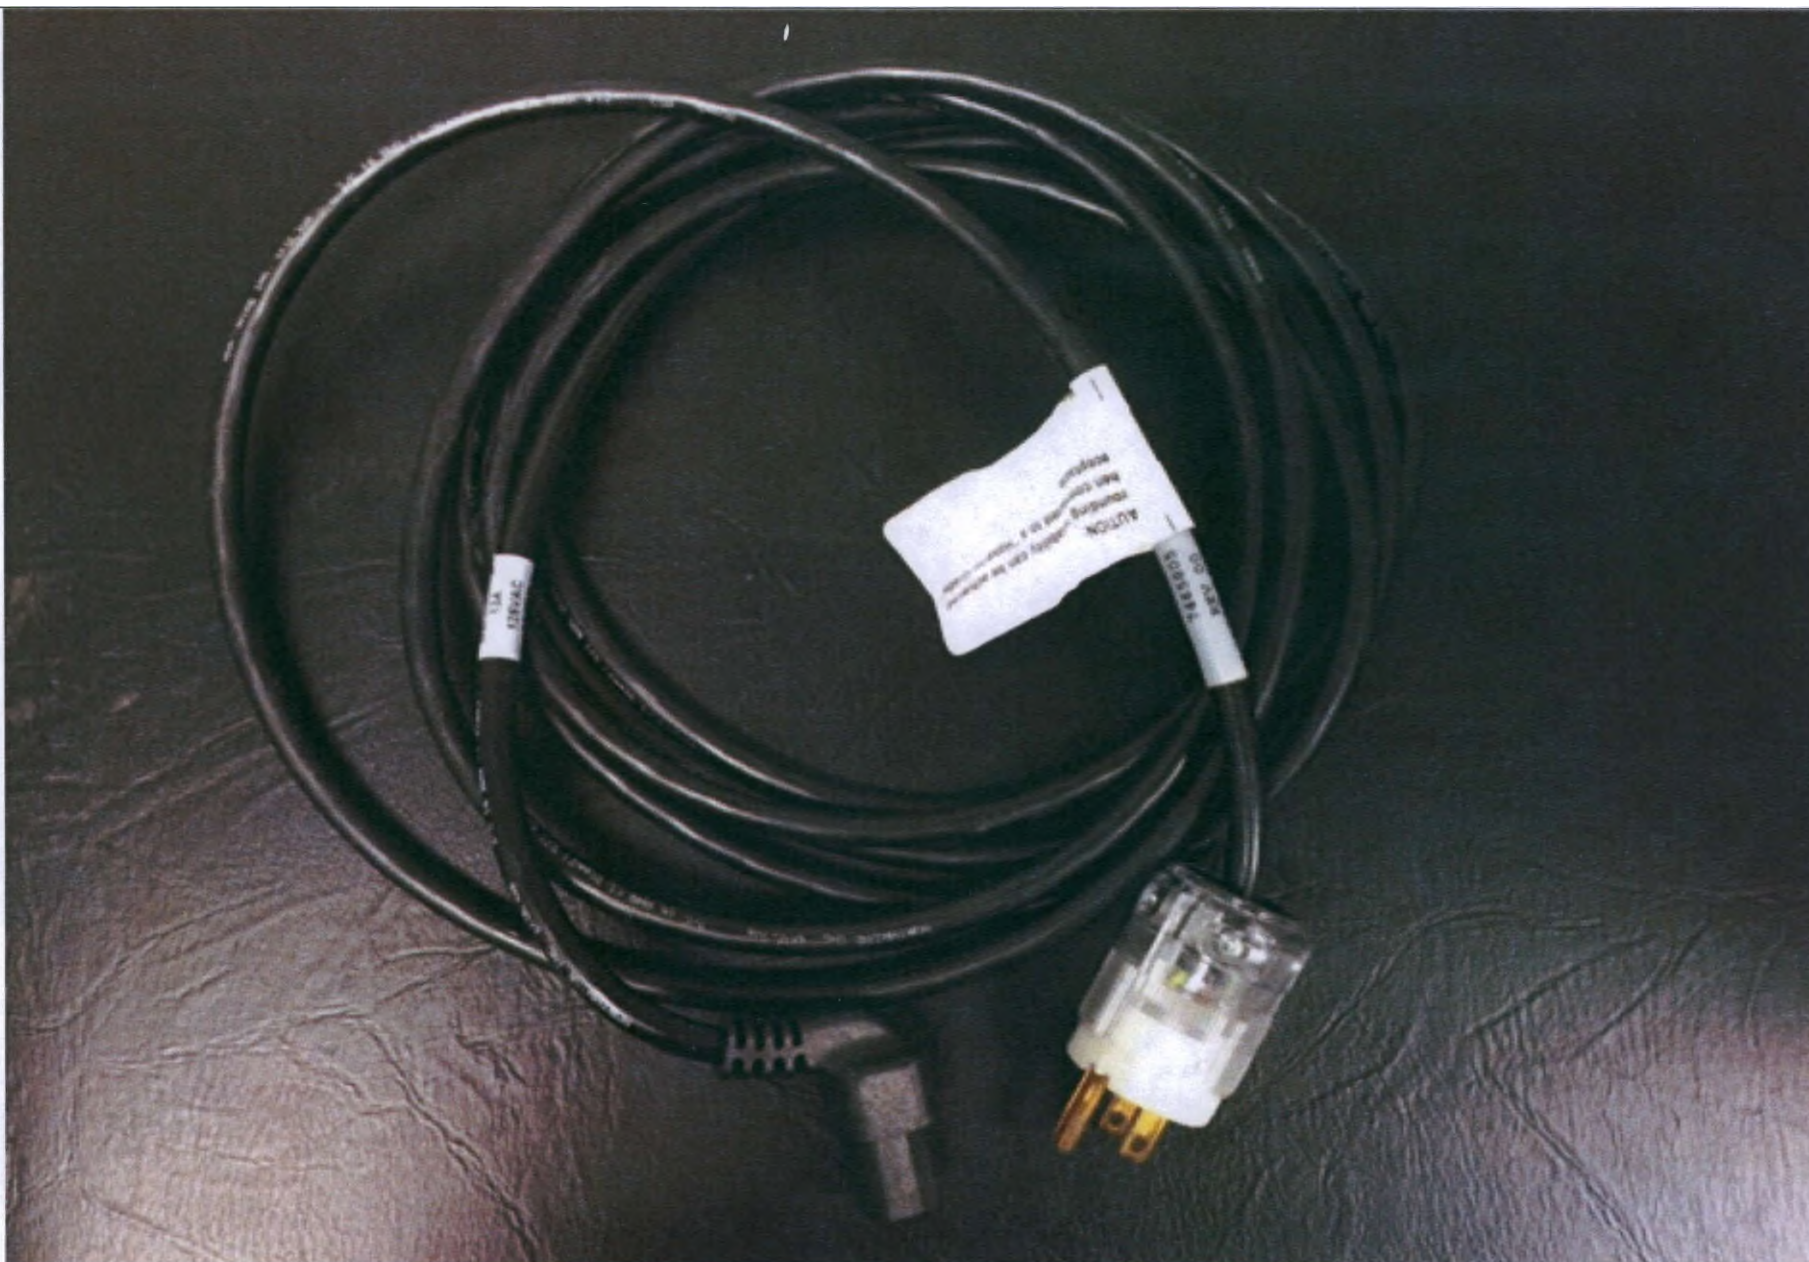

17. Кабель питания

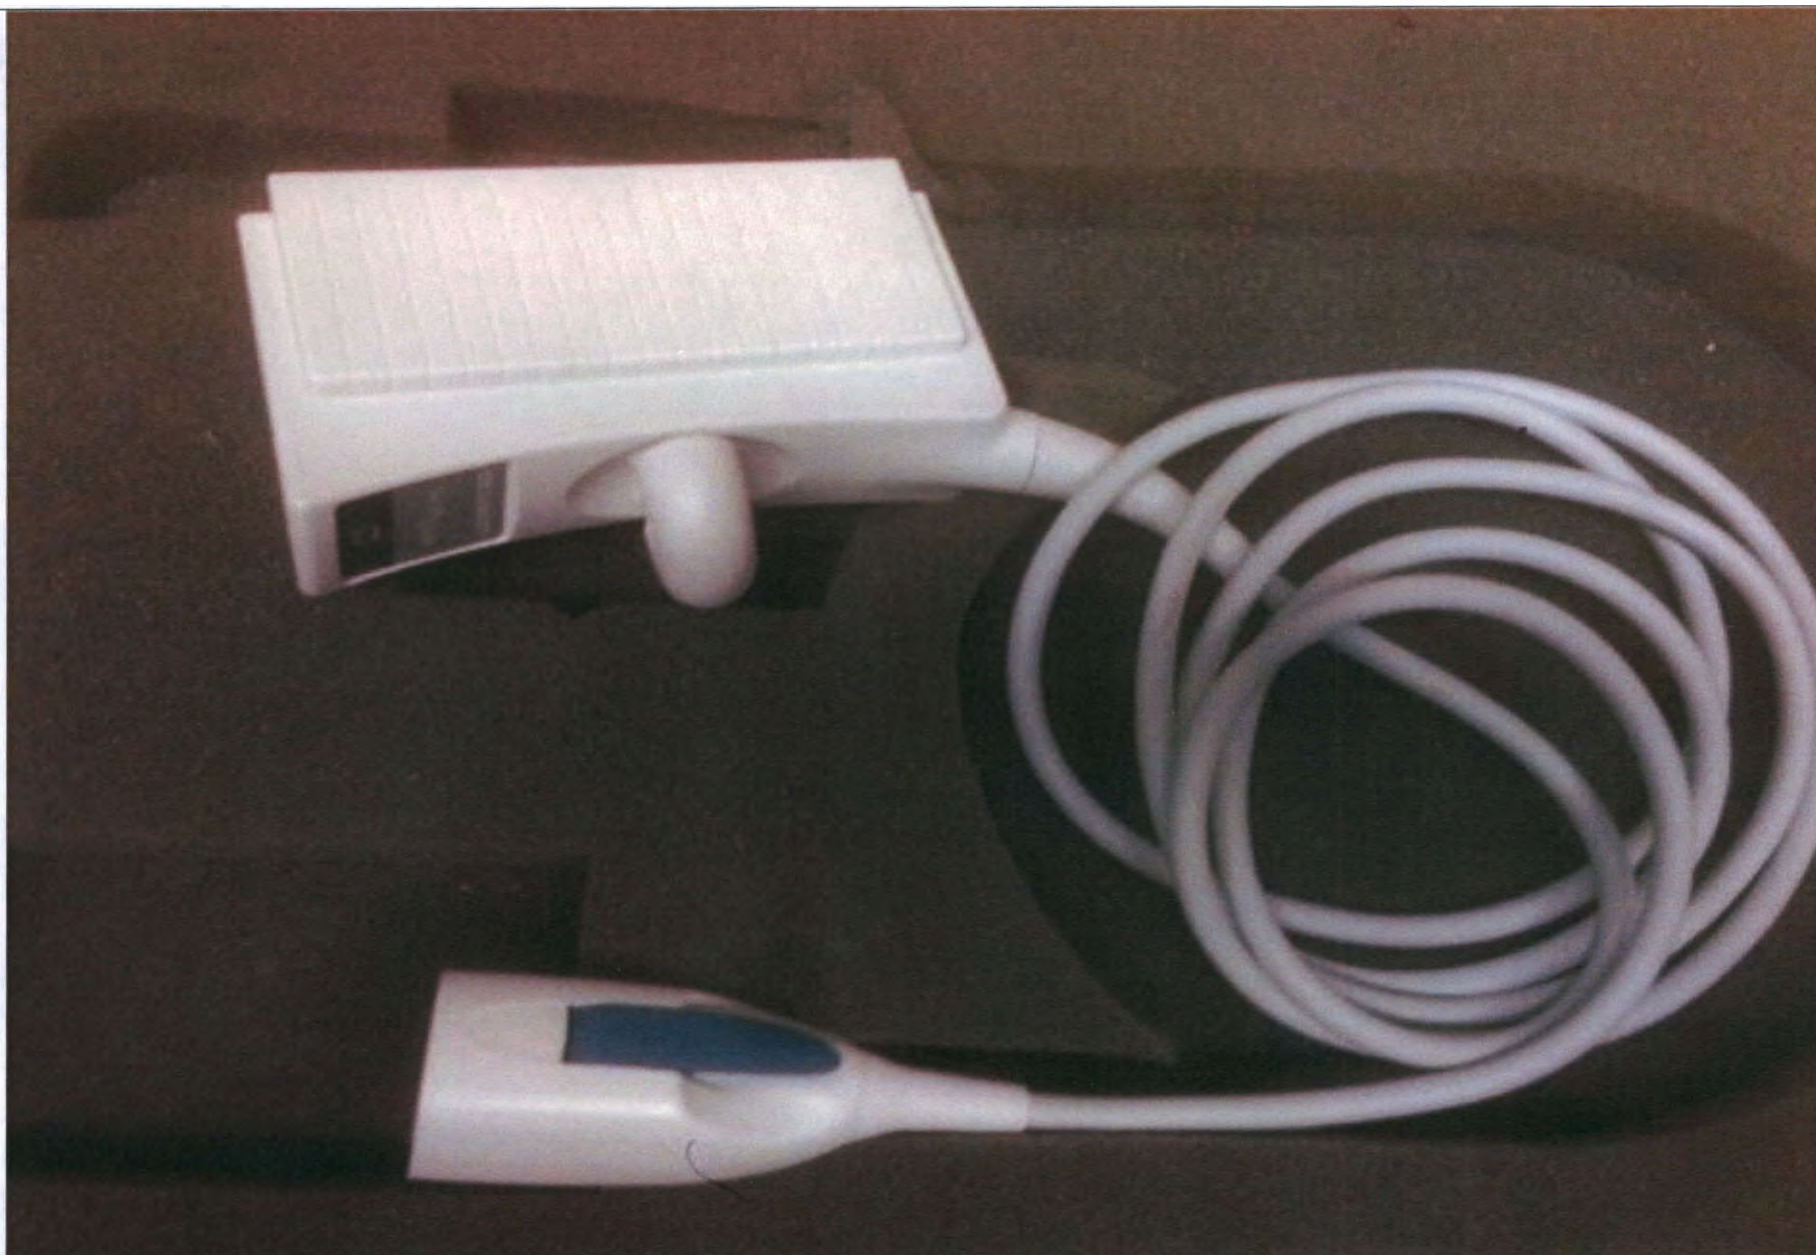


18. Соединитель катетера AcuNav с ультразвуковой системой



19. Стерильные оболочки



20. Тестер токов утечки для датчиков Z6Ms, V5Ms, V7M

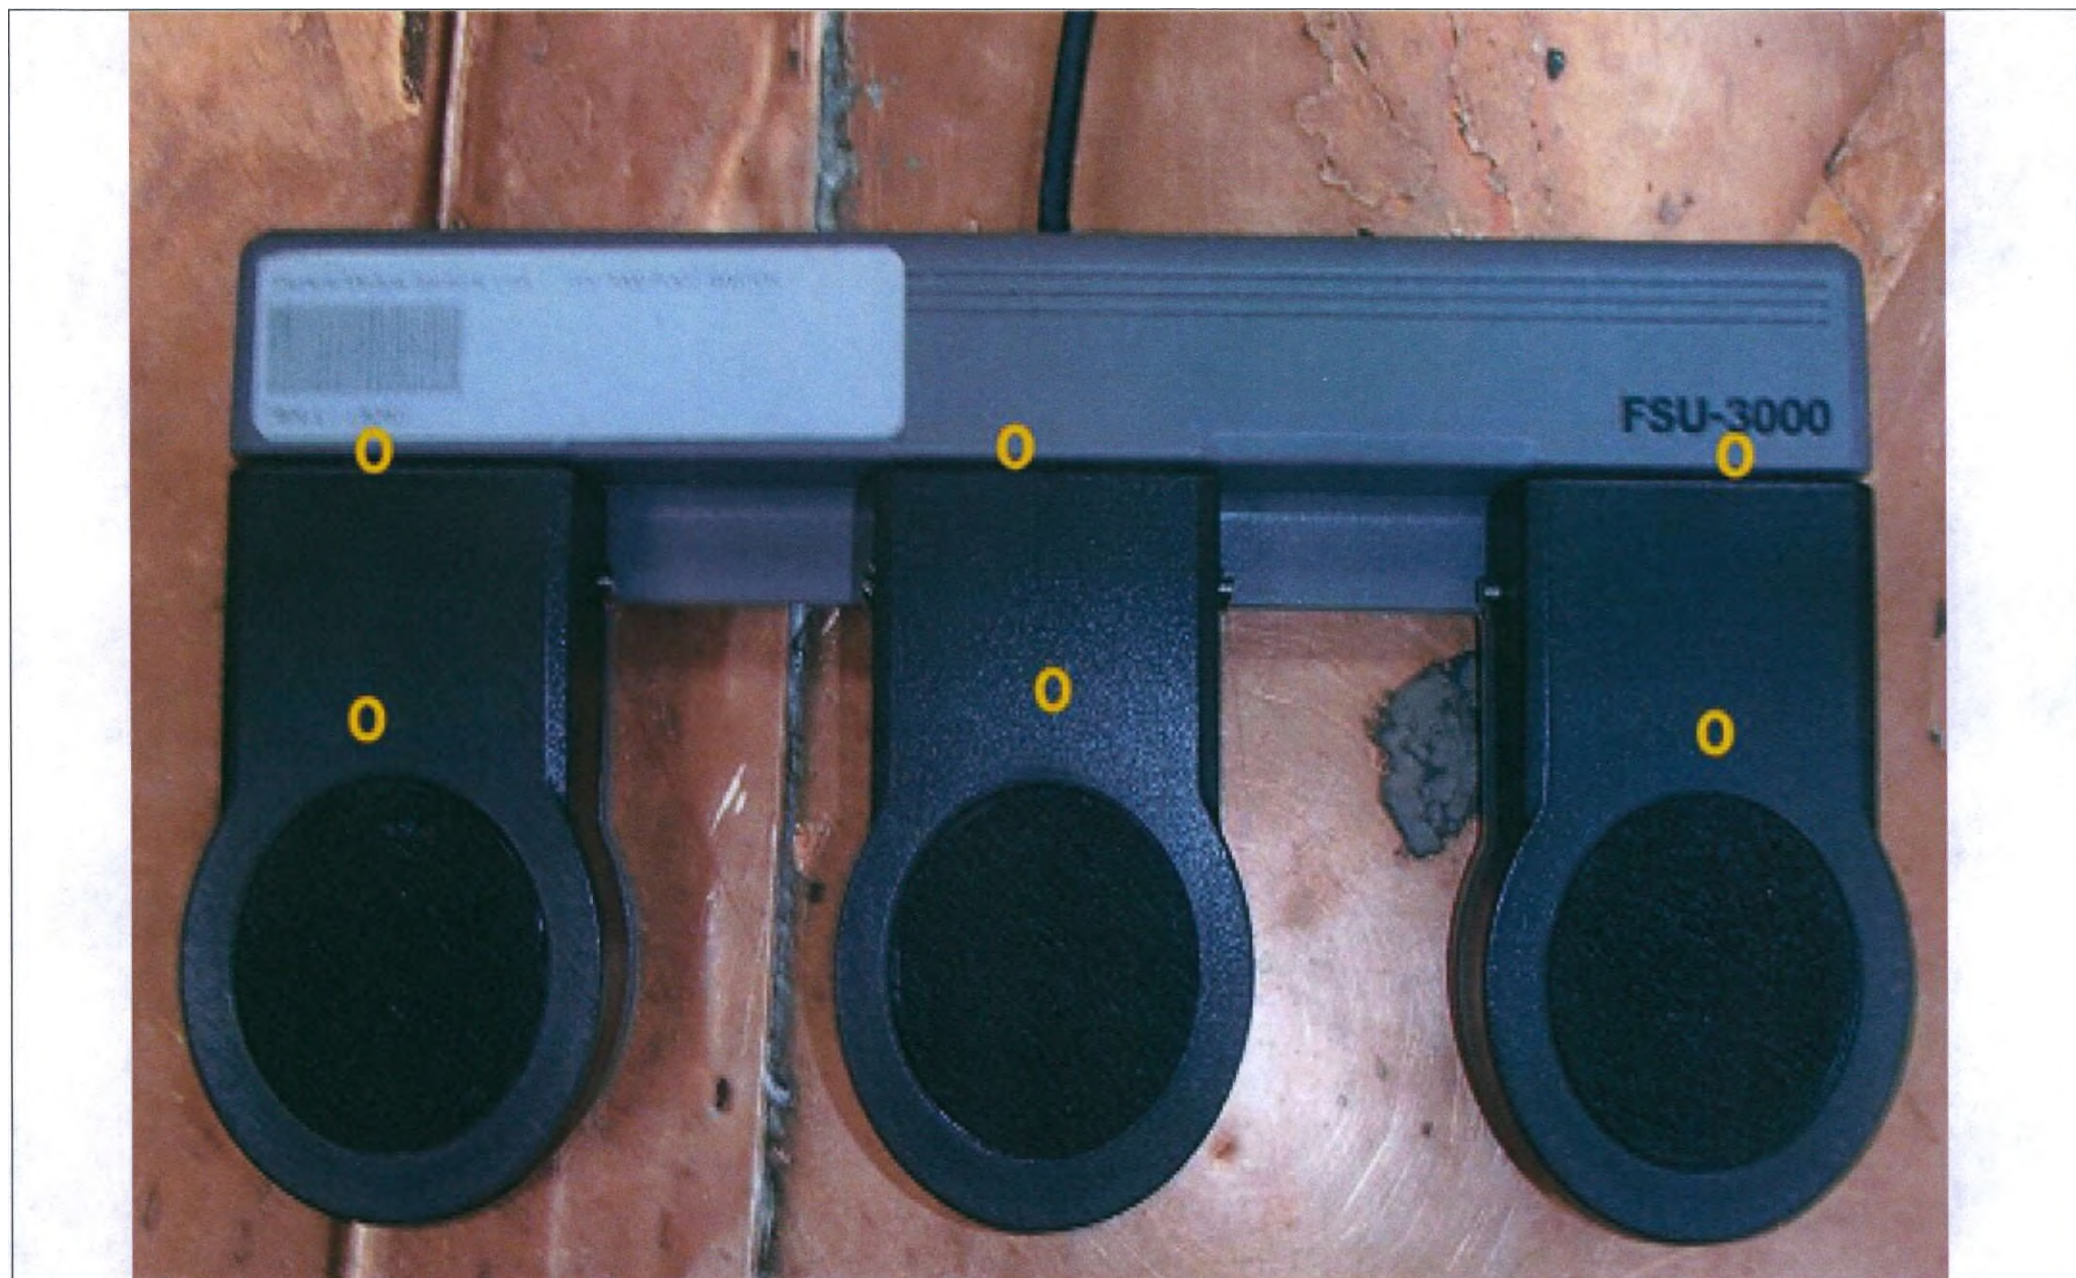


21. Ножной переключатель




22. Кабель с адаптером для проведения стресс-эхокардиографии


Принадлежности:

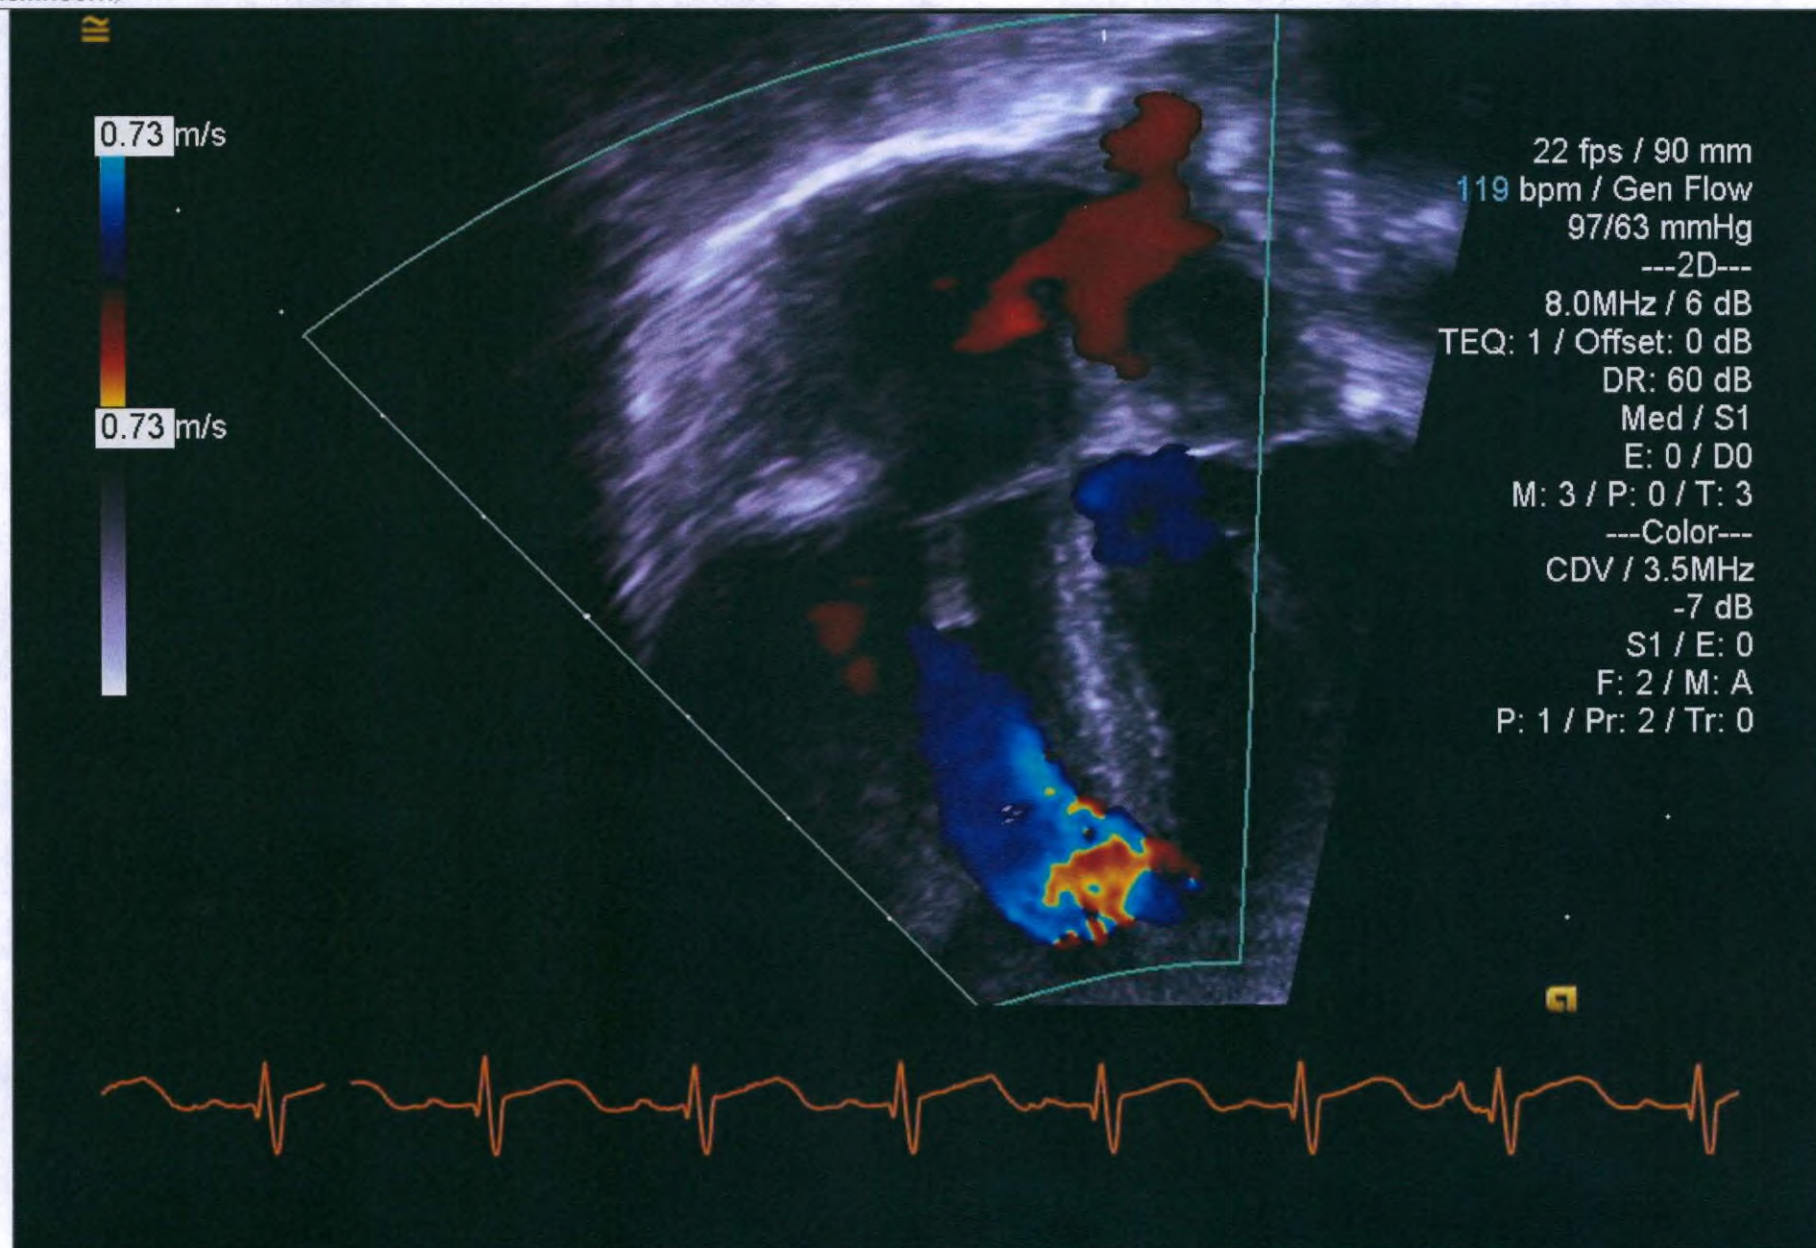


1. Лицензионный ключ для поддержки педиатрических исследований

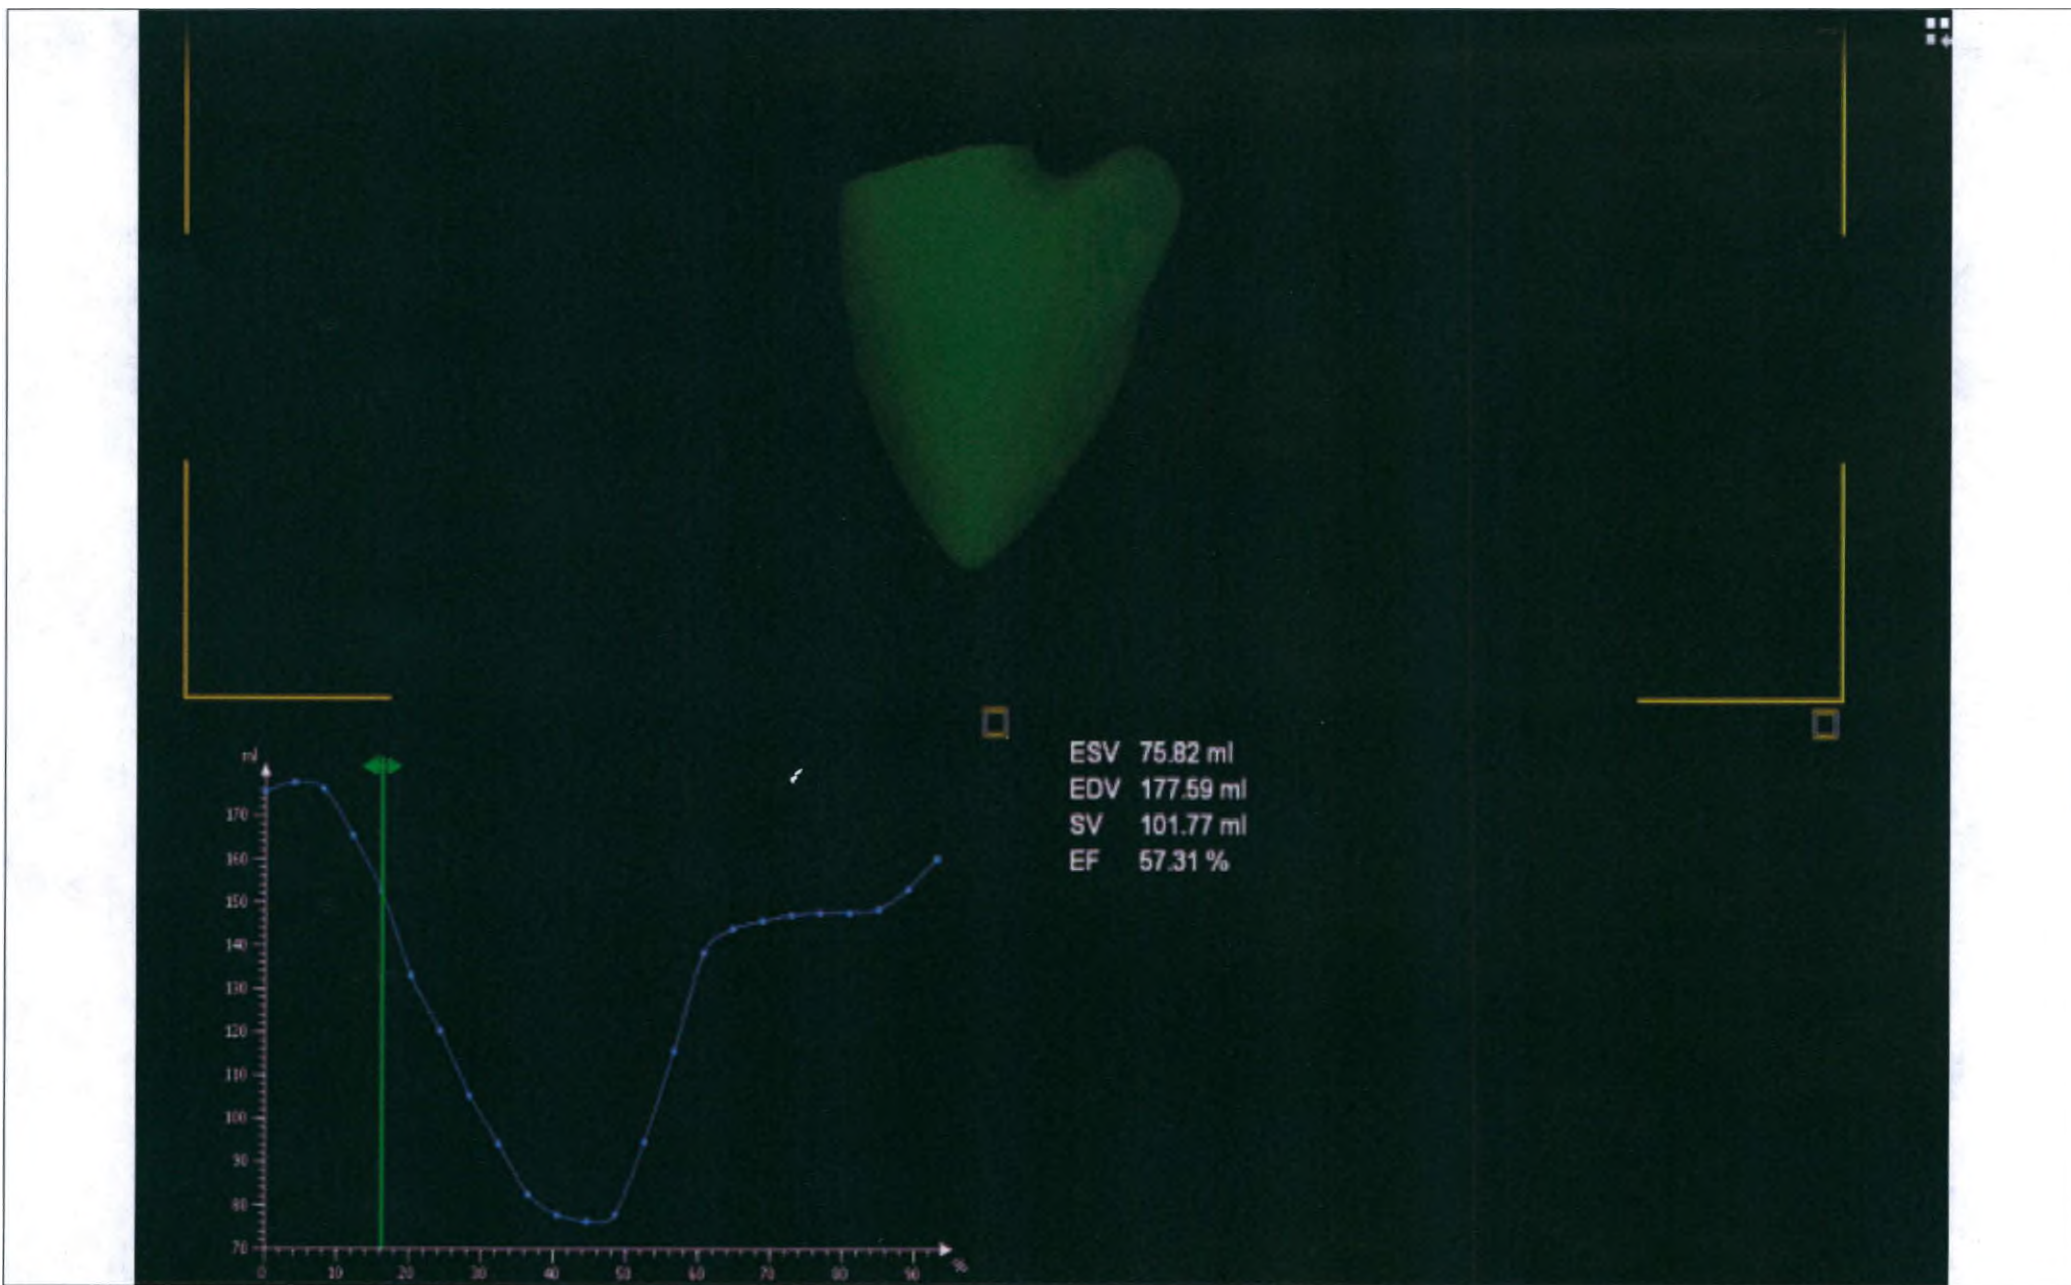


2. Лицензионный ключ для поддержки количественного анализа правого желудочка на основе объёмных данных

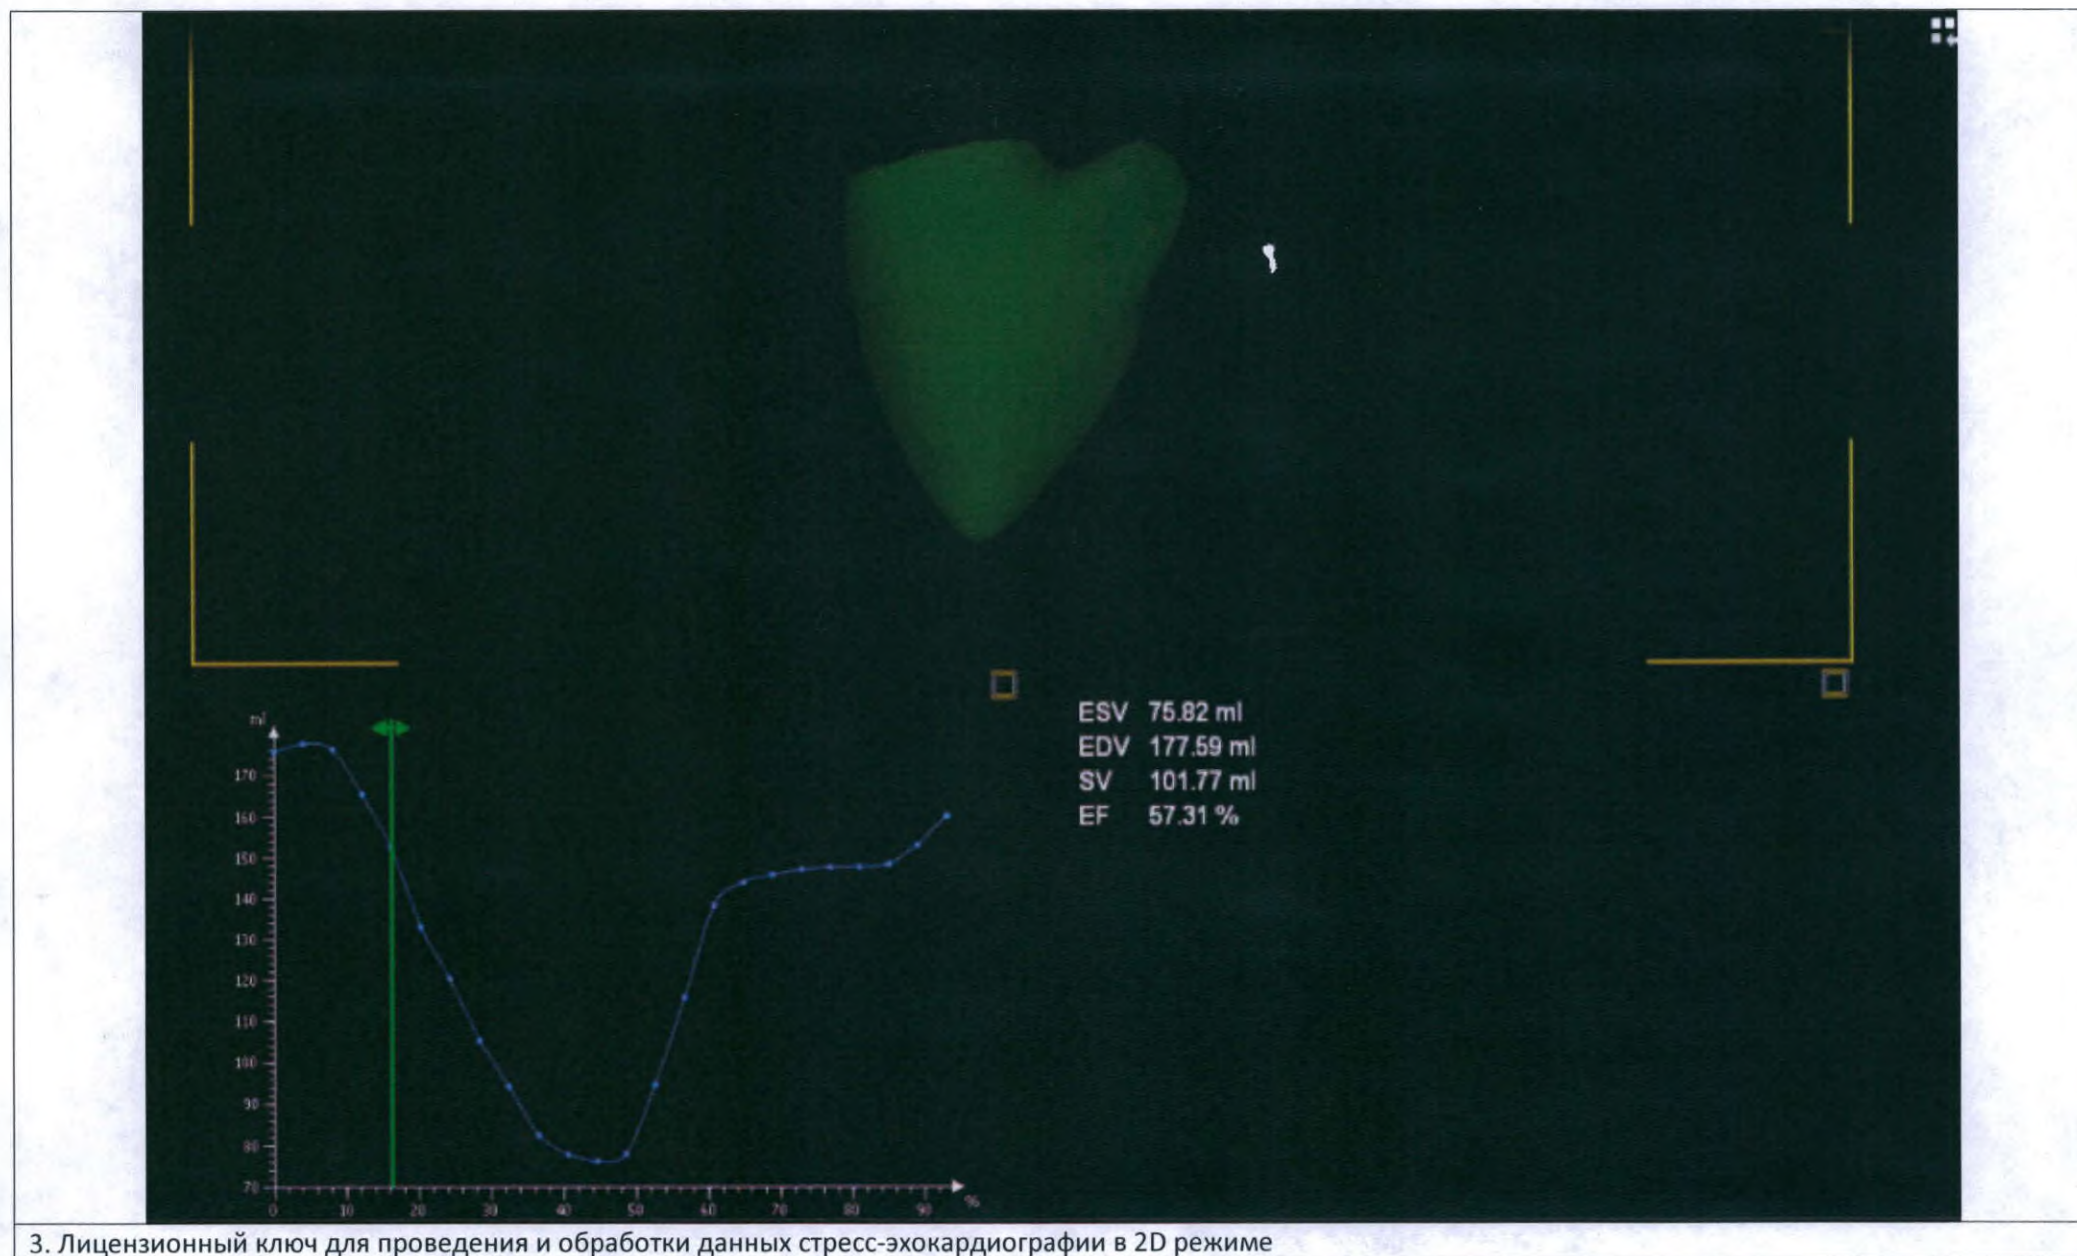


3. Лицензионный ключ для проведения и обработки данных стресс-эхокардиографии в 2D режиме

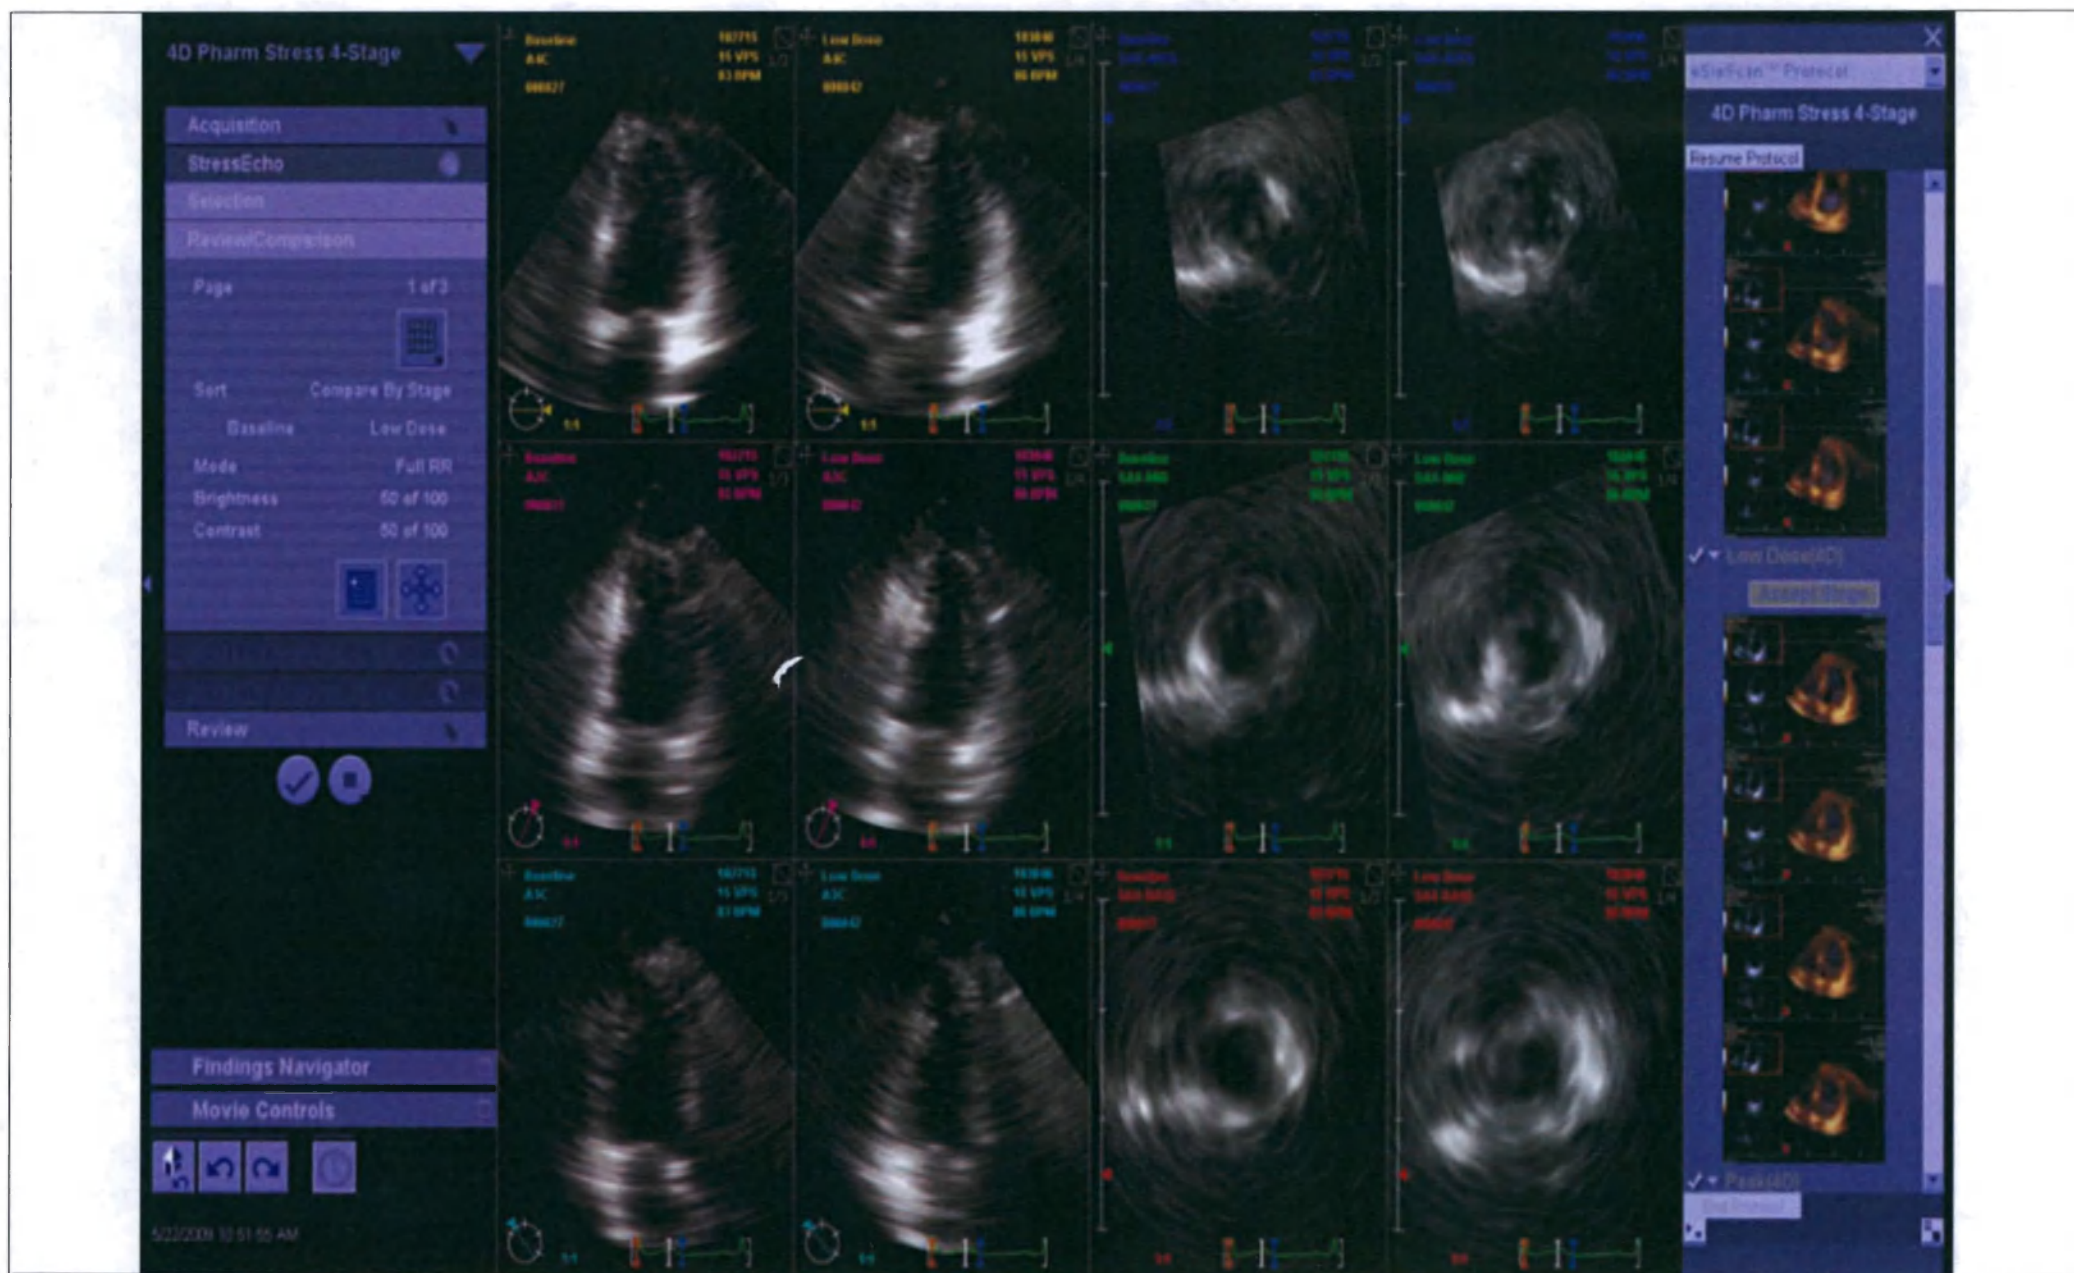




4. Лицензионный ключ для проведения и обработки данных стресс-эхокардиографии с использованием объёмного изображения

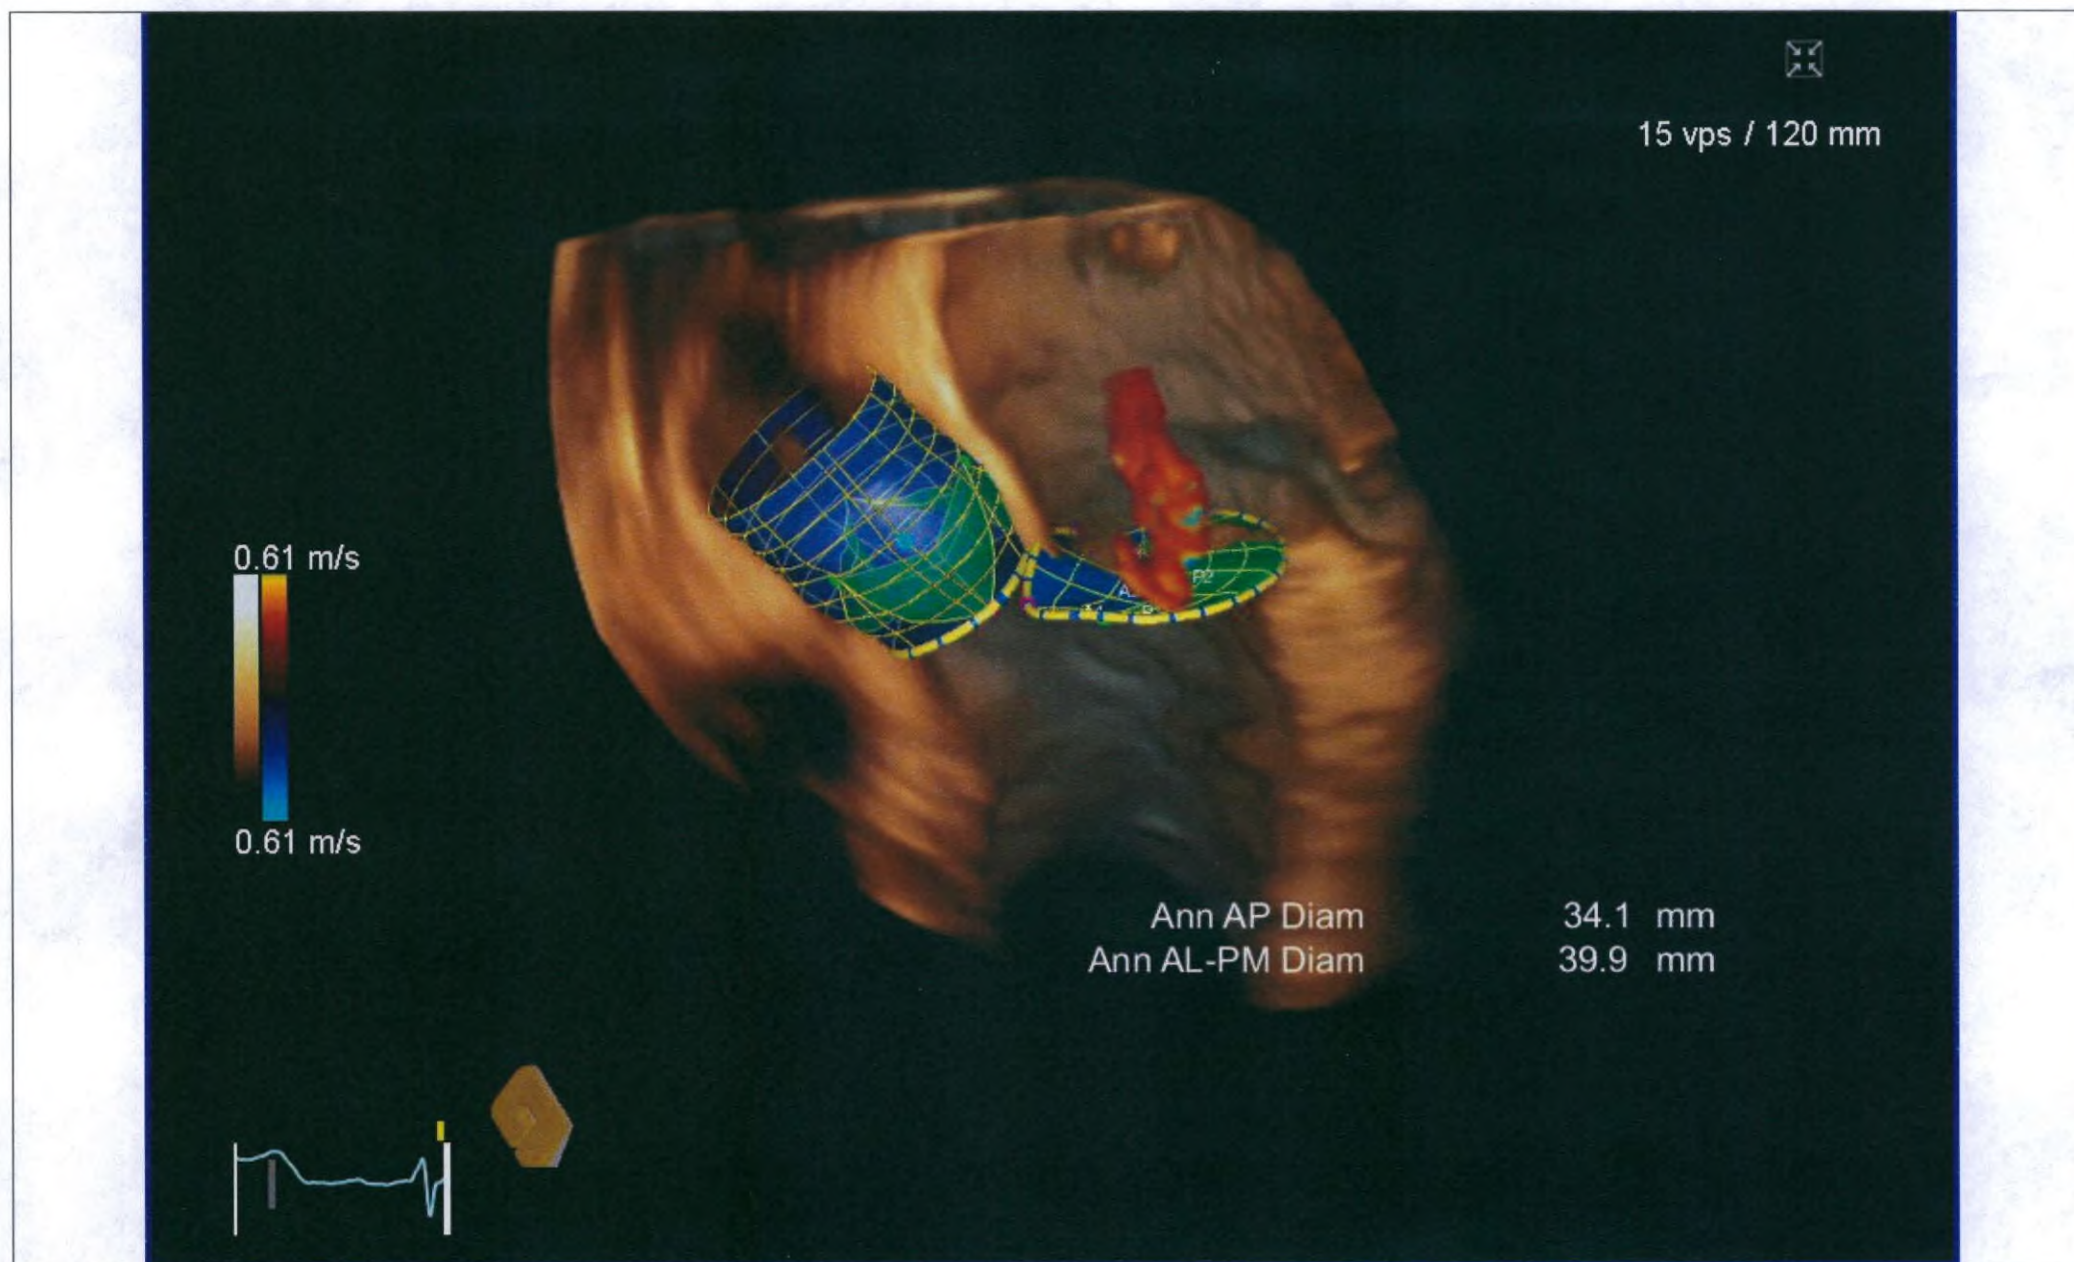

5. Лицензионный ключ для визуализации и количественного анализа анатомических структур митрального и аортального клапанов с использованием объемных данных

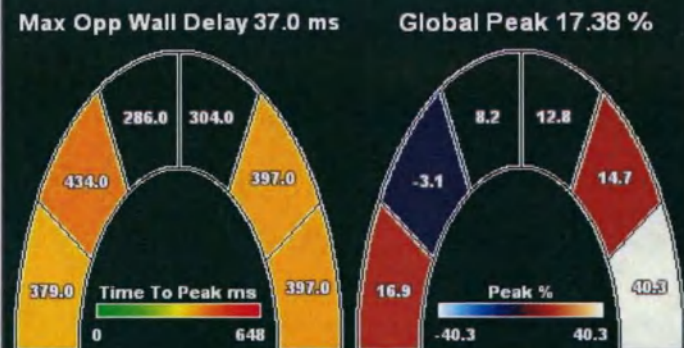

Rocking: +0.27

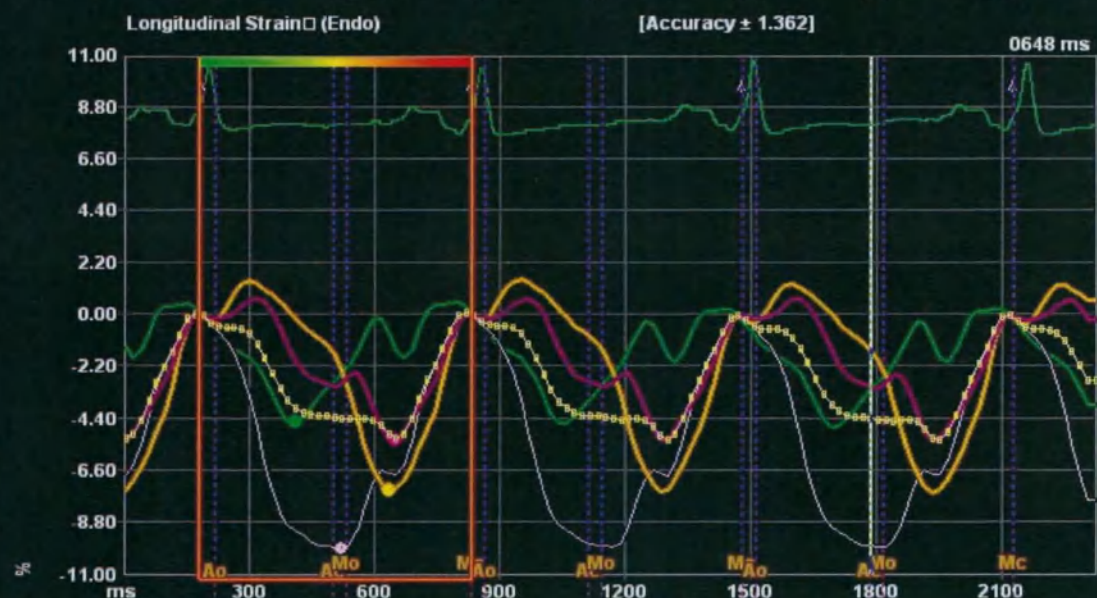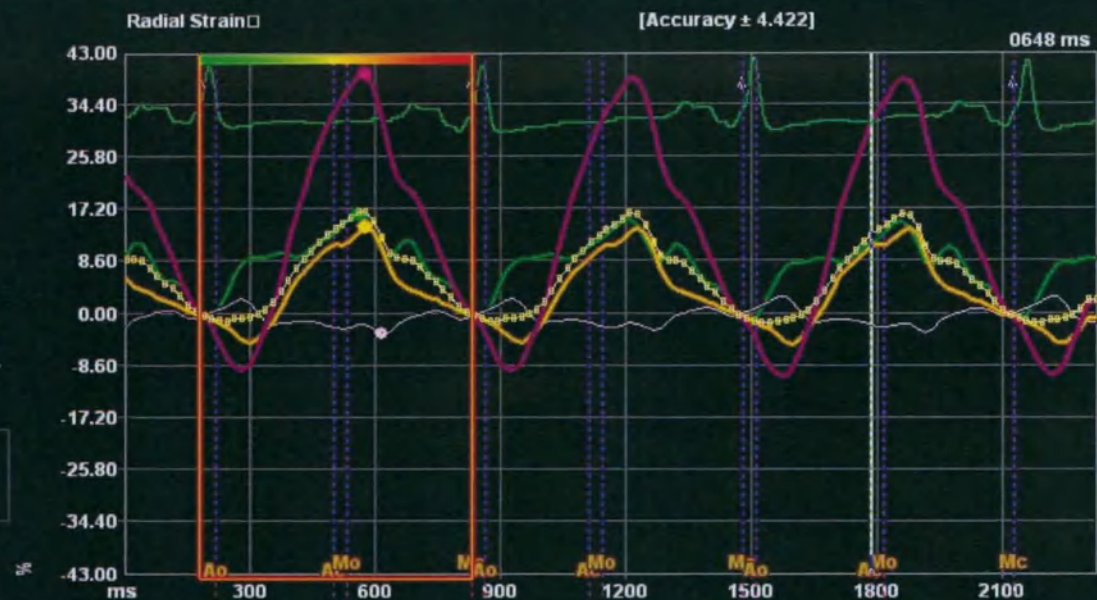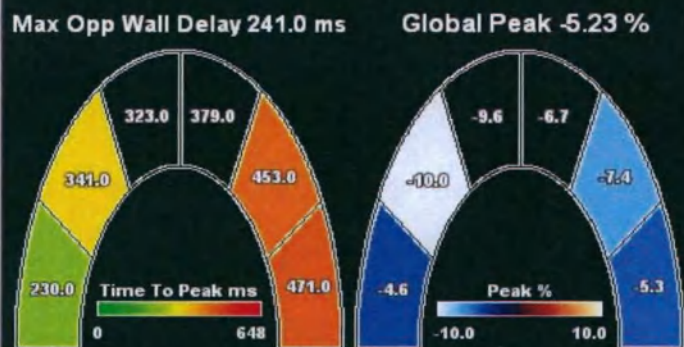


6. Лицензионный ключ для визуализации, оценки движения и механики миокарда при помощи полученных 2D данных

0.34 m/s



0.34 m/s

18 mm
60°

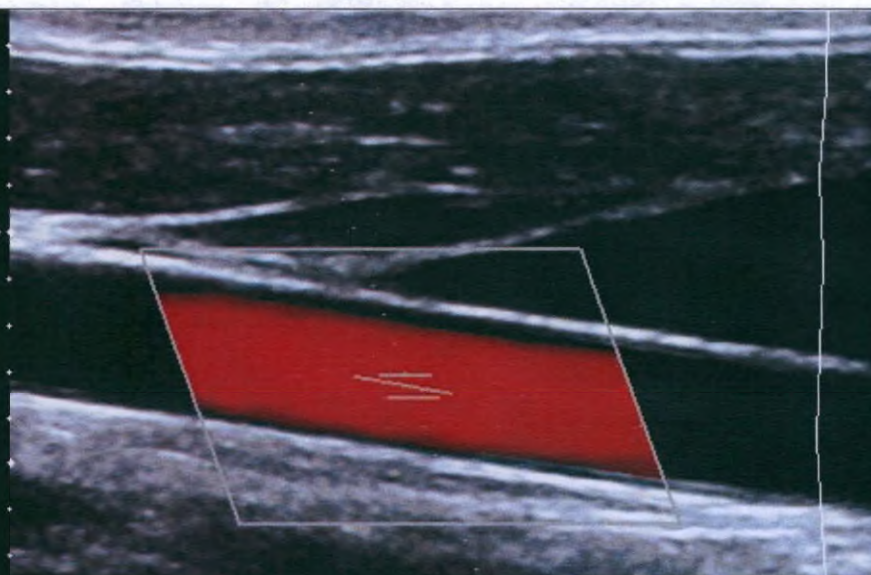

19 fps / 25 mm

General

---2D---

H9.0MHz

-1 dB

DR: 68 dB

Med / ASC: 3

E: 0 / D2

M: 5 / P: 1 / T: 2

---Color---

CDV / 4.0MHz

-5 dB

S1 / E: 0

F: 2 / M: 2

P: 4 / Pr: 1

Tr: 0

---PW---

1 mm

4.0MHz

0 dB / DR: 65

Med / E: 0 / F: 4

M: 7 / P: 2 / T: 1

Sweep: 50

4

1.20

1.00

0.80

0.60

0.40

0.20

m/s

0.20


0.40

0.60

7. Лицензионный ключ для поддержки исследования сосудов




8. Лицензионный ключ для поддержки технологии пространственного компаундинга

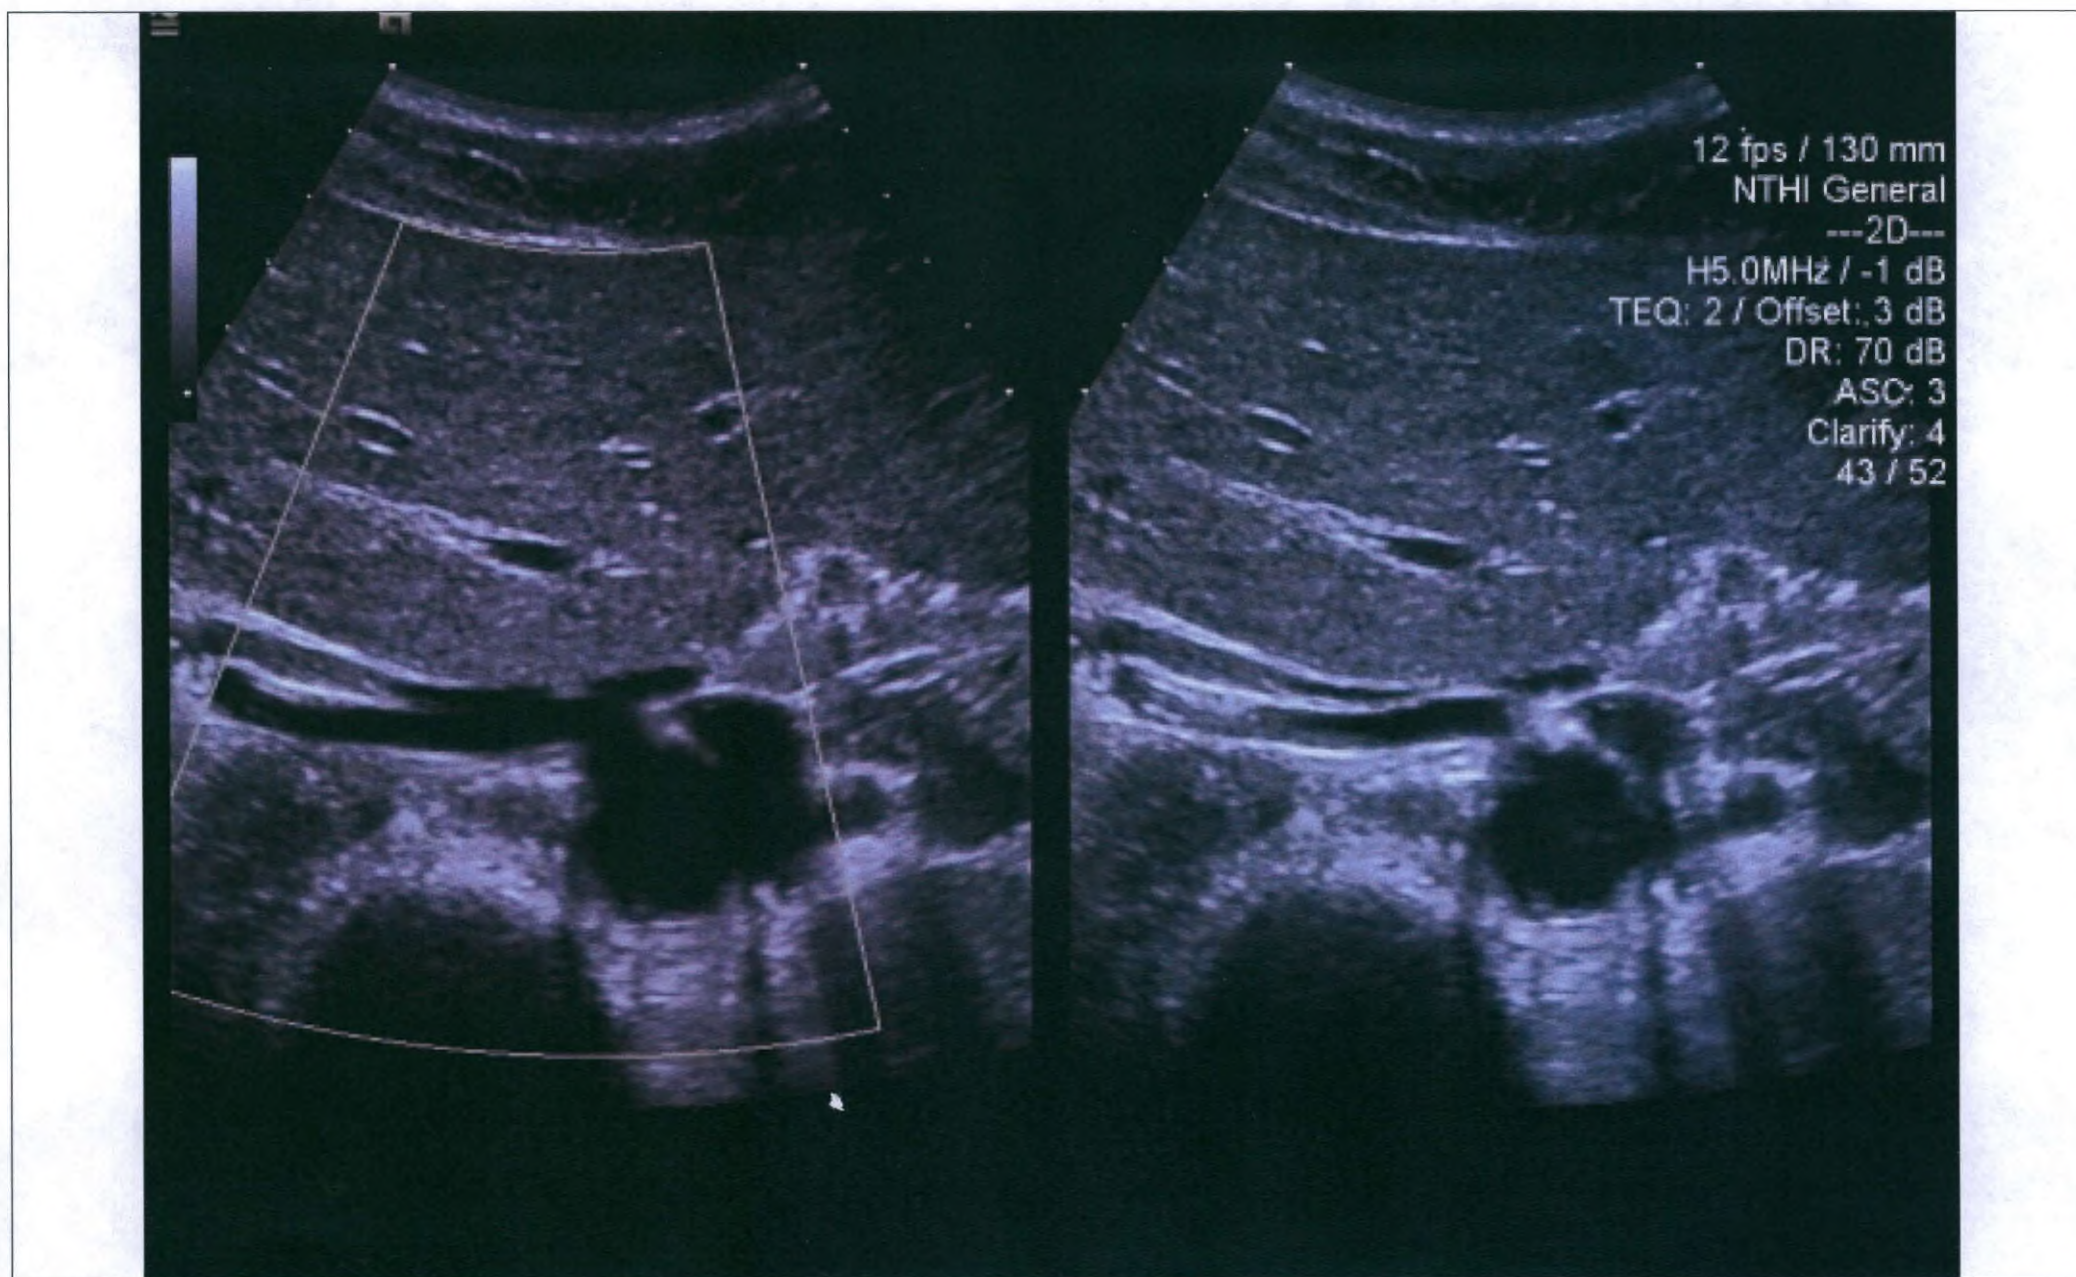

9. Лицензионный ключ для функции улучшения визуализации анатомических структур сосудов




10. Лицензионный ключ для функции автоматического равномерного выравнивания тканей и оптимизации яркости изображения

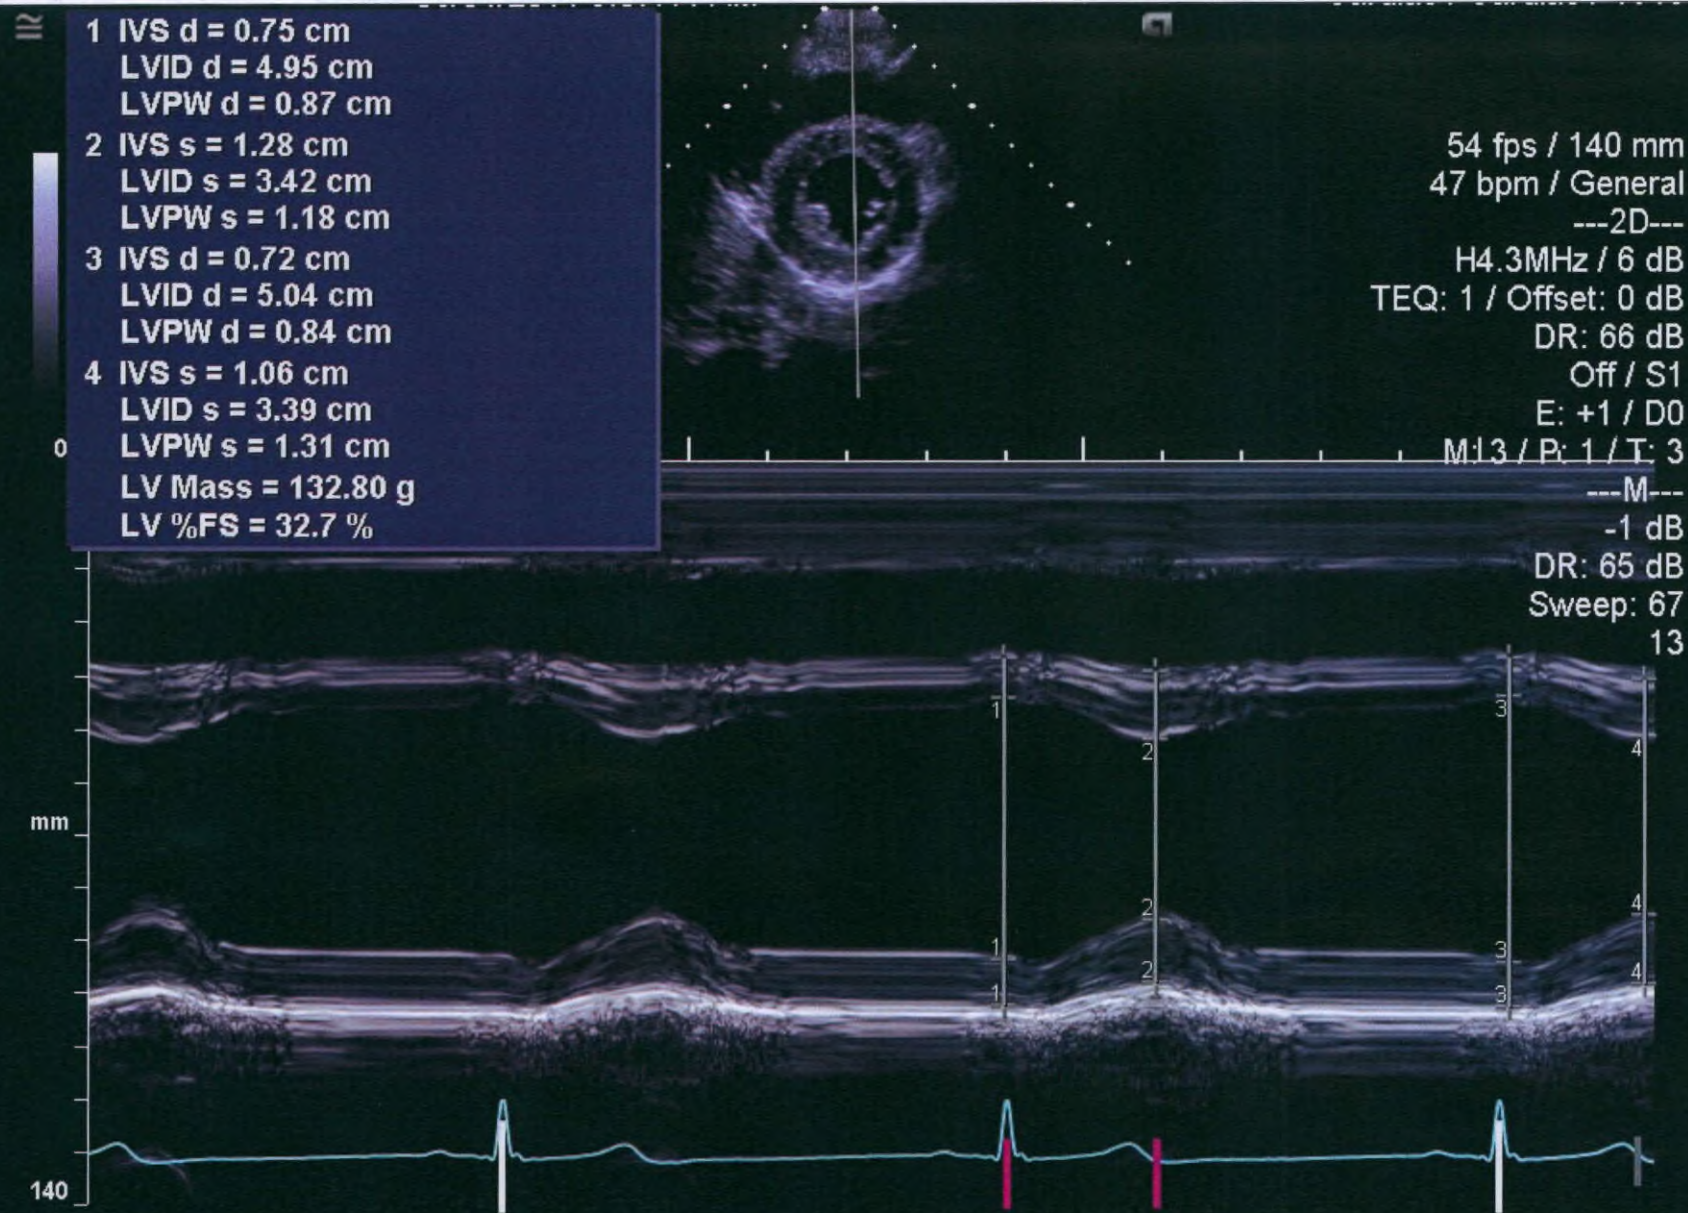


12. Лицензионный ключ для автоматизации процесса измерений в М-режиме


1 LVOT VTI = 0.216 m
 LVOT Vmax = 1.38 m/s
 LVOT Vmean = 0.88 m/s
 LVOT Peak Grad = 7.6 mmHg
 LVOT Mean Grad = 3.7 mmHg
 AT = 95 msec
 ET = 244 msec
 2 LVOT VTI = 0.220 m
 LVOT Vmax = 1.47 m/s
 LVOT Vmean = 0.93 m/s
 LVOT Peak Grad = 8.7 mmHg
 LVOT Mean Grad = 4.1 mmHg
 AT = 79 msec
 ET = 236 msec

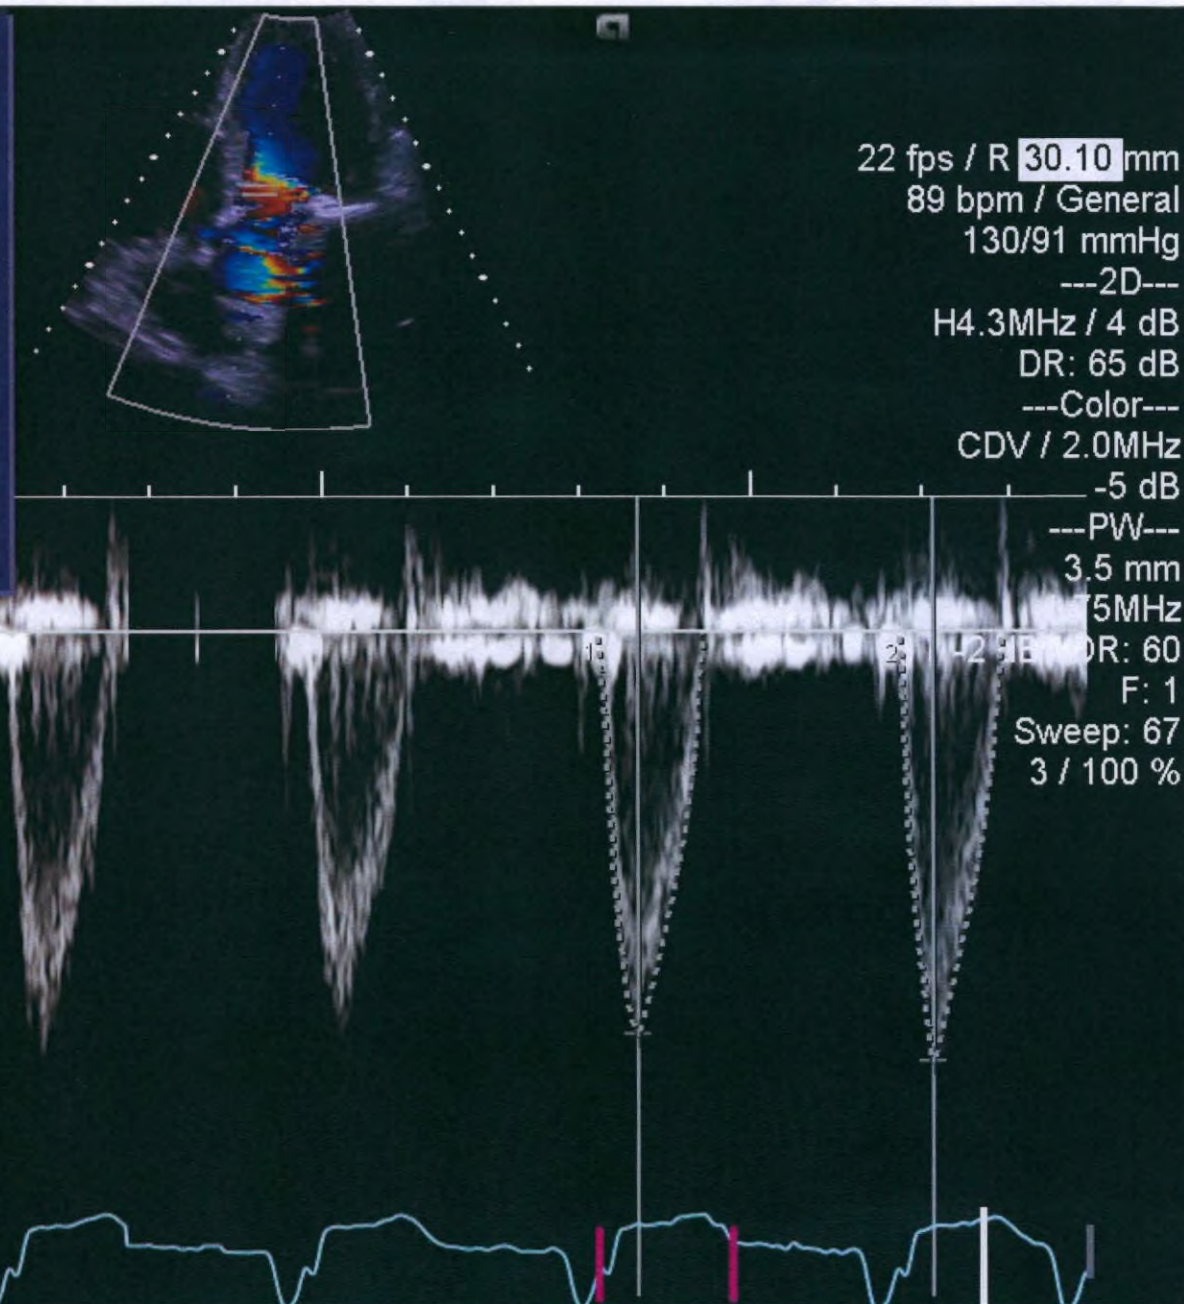


13. Лицензионный ключ для автоматизации процесса измерений в режиме спектрального доплера

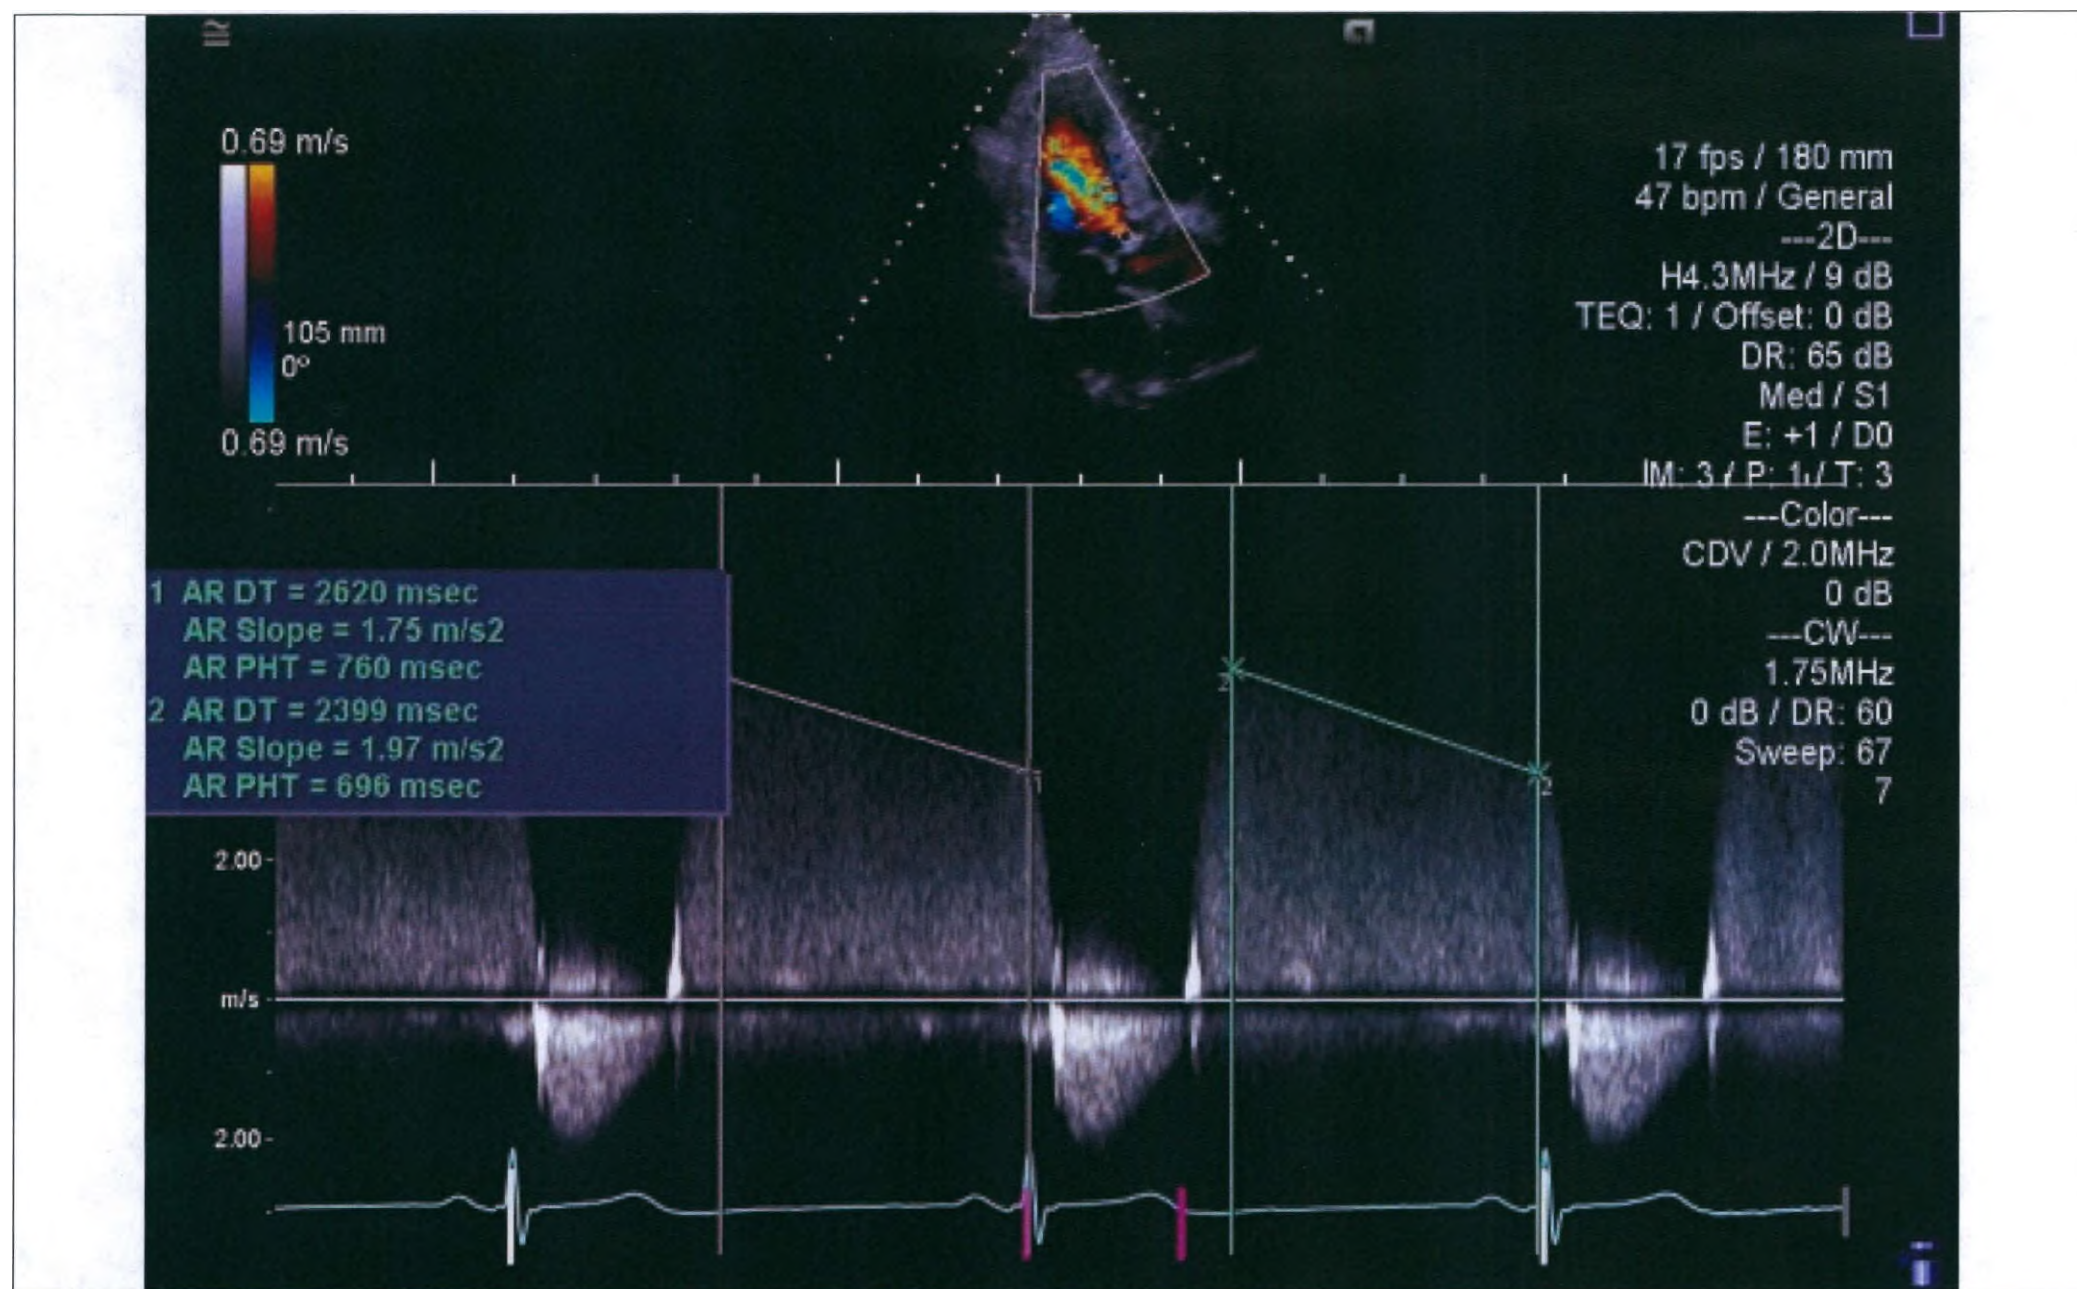

14. Лицензионный ключ для автоматизации процесса измерений в 2D-, M- и доплеровских режимах

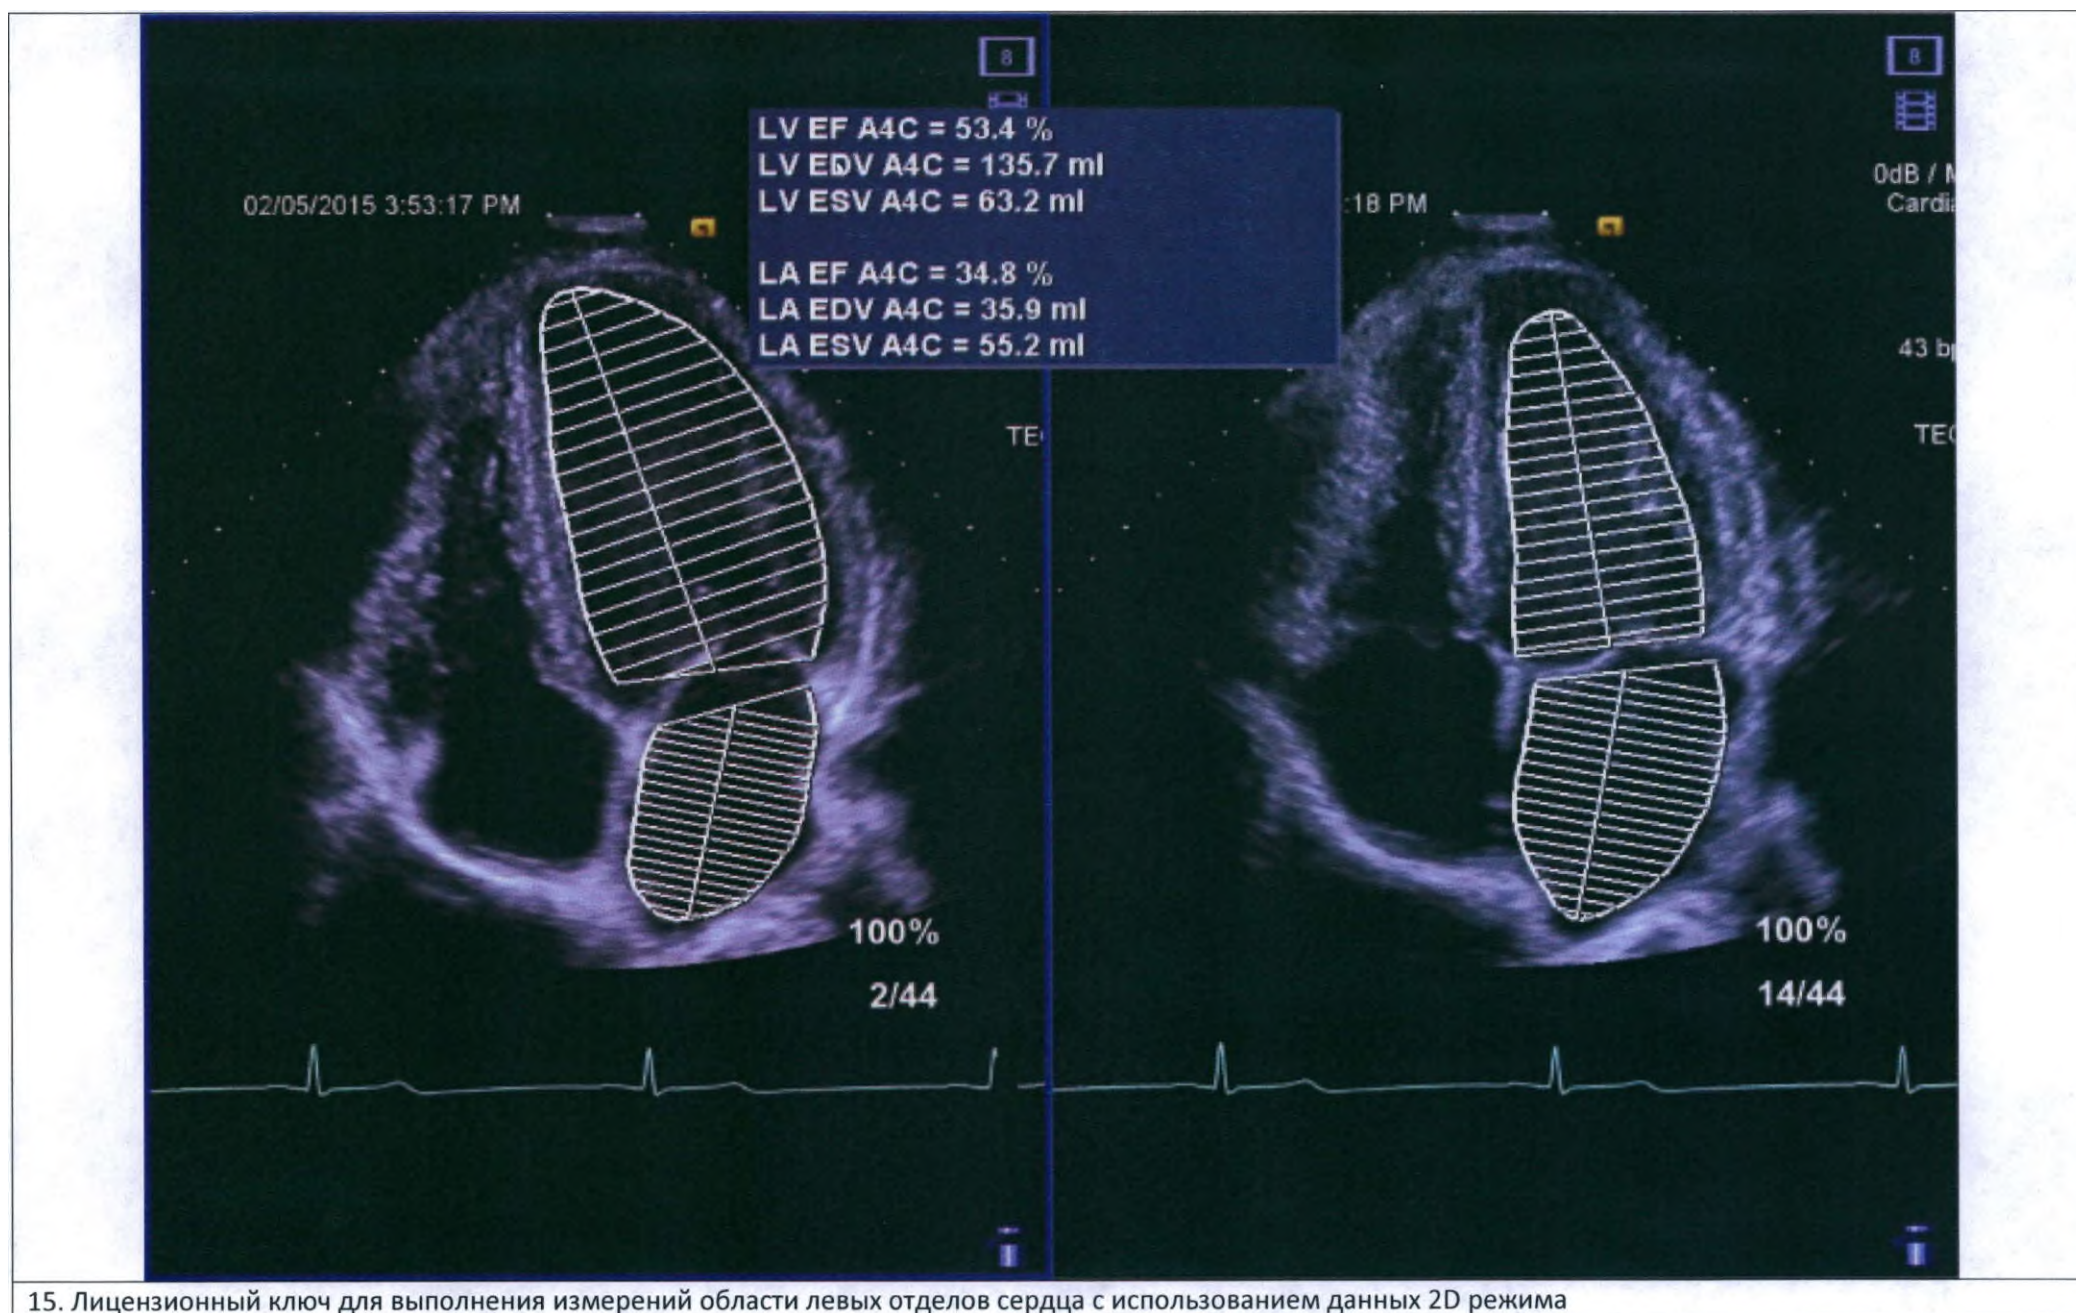

15. Лицензионный ключ для выполнения измерений области левых отделов сердца с использованием данных 2D режима

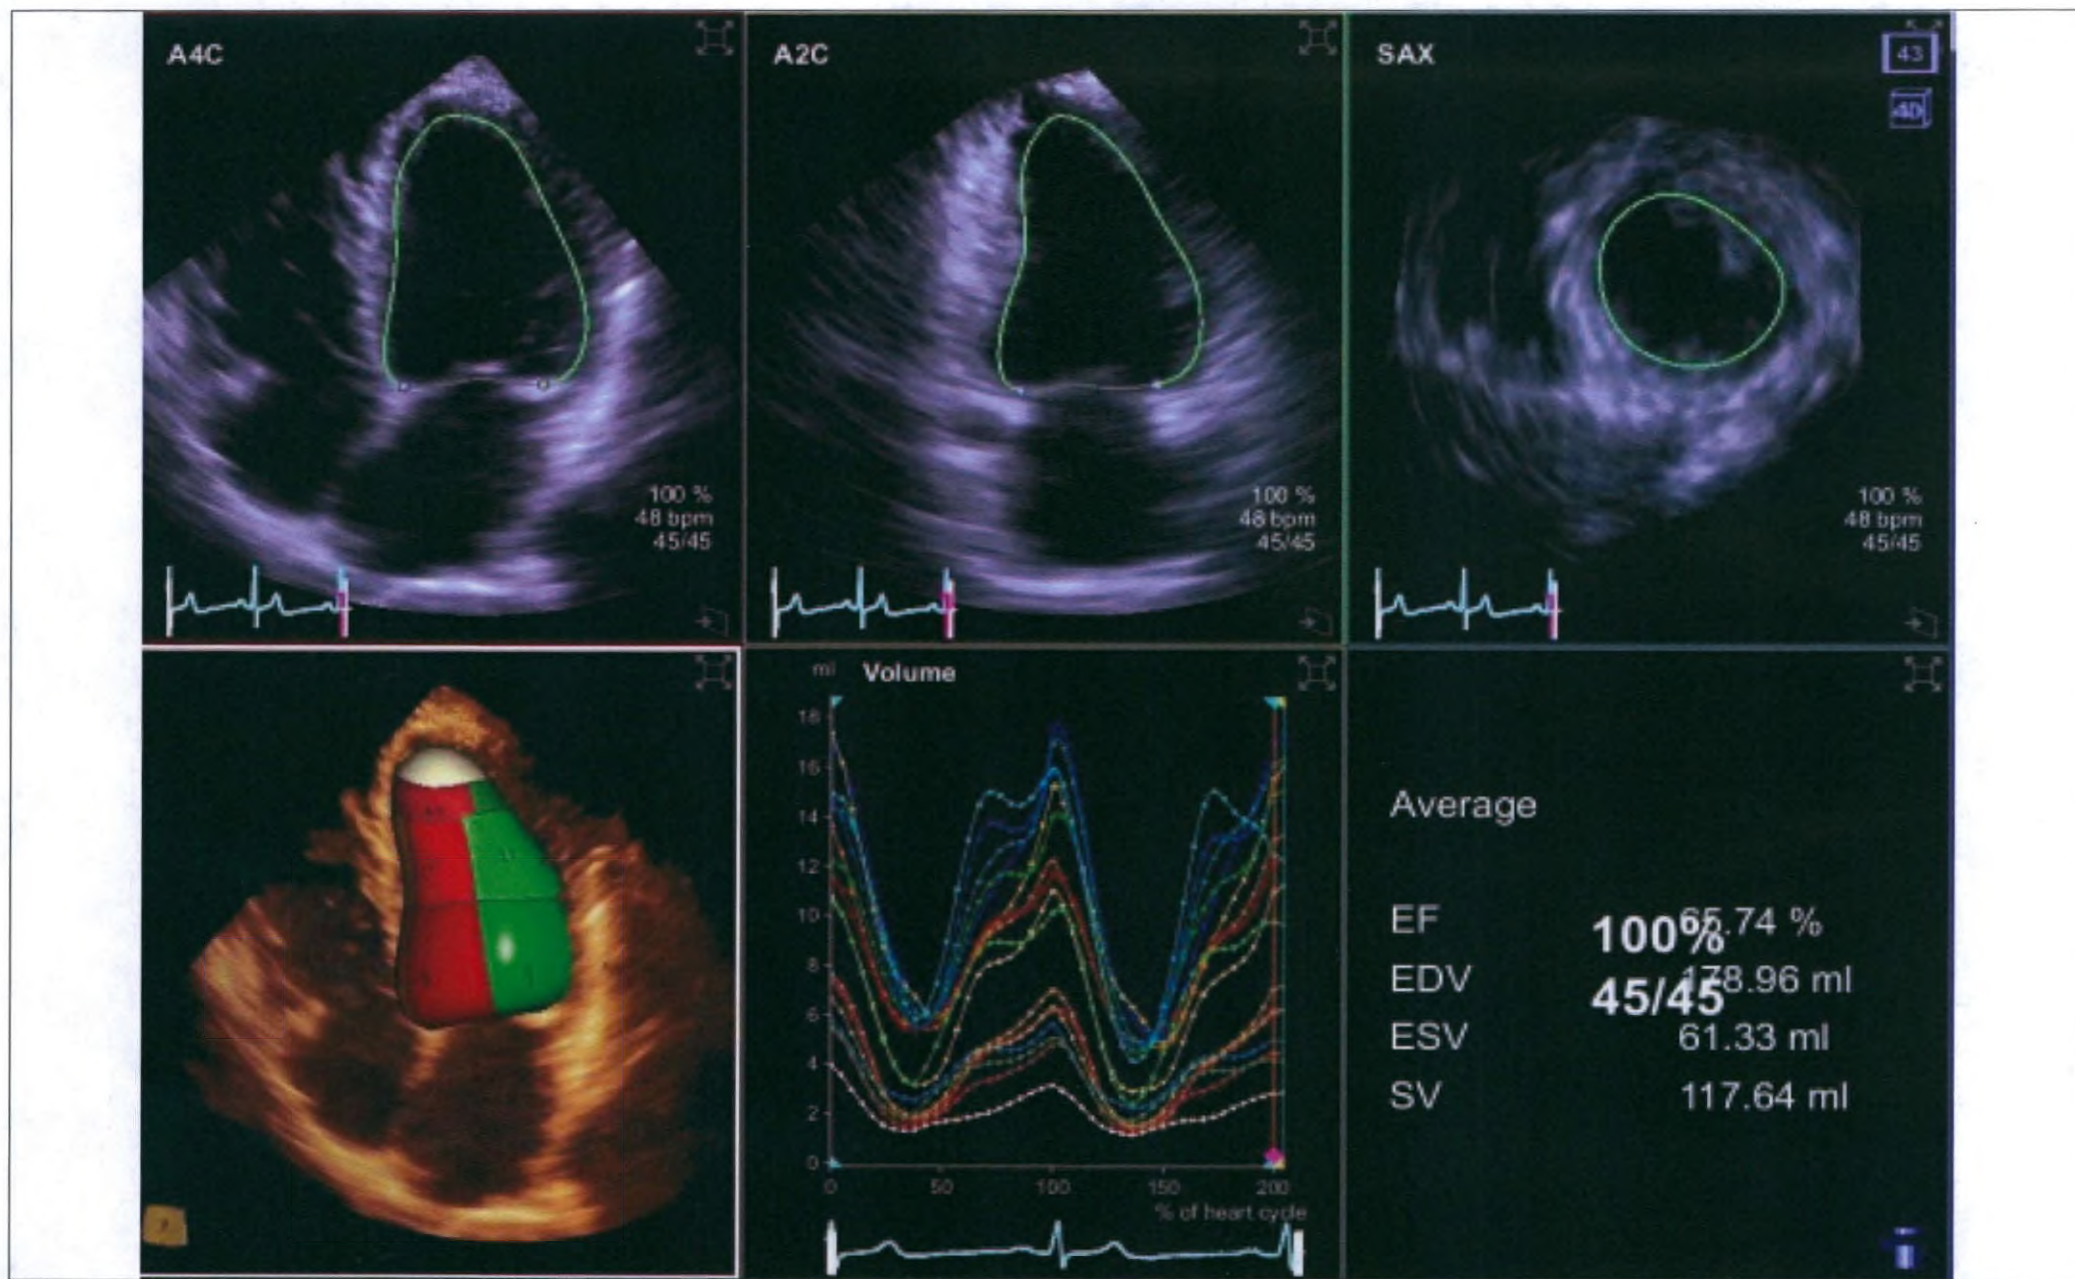

16. Лицензионный ключ для поддержки количественного анализа левого желудочка на основе объёмных данных




Average

EF	65.74 %
EDV	178.96 ml
ESV	61.33 ml
SV	117.64 ml



17 Segment Model



Volume

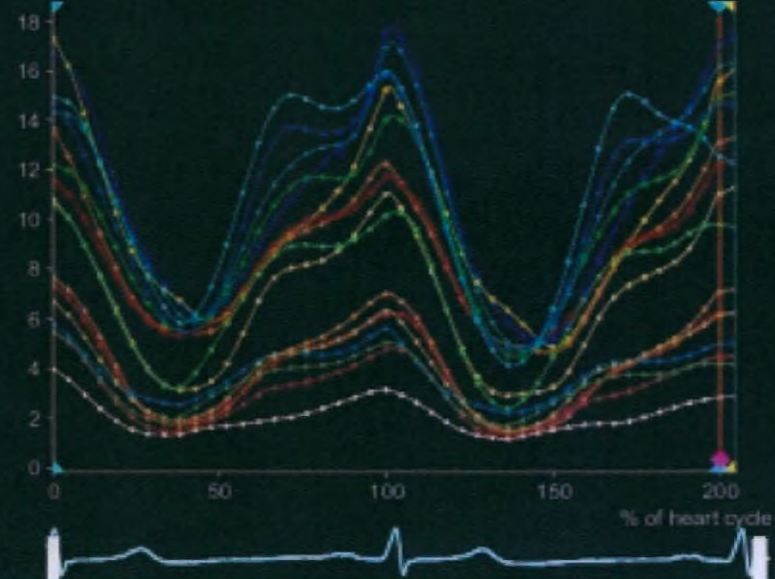


17. Лицензионный ключ для поддержки количественного анализа левого желудочка на основе объёмных данных множественных сердечных циклов

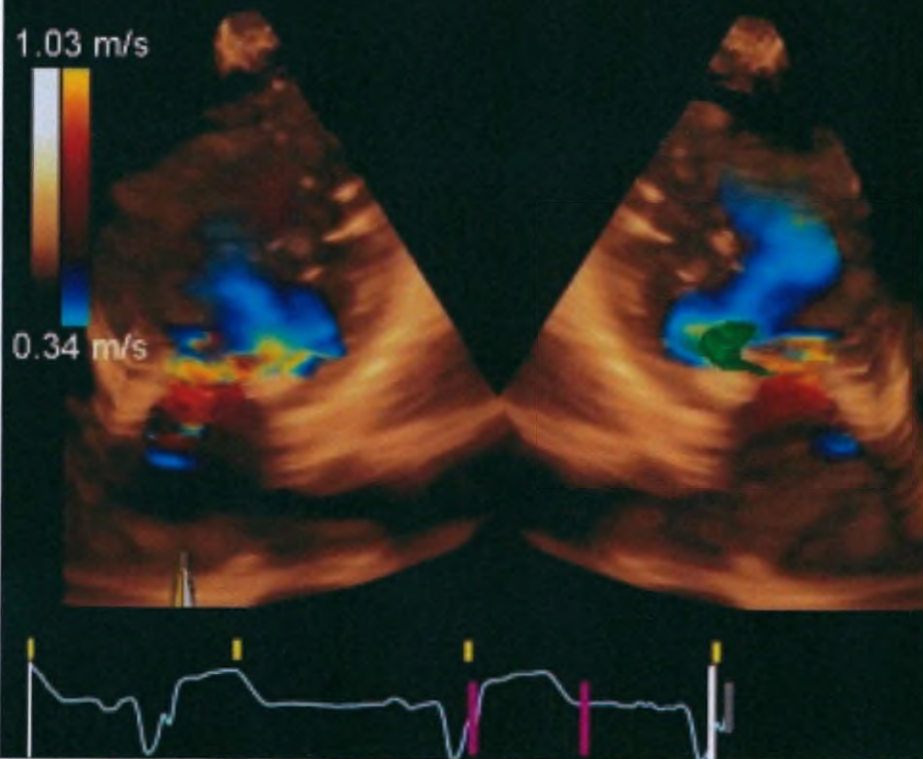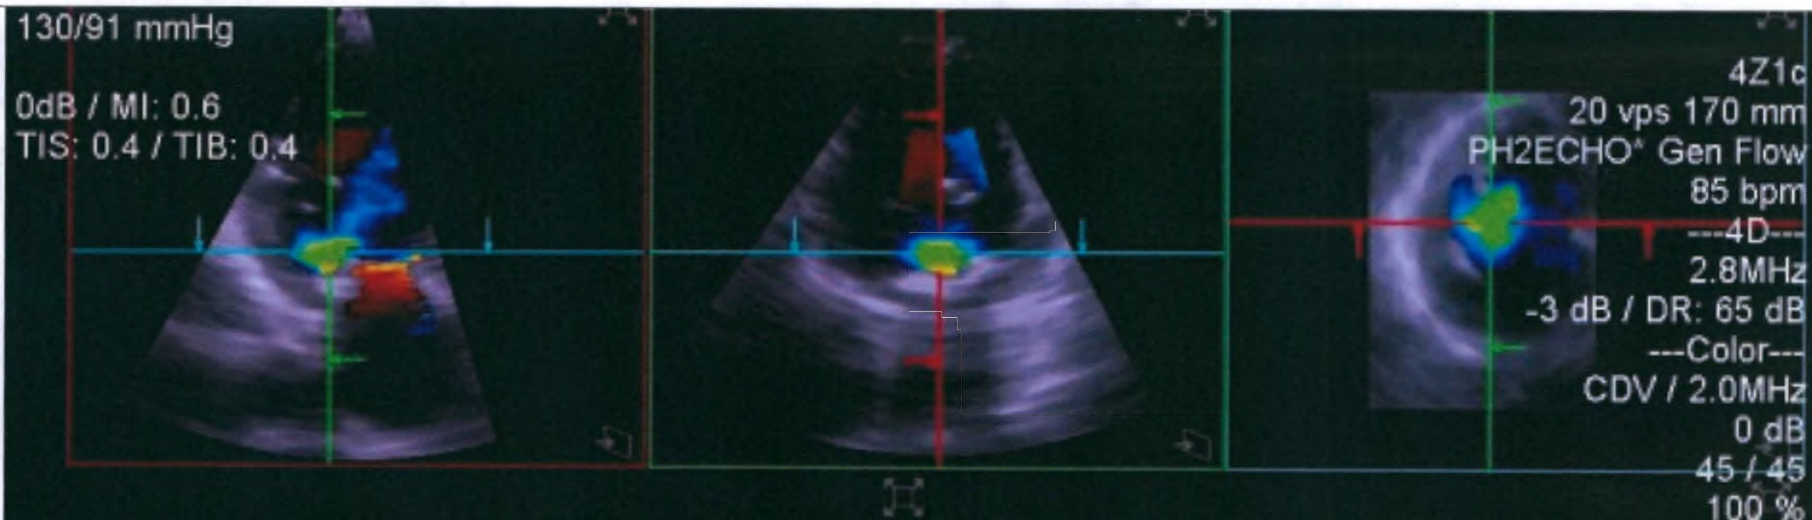


Mitral Regurgitation Measurement

Measurement	Current	Peak
Volume PISA	10.71	10.71 cm ²
Aliasing Velocity	0.34	0.34 m/s
Inst. Flow Rate	368.16	368.16 ml/s
Peak RF	--	-- %
VTI	--	-- m
ERO	0.8	0.8 cm ²
Peak Regurg Vol	--	-- ml


18. Лицензионный ключ для анализа регургитации клапанов сердца на основе объёмных данных цветного доплеровского картирования

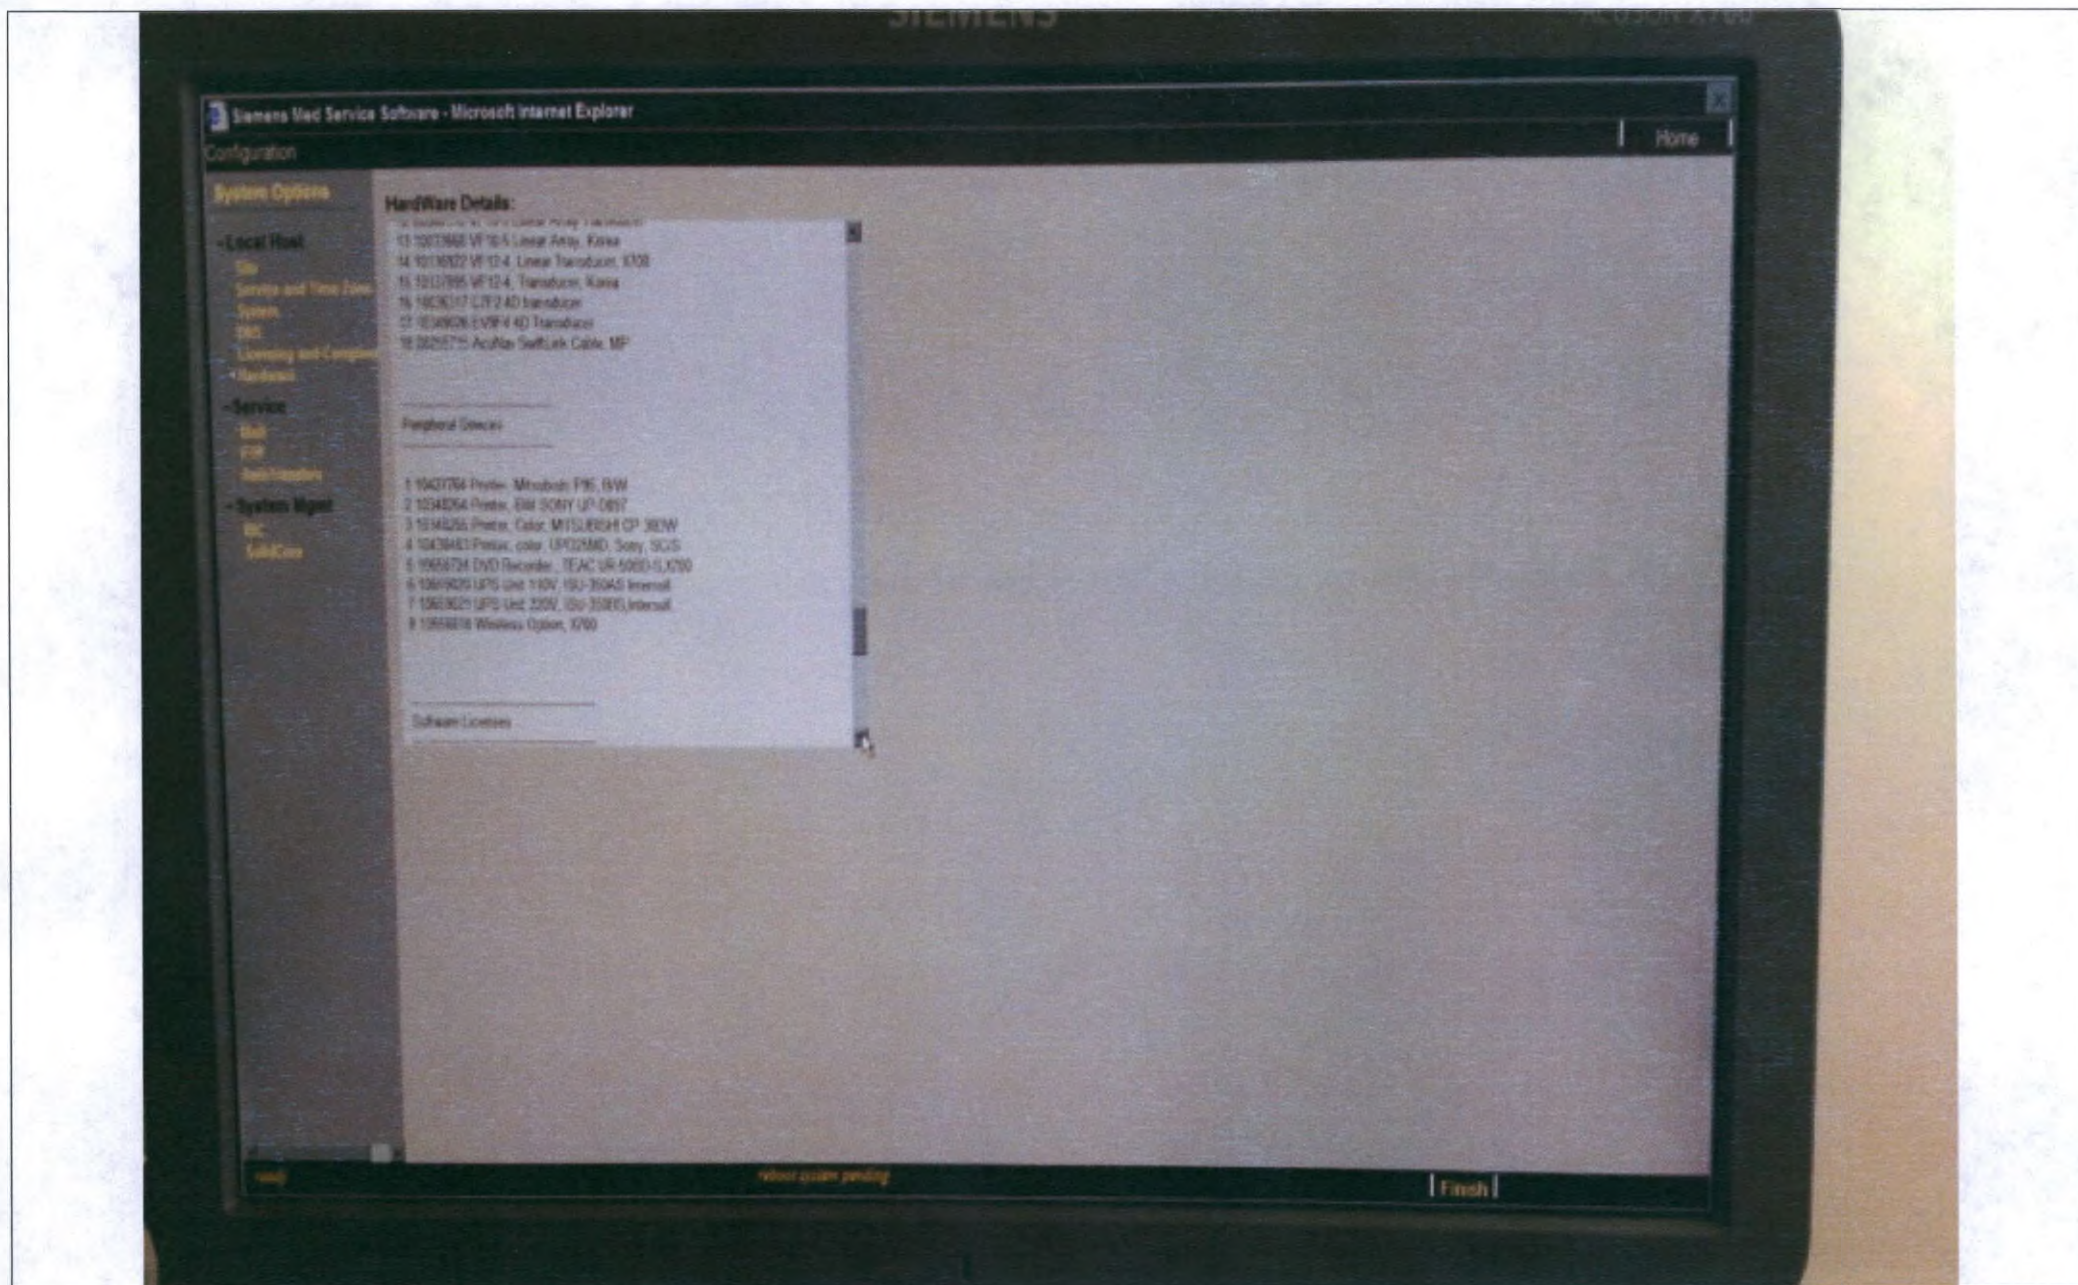


19. Лицензионный ключ для беспроводной передачи данных

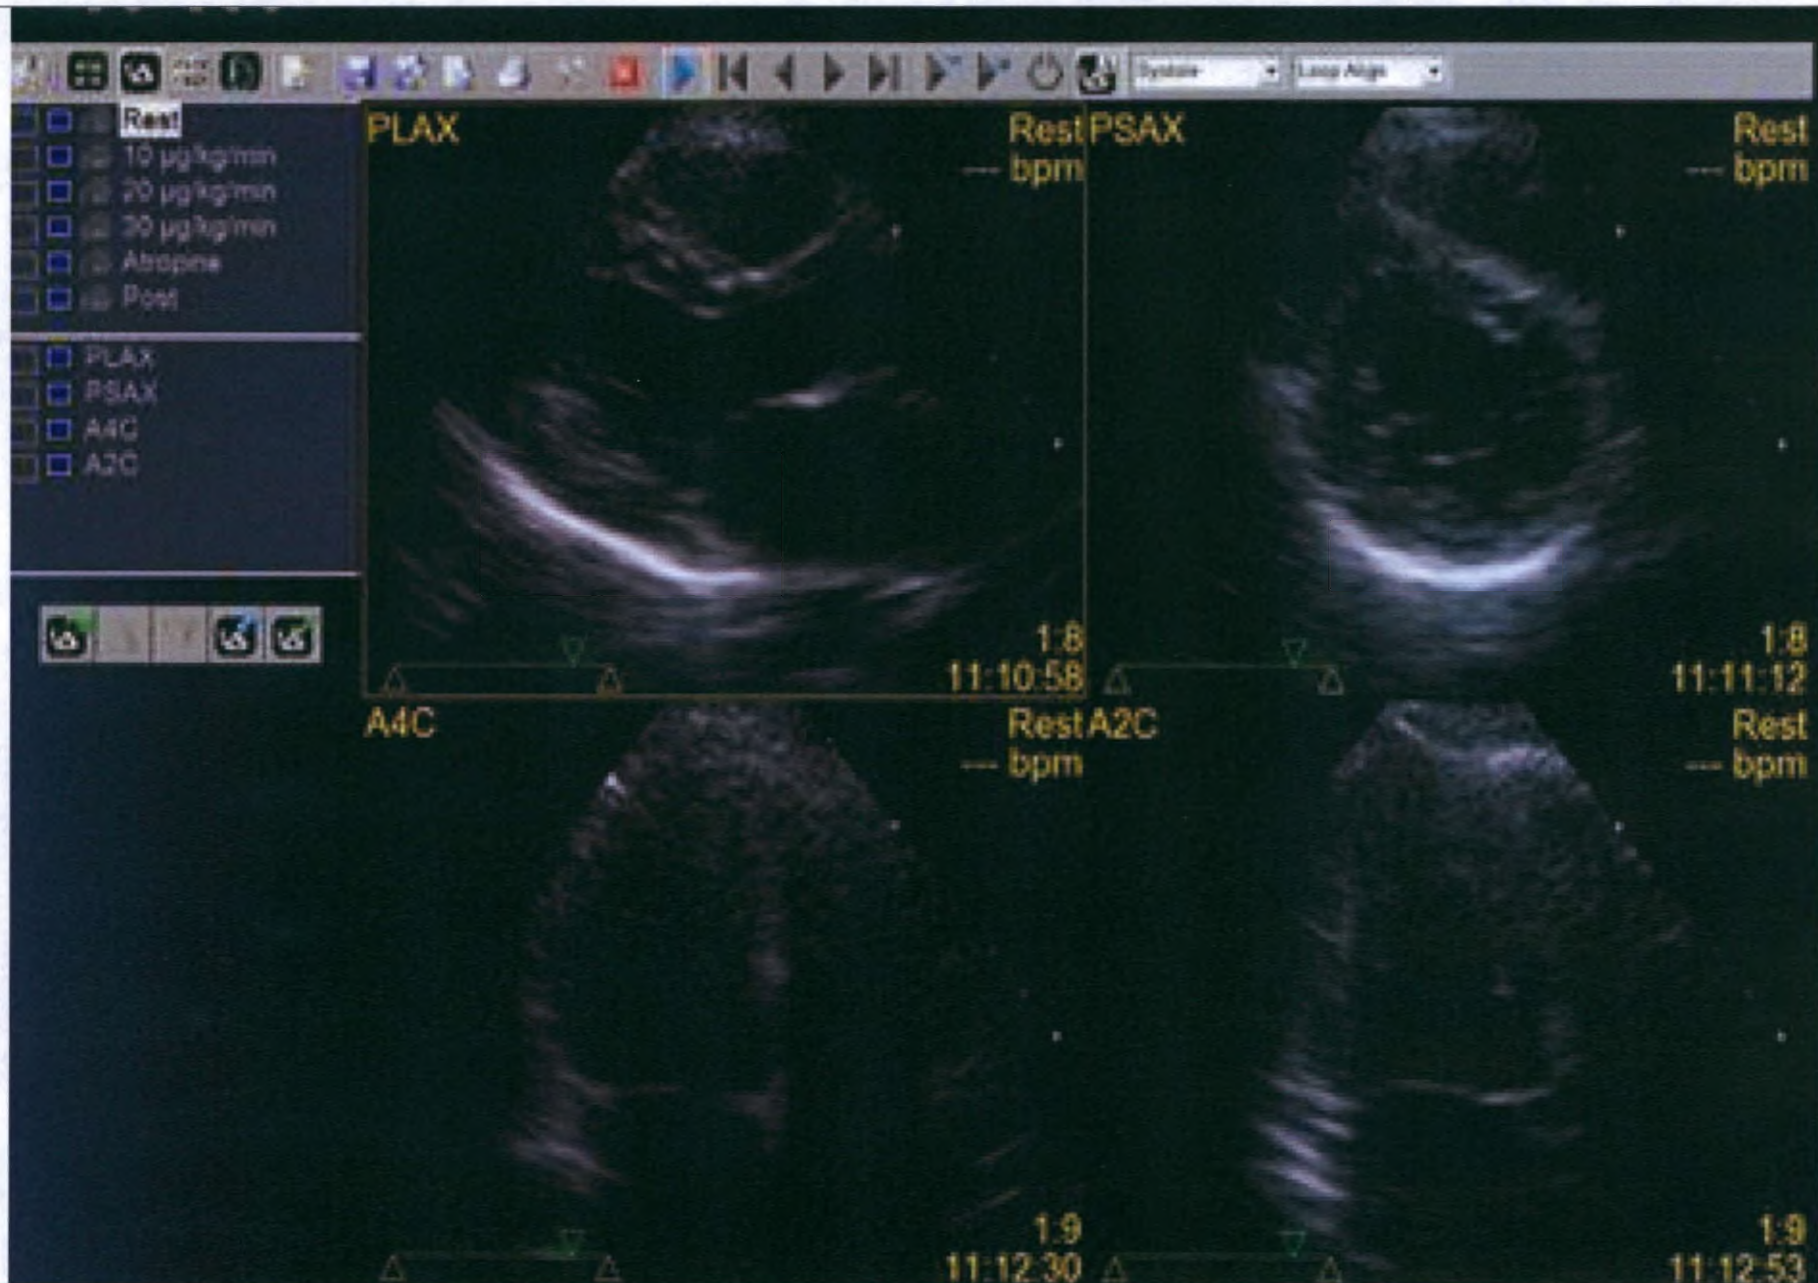


20. Лицензионный ключ для внутрисердечной эхографии

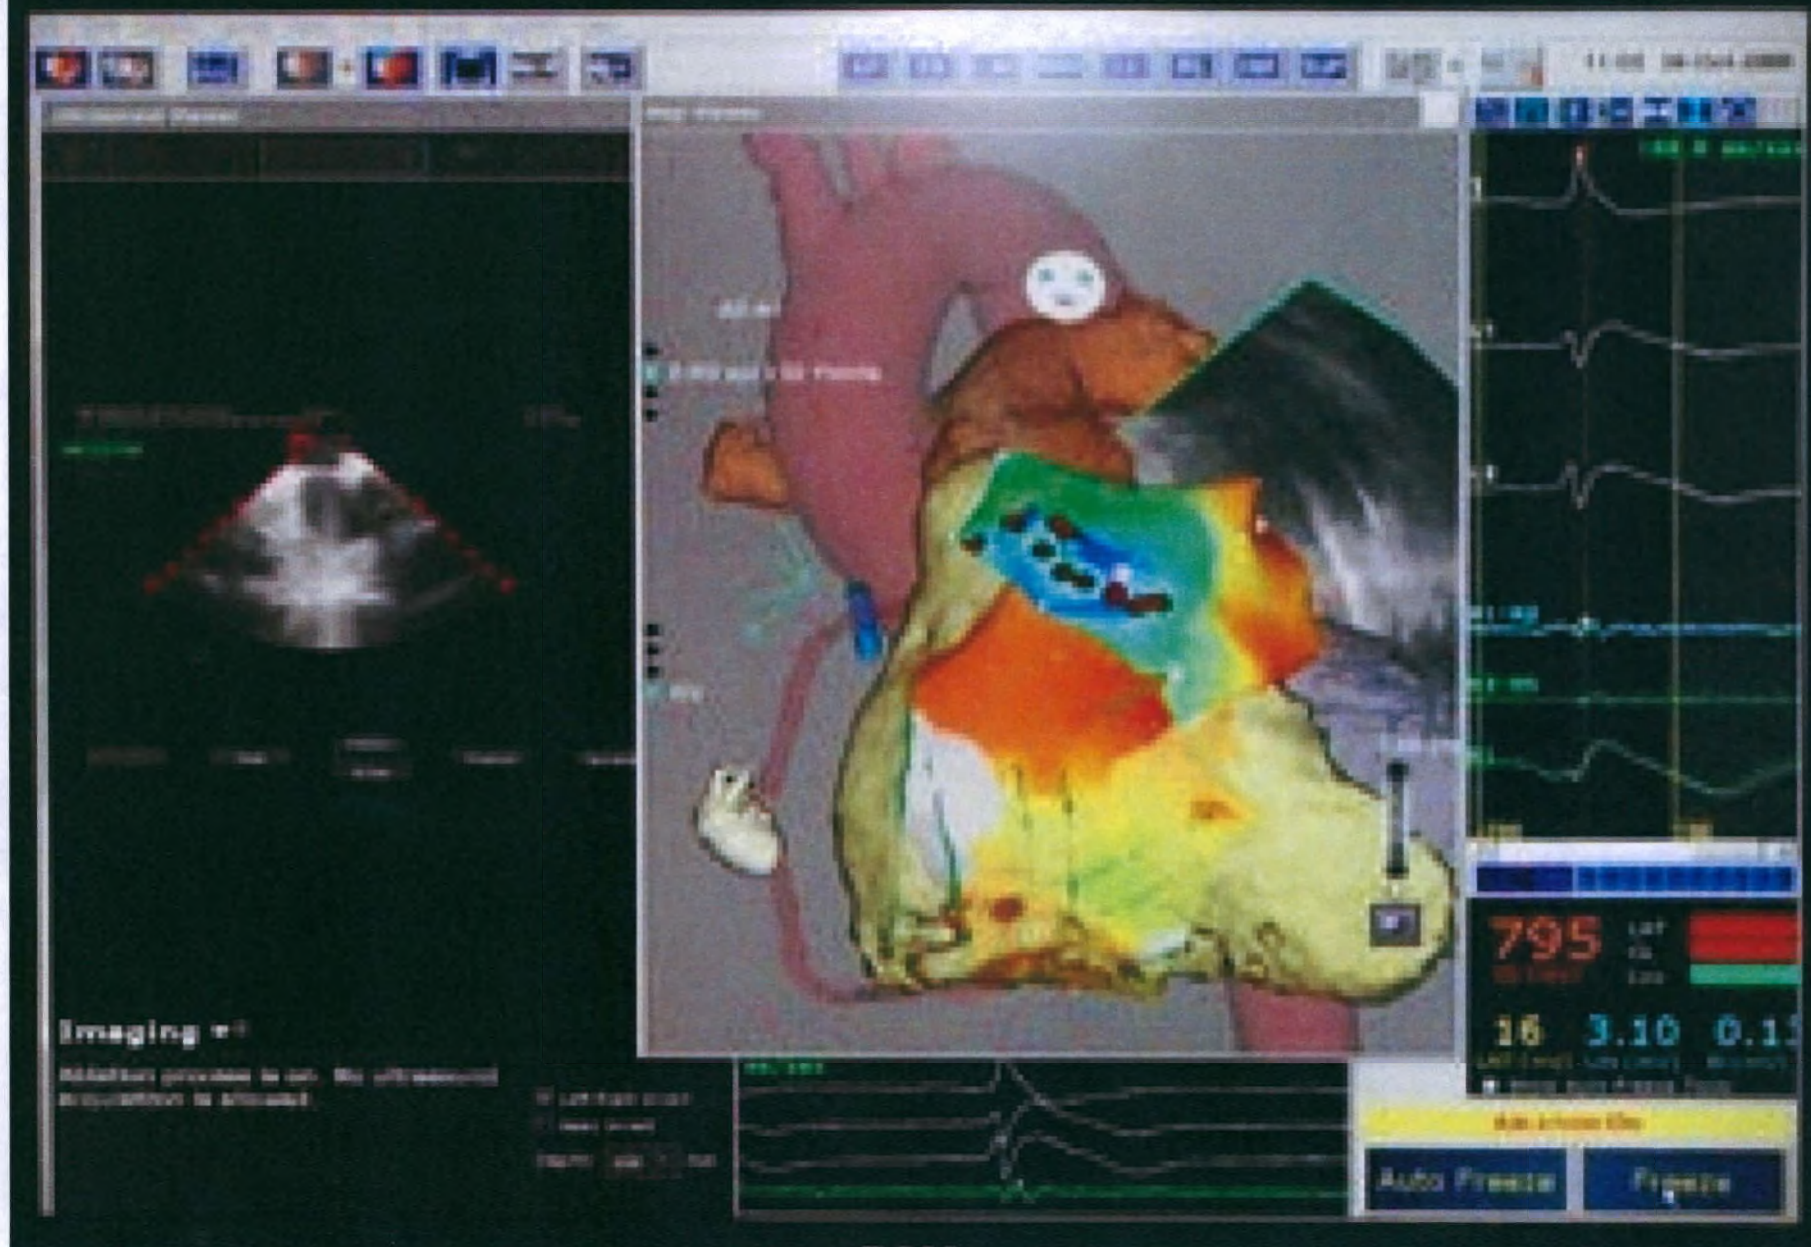

21.1 Лицензионный ключ для коммуникационного пакета CartoSound

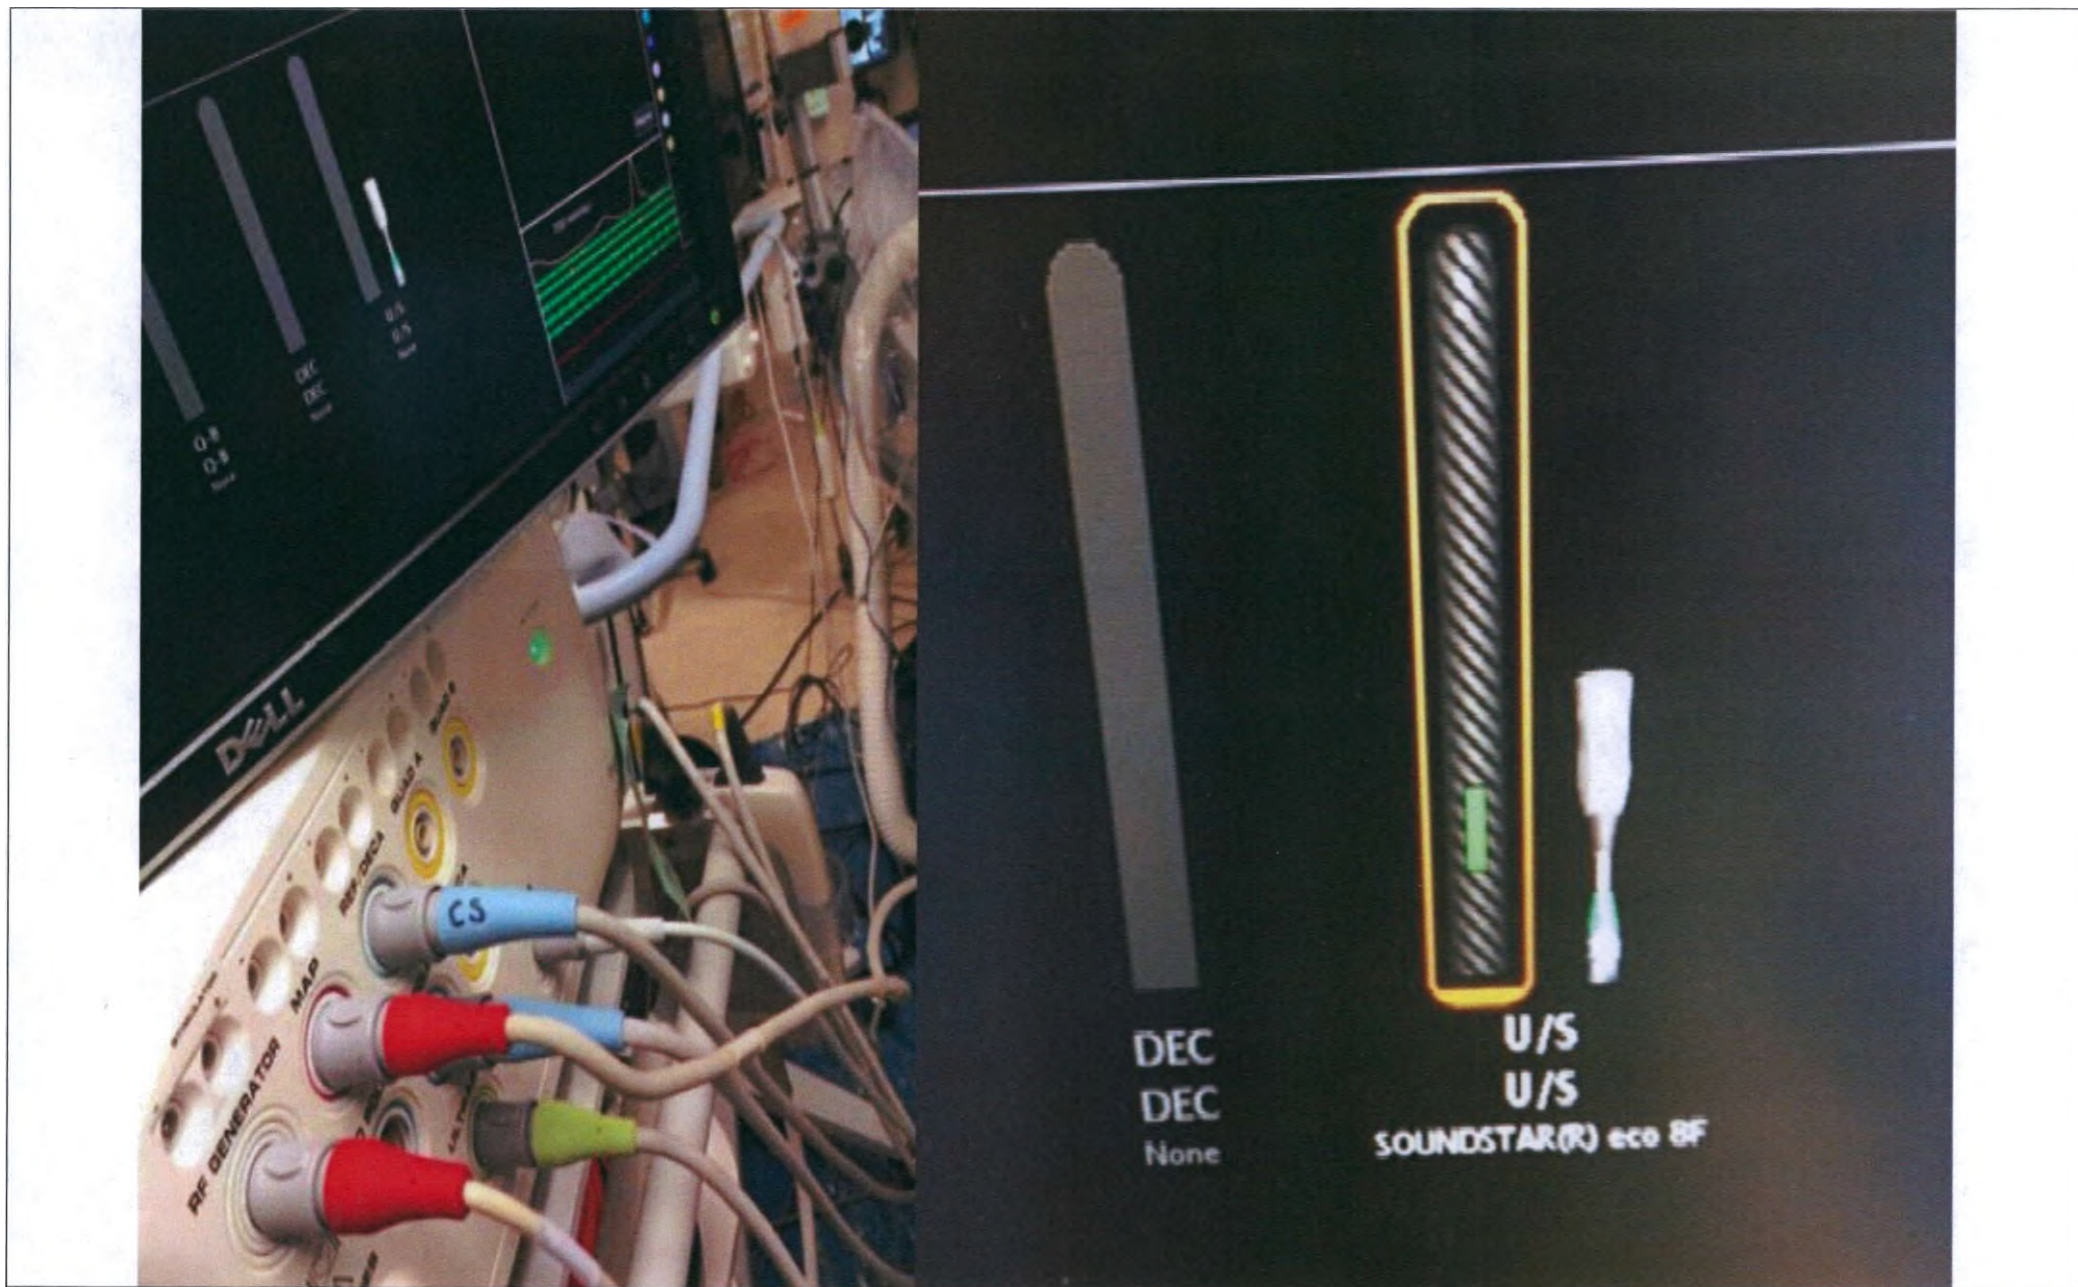


21.2 Лицензионный ключ для коммуникационного пакета CartoSound

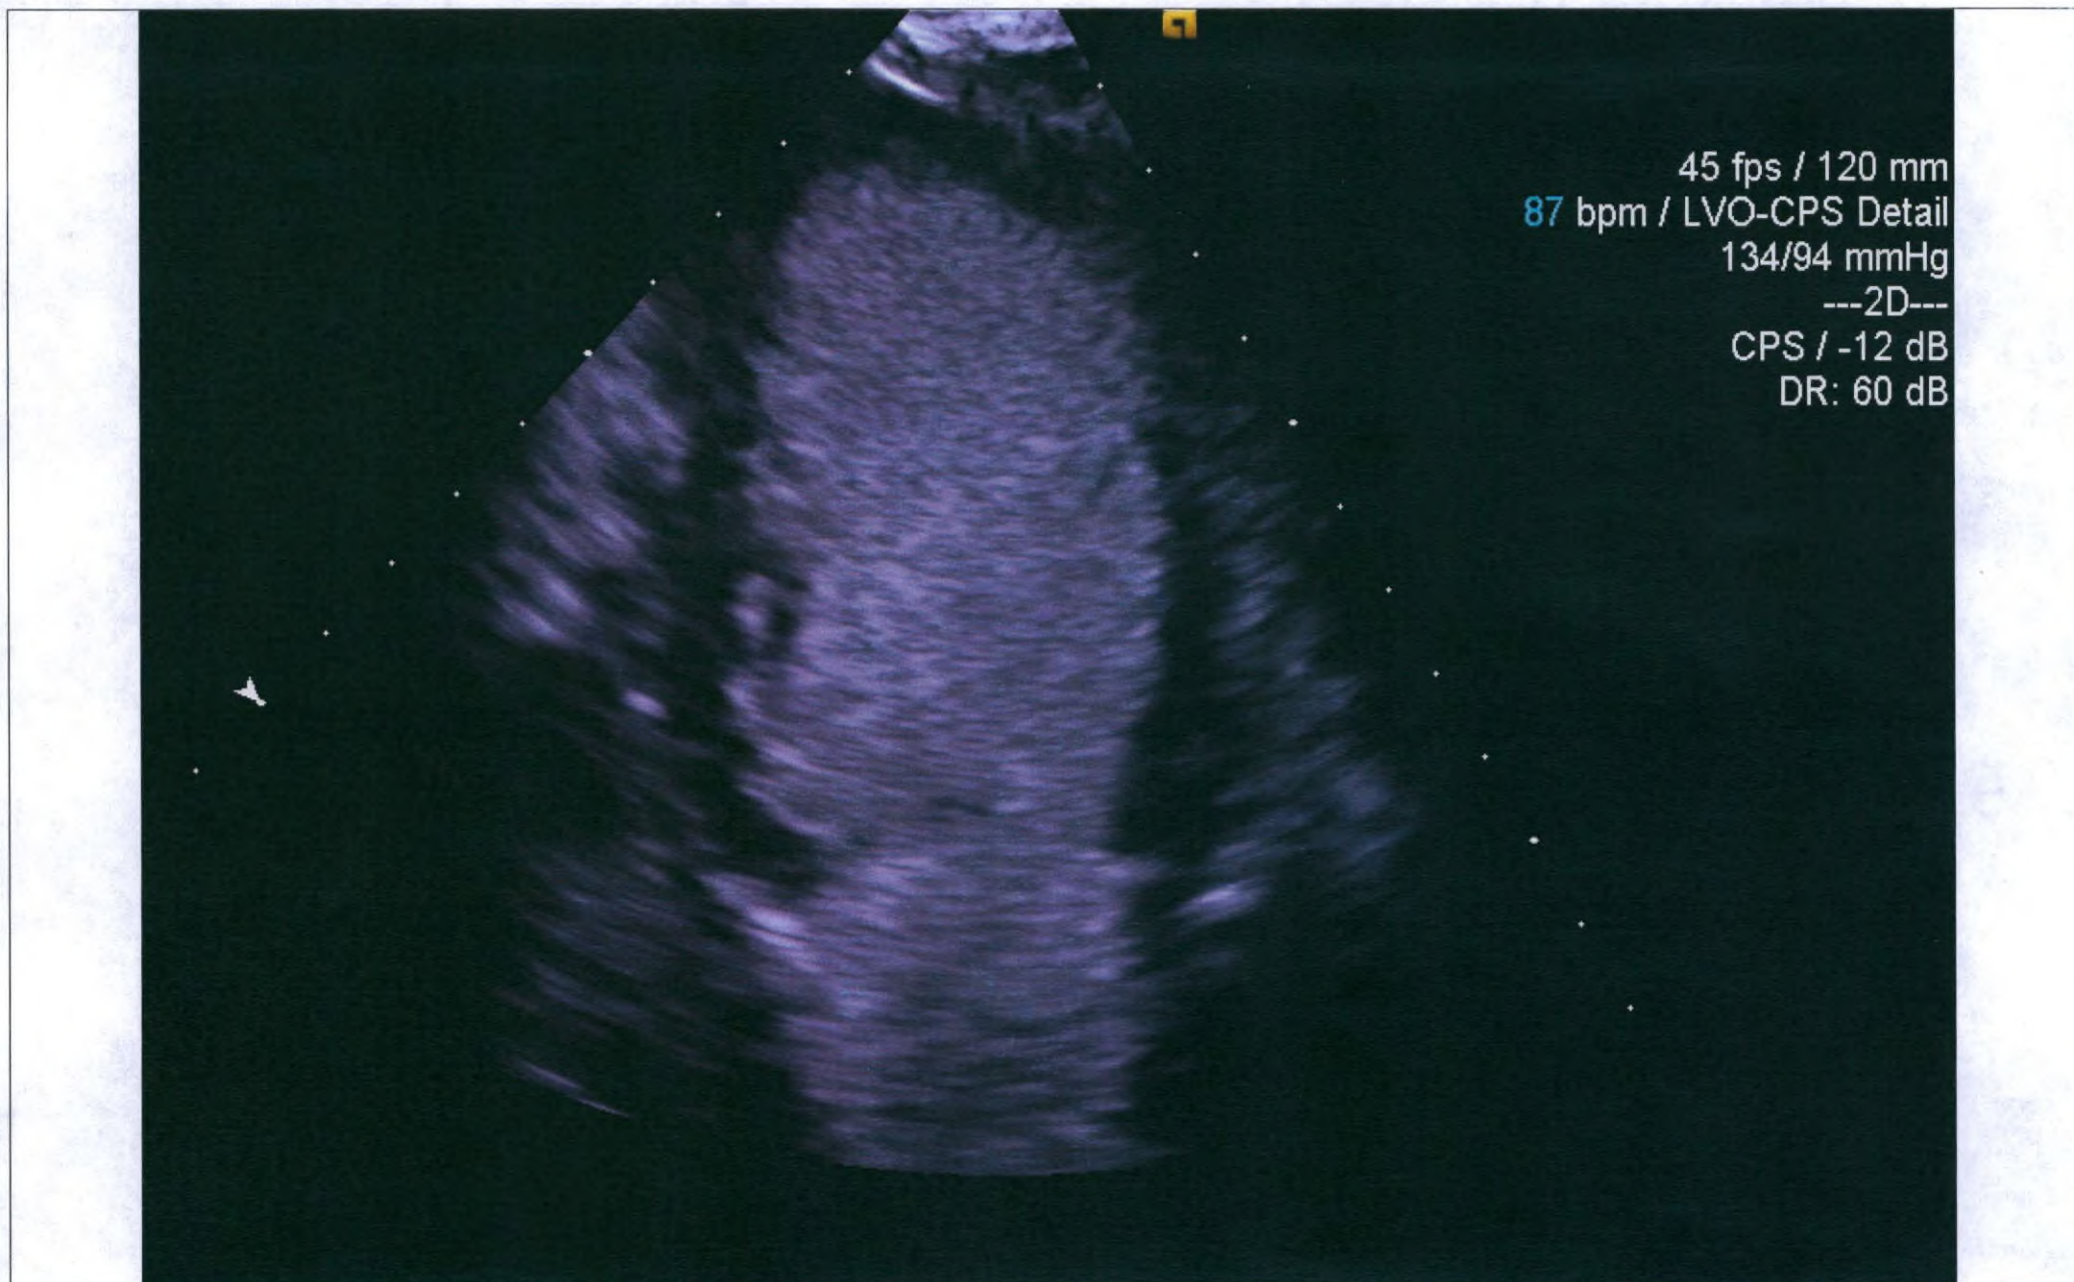

45 fps / 120 mm
87 bpm / LVO-CPS Detail
134/94 mmHg
---2D---
CPS / -12 dB
DR: 60 dB

22. Лицензионный ключ для опции контрастирования левого желудочка

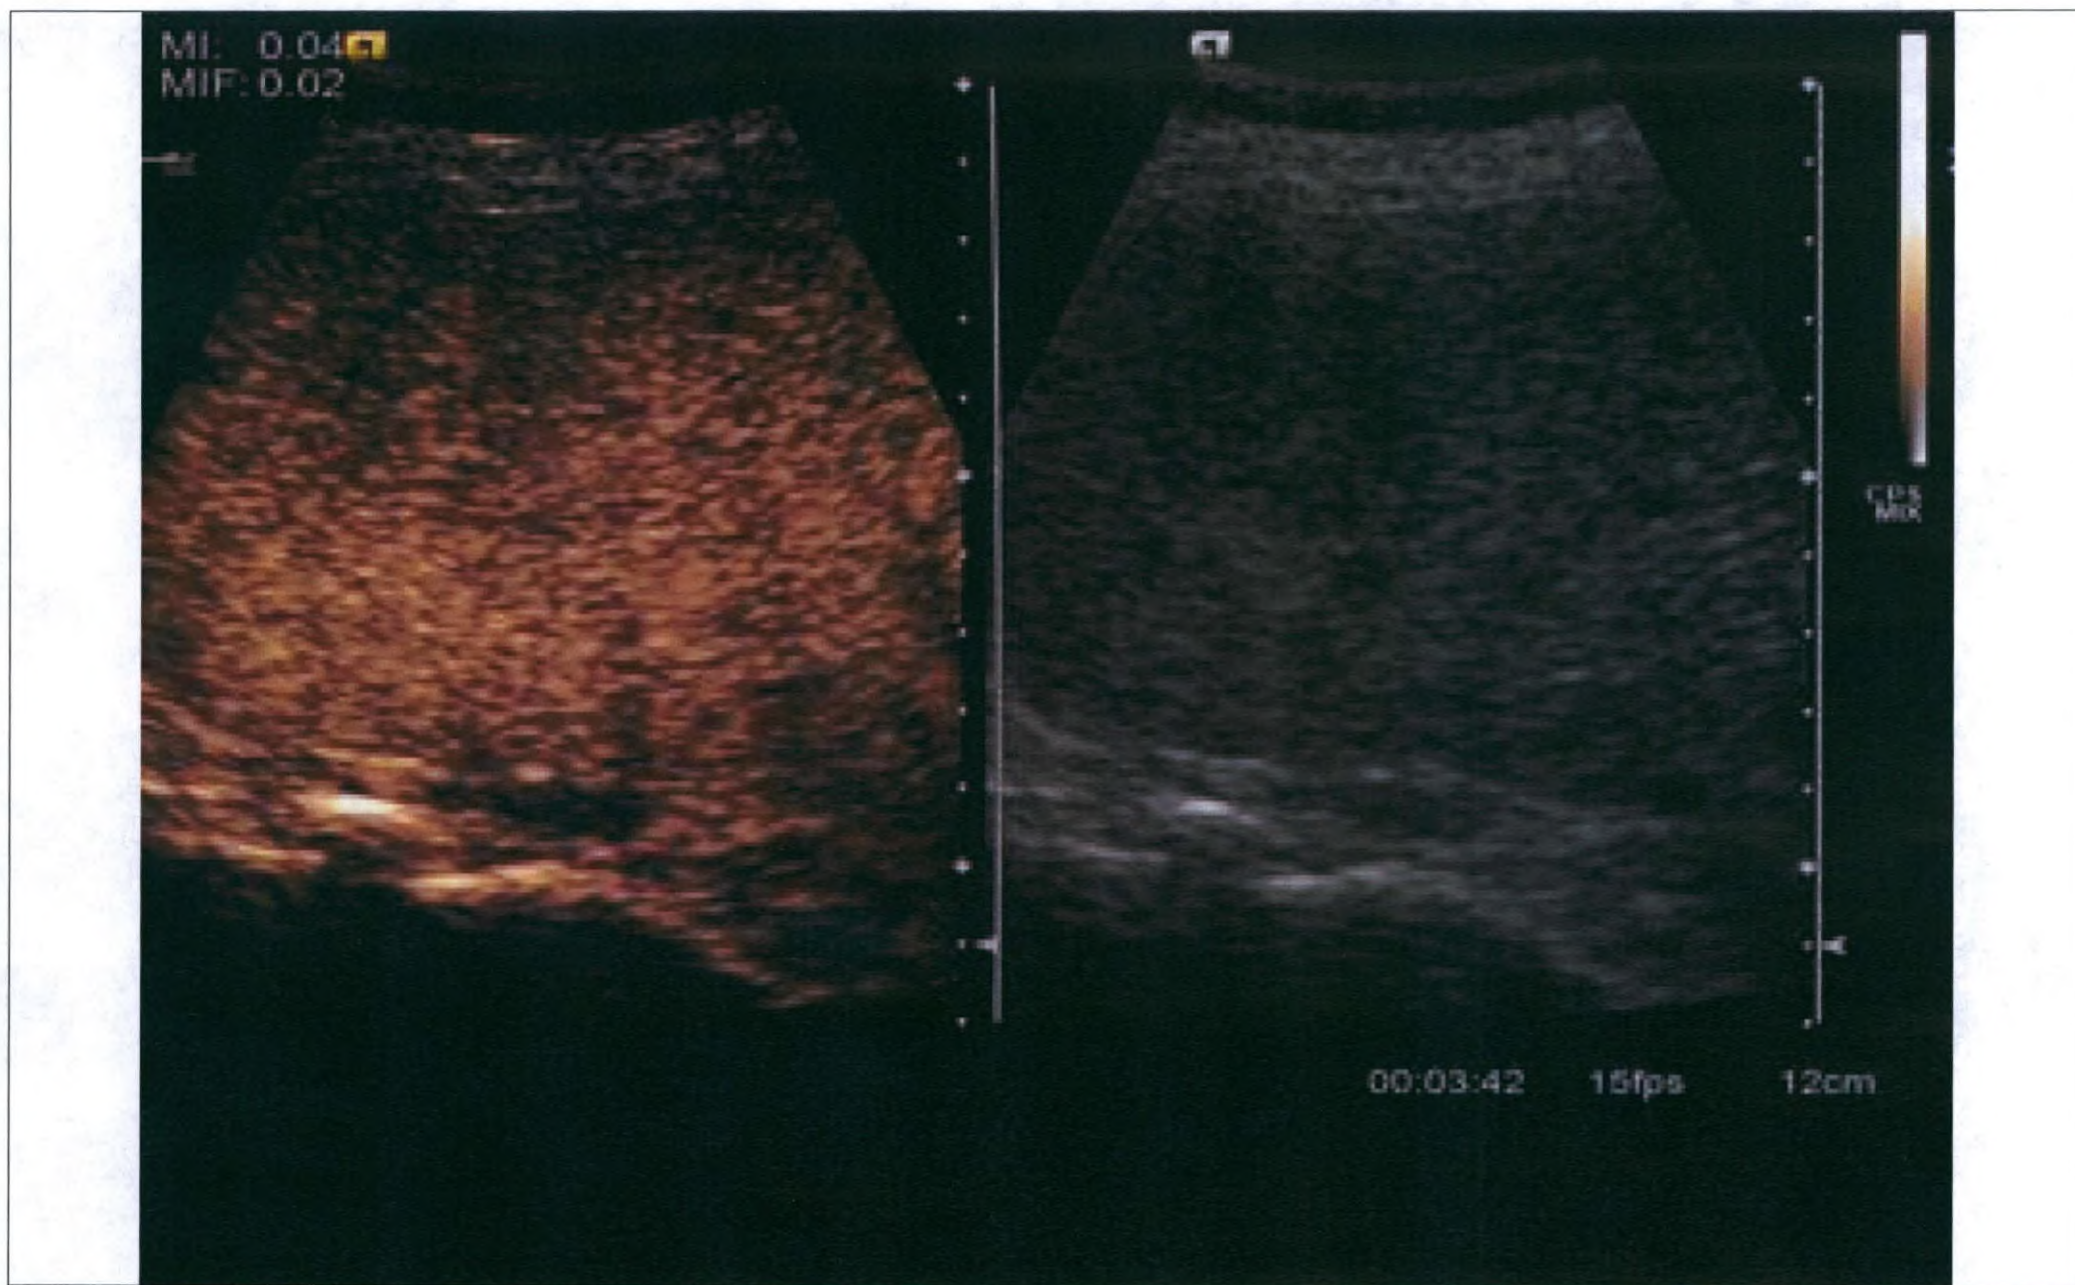

23. Лицензионный ключ для визуализации с применением контрастного вещества в режиме реального времени

Presets

- General 1
- General 2
- Peripheral
- Customize Keys
- Display
- Exam Configuration
- User-Defined Exam List
- Text Annotation
- Pictogram List
- M & R Configuration
- Summary
- Service
- Stress Echo
- SieScape
- CAI
- Wireless
- DICOM**
- DIMAQ Utility
- Clip Capture
- Network Export
- Authorization
- Archive
- Printer

DICOM

Local Host | Storage Server | Worklist Server | MPPS Server | B/W Printer | Color Printer | Query/Retrieve

Local Host ☒ Show network status

Alias: Default

AE Title: Default

Host Name: Default

MAC Address: 00-19-0F-23-2C-DE

New Edit Delete

☐ DHCP

☐ Mapping Application

☒ Fixed IP address

IP Address: 192 168 0 1

Subnet Mask: 255 255 255 0

Default Gateway: 0 0 0 0

Media Type: HardwareDefault

Duplex Mode: HardwareDefault


Save Cancel




25. Подогреватель геля




26. Кабель ЭКГ на 3 отведения, европейский стандарт

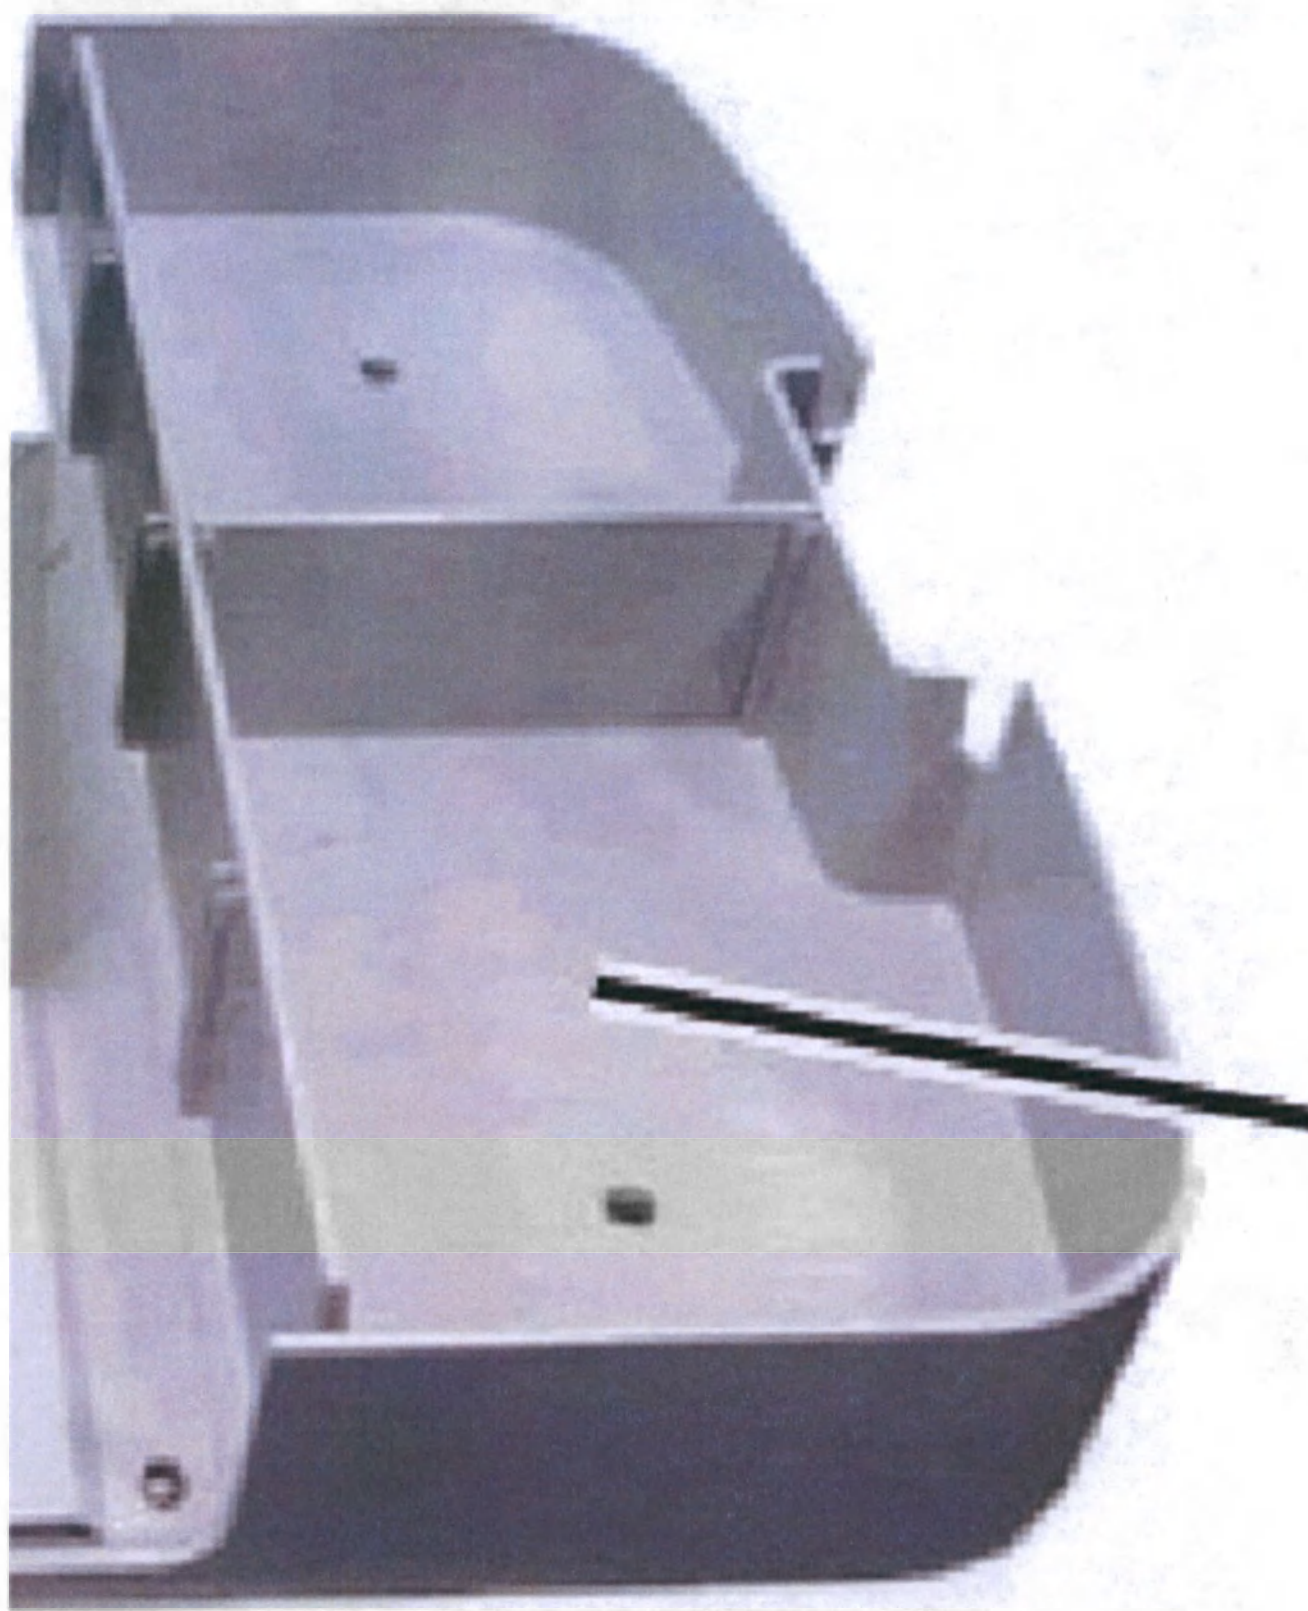


27. Лоток для принтеров и расходных материалов с кронштейном для крепления

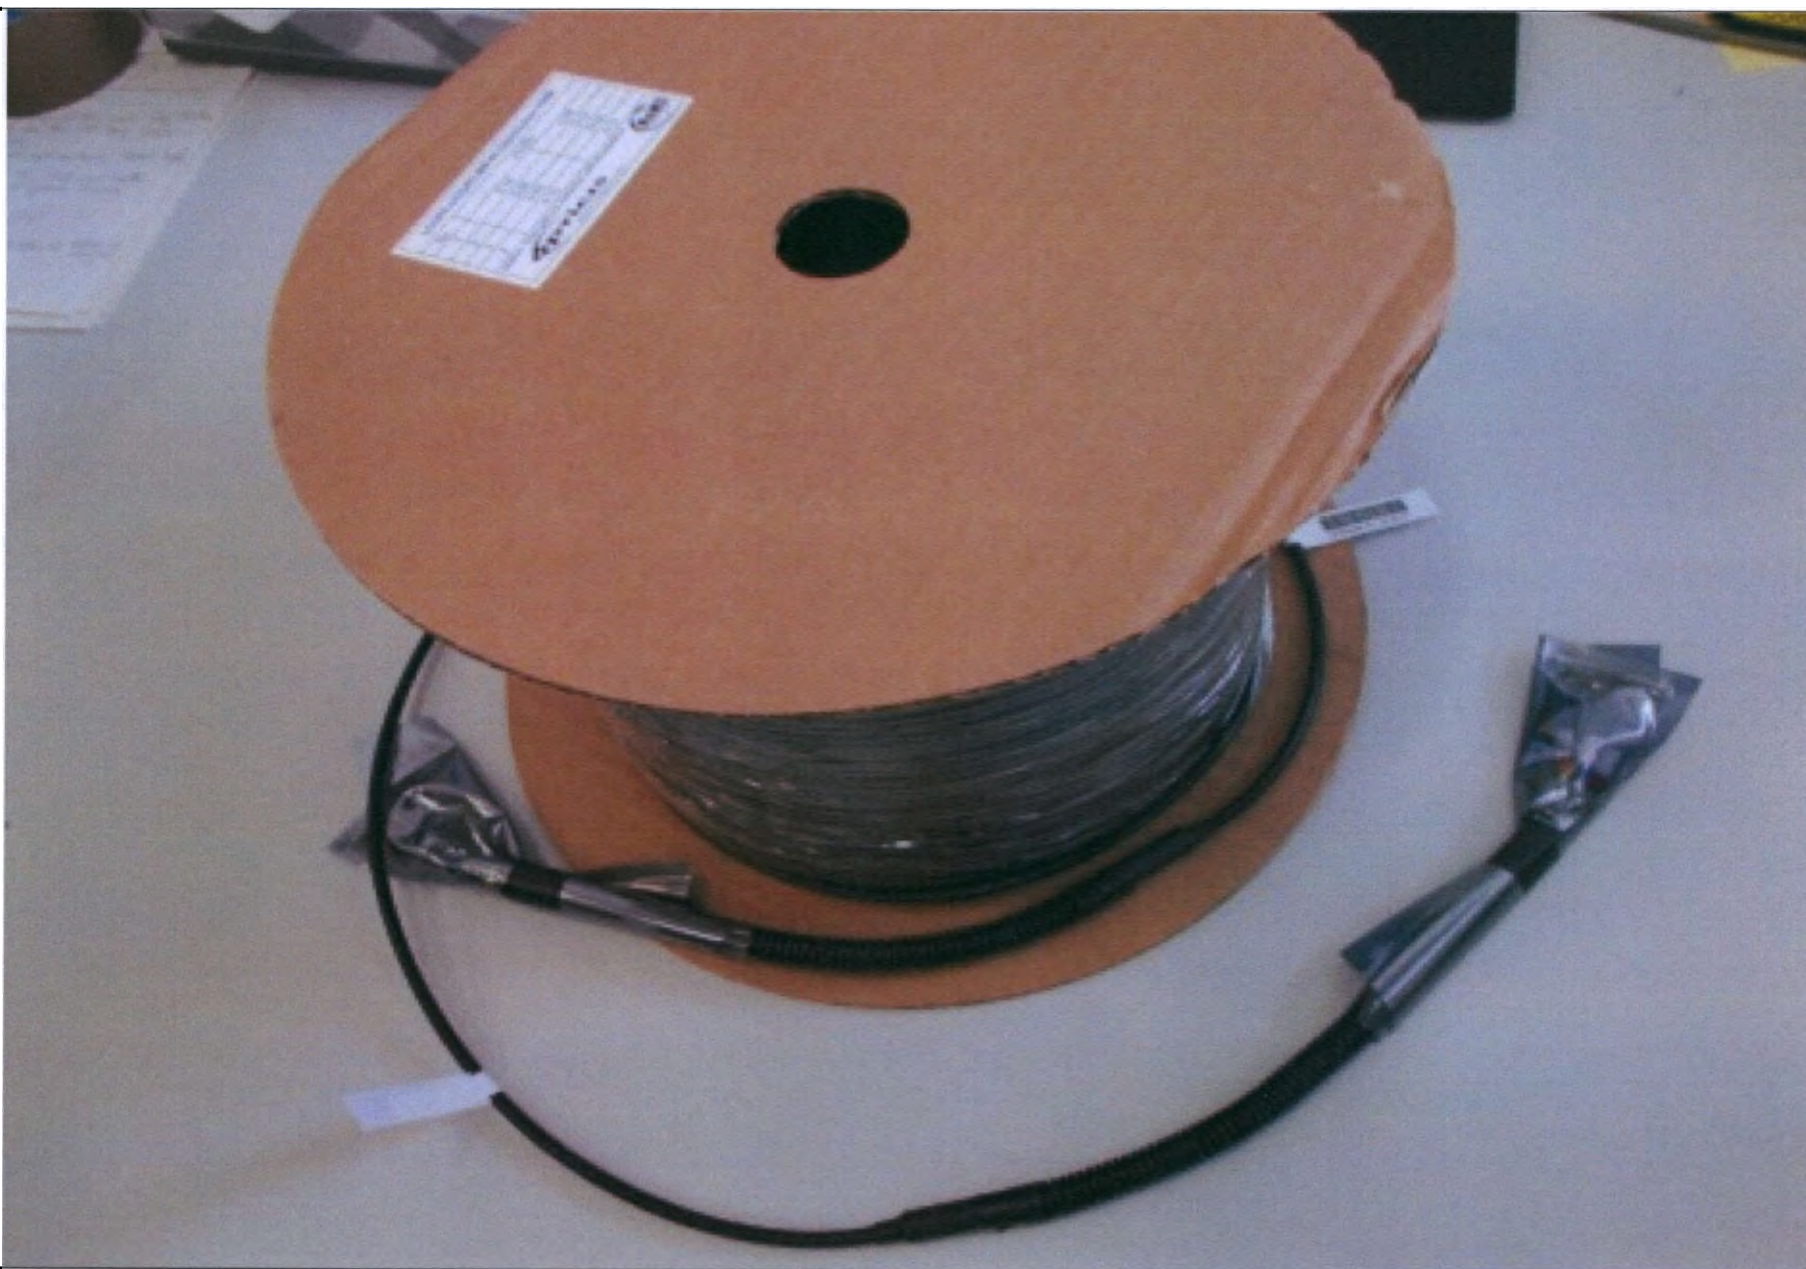

28. Кабели

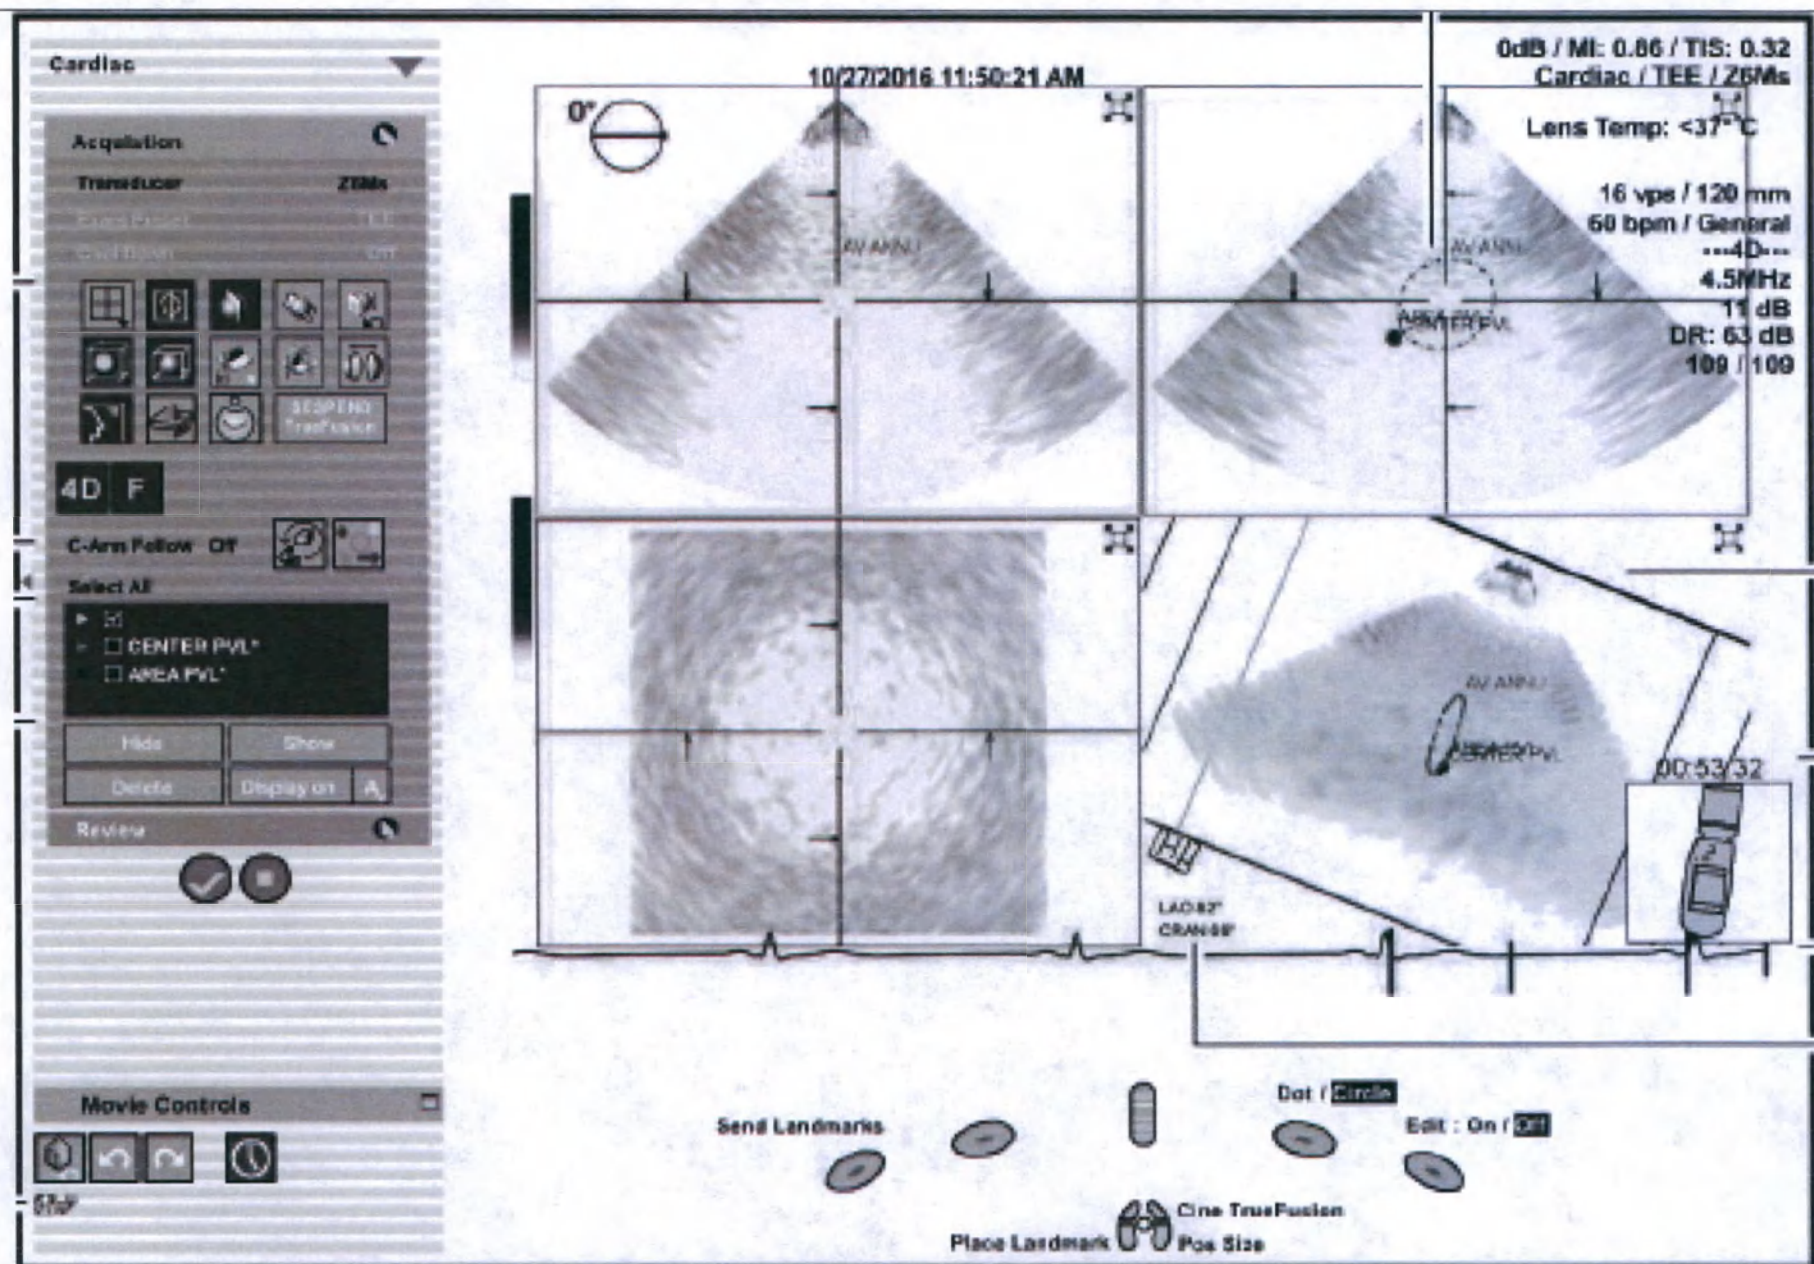

29. Лицензионный ключ для эхо - рентгеноскопического наведение (TrueFusion).

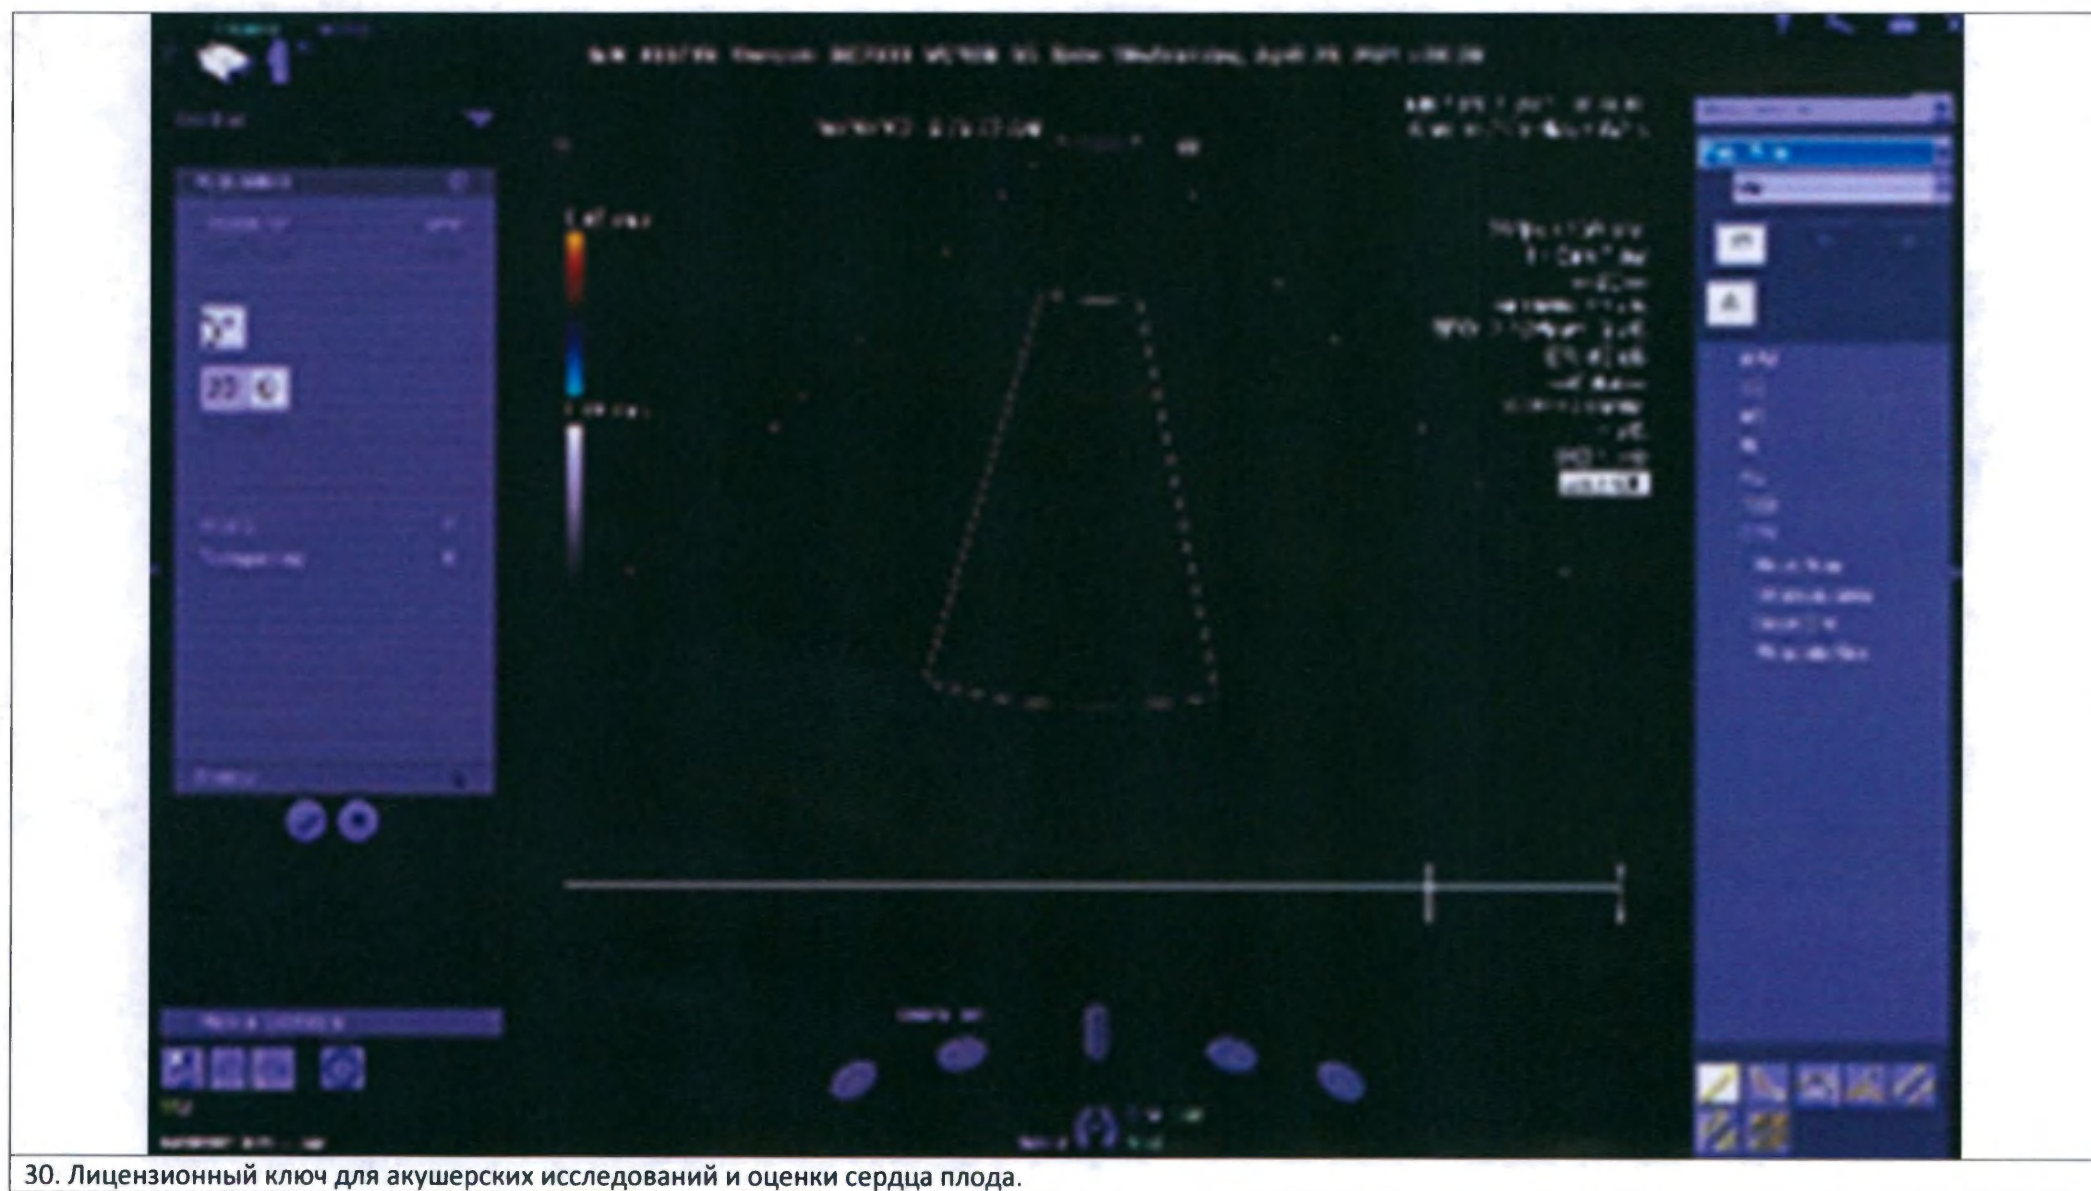

30. Лицензионный ключ для акушерских исследований и оценки сердца плода.



31. Лицензионный ключ для функции виртуальной коммуникации для оказания дистанционной помощи eSieLink

SIEMENS

Not a Memory Stick -

For Use With Ultrasound System Only



32. Лицензионный ключ для шифрования жесткого диска




33. Джойстик дистанционного управления для операционного стола



34. Одноразовые электроды для ЭКГ



35. Принтер черно-белый для печати медицинских изображений

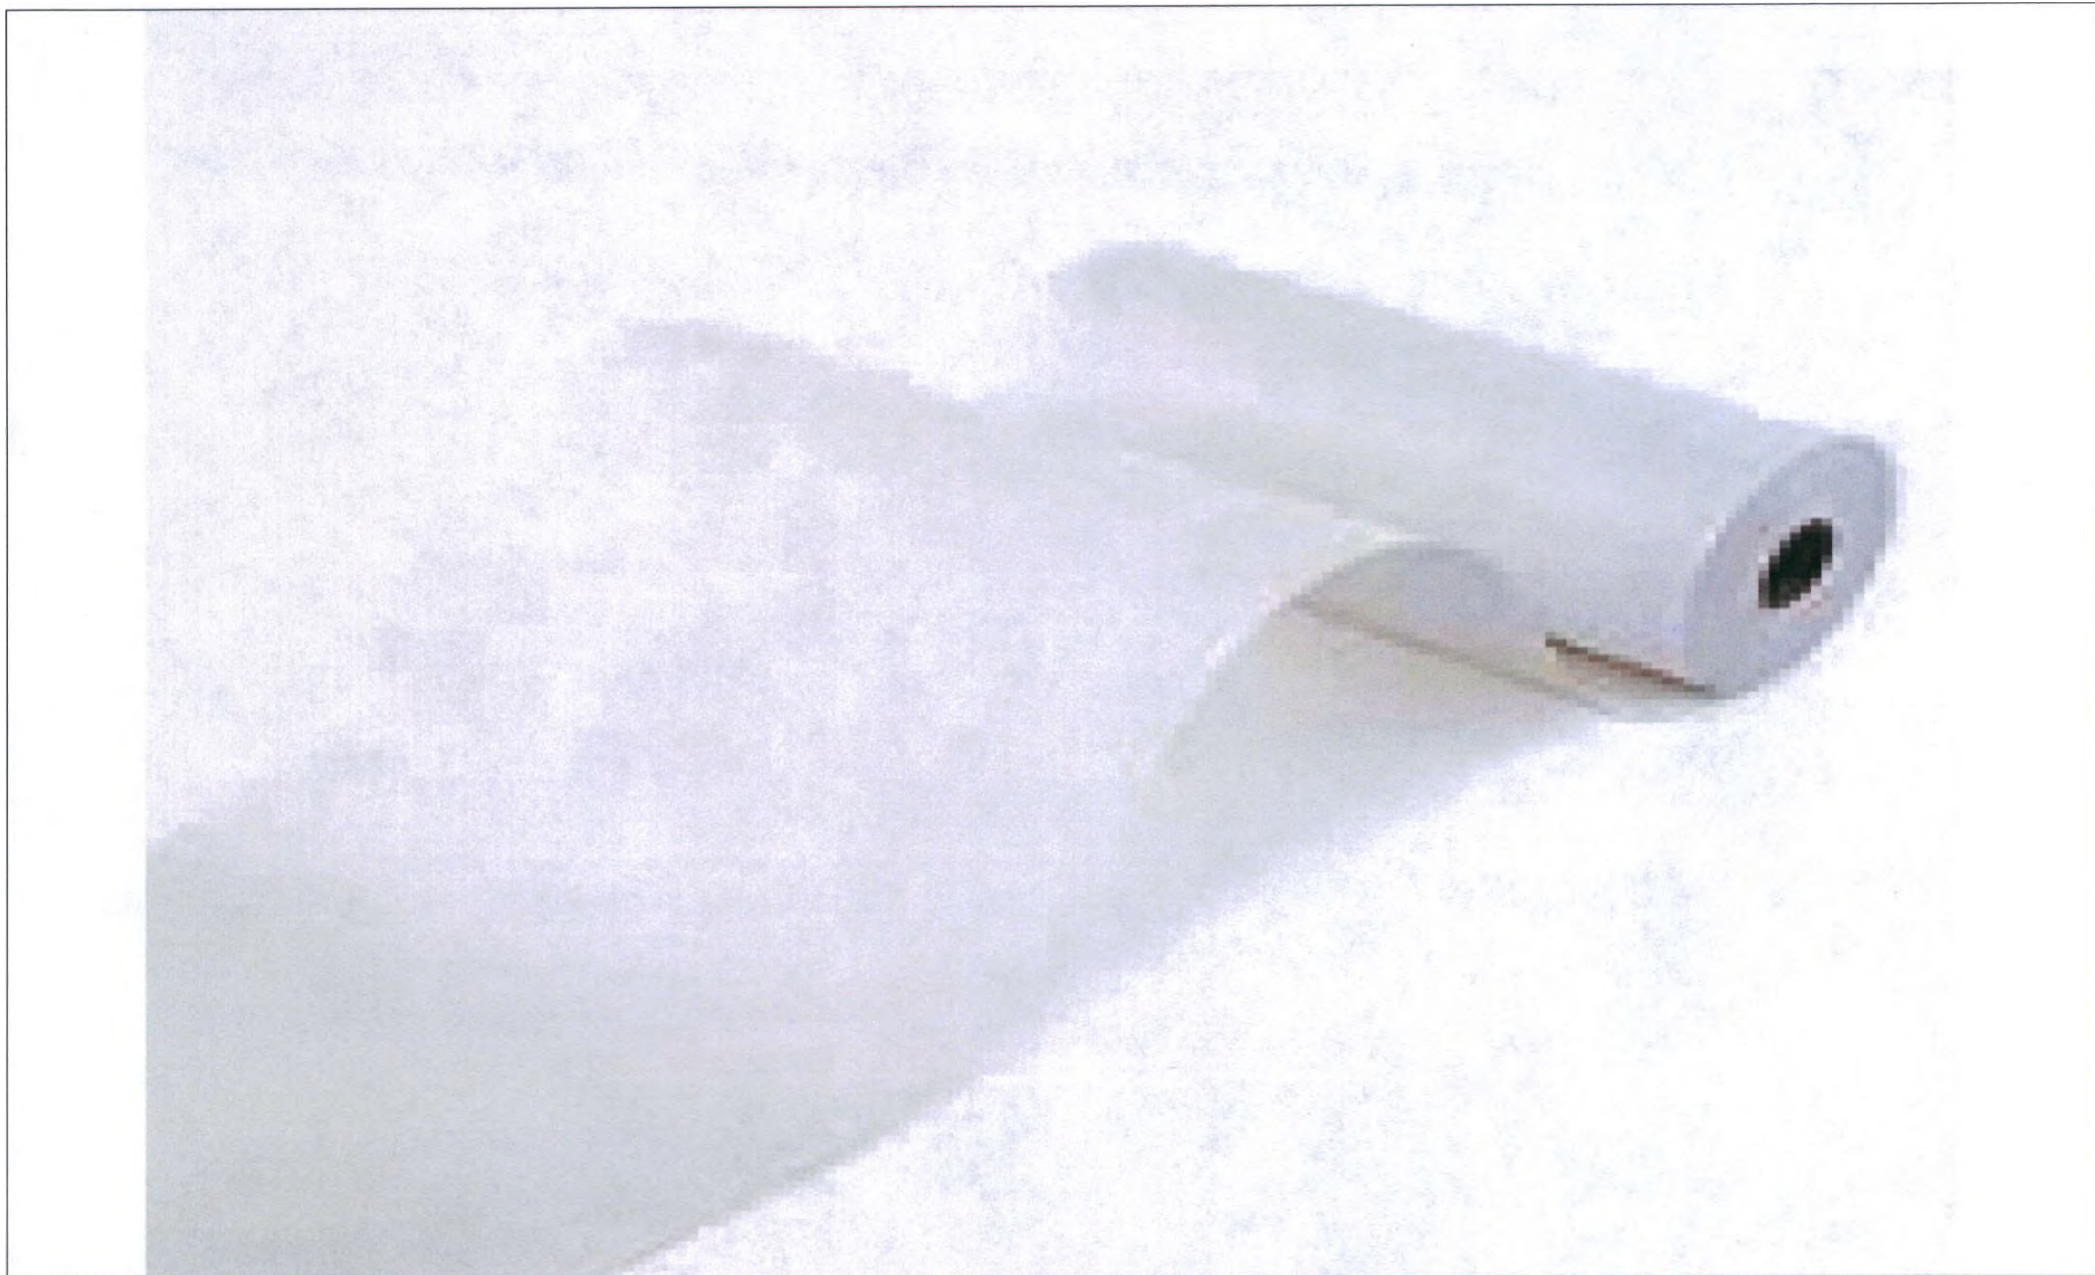

36. Бумага для черно-белого принтера



37. Устройство цифровой видеозаписи

Всего прошито и пронумеровано
32 листа (ов).

ООО «Сиенс Здравоохранение»

