

ПОДТВЕРЖДАЮ
Руководитель группы по регистрации
продукции для in vitro диагностики,
иммунохимия, гематология и гемостаз
ООО «Сименс Здоровоохранение»



Денисенко Е.А.
_____ 2024 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

«Анализаторы иммунохемилюминесцентные Immulite One, Immulite 1000, Immulite 2000, Immulite 2000XPi, с принадлежностями»

производства «Сименс Хелскеа Diagnostикс Инк.», Siemens Healthcare Diagnostics Inc., США

Анализатор иммунохемилюминесцентный IMMULITE 2000 XPi



Рисунок 1. Общий вид Анализатора иммунохемилюминесцентный IMMULITE 2000 XPi (брендрование Siemens)

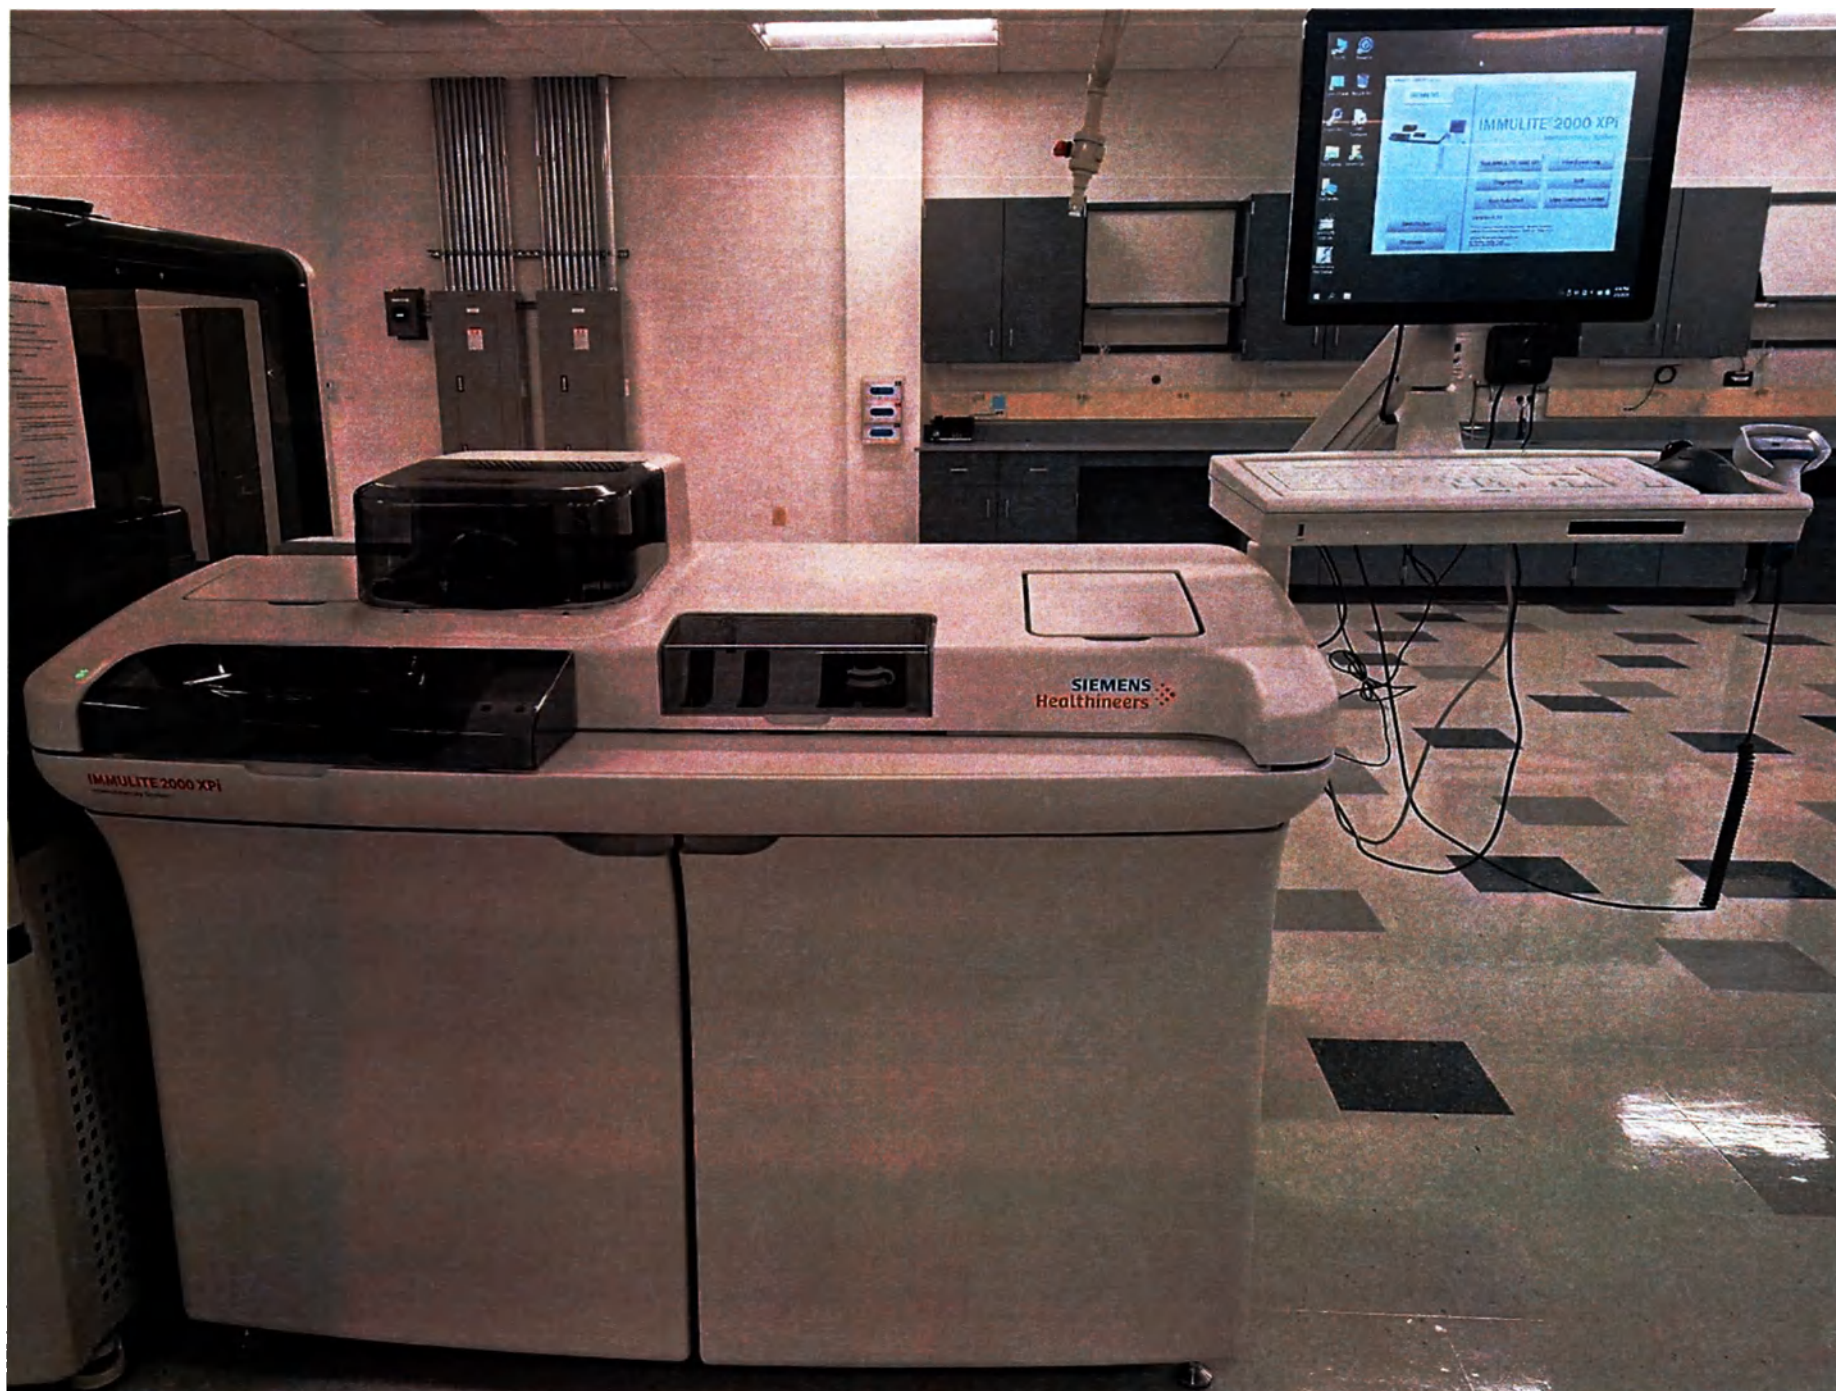




Рисунок 3. Сканер штрих-кодов и кабель к нему

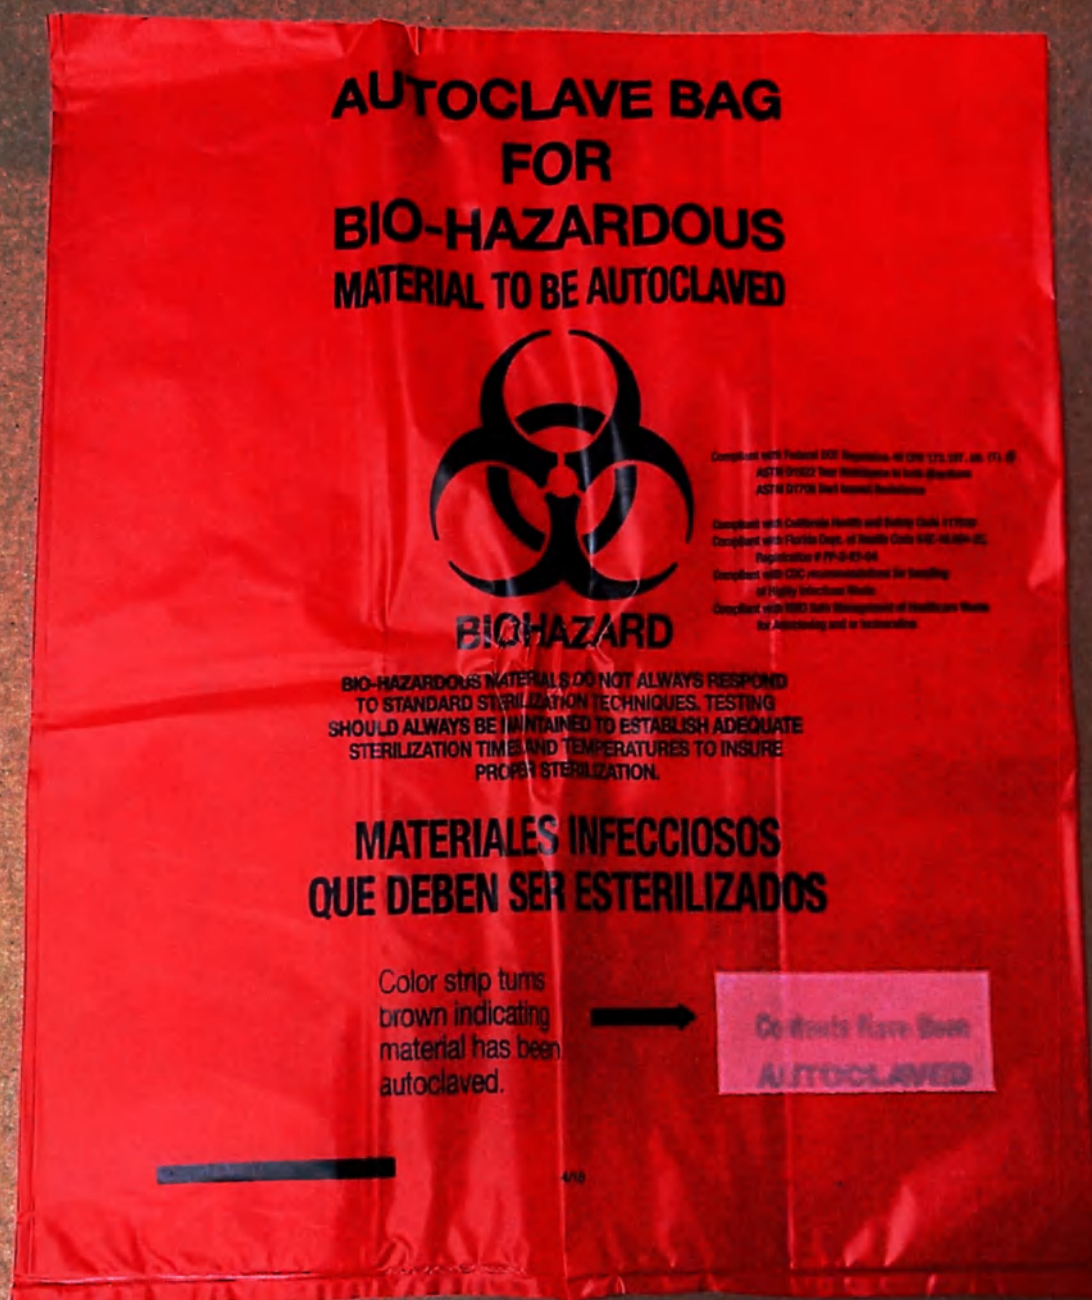




Рисунок 5. Трубочки - поглотители CO2



Рисунок 6. Бутылка для проведения очистки системы



Рисунок 7. Бутыл для воды 6л

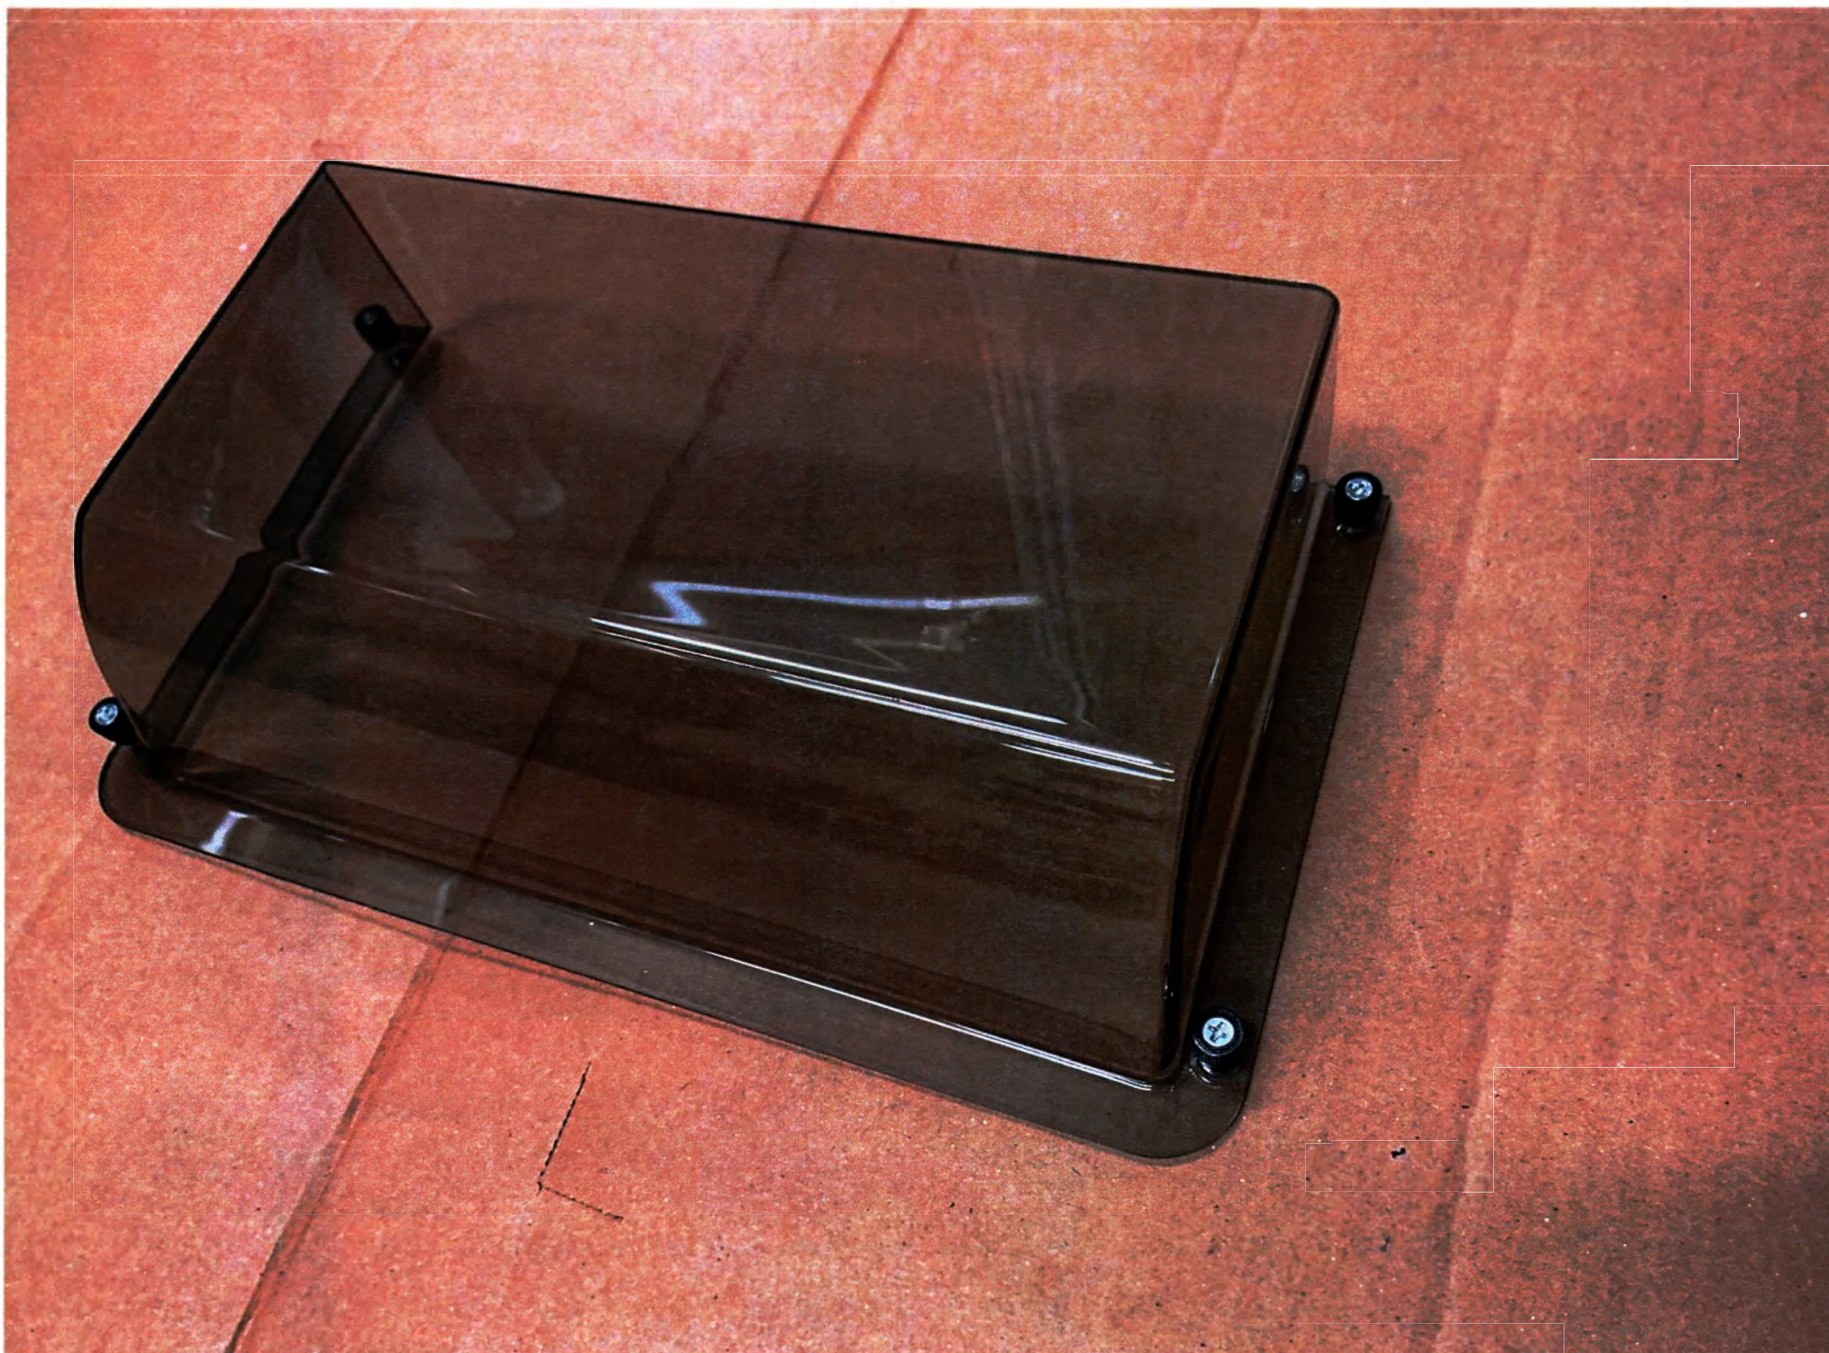


Рисунок 8. Крышка панели подключения

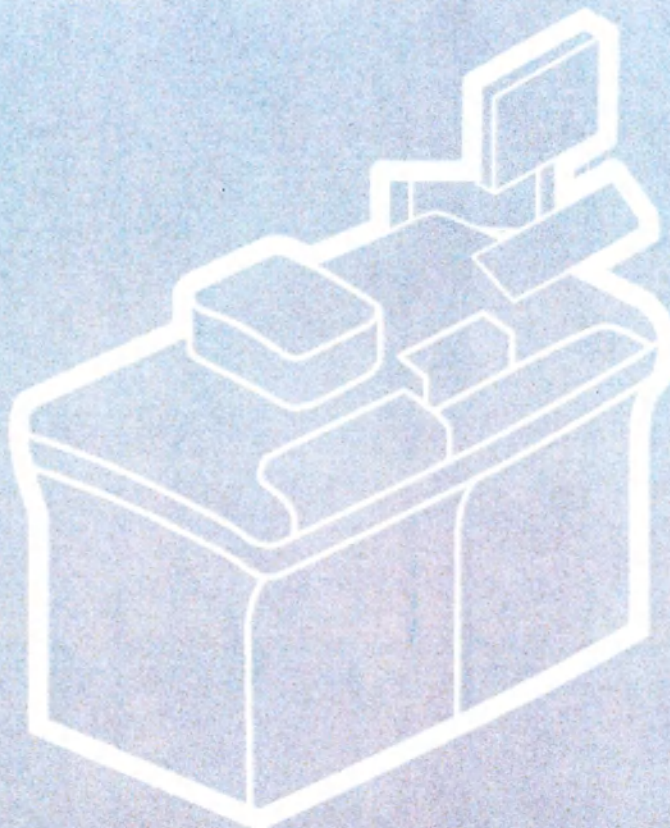


Рисунок 9. Комплект дисков с программным обеспечением

SIEMENS

IMMULITE[®]2000
IMMULITE[®]2000 XPI

Immunoassay Systems



Анализатор иммунохемилюминесцентный IMMULITE 2000 XPI, с принадлежностями

Руководство пользователя

REF

11353546 Rev. 01, 2021-12



Рисунок 10. Руководство по эксплуатации

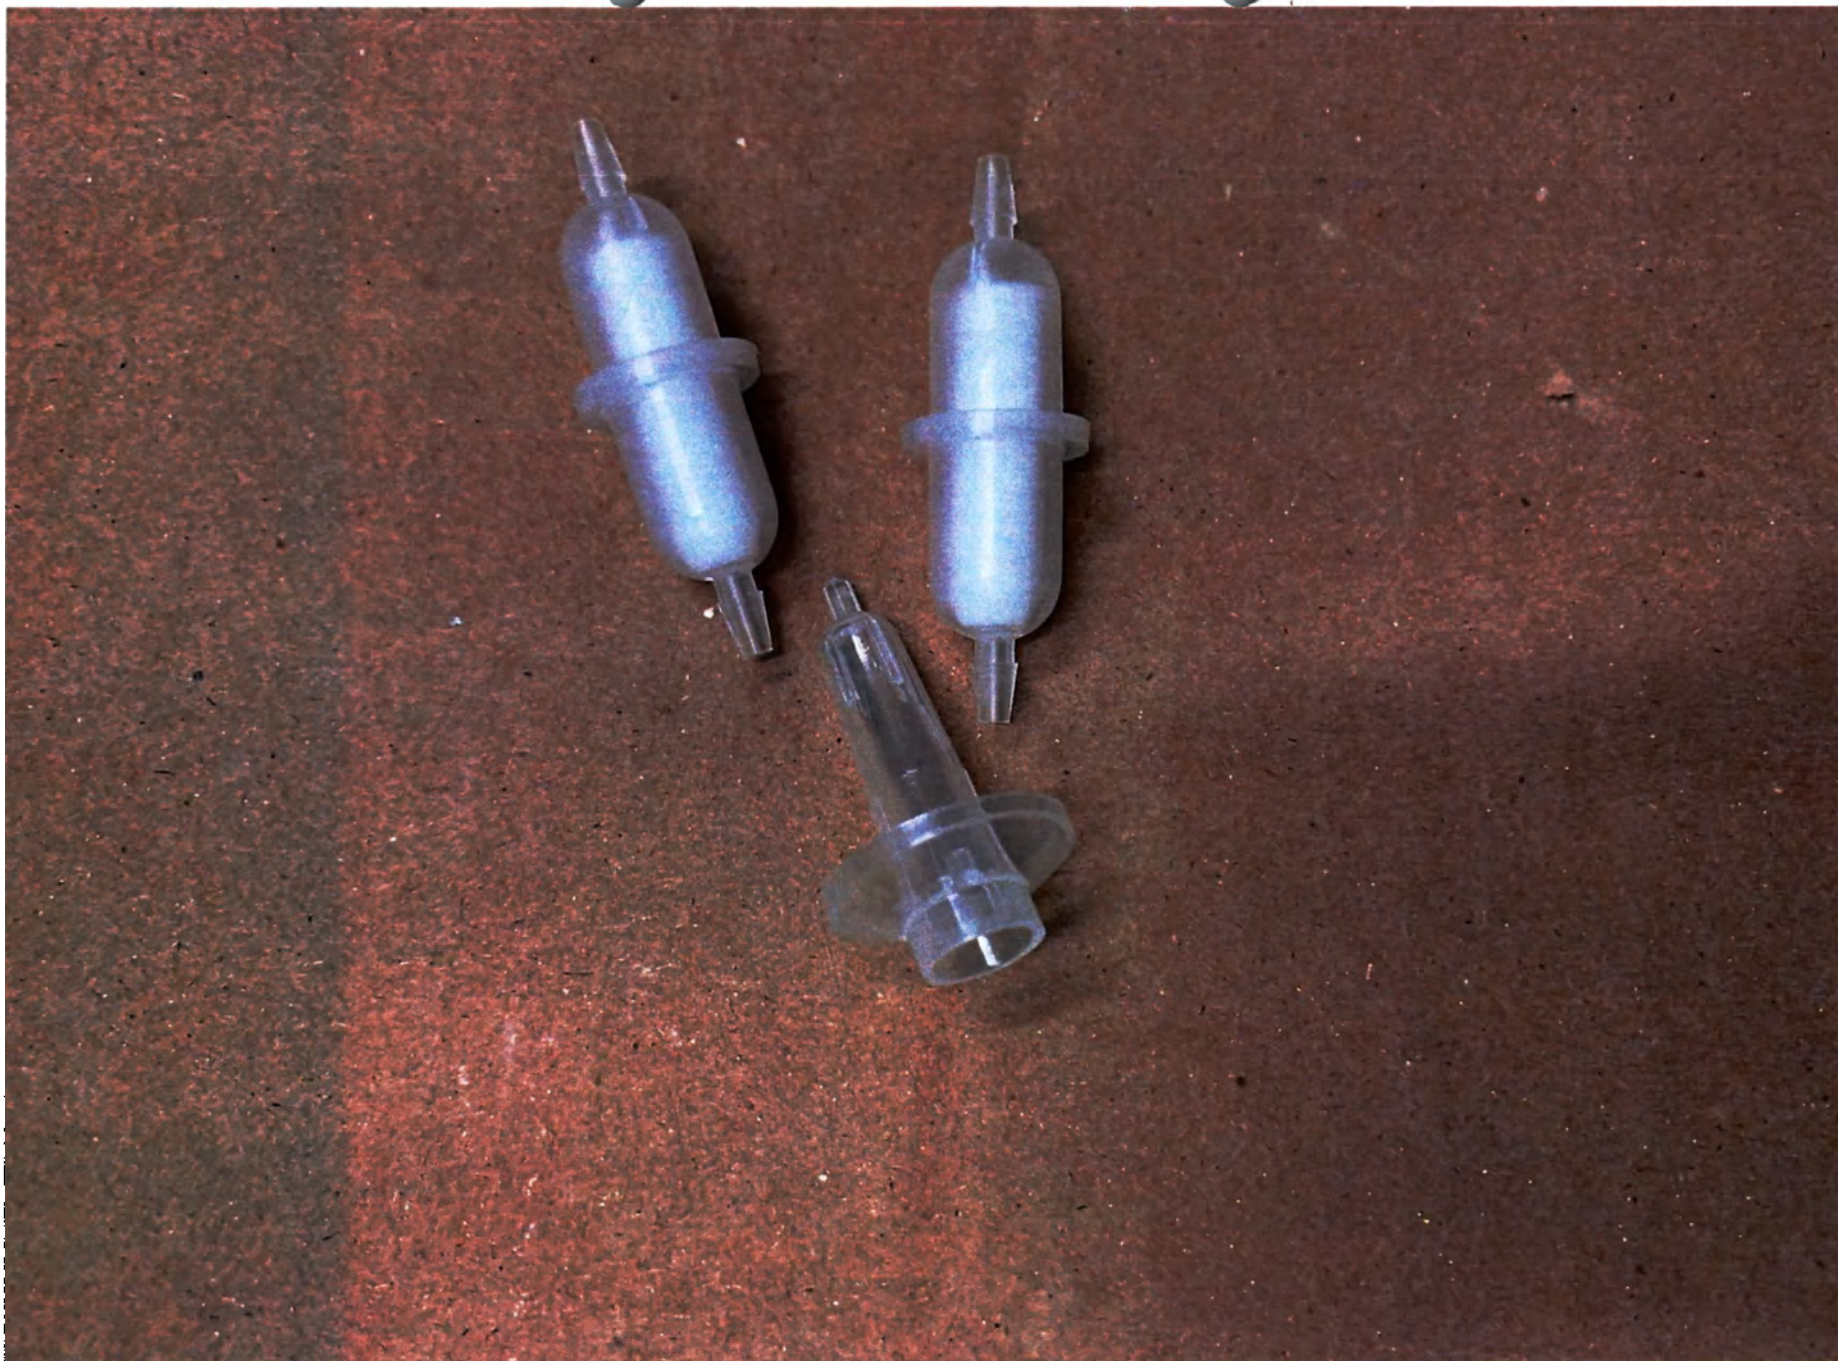


Рисунок 11. Фильтры трубок жидкости

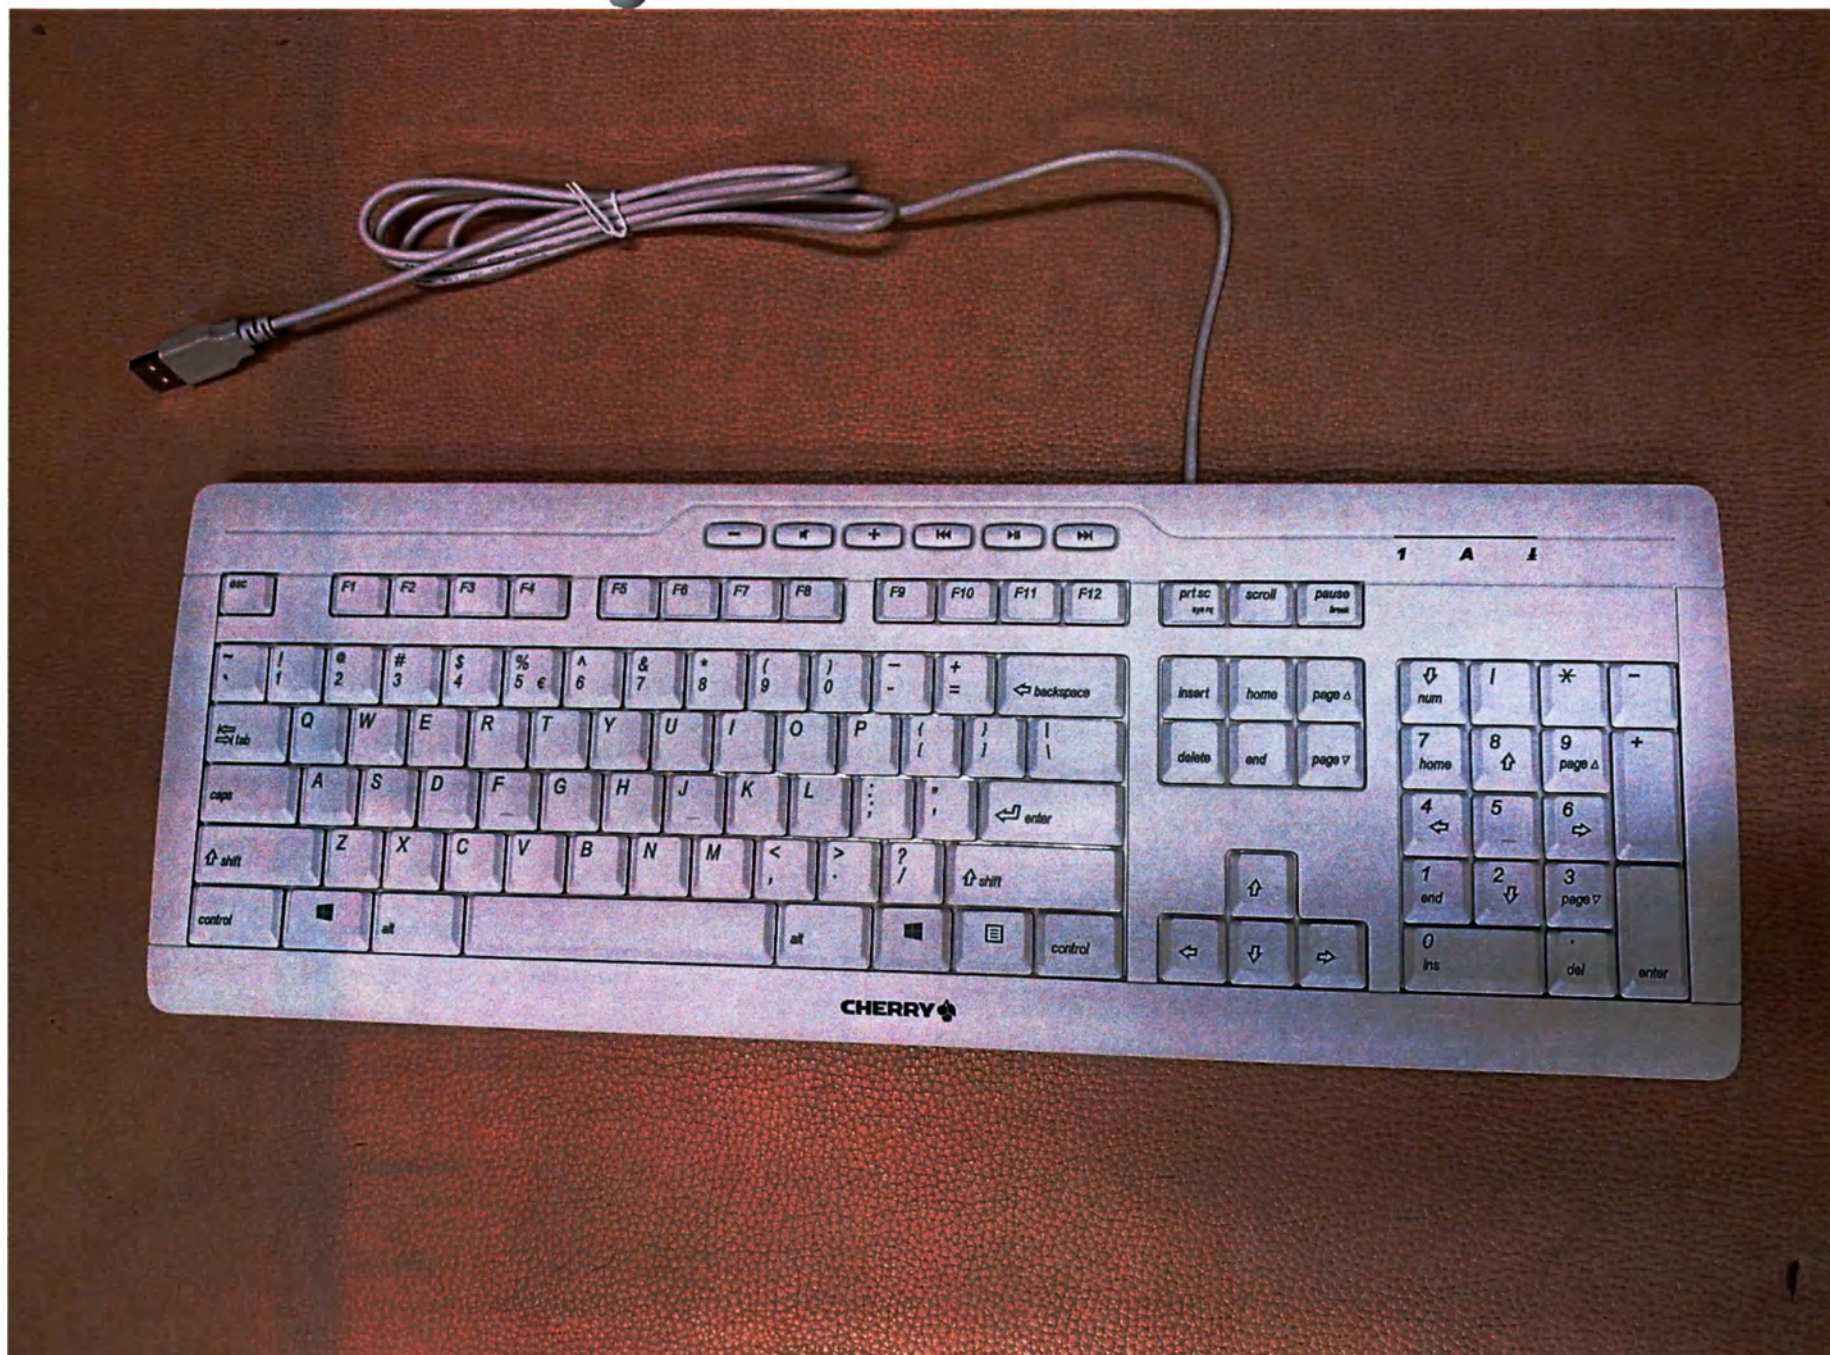


Рисунок 12. Клавиатура



Рисунок 13. Бутыль для жидких отходов 6л

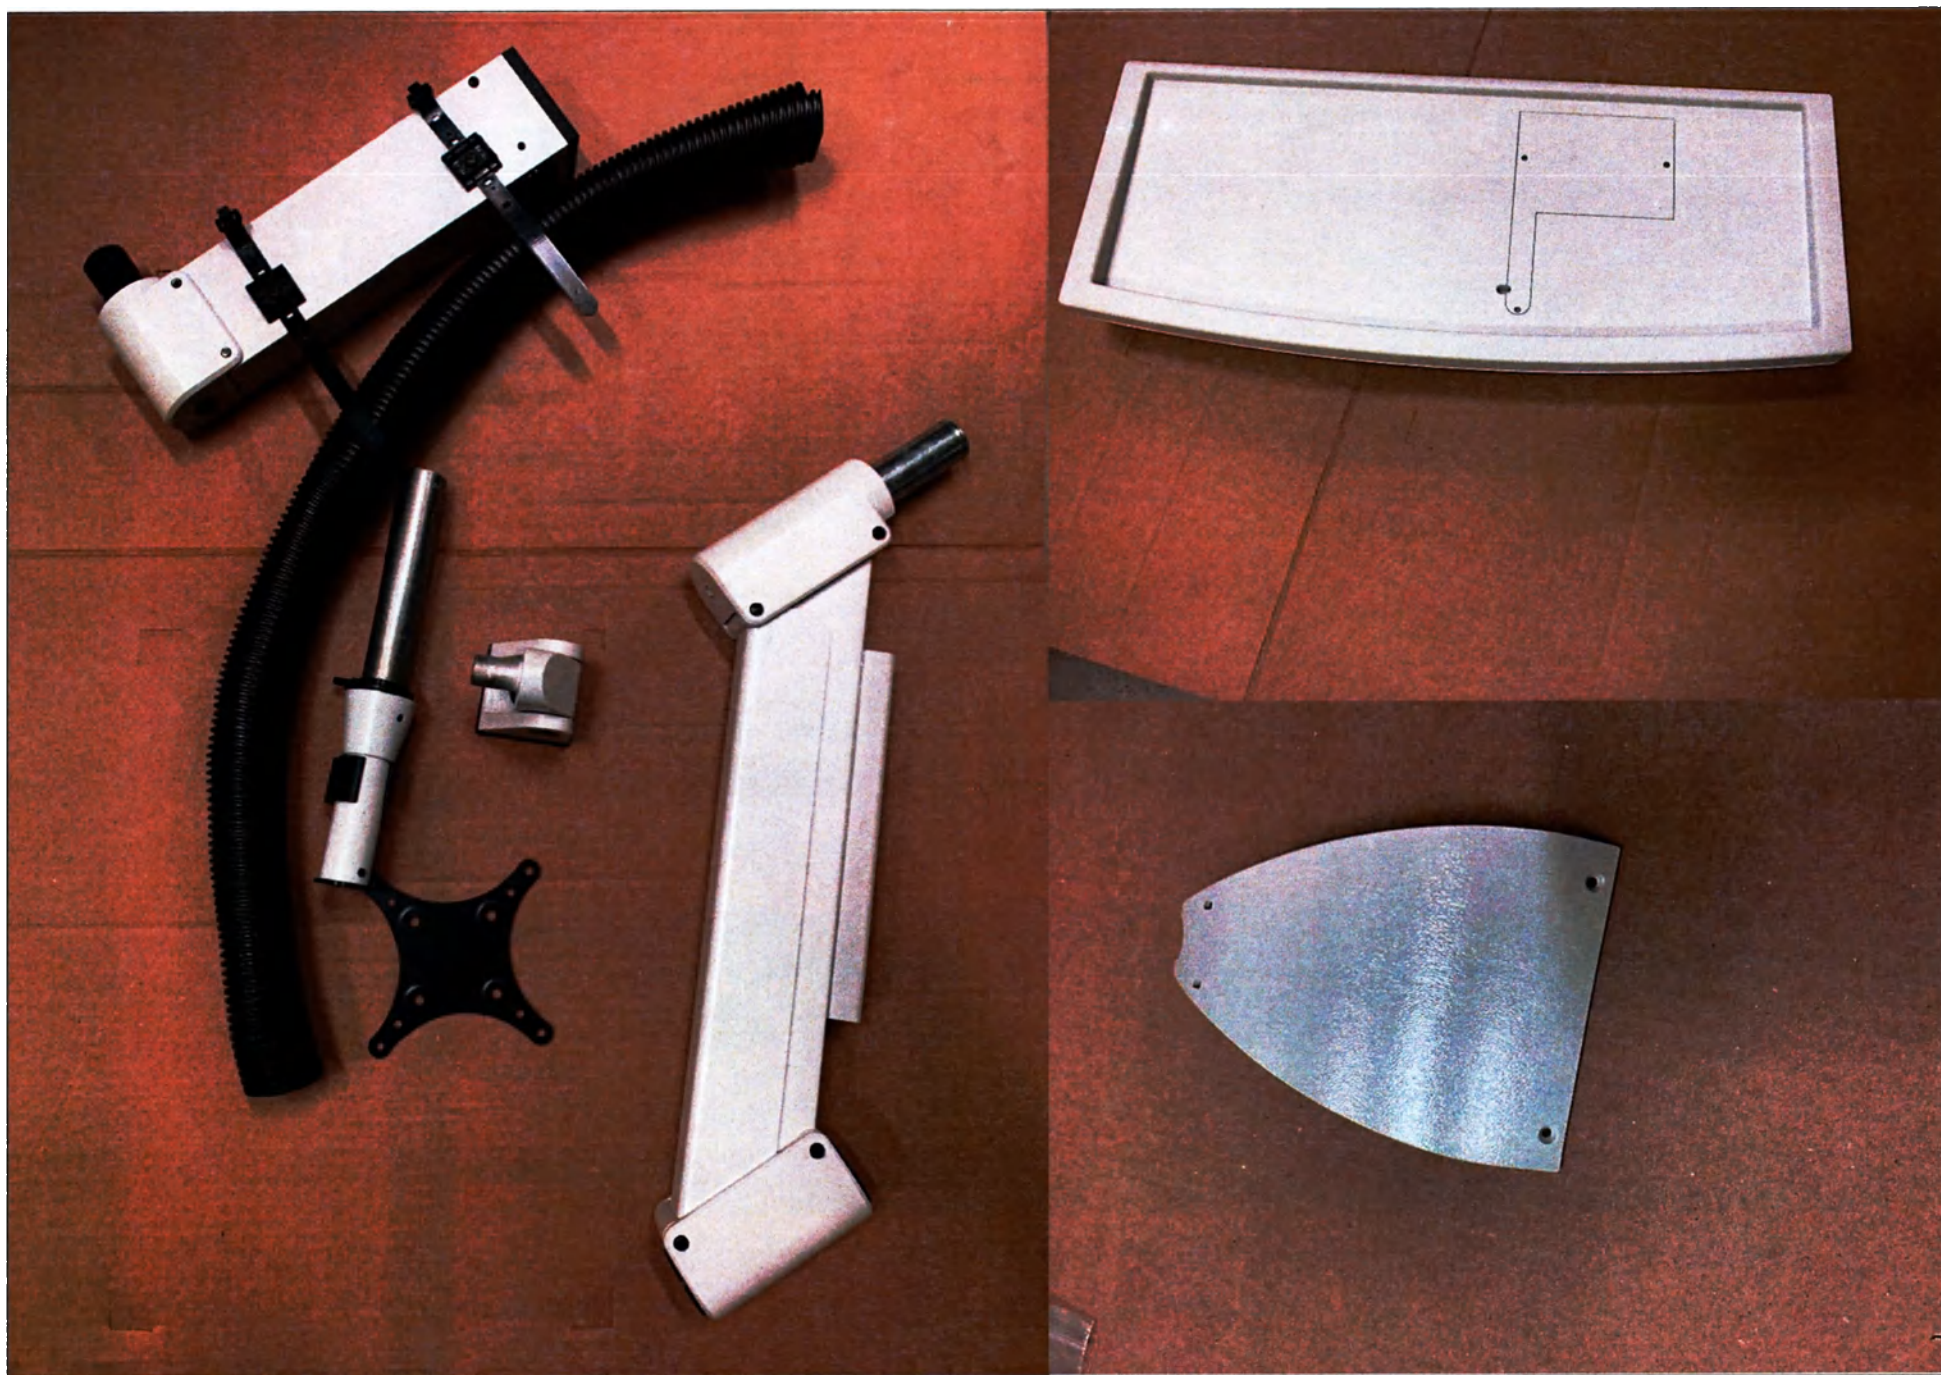


Рисунок 14. Кронштейн для монитора и стойка подставки под клавиатуру

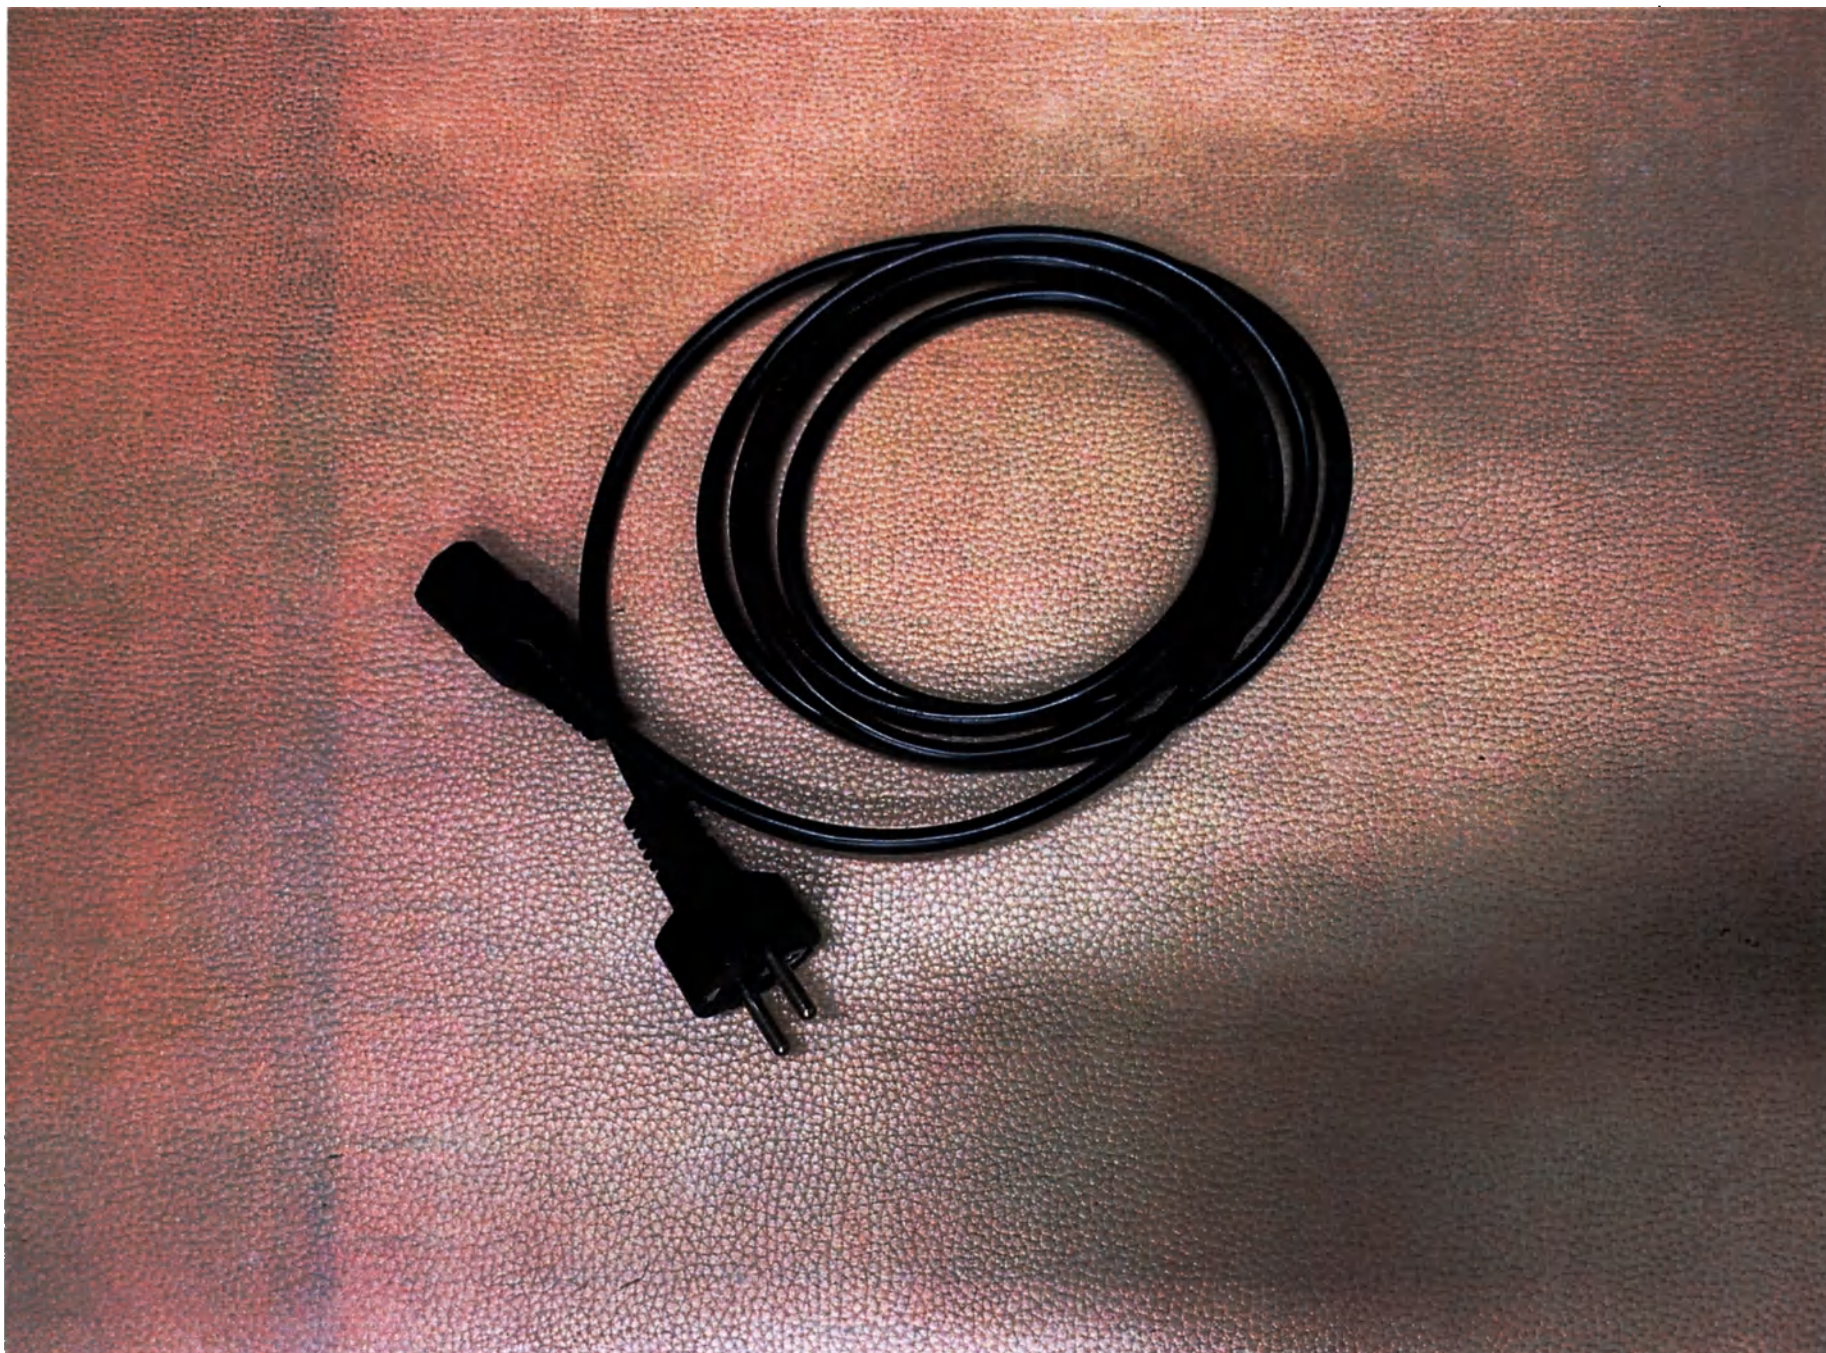


Рисунок 15. Сетевой шнур



Рисунок 16. Бутыль для промывающей жидкости (2л)



Рисунок 17. Реакционные пробирки



Рисунок 18. Контейнер для твердых отходов



Рисунок 19. Защита от превышения напряжения



Рисунок 20. Монитор с сенсорным экраном и кабелями



Рисунок 21. Шаровой манипулятор-трекбол



Рисунок 22. Мандрен для очистки трубы отходов



Рисунок 24. Наставляемые мини-пробирки, 1 мл для использования с пробирками диаметром 12 мм и 13 мм



Рисунок 25. USB кабель



Рисунок 26. Подставка для принтера

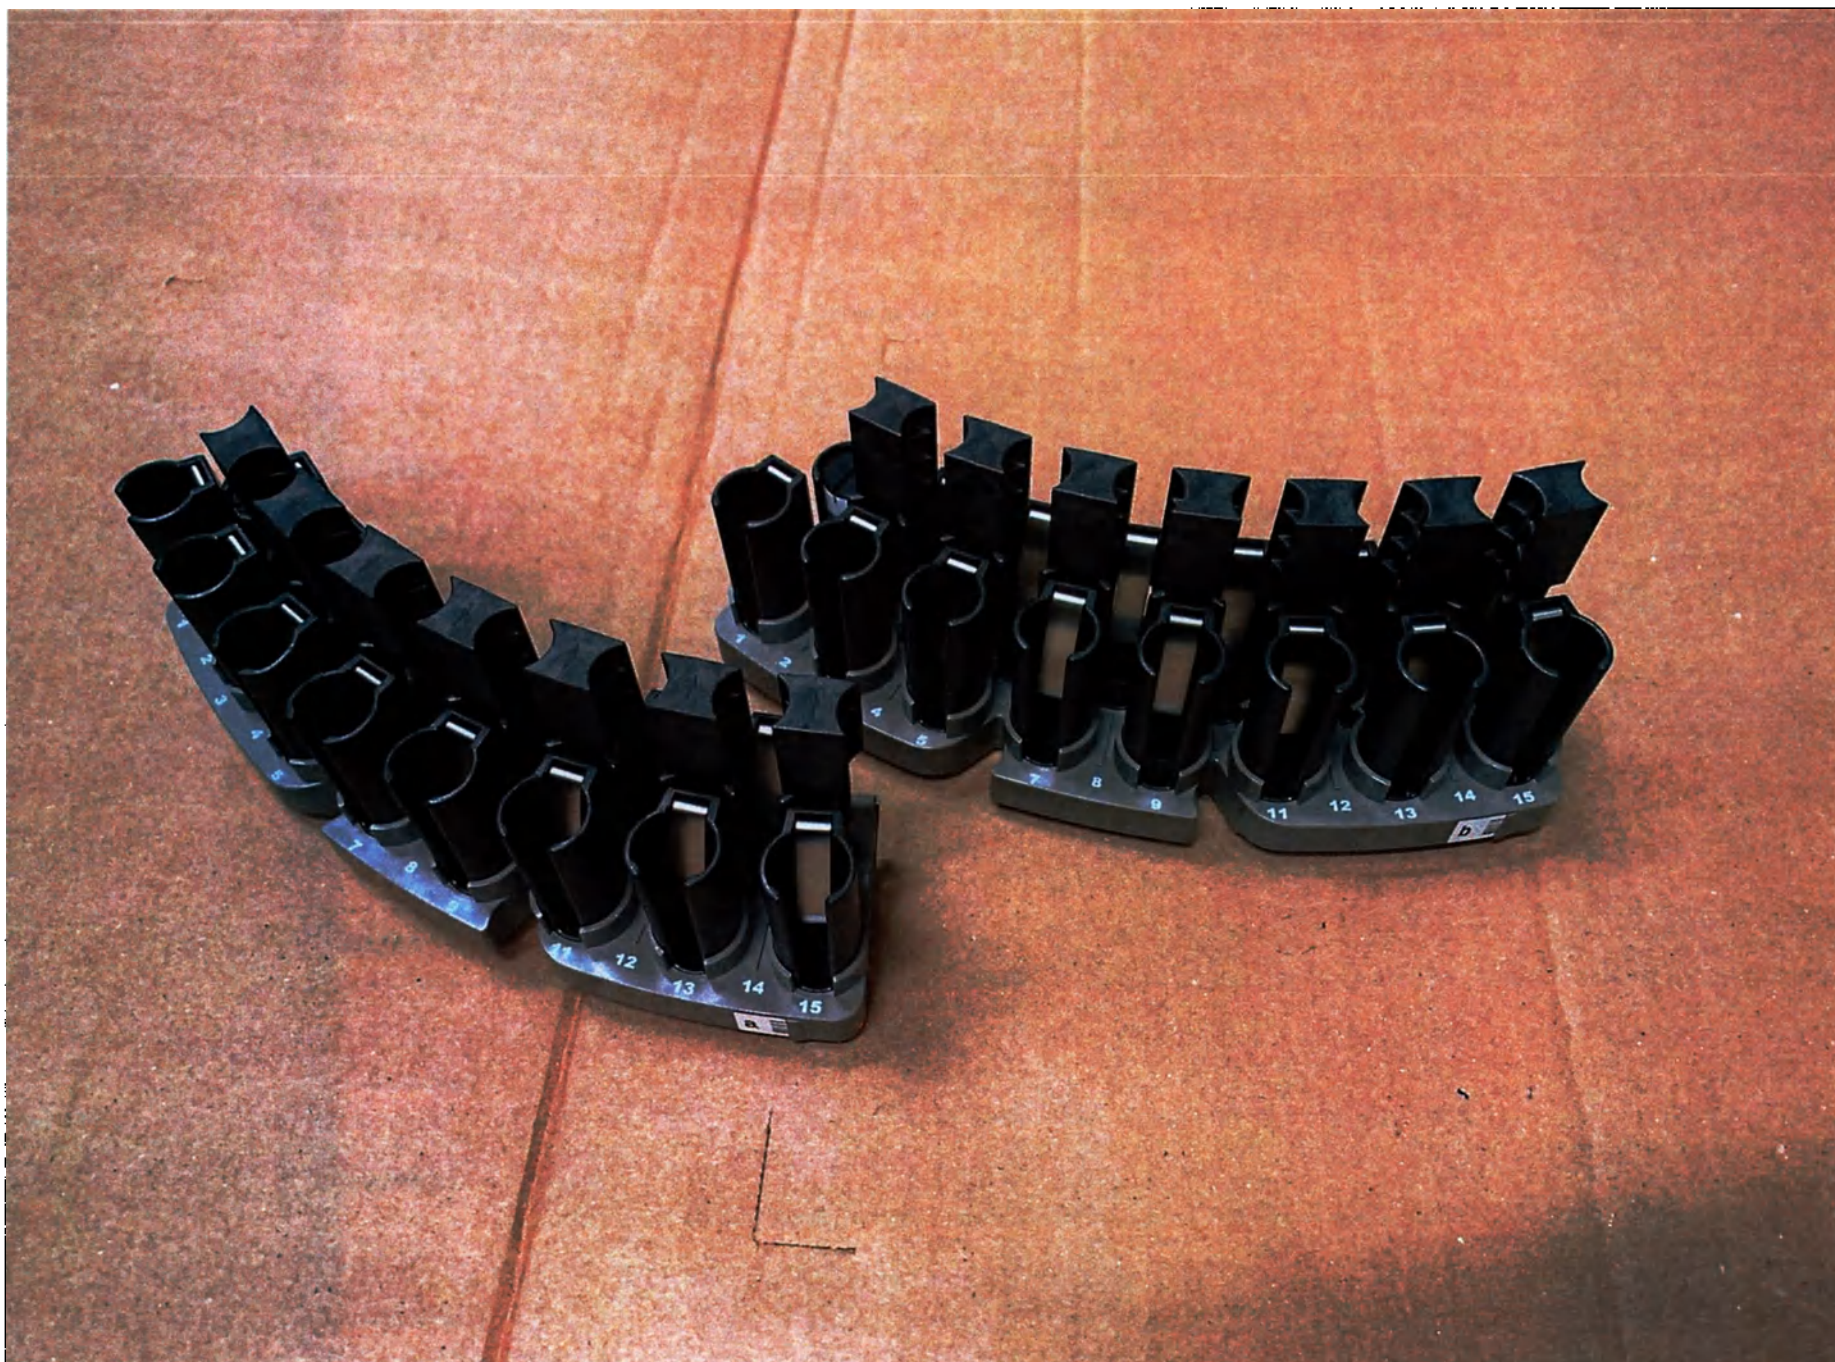


Рисунок 27. Штатив для пробирок




Рисунок 28. Вкладыши для микрообразцов



Рисунок 29. Пробирки для микропроб



Рисунок 30. Крышечки к пробиркам для микропроб

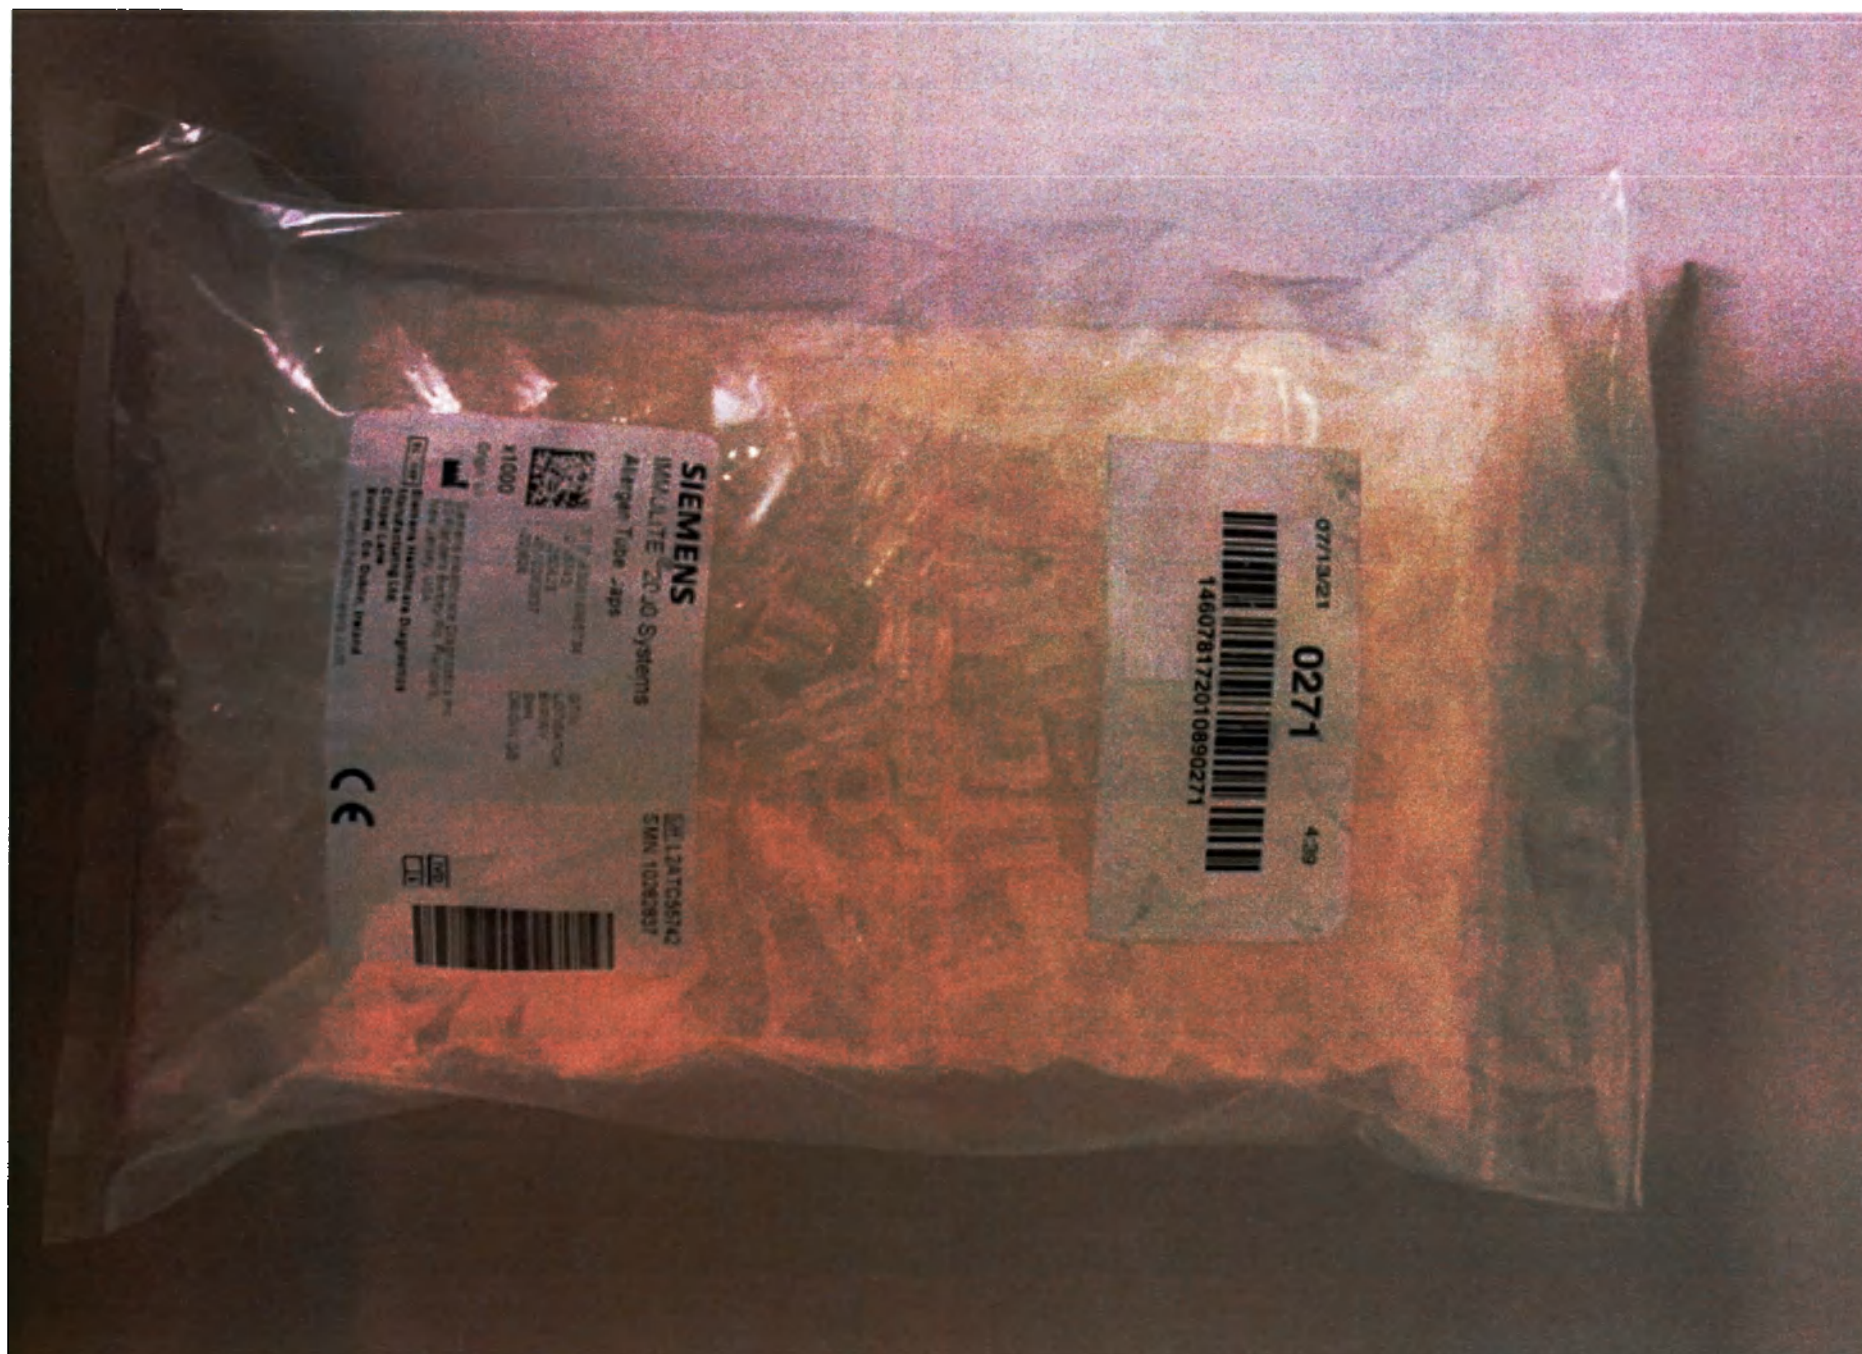

07/13/21 0271 439
146076172010890271

SIEMENS
MILITE 20.00 Systems
Allergen Type: Japs
x1000
CE
146076172010890271

Рисунок 31. Крышечки к пробиркам для аллергена

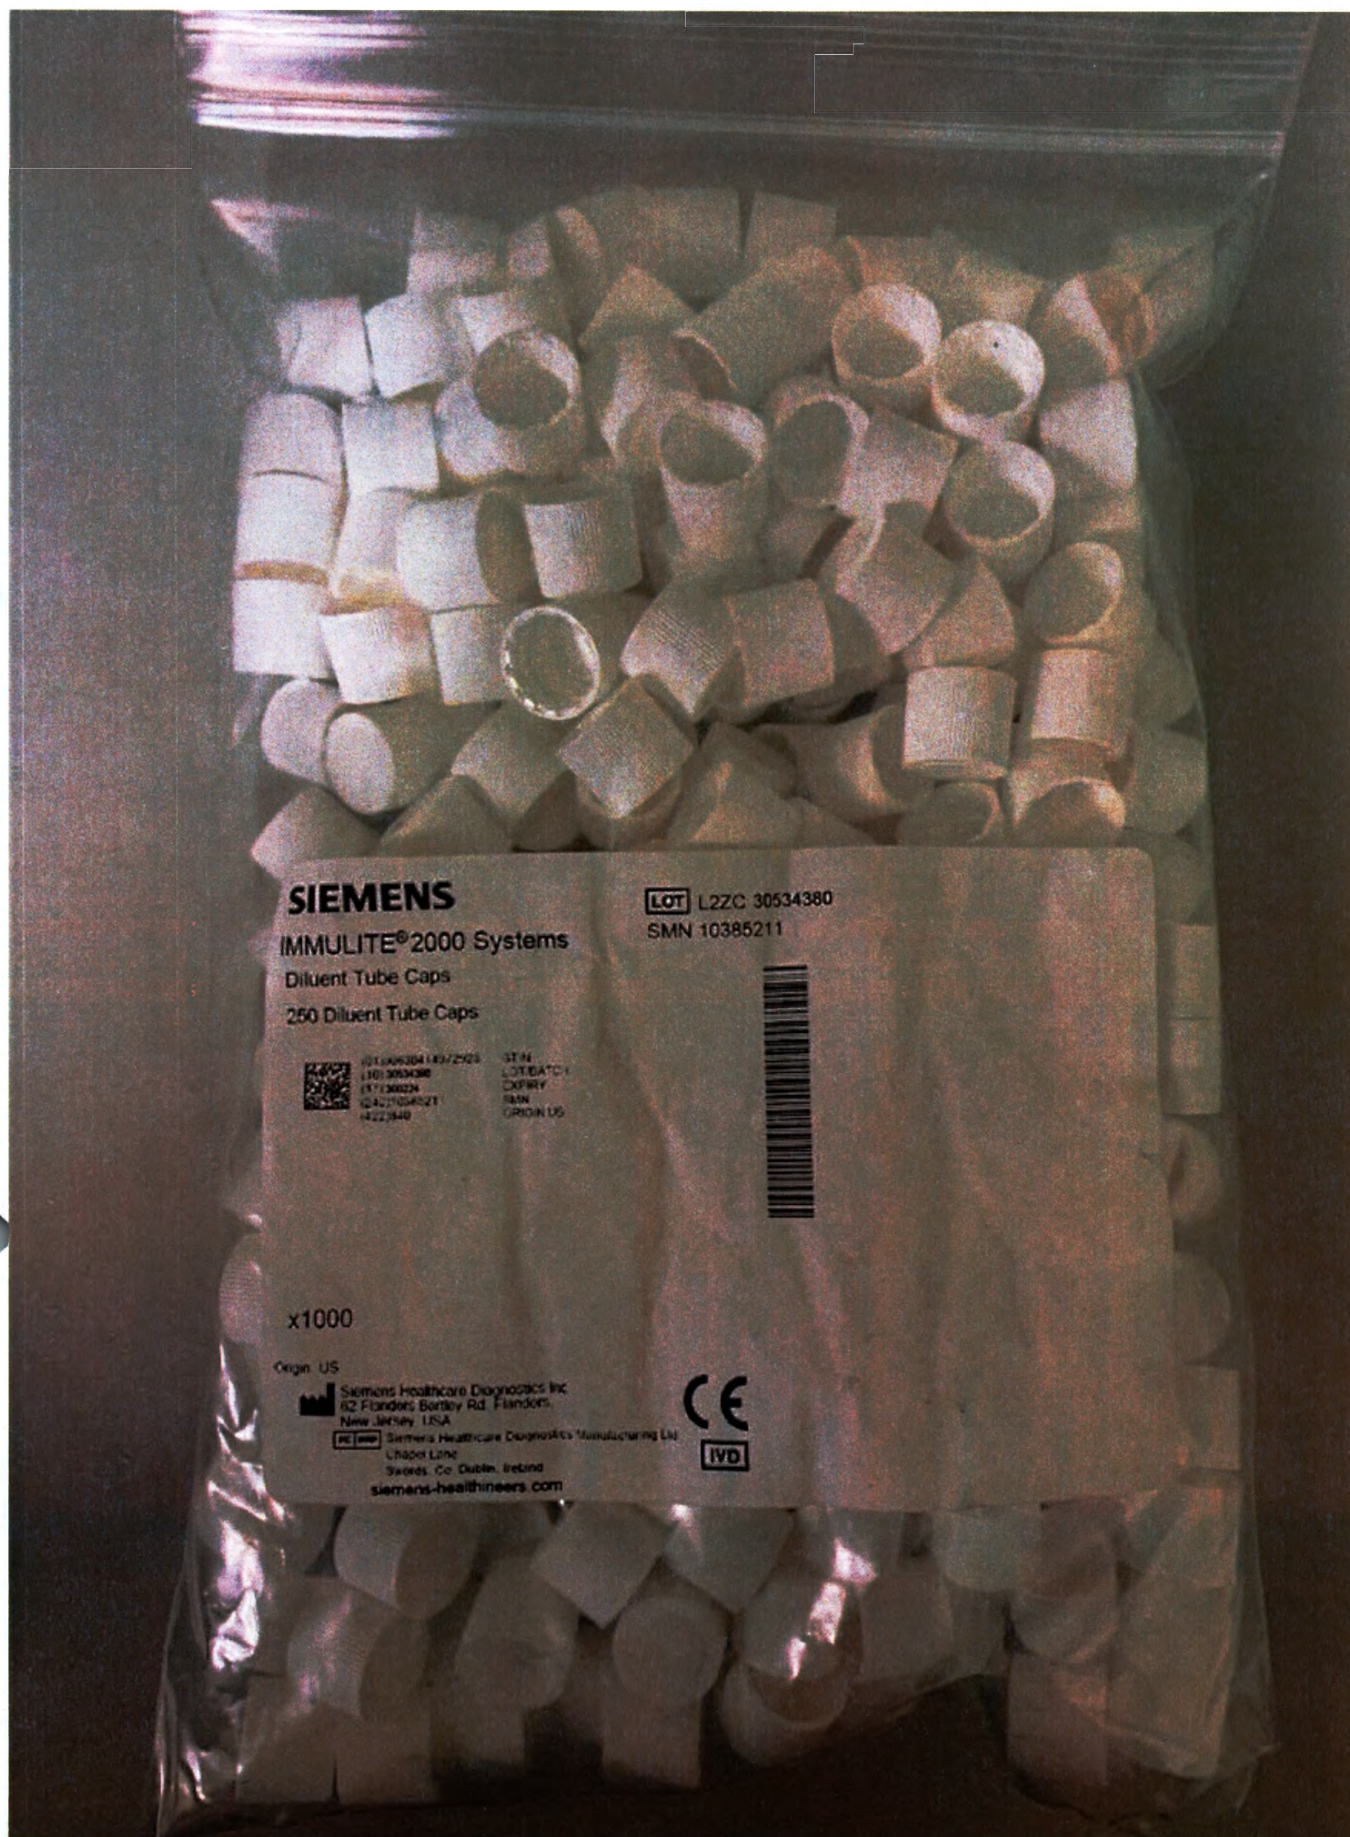


Рисунок 32. Крышки к пробиркам для разбавителей / Diluent tube caps

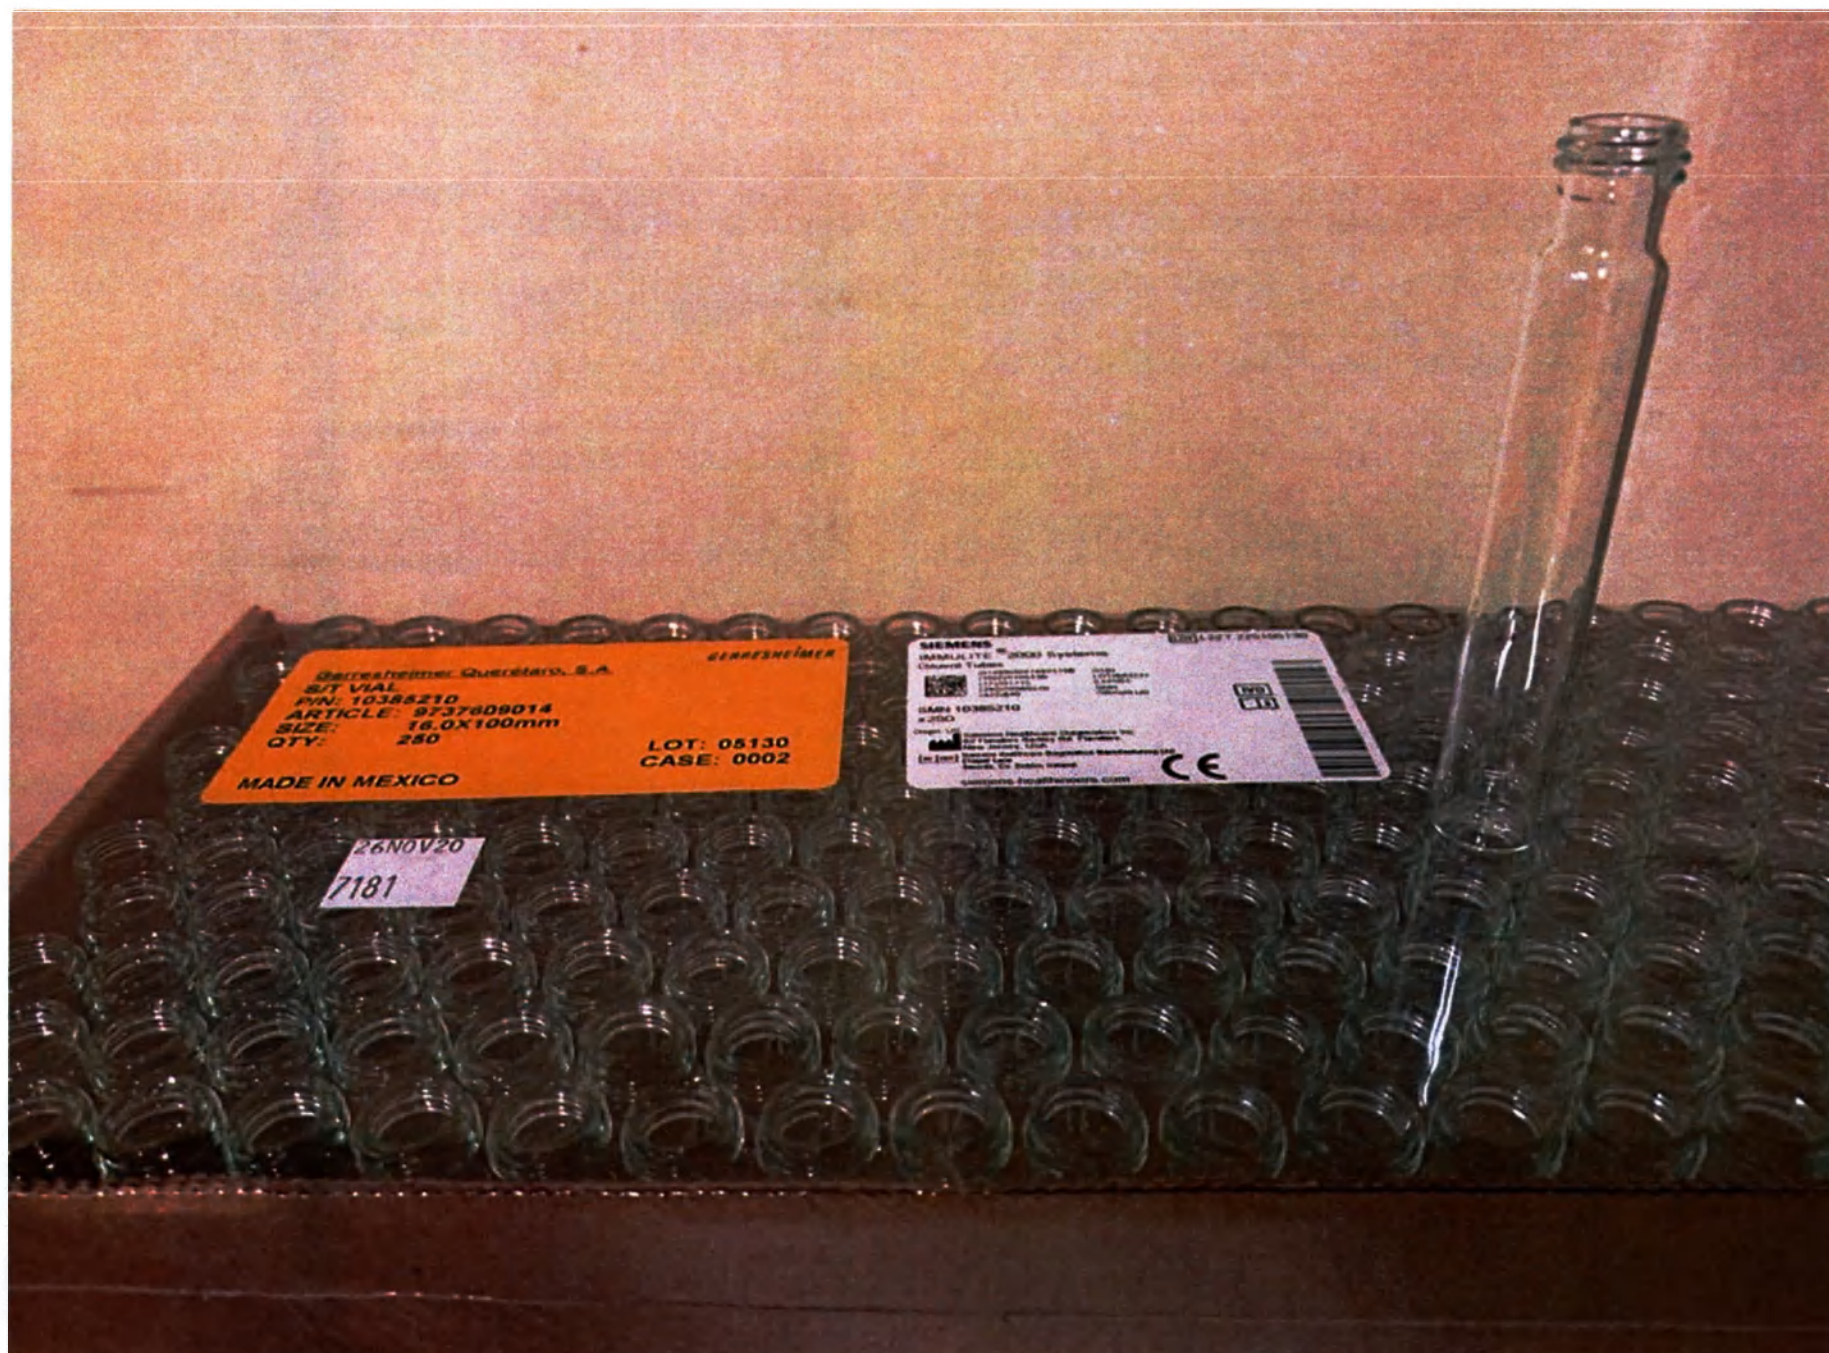


Рисунок 33. Пробирки для разбавителей / Diluent tubes



Рисунок 34. Мембраны к пробиркам для аллергена



Рисунок 35. Комплект клиновидных штативов аллергена

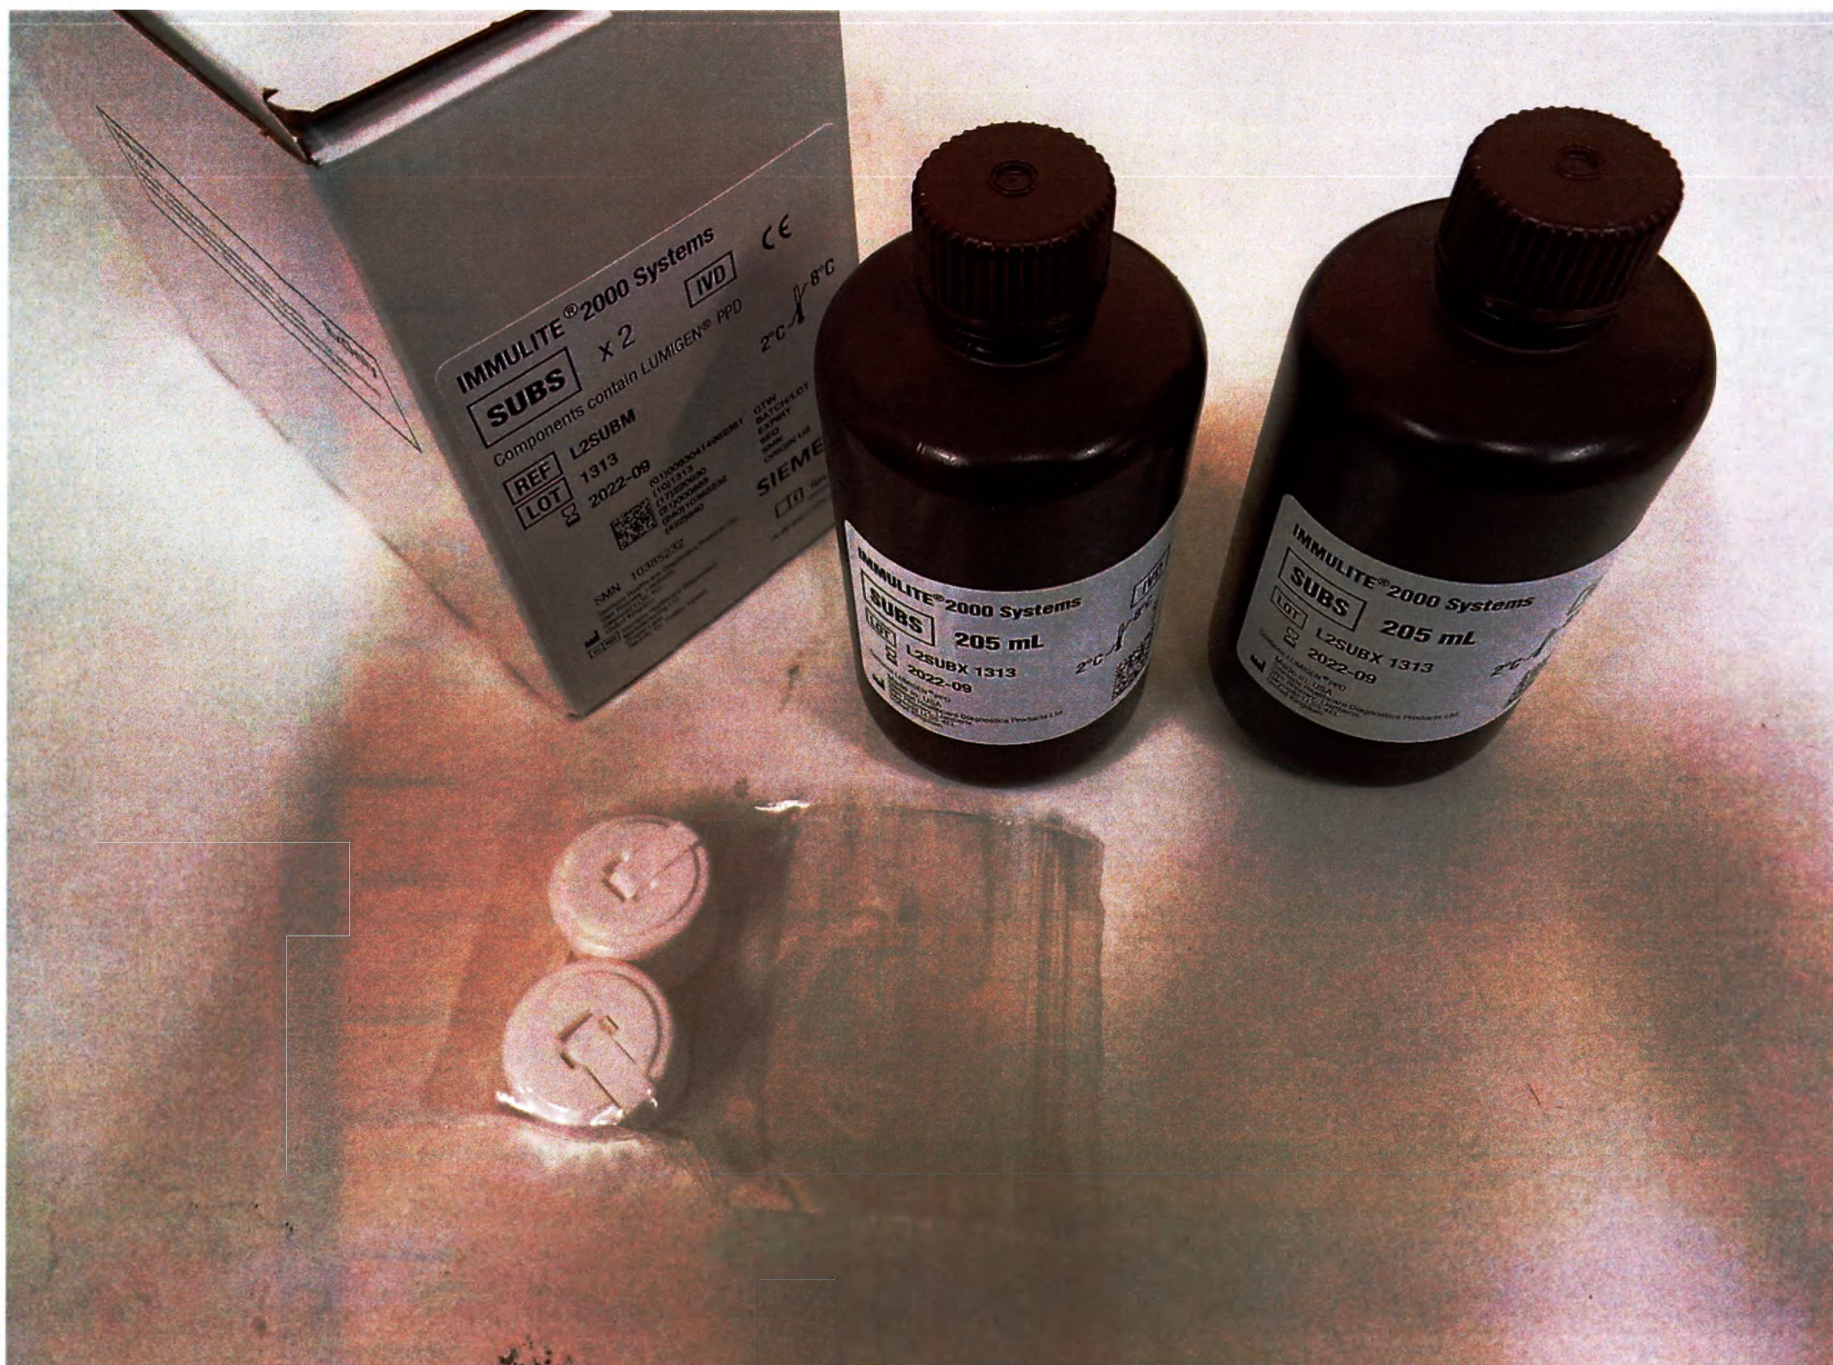


Рисунок 36. Хемилуминесцентный субстрат / Chemiluminescent substrate module



Рисунок 37. Очищающий раствор / Probe cleaning kit

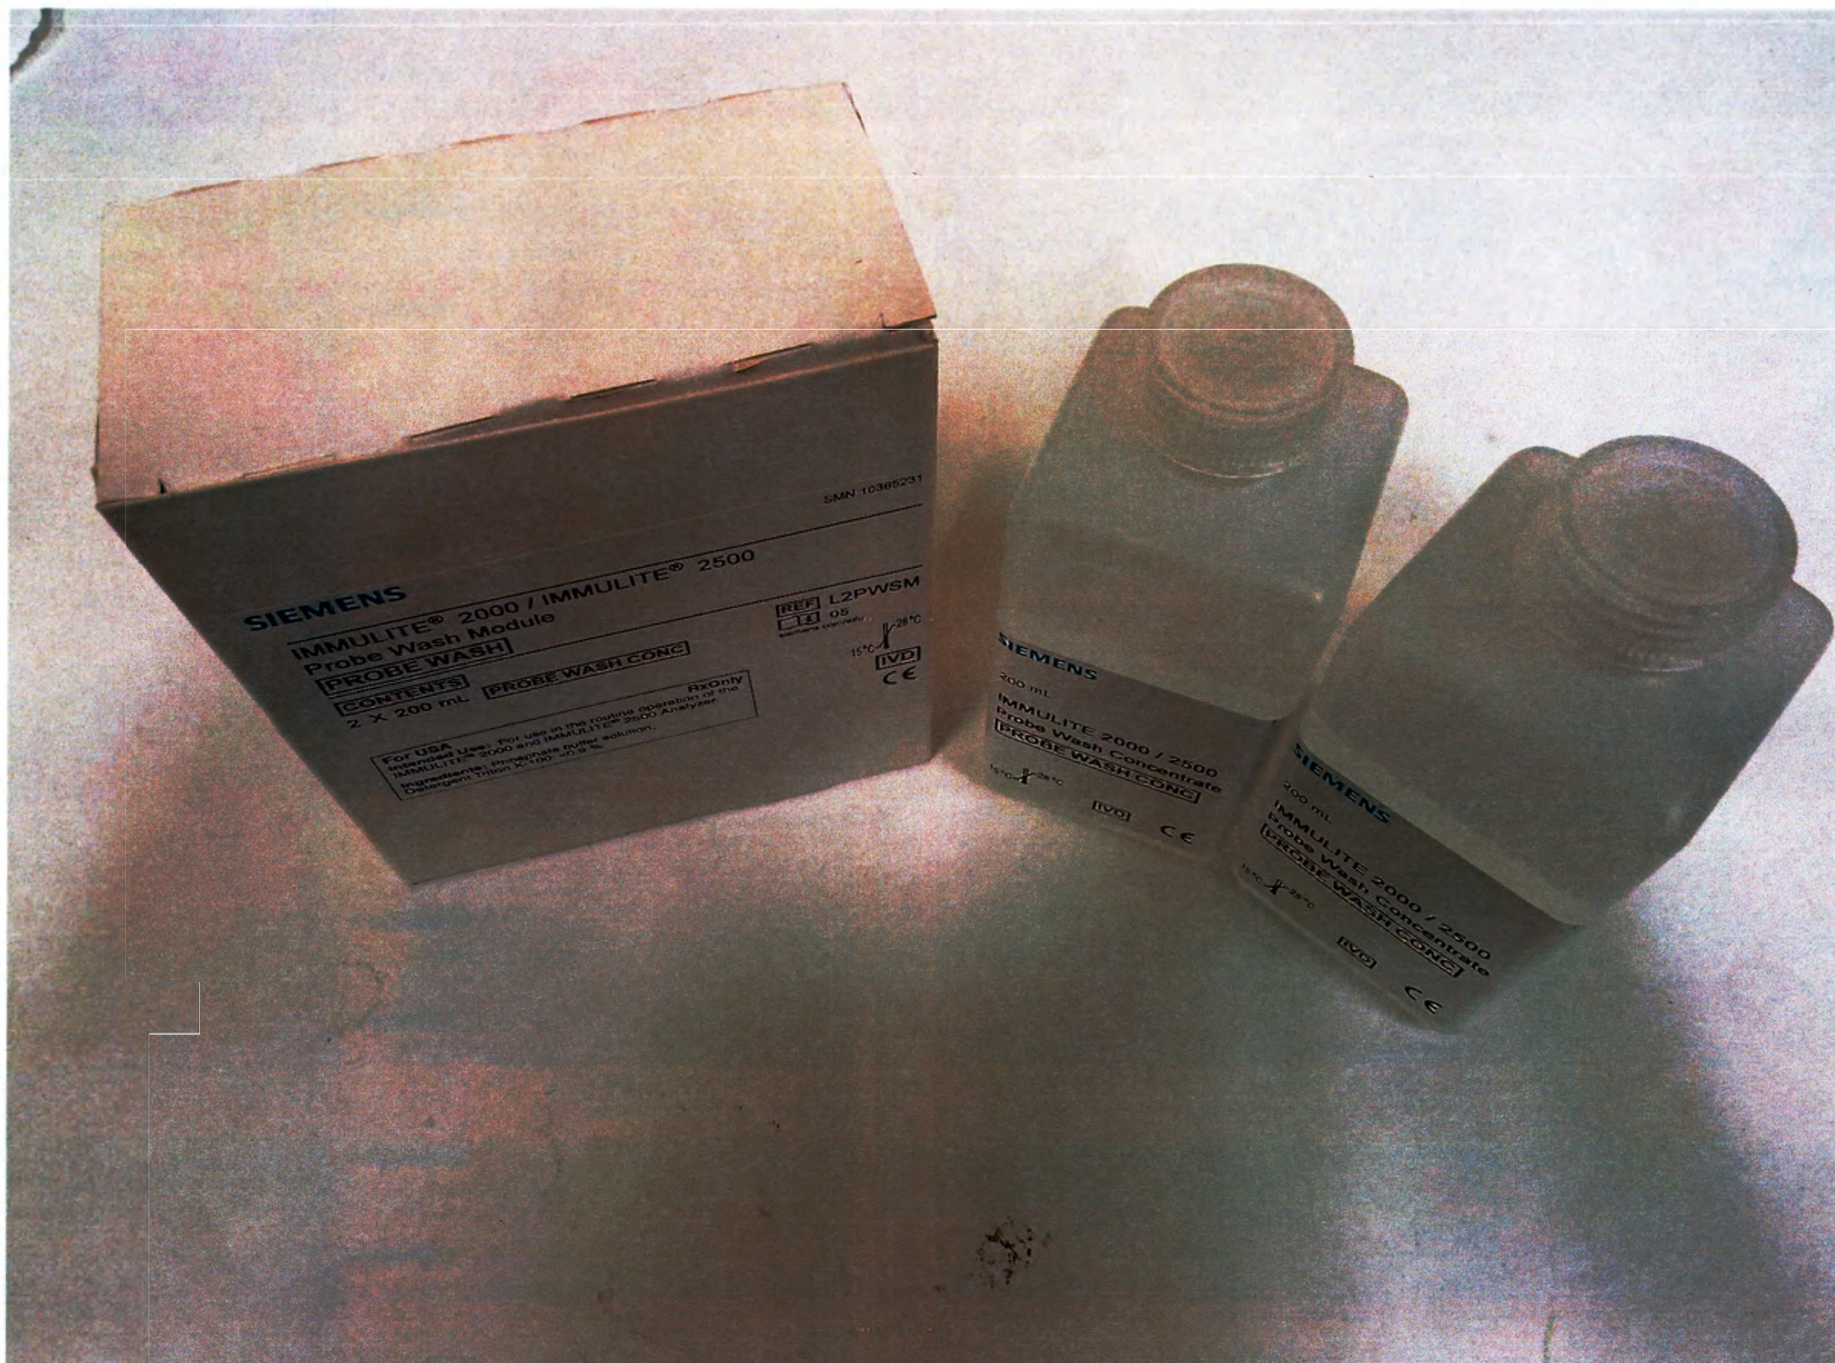


Рисунок 38. Раствор для промывки дозаторов

**Анализатор иммунохемилюминесцентный
IMMULITE 2000 XPr, с принадлежностями**

**Регистрационное удостоверение:
№ ФСЗ 2007/00551 от 14.07.2022**

Страна производства: США

**Производитель, дата производства, серийный номер и др.
символы указаны на основной маркировке изделия**

ТОЛЬКО ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ IN VITRO

**Уполномоченный представитель производителя:
ООО «Сименс Здравоохранение», 115093, г. Москва, ул.
Дубининская, д. 96**

200/208/220/230/240 В 50/60 Гц 6 А 1500 Вт

11354024 Rev. 01

Анализатор иммунохемилюминесцентный Immulite 2000



Рисунок 40. Общий вид Анализатора иммунохемилюминесцентного Immulite 2000



Рисунок 41. Сканер штрих-кодов и кабель к нему

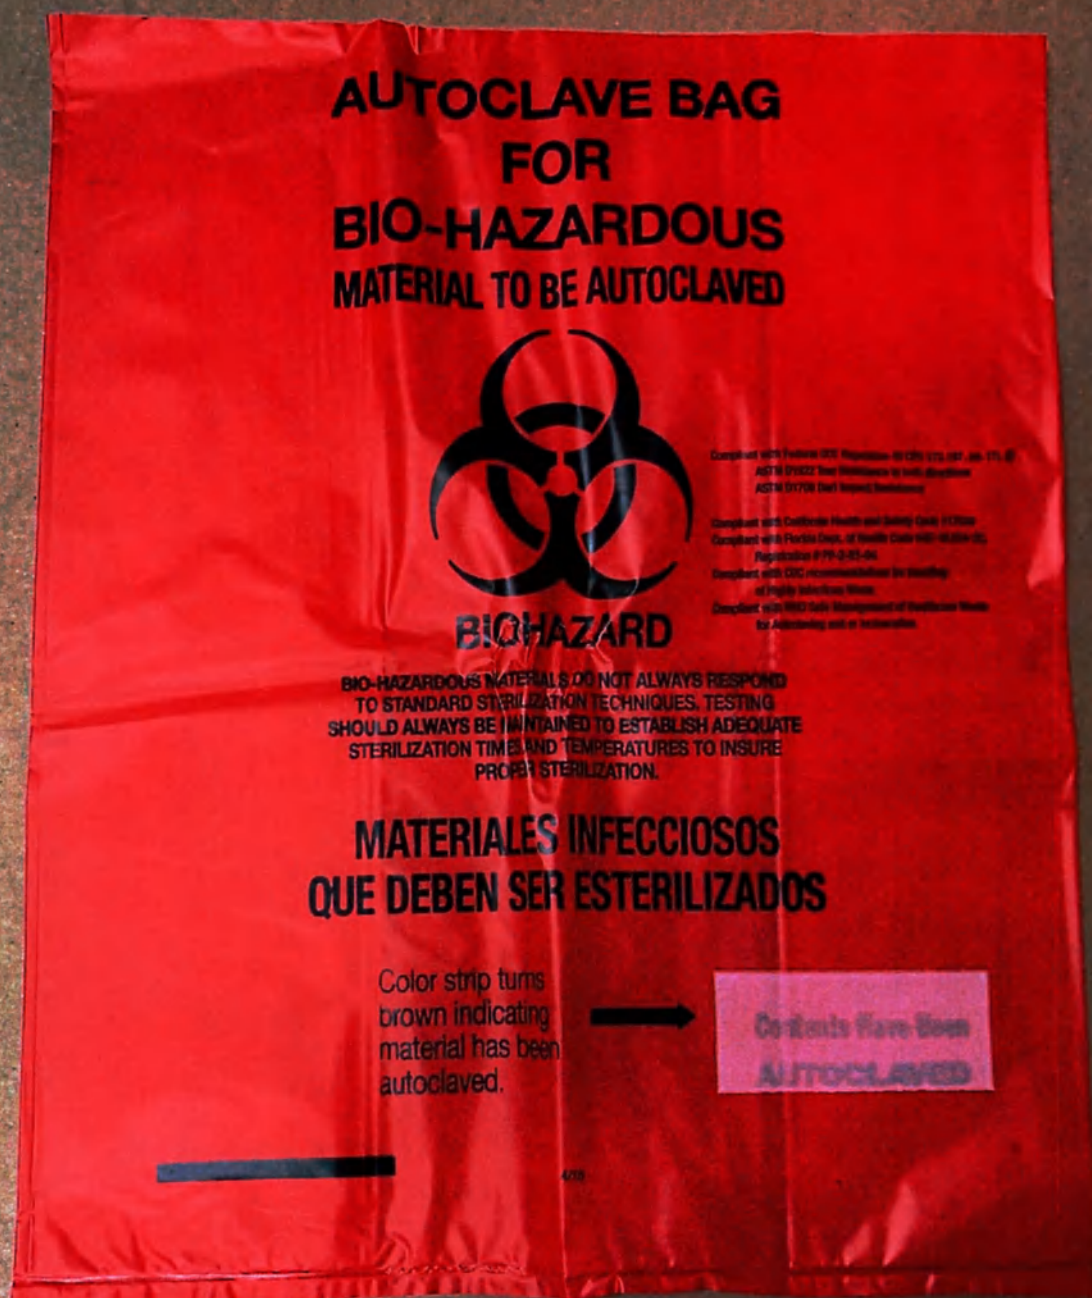




Рисунок 43. Трубочки - поглотители CO2



Рисунок 44. Бутыл для проведения очистки системы

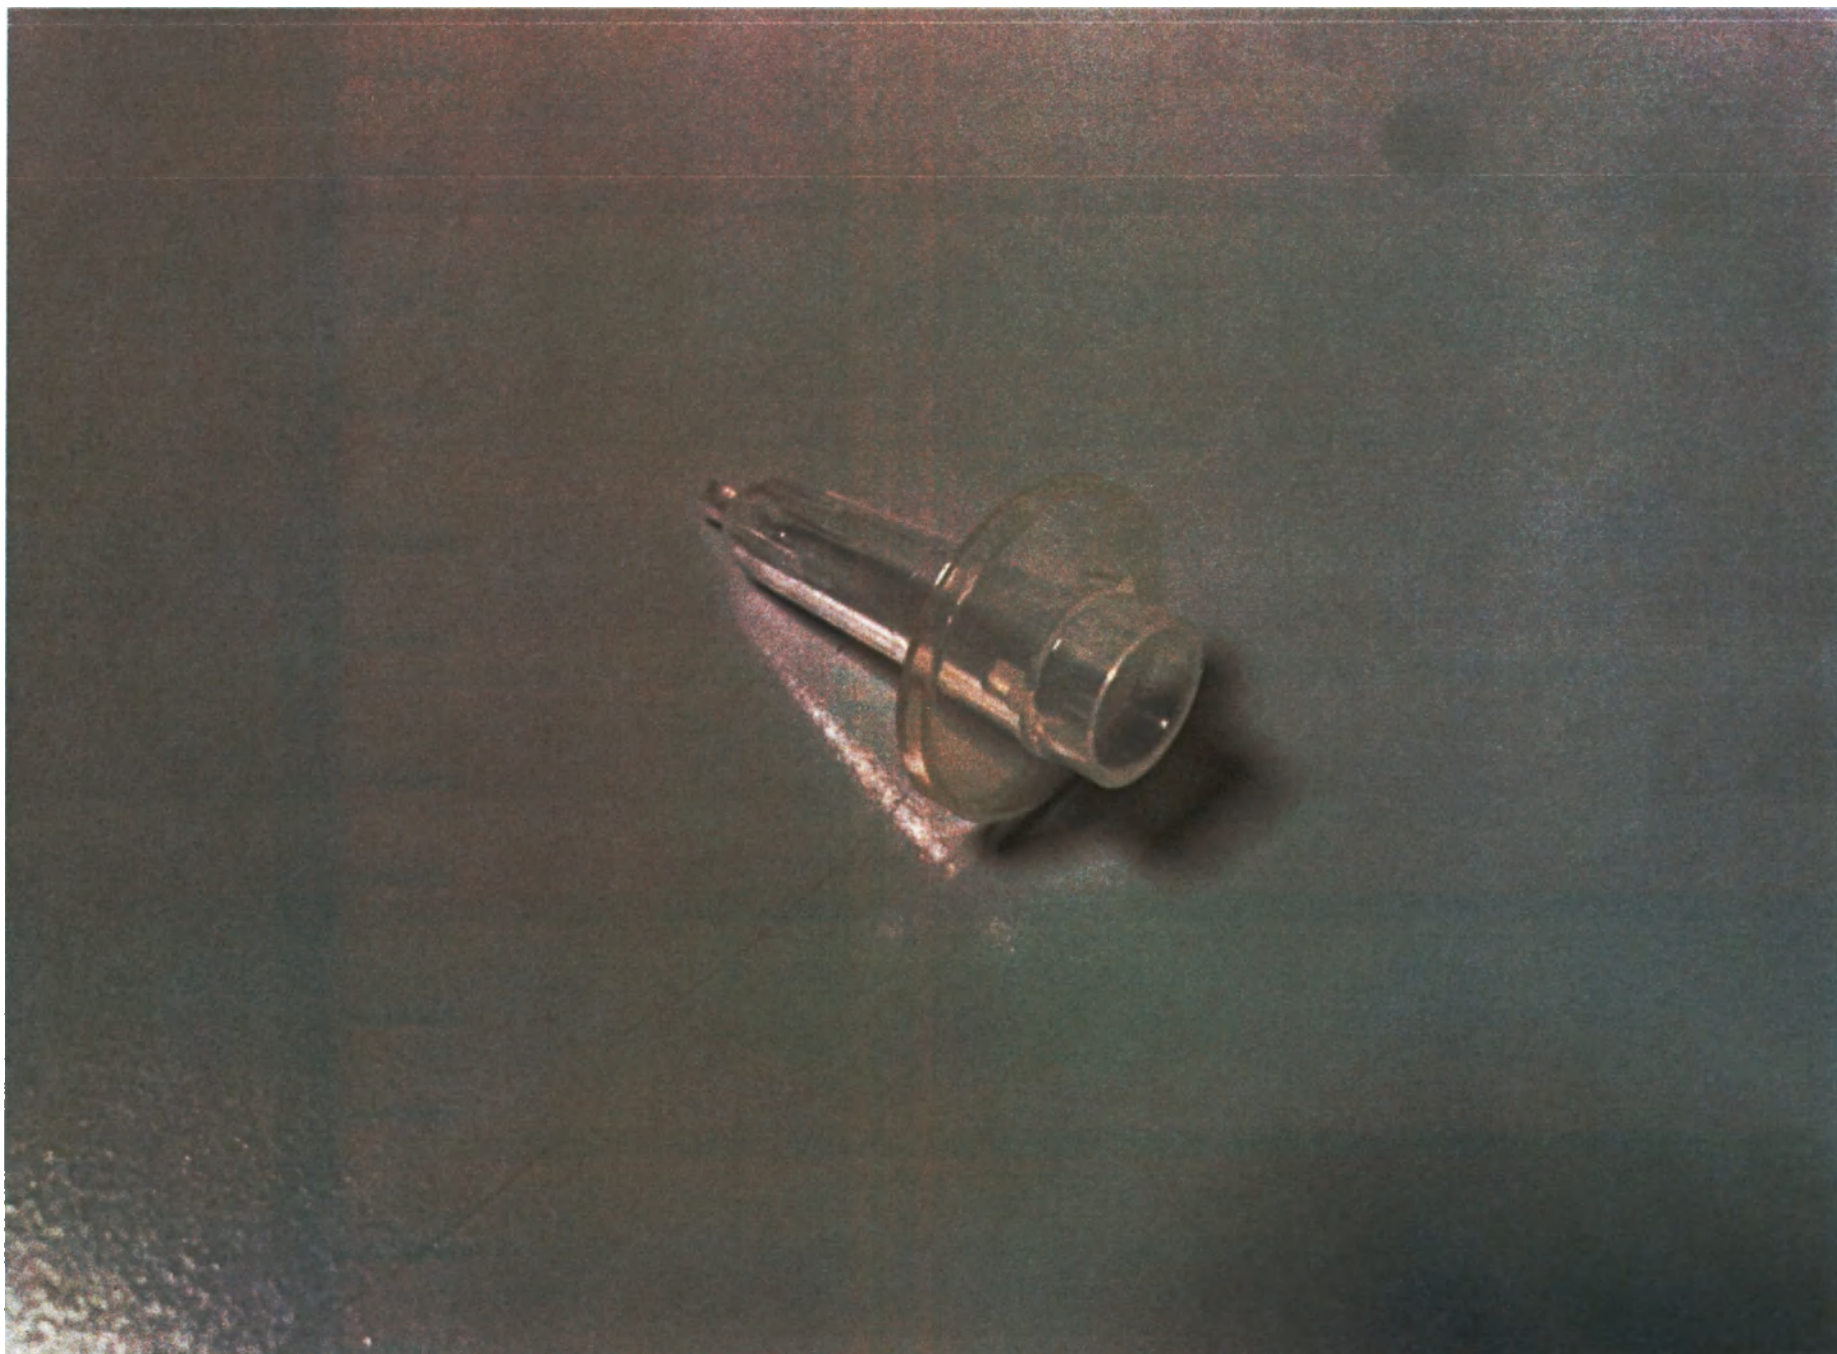


Рисунок 45. Вставка в колодец разведения



Рисунок 46. Бутыл для воды 6л



Рисунок 47. Кабель для заземления кронштейна и стойки подставки

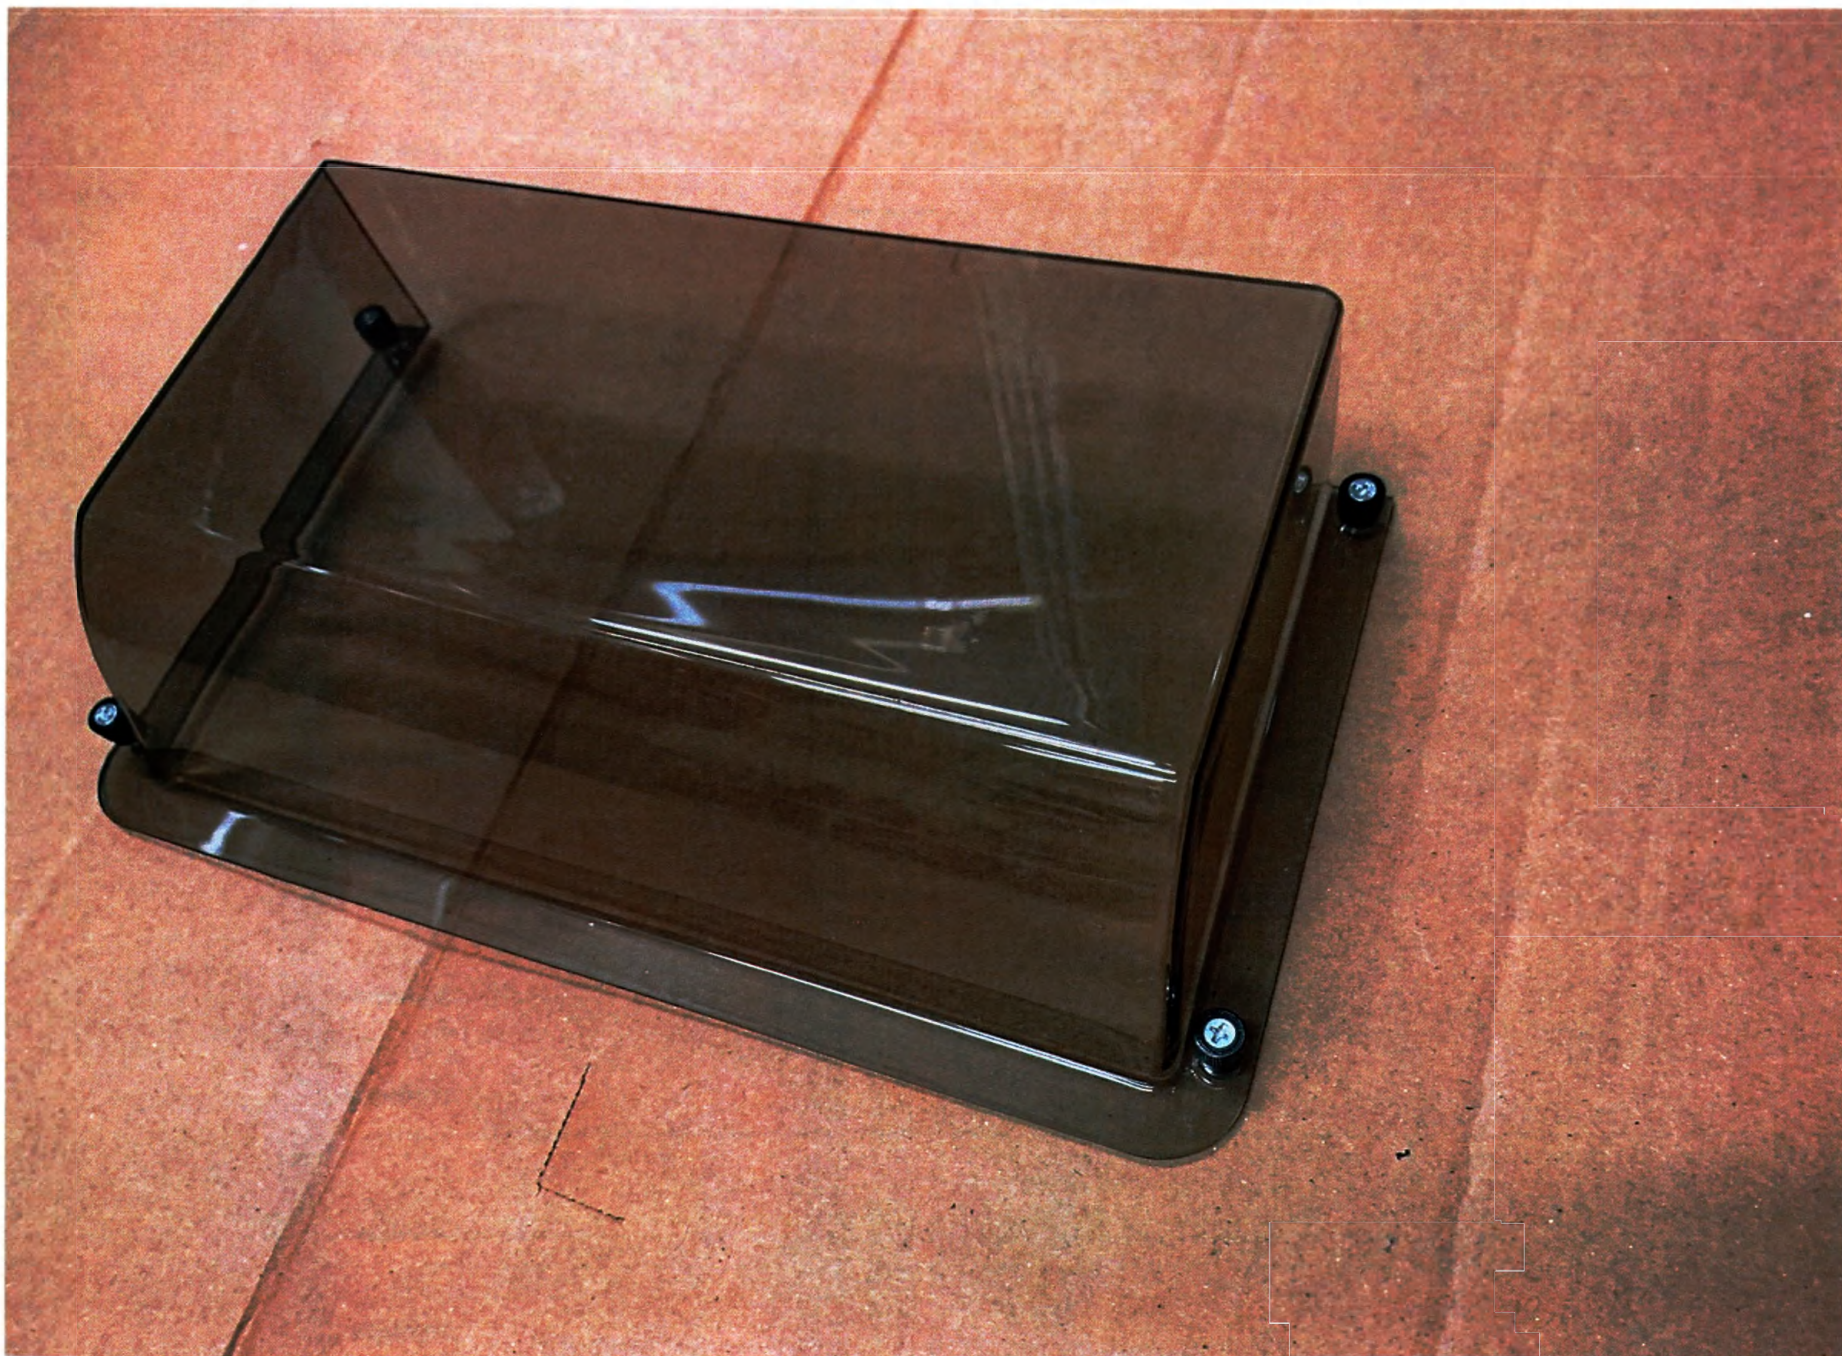



Рисунок 48. Крышка панели подключения



Рисунок 49. Комплект дисков с программным обеспечением

SIEMENS

IMMULITE® 2000
IMMULITE® 2000 Xpi
Immunoassay Systems

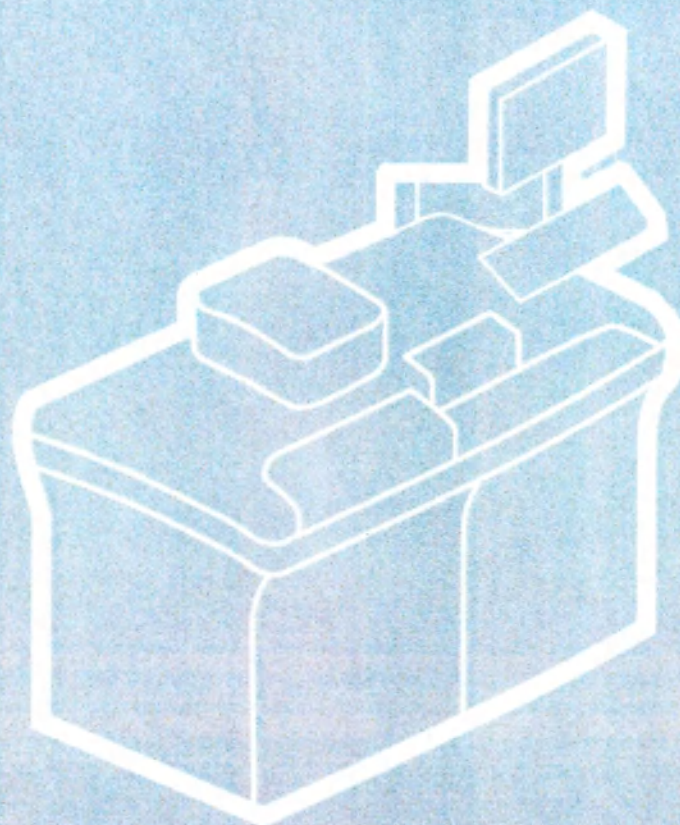

IMMULITE® 2000 Immunoassay Systems

Operator's Guide

REF 10793630 Rev. 02, 2019-03



Рисунок 50. Руководство по эксплуатации (англ.)

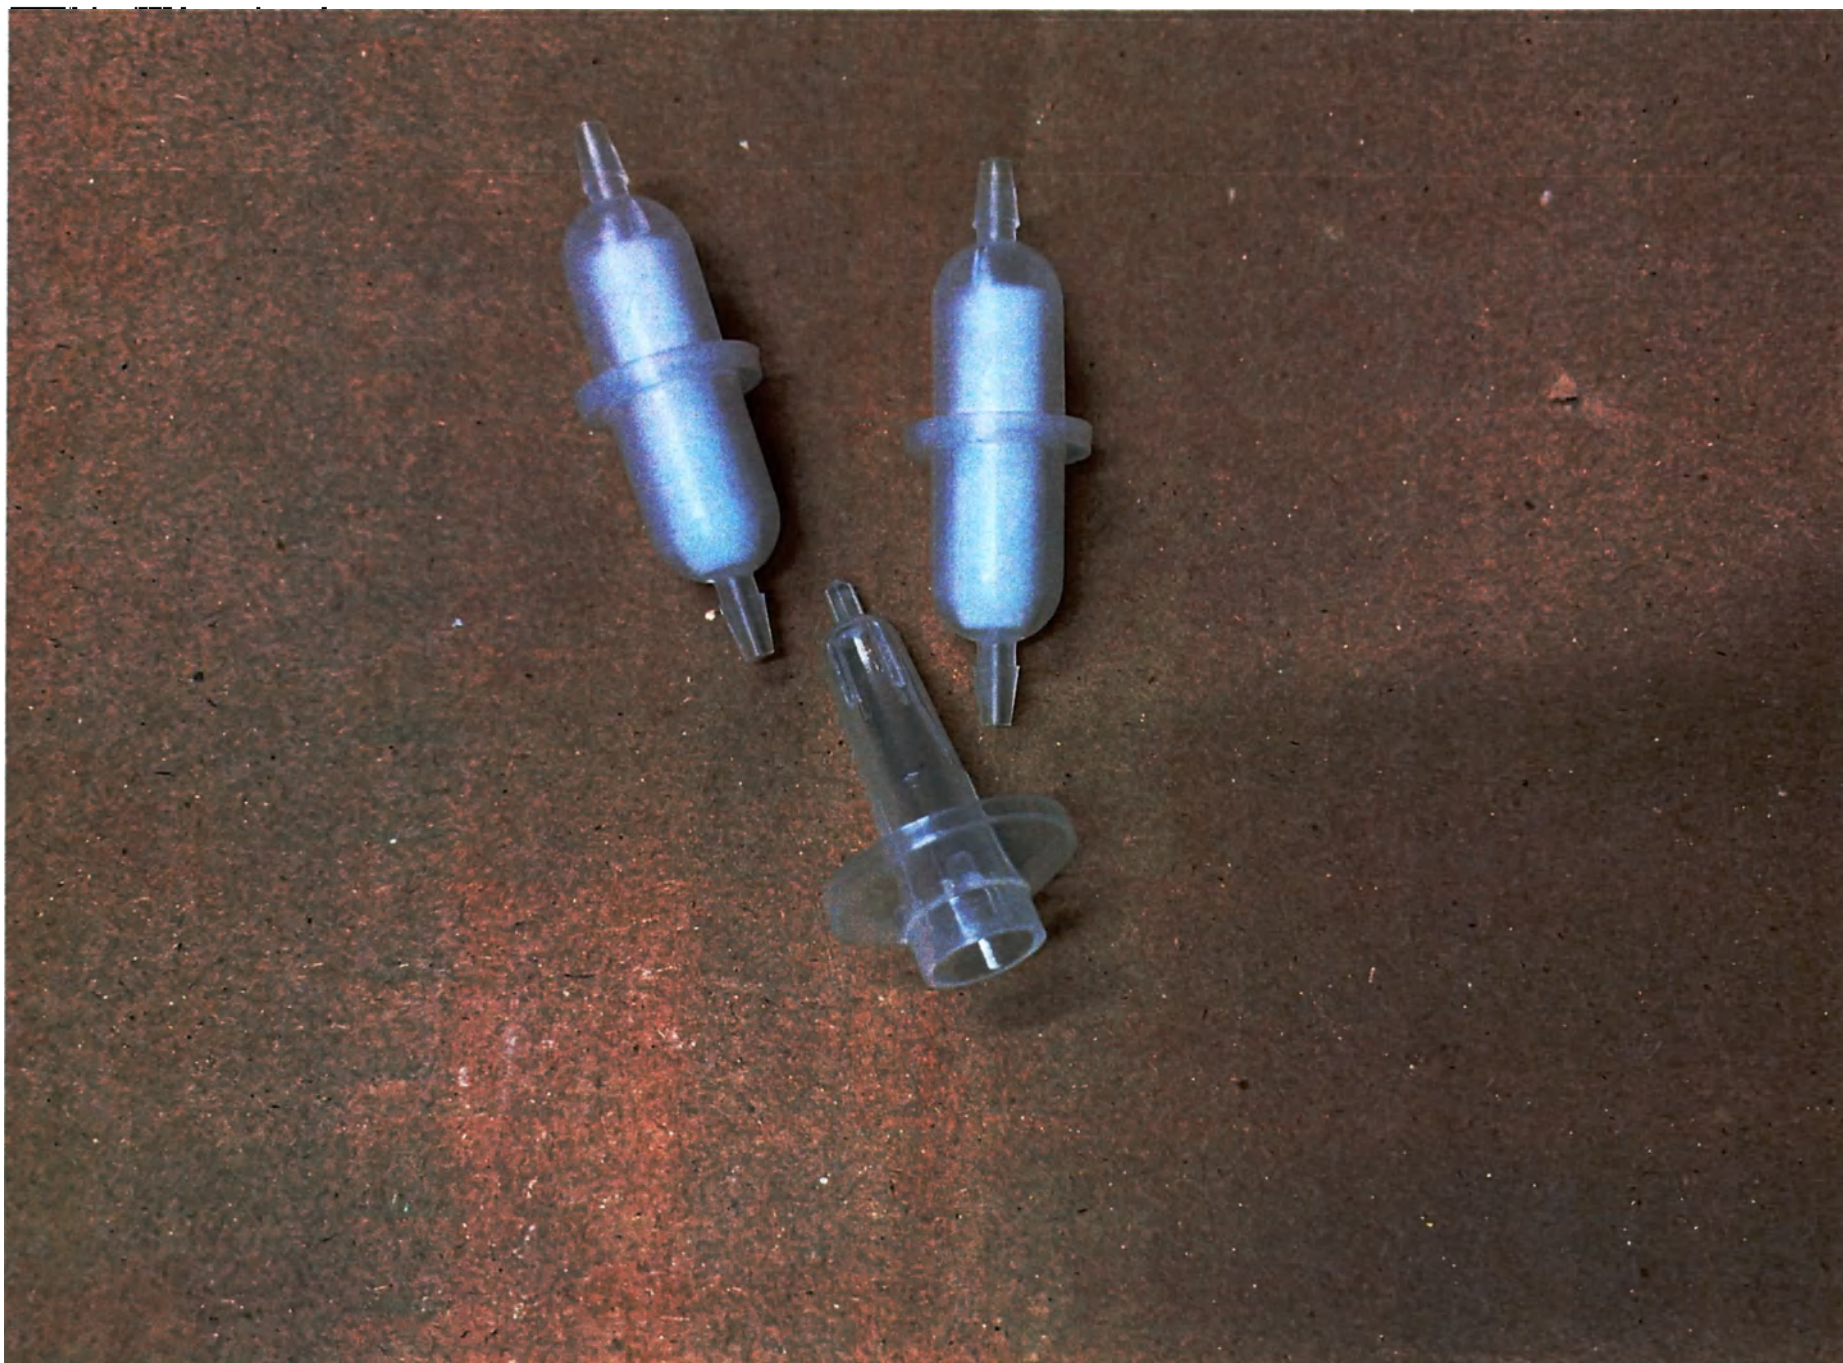


Рисунок 51. Фильтры трубок жидкости

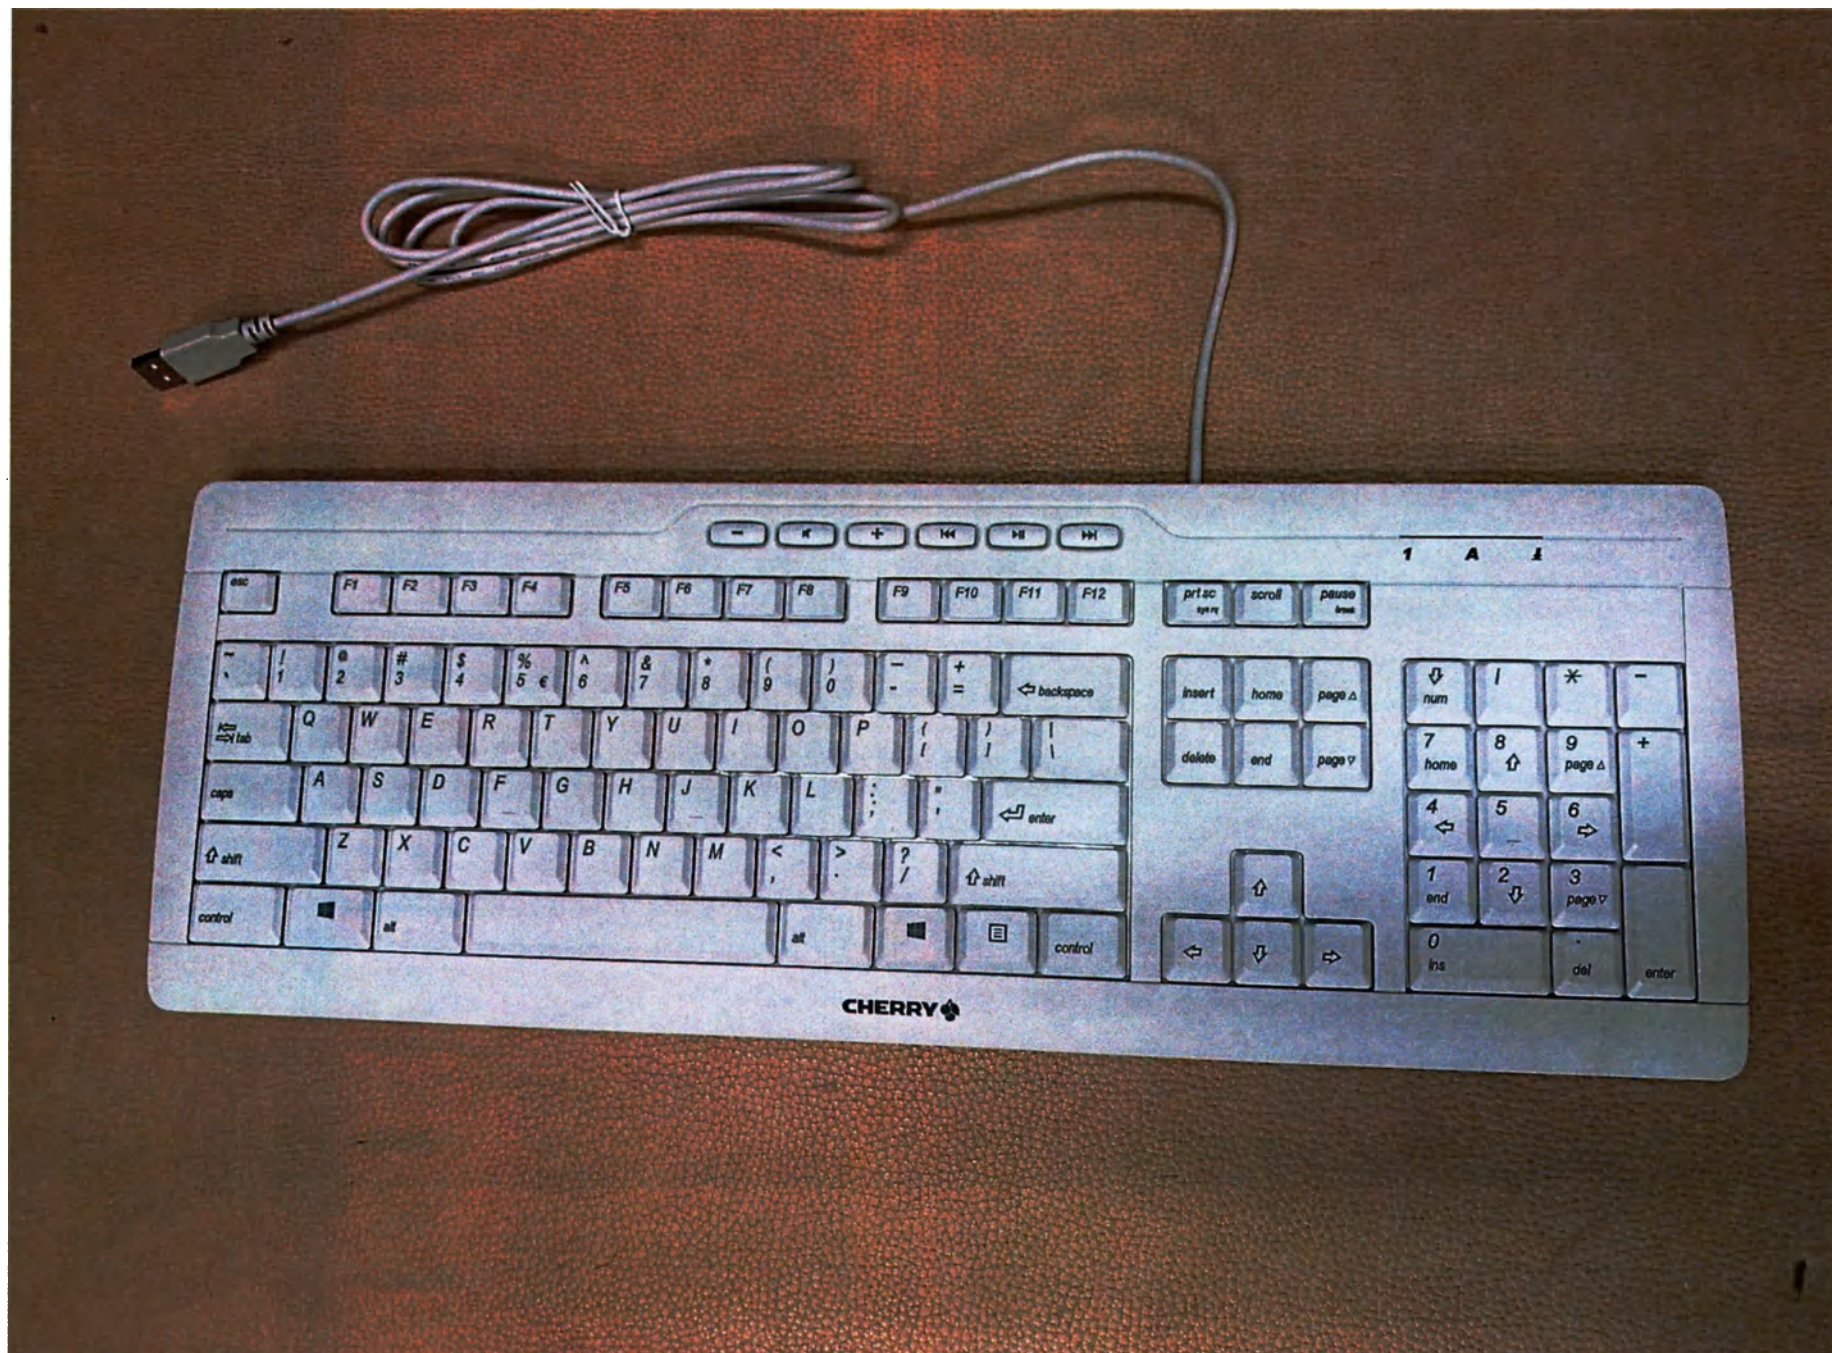



Рисунок 52. Клавиатура с кабелем



Рисунок 53. Бутыль для жидких отходов бл.



Рисунок 54. Набор для работы с микрообъемами

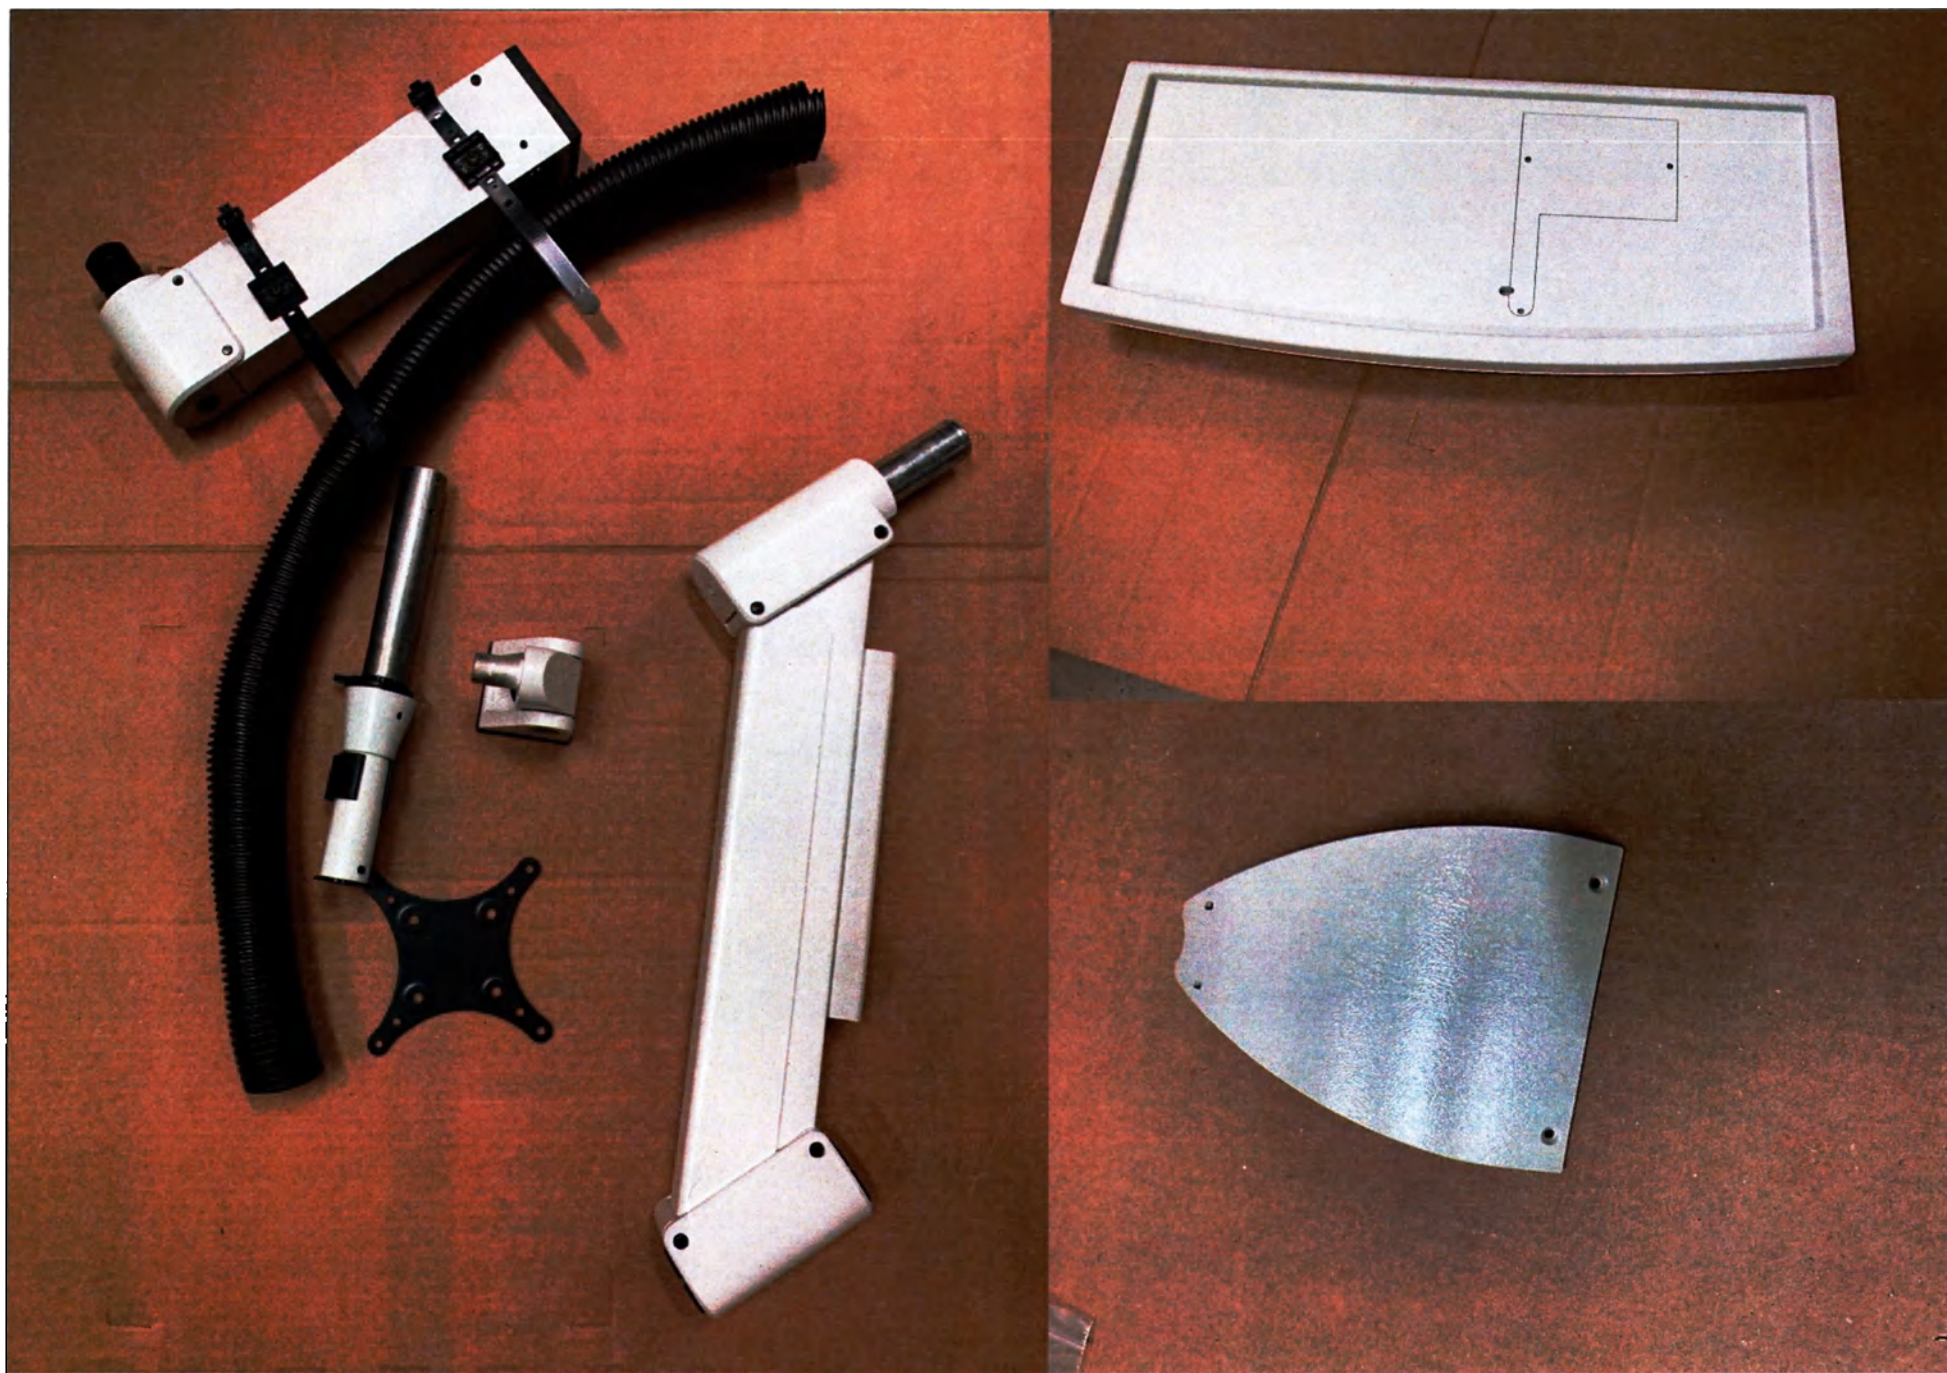

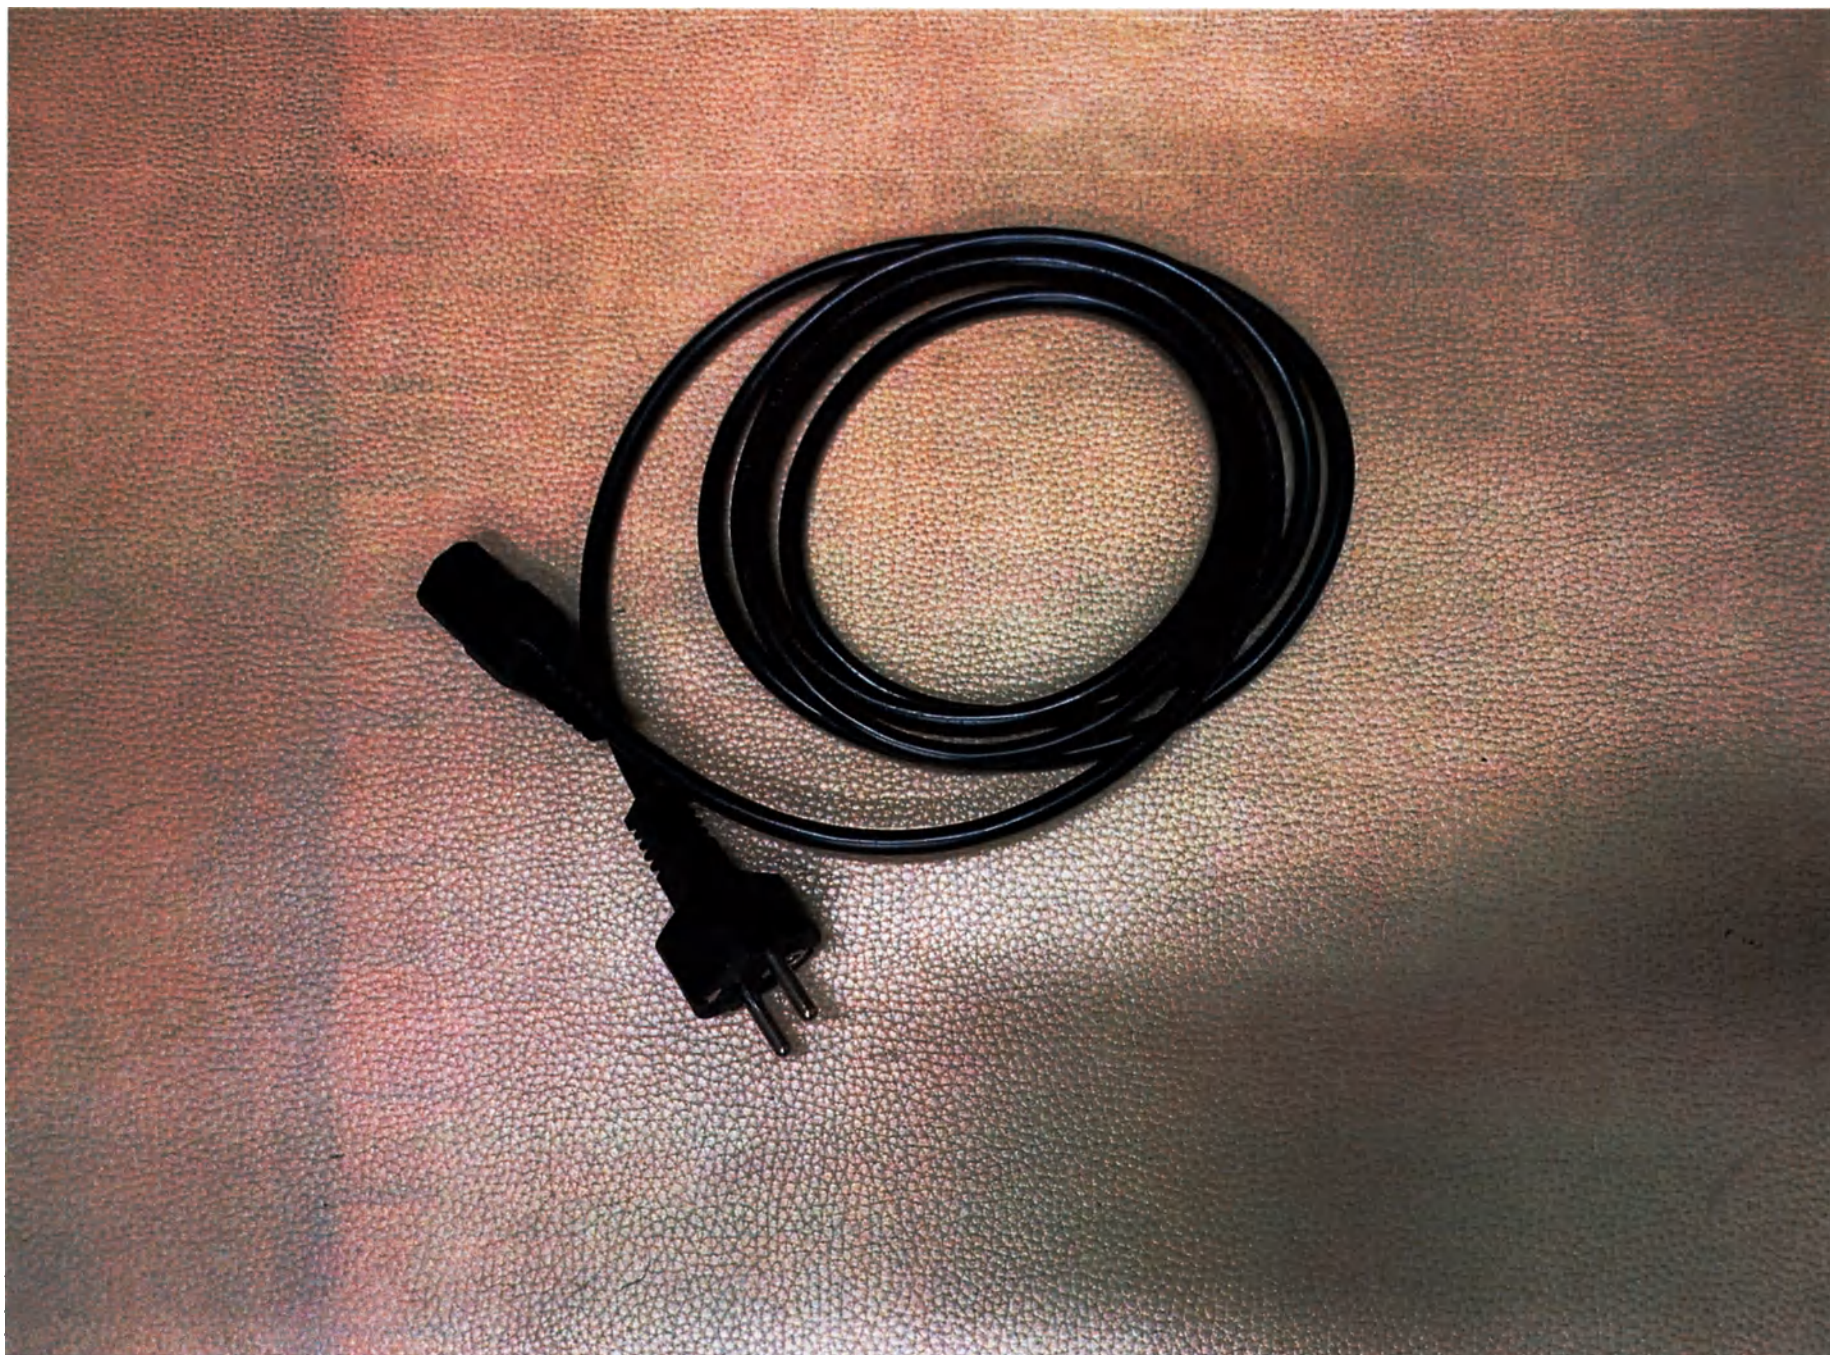


Рисунок 56. Сетевой шнур



Рисунок 57. Бутыл для промывающей жидкости 2л



Рисунок 58. Реакционные пробирки



Рисунок 59. Контейнер для твердых отходов



Рисунок 60. Защита от превышения напряжения



Рисунок 61. Набор инструментов



Рисунок 62. Монитор с сенсорным экраном и 4 кабеля к нему



Рисунок 63. Шаровой манипулятор-трекбол с кабелем



Рисунок 64. Мандрен для очистки трубы отходов



Рис. 65. Ножки для прибора



Рисунок 66. Подставки для работы с аллерготестами



67. Наборы профилактического обслуживания
ООО ЦРМИ info@cirmi.ru www.goszdravnadzor.ru

Анализатор иммунохемилюминесцентный Immulite 2000

Регистрационное удостоверение:

№ ФСЗ 2007/00551 от 14.07.2022

ТОЛЬКО ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ IN VITRO

Производитель, дата производства, серийный номер и др. символы указаны на оригинальной маркировке изделия

200/208/220/230/240 В

50/60 Гц

6 А

1500 Вт

Уполномоченный представитель производителя на территории Российской Федерации:

ООО «Сименс Здравоохранение», 115093, Россия, г. Москва, ул. Дубининская, д. 96

Тел.: 8(800) 550 50 22

Рисунок 68. Макет маркировки для Российской Федерации, который будет наноситься на Блок Анализатора иммунохемилюминесцентного Immulite 2000.

Анализатор иммунохемилюминесцентный Immulite One



Рисунок 69. Блок Анализатора иммунохемилюминесцентного Immulite One



Рисунок 70. Сканер штрих-кодов и кабель к нему

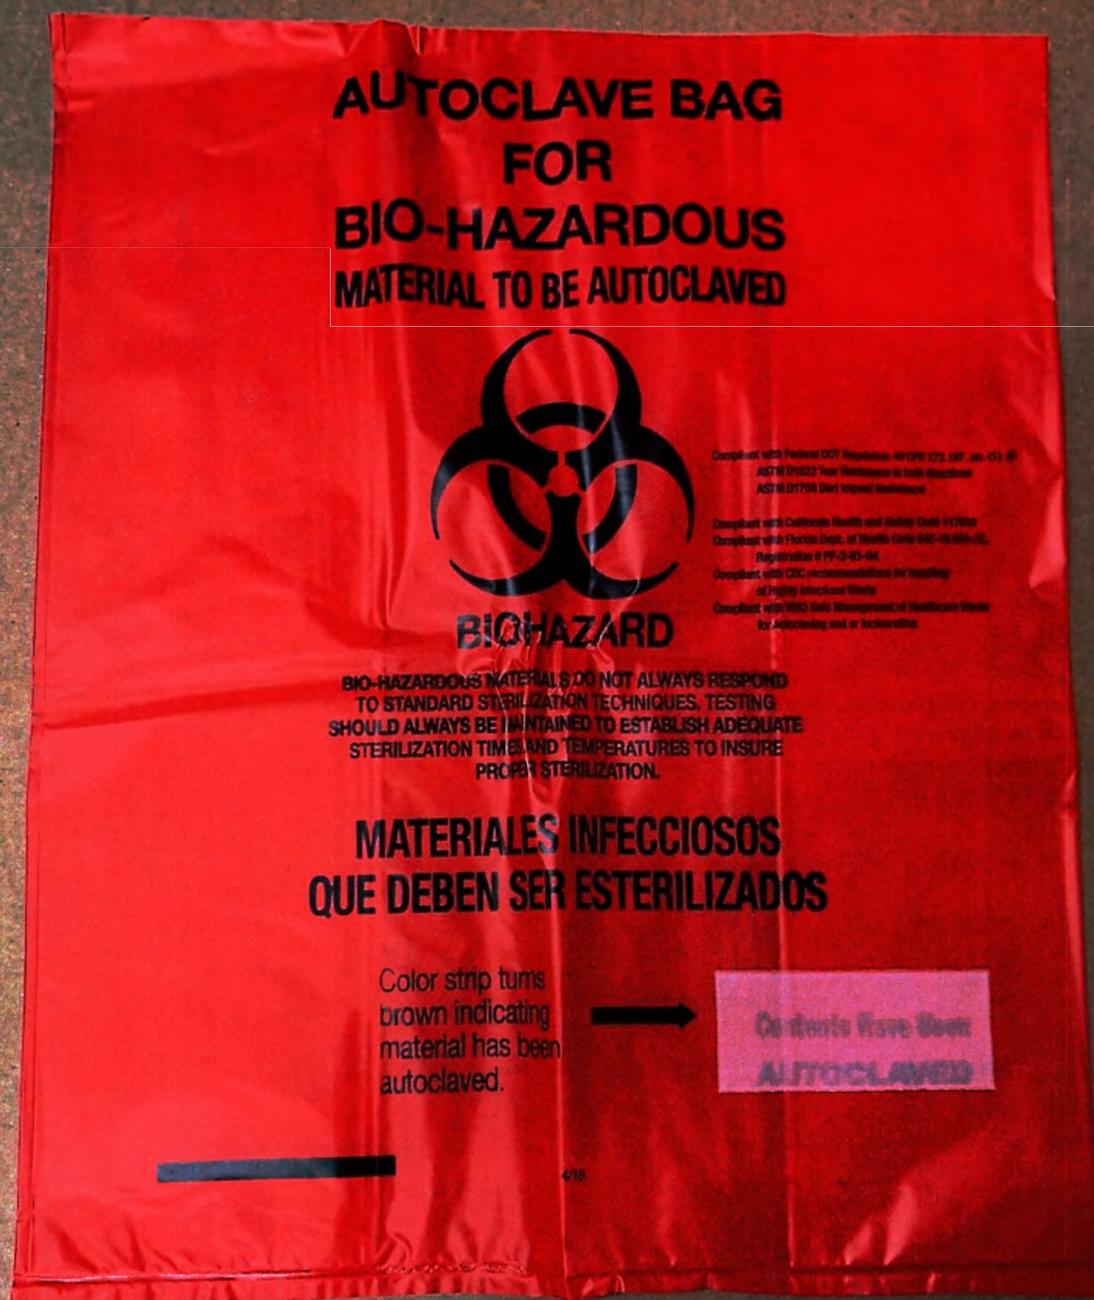




Рисунок 72. Бутыл для воды (2 л)

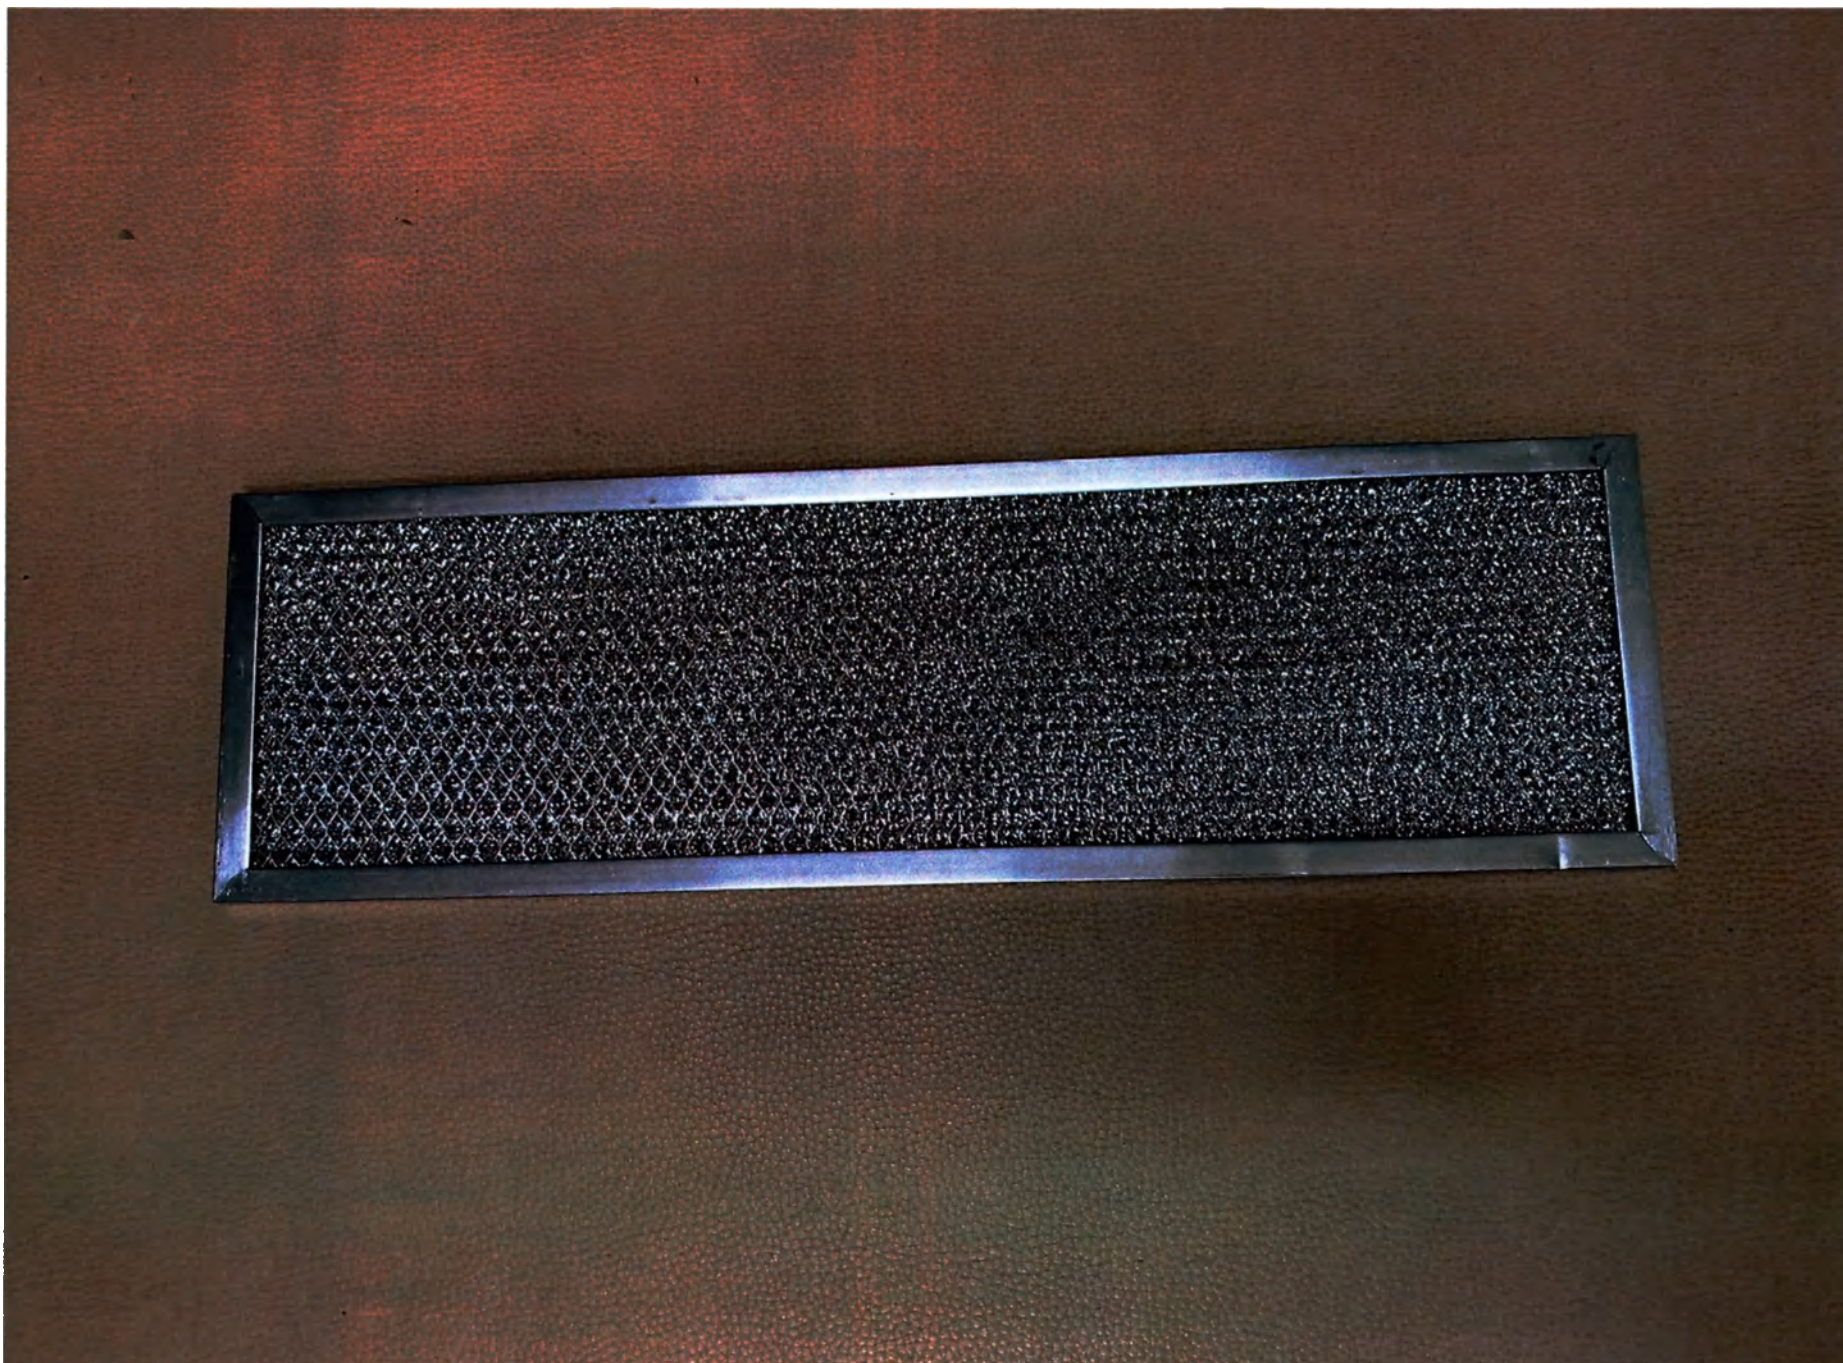


Рисунок 73. Фильтр вентилятора

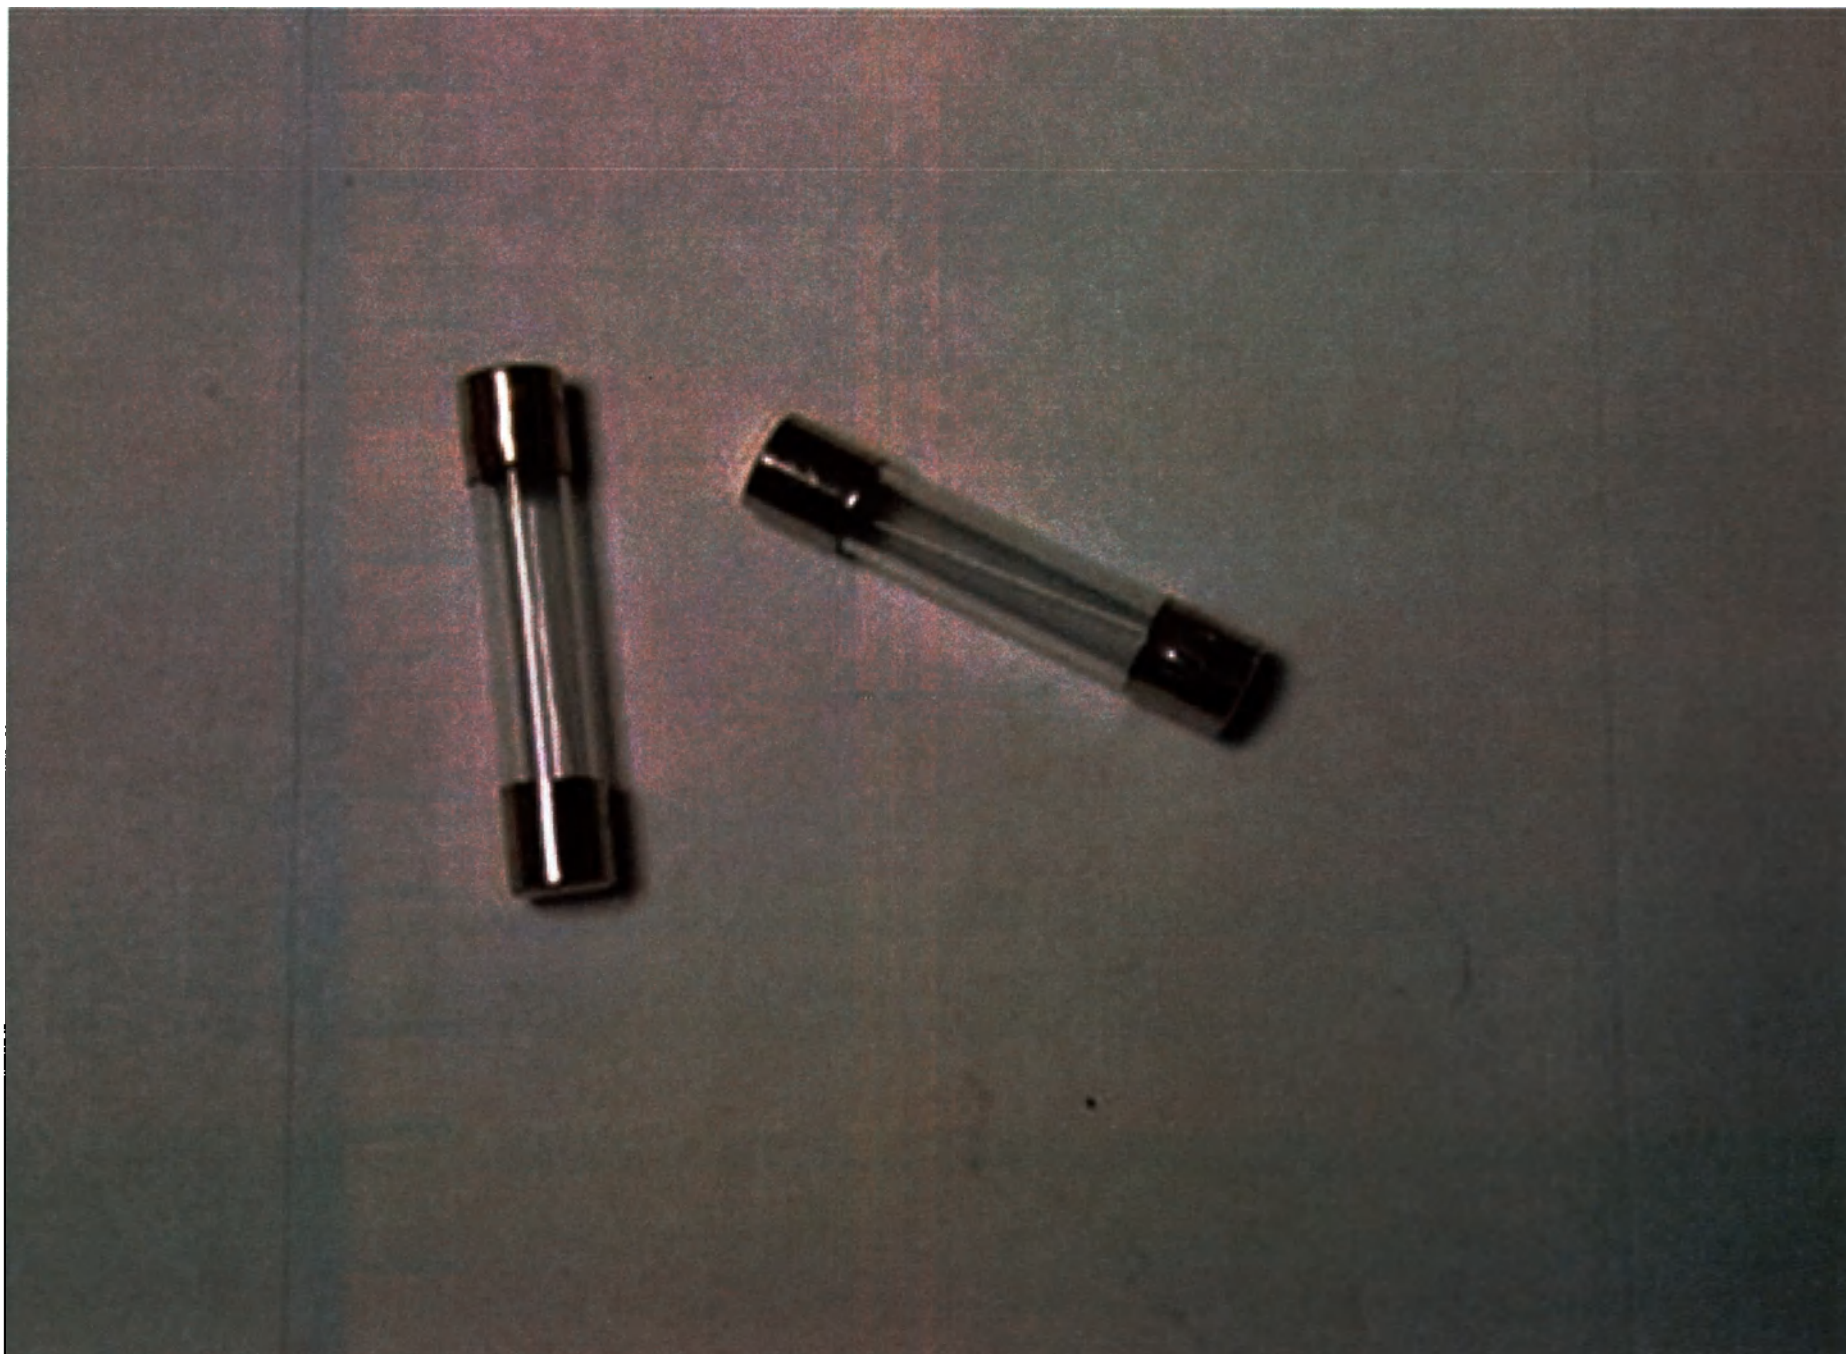


Рисунок 74. Предохранители



Рисунок 75. Кабель к компьютеру

SIEMENS

IMMULITE® & IMMULITE 1000


Installation Guide

Document Number: 600888
Revision A
Date: January 2007

Copyright © 2007 by Siemens Medical Solutions Diagnostics. All rights reserved.

SIEMENS

IMMULITE® One
Immunoassay System

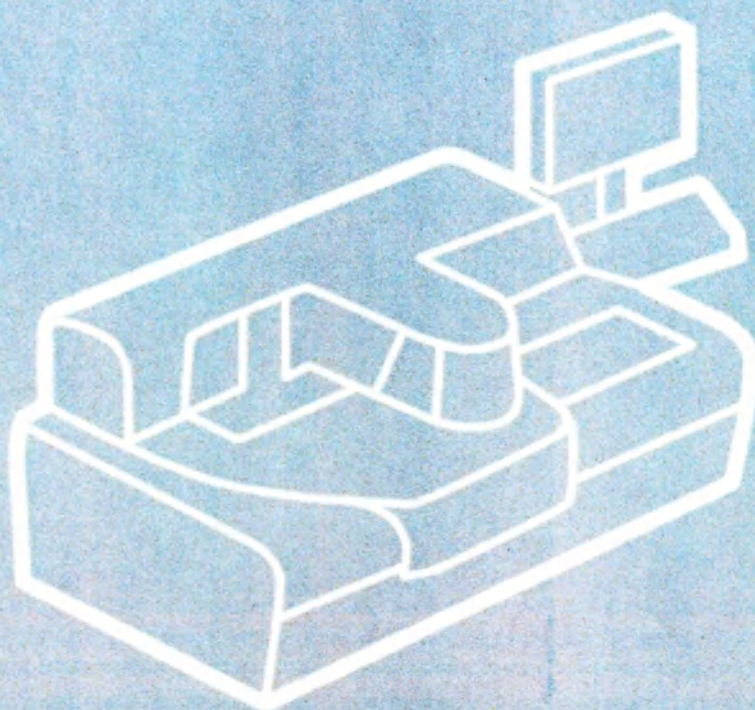

IMMULITE® One Immunoassay Systems

Operator's Guide

REF 11153892 Rev. 03, 2021-02



Рисунок 77. Руководство по эксплуатации





Рисунок 79. Бутыль для жидких отходов 2л



Рисунок 80. Г-образные переходники (12 и 14 дюйма)

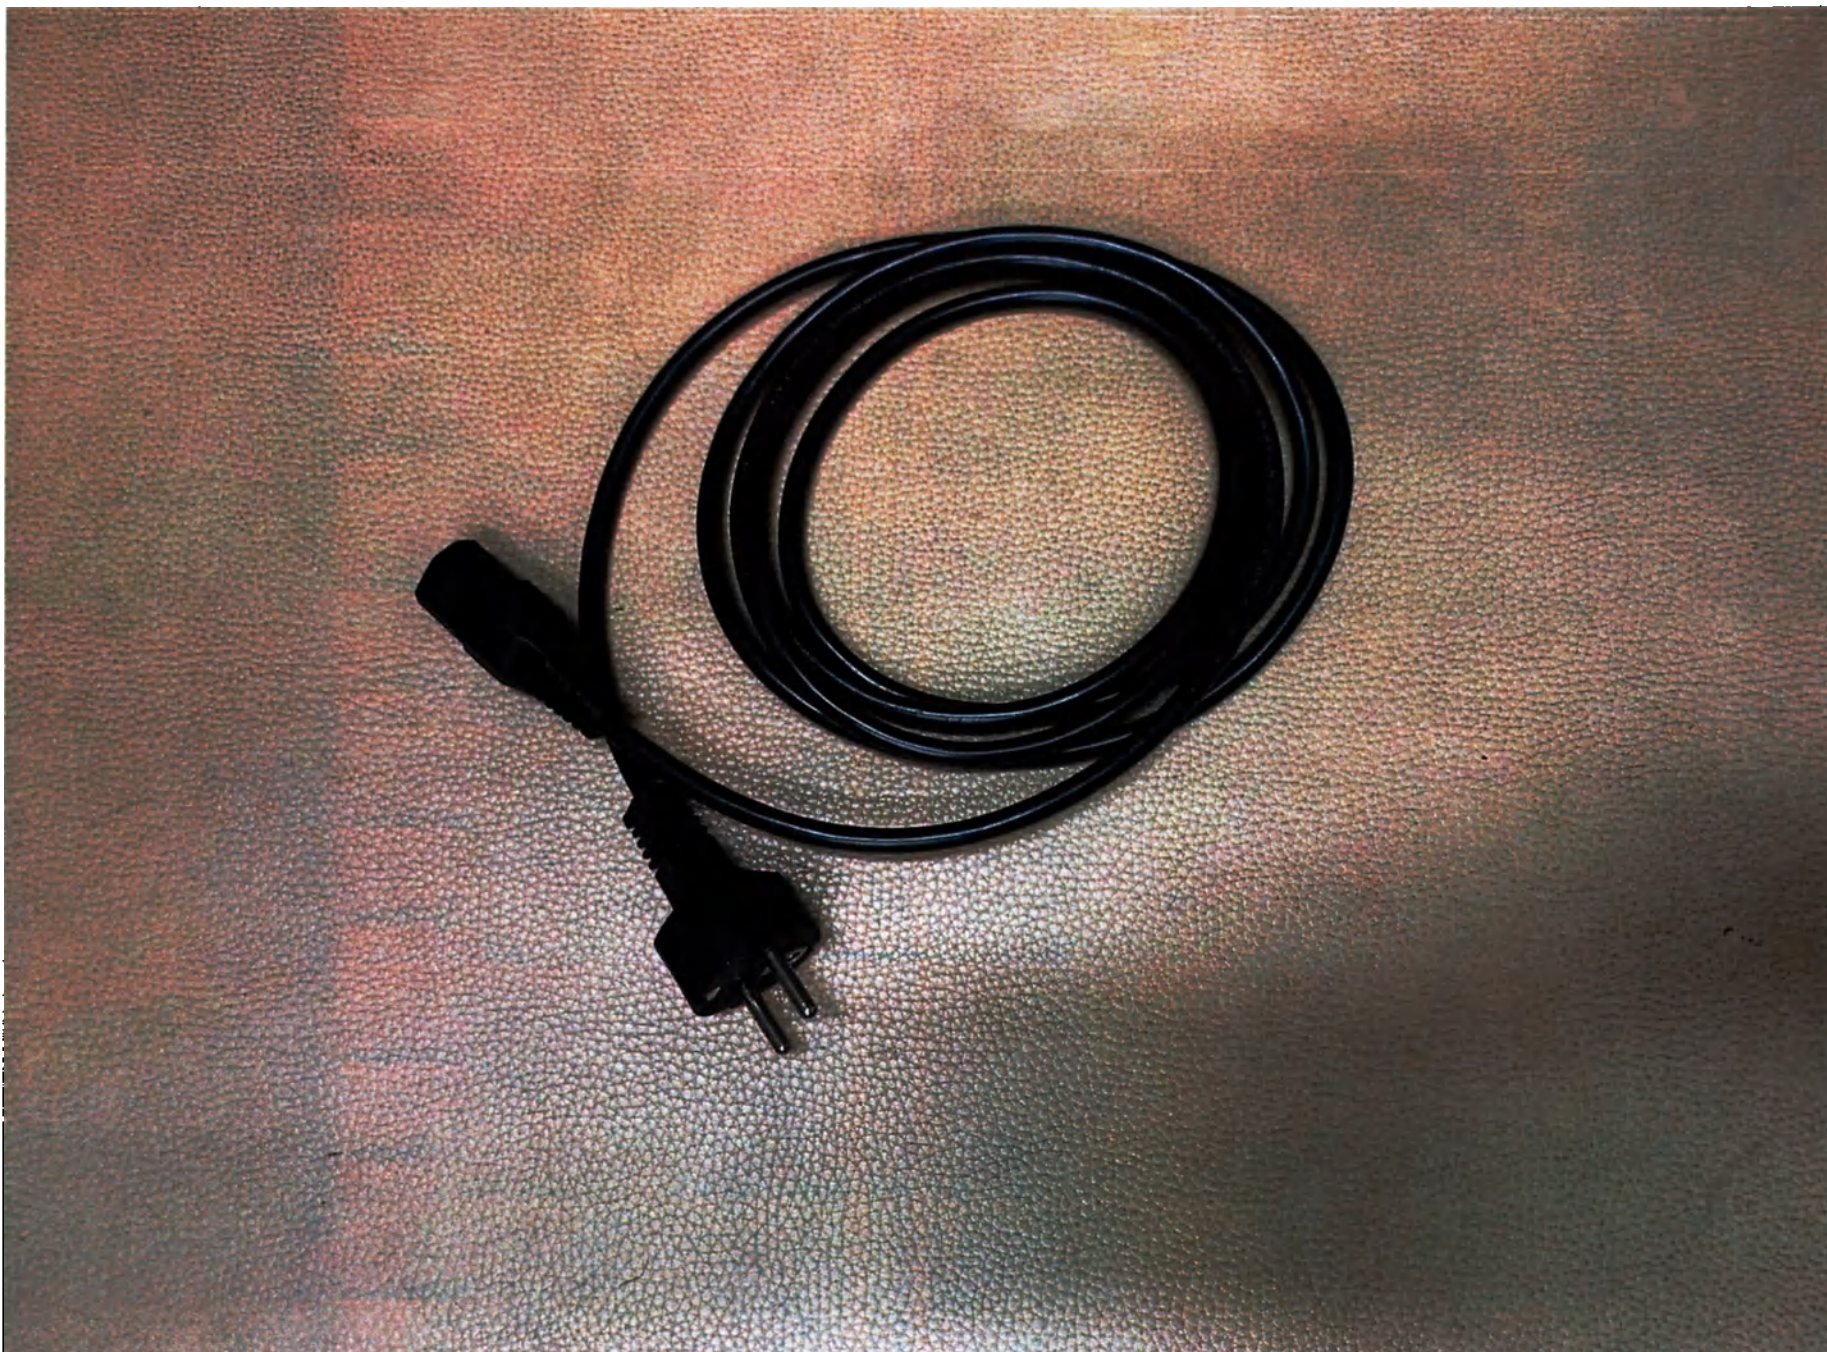


Рисунок 81. Кабели питания



Рисунок 82. Бутыл для промывающей жидкости (1л)

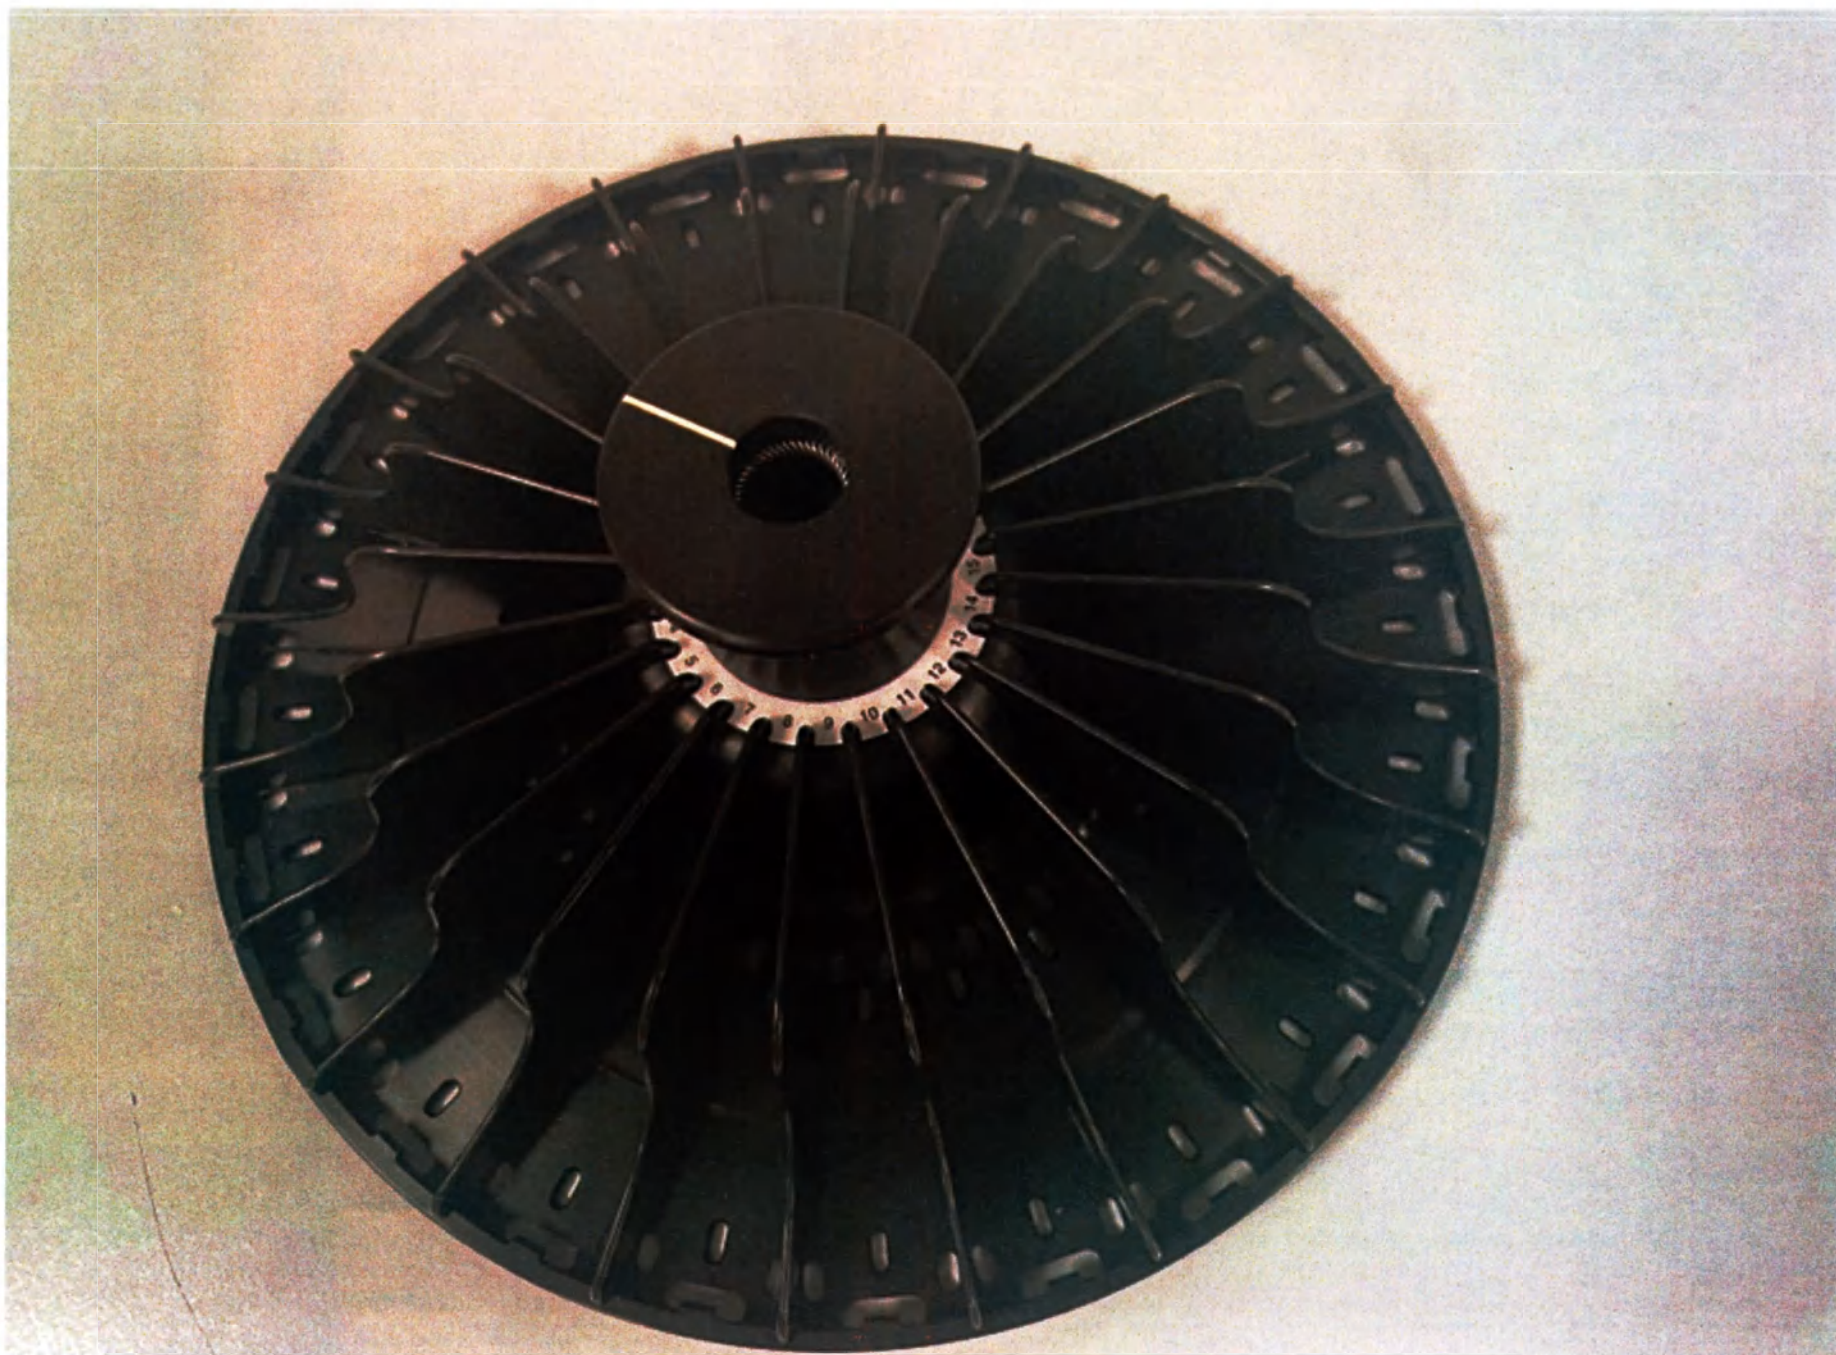


Рисунок 83. Карусель для реактивов



Рисунок 84. Крышки пробирок для проб



Рисунок 85. Подставки для пробирок с образцами



Зунон 86. Пробирки для проб

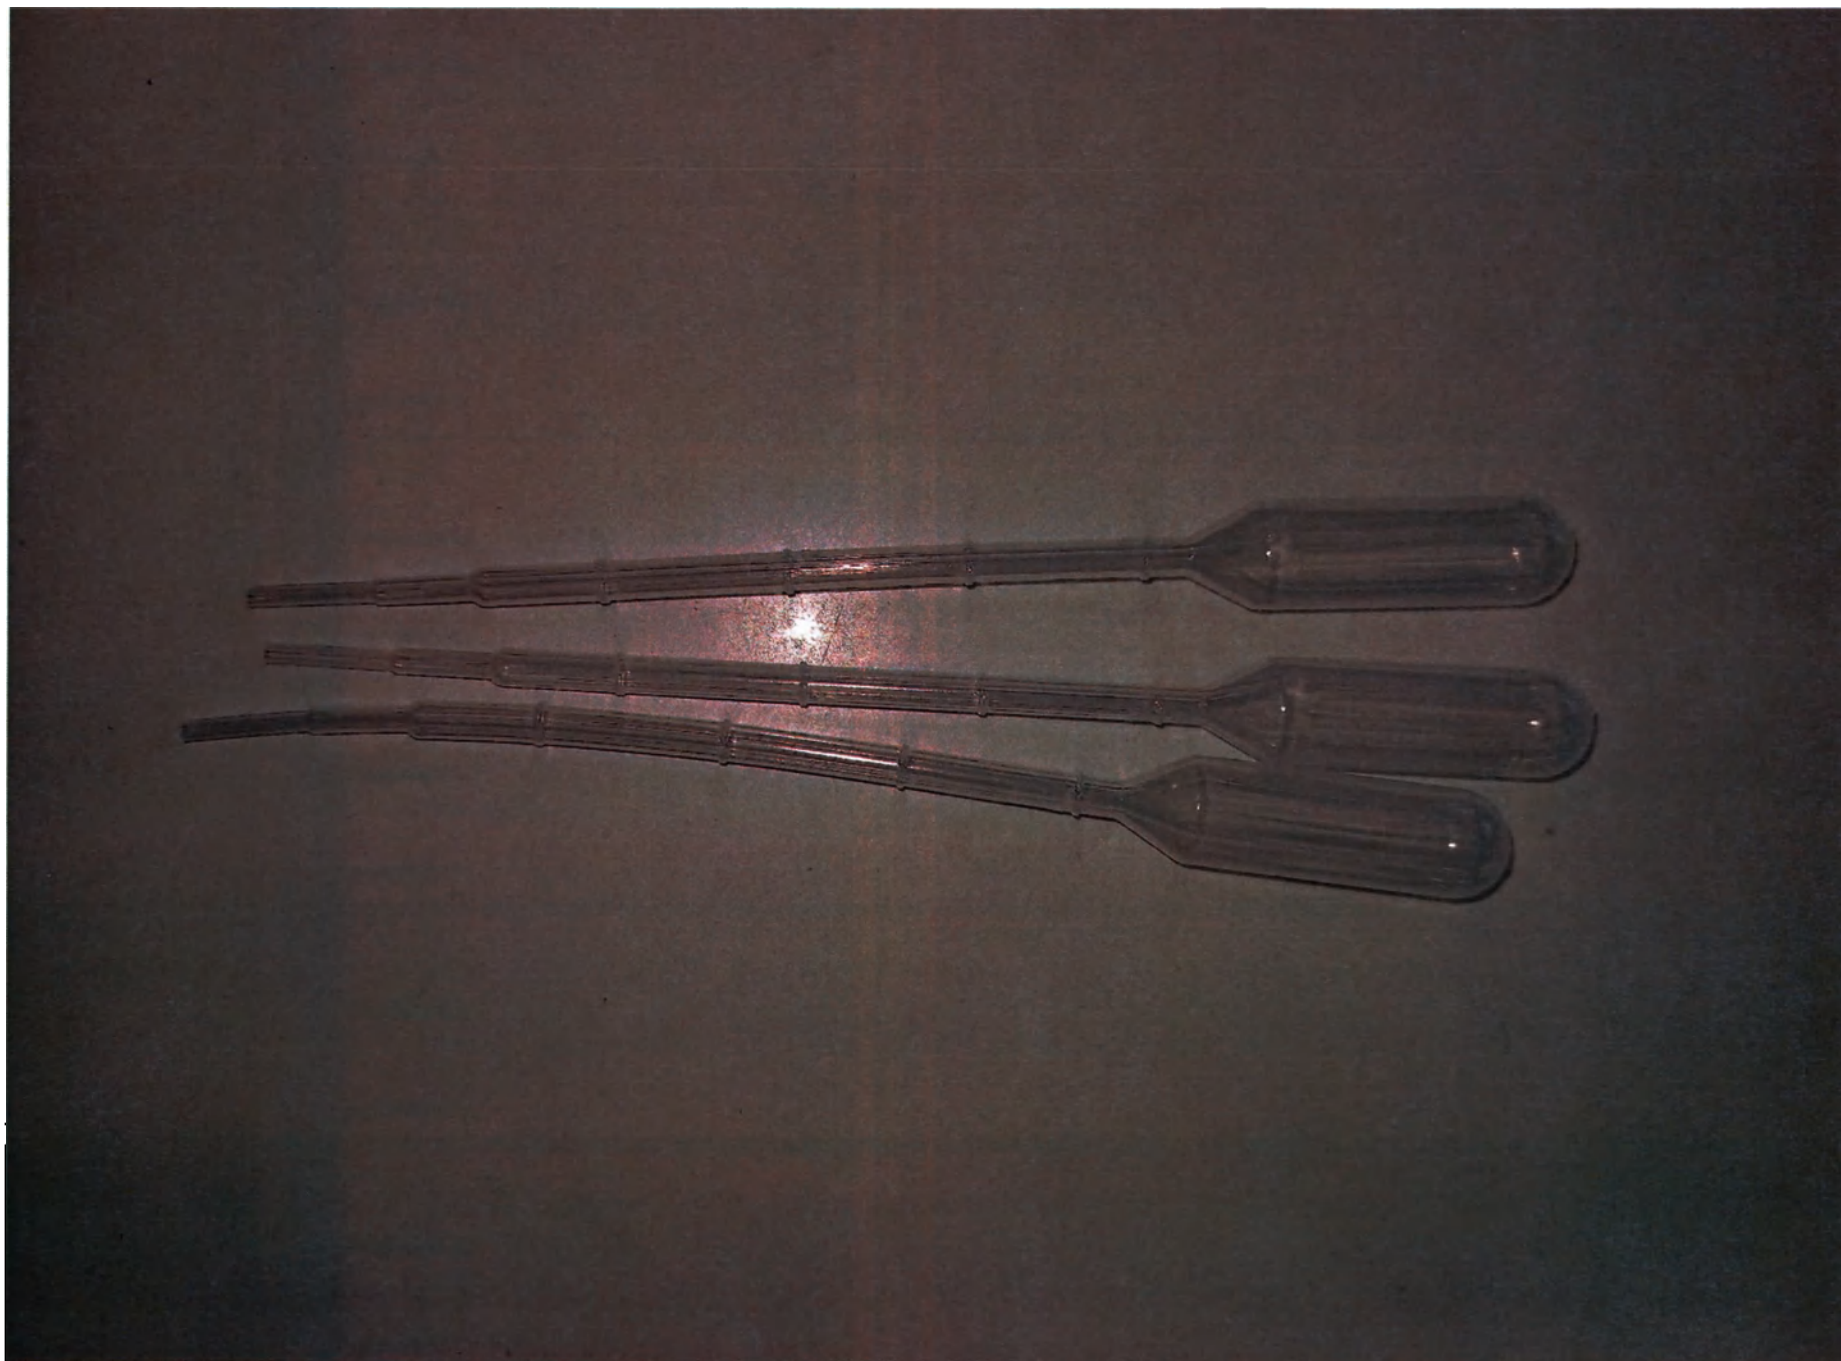


Рисунок 87. Пипетки для переноса проб

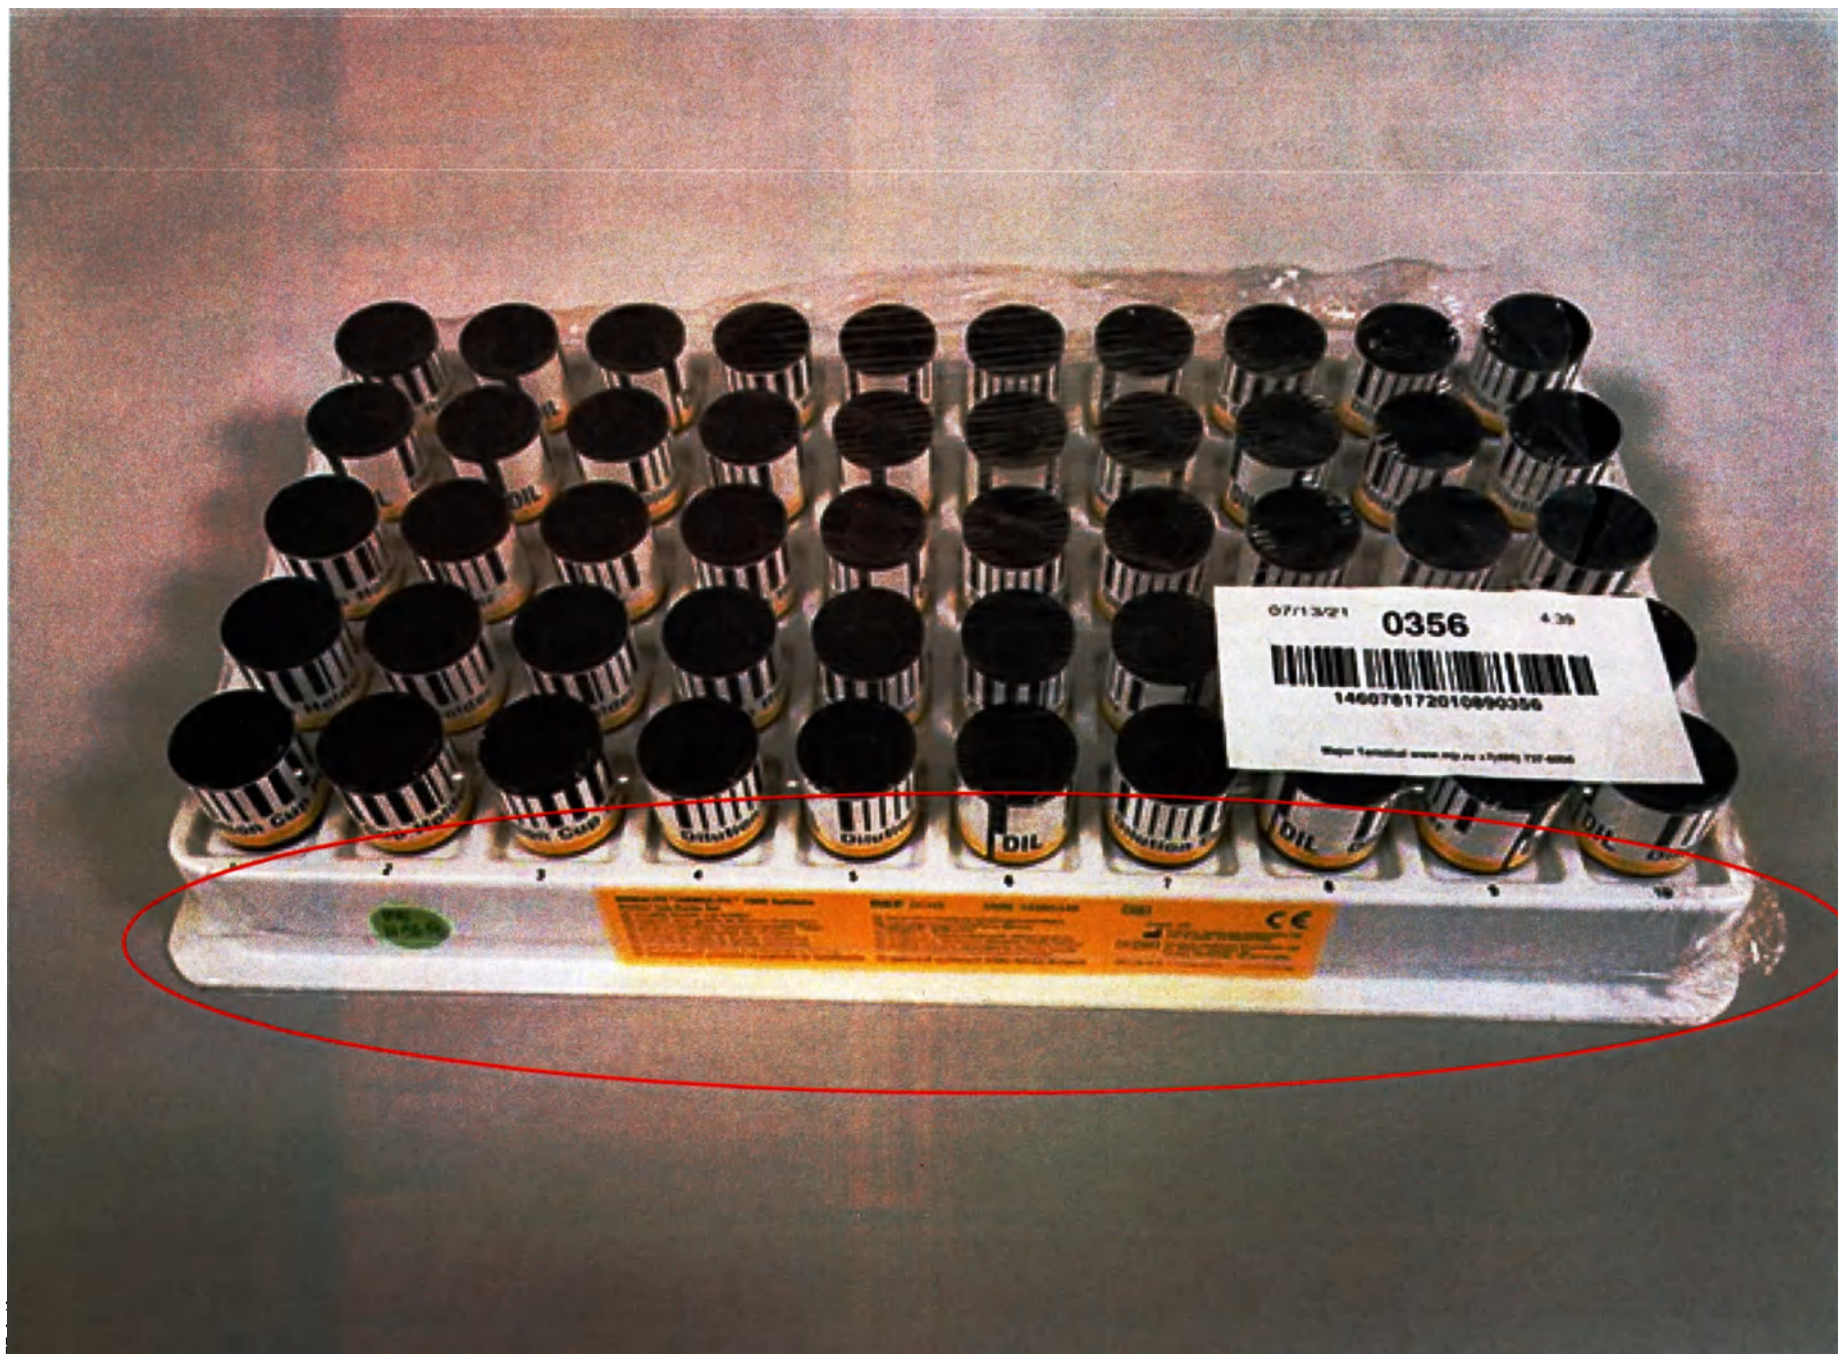


Рисунок 88. Штатив для переноса проб



Рисунок 89. Контейнер для твердых отходов

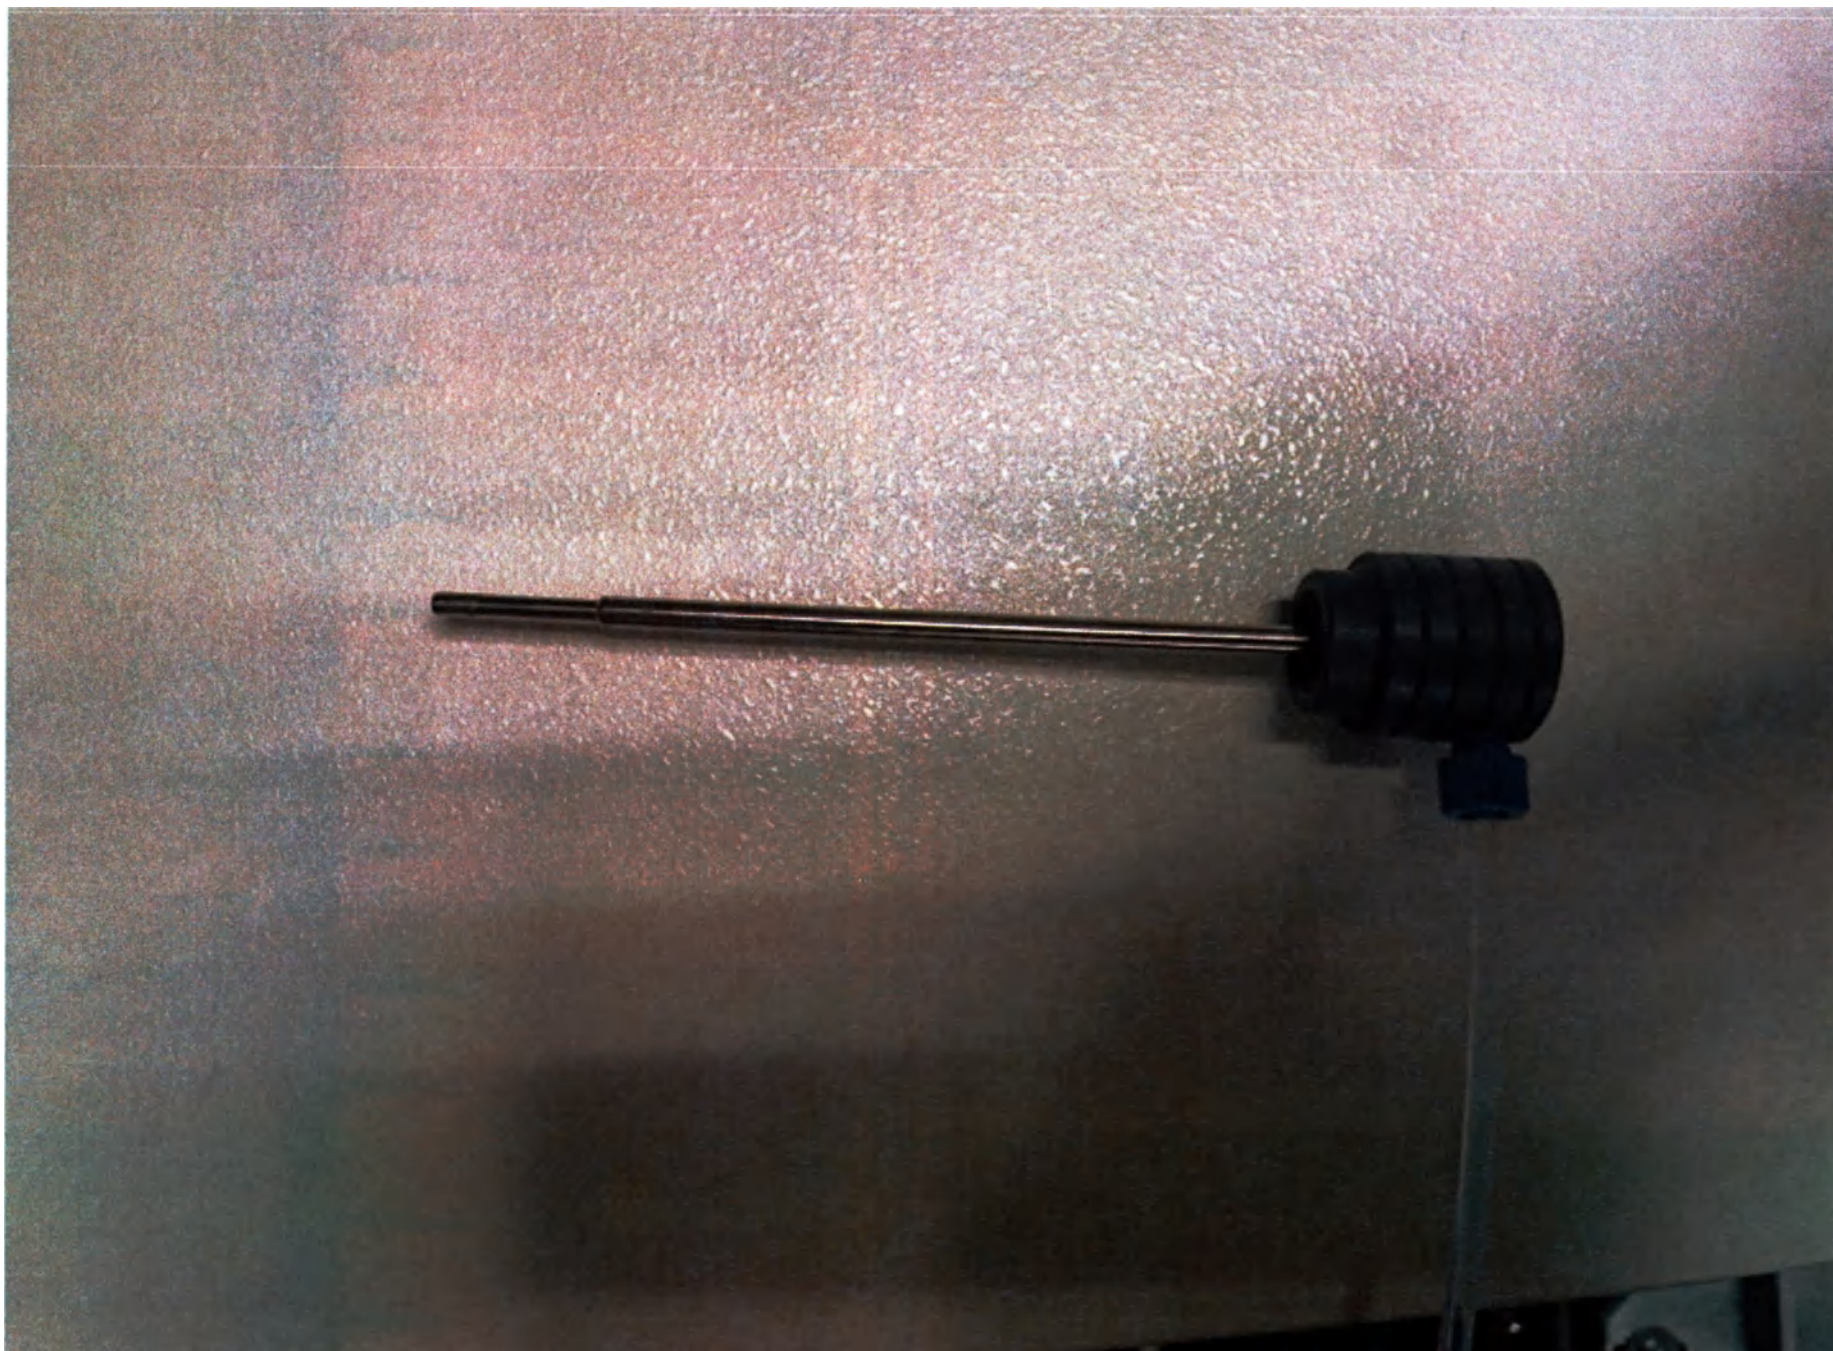


Рисунок 90. Игла заборника субстрата

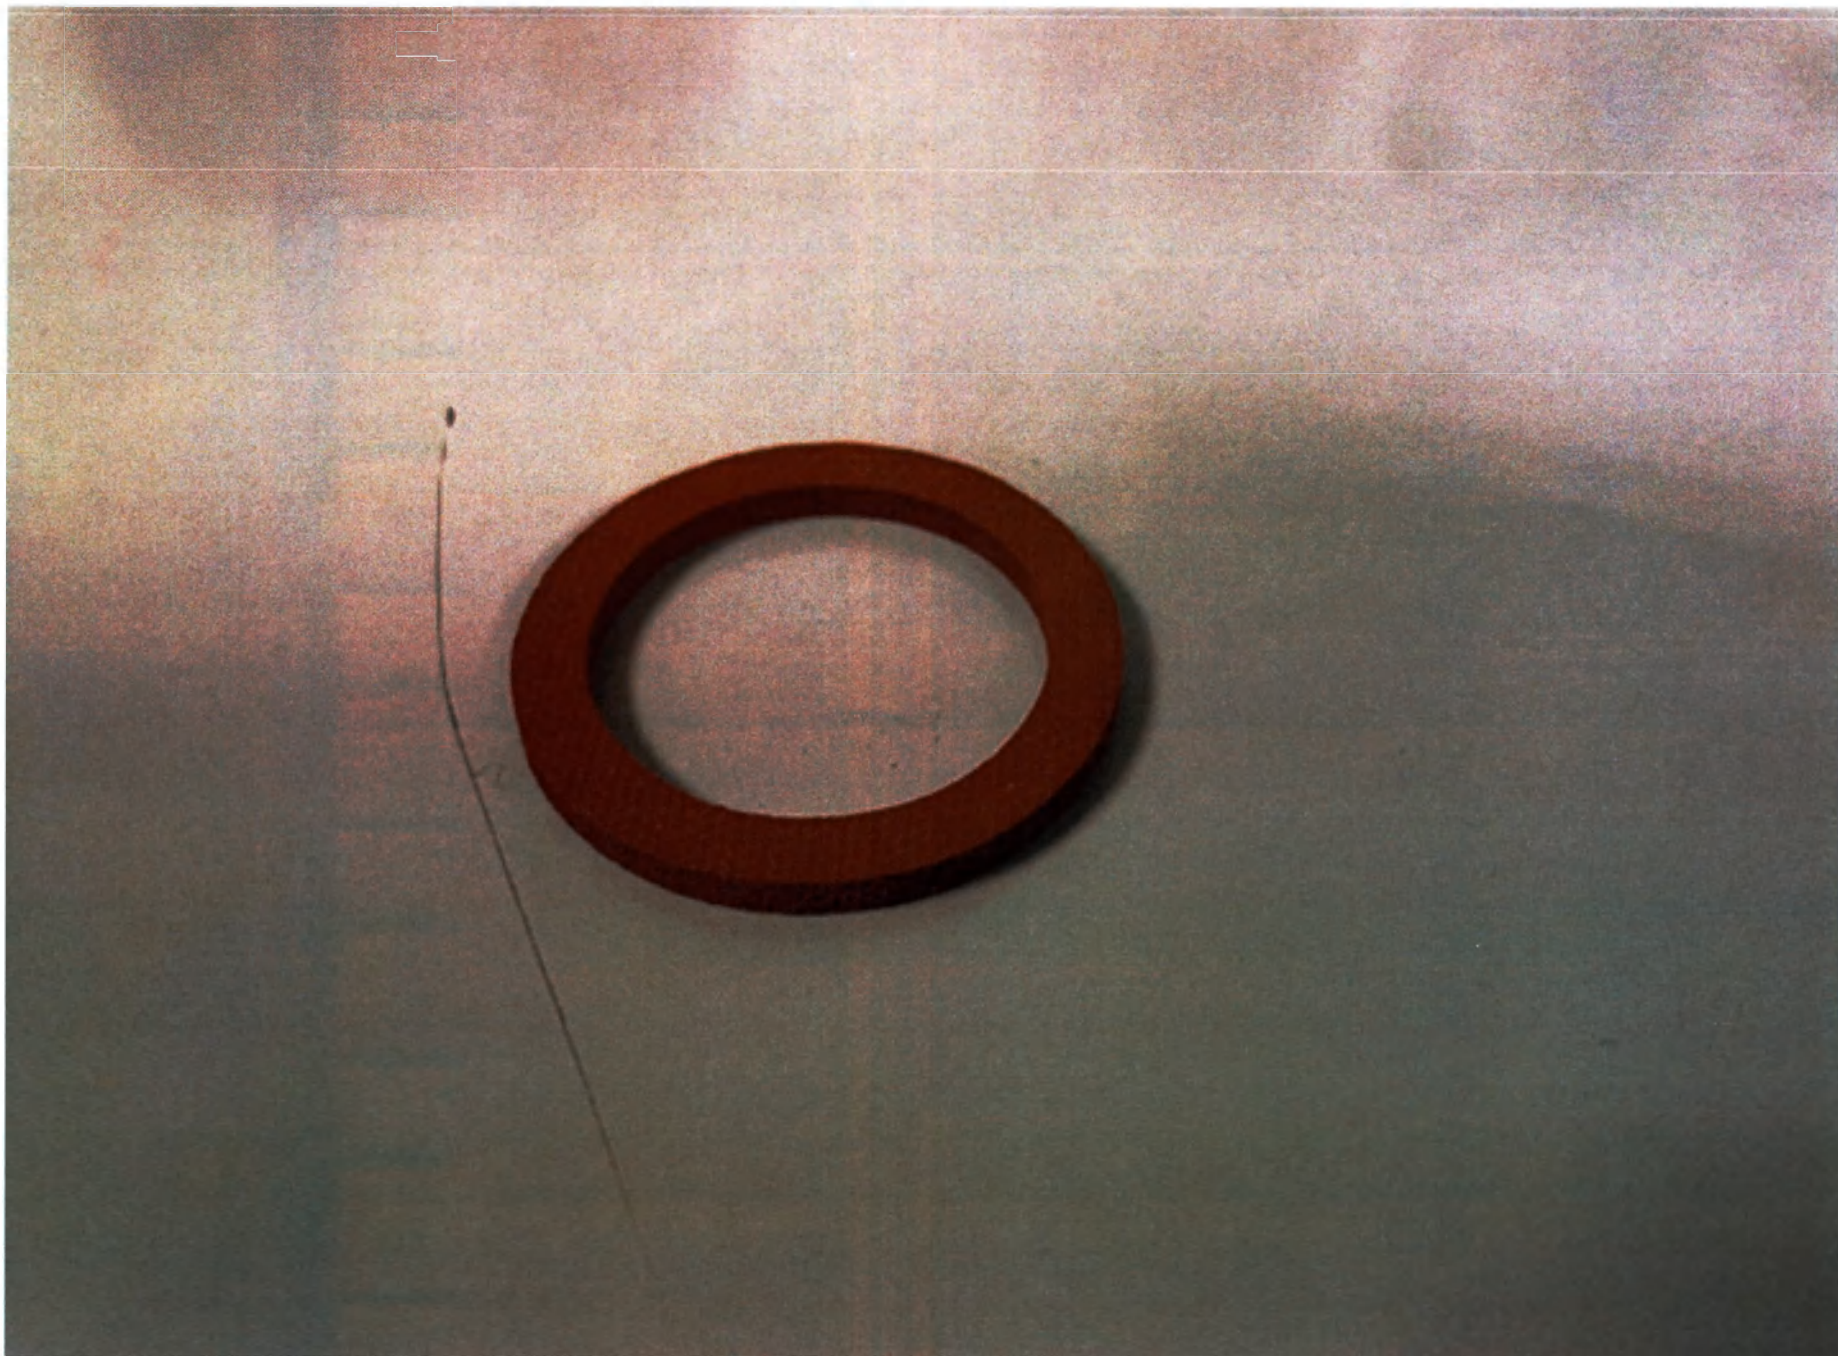


Рисунок 91. О-образные кольца для дозатора

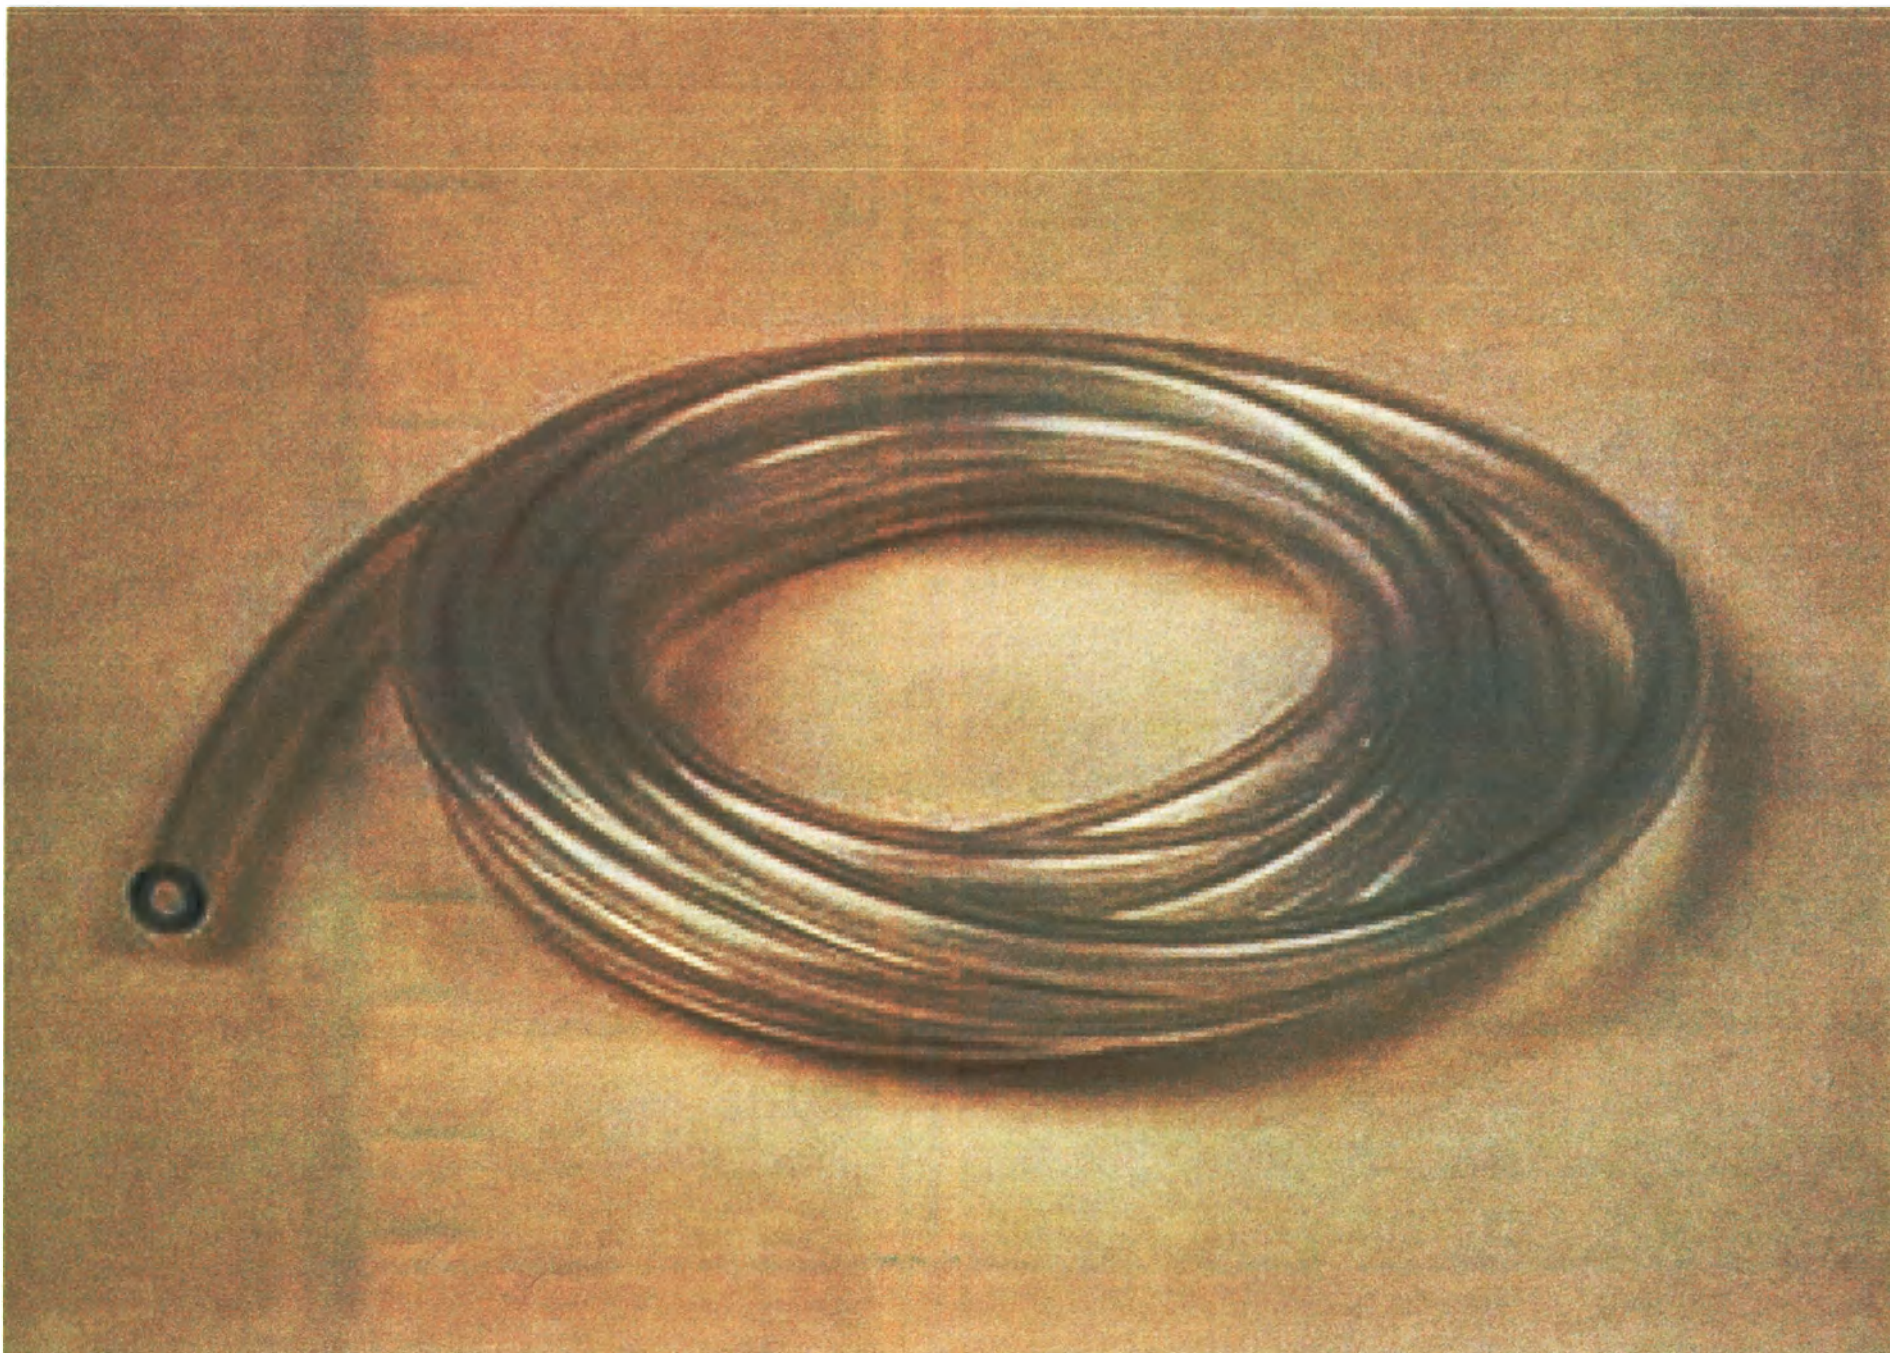


Рисунок 92. Трубка слива жидких отходов

Анализатор иммунохемилюминесцентный Immulite One

Регистрационное удостоверение:

№ ФСЗ 2007/00551 от 14.07.2022

ТОЛЬКО ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ IN VITRO

Производитель, дата производства, серийный номер и др. символы указаны на оригинальной маркировке изделия

110/120/220/240 В

50/60 Гц

700/800 Вт

Уполномоченный представитель производителя на территории Российской Федерации:

ООО «Сименс Здравоохранение», 115093, Россия, г. Москва, ул. Дубининская, д. 96

Тел.: 8(800) 550 50 22

Рисунок 93. Макет маркировки для Российской Федерации, который будет наноситься на Блок Анализатора иммунохемилюминесцентного Immulite One.


Анализатор иммунохемилюминесцентный Immulite 1000



Рисунок 94. Блок Анализатора иммунохемилюминесцентного immulite 1000



Рисунок 95. Лазерный сканер штрих-кодов и кабель к нему

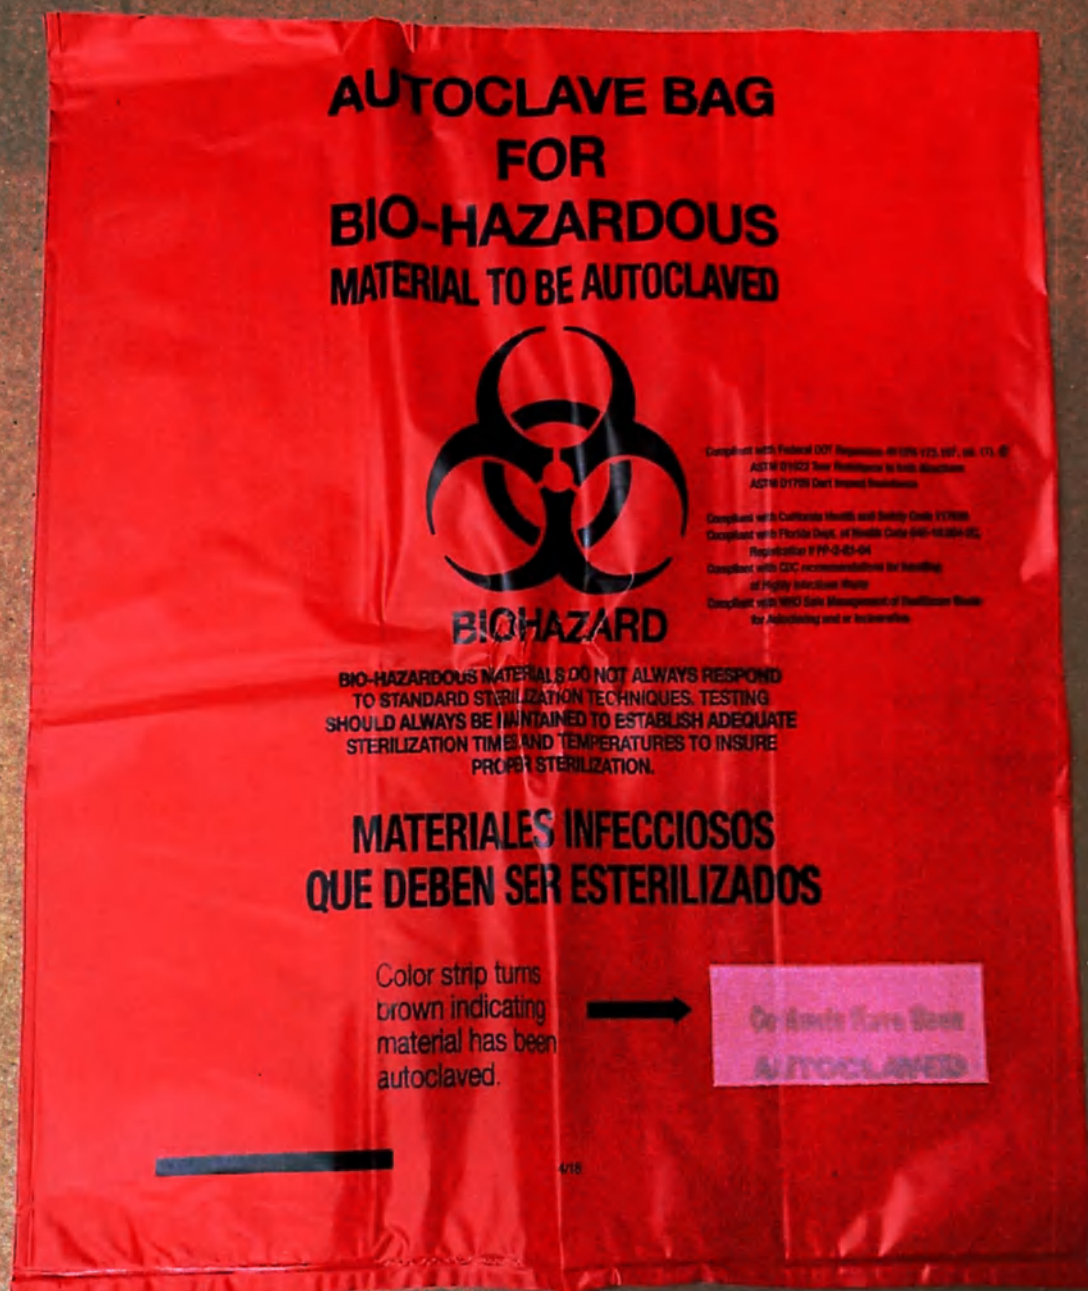

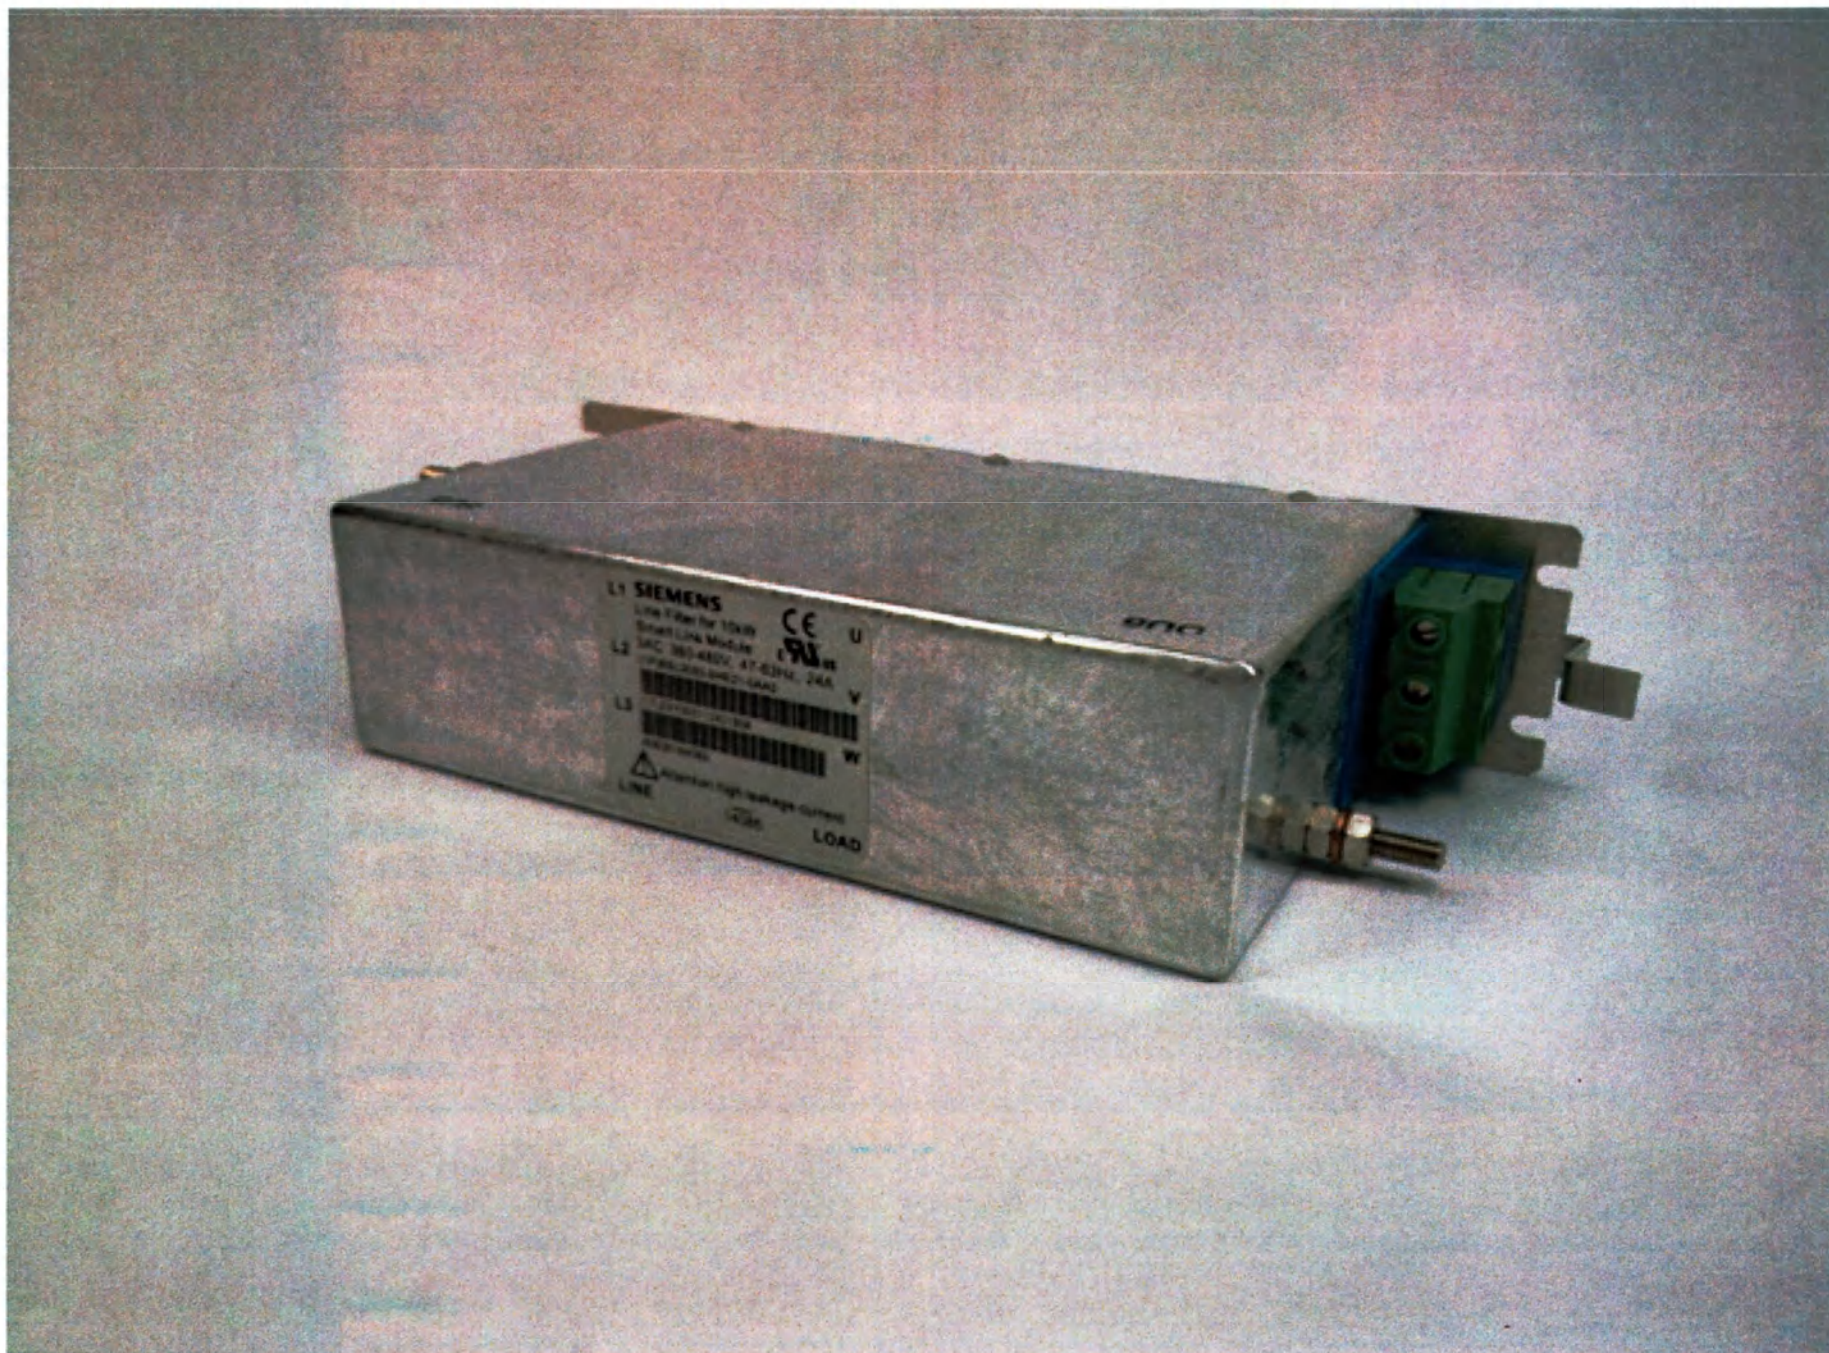


Рисунок 97. Фильтр компьютера



Рисунок 98. Бутыл для воды (2 л)

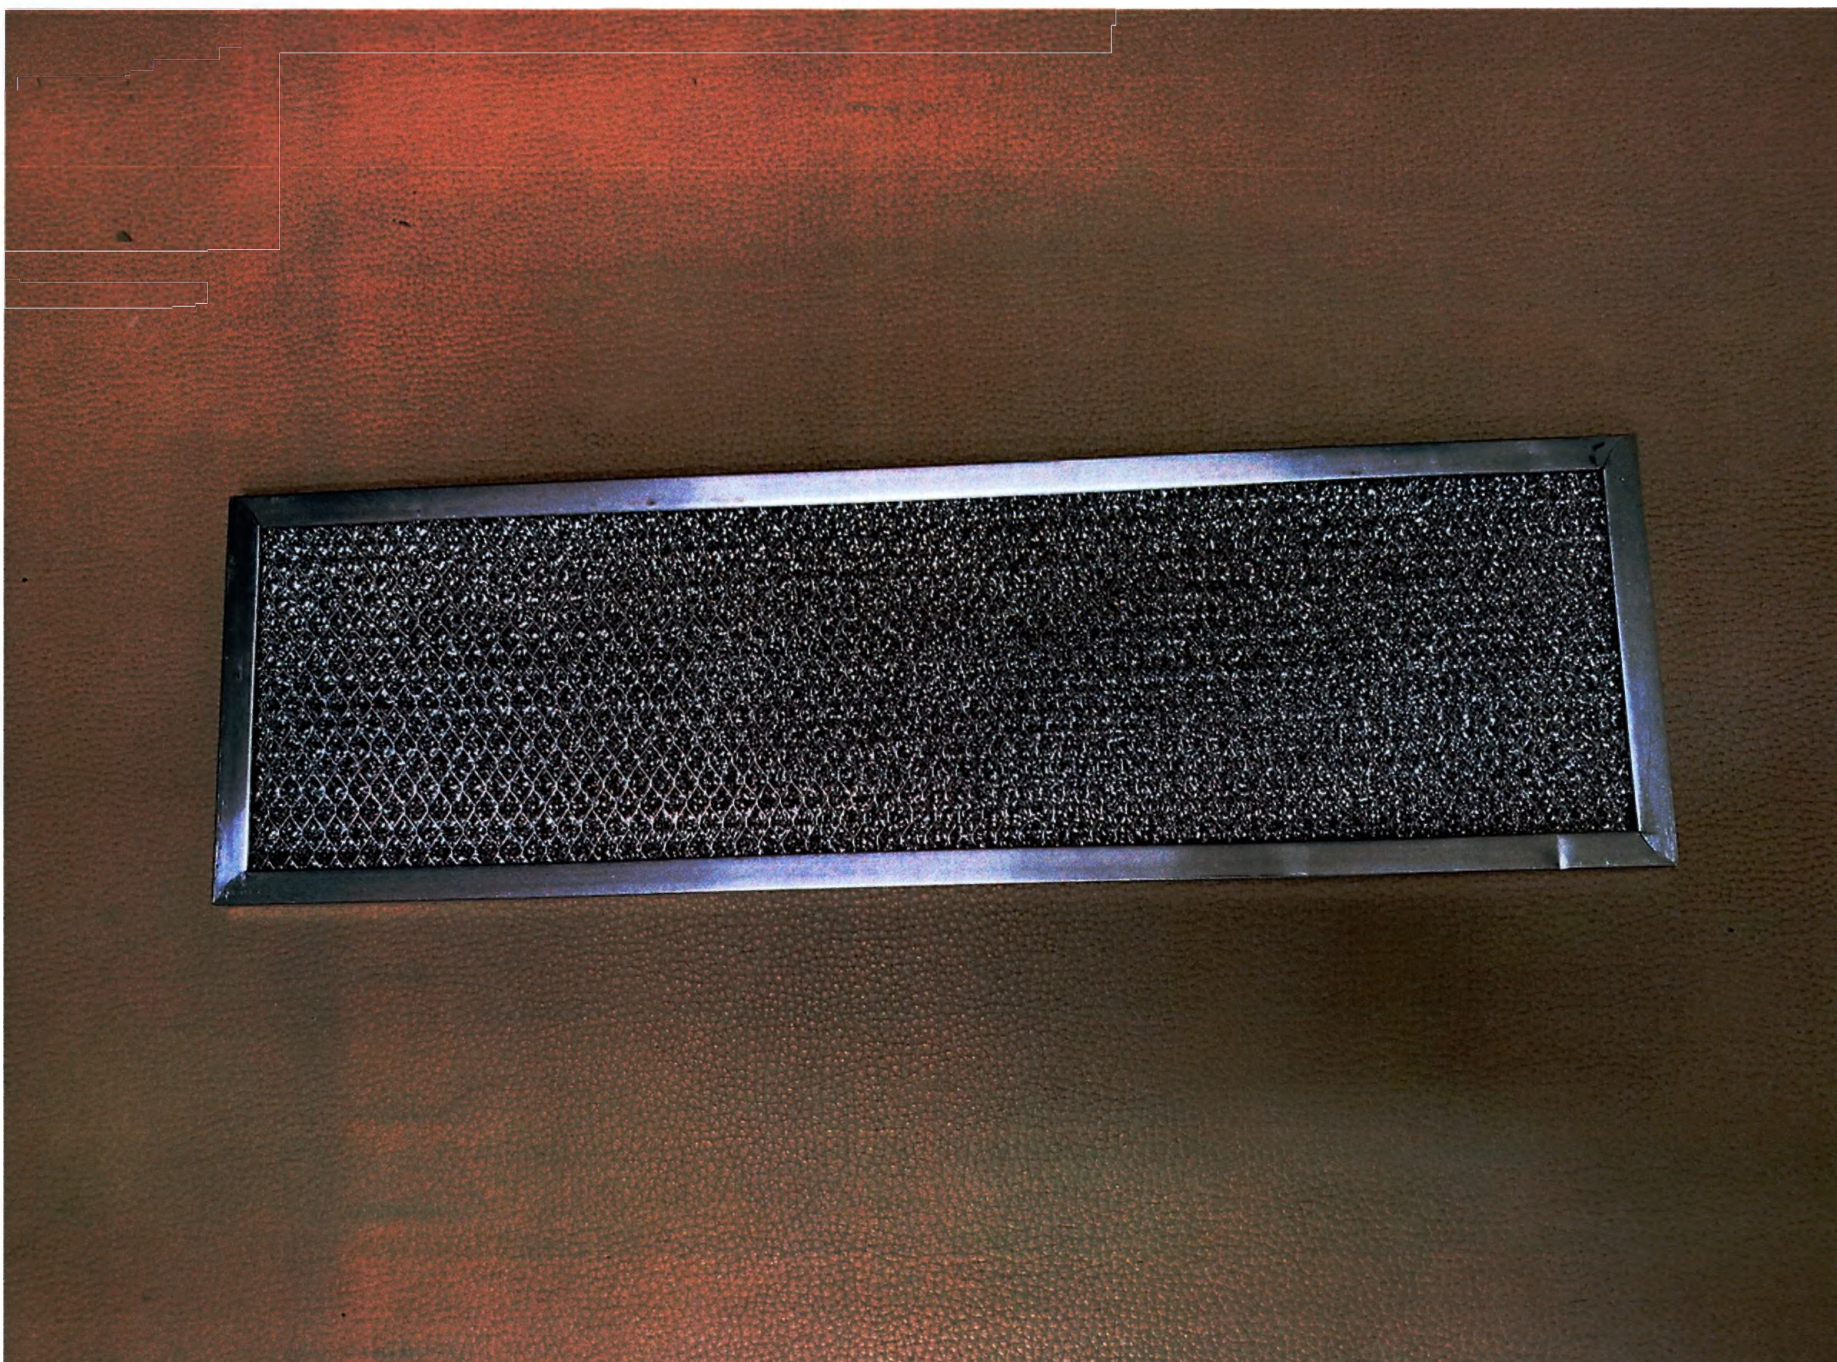


Рисунок 99. Фильтр вентилятора

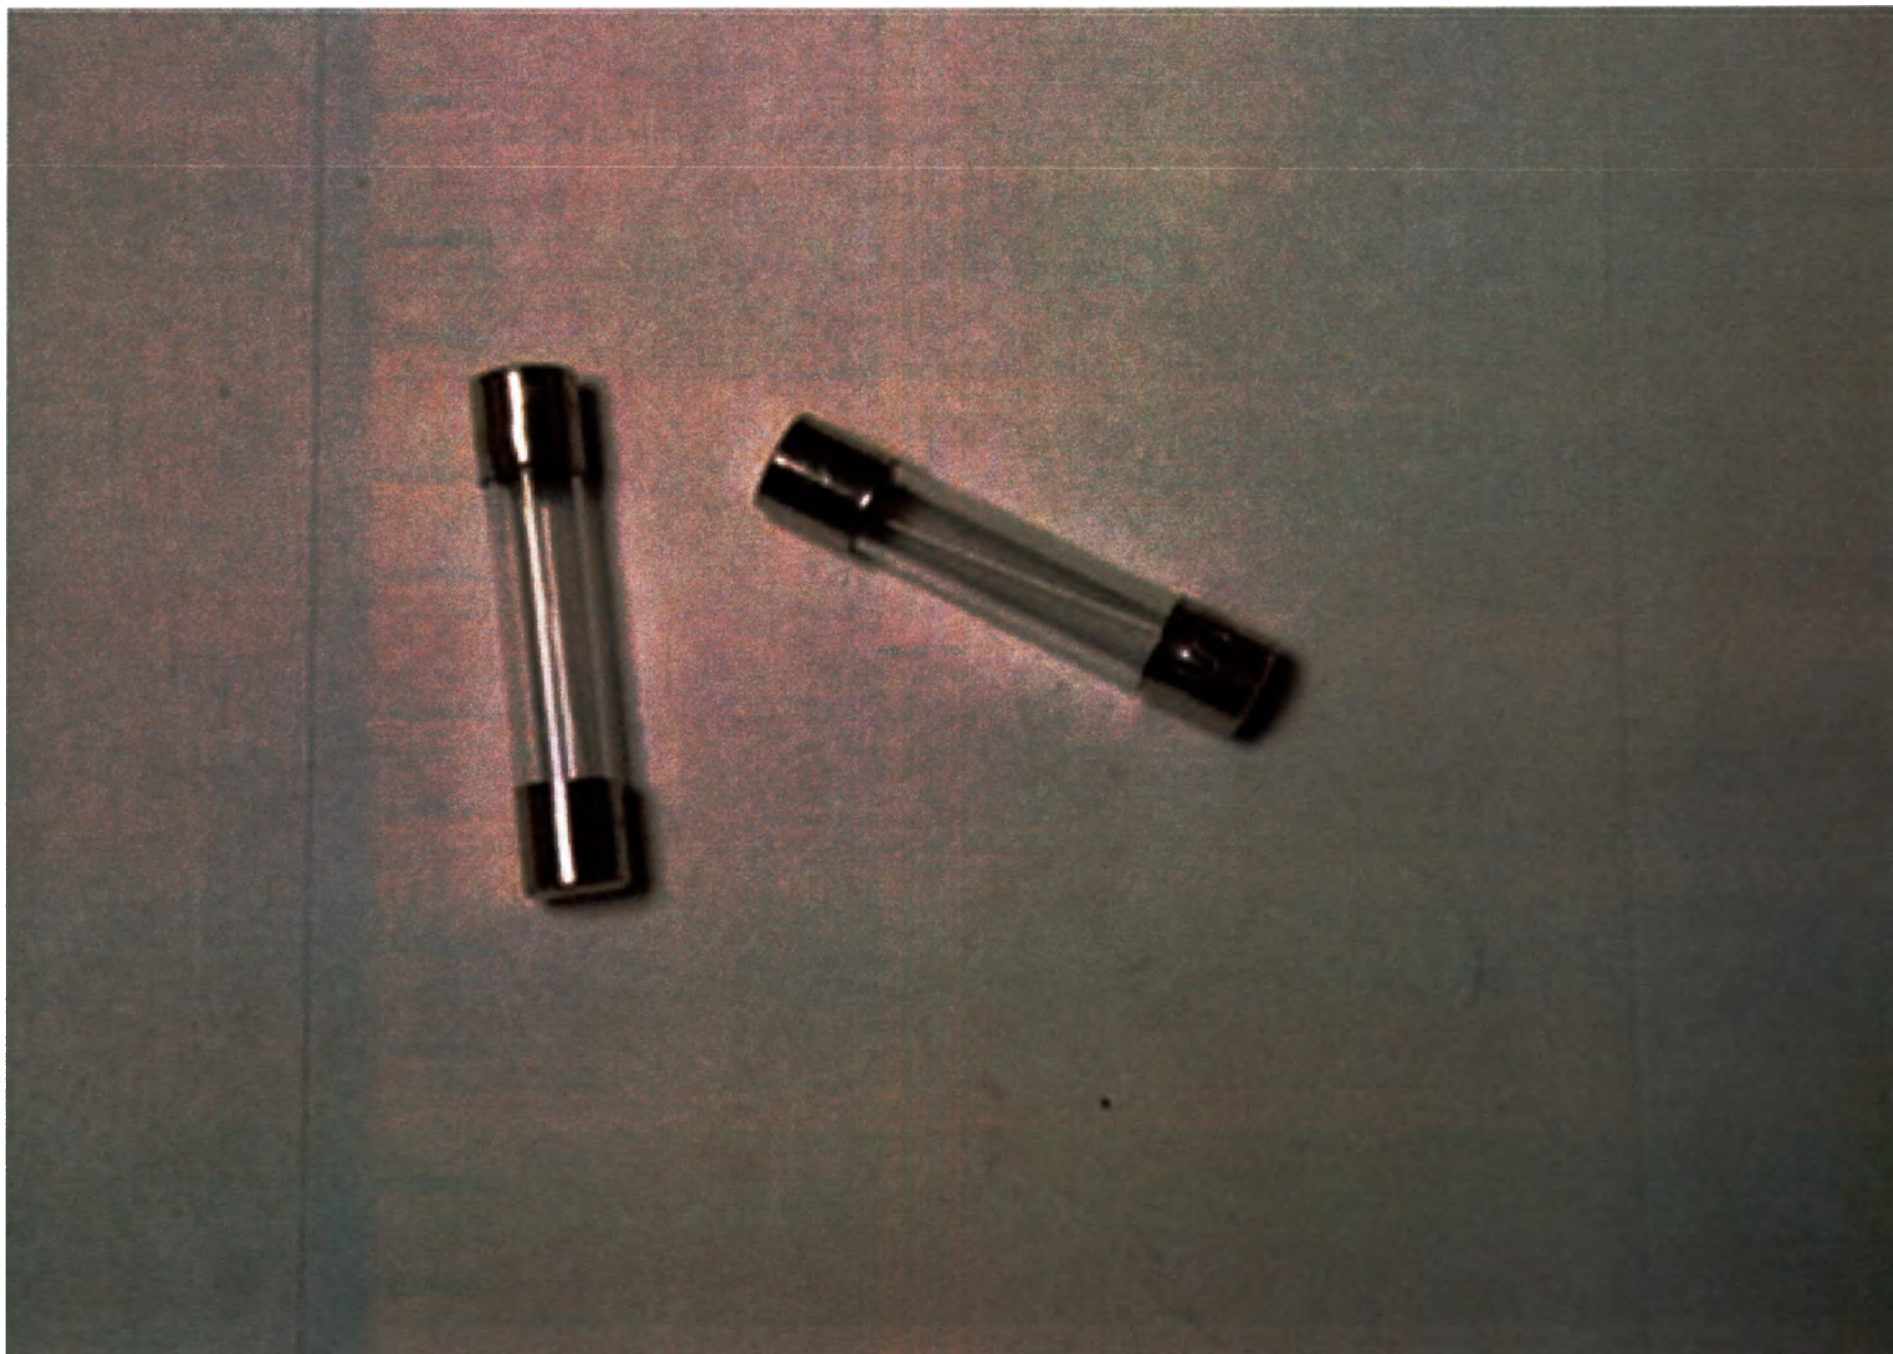



Рисунок 100. Предохранители



Рисунок 101. Кабель для заземления кронштейна и стойки подставки

SIEMENS

IMMULITE® 1000
Immunoassay System

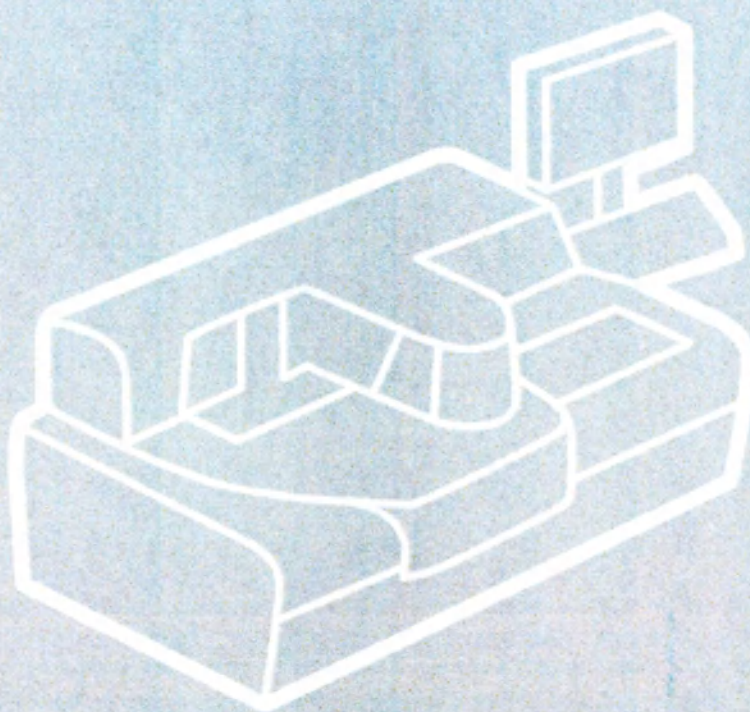

IMMULITE® 1000 Immunoassay System

Руководство пользователя

REF 11154071 Rev. 02, 2021-01



Рисунок 102. Руководство по эксплуатации



Рисунок 103. Набор дисков с программным обеспечением



Рисунок 104. Клавиатура с кабелем



Рисунок 105. Бутыл для жидких отходов 2л



Рисунок 106. Г-образные переходники (12 и 14 дюйма)

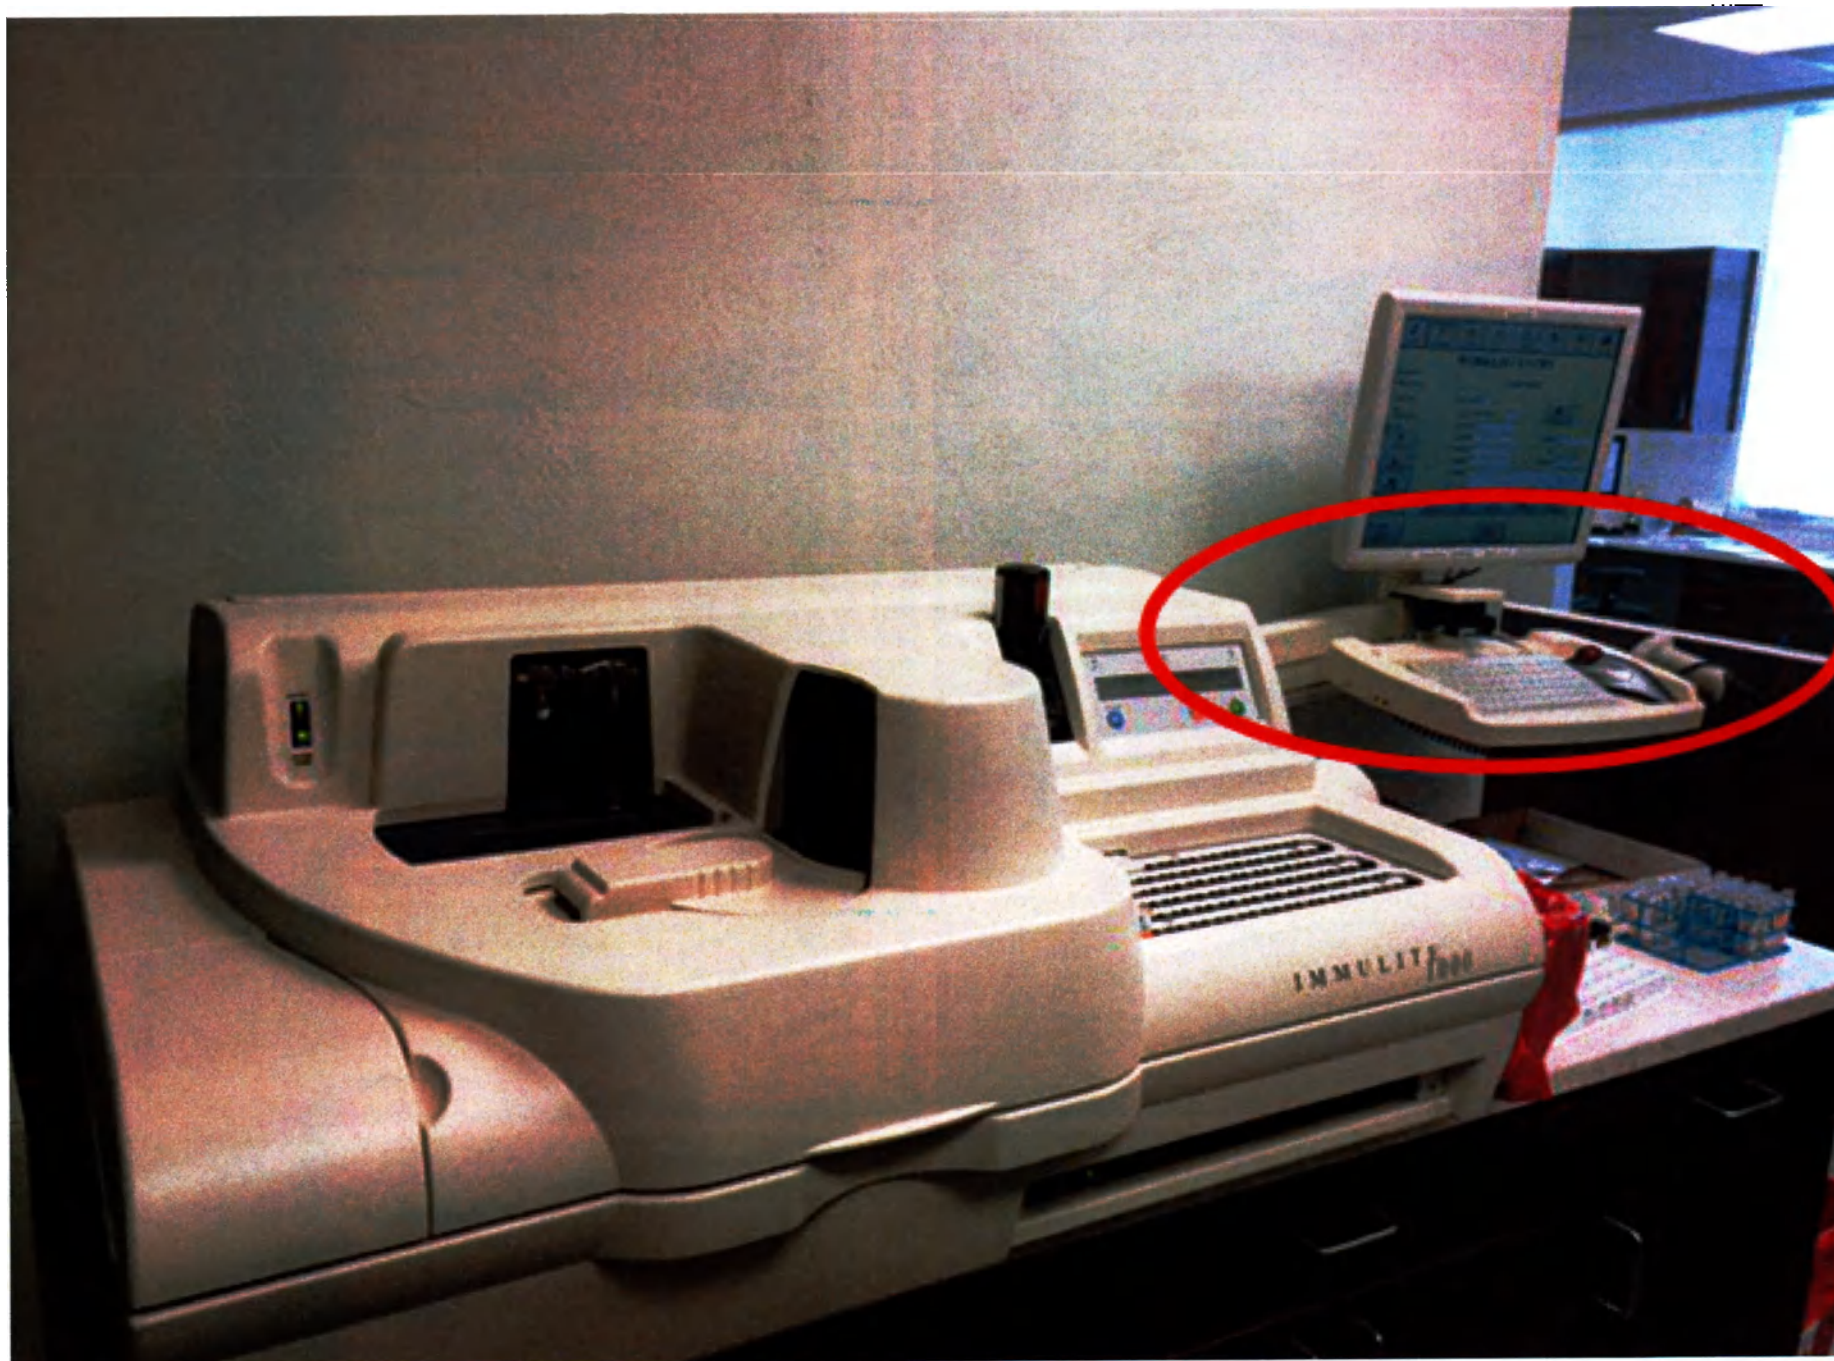


Рисунок 107. Кронштейн для монитора и стойка подставки под клавиатуру

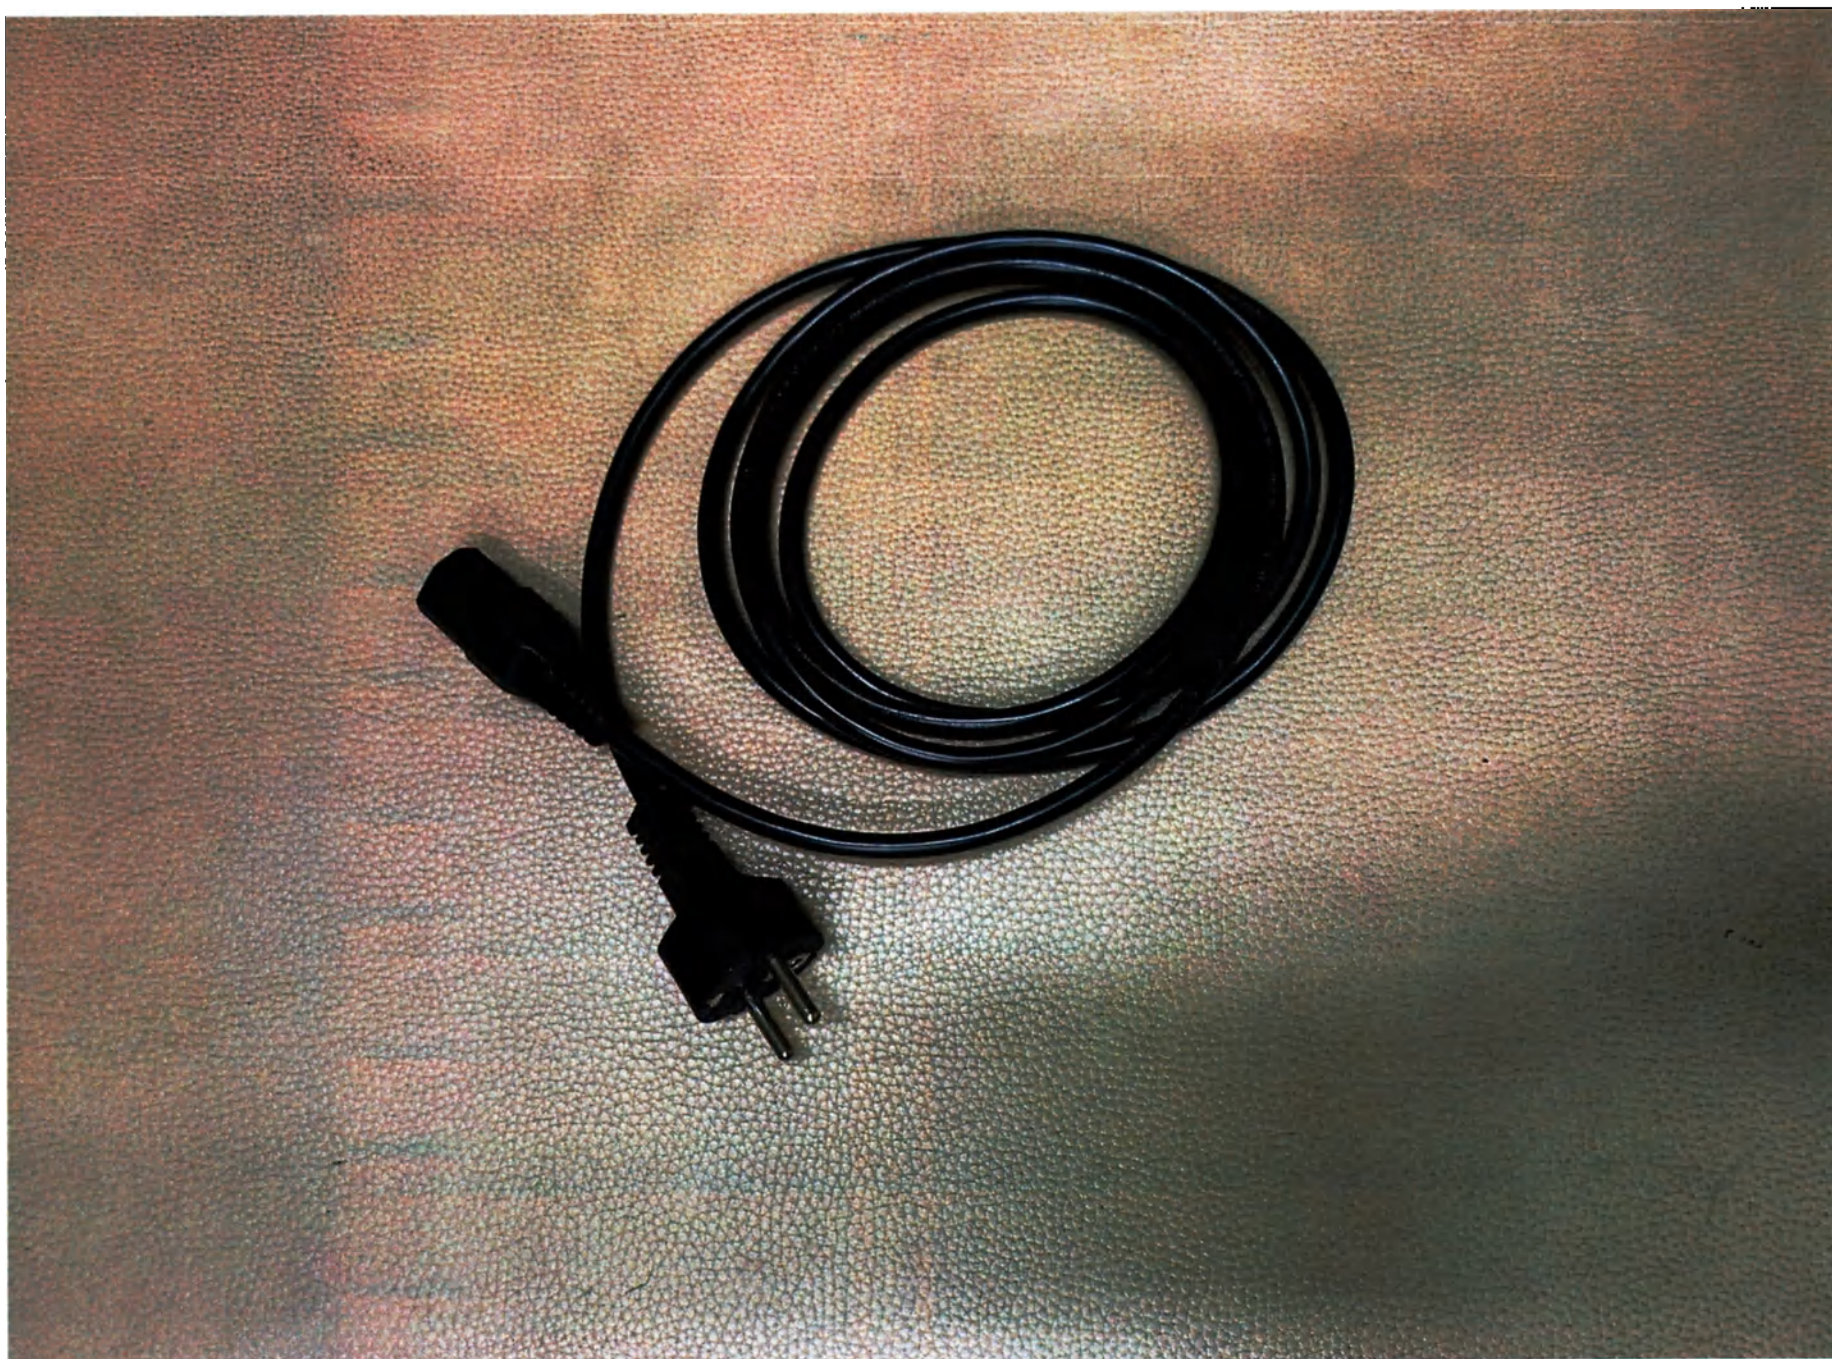


Рисунок 108. Кабели питания



Рисунок 109. Бумага для принтера



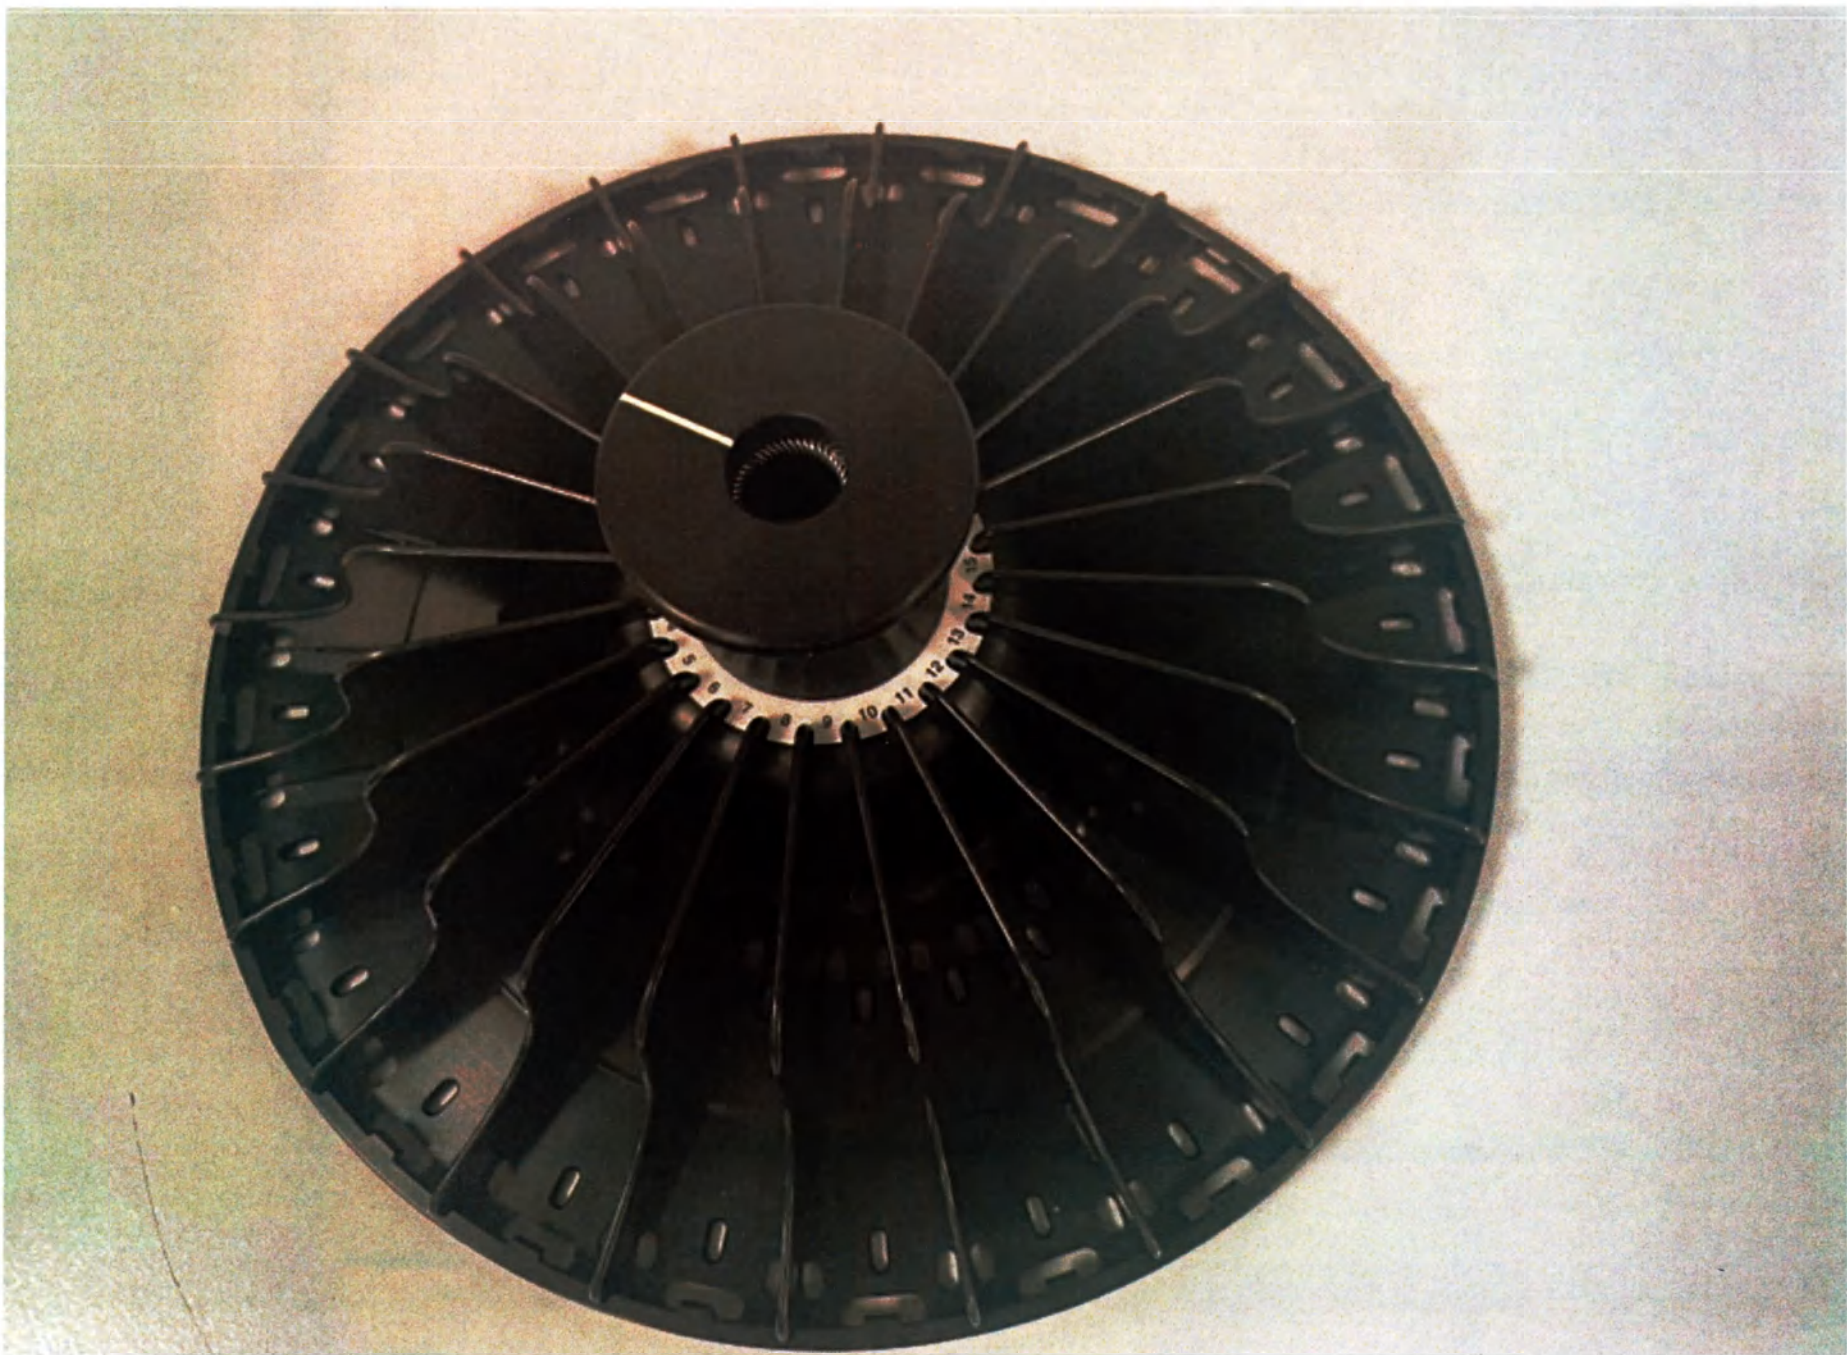


Рисунок 111. Карусель для реактивов

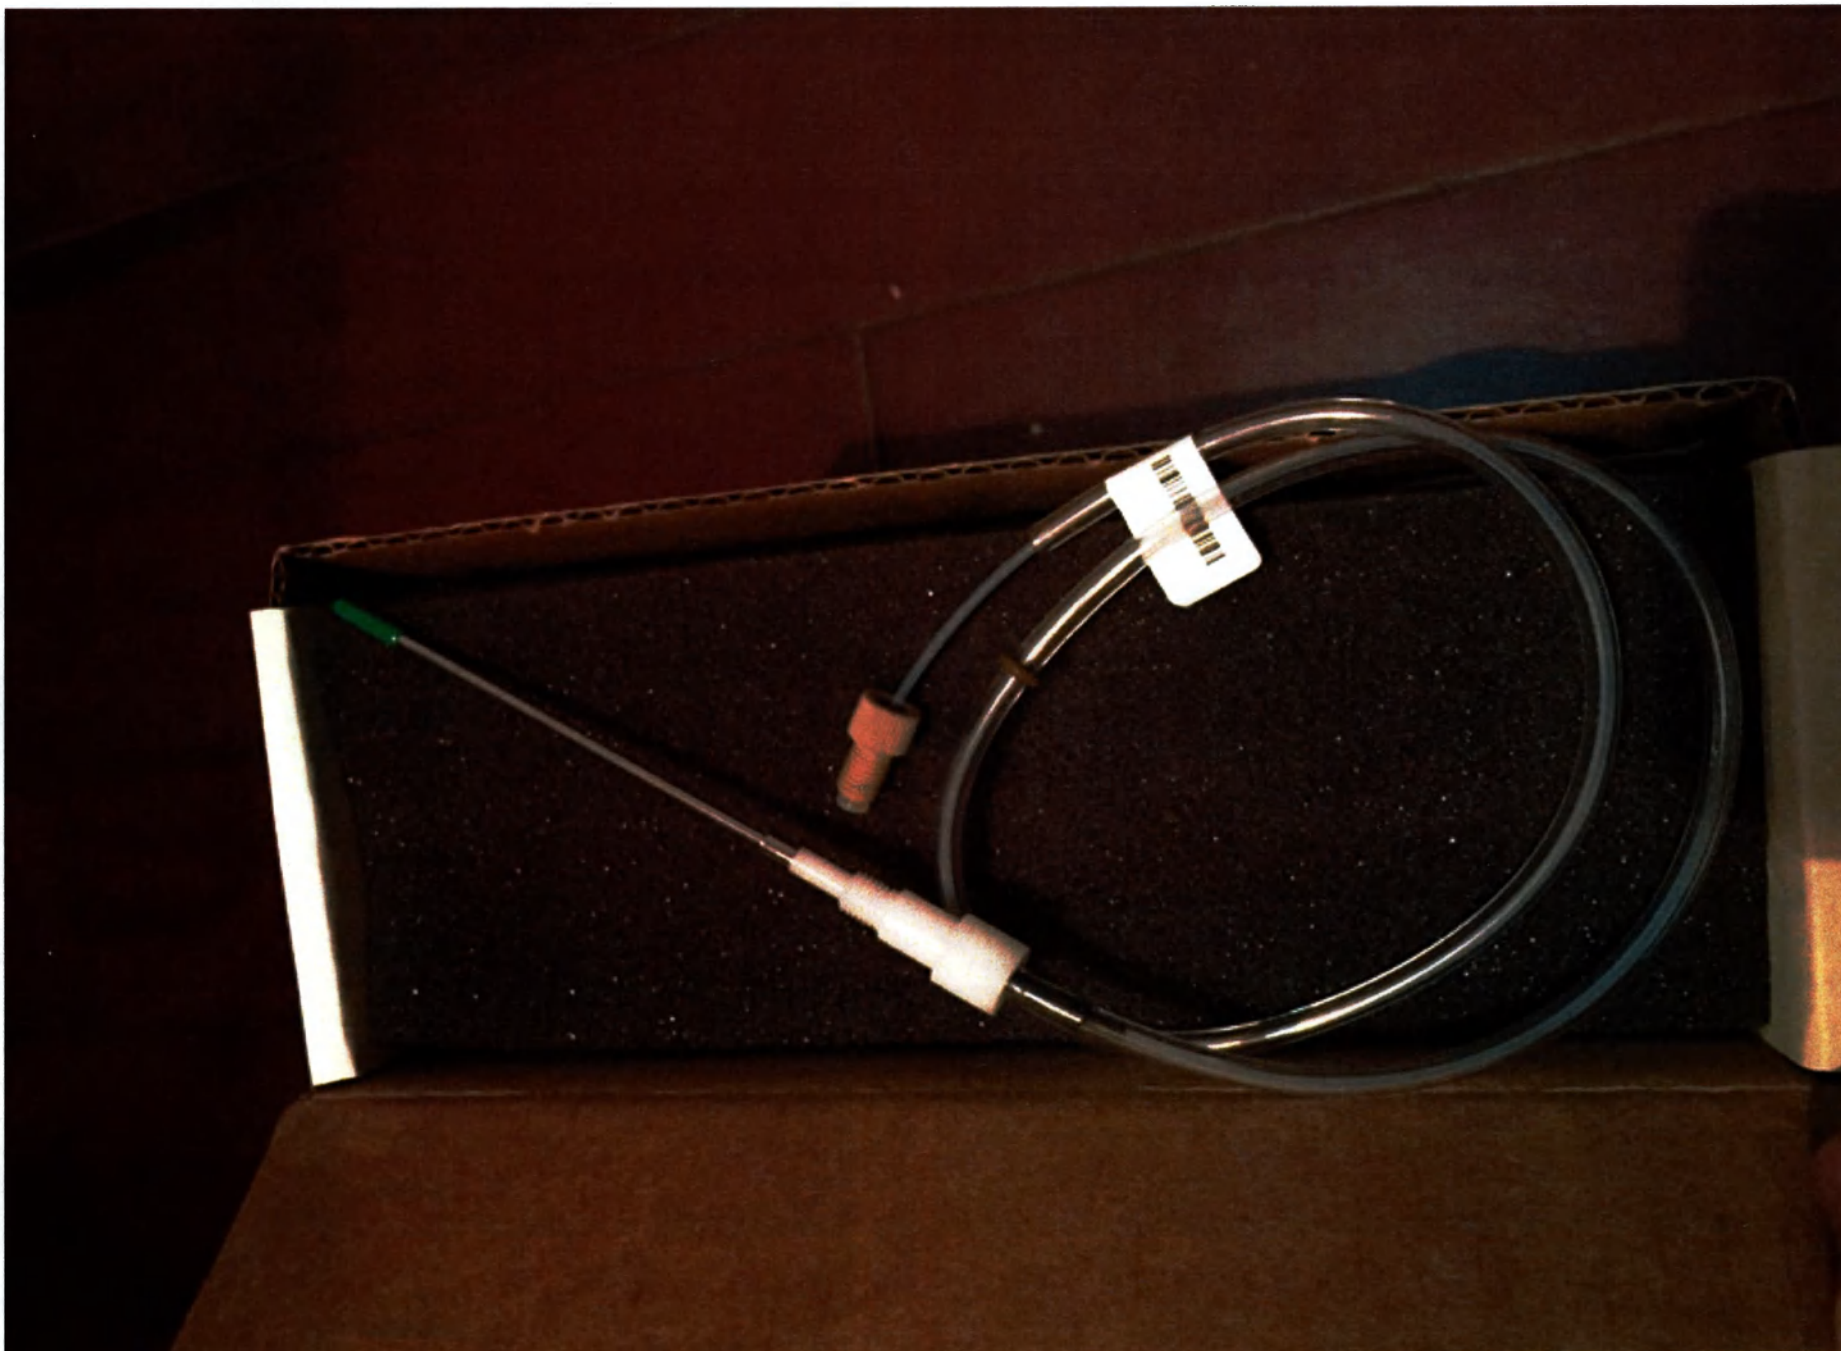


Рисунок 112. Заменяемые наконечники дозатора

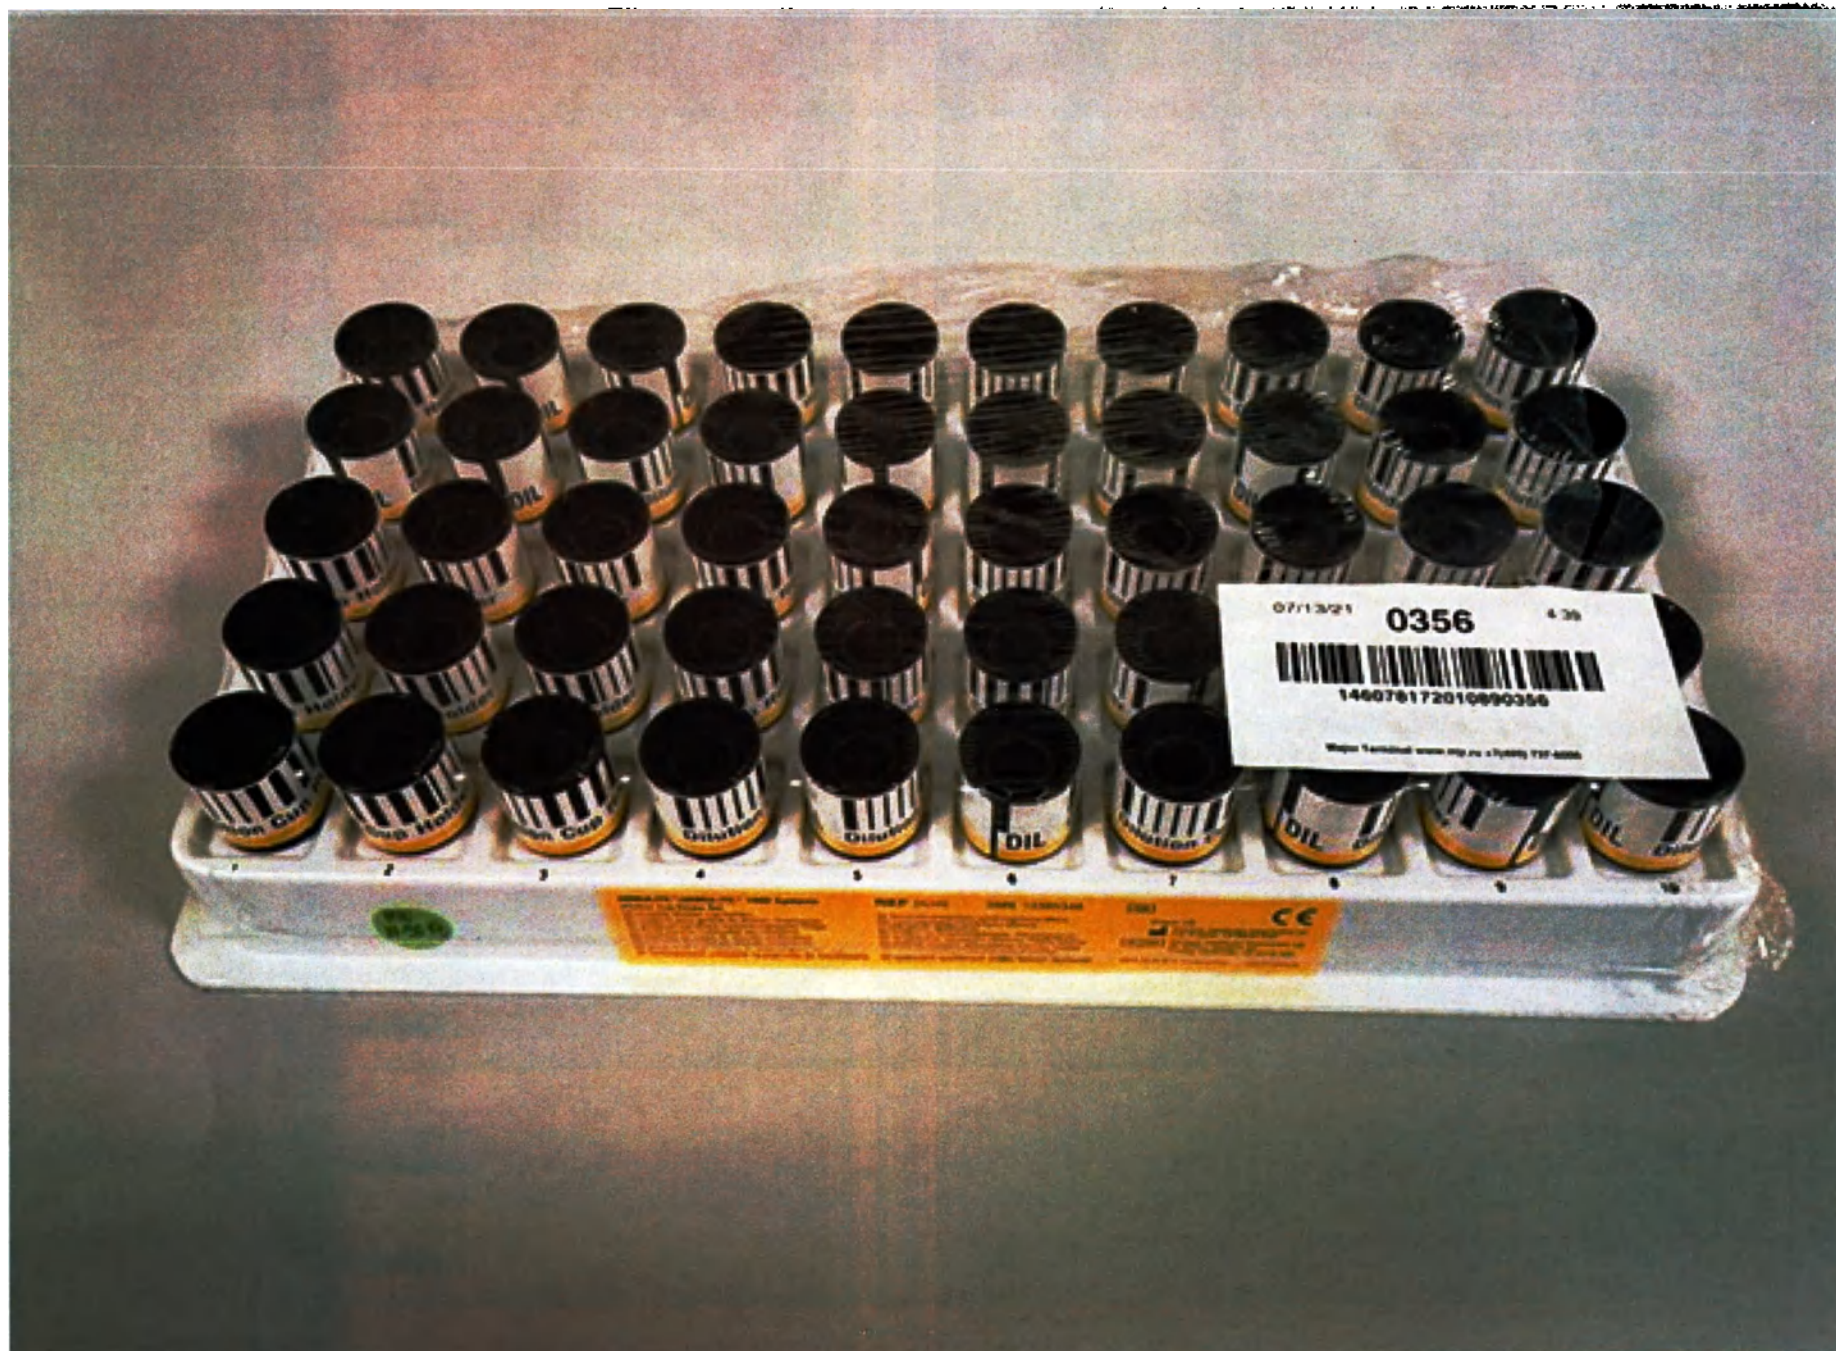


Рисунок 113. Подставки для пробирок с образцами



Рисунок 114. Пробирки для проб

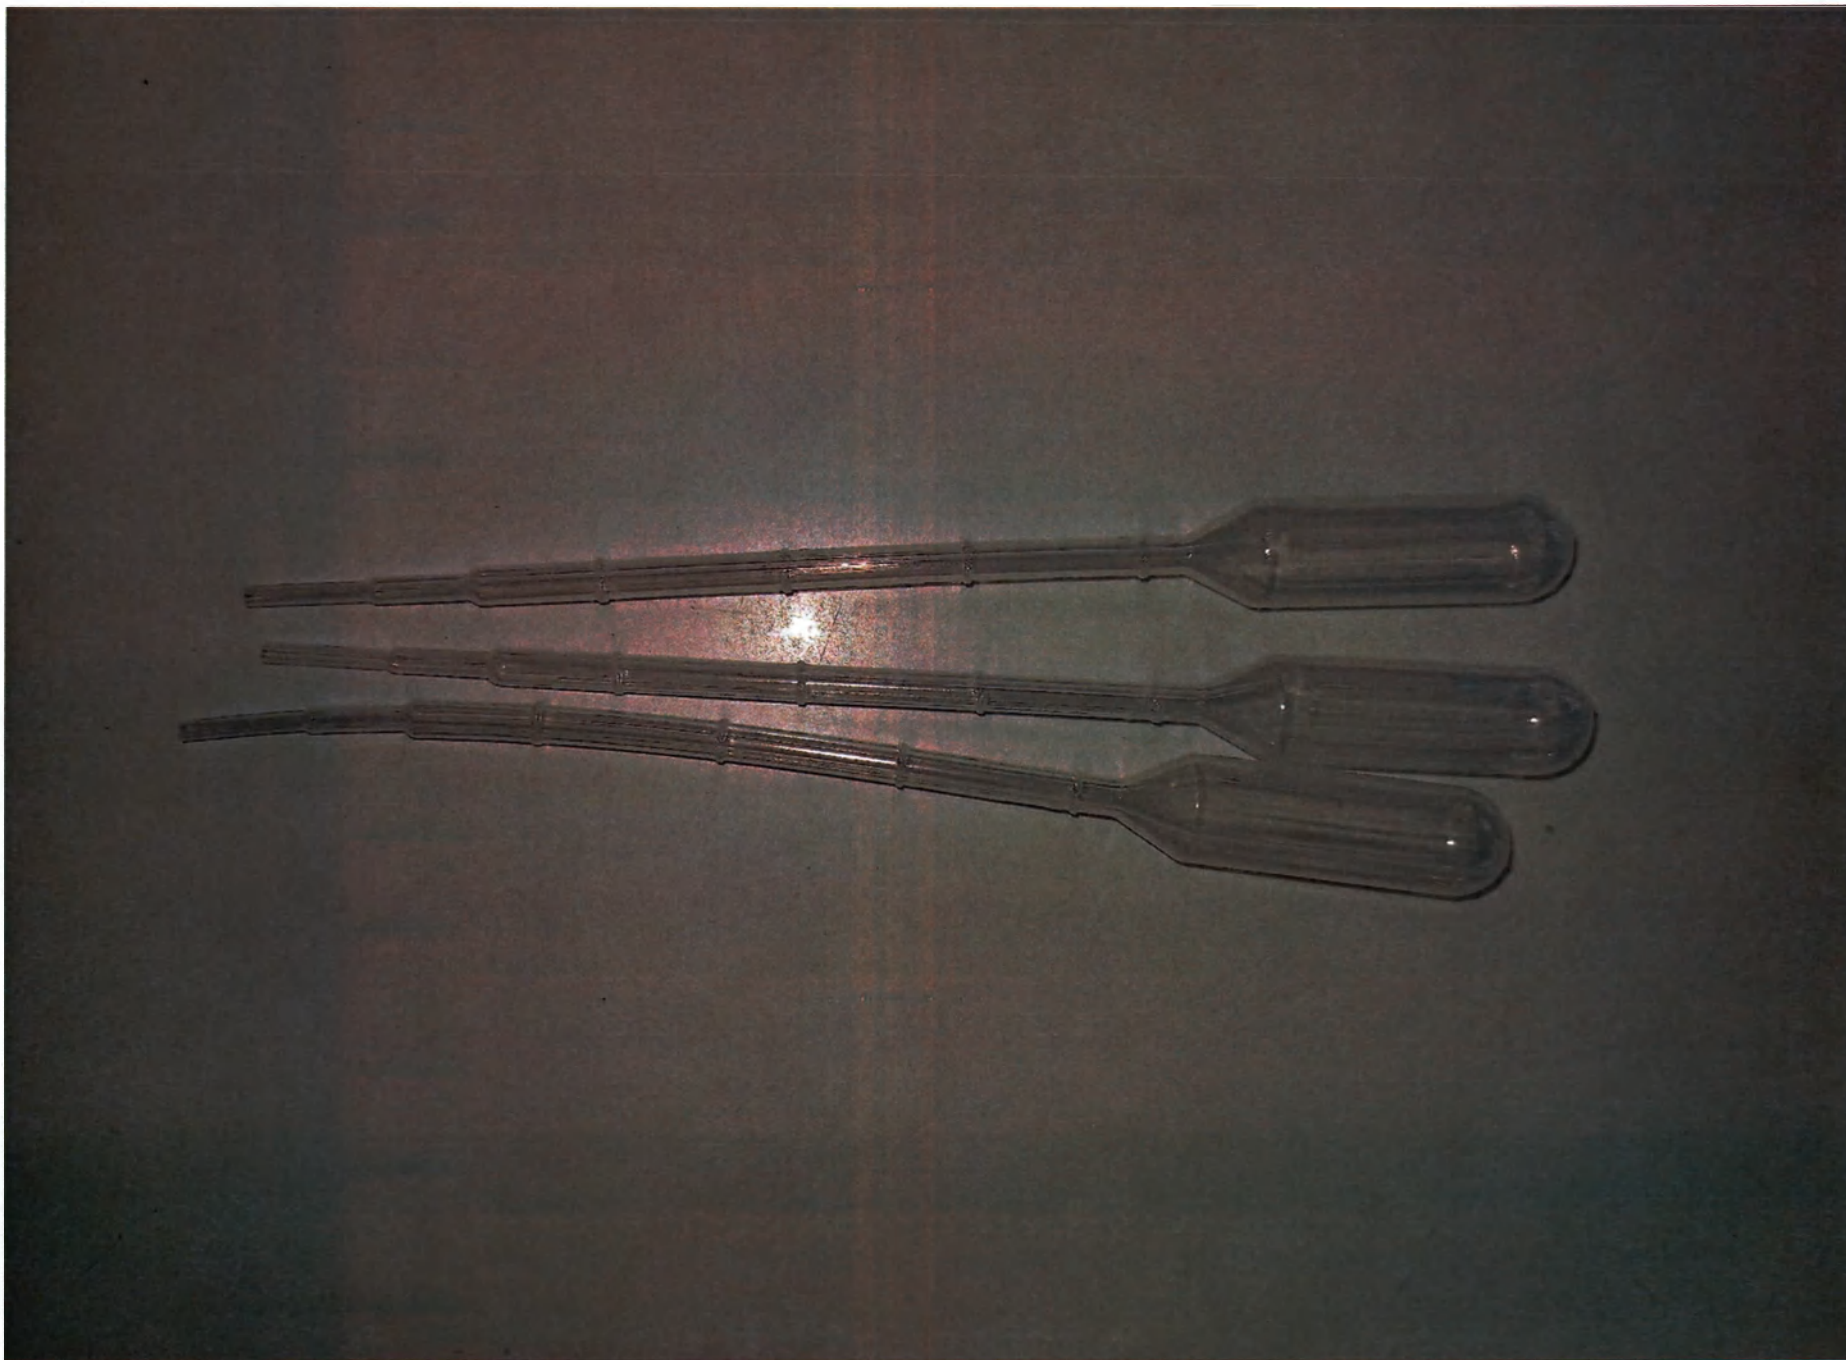


Рисунок 115. Пипетки для переноса проб

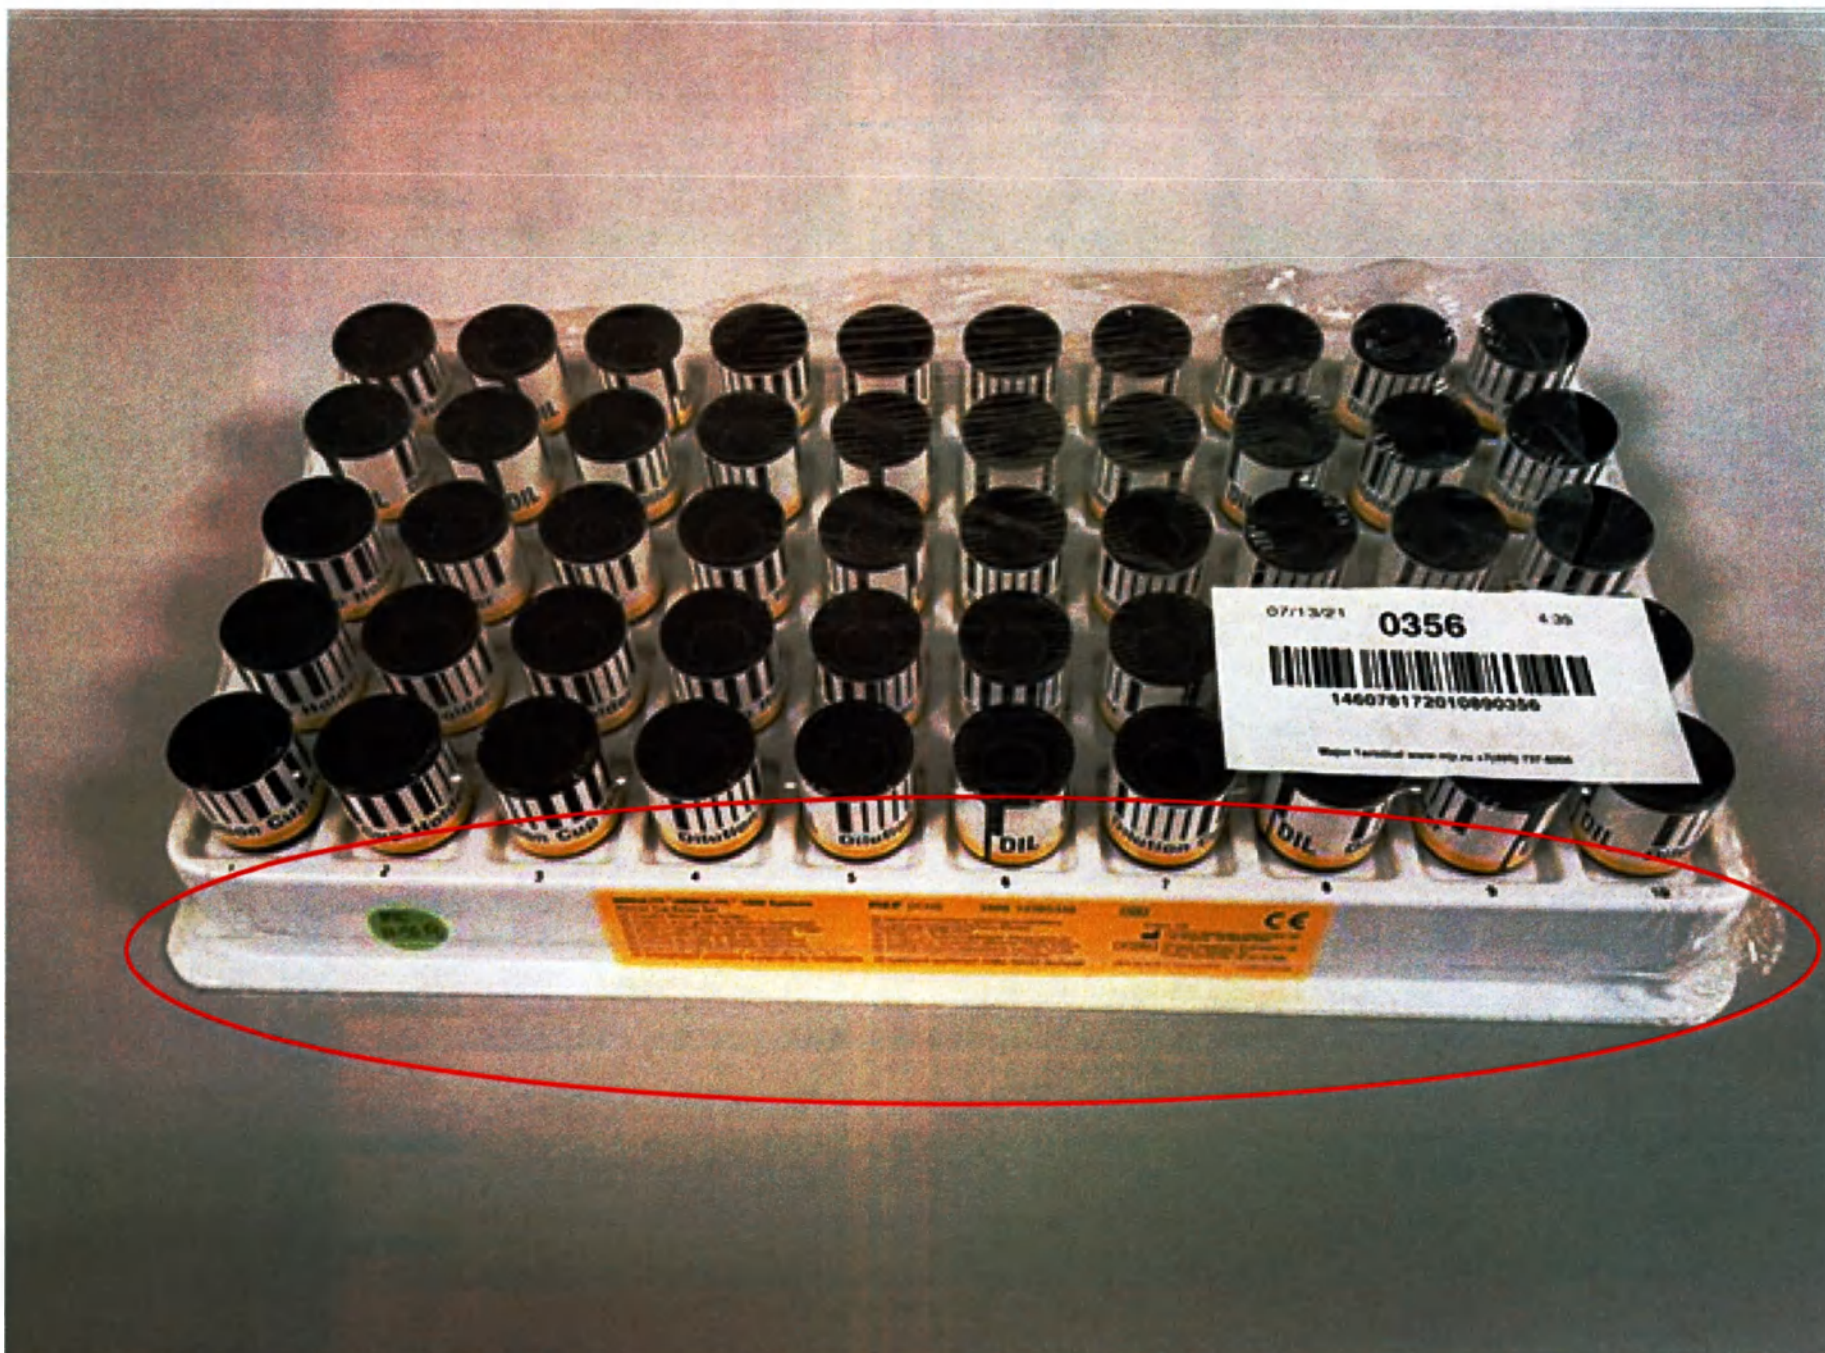


Рисунок 116. Штатив для переноса проб



Рисунок 117. Контейнер для твердых отходов

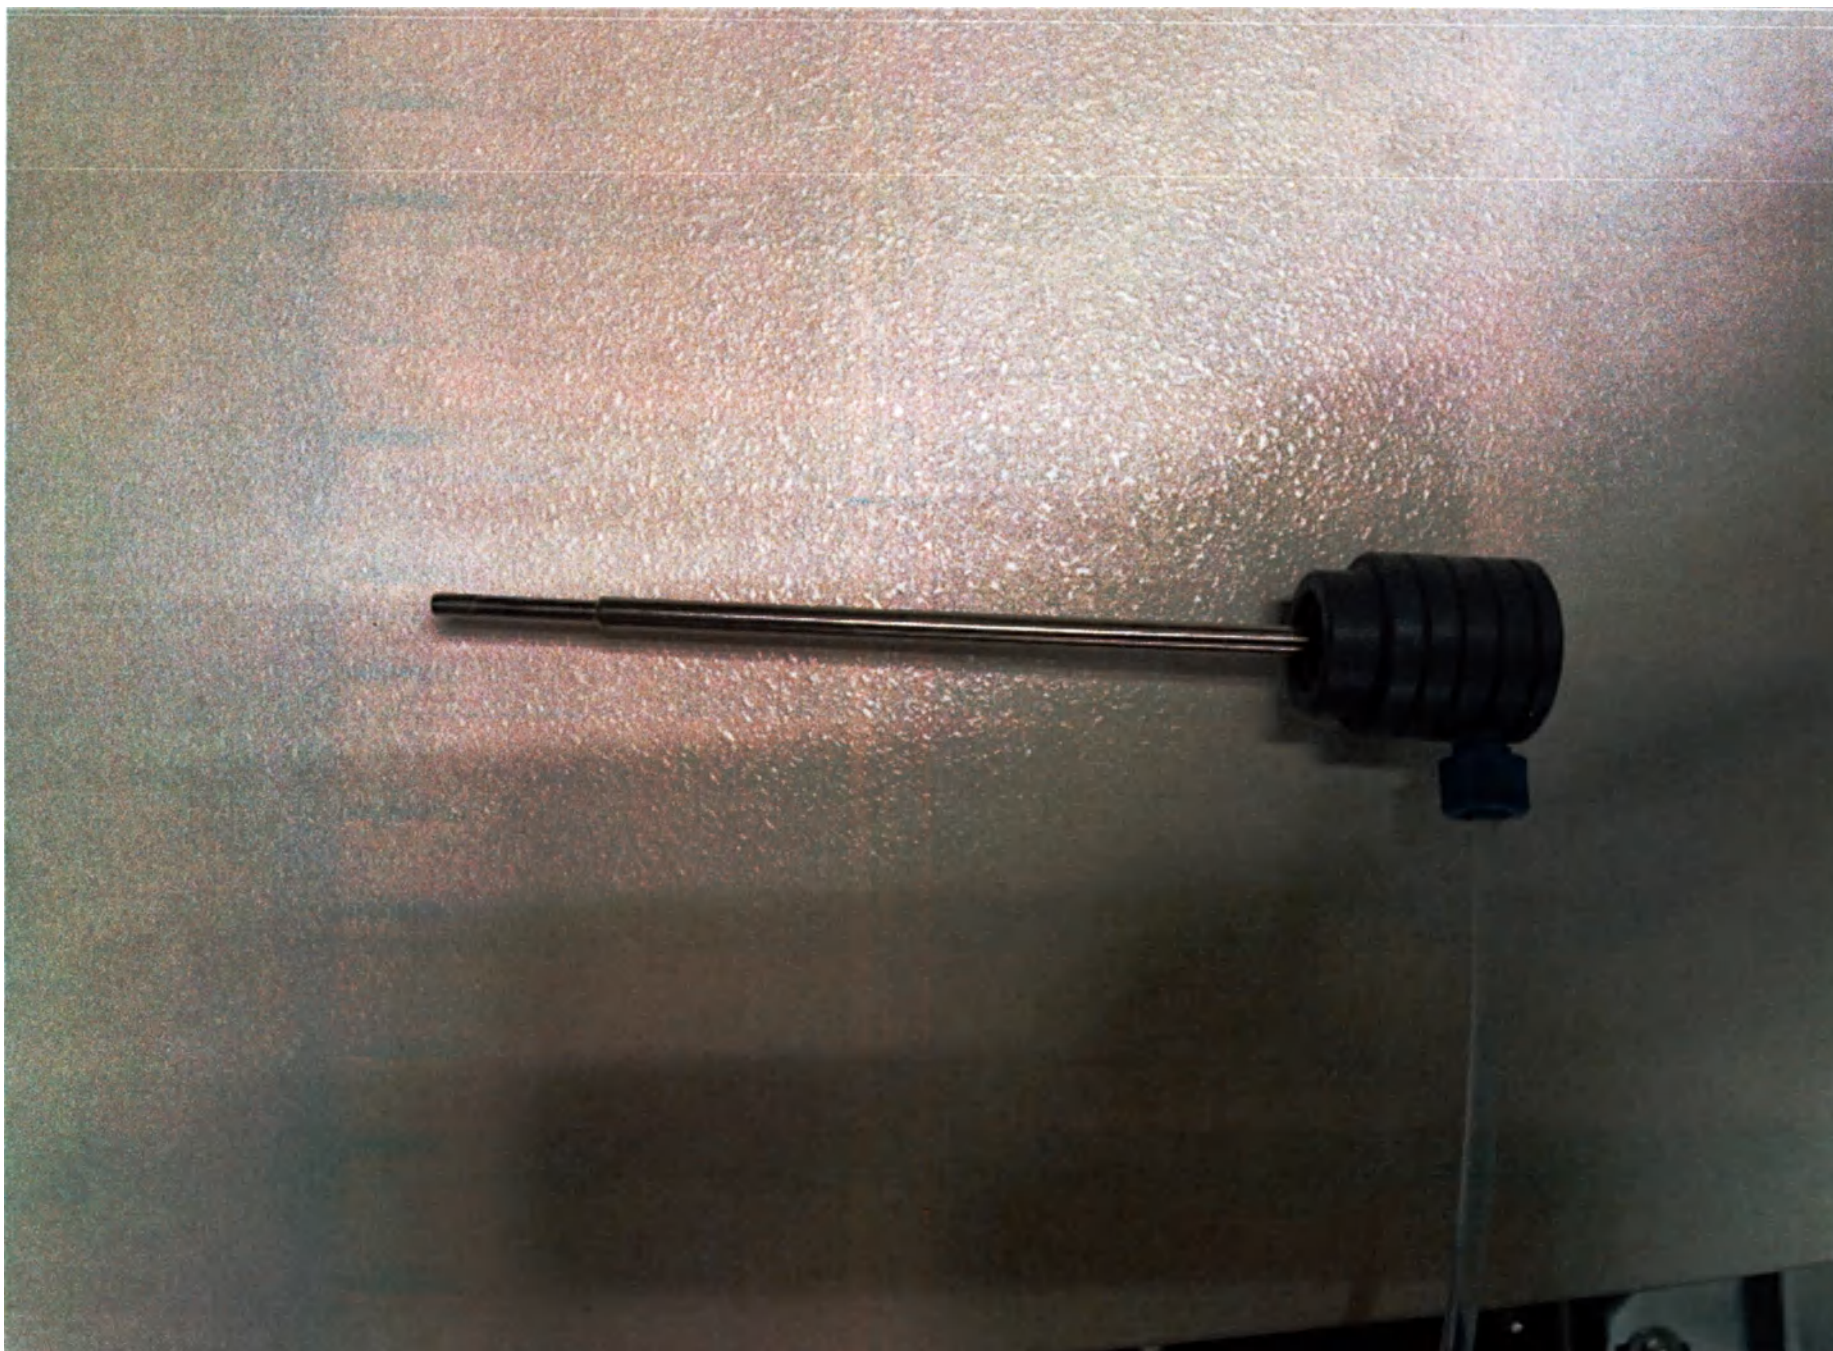


Рисунок 118. Игла заборника субстрата

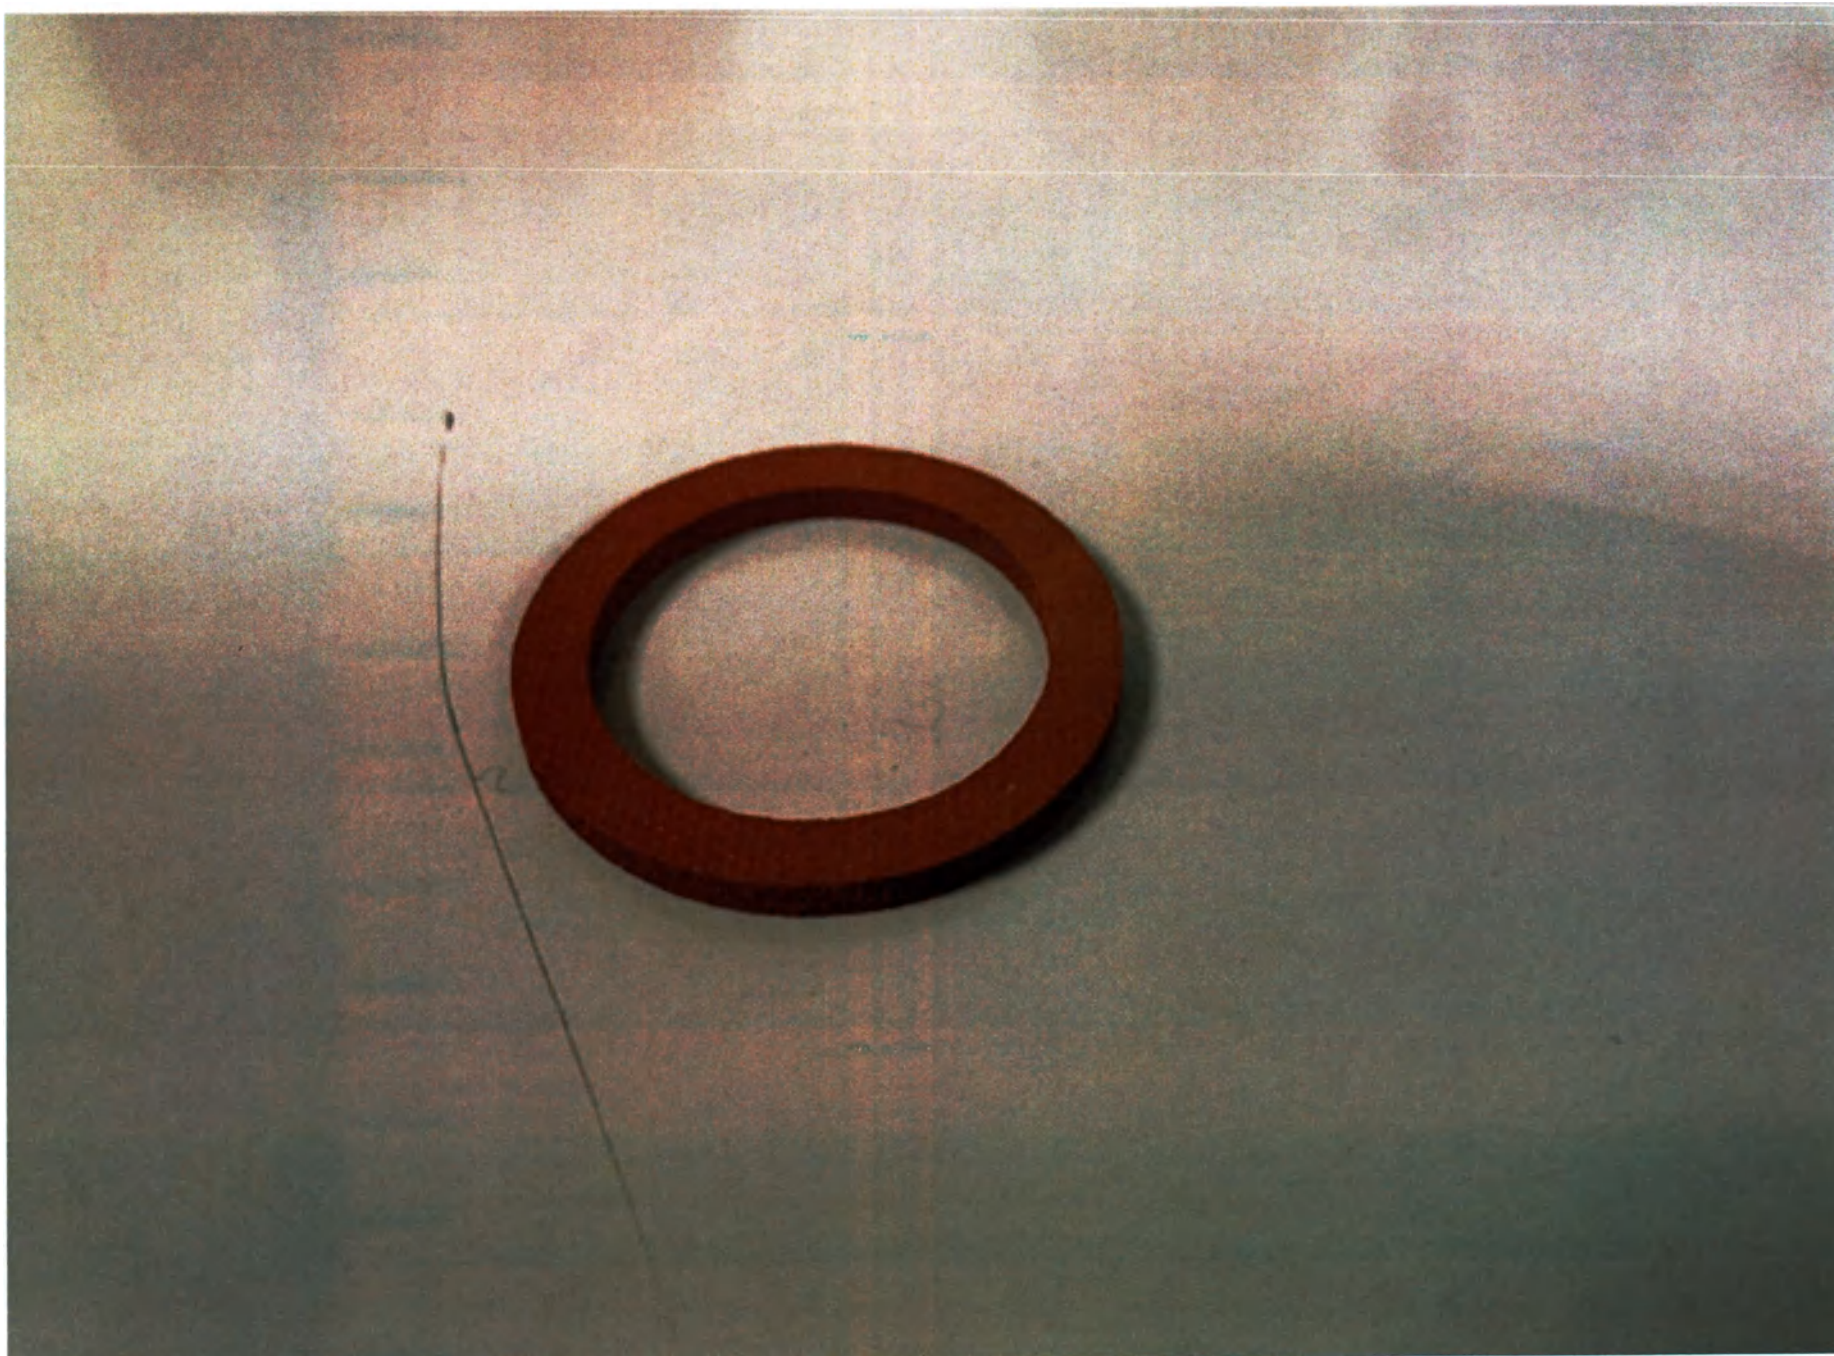


Рисунок 119. O-образные кольца для дозатора



Рисунок 120. Набор инструментов



Рисунок 121. Монитор с сенсорным экраном и 4 кабеля к нему



Рисунок 122. Шаровой манипулятор трекбол и кабель к нему

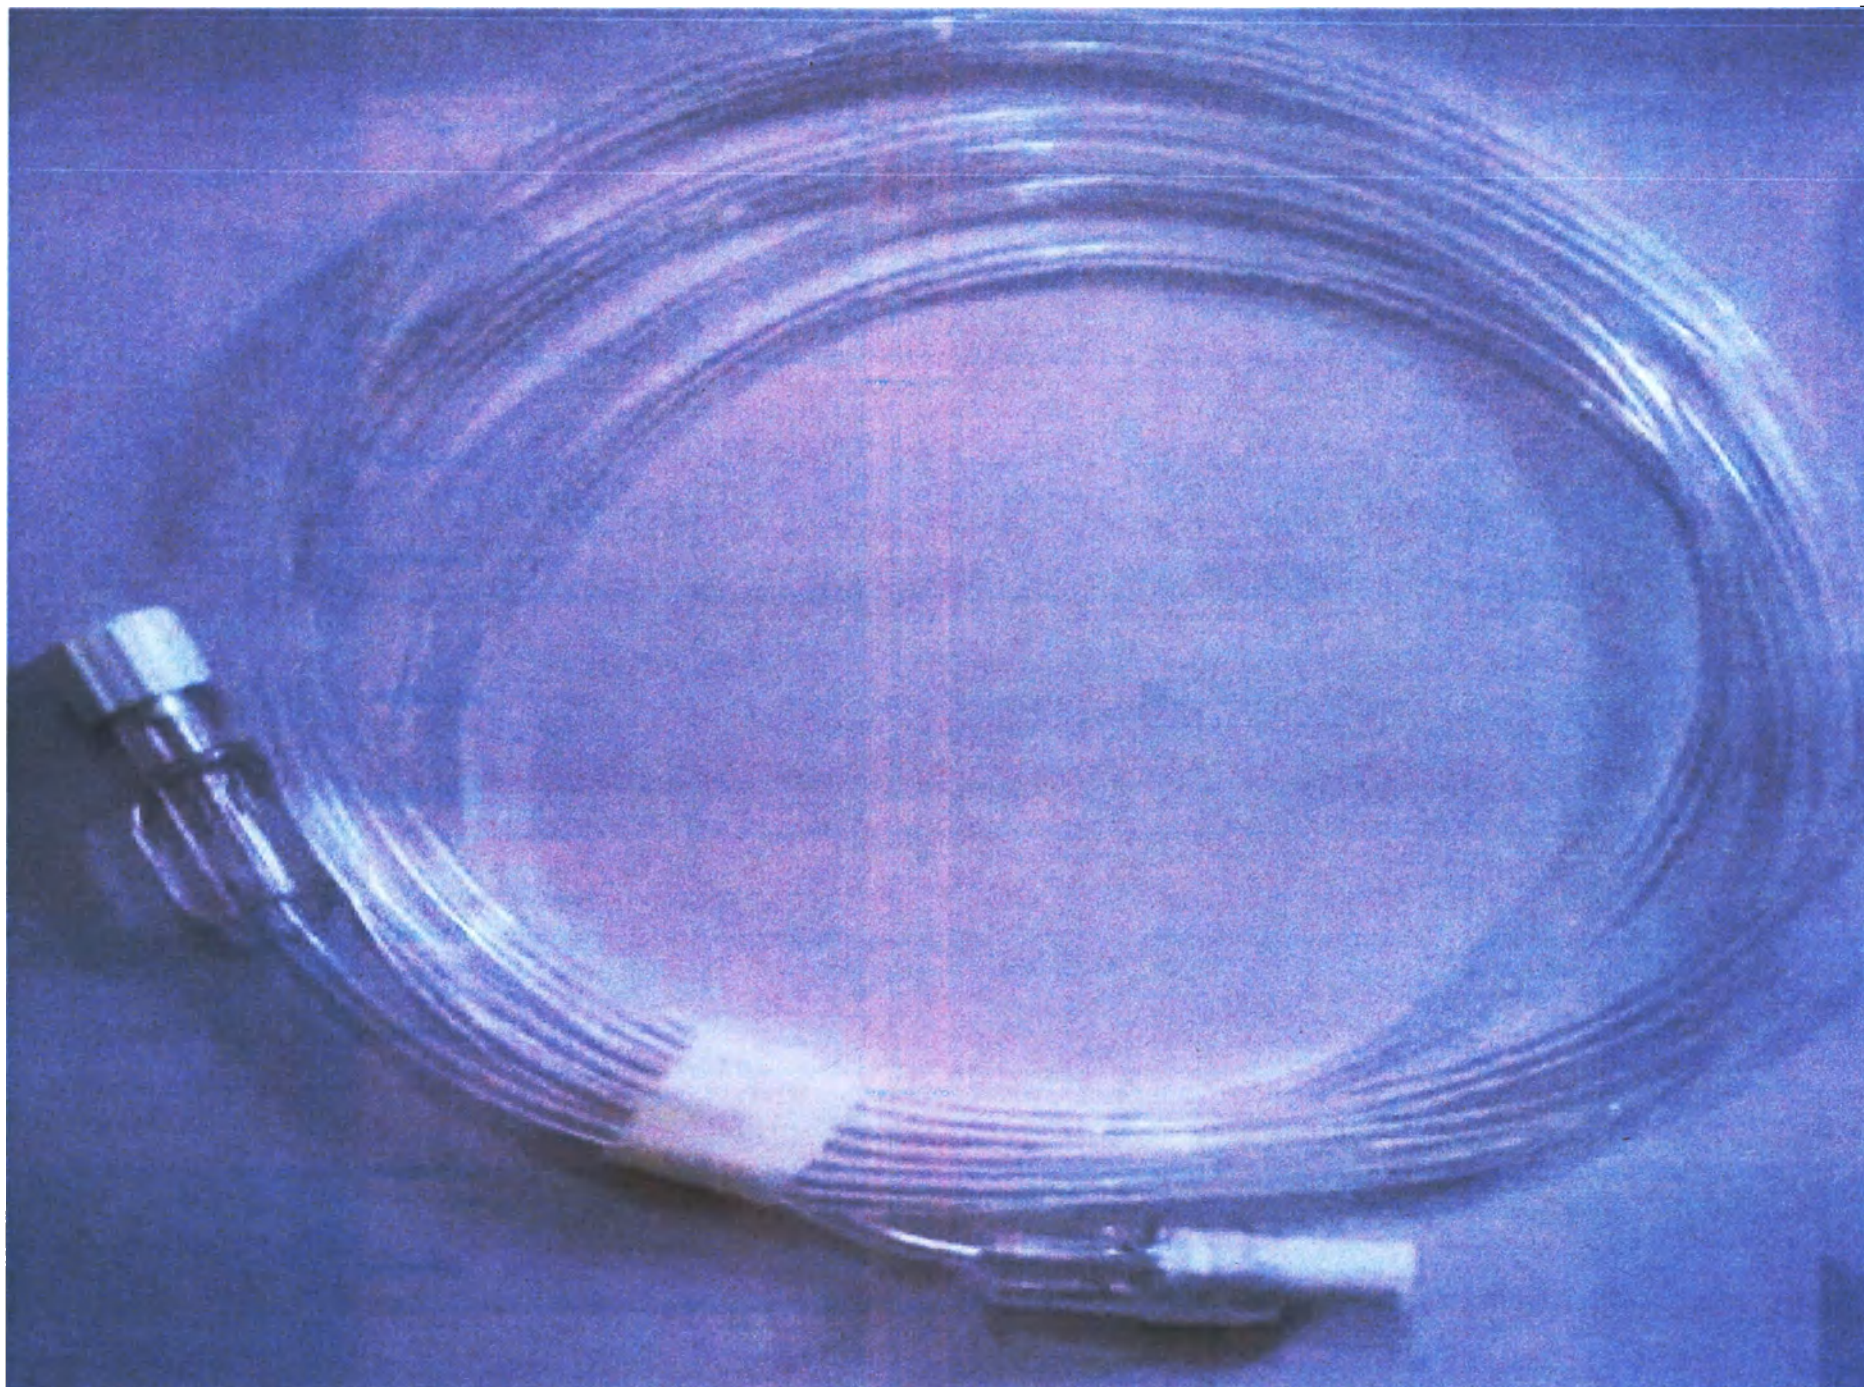




Рисунок 124. Трубка к бутылки для промывающей жидкости

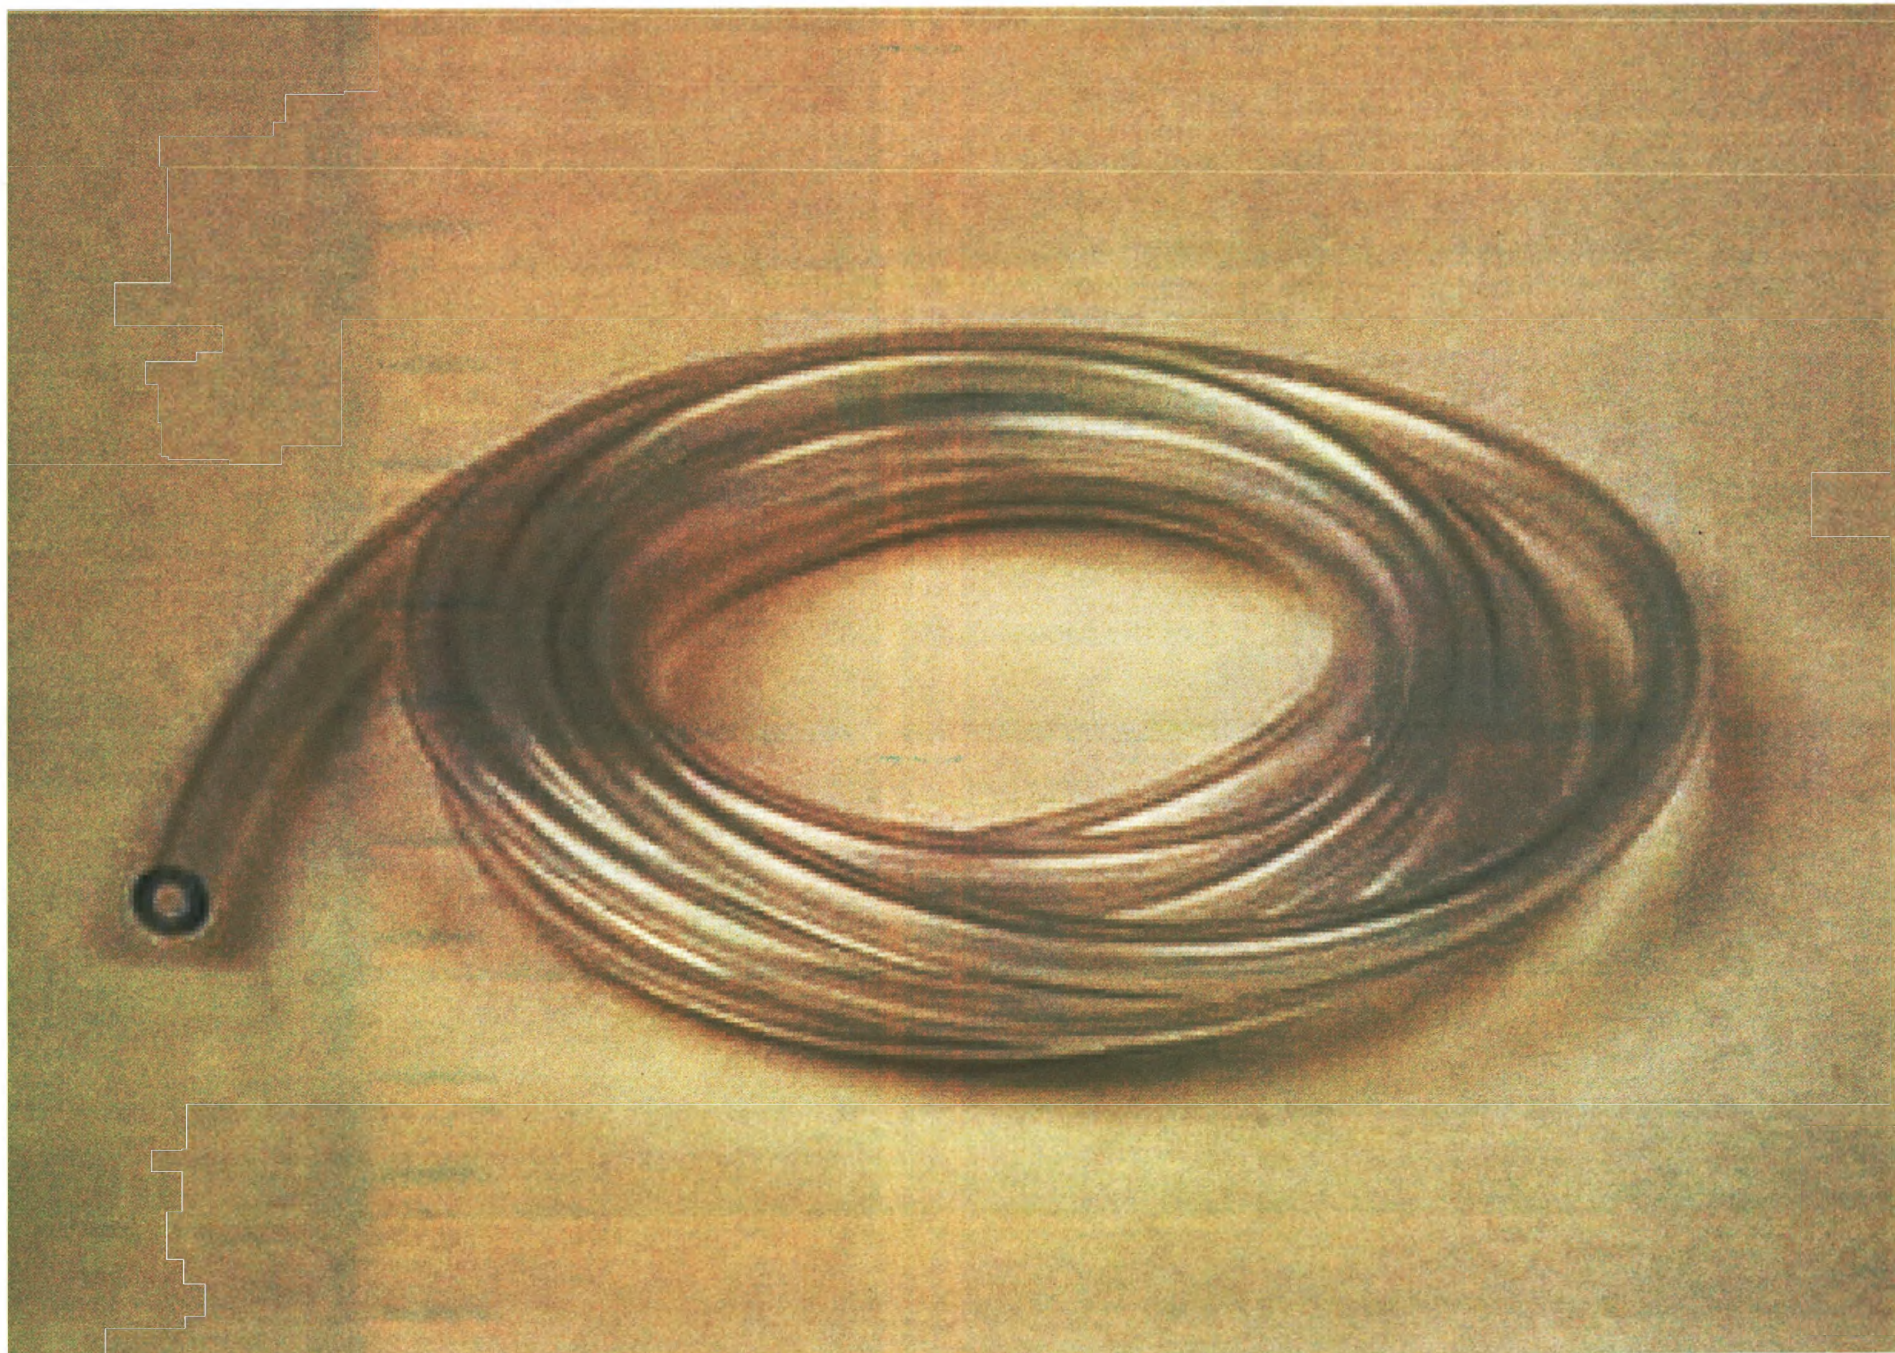


Рисунок 125. Трубка слива жидких отходов

Анализатор иммунохемилюминесцентный Immulite 1000

Регистрационное удостоверение:

№ ФСЗ 2007/00551 от 14.07.2022

ТОЛЬКО ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ IN VITRO

Производитель, дата производства, серийный номер и др. символы указаны на оригинальной маркировке изделия

110/120/220/240 В

50/60 Гц

700/800 Вт

Уполномоченный представитель производителя на территории Российской Федерации:

ООО «Сименс Здравоохранение», 115093, Россия, г. Москва, ул. Дубининская, д. 96

Тел.: 8(800) 550 50 22

Рисунок 126. Макет маркировки для Российской Федерации, который будет наноситься на Блок Анализатора иммунохемилюминесцентного Immulite 1000.

Принадлежности к анализаторам иммунохемилюминесцентным Immulite One, Immulite 1000, Immulite 2000, Immulite 2000XPI

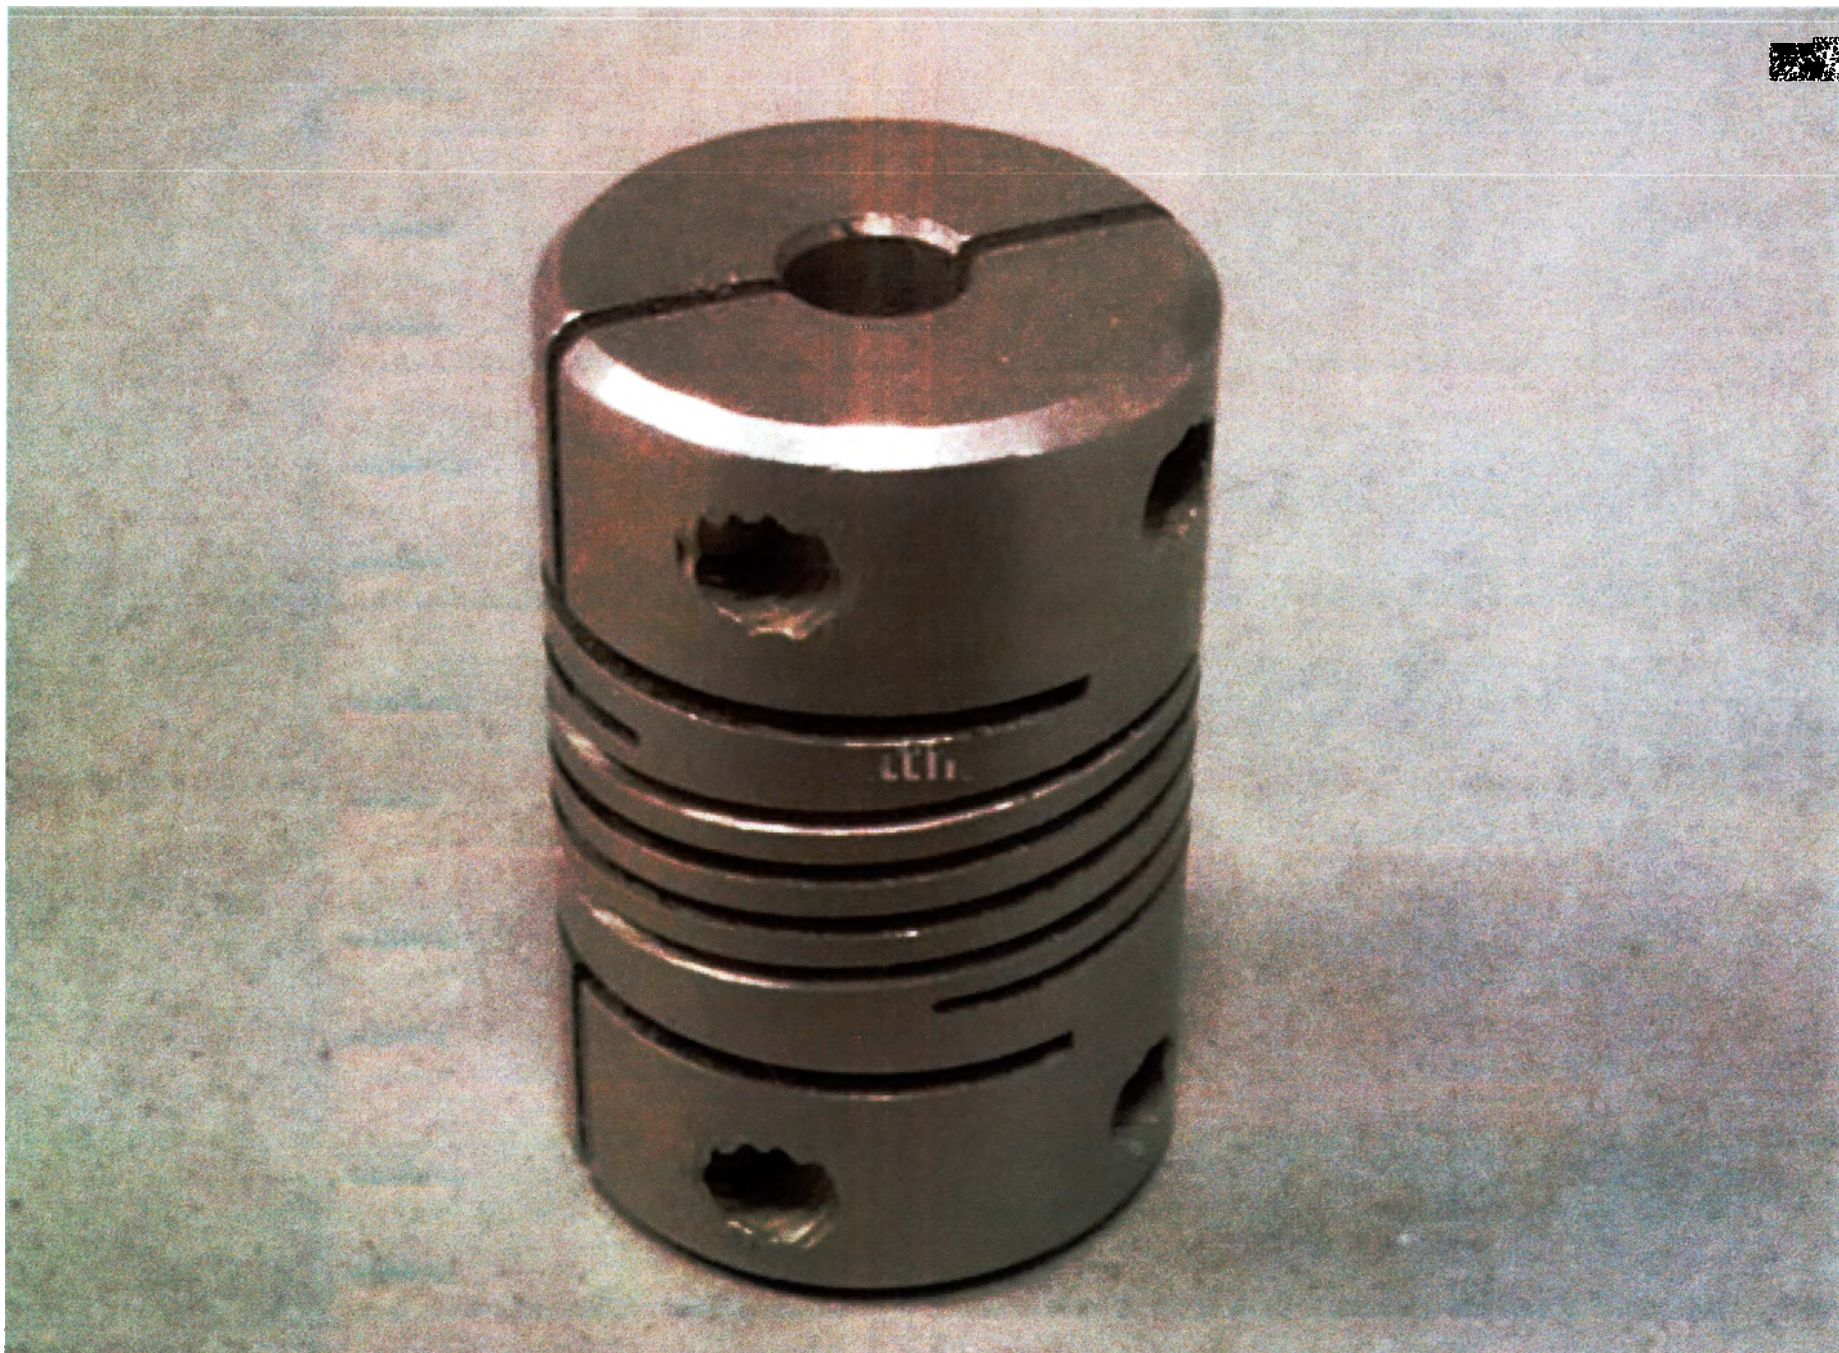


Рисунок 1. Амортизаторы



Рисунок 2. Атенюатор

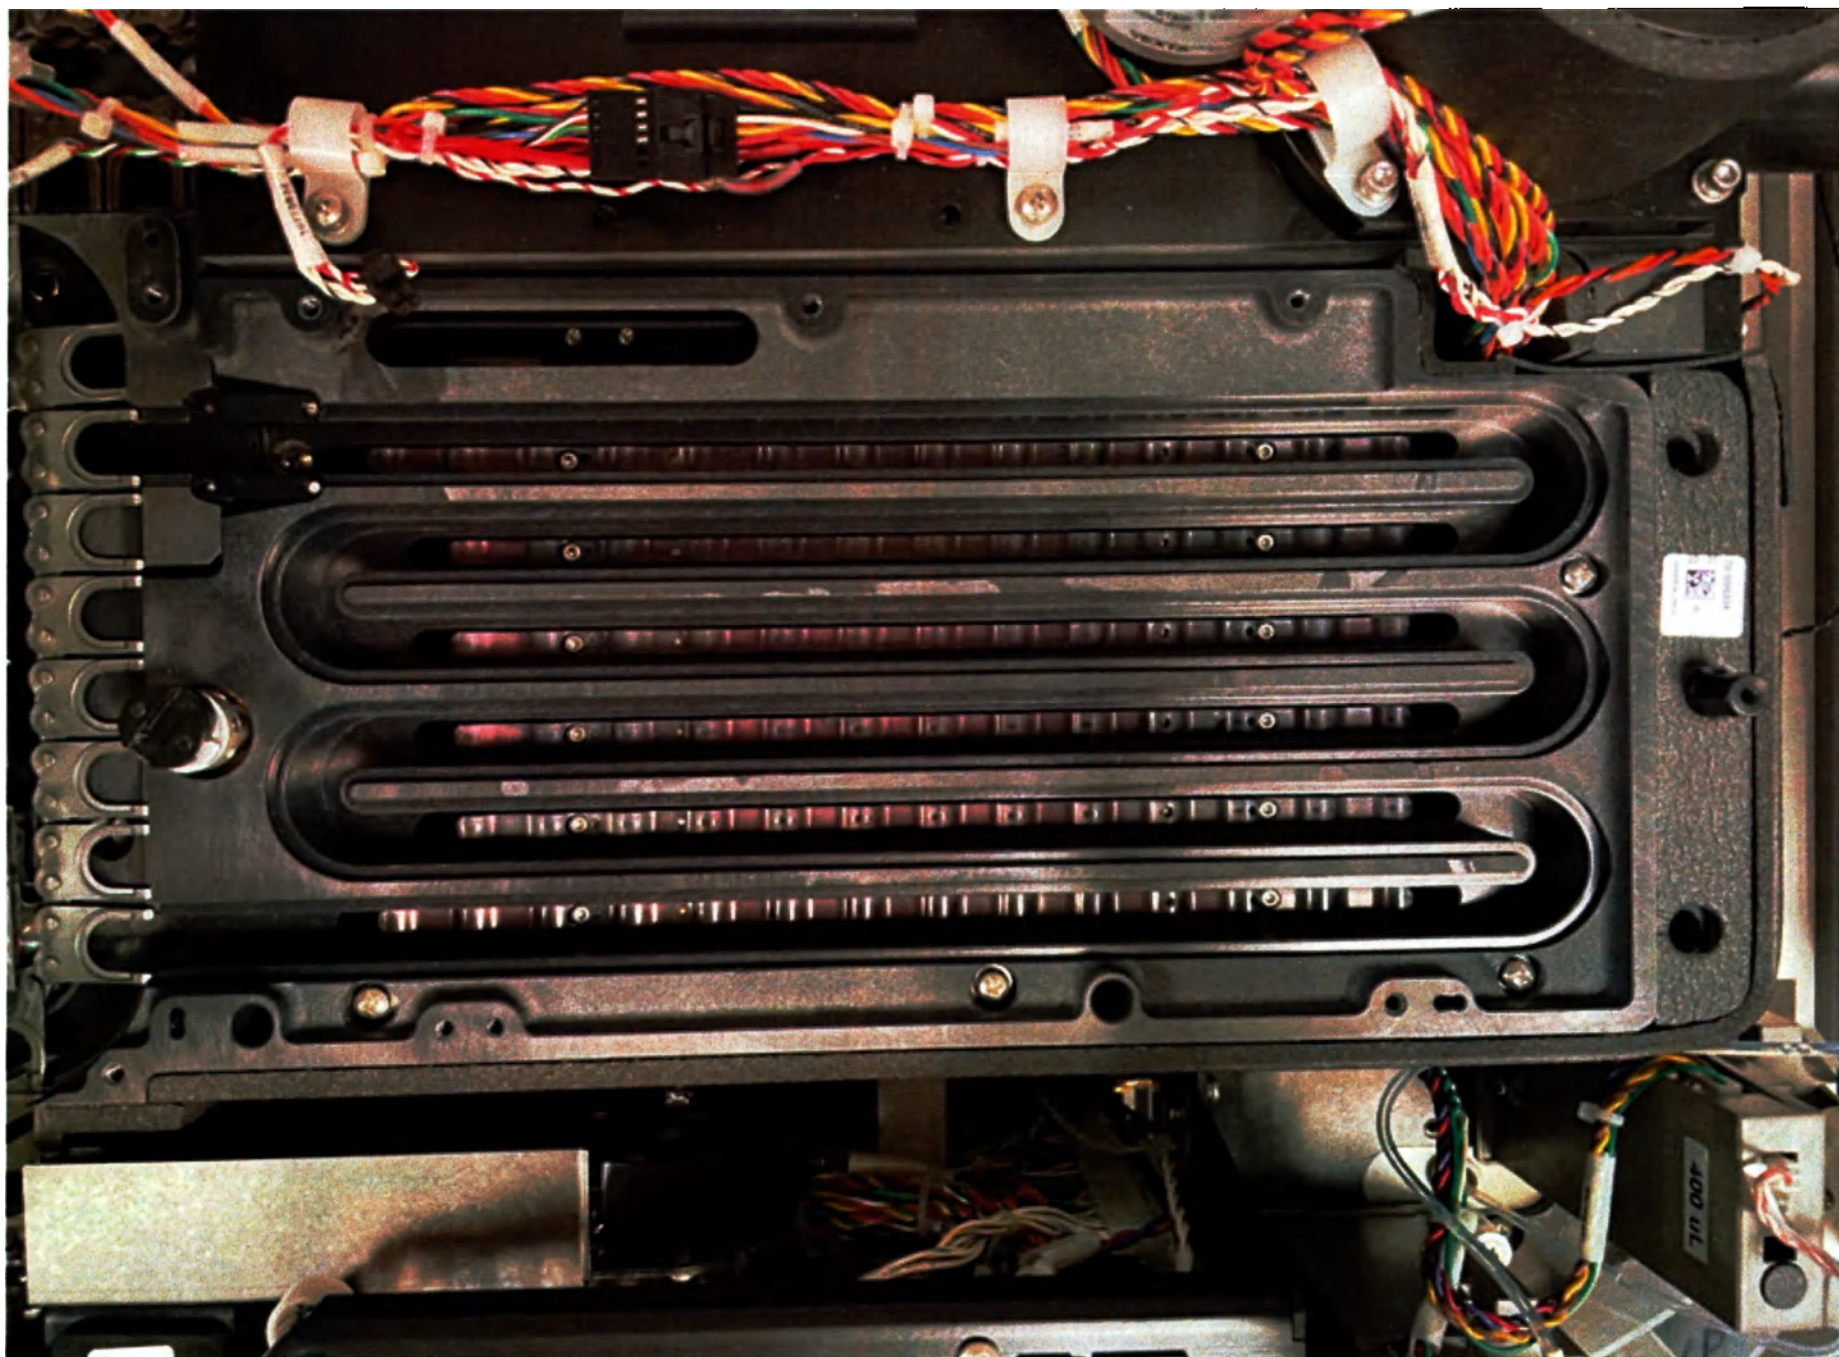


Рисунок 3. Блок инкубации пробирок

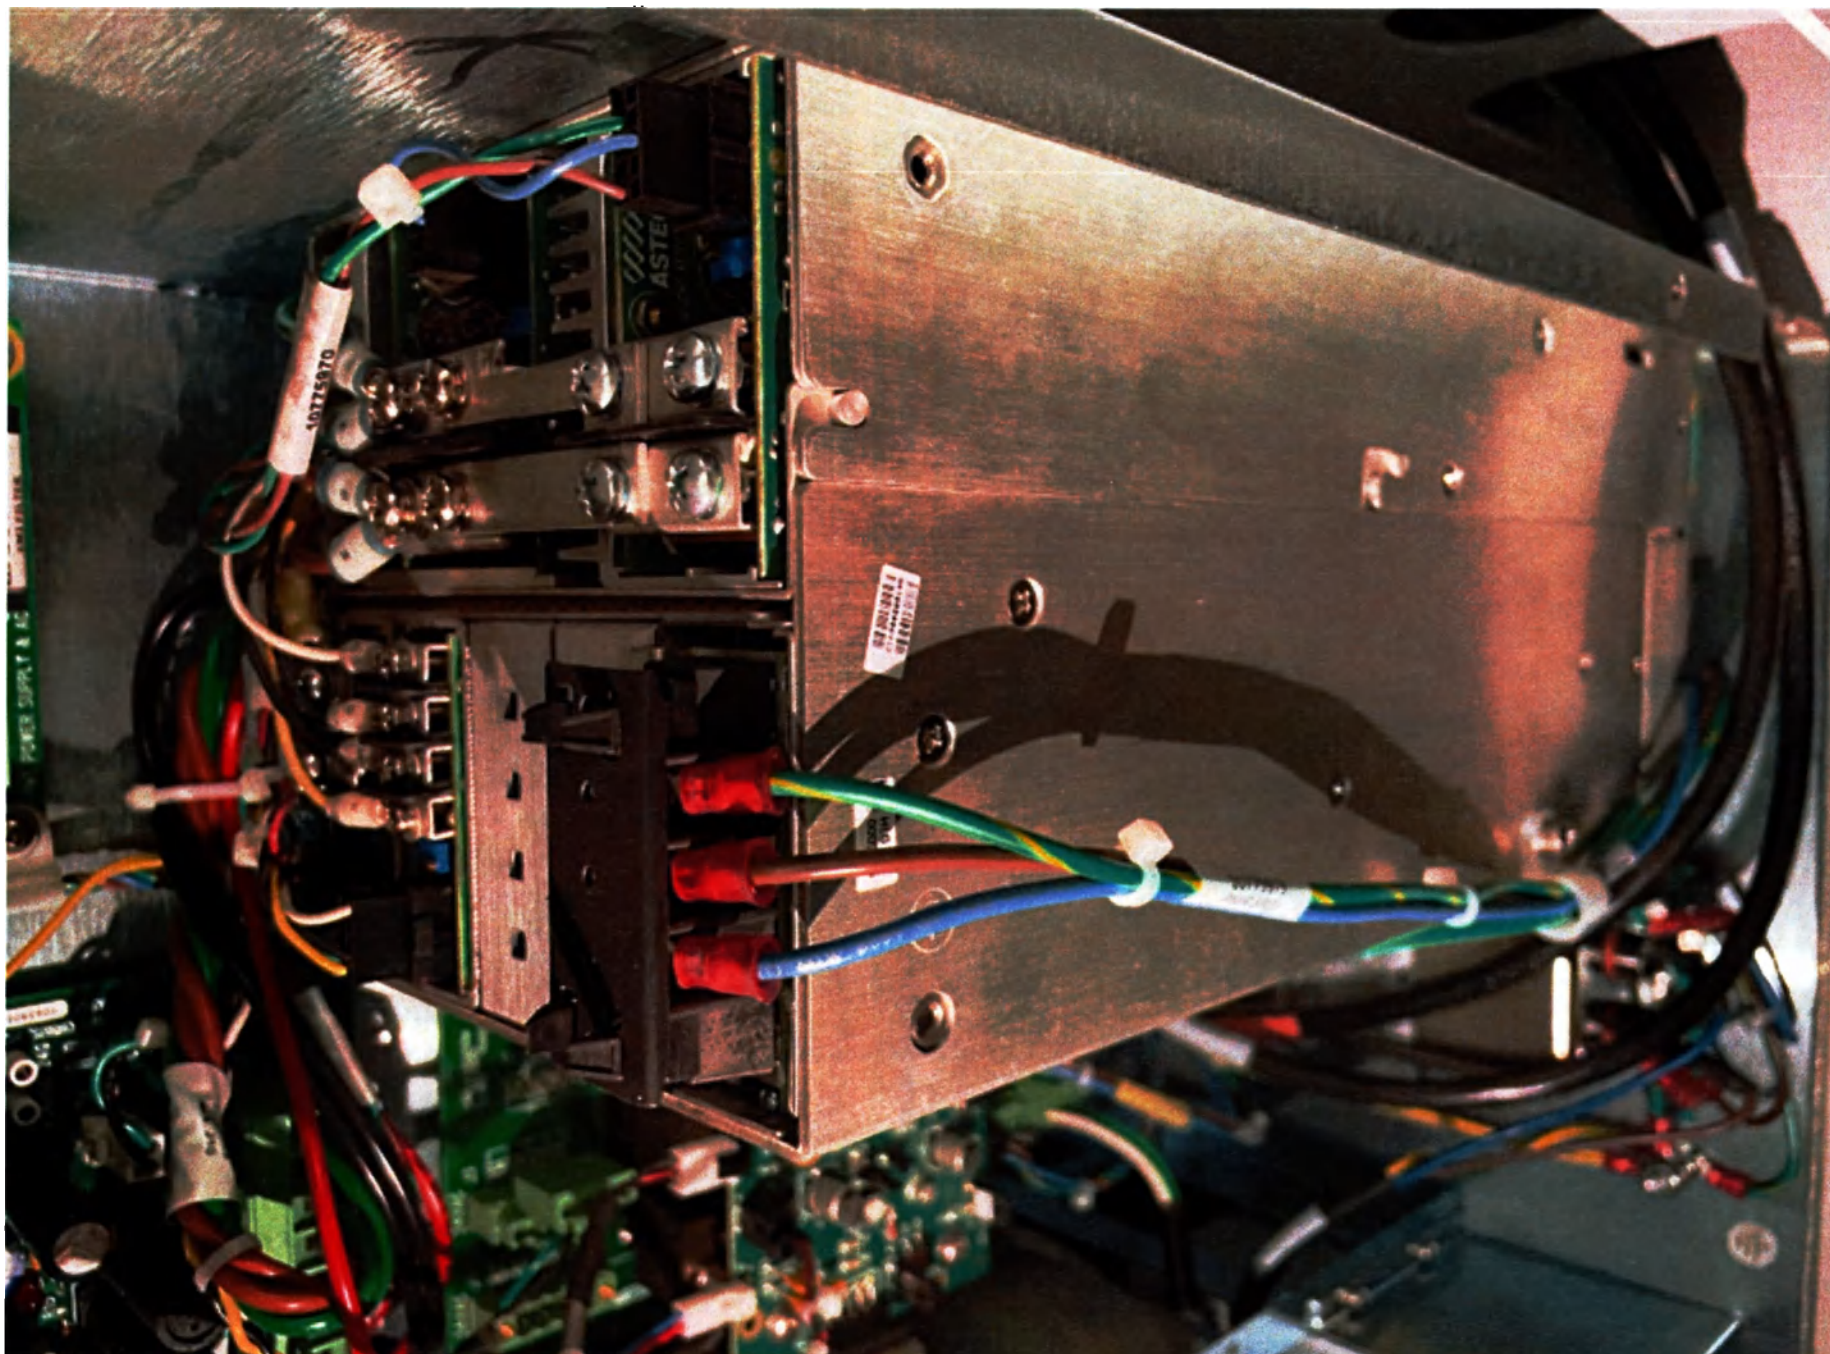


Рисунок 4. Блоки питания с кабелями и без



умага для принтера

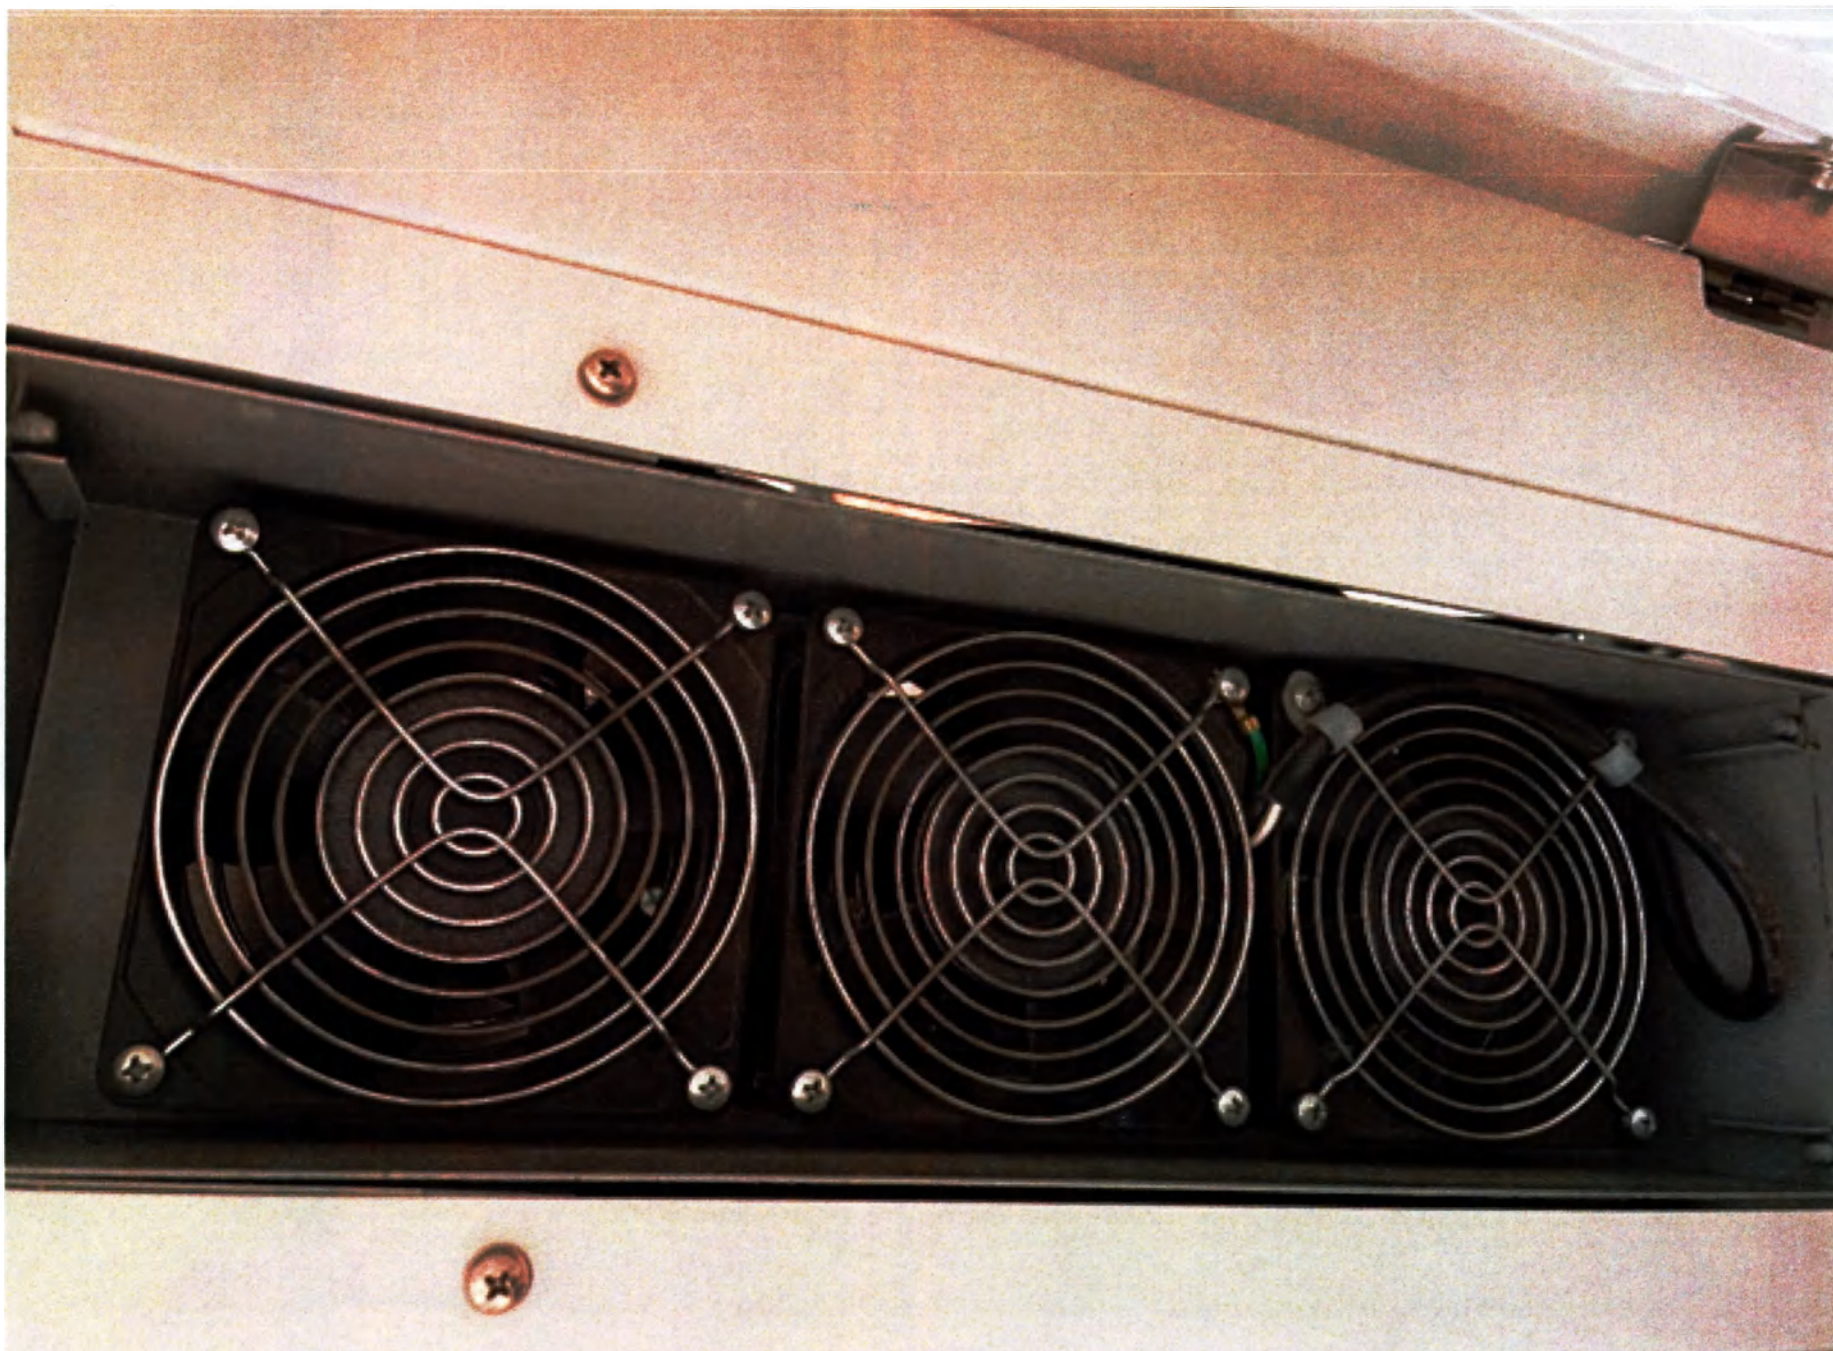


Рисунок 6. Вентиляторы



Рисунок 7. Весы электронные разные



Рисунок 8. Винты разных размеров

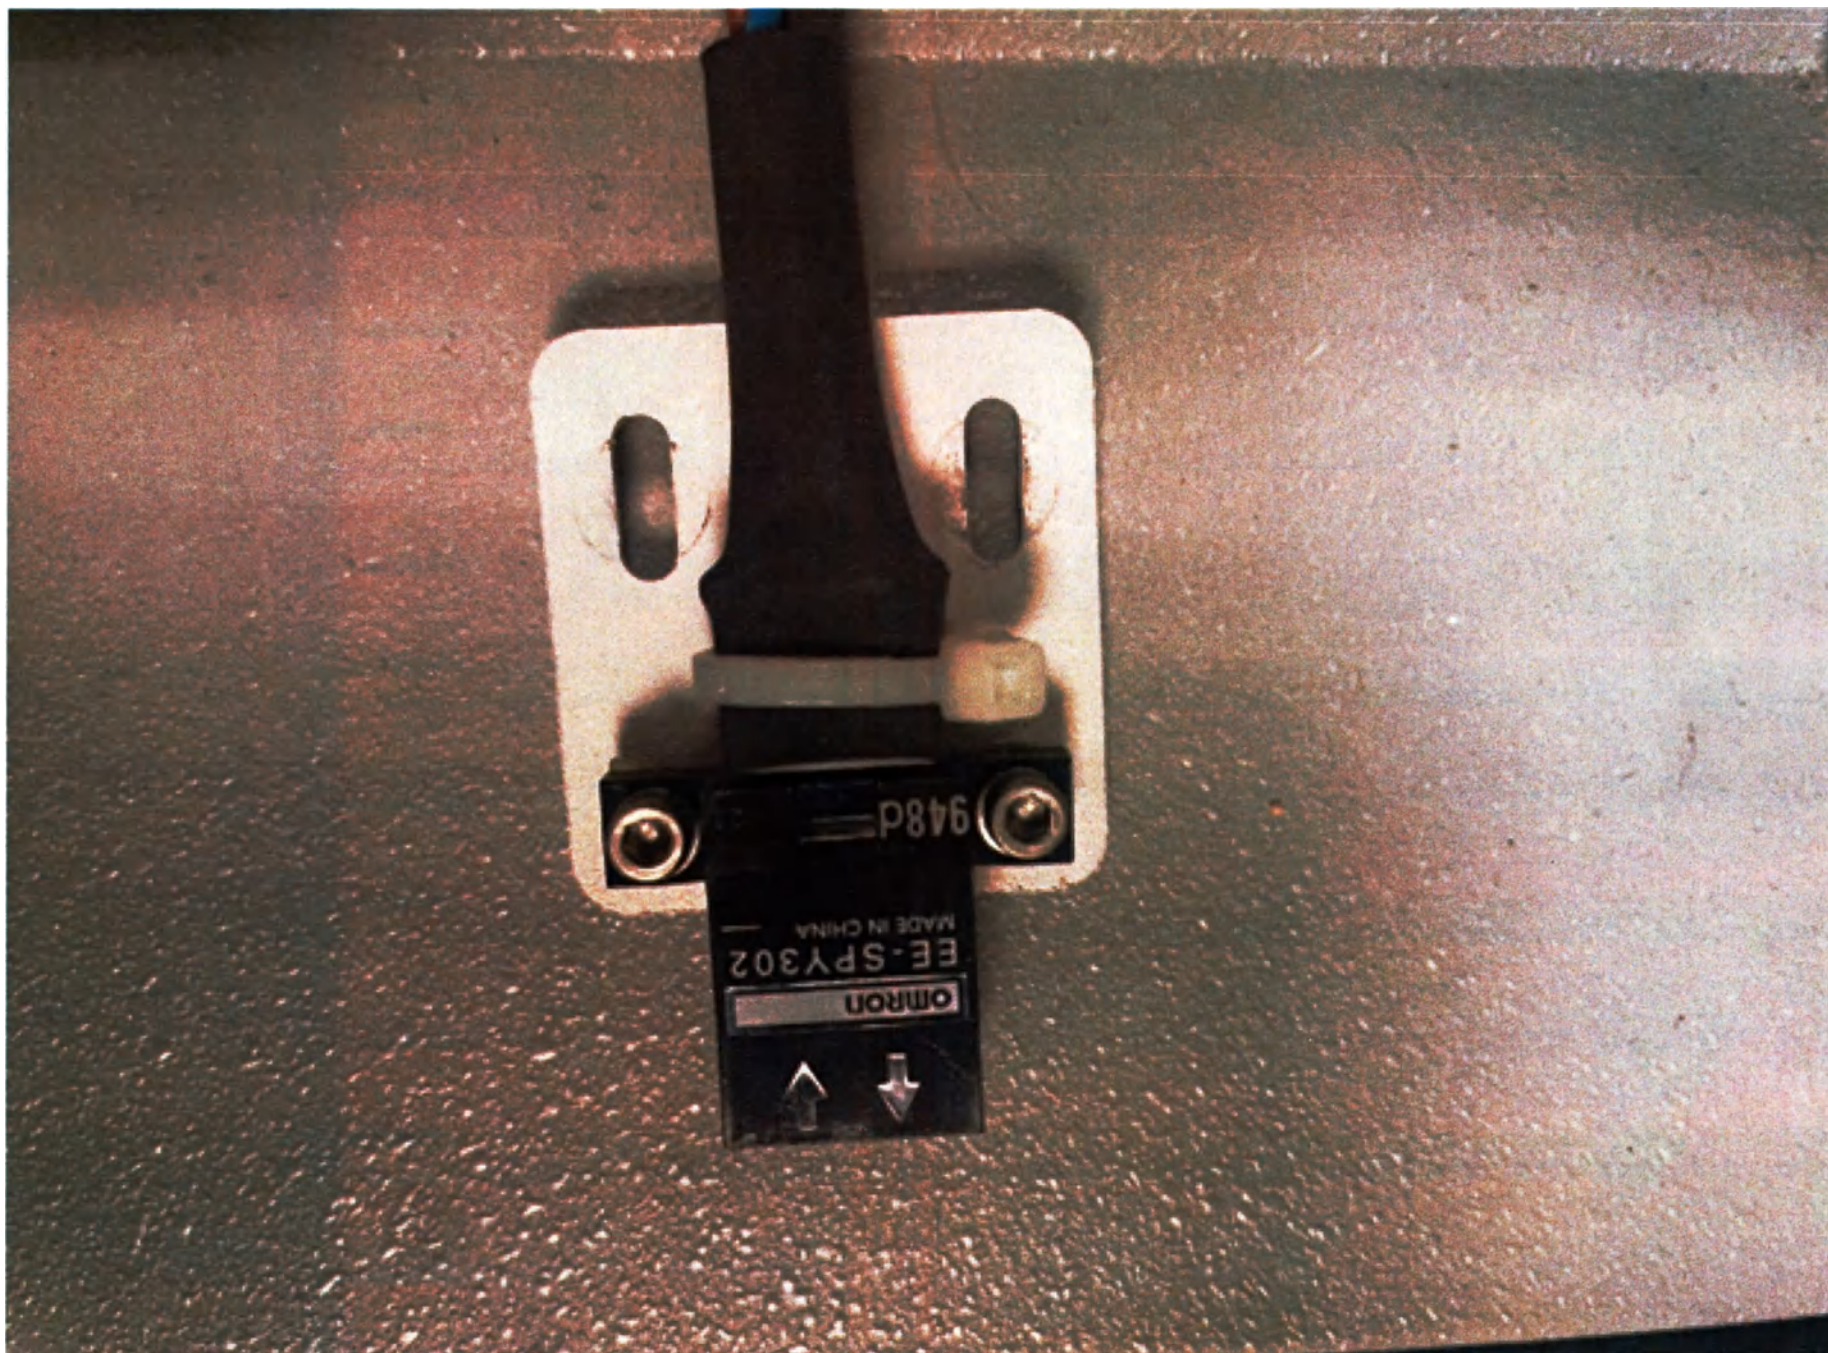


Рисунок 9. Датчики электронные разные

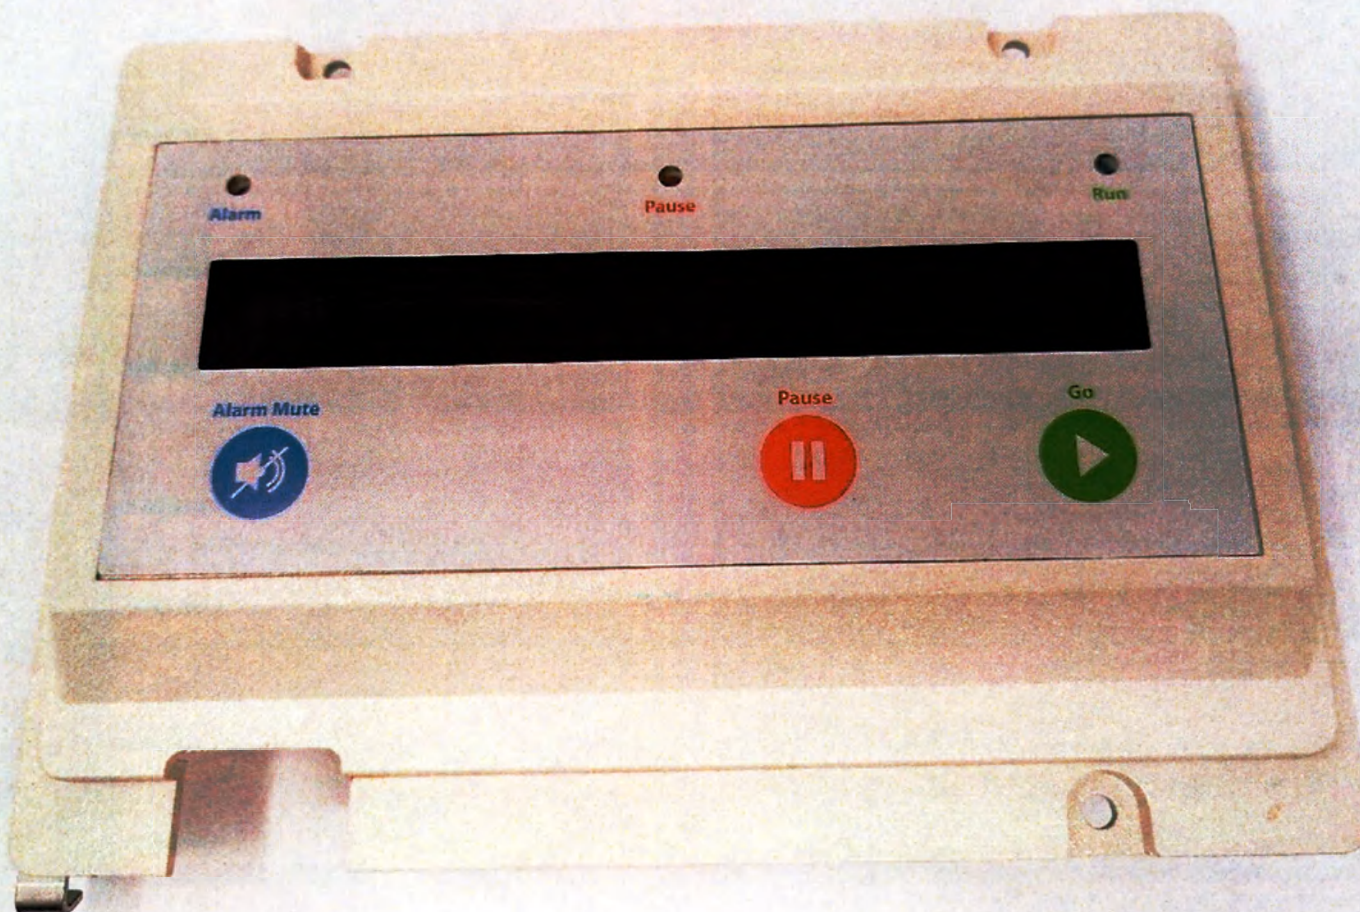


Рисунок 10. Дисплей

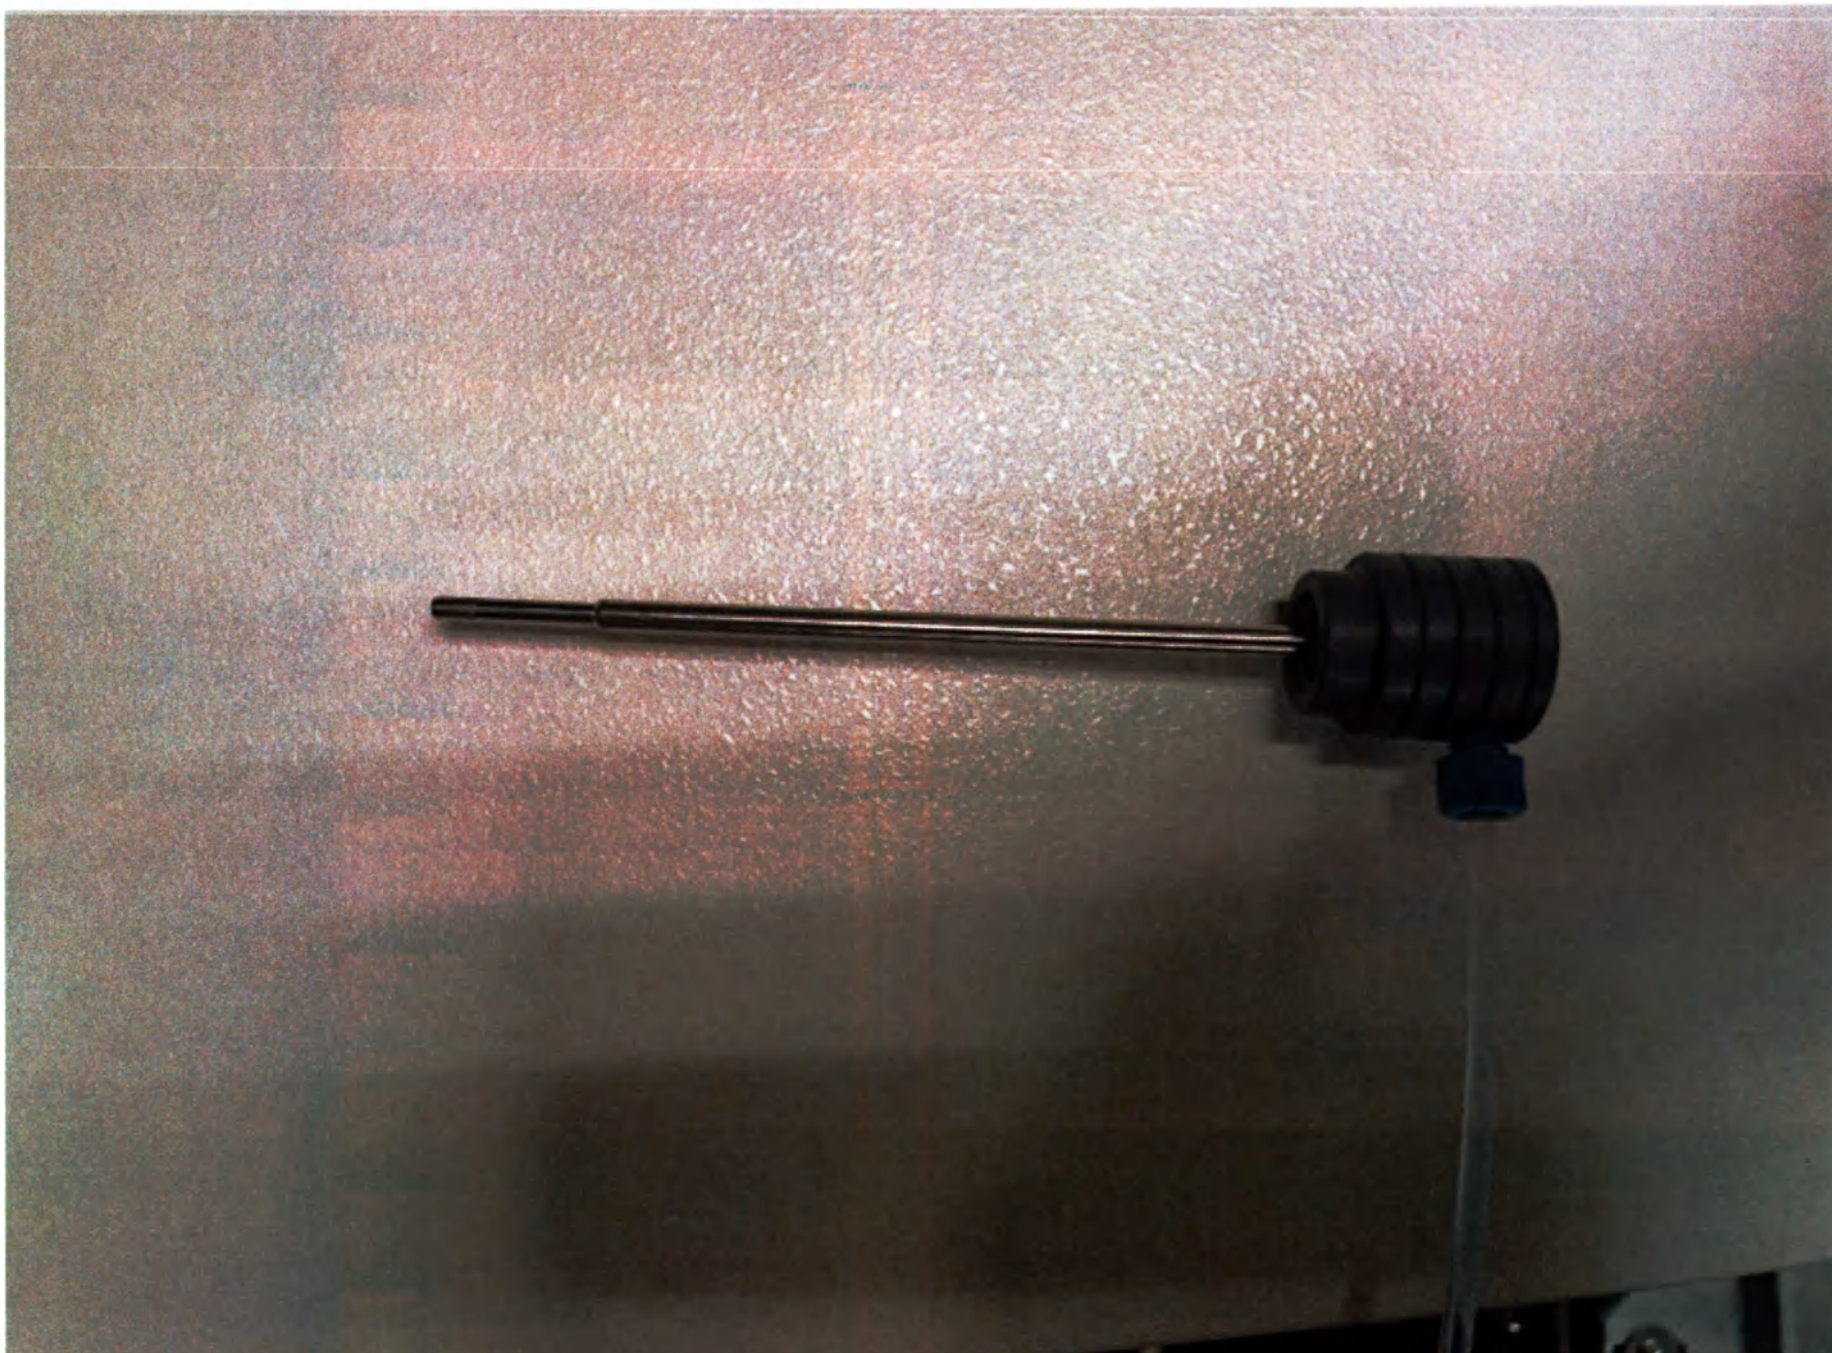


Рисунок 11. Дозаторы воды и субстрата

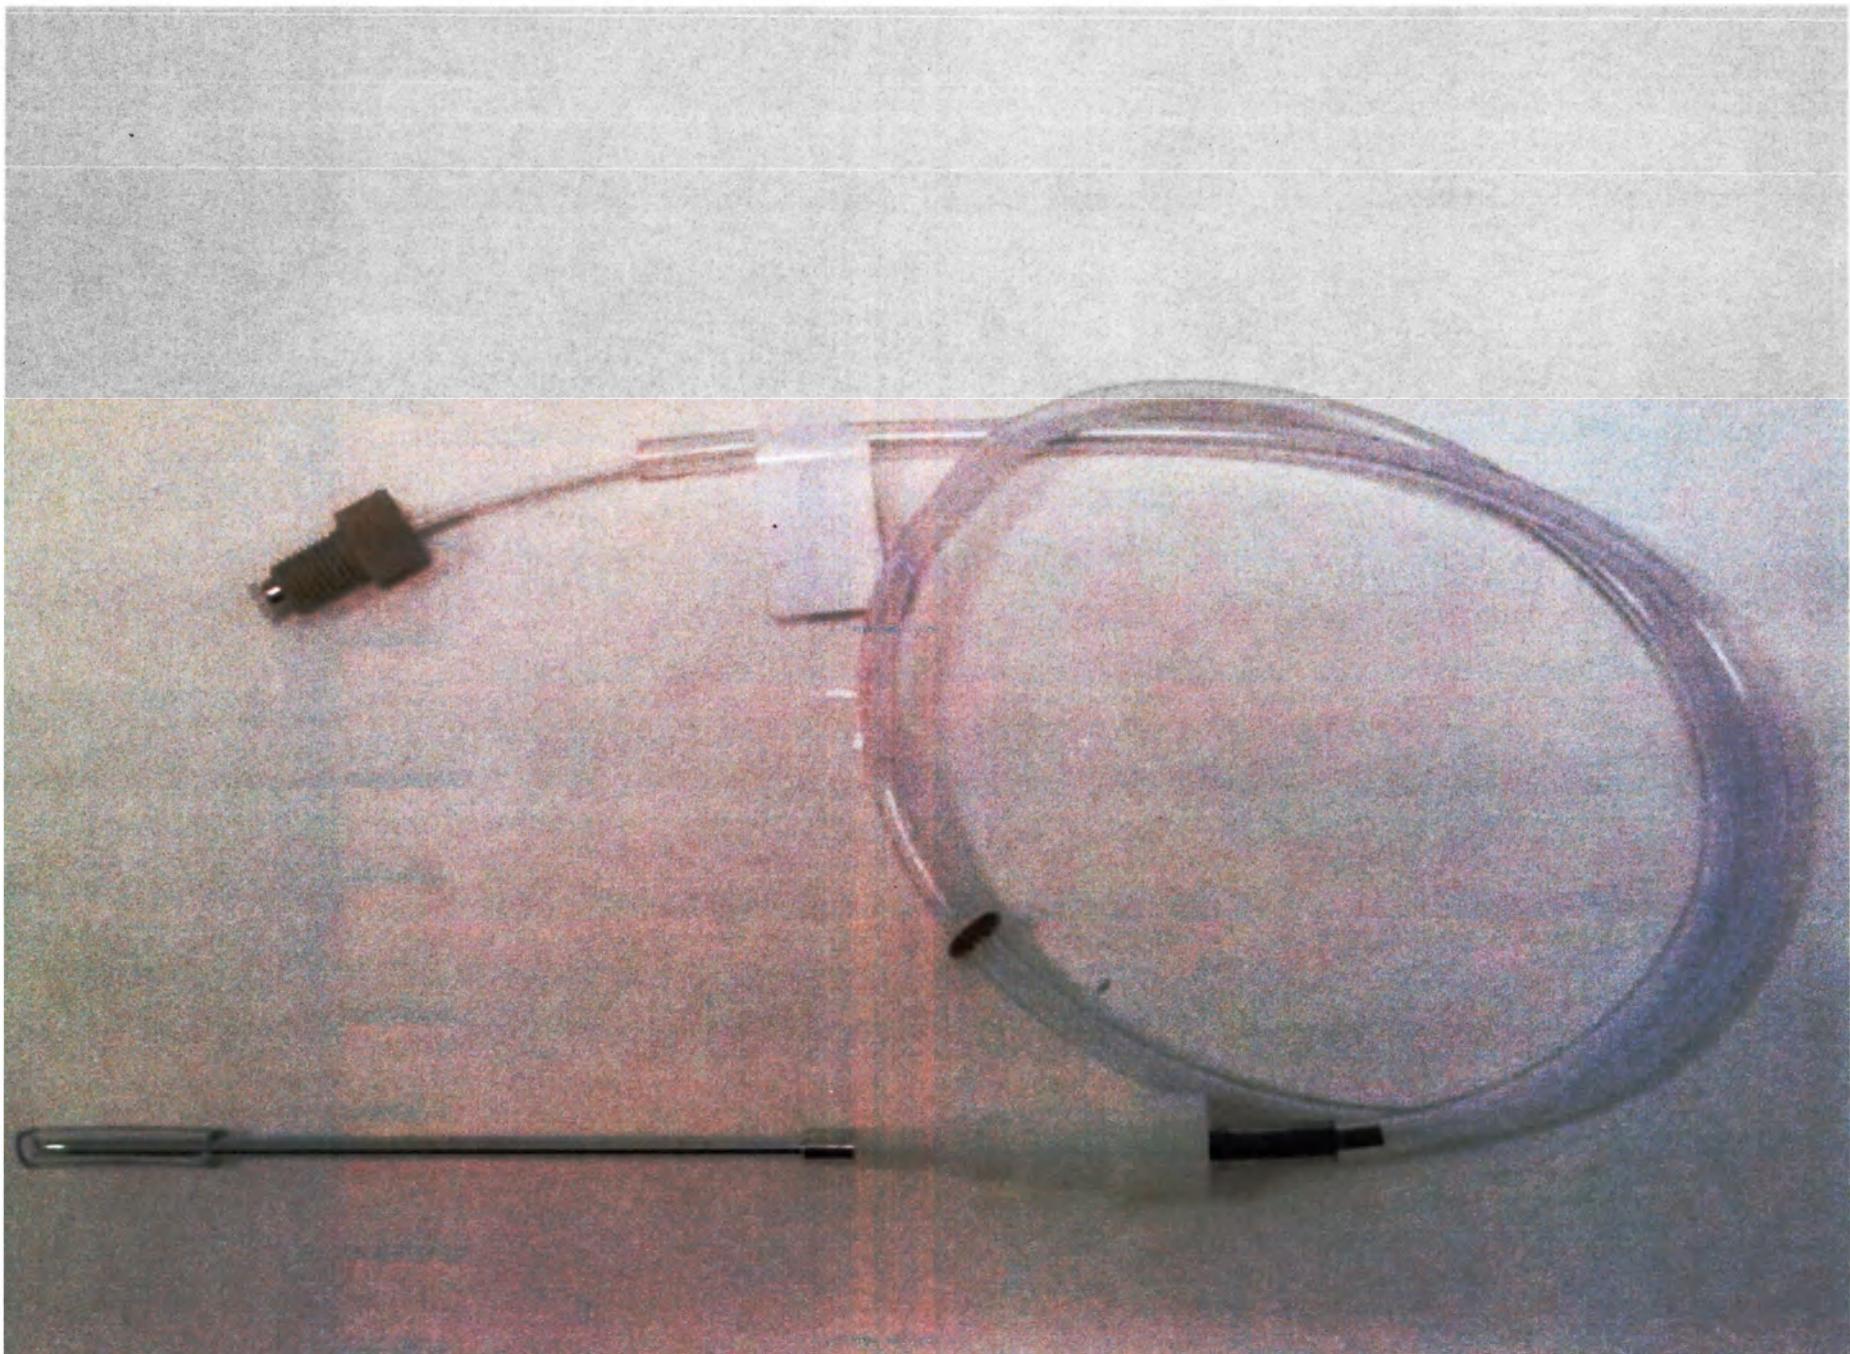


Рисунок 12. Дозаторы реактива и проб

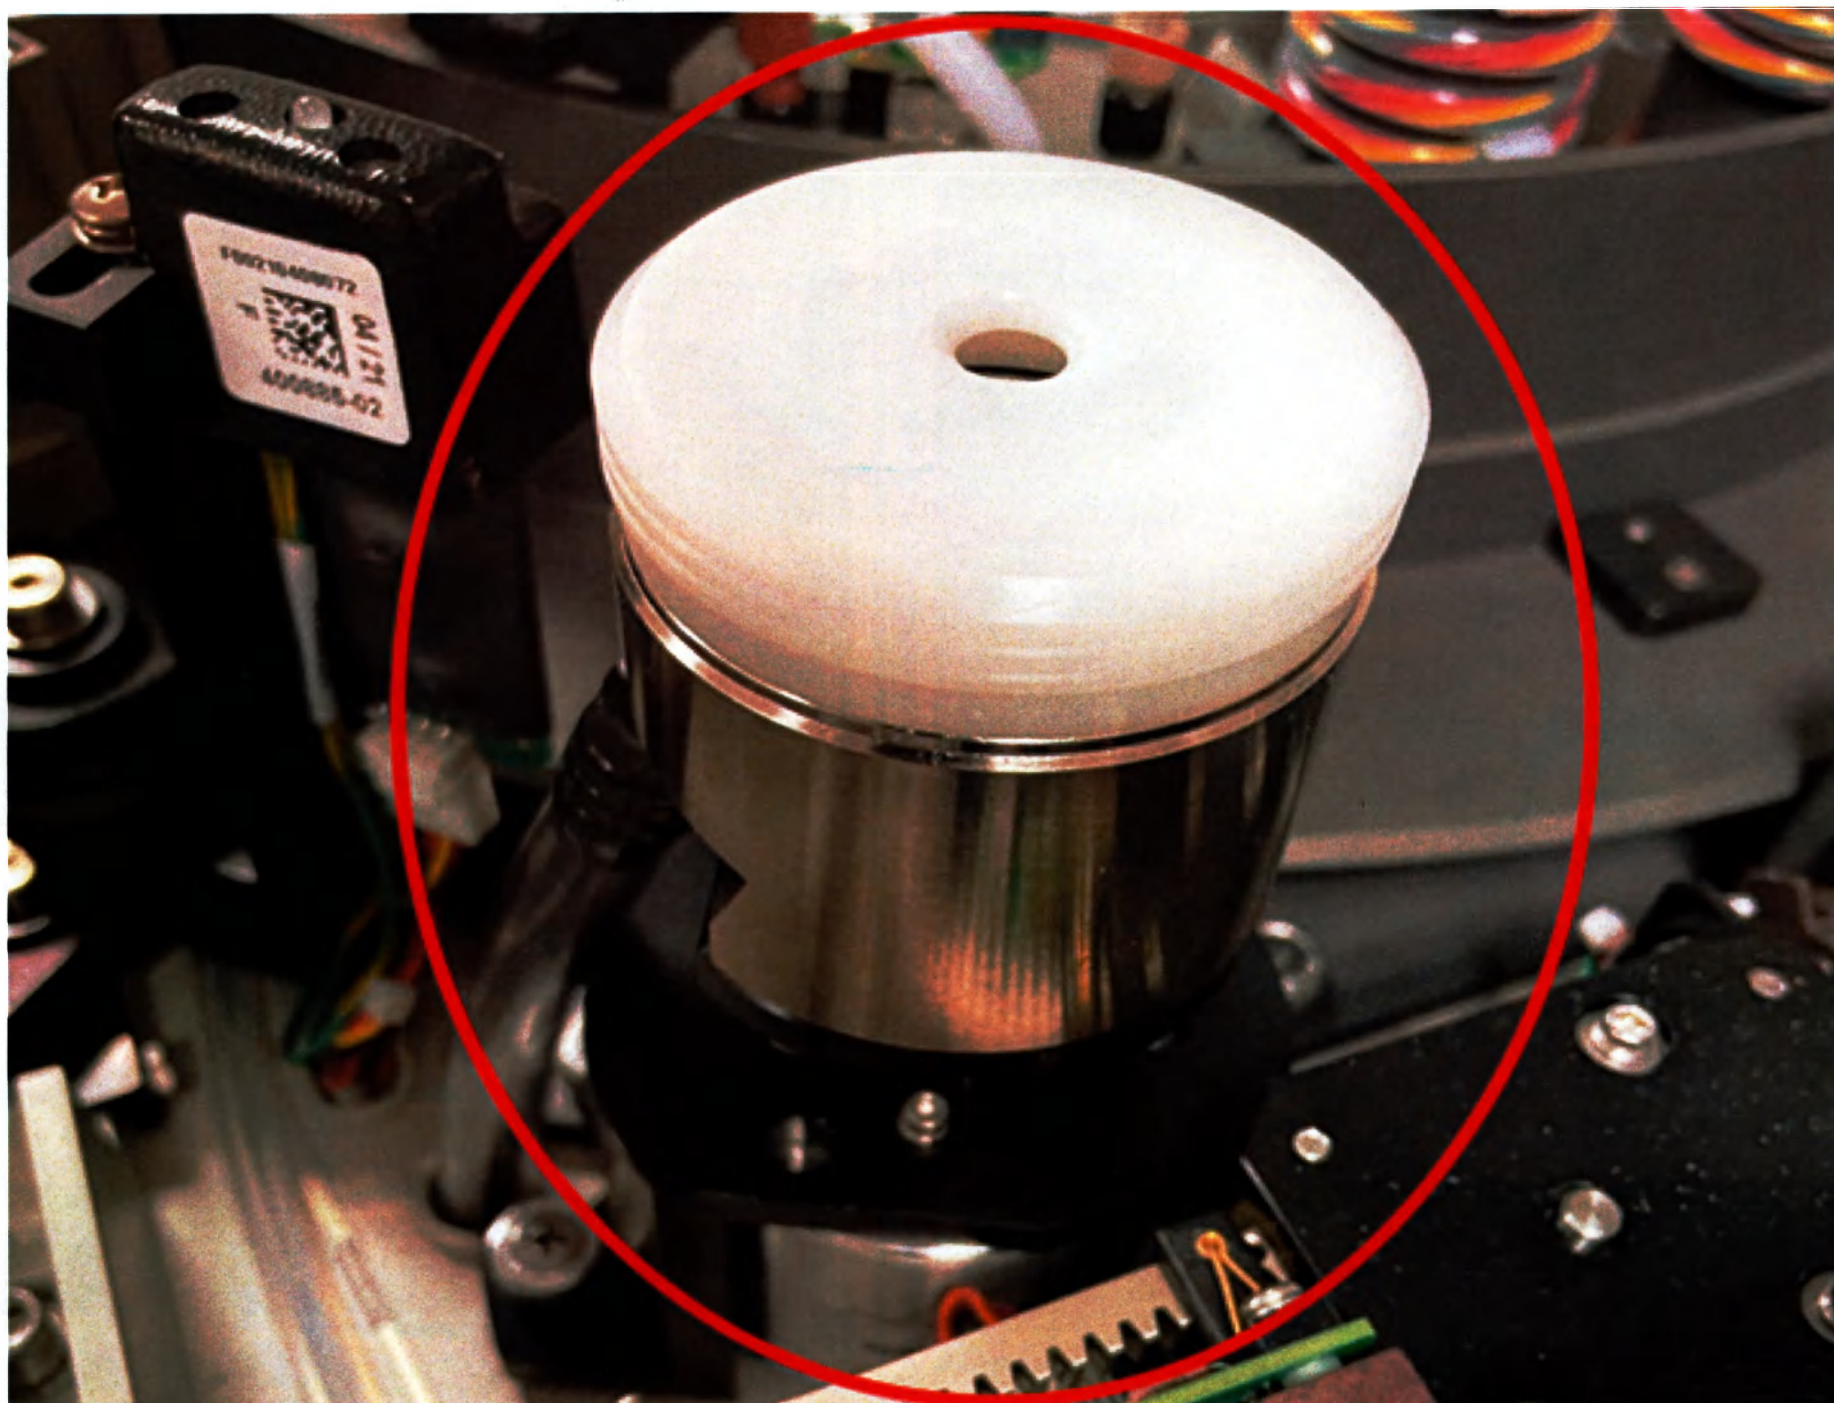




Рисунок 14. Карусели для реактивов

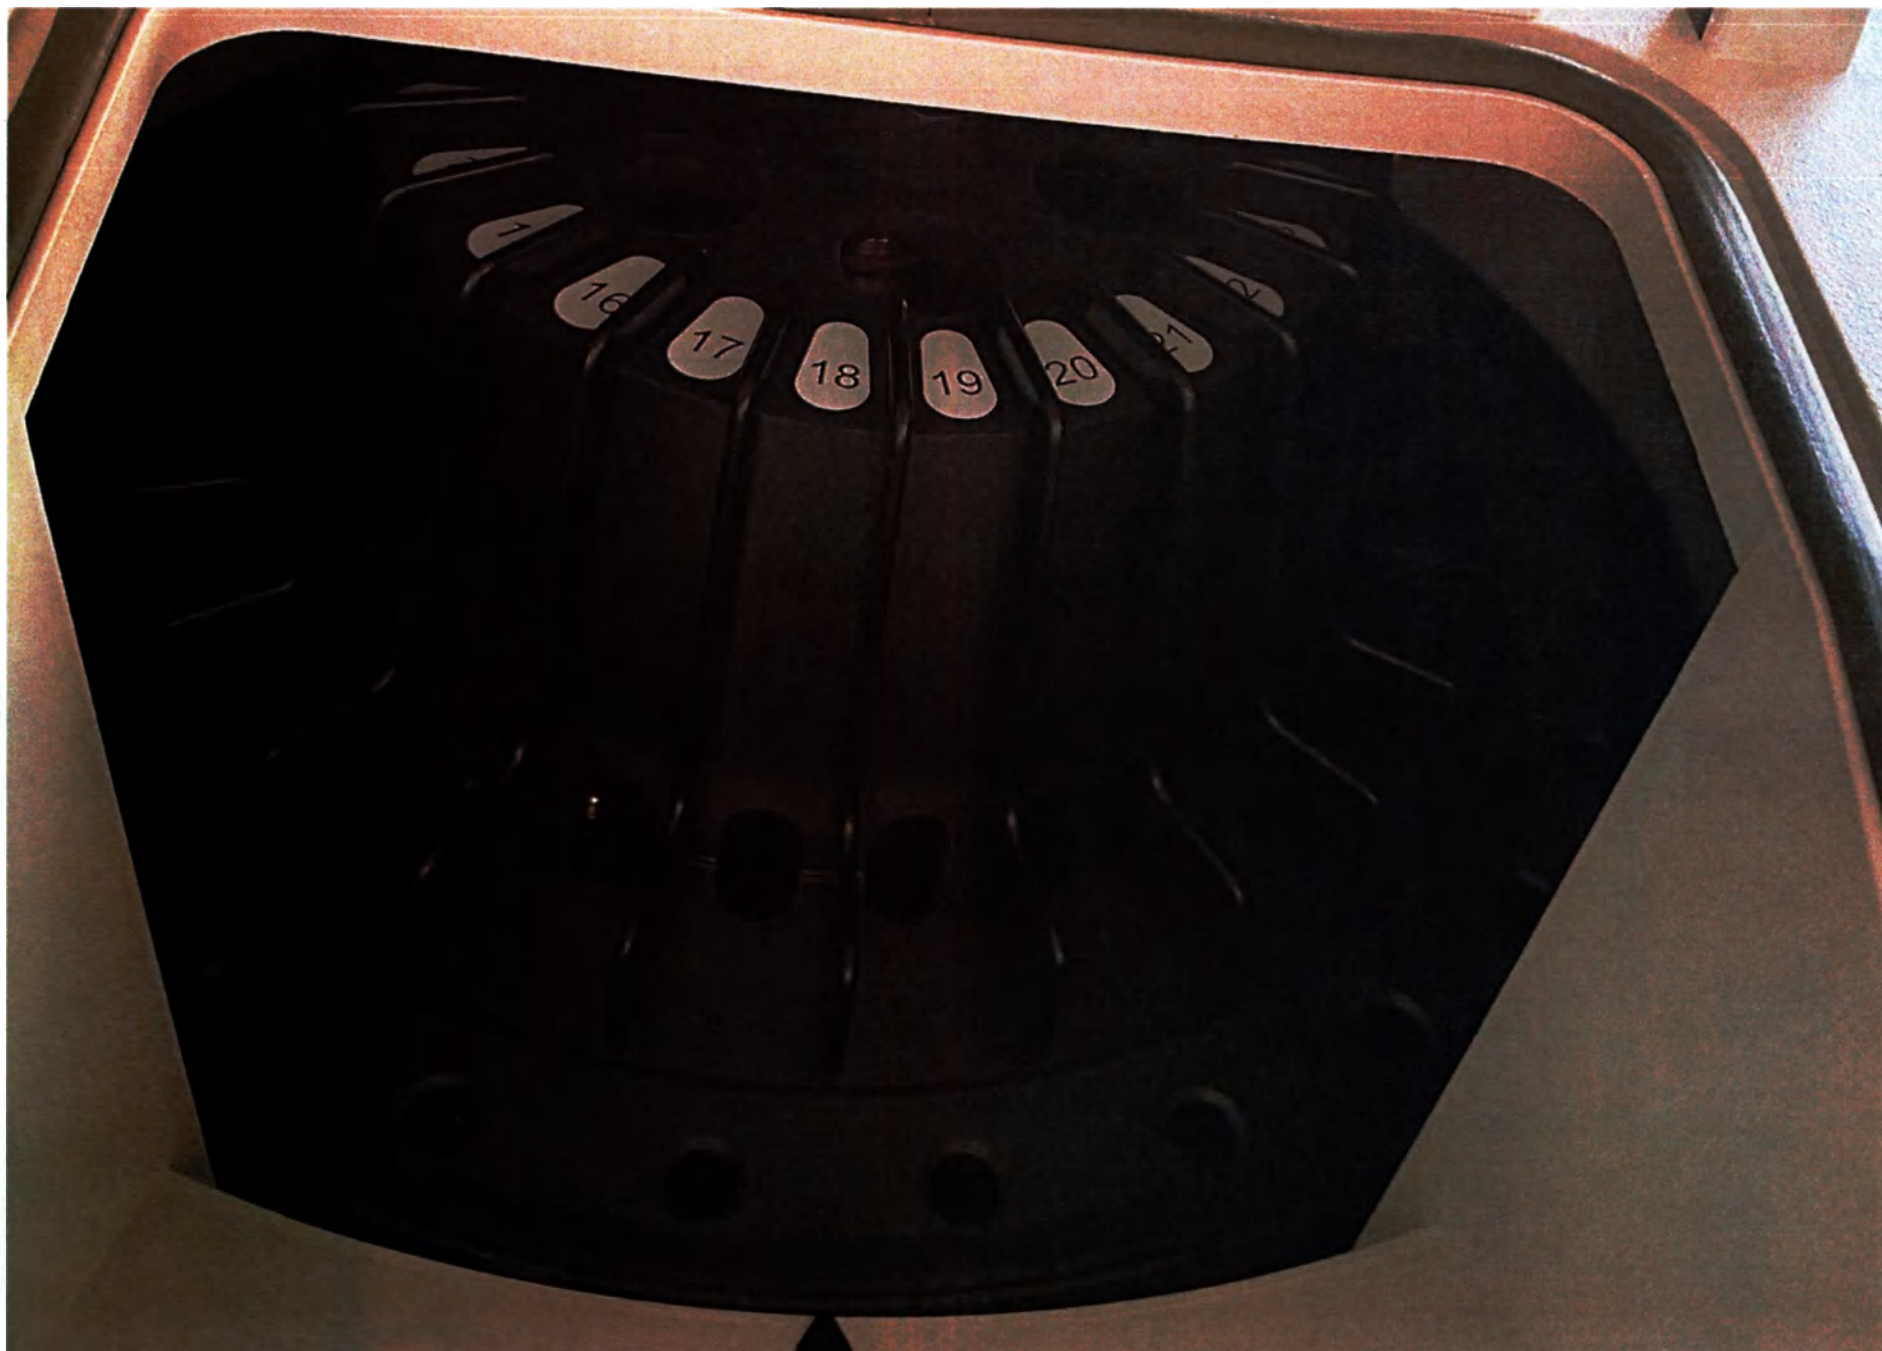


Рисунок 15. Карусель для тестовых шариков



Рисунок 16. Клапанный механизм для управления потоками жидкостей в анализаторе

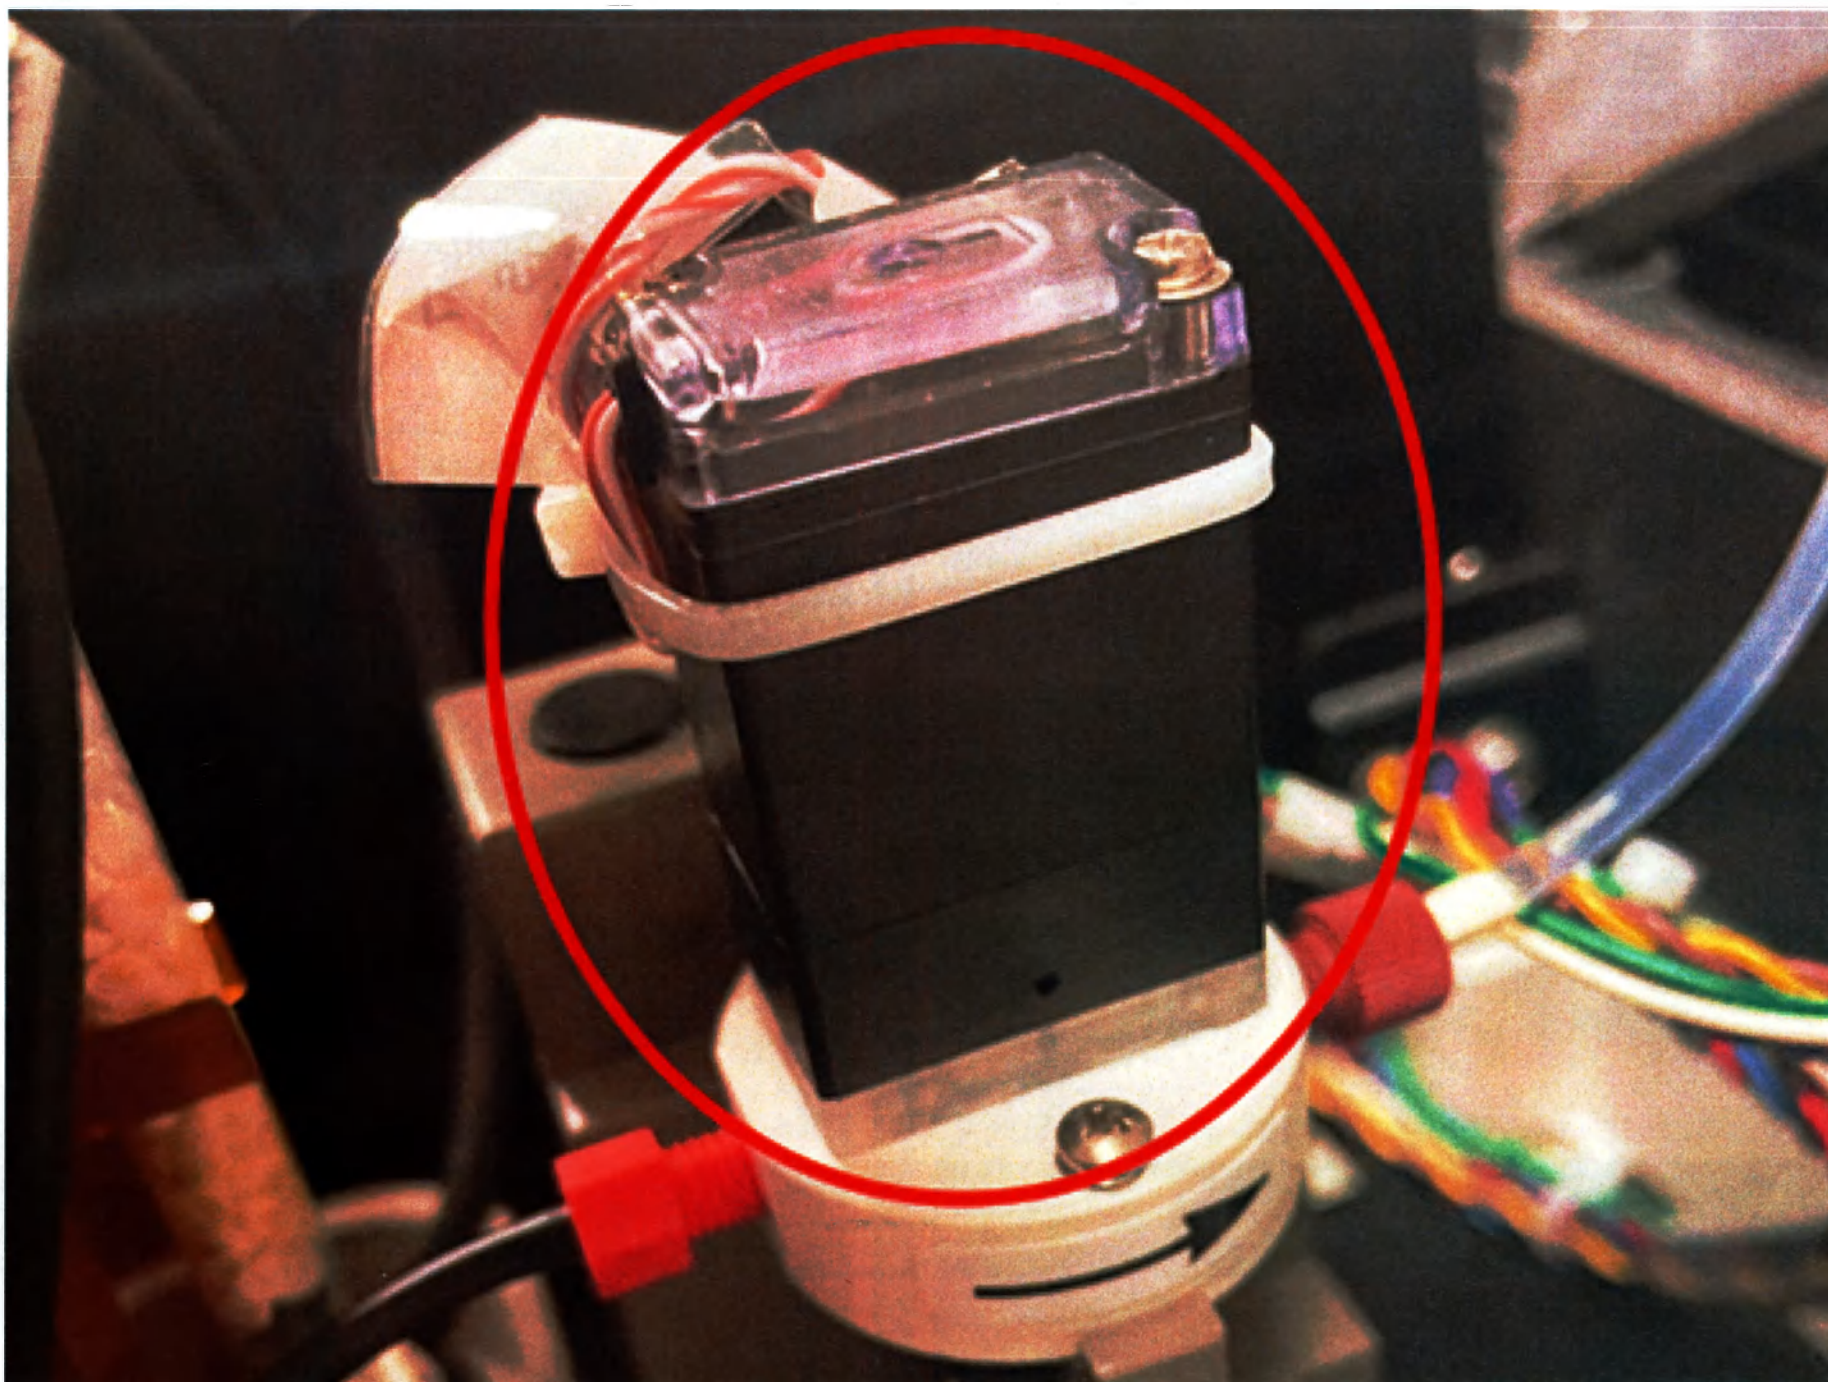




Рисунок 18. Колесо

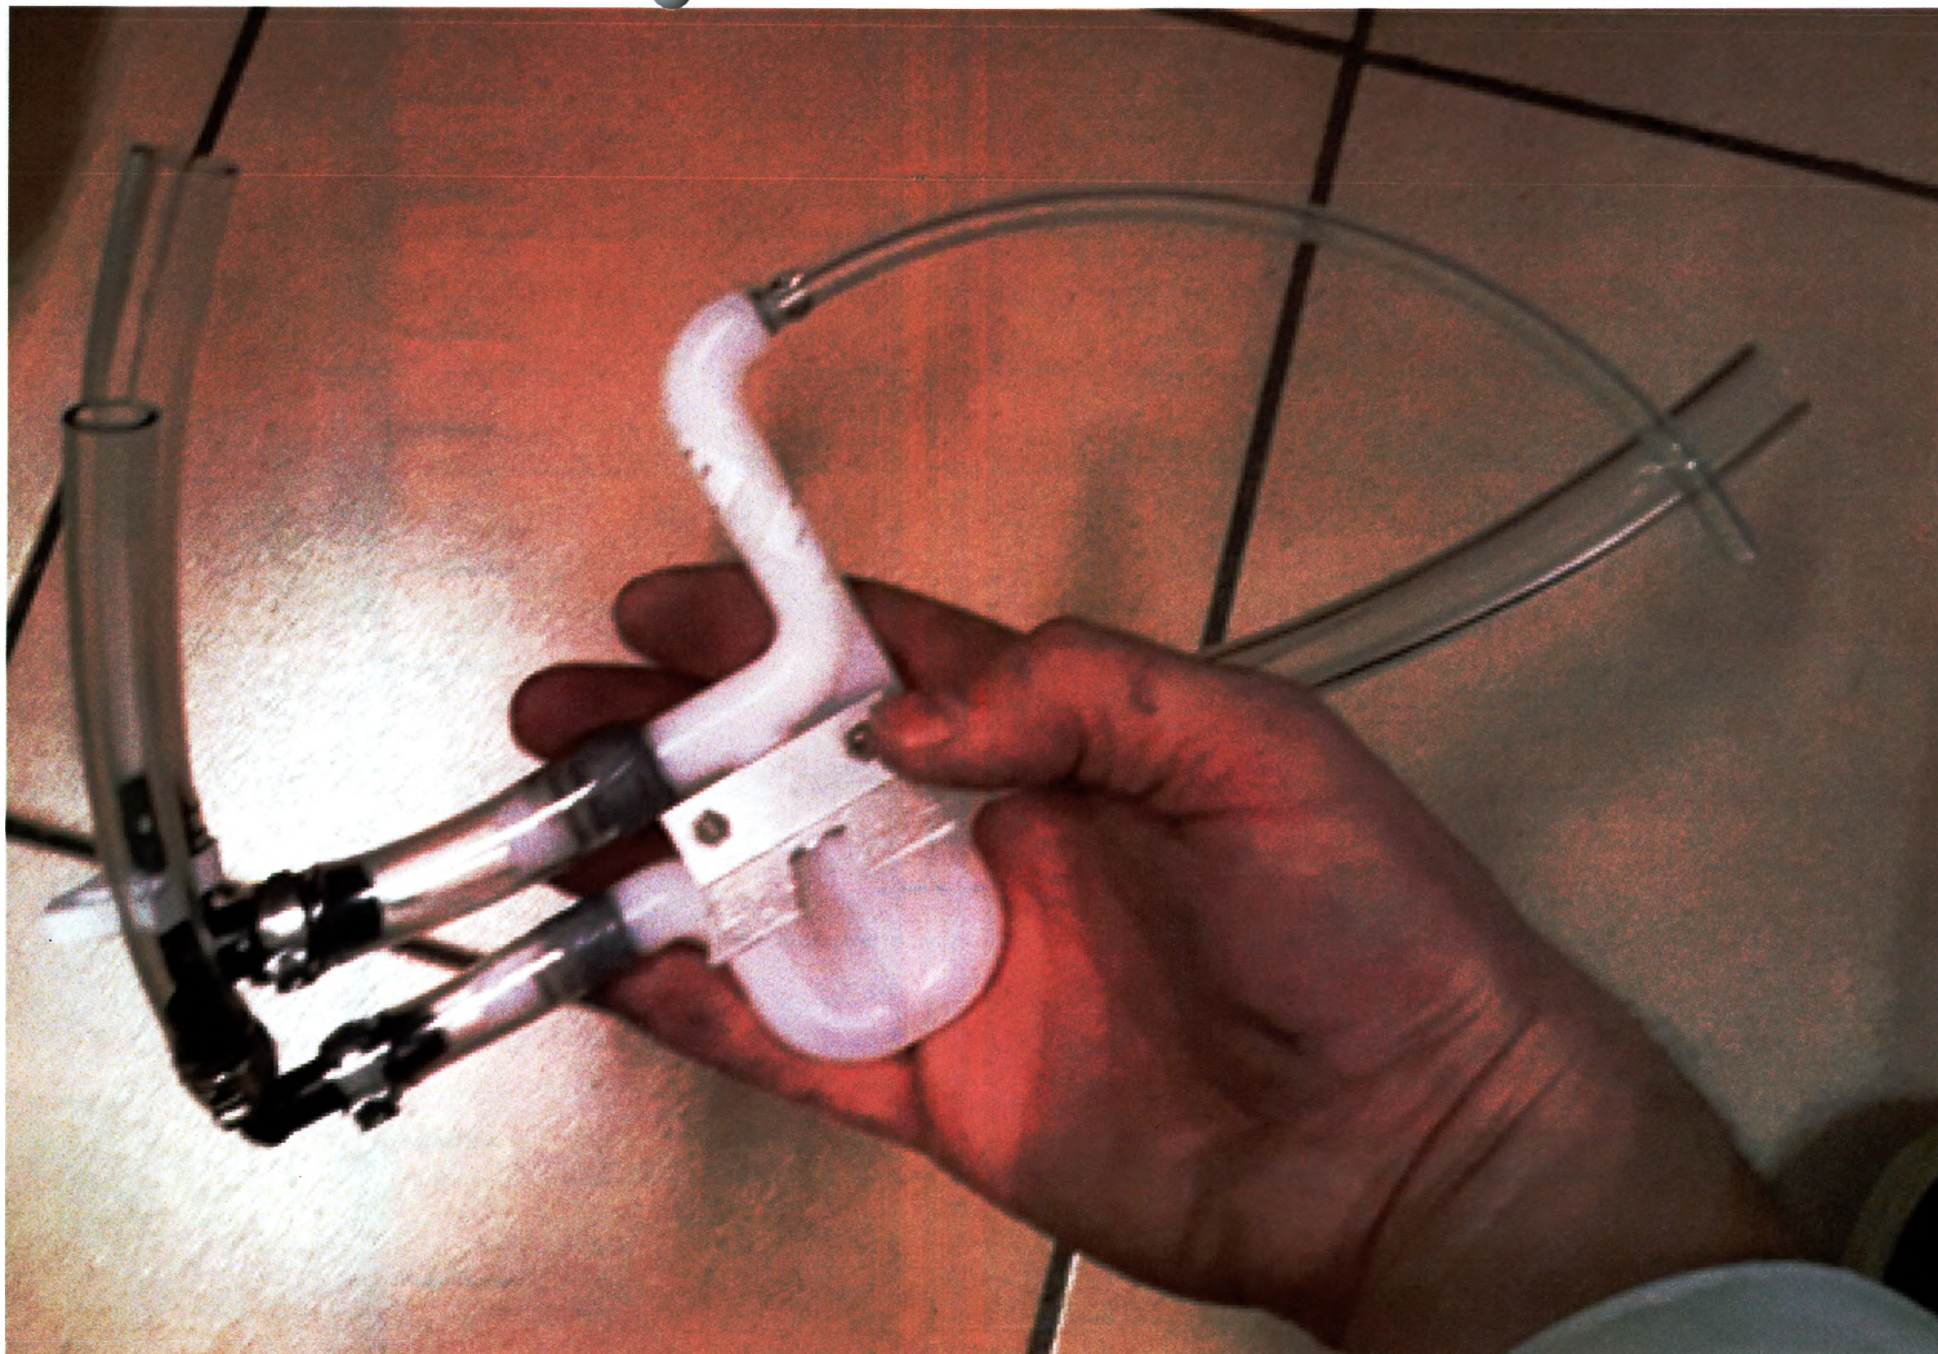


Рисунок 19. Коллектор жидкостной системы

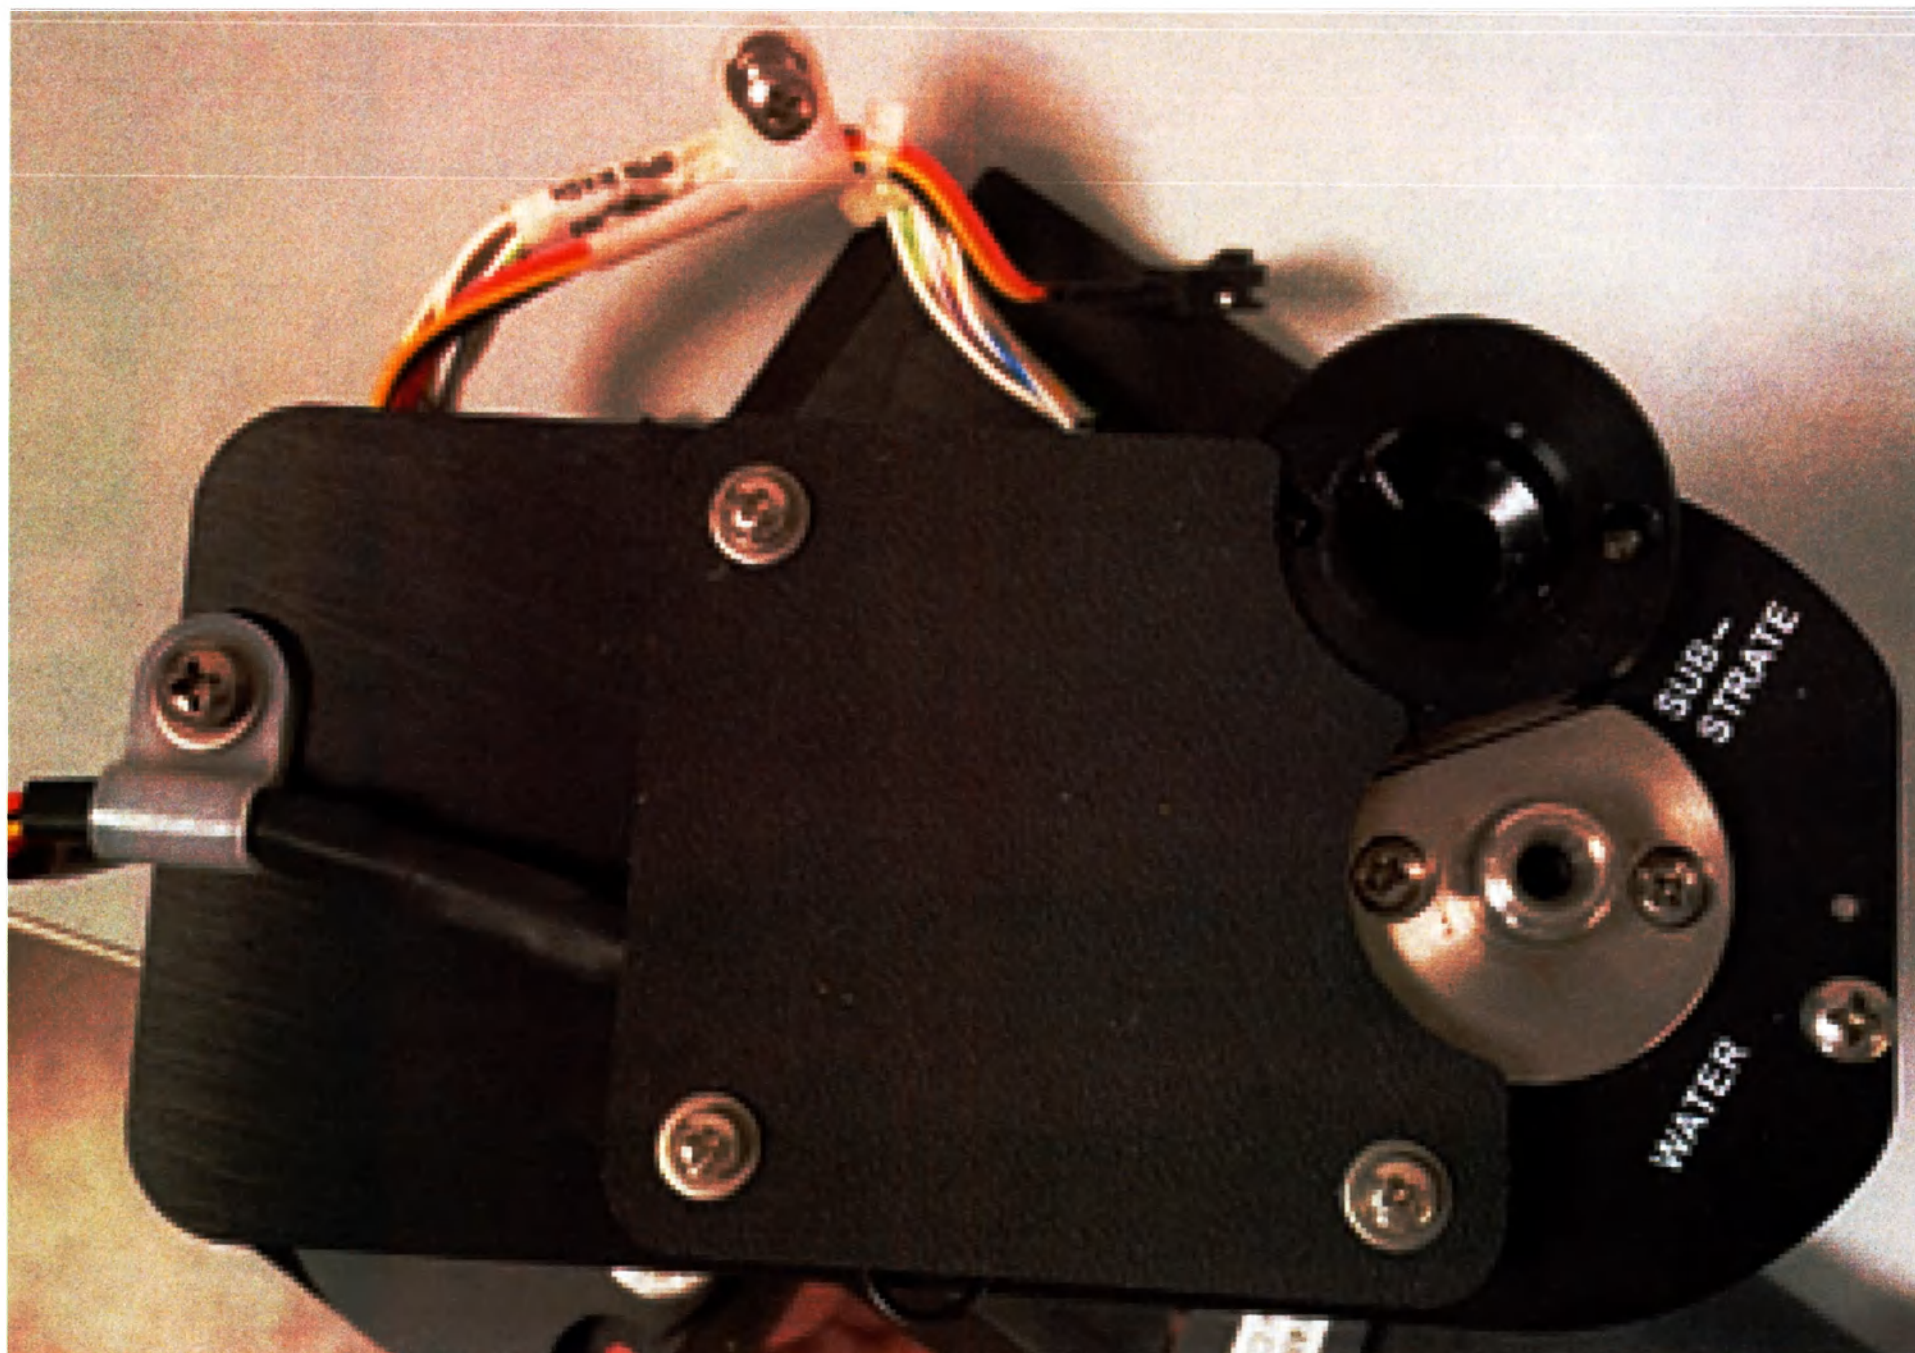


Рисунок 20. Колодец промывки

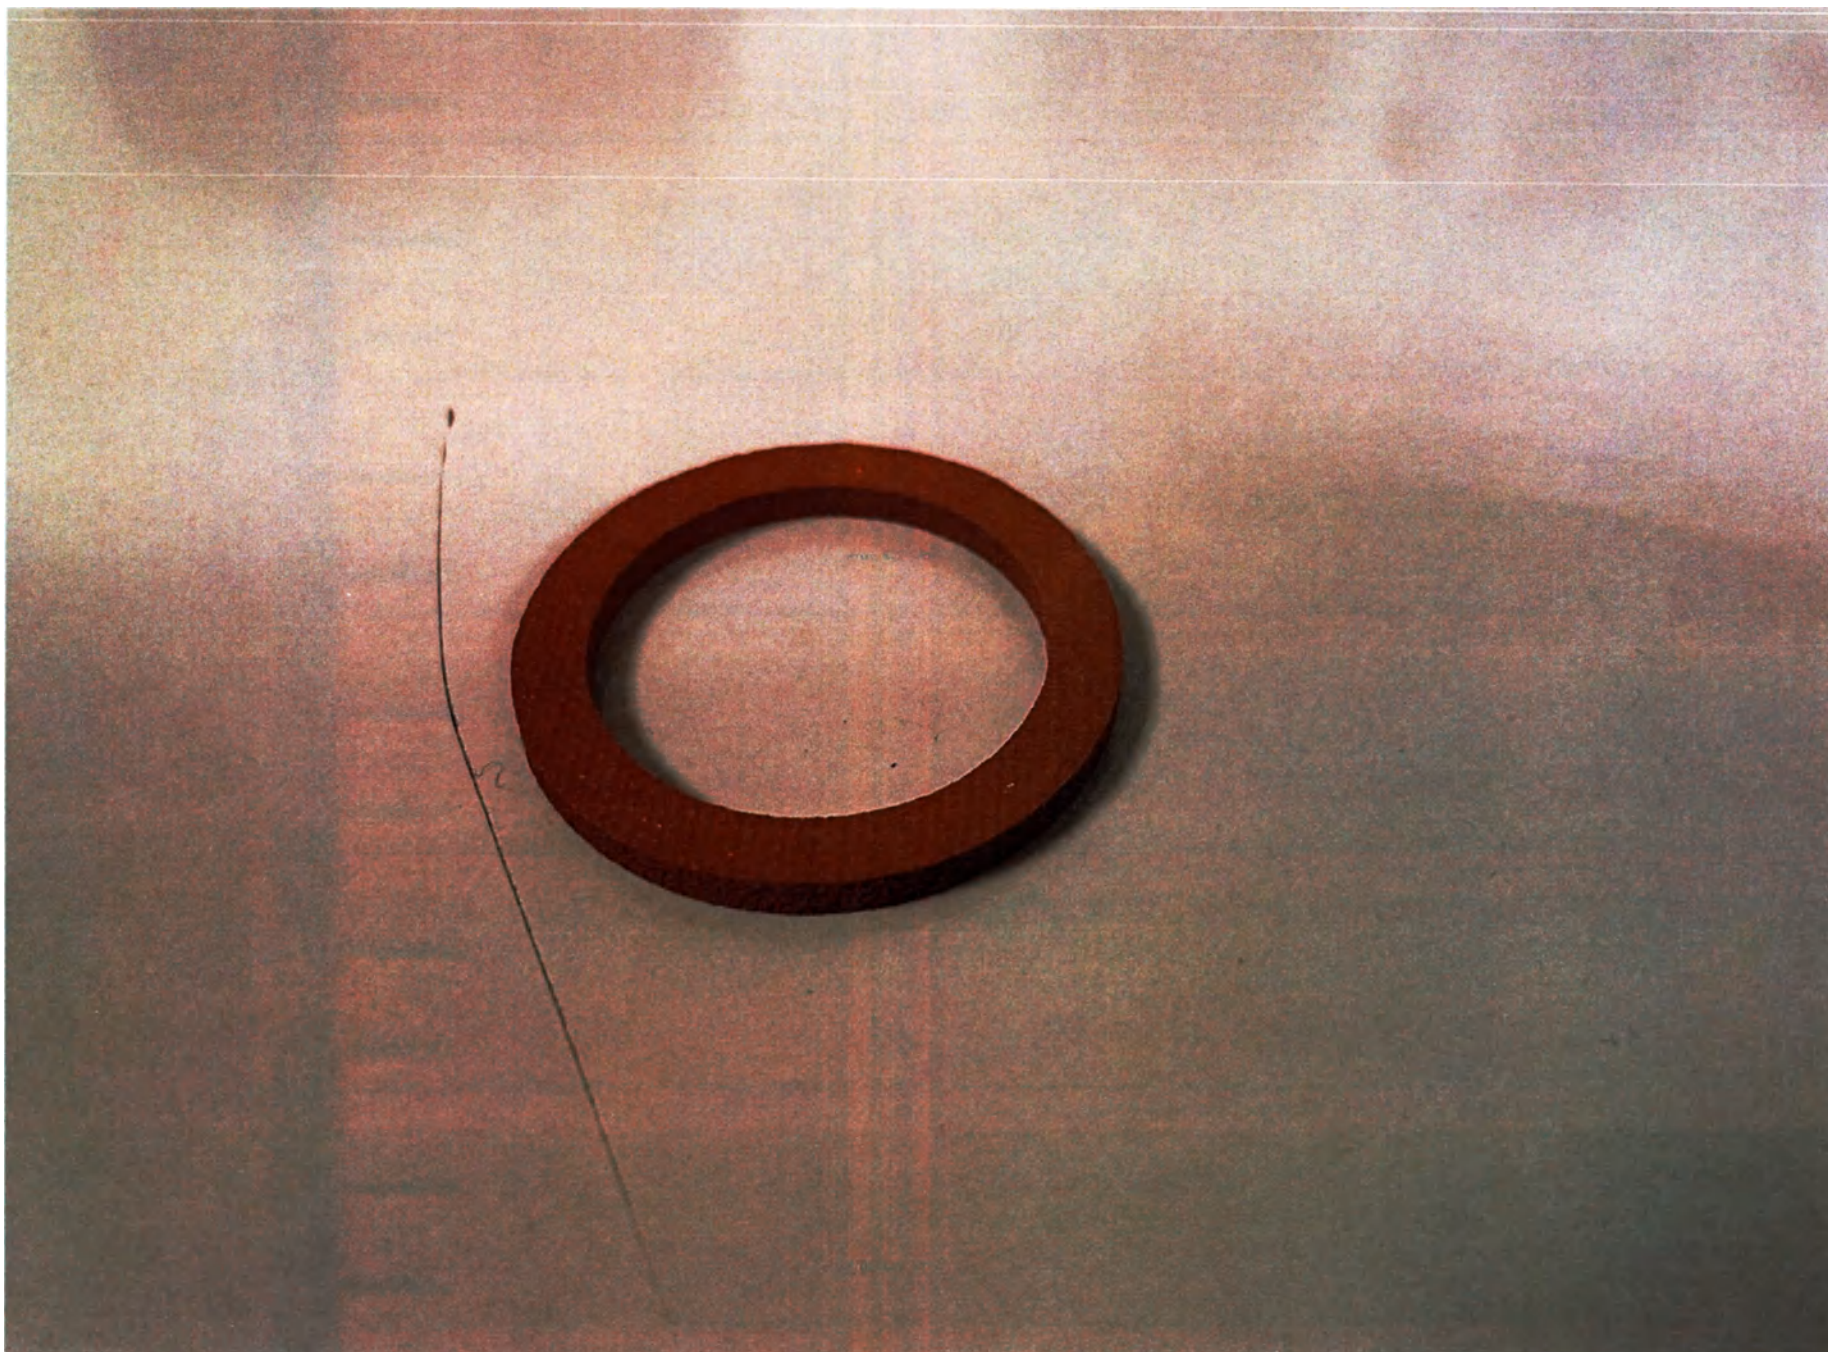
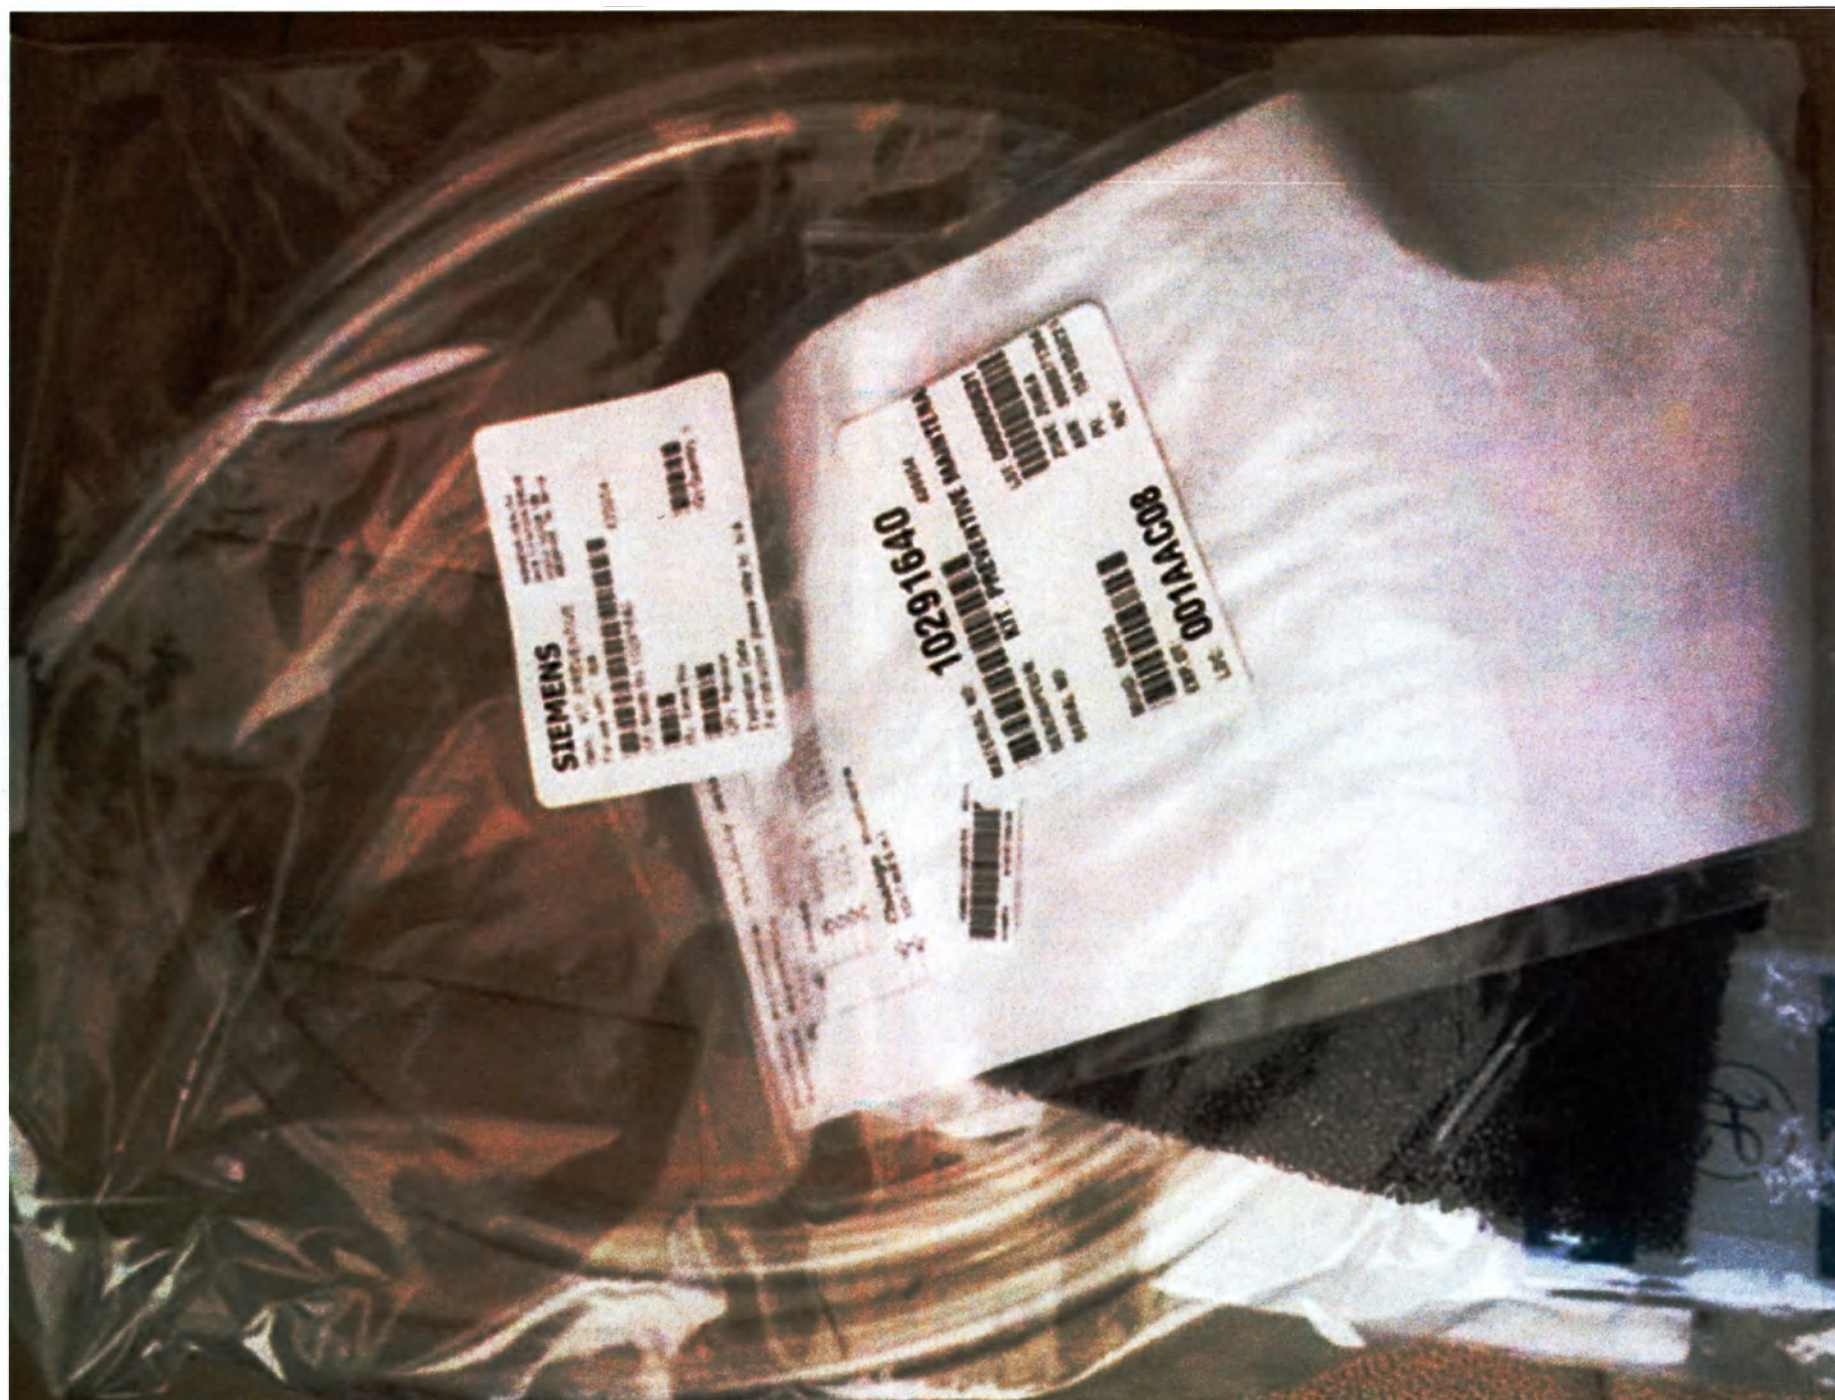


Рисунок 21. Кольца уплотнительные



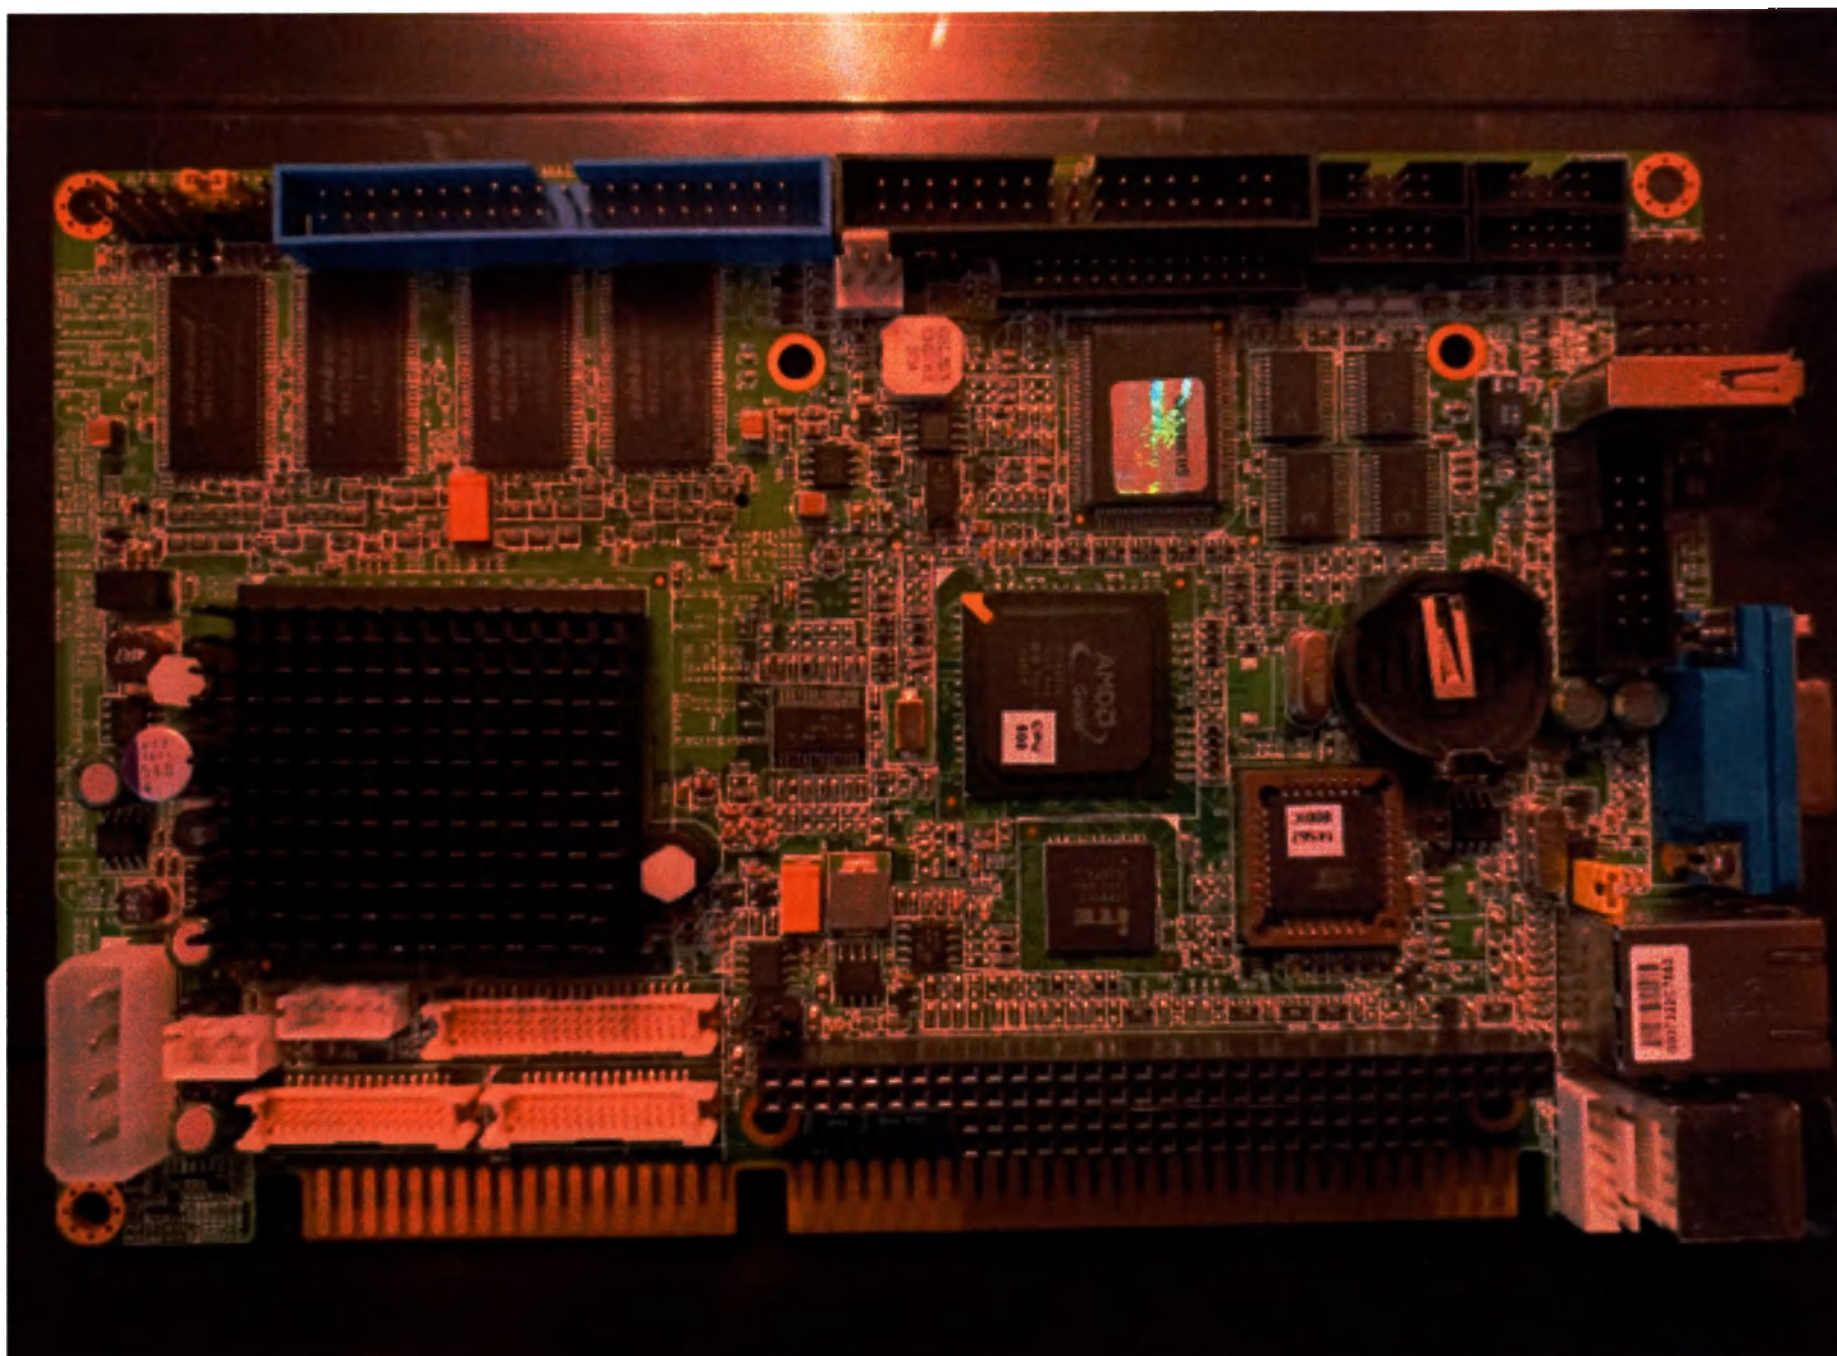


Рисунок 23. Компьютер анализатора

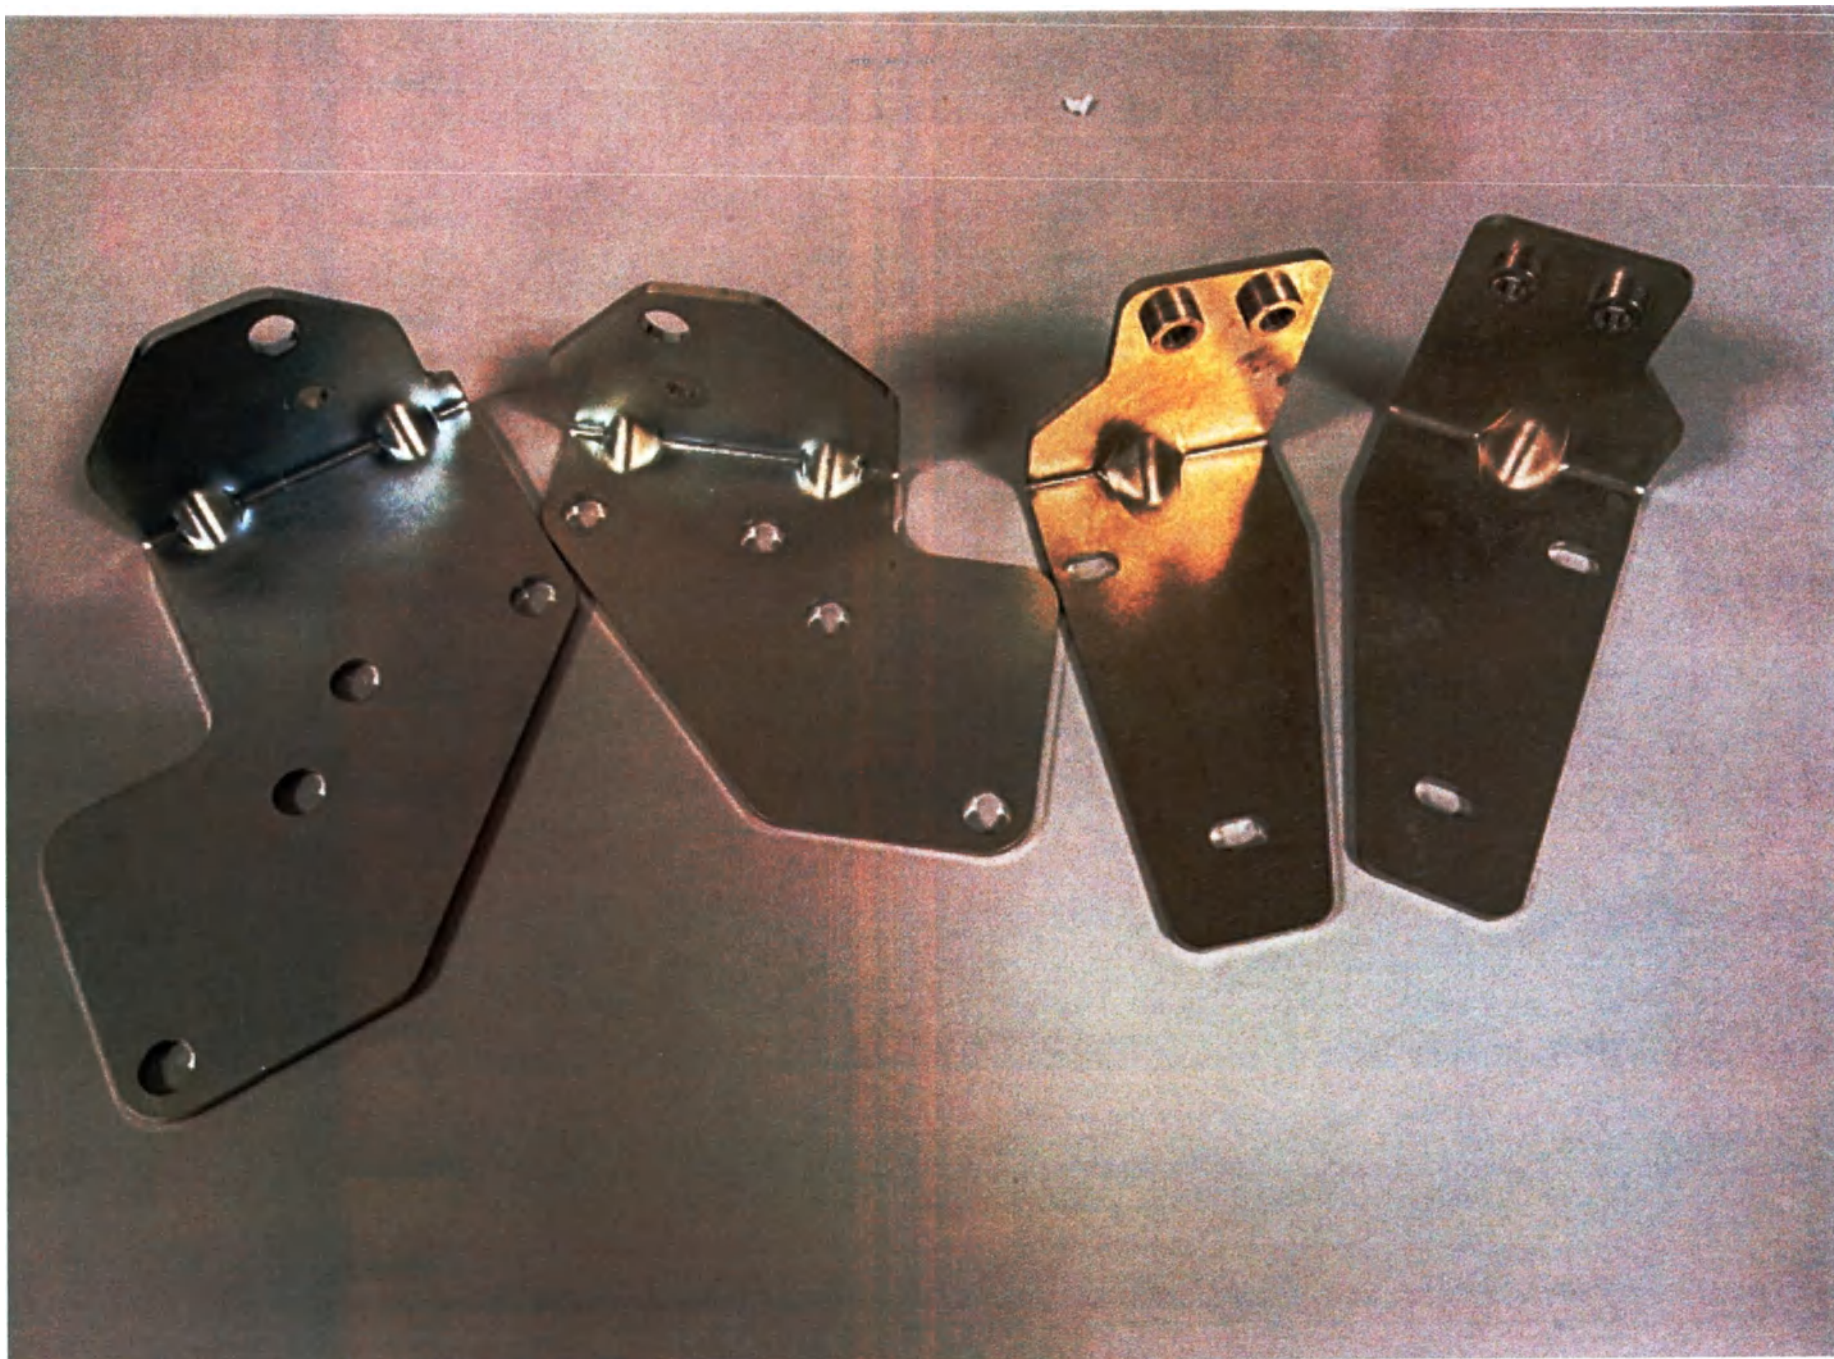


Рисунок 24. Крепежи для подсоединения анализаторов в различной конфигурации

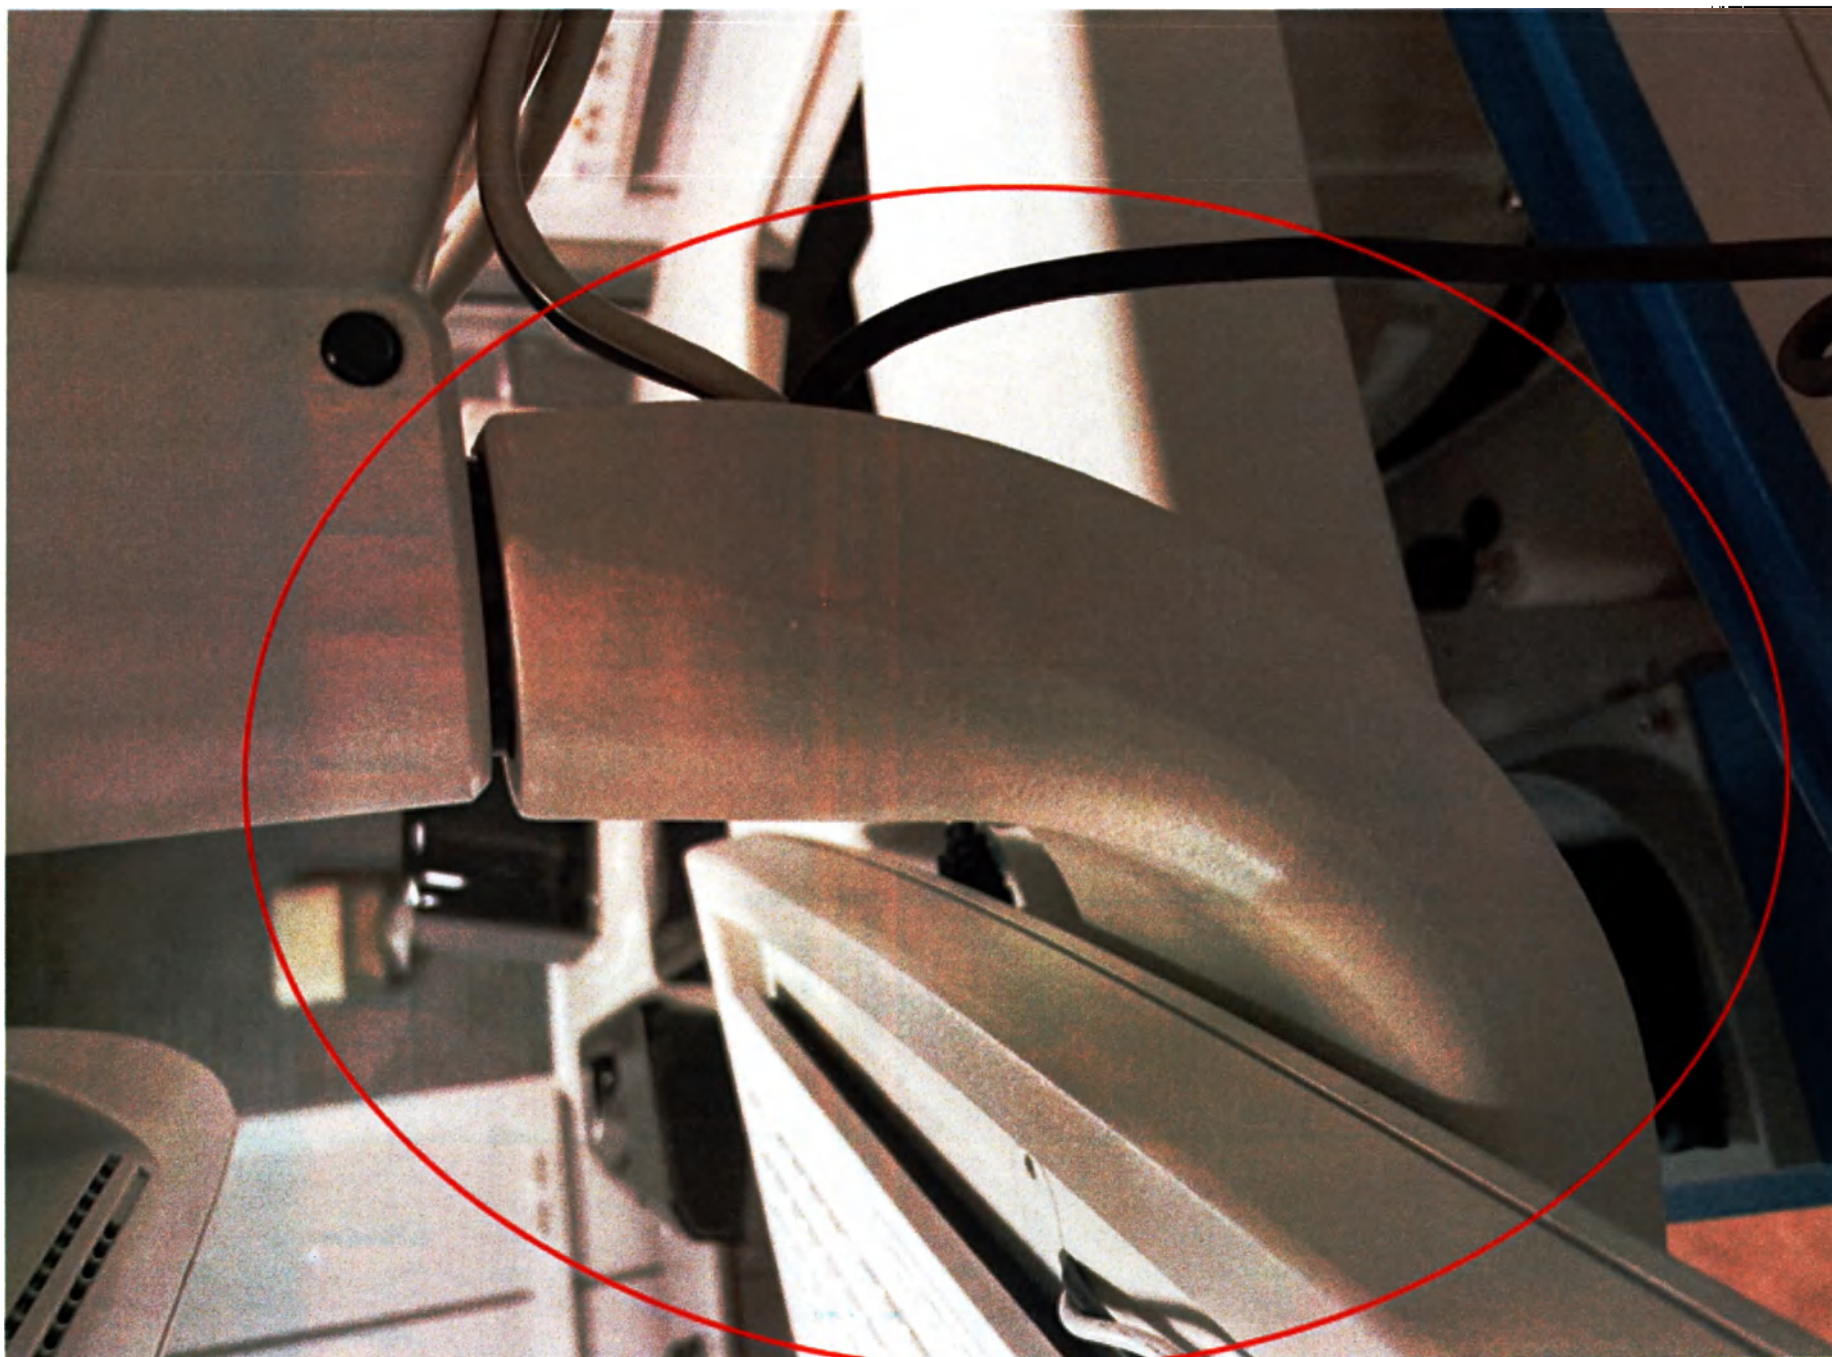


Рисунок 25. Кронштейны

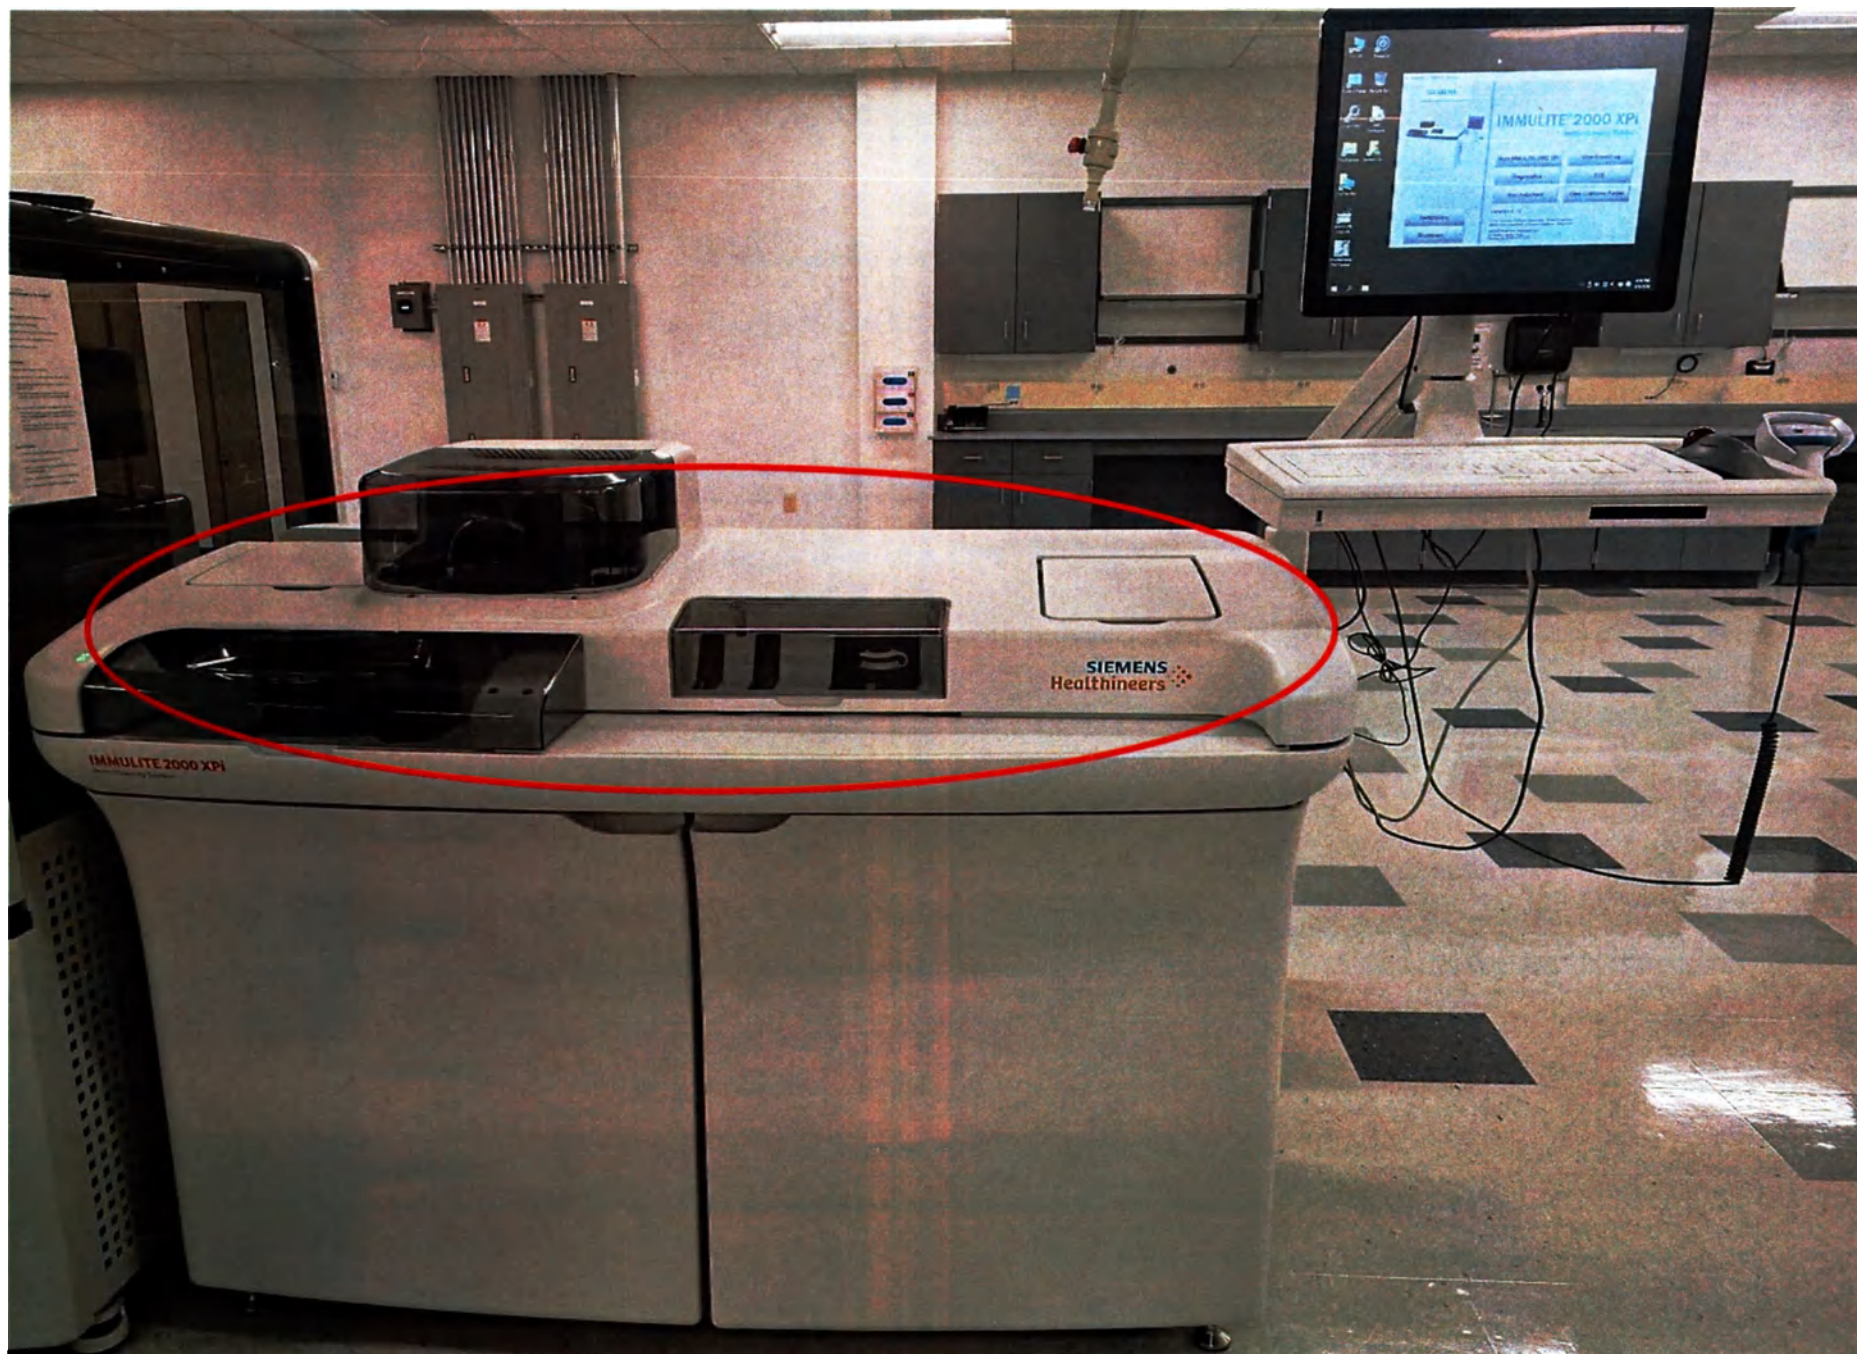


Рисунок 26. Крышки анализатора с отверстием и без

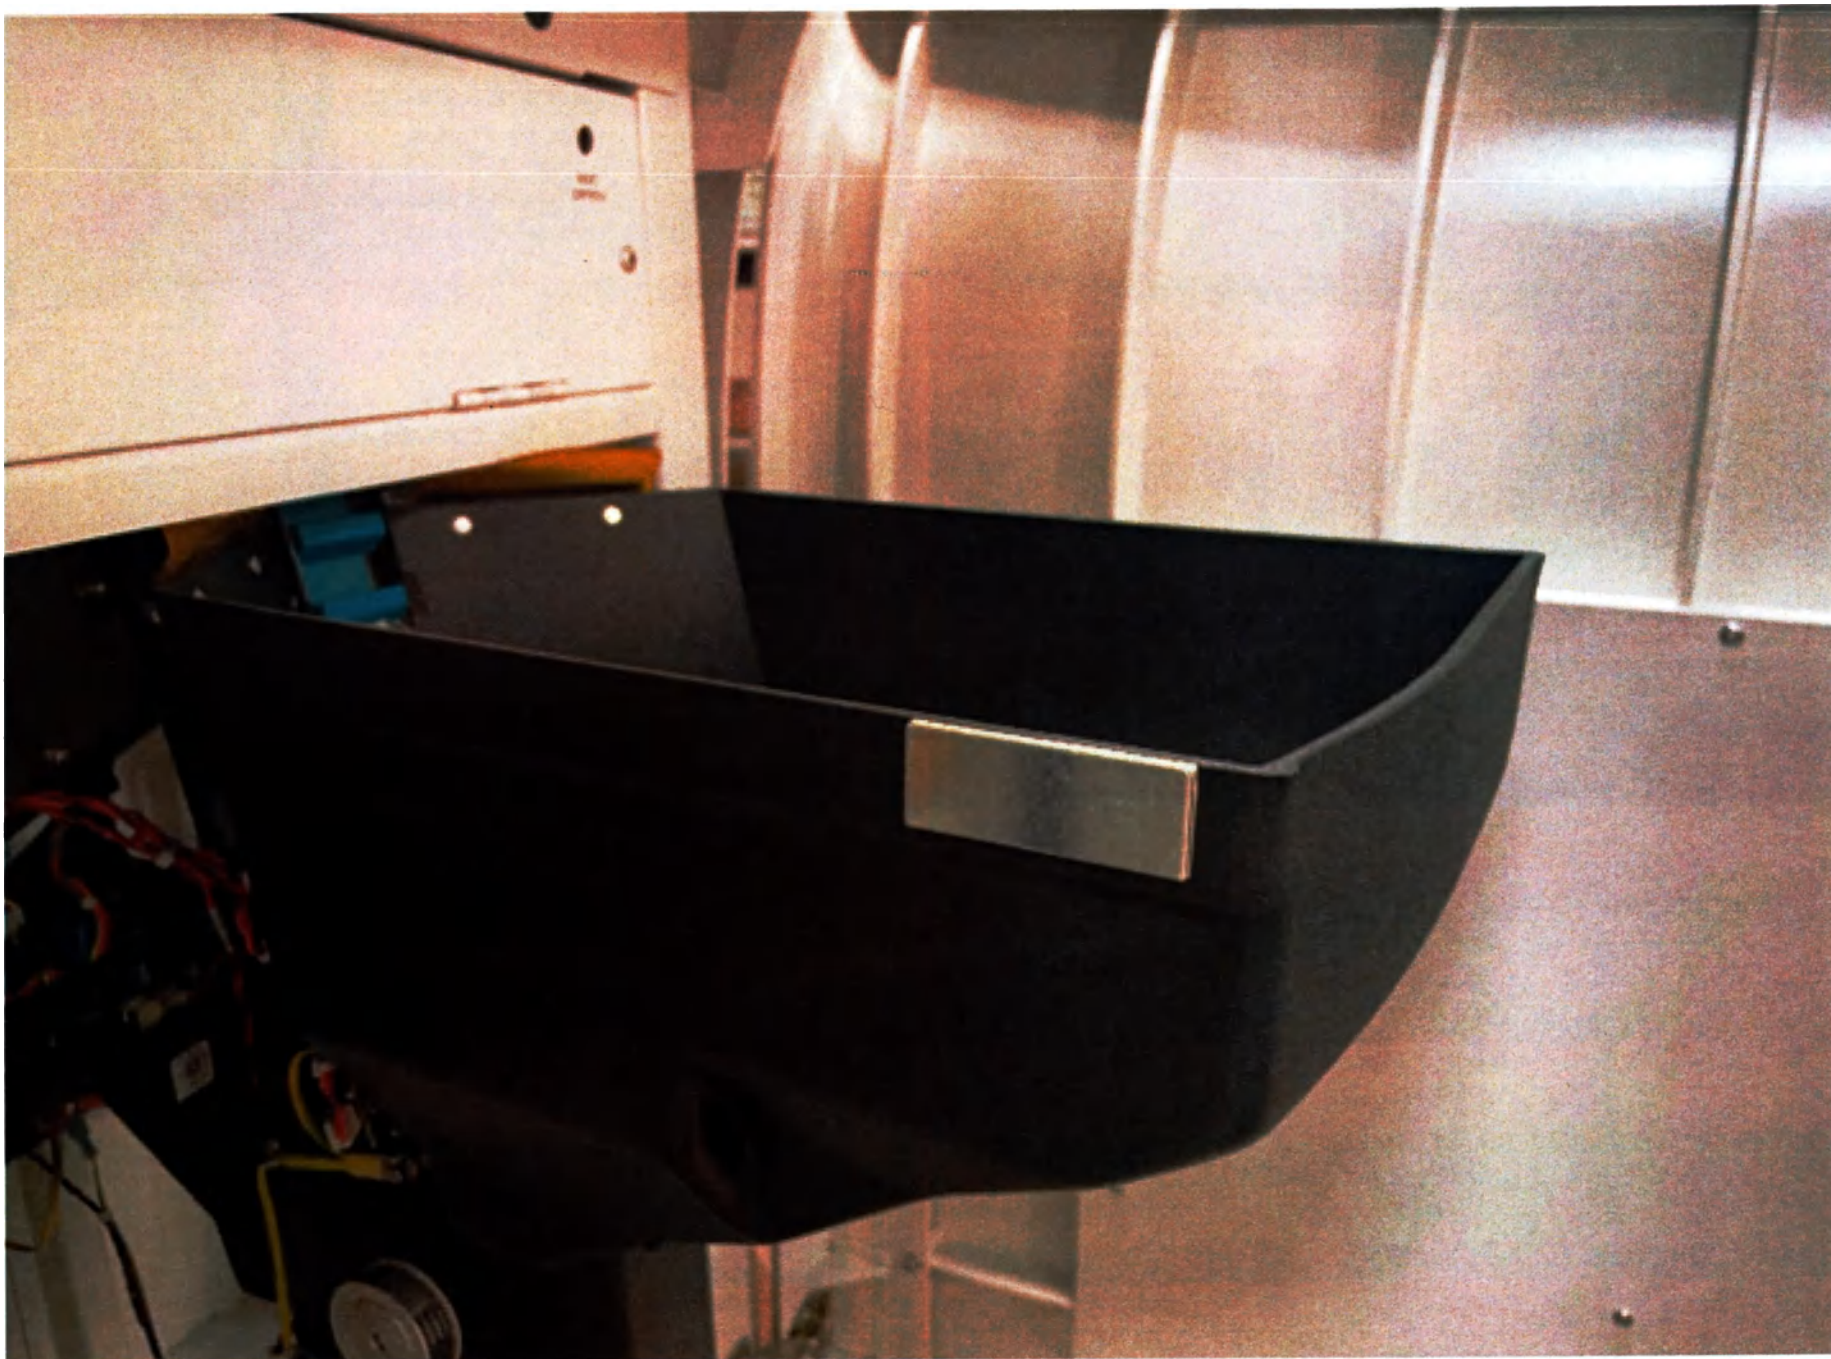


Рисунок 27. Лоток для реакционных пробирок

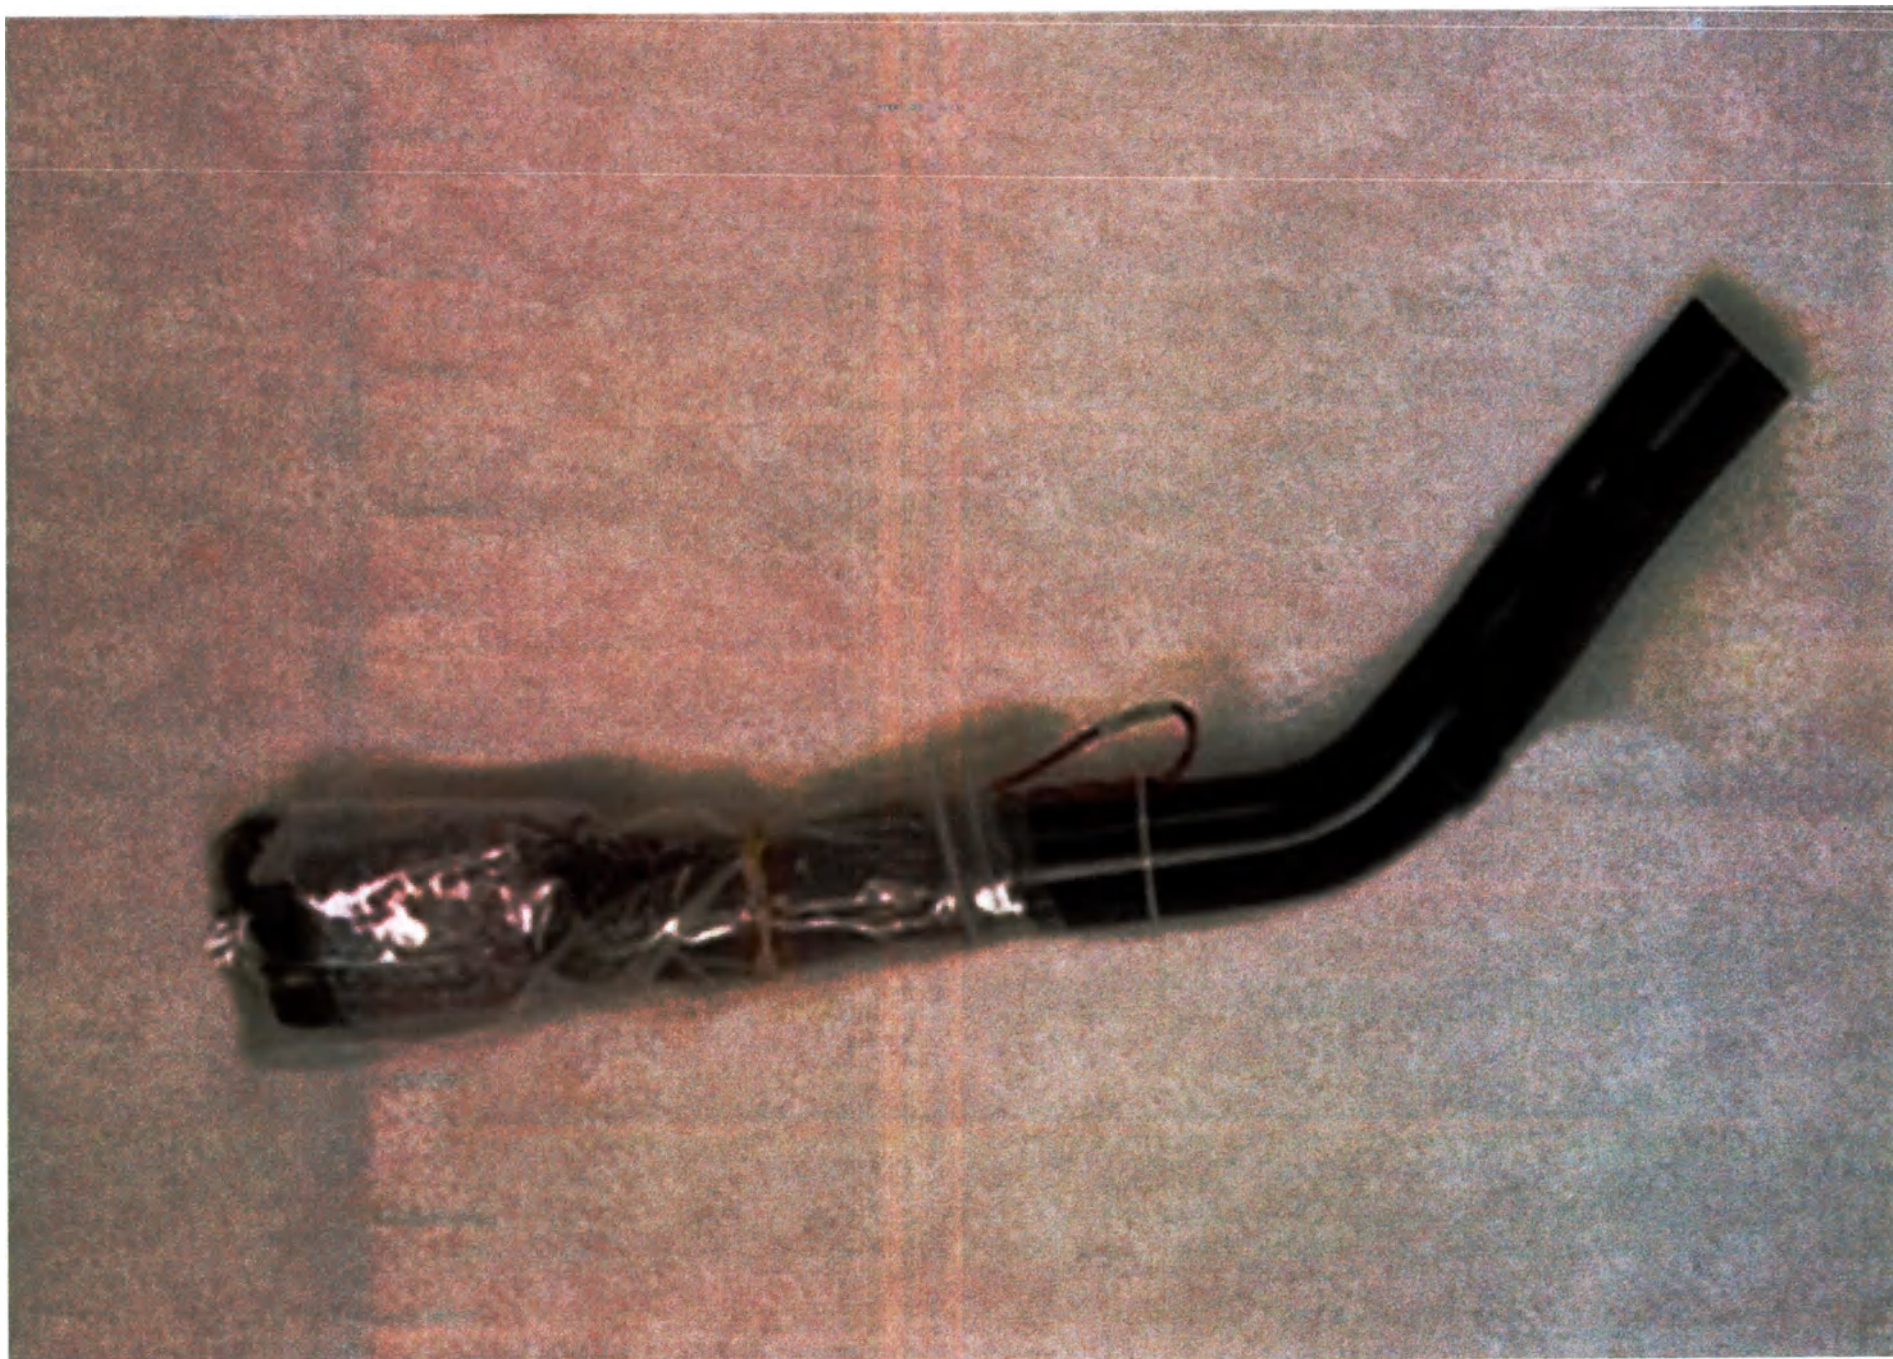


Рисунок 28. Лоток для сбора пробирок с пробами

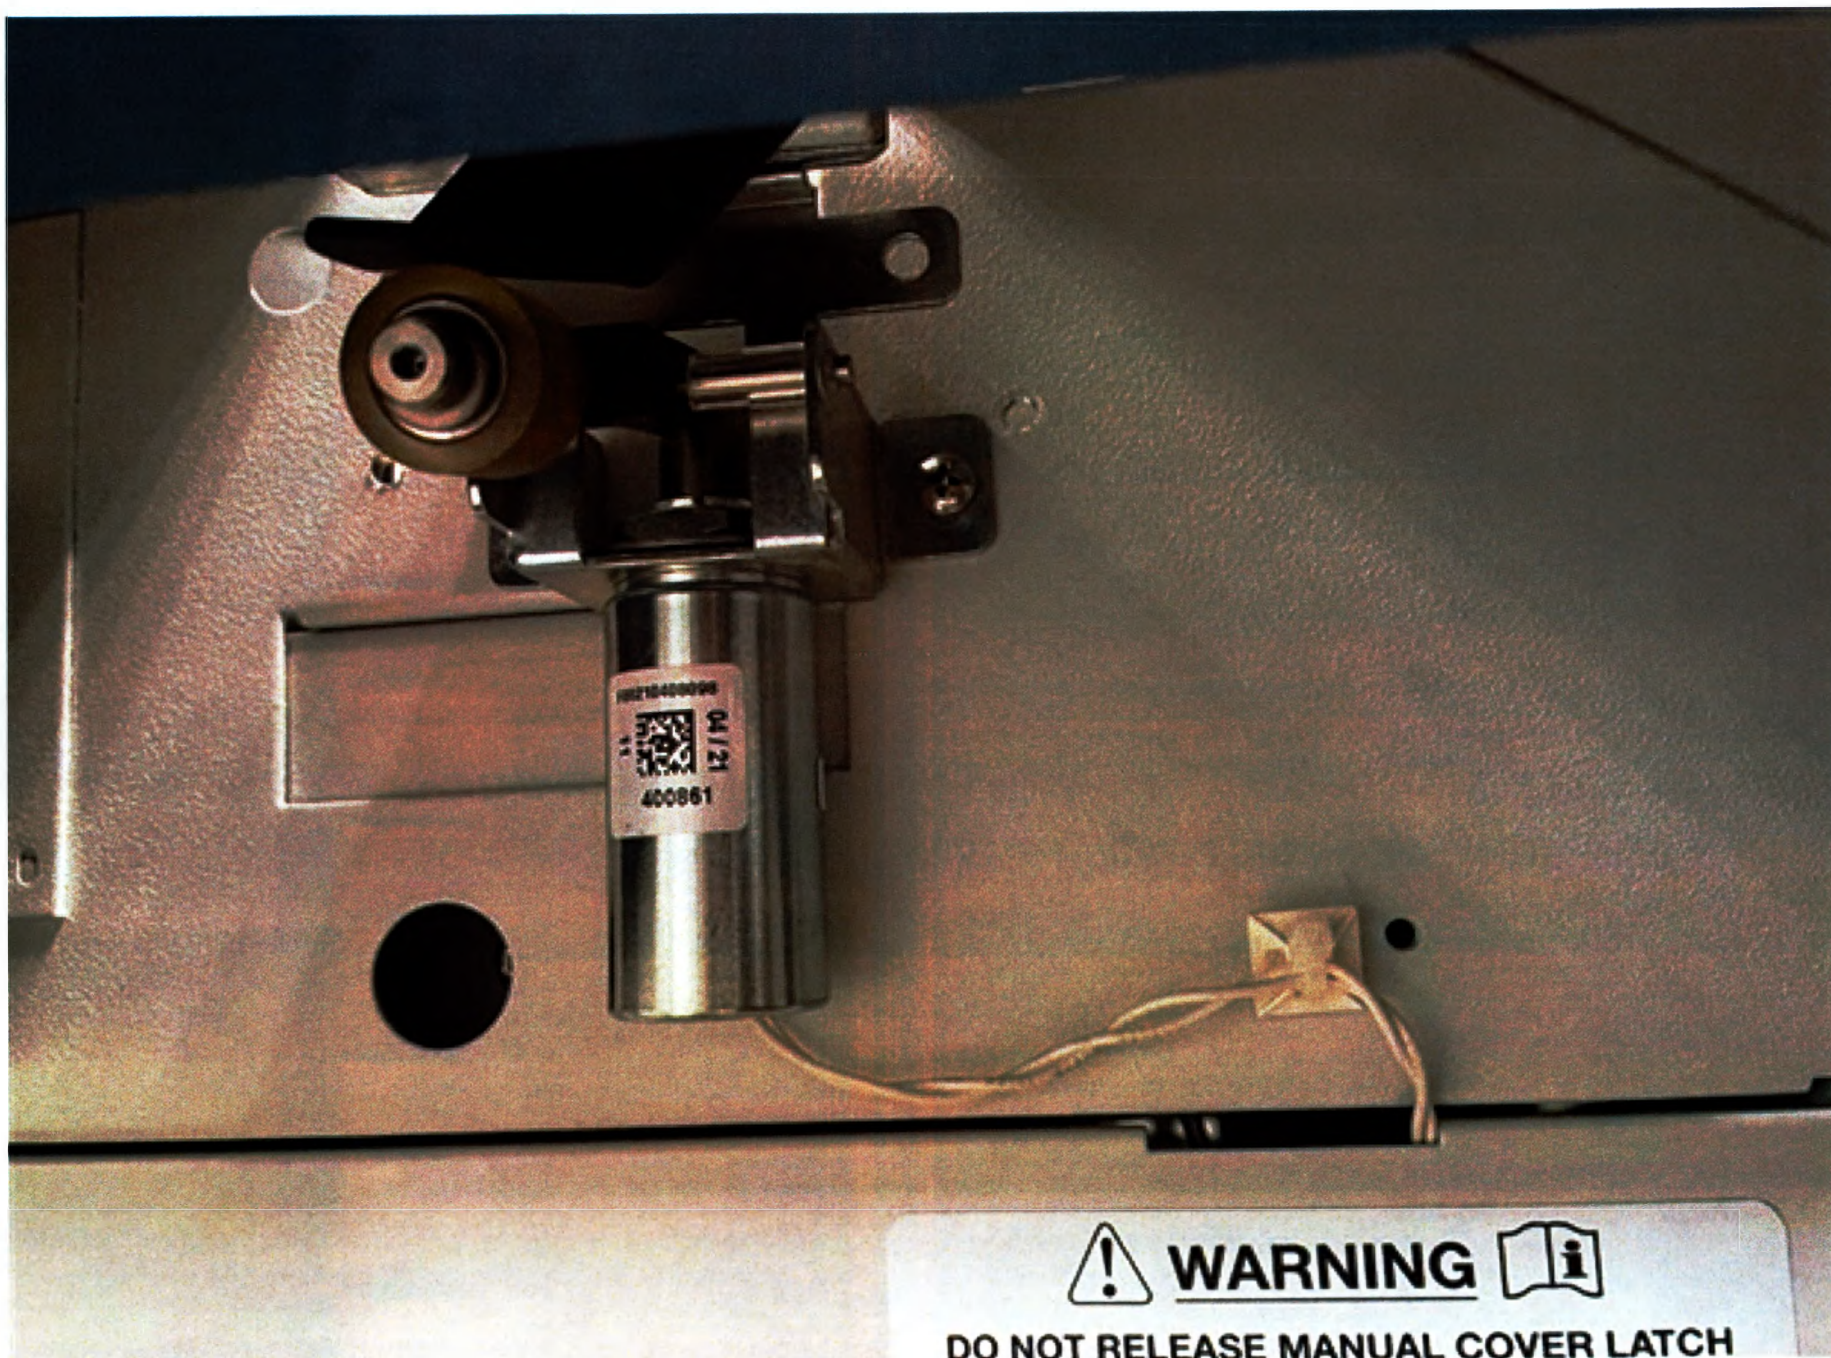


Рисунок 29. Магнитные замки

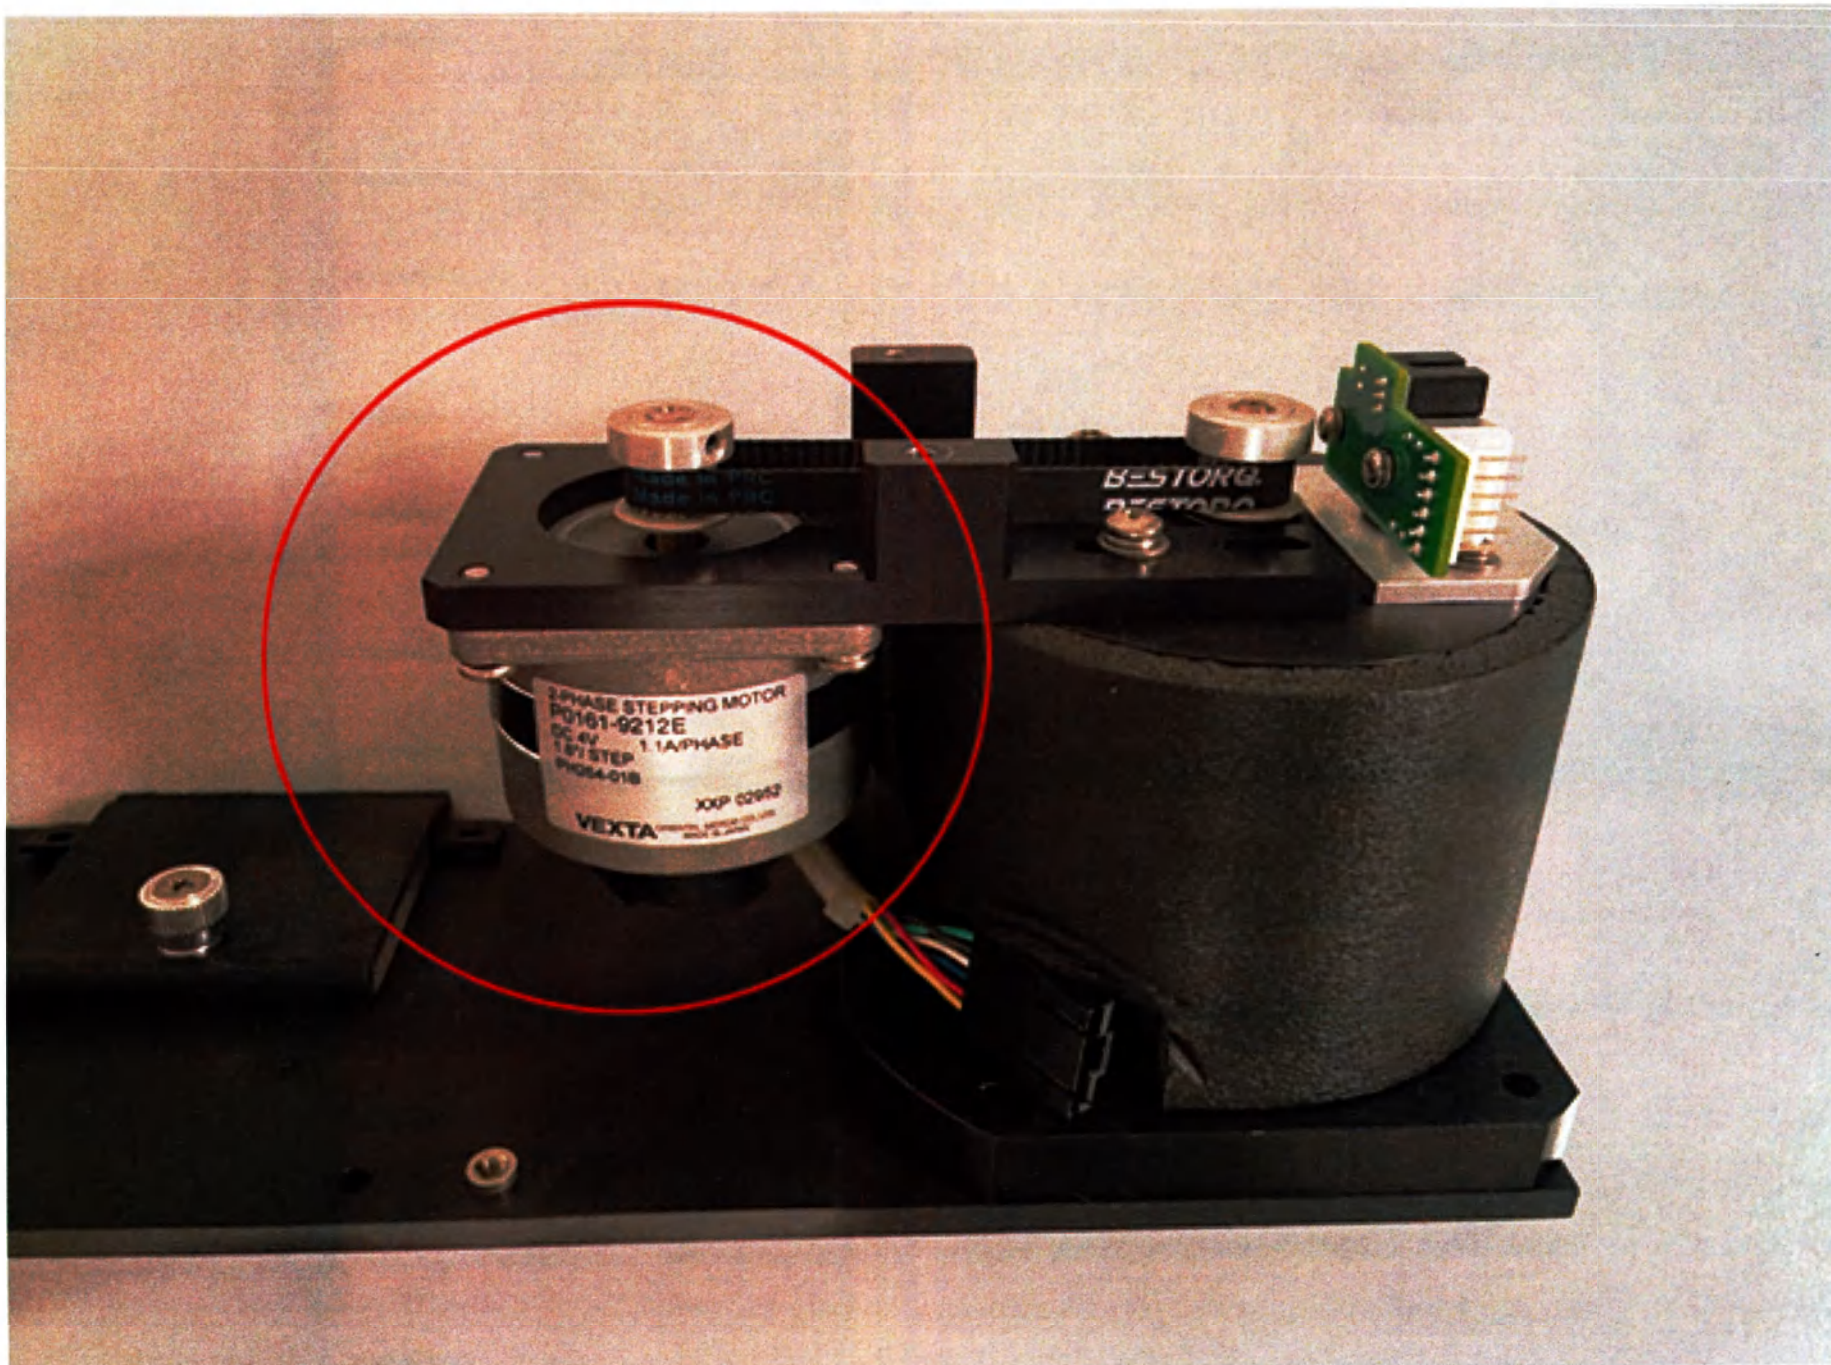


Рисунок 30. Моторы различной мощности



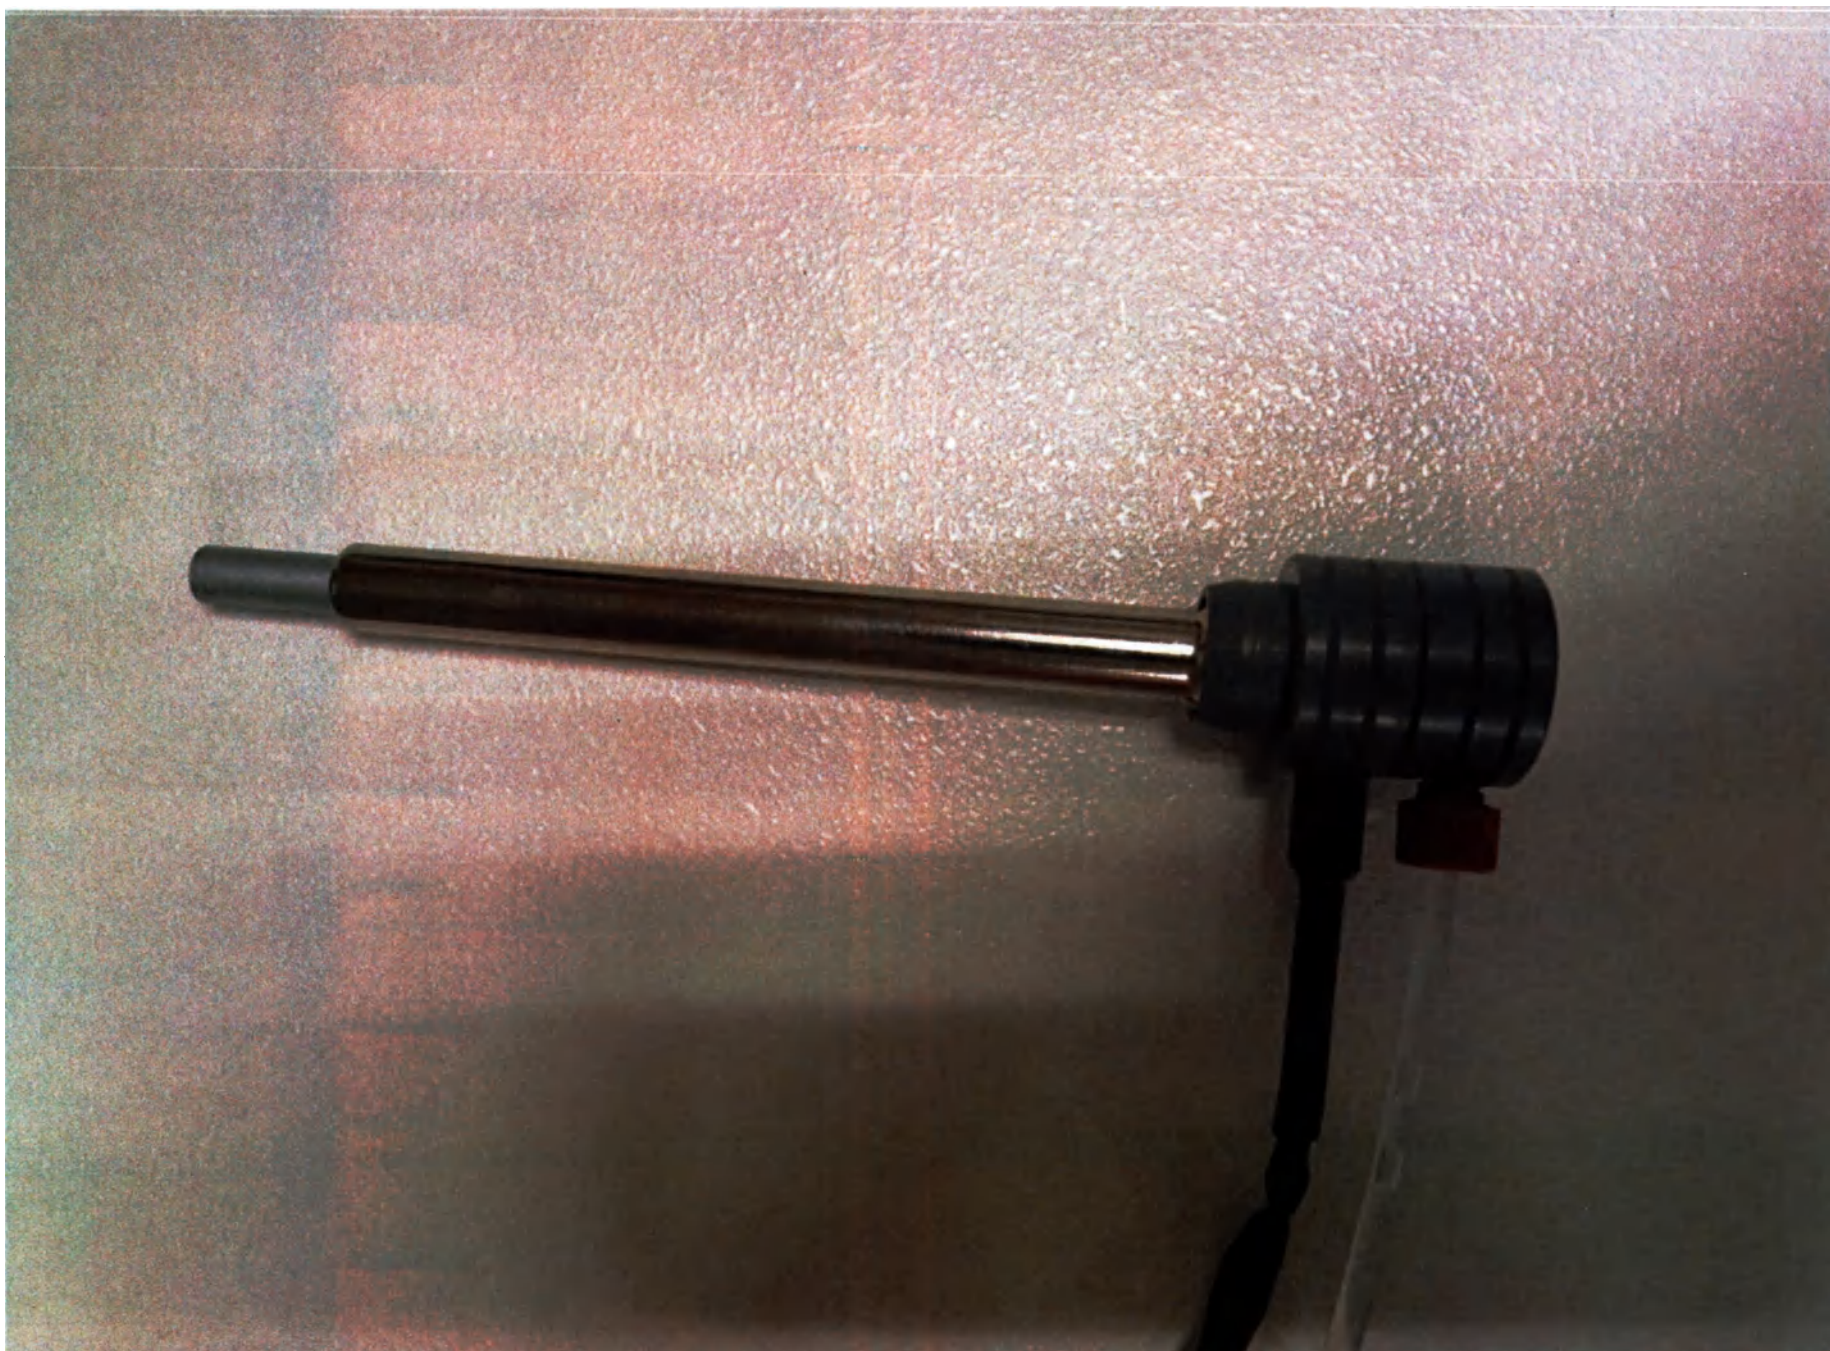


Рисунок 32. Нагреватель субстрата

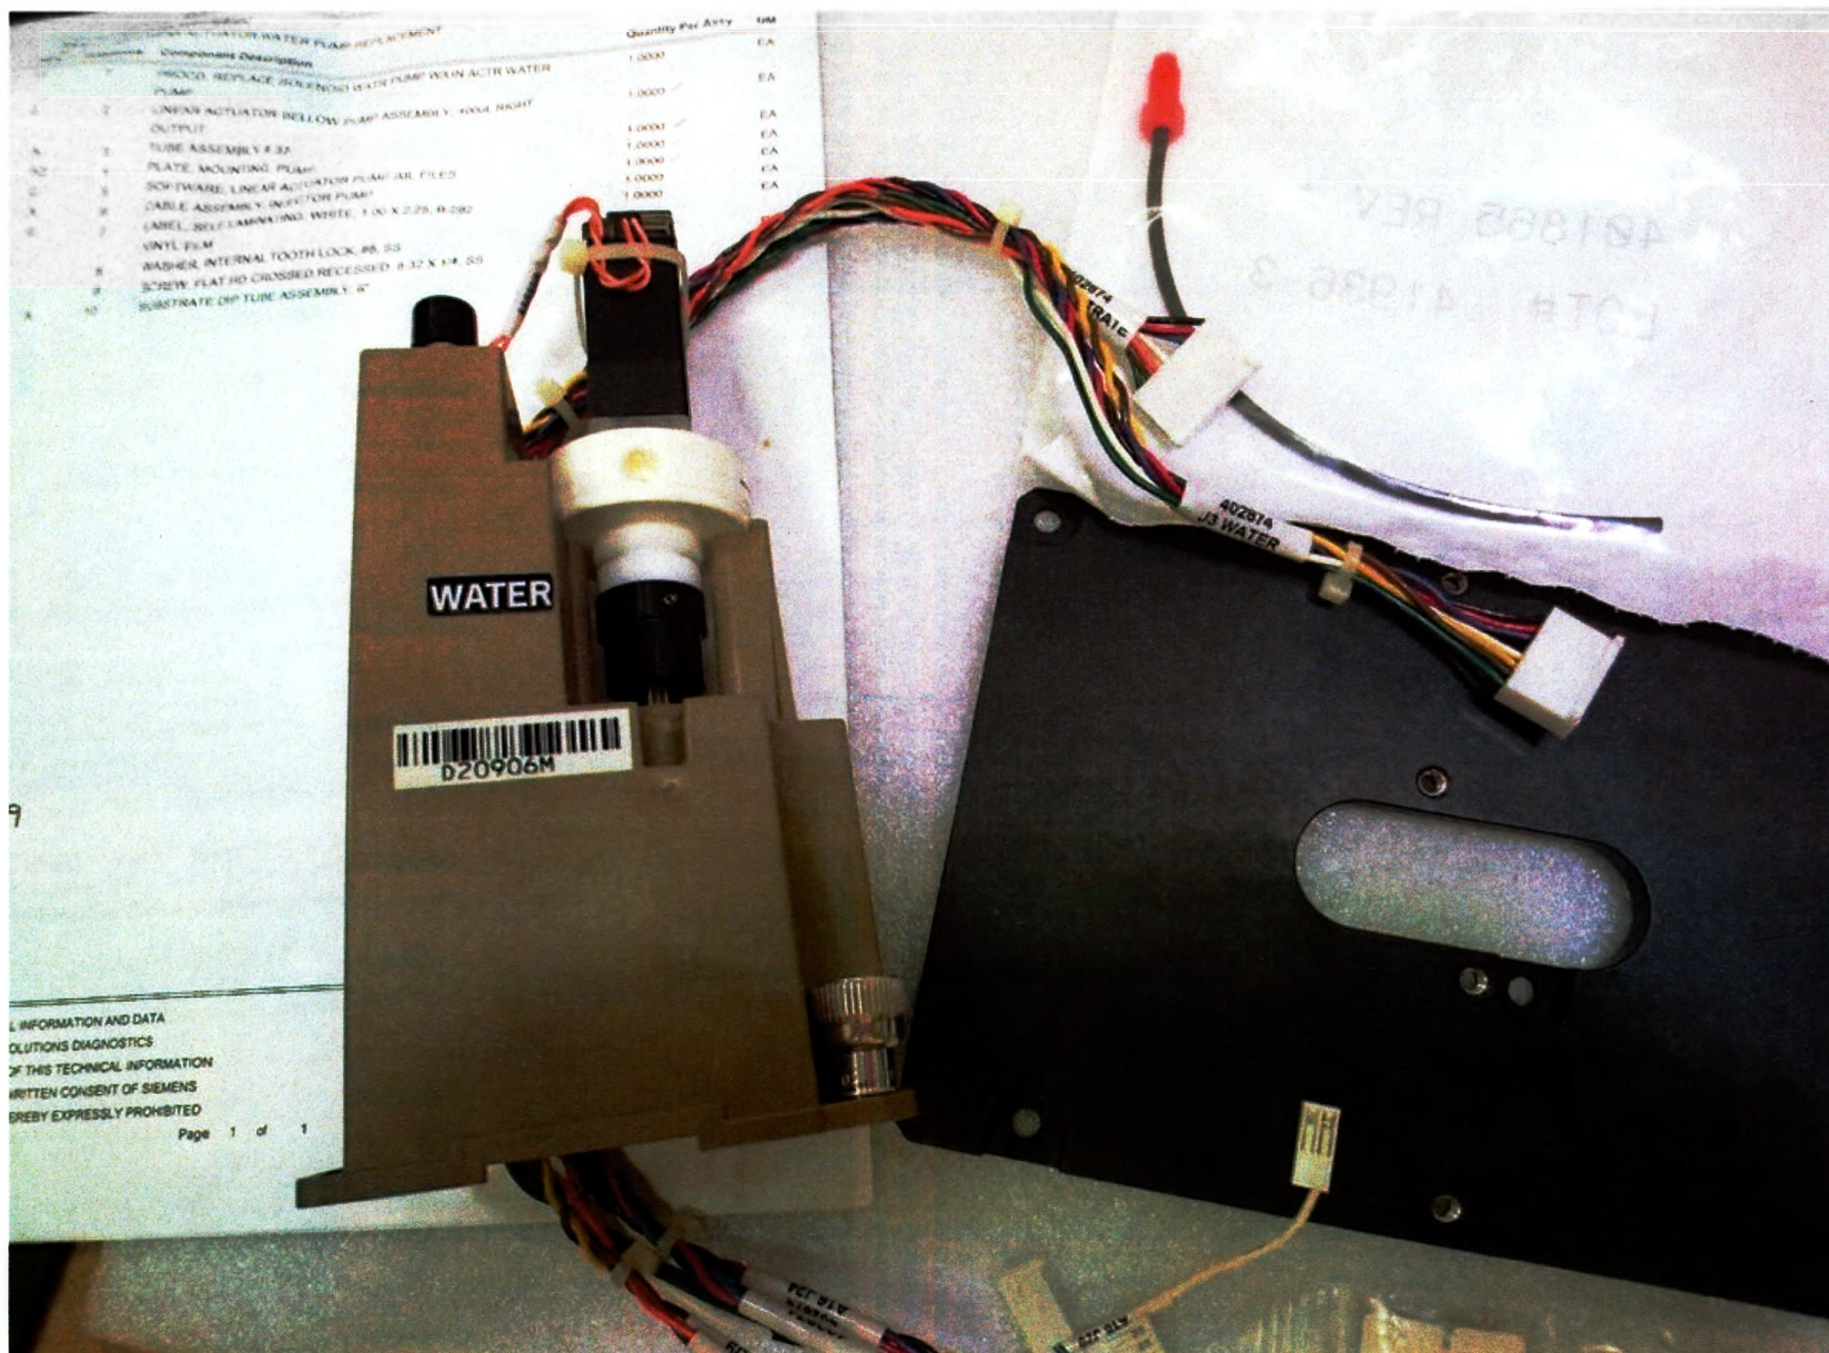


Рисунок 33. Насосы разные

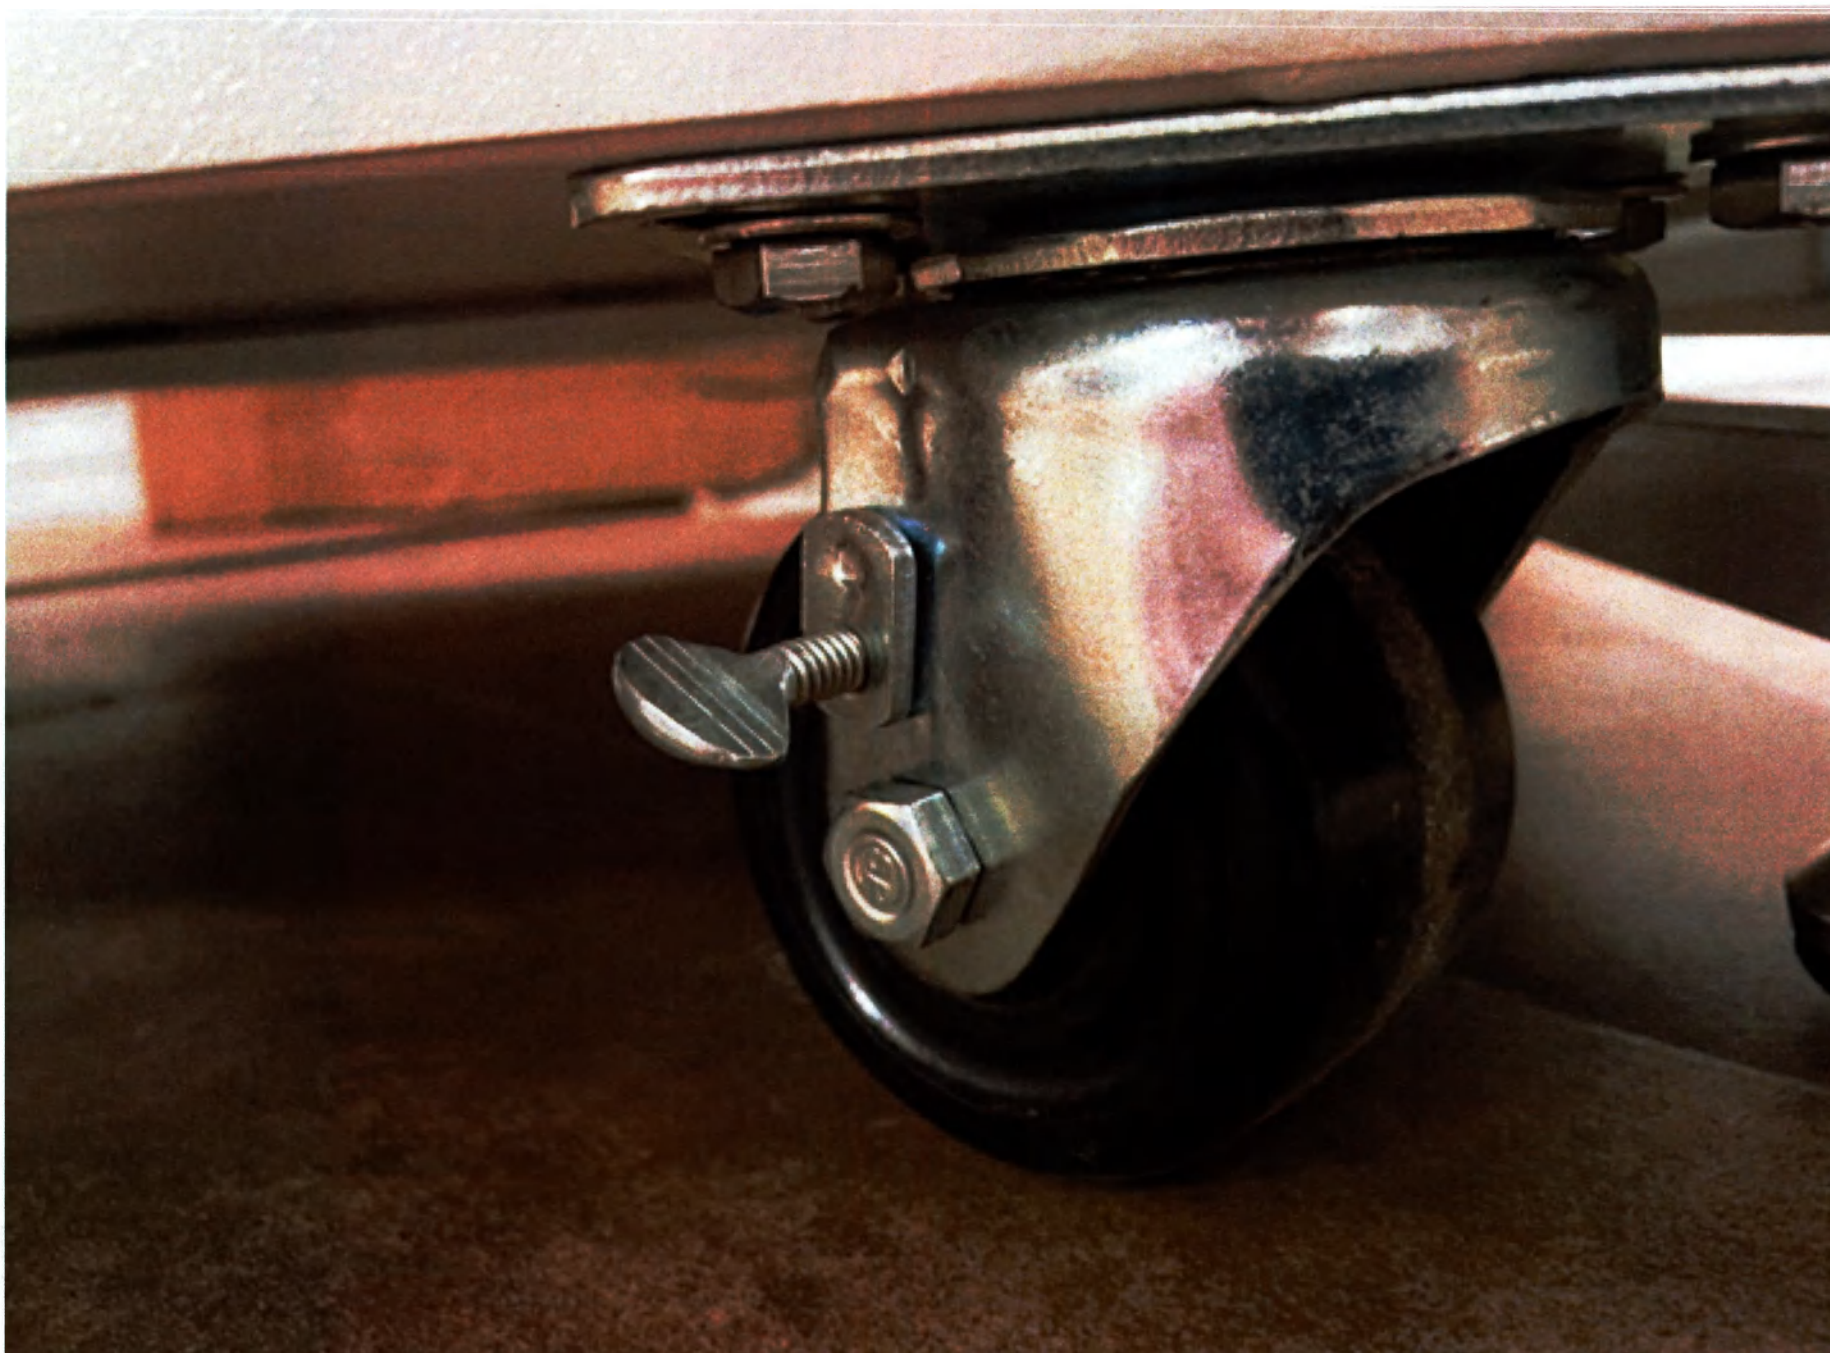


Рисунок 34. Ножки к прибору



Рисунок 35. Осушитель



Рисунок 36. Пластиковые наконечники дозатора

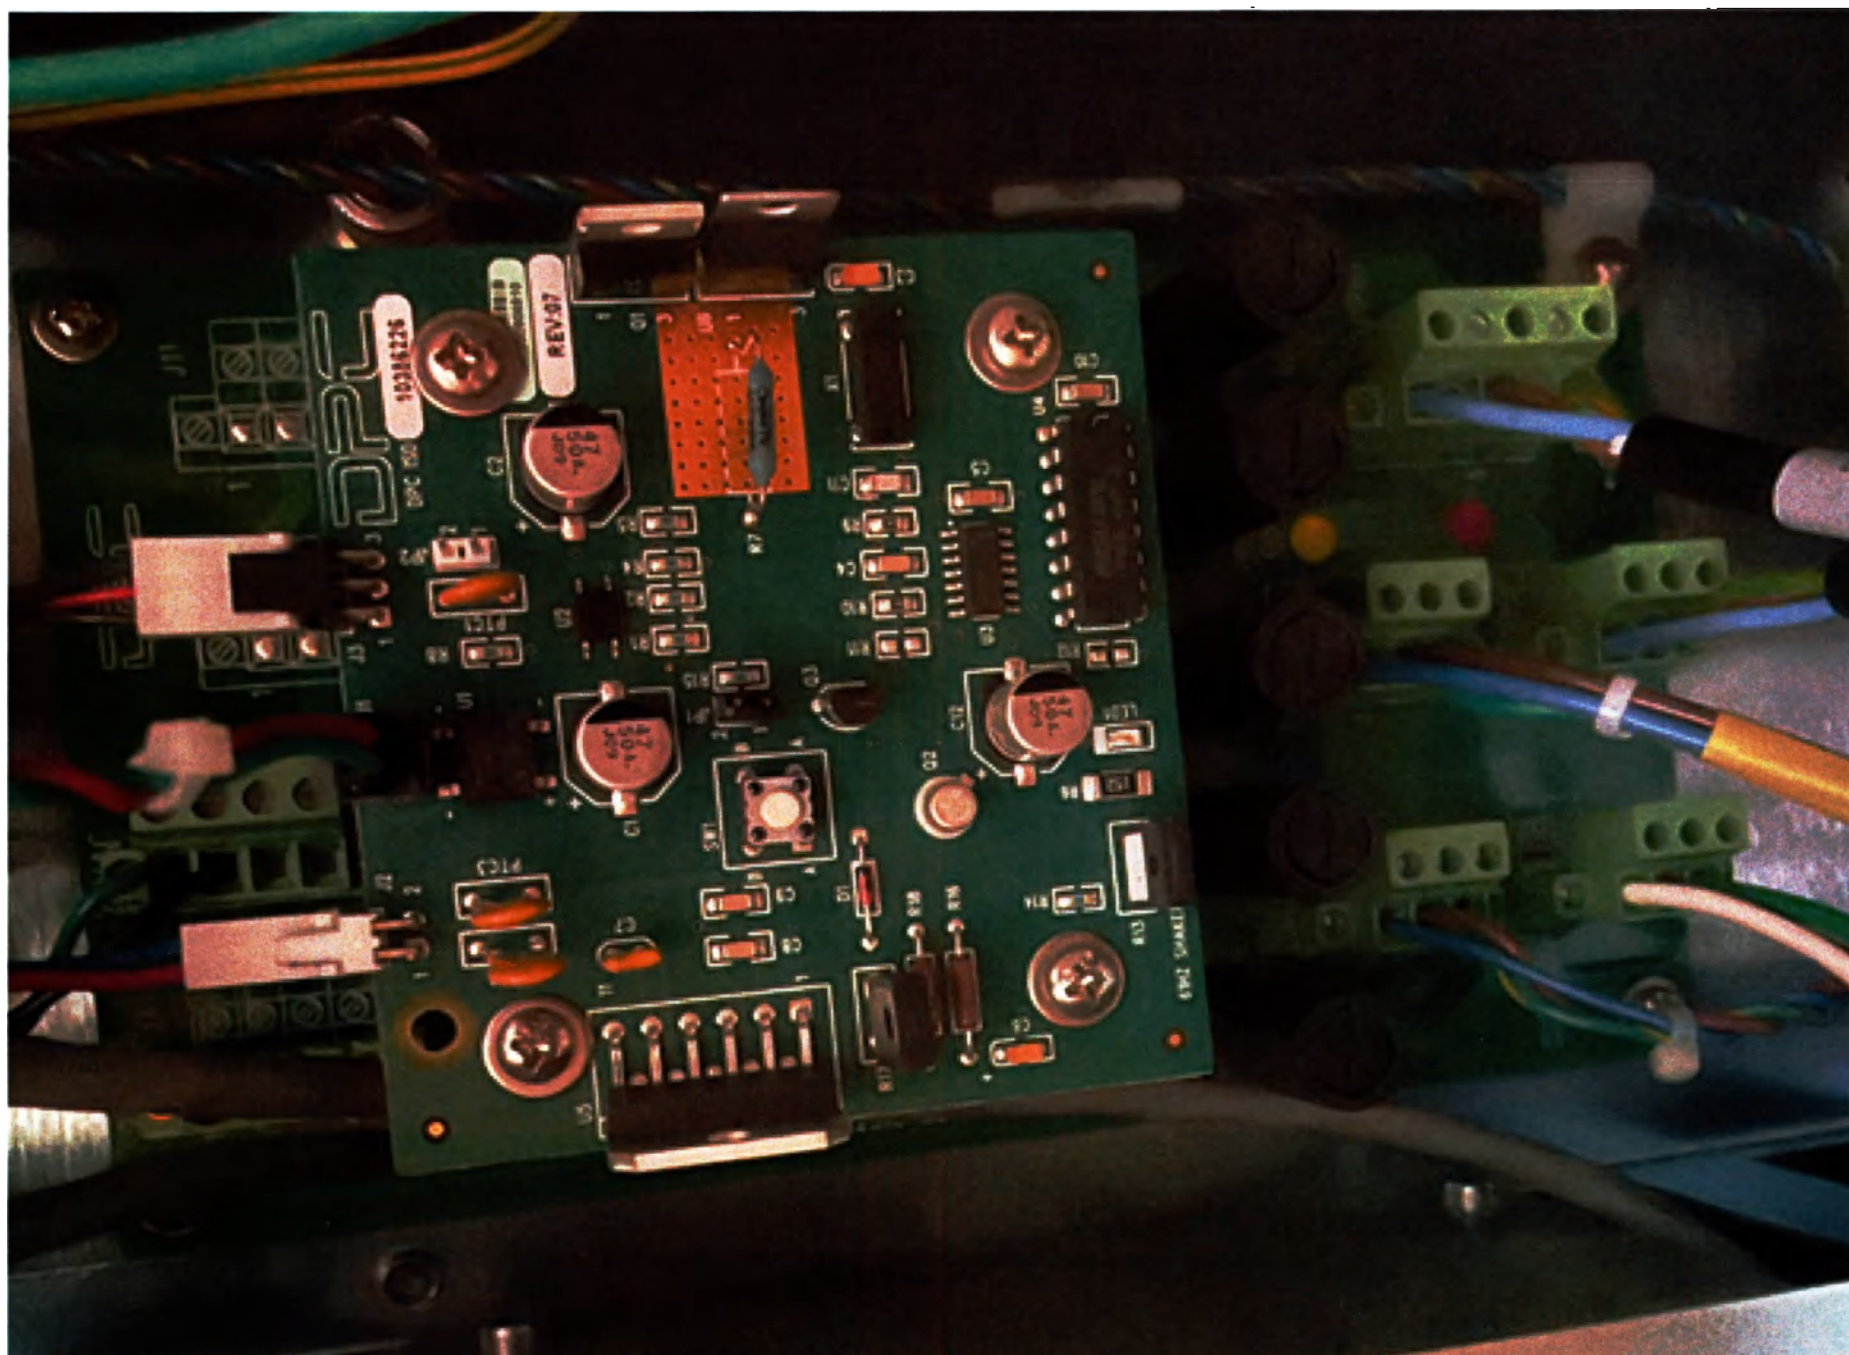


Рисунок 37. Платы электронные для анализатора



Рисунок 38. Подставки для работы с аллерготестами



Рисунок 39. Подставки для работы с пробирками (для разведения)

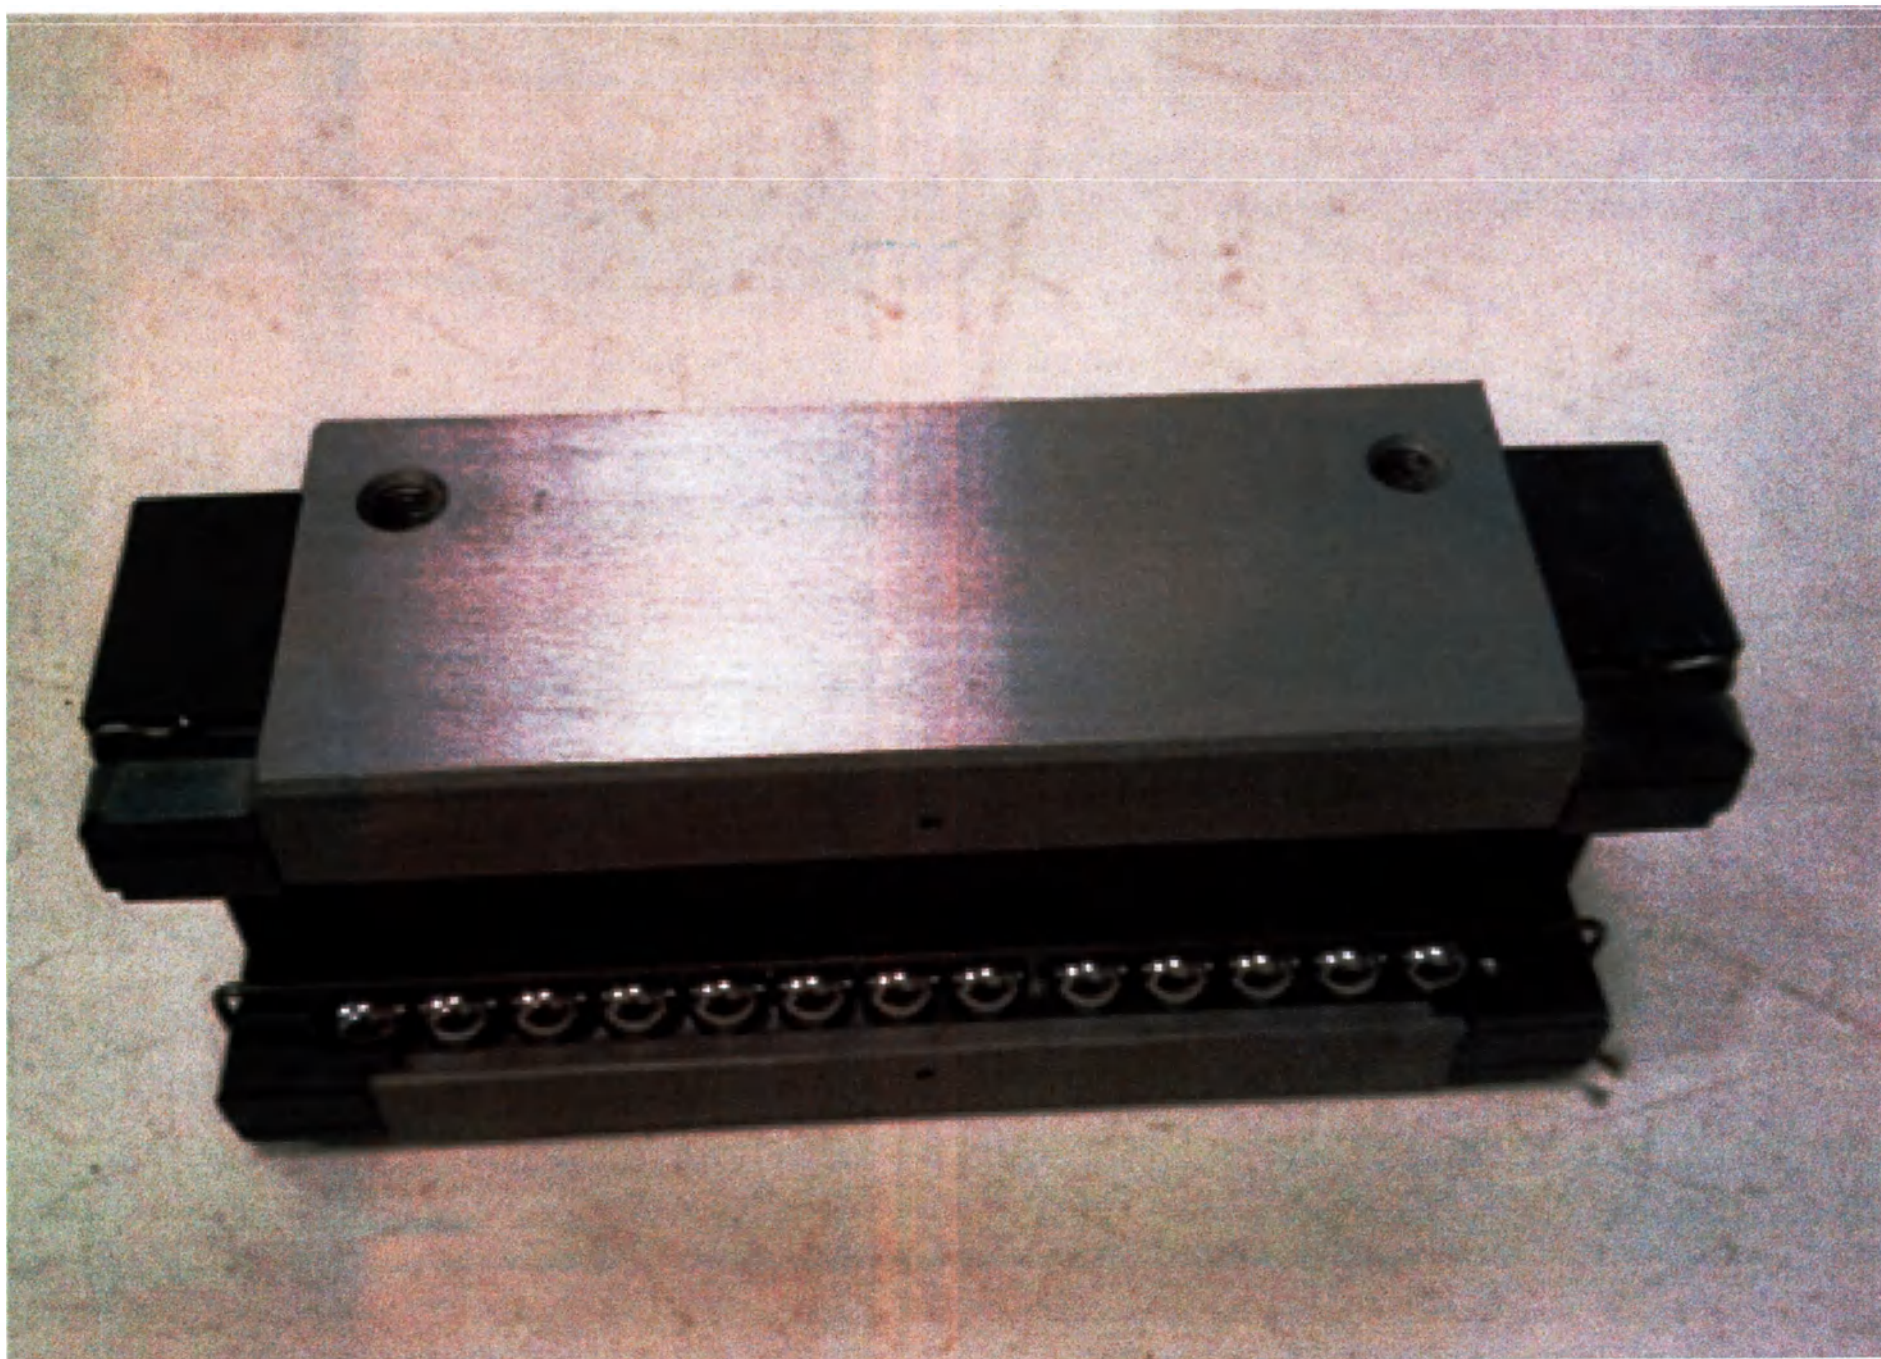


Рисунок 40. Подшипники различного назначения



SIEMENS

Software Kit

REF 10475998

SN 2102039



Origin: IE

Siemens Healthcare Diagnostics Products Ltd
Glyn Rhonwy, Llanberis, Gwynedd LL55 4LL
United Kingdom



Siemens Healthcare Diagnostics
Manufacturing Ltd
Chapel Lane
Swords, Co. Dublin, Ireland




0197

PRISCA 5

Software to calculate risk of Trisomy 21, Trisomy 18, Trisomy 13,
Neural Tube Defects, and share and control PRISCA medians.

11J53731 Rev. 02

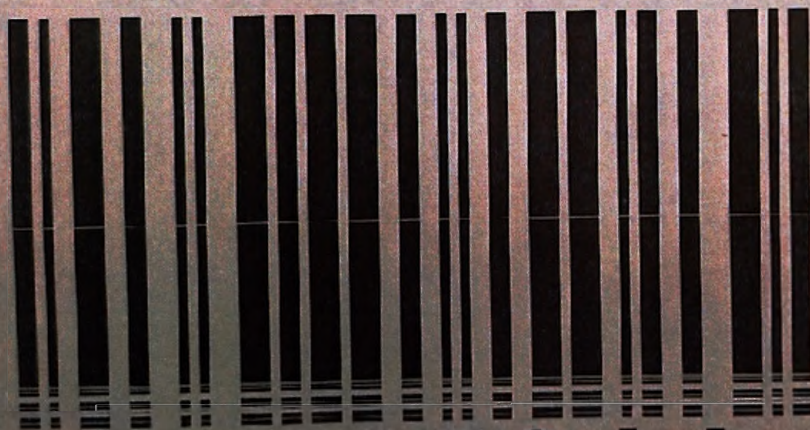

40232914



Рисунок 43. Прозрачные крышки



Рисунок 44. Прокладки разные



Рисунок 45. Пружины



Рисунок 46. Резервуар субстрата

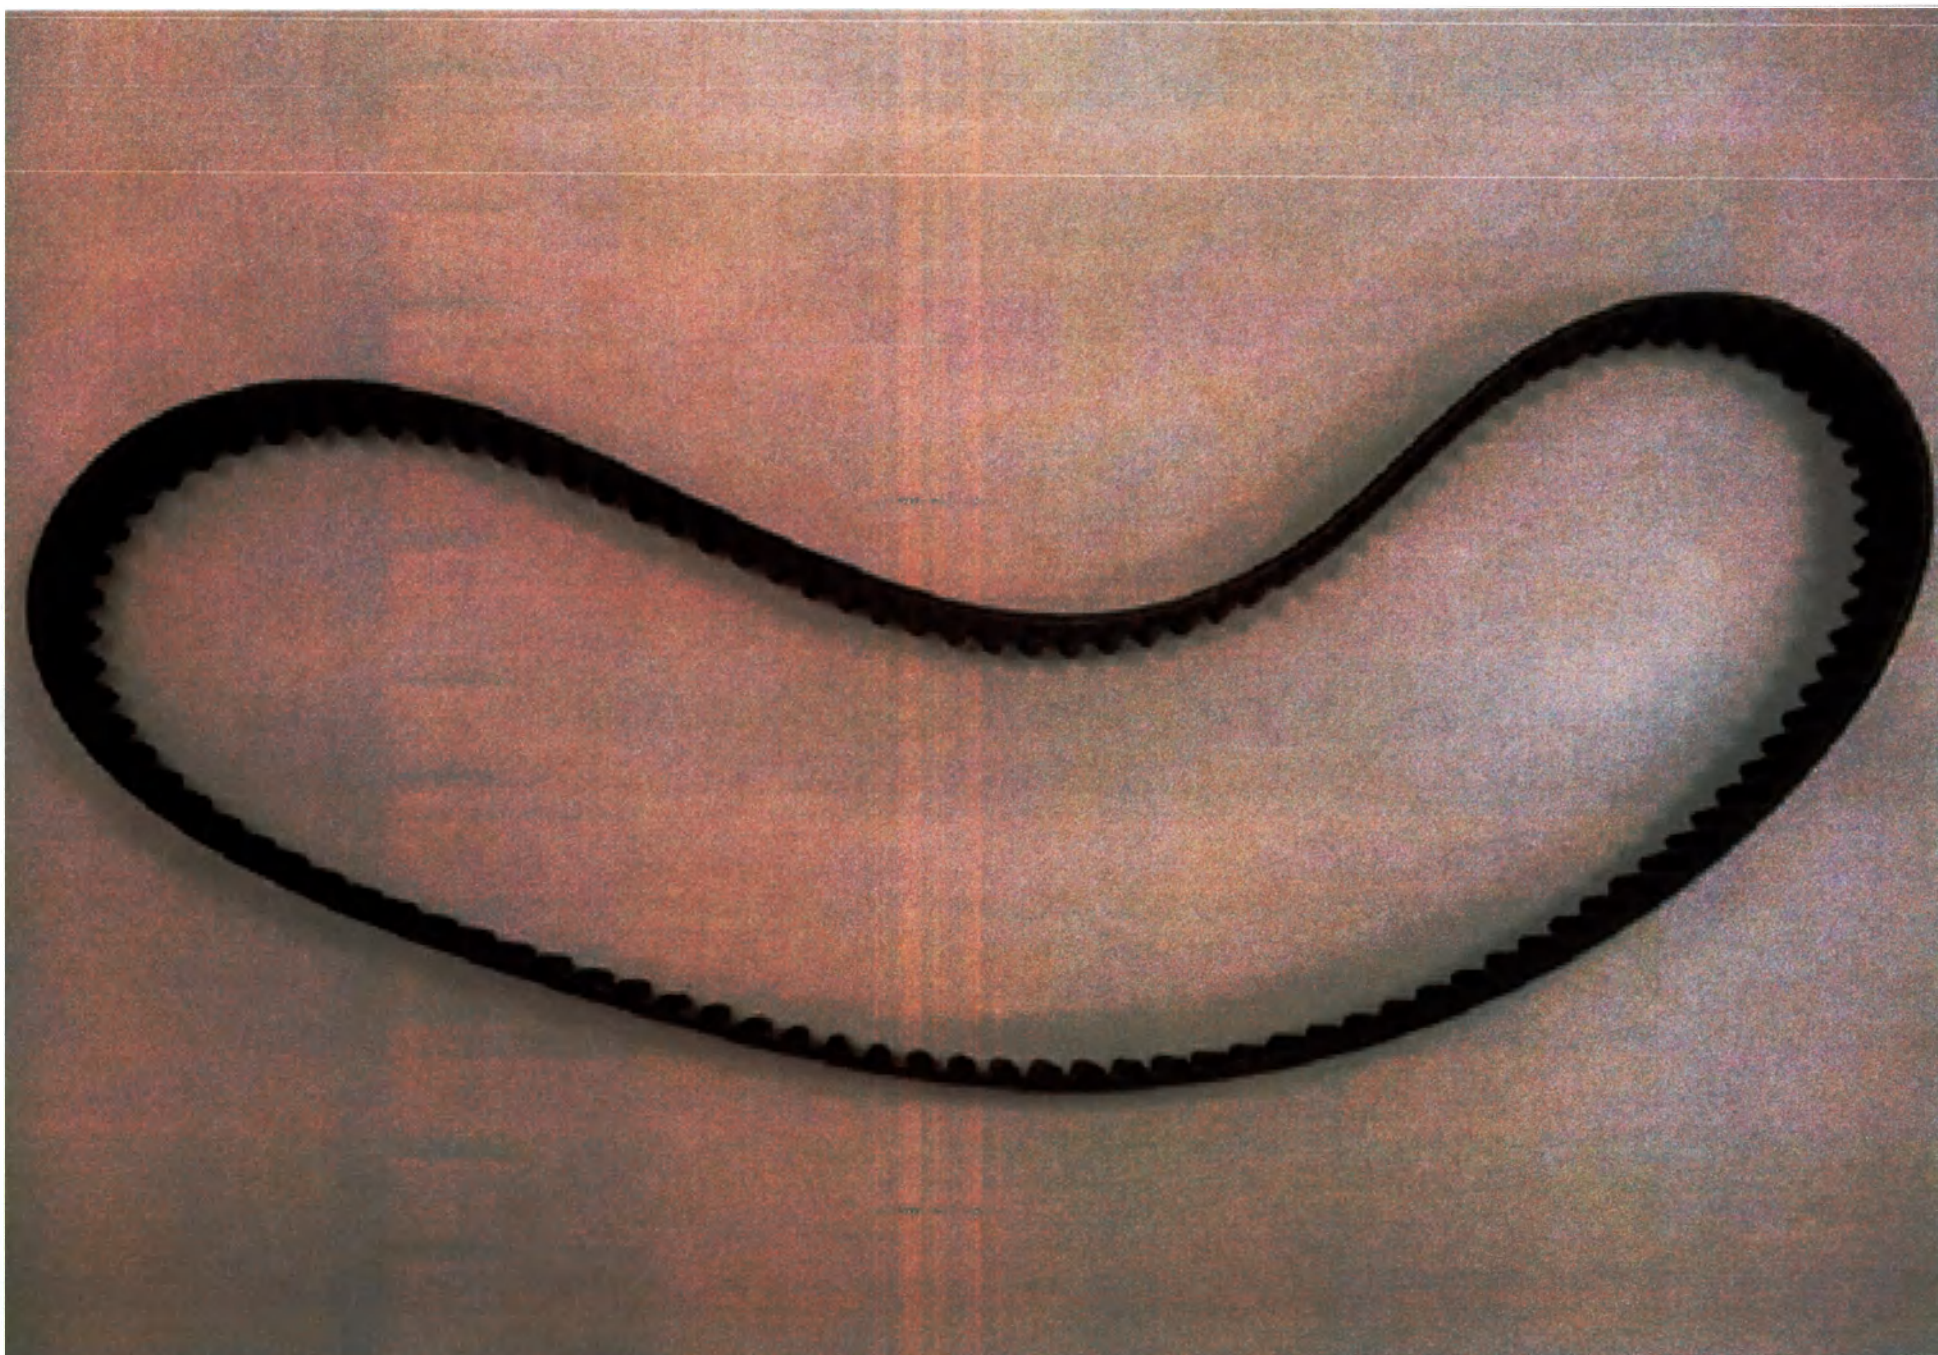


Рисунок 47. Ремни

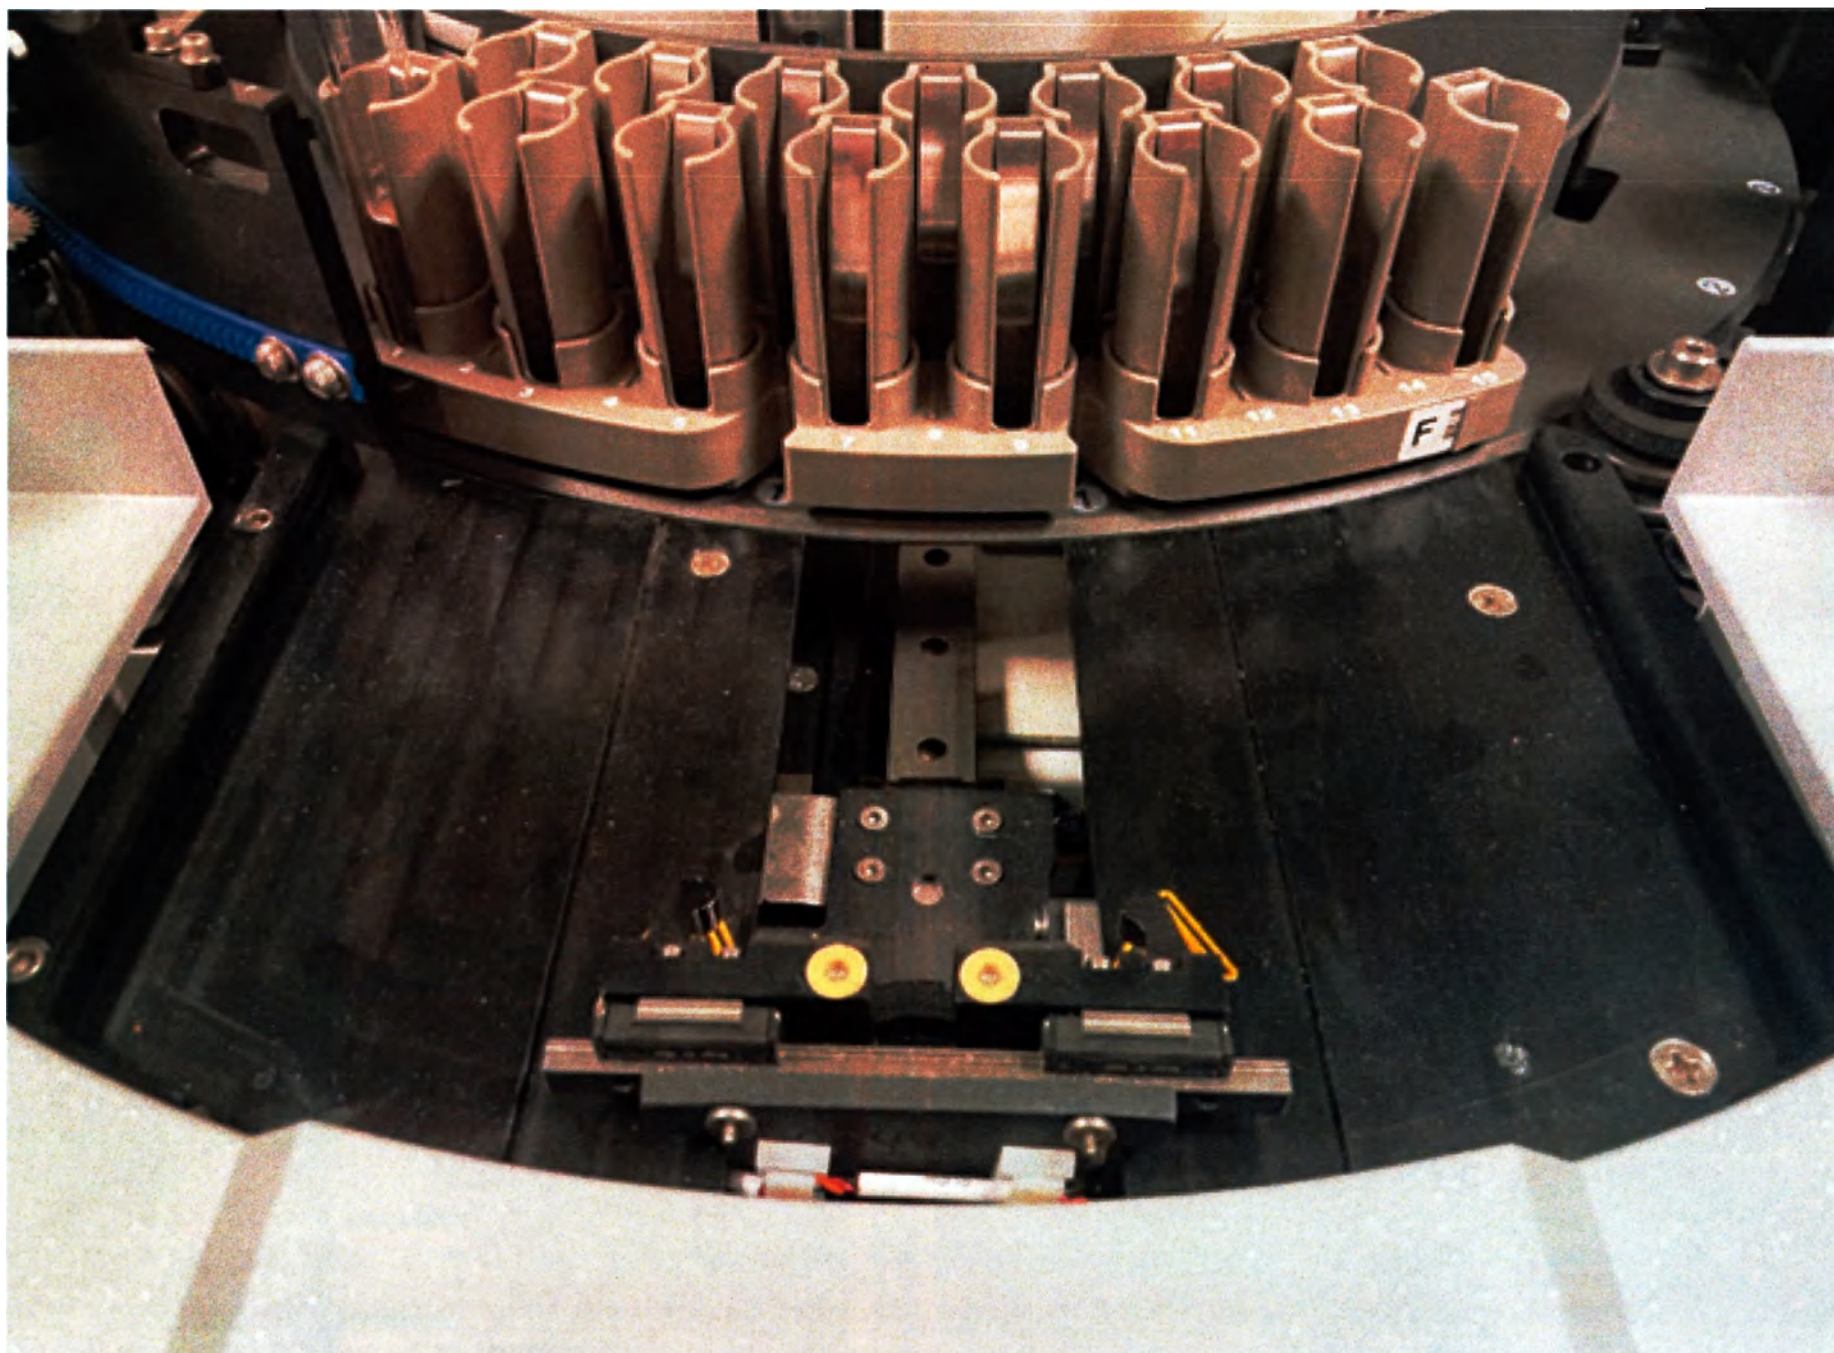


Рисунок 48. Система Управления Образцами (SMS)



Рисунок 49. Станция мониторинга состояния анализаторов Immulite Real time service (RTS)



Рисунок 50. Станция промывки

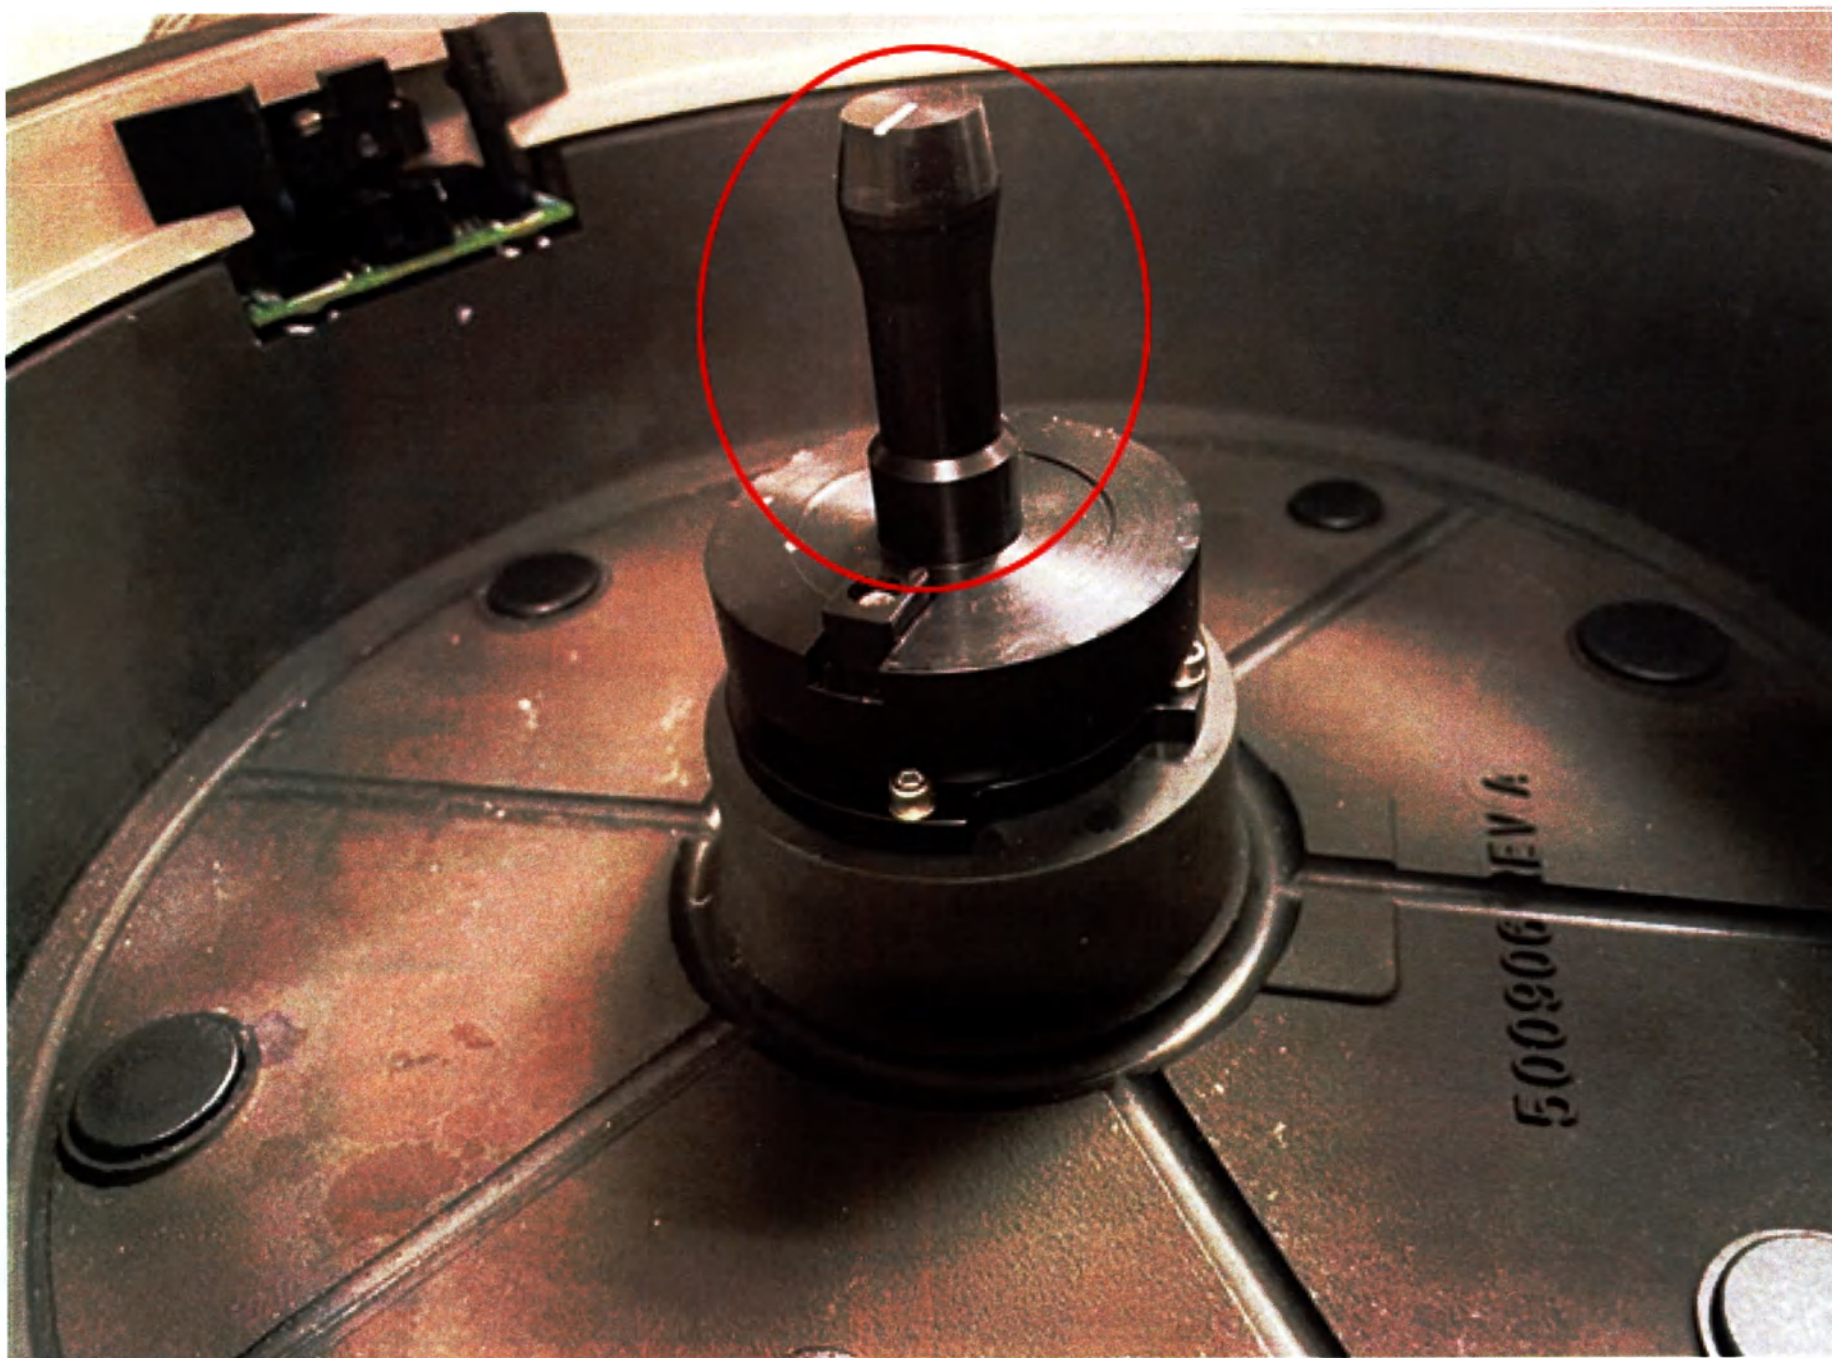


Рисунок 51. Стержень мотора

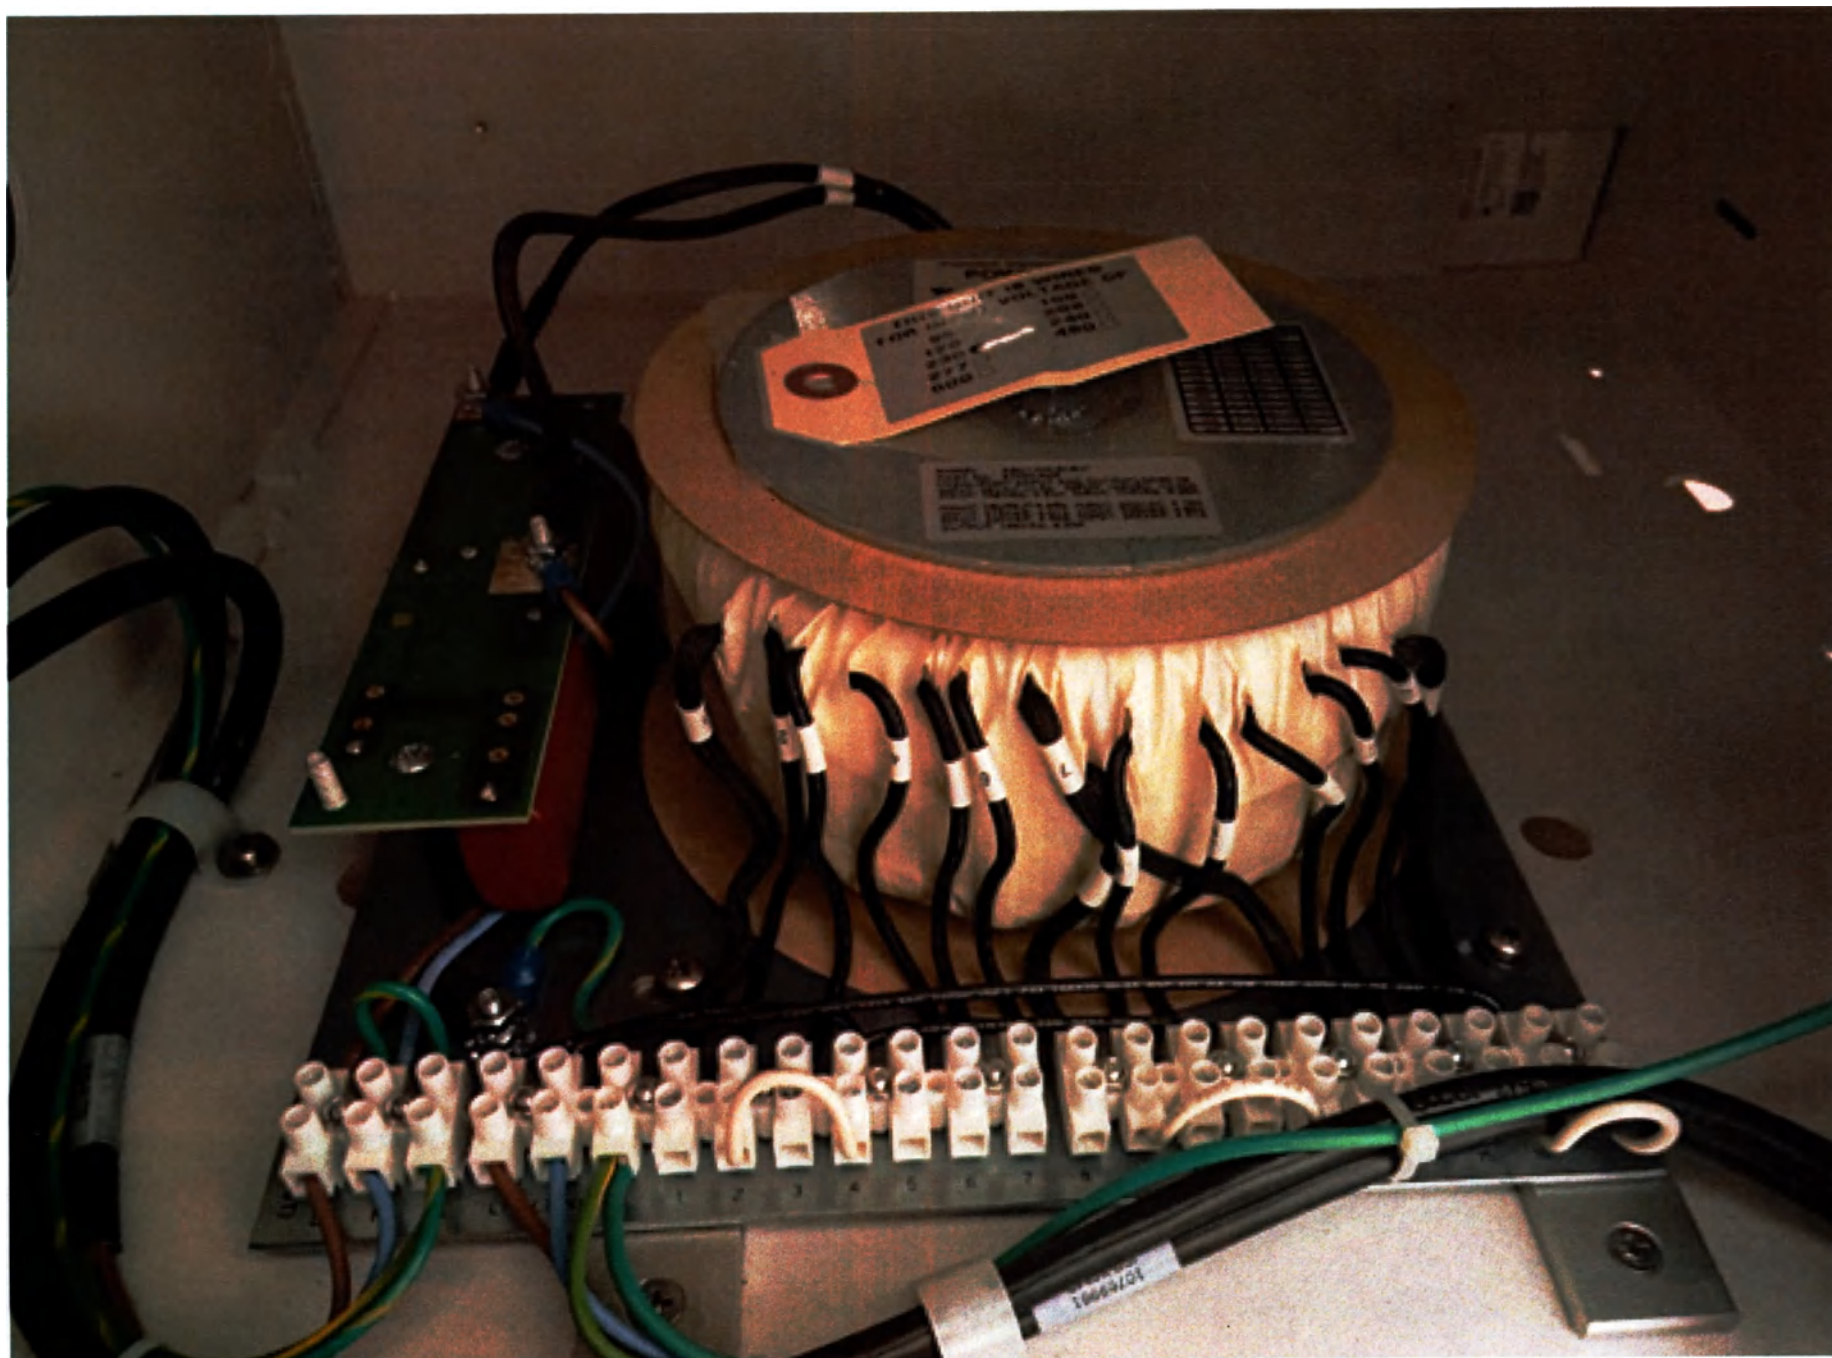


Рисунок 52. Трансформатор



Рисунок 53. Трубки разные

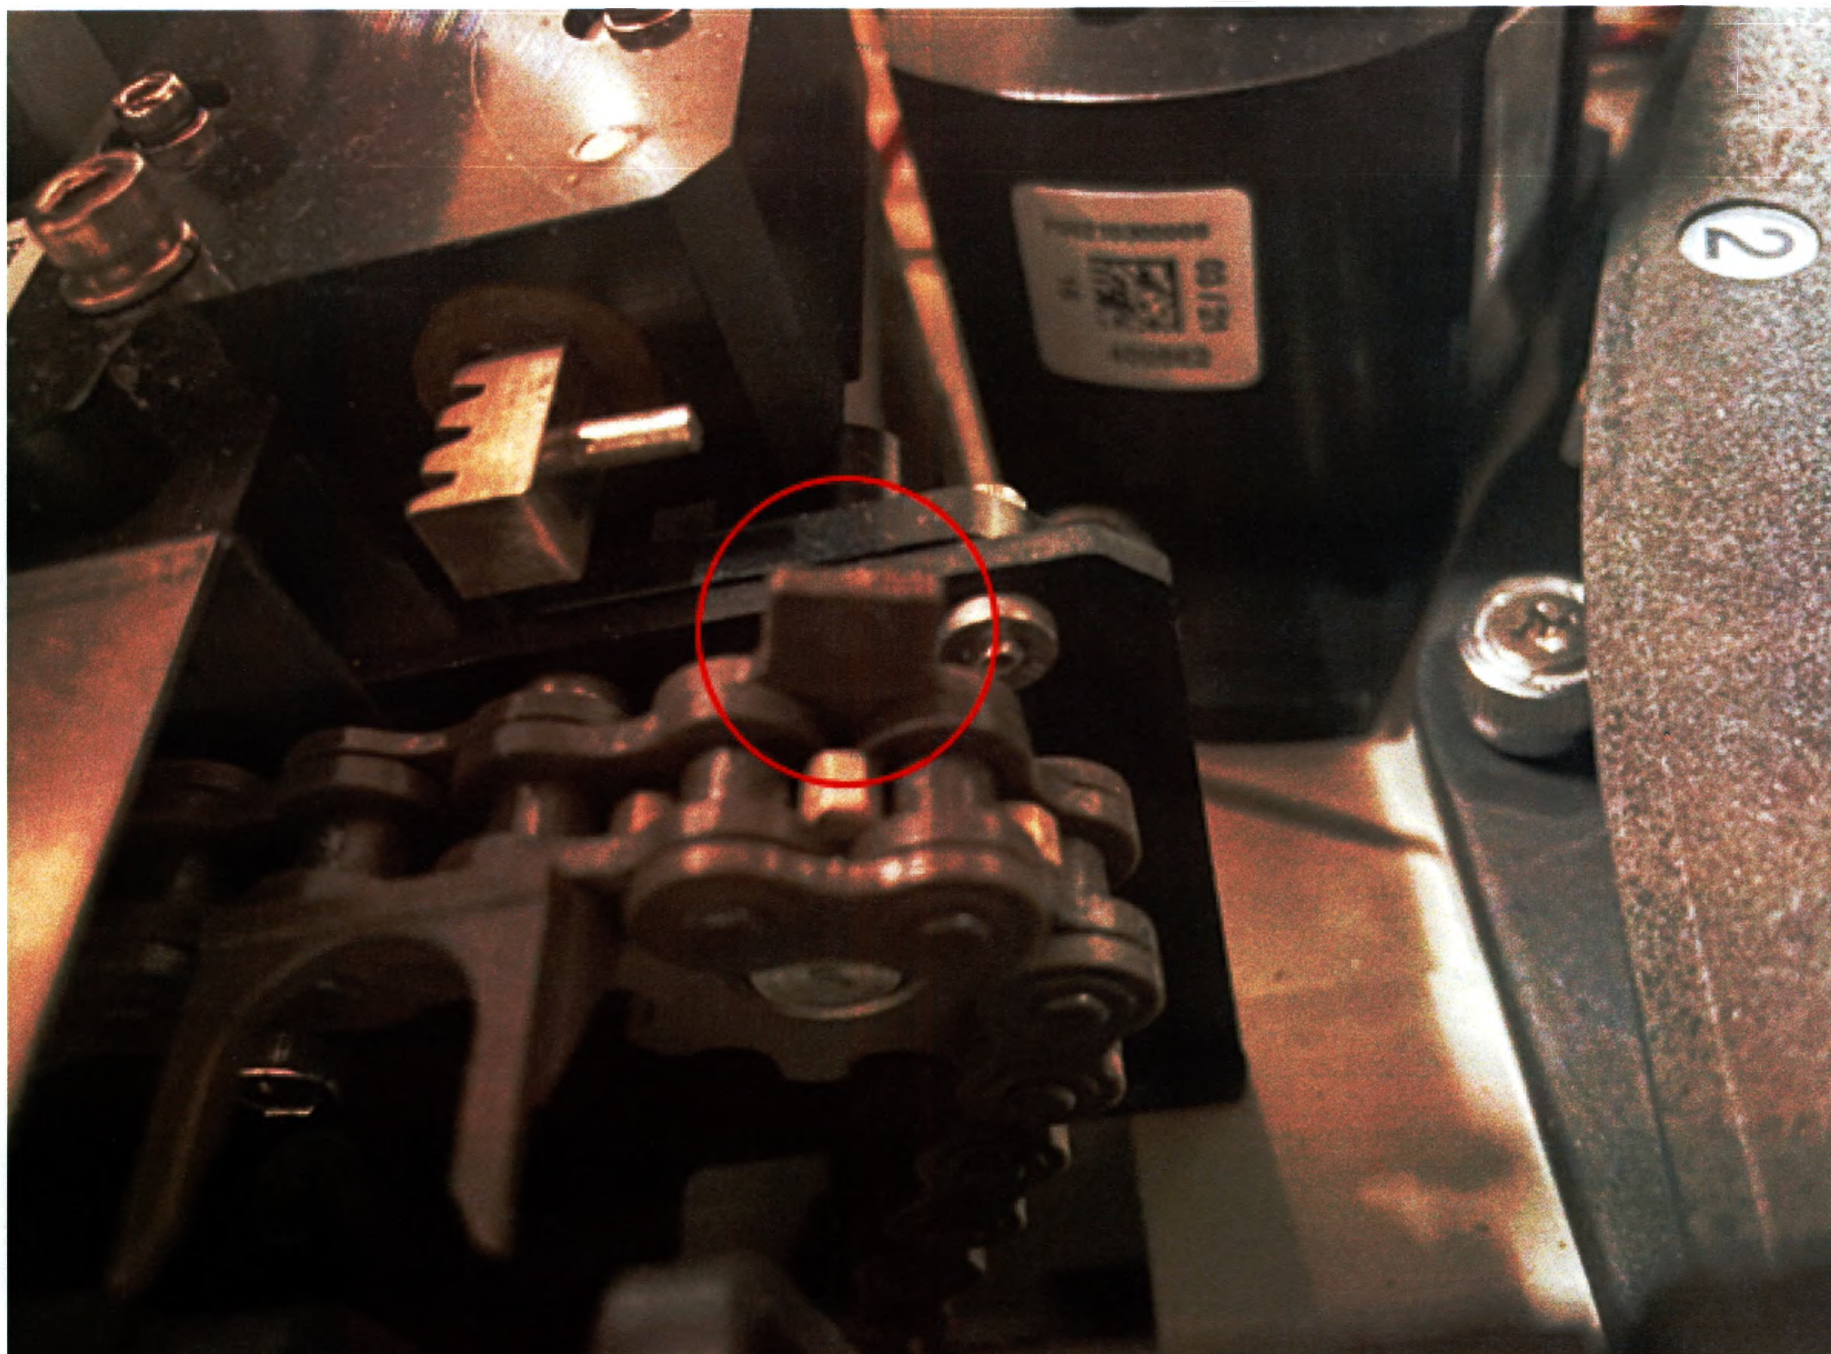


Рисунок 54. Флаг датчика

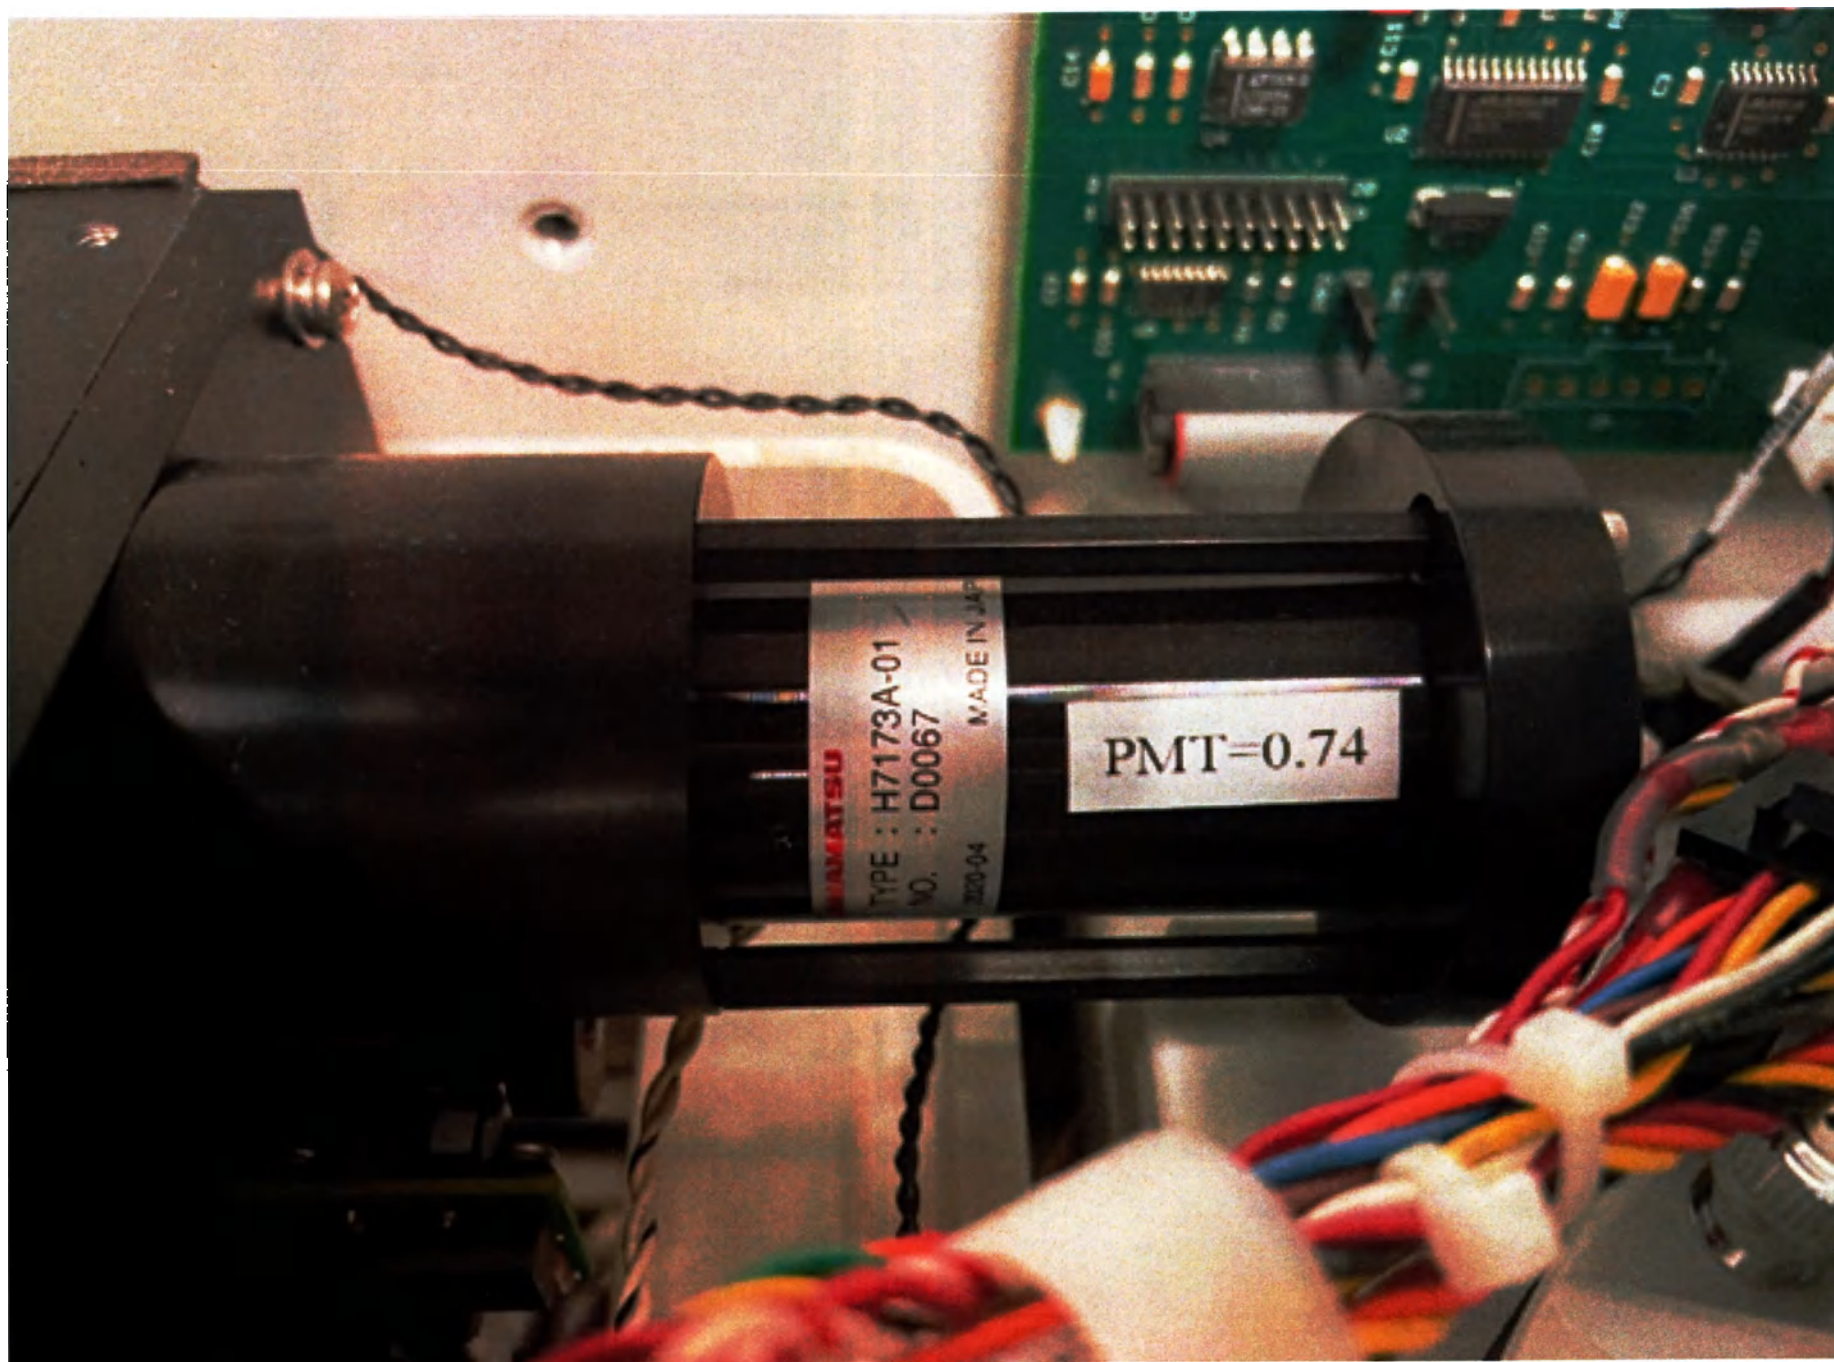


Рисунок 55. Фотоэлектронный умножитель

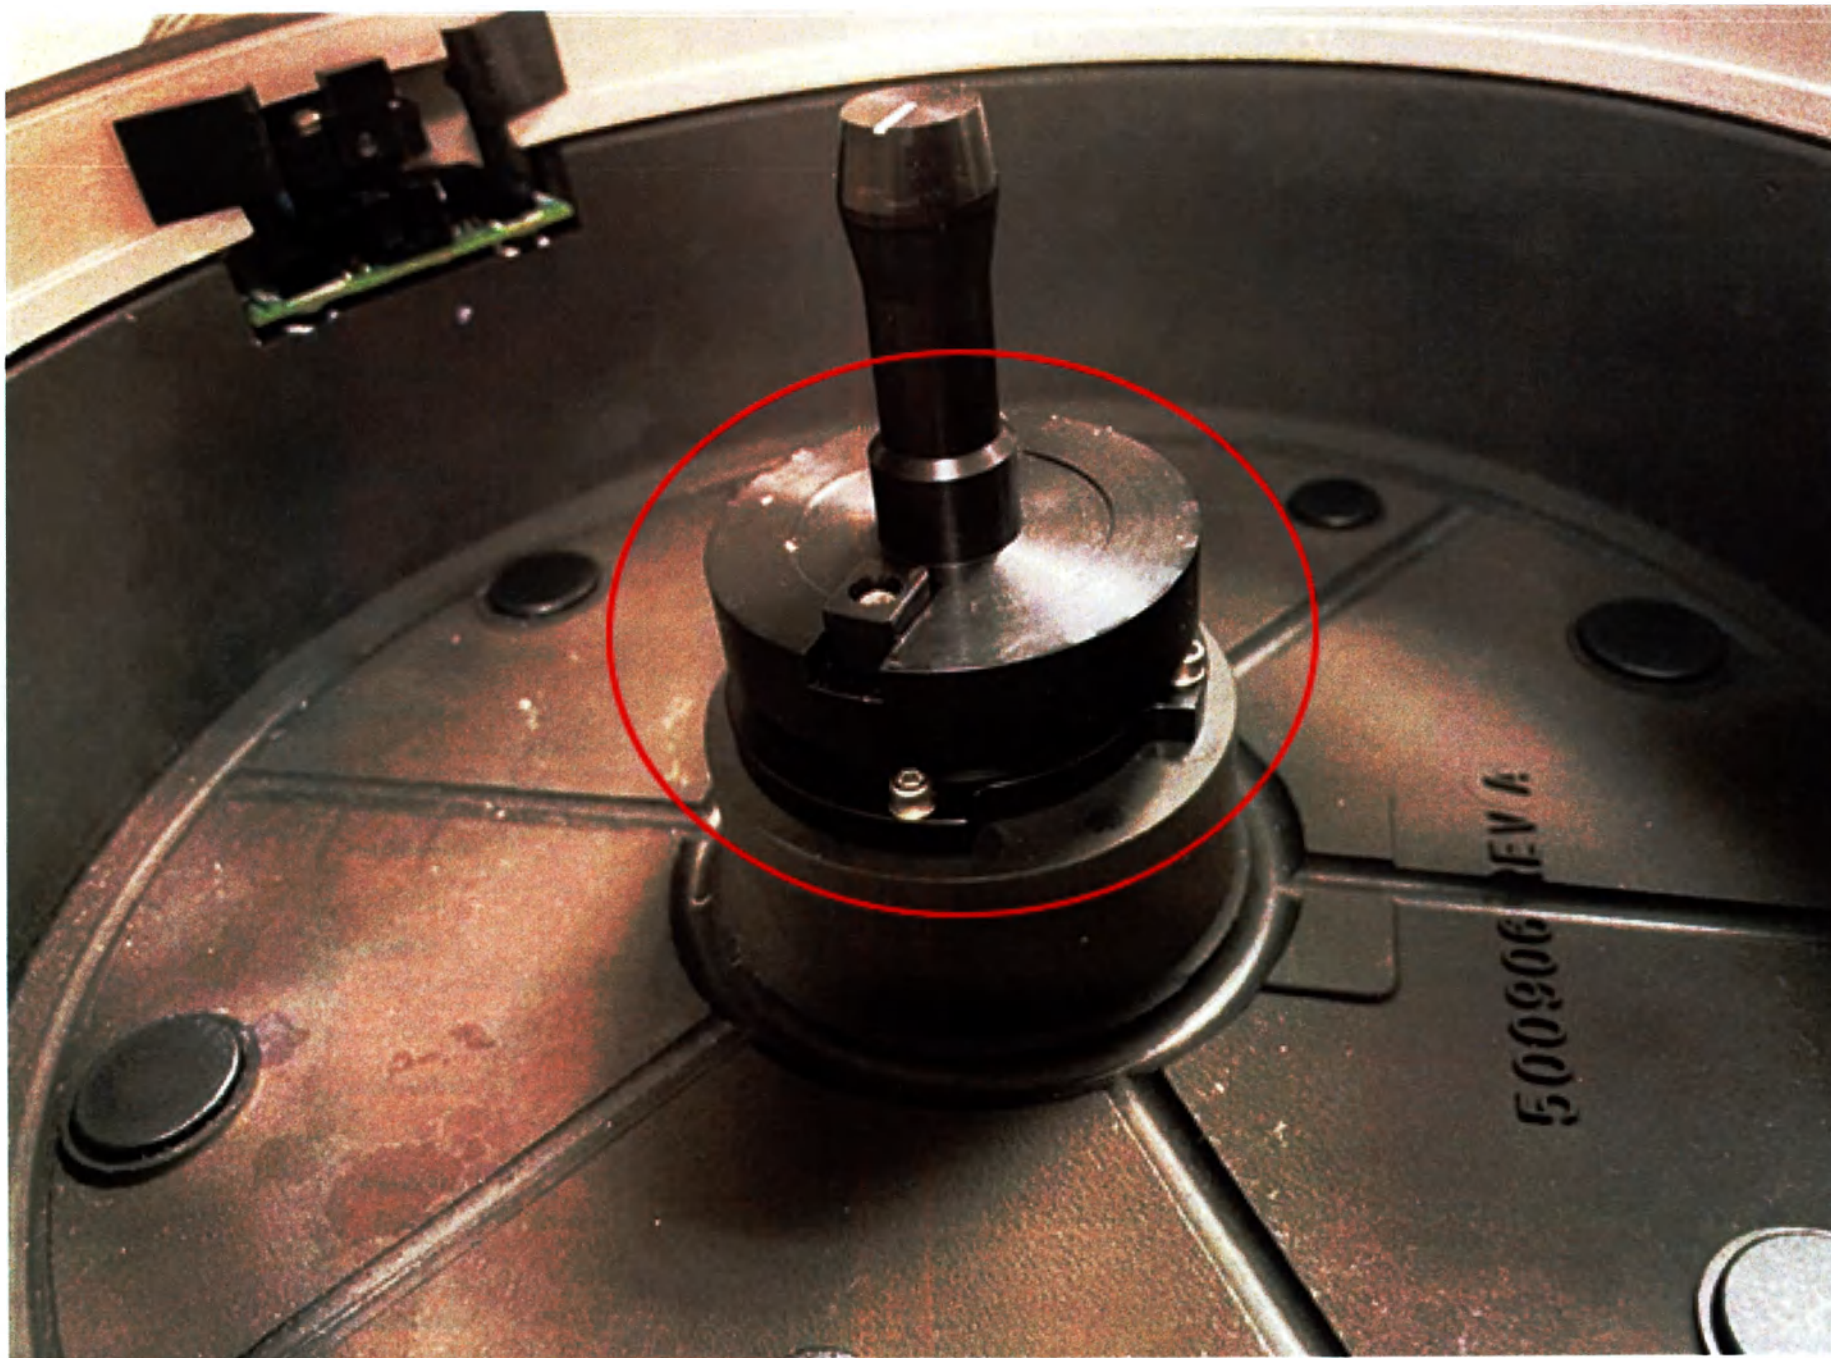


Рисунок 56. Хомут мотора

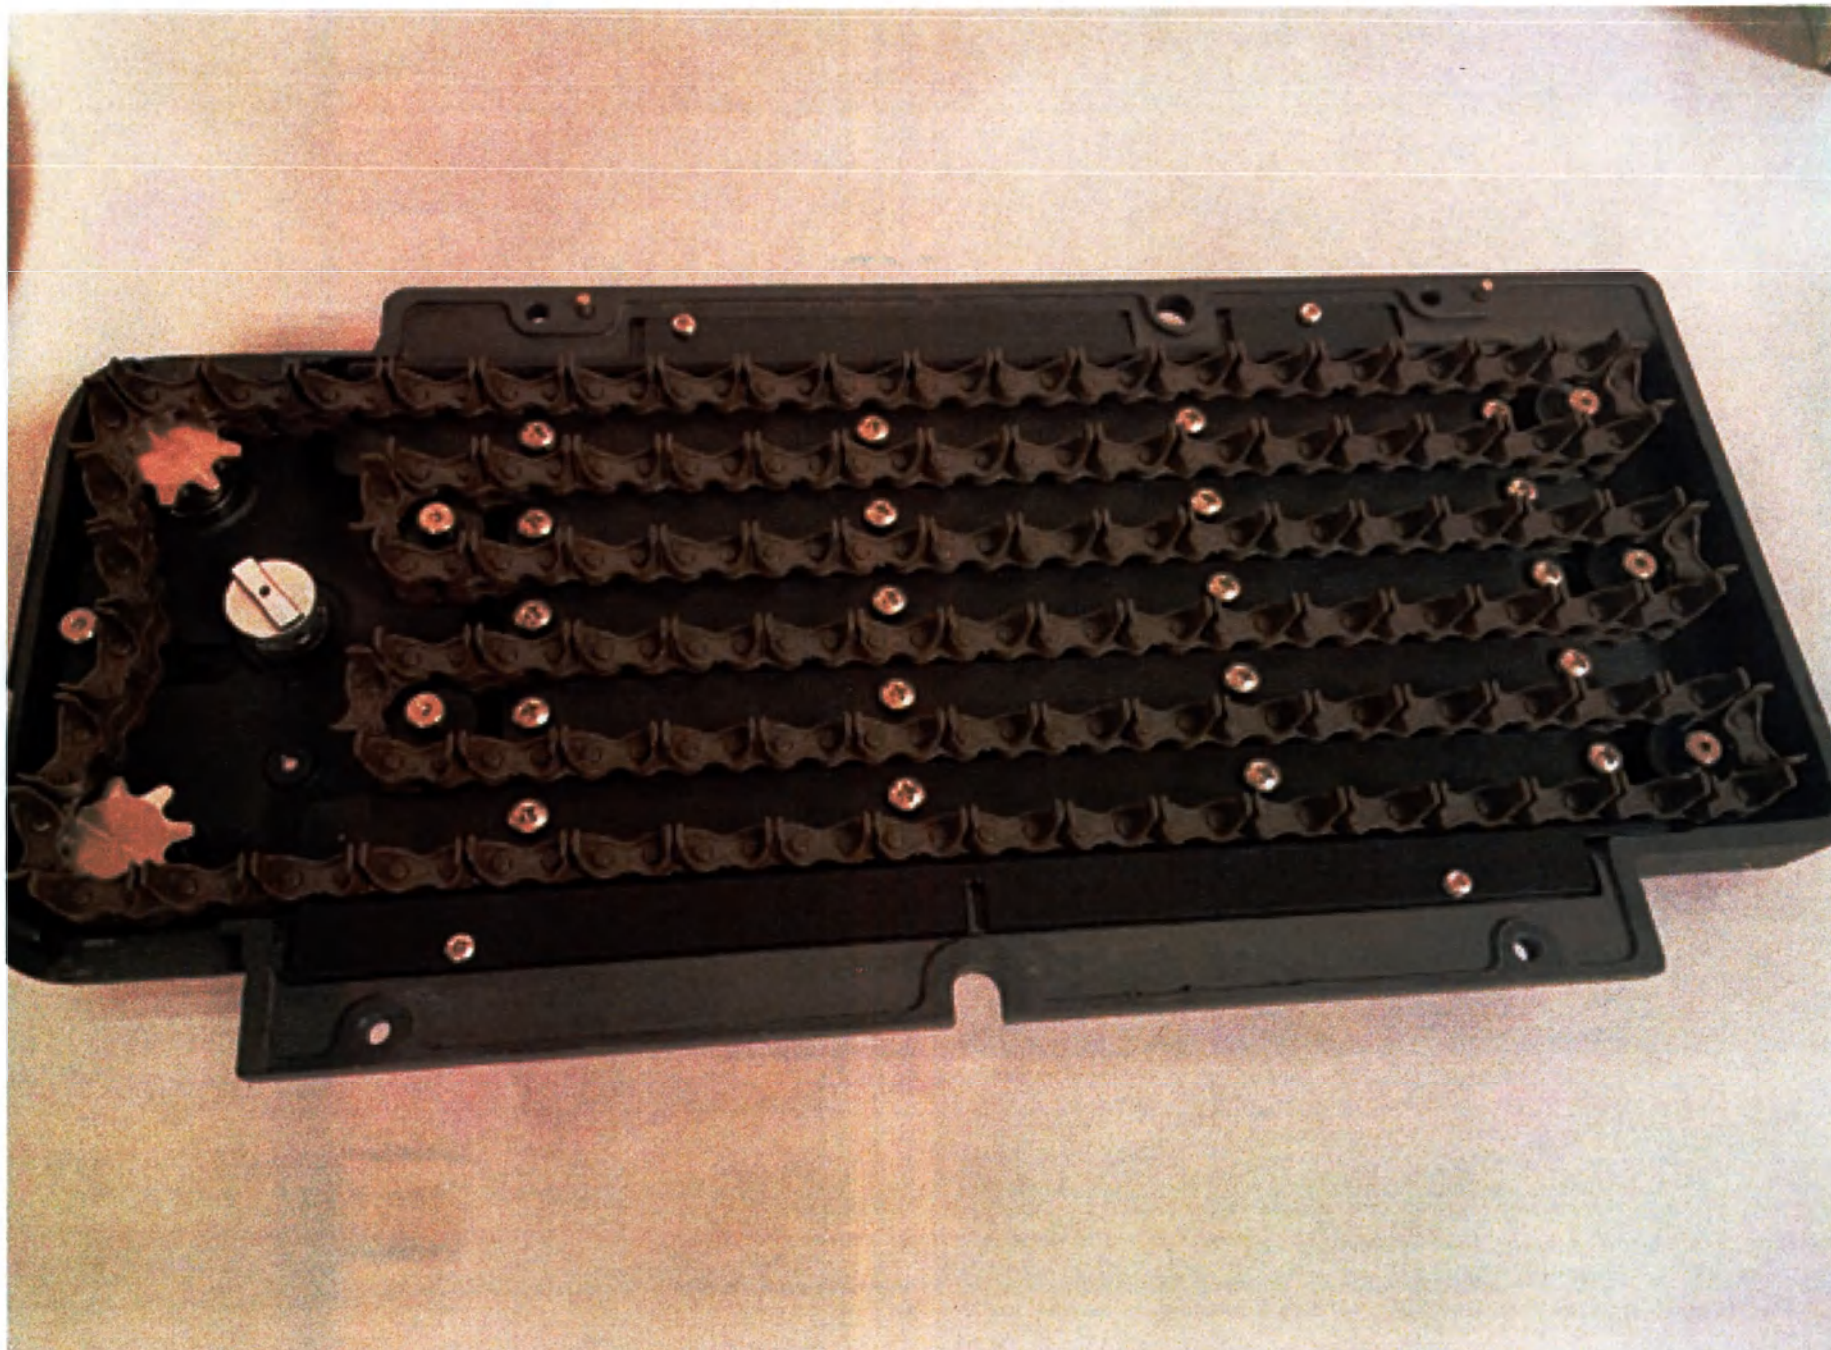


Рисунок 57. Цепи пластиковые разные

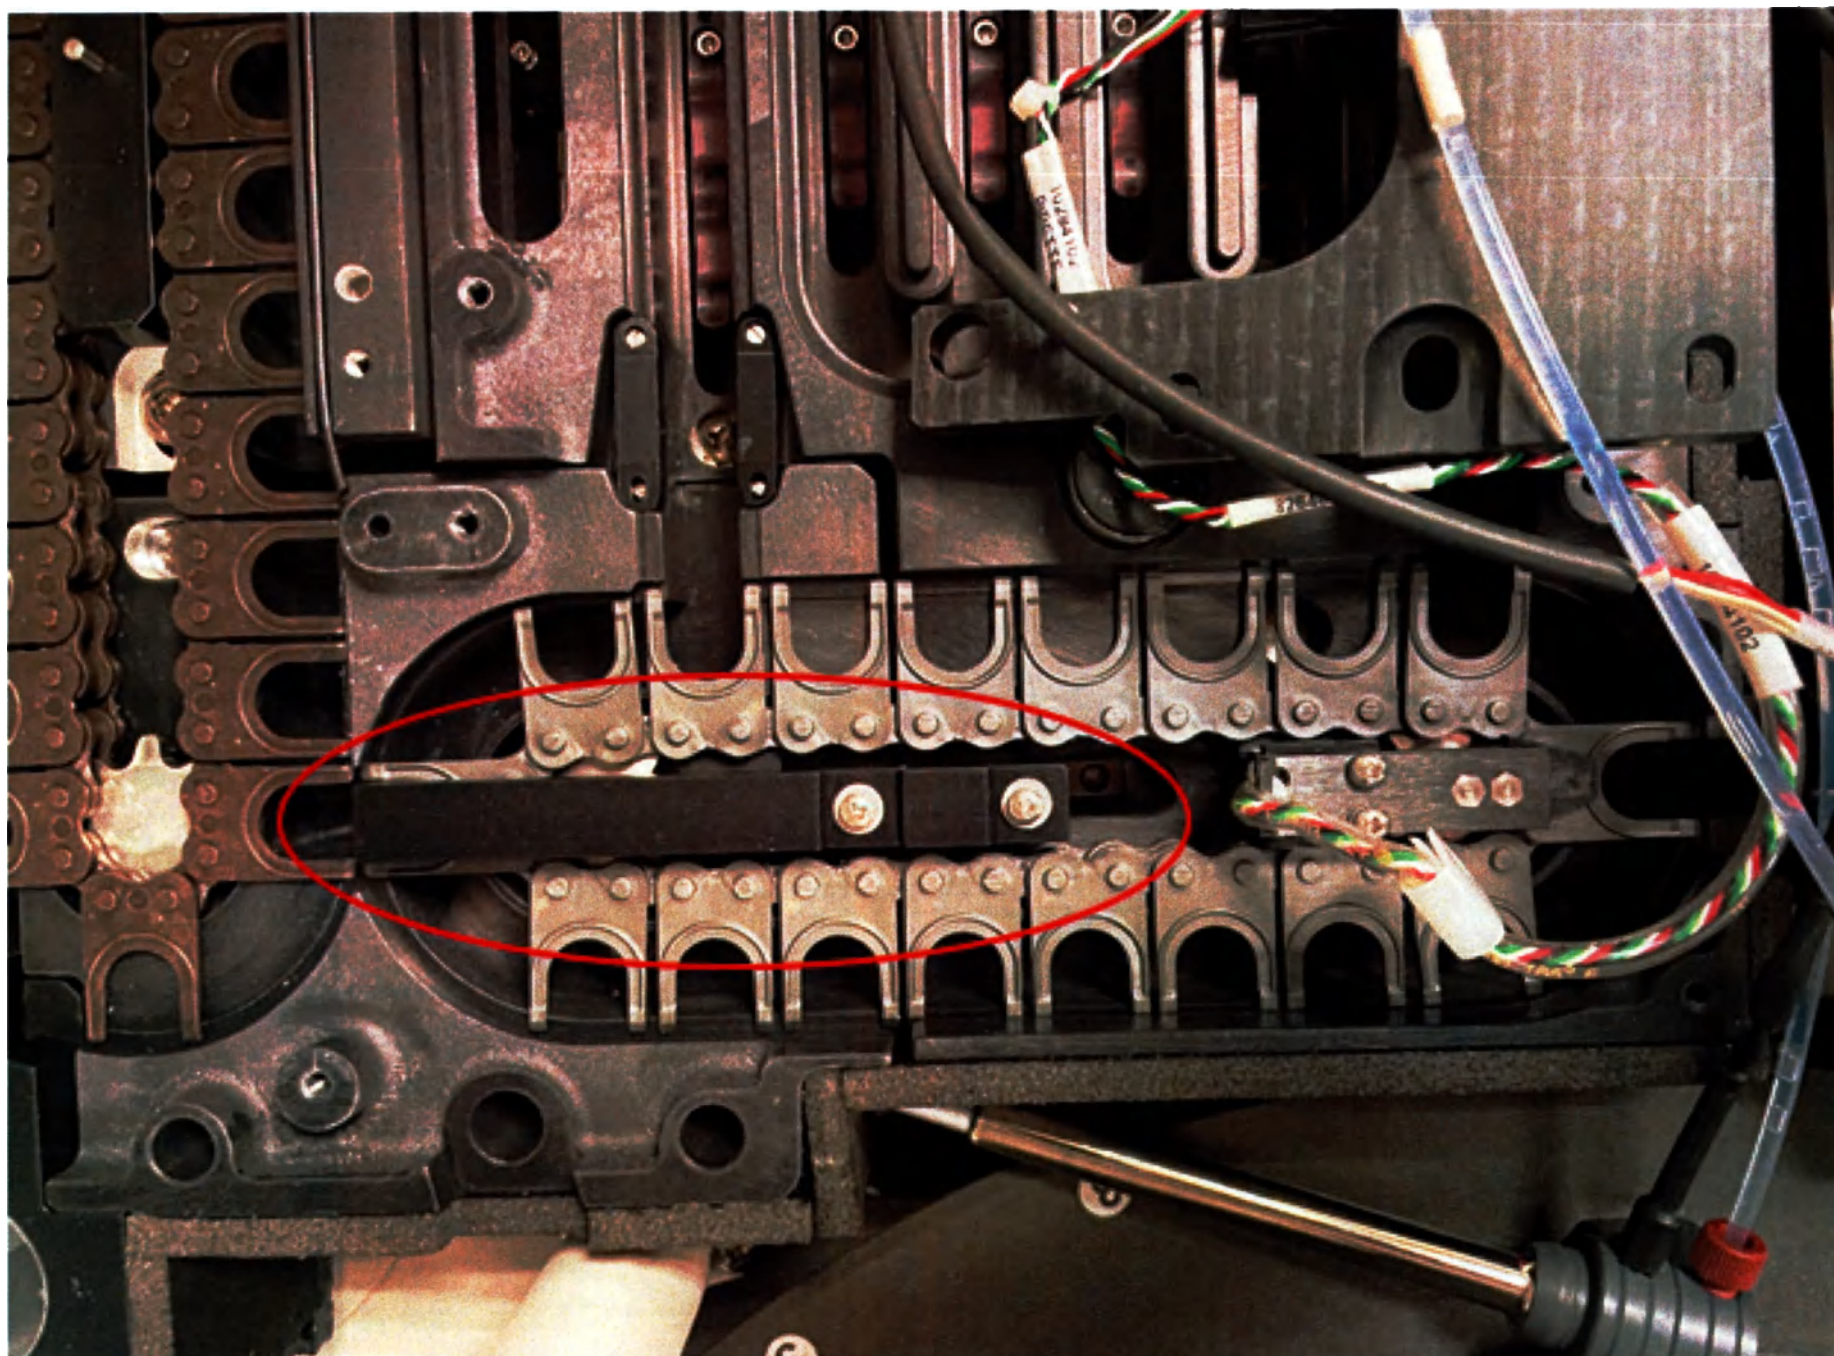


Рисунок 58. Челнок

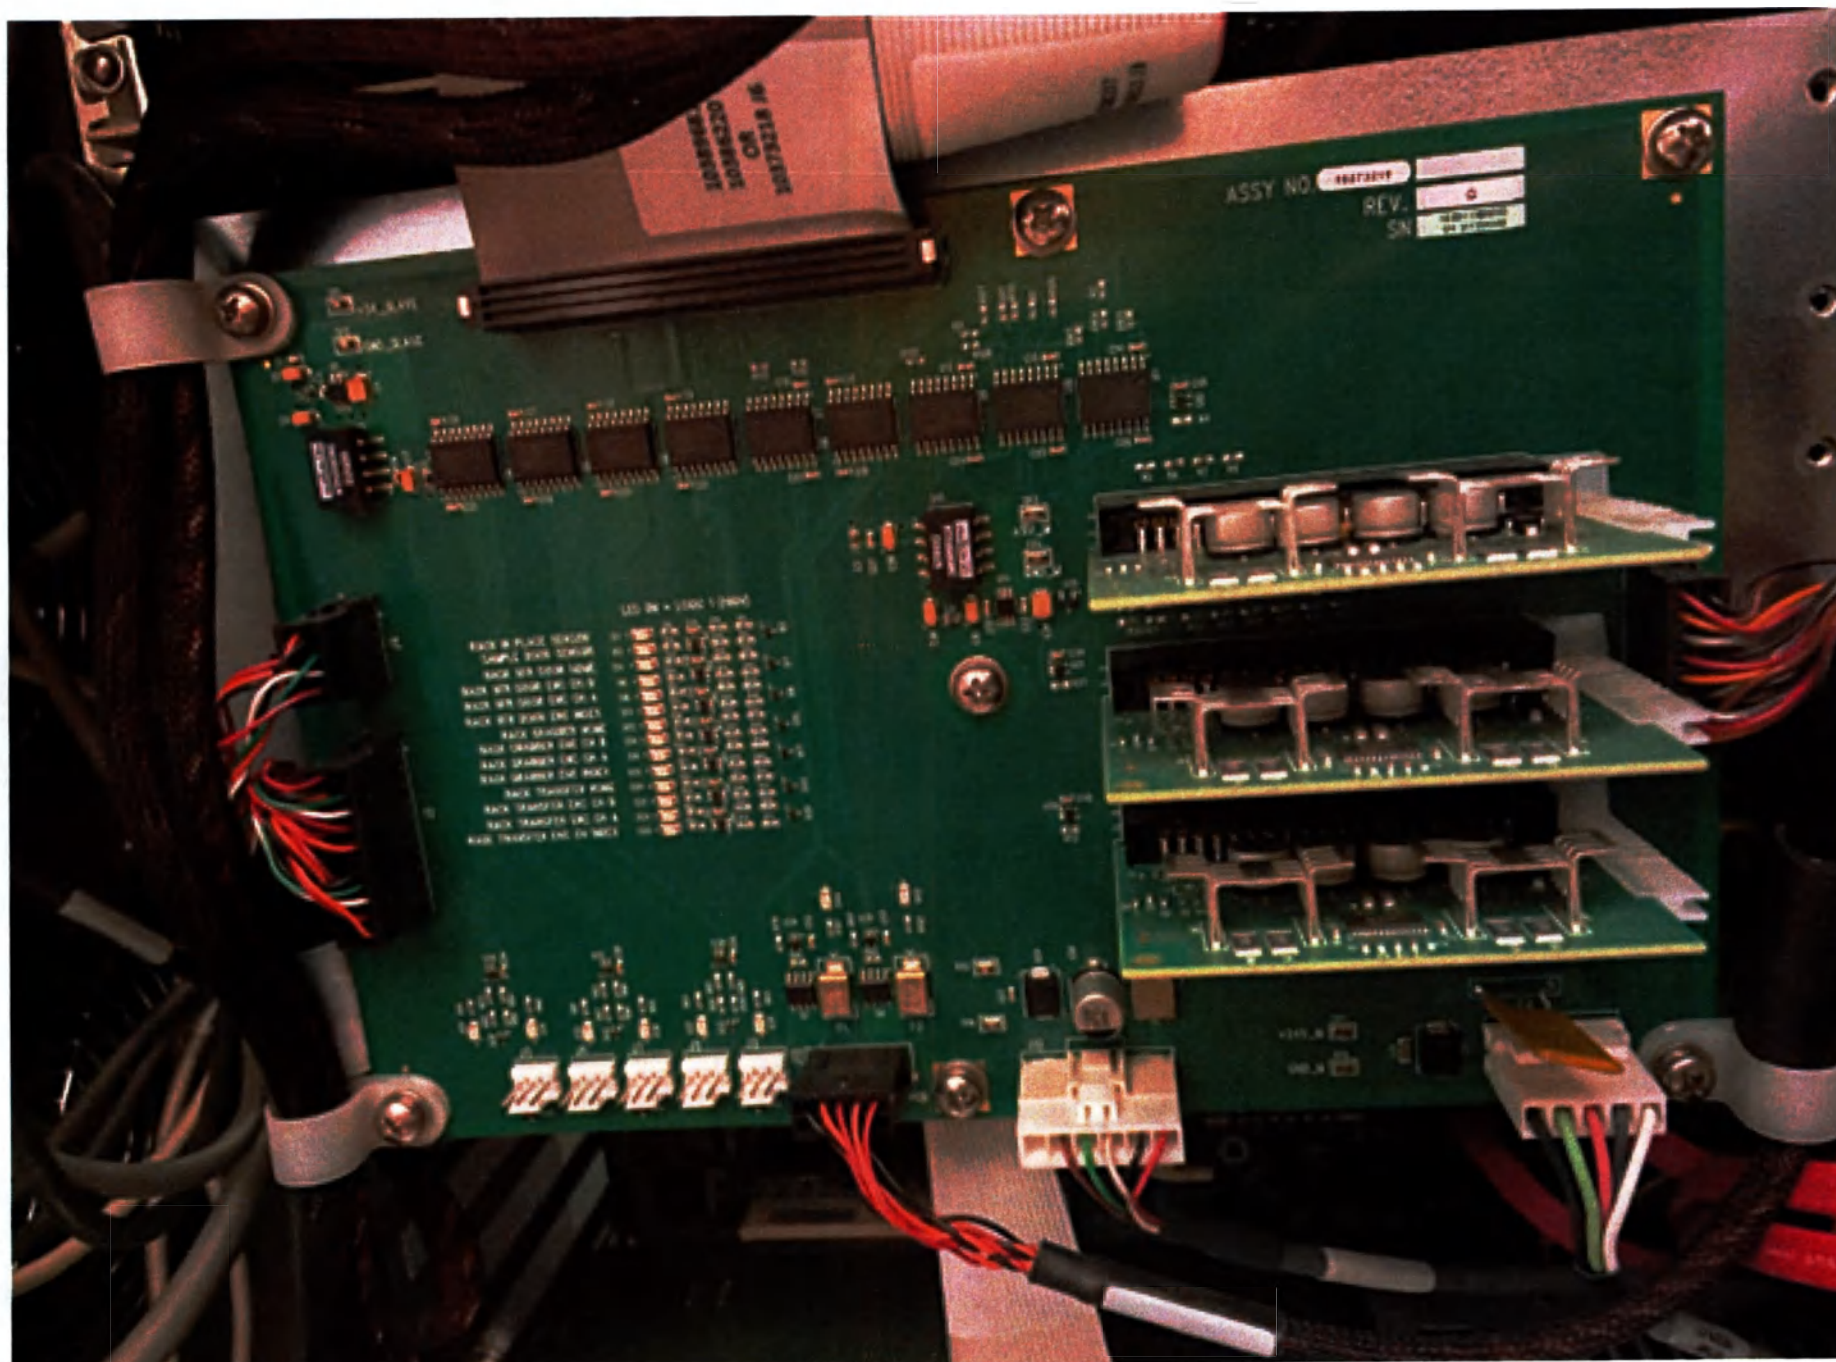


Рисунок 59. Шасси электронные анализатора

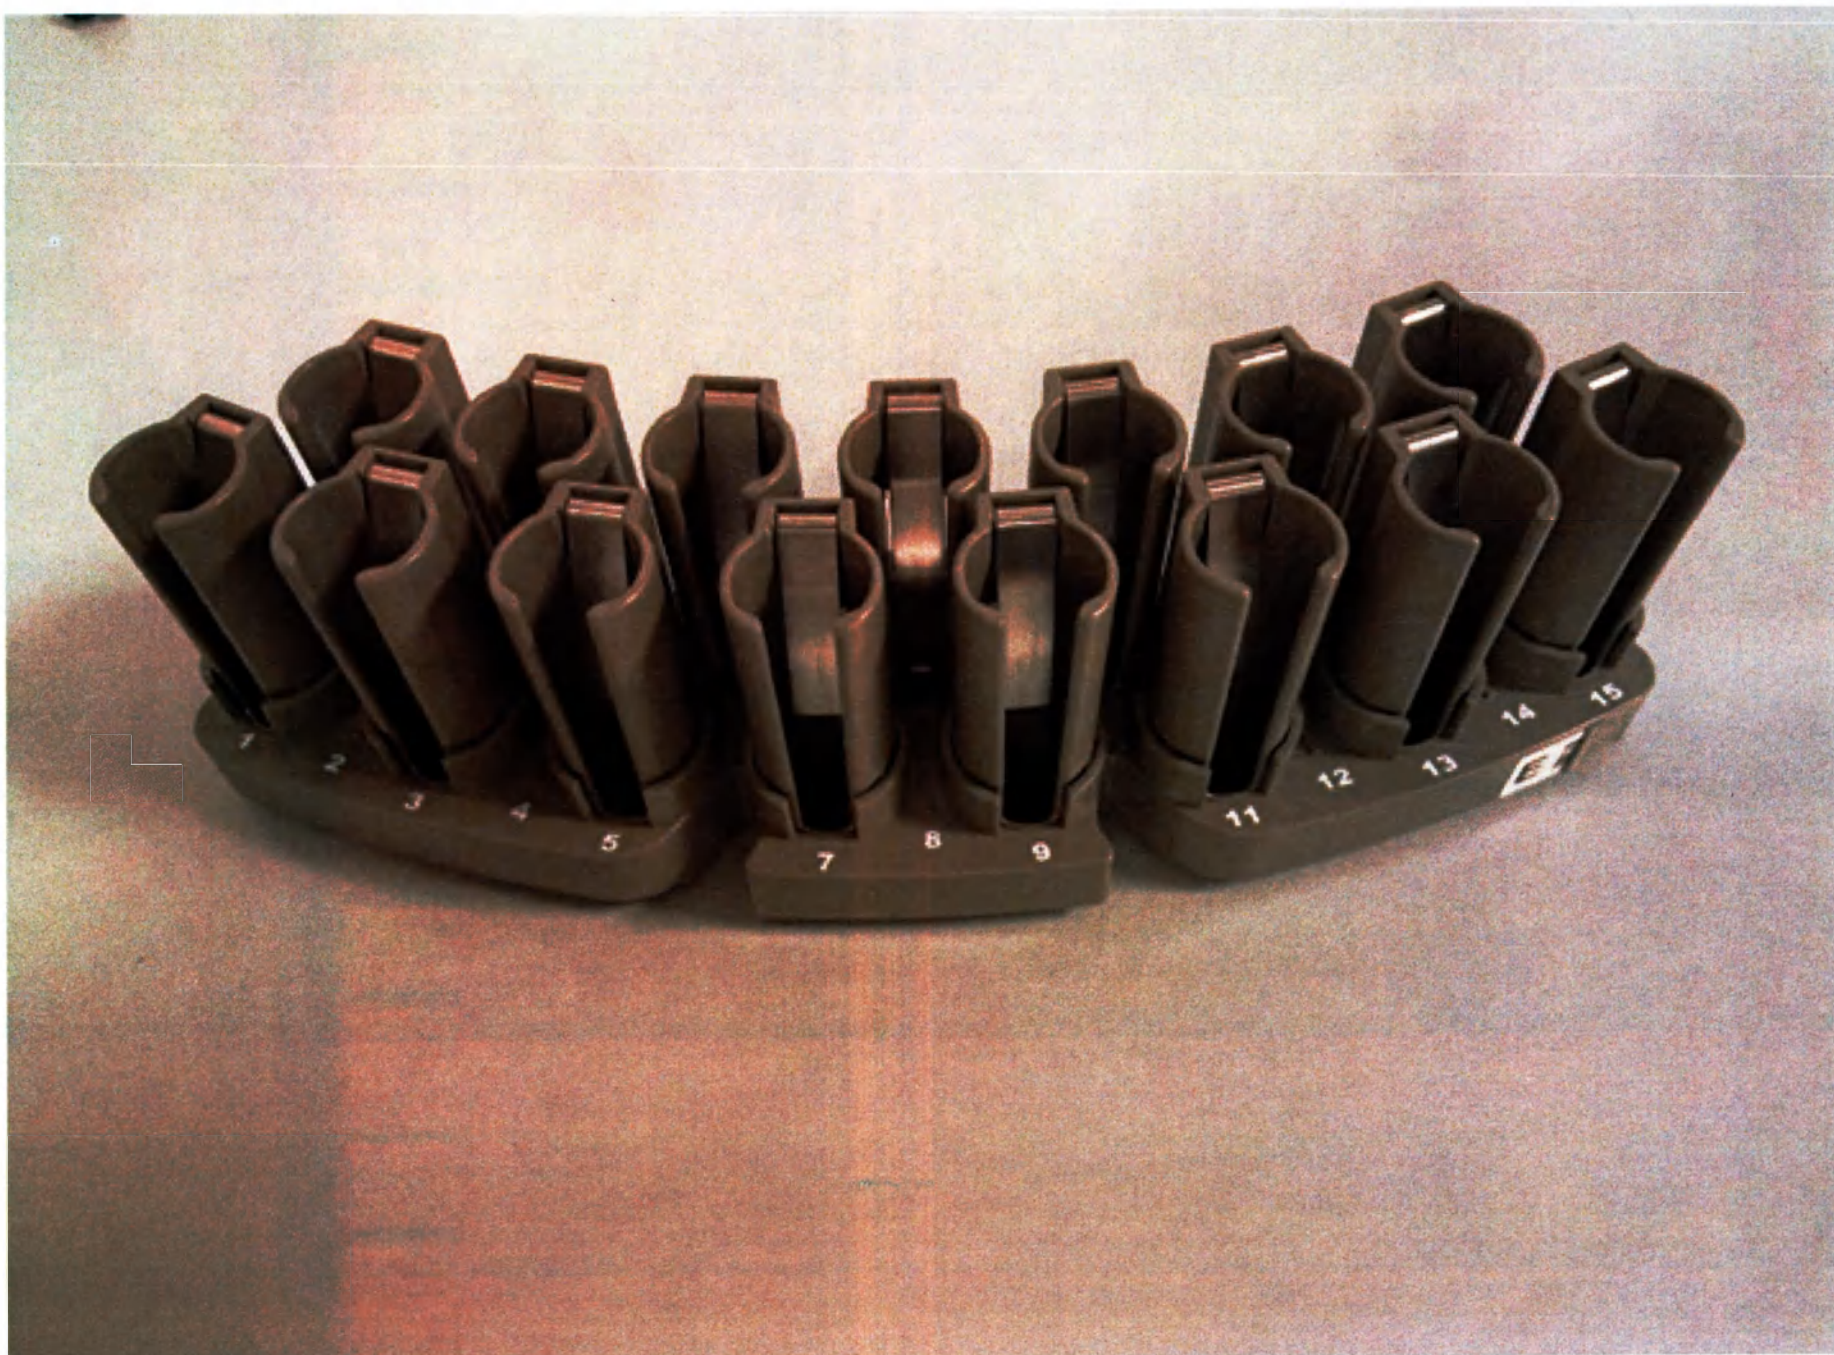


Рисунок 60. Штативы для пробирок



Рисунок 61. Штативы для проб

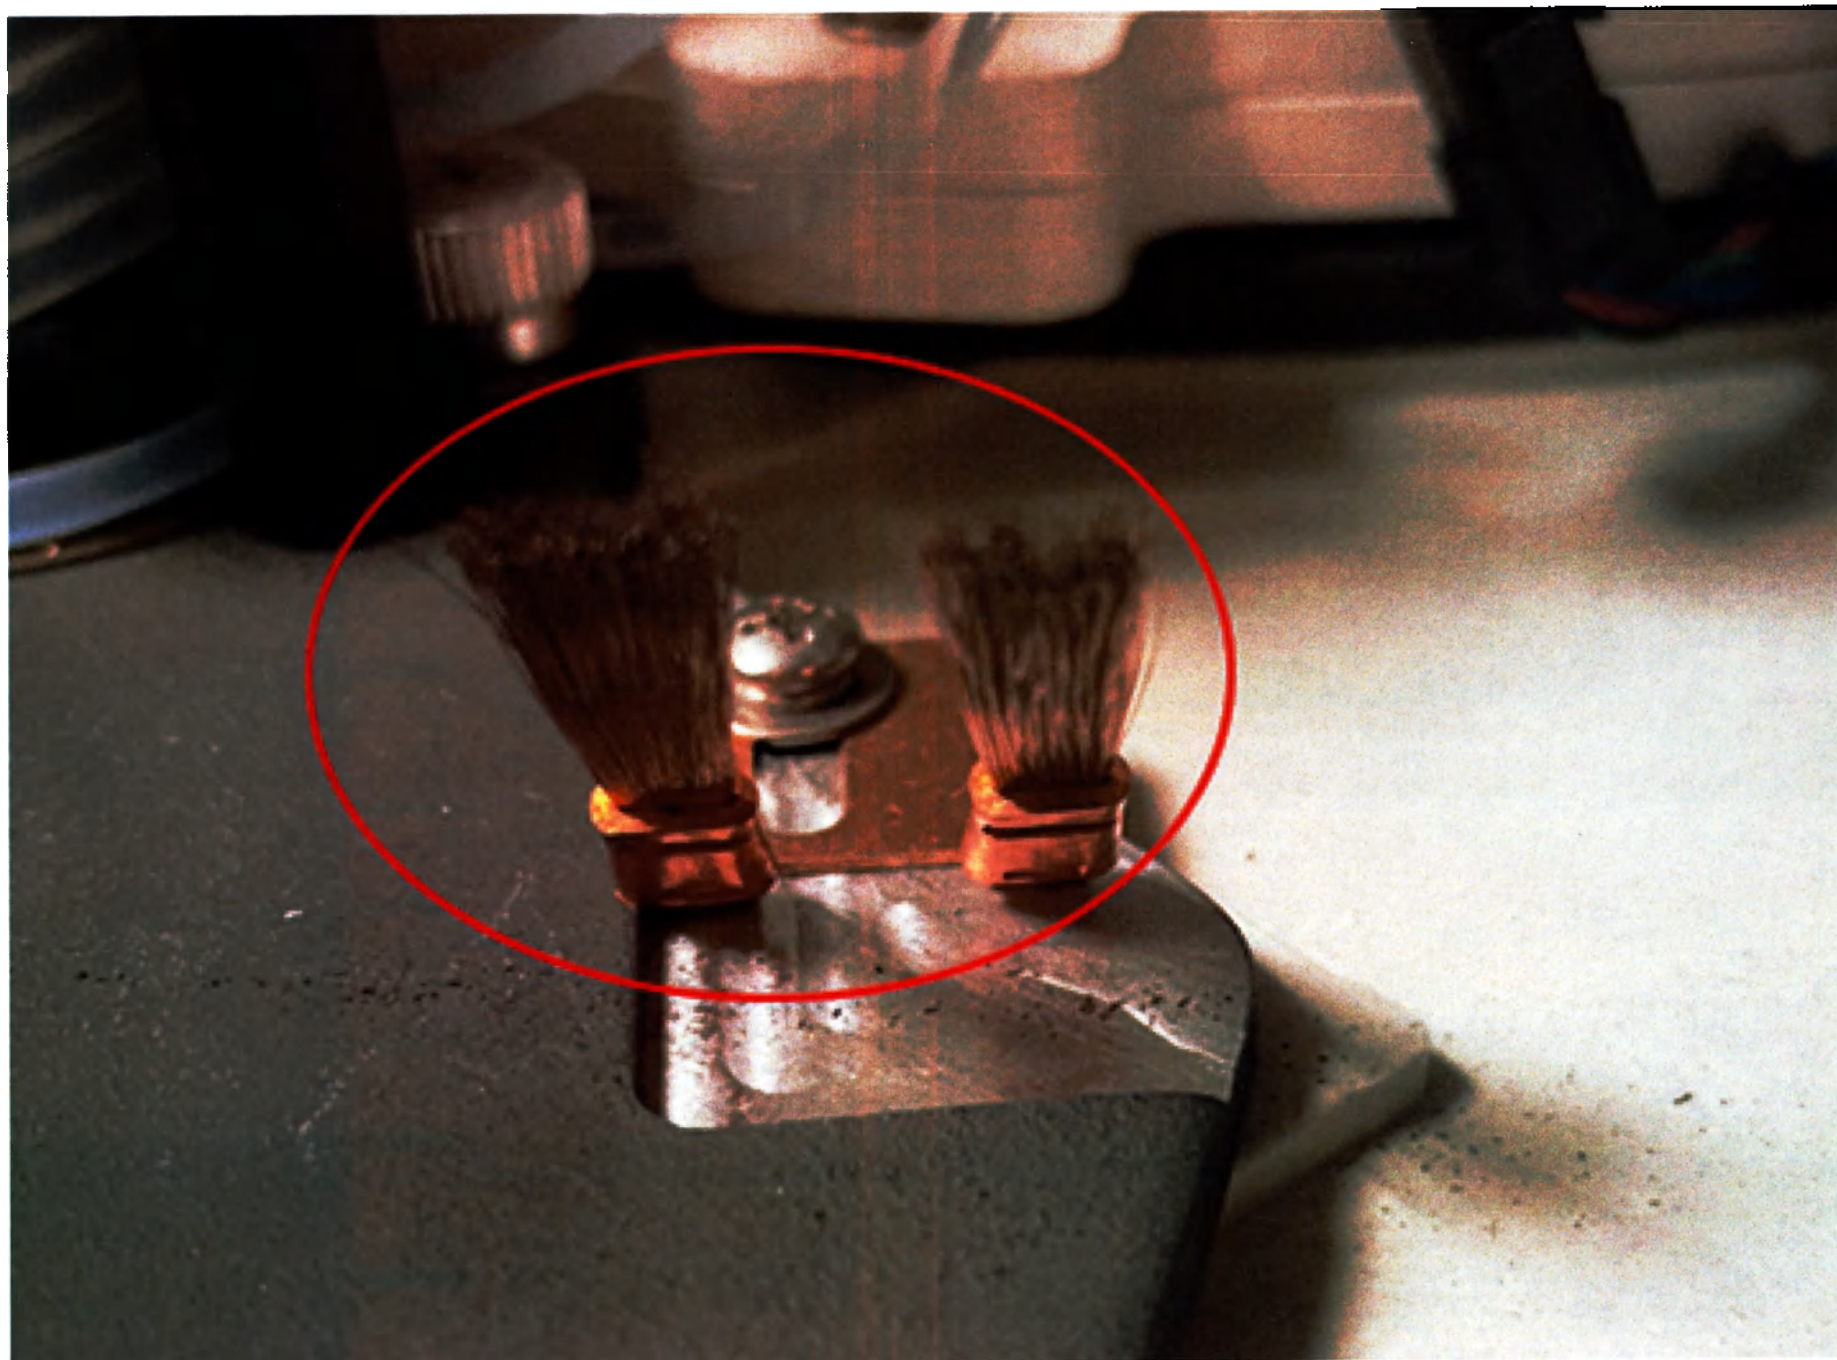


Рисунок 62. Щетка металлическая

Дополнительные принадлежности к анализатору иммунохемилюминесцентному IMMULITE 2000XPI

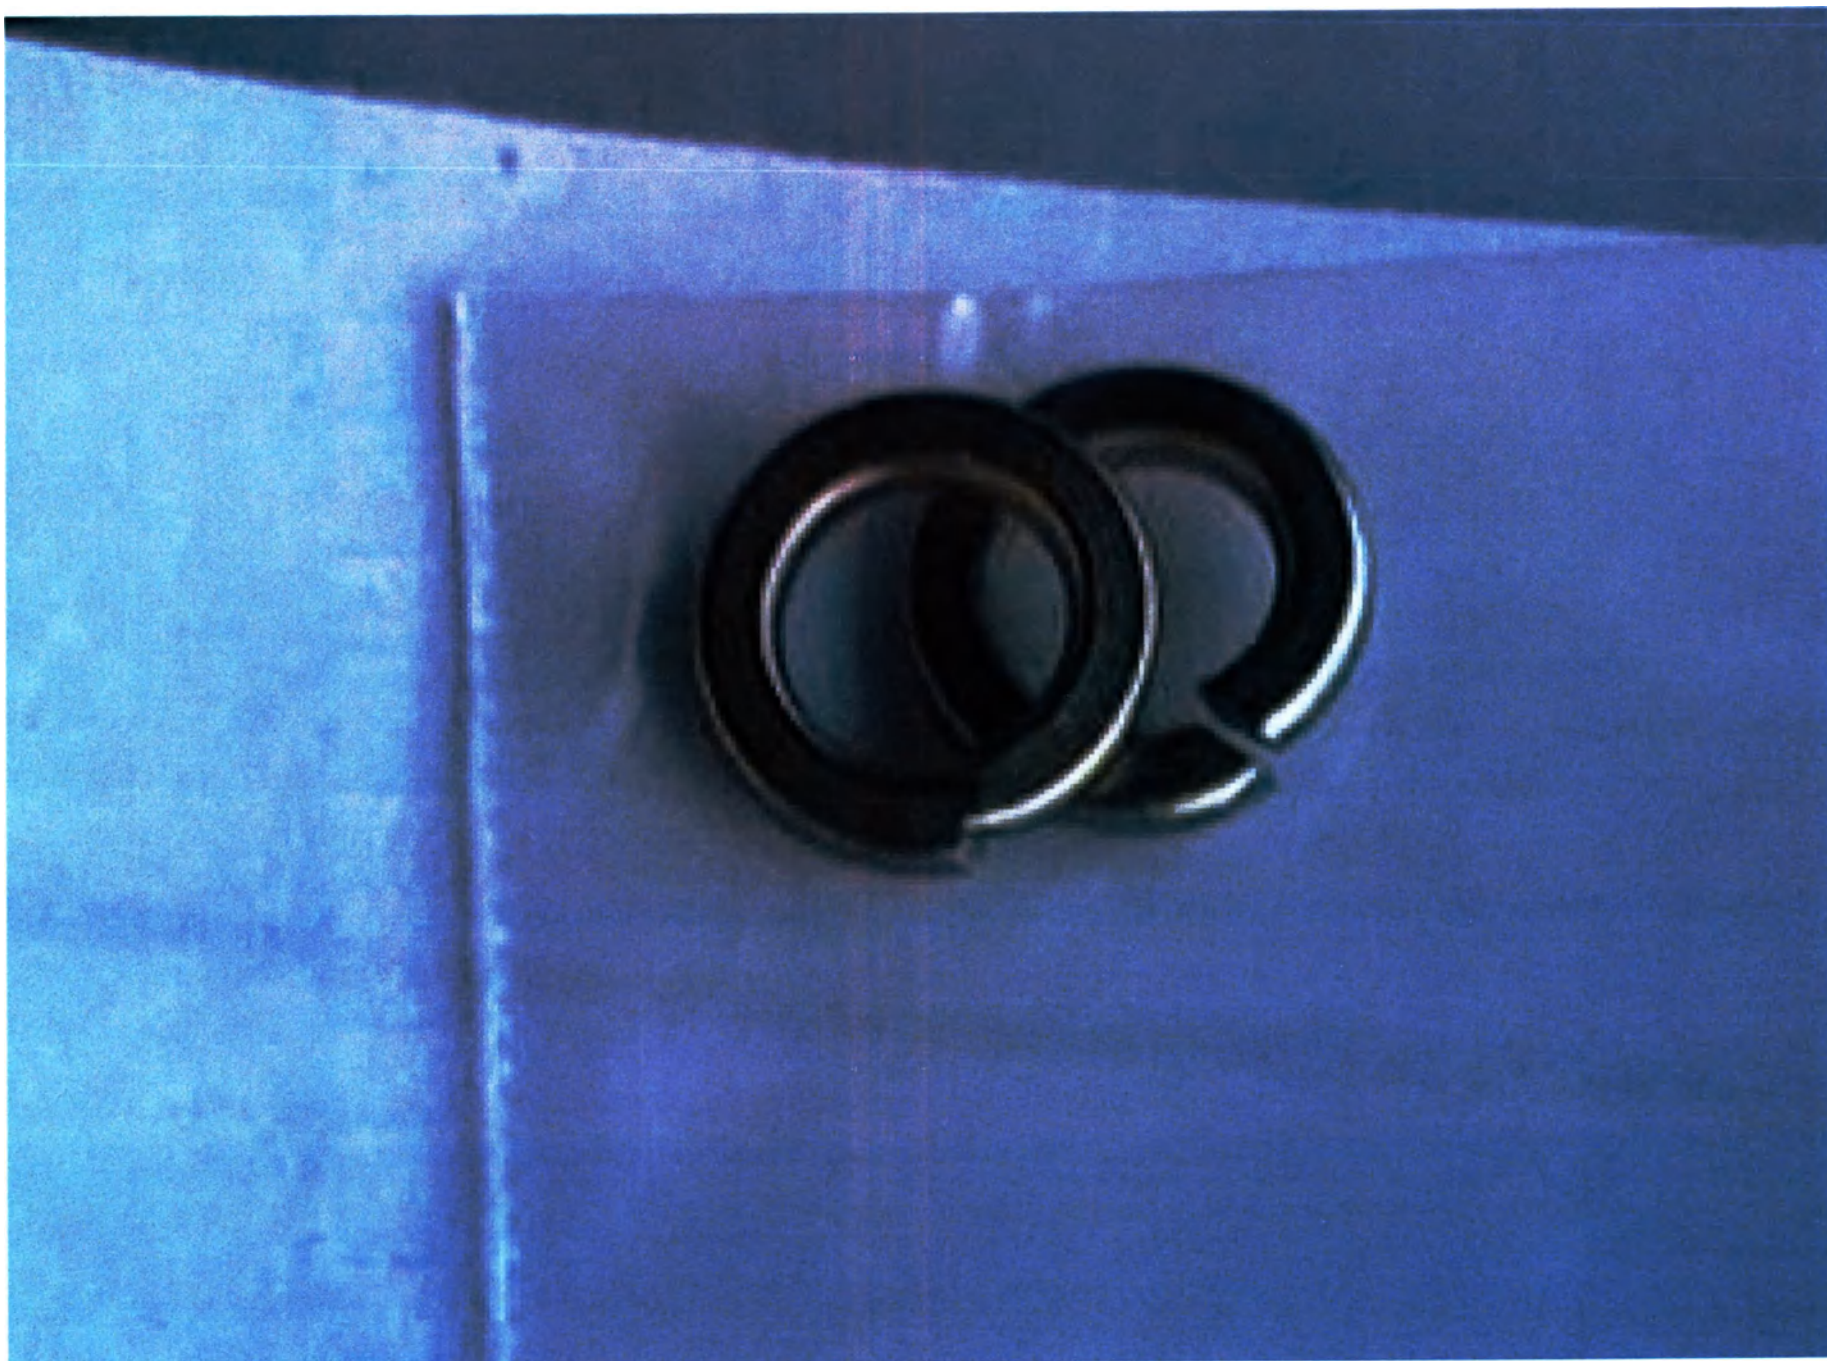


Рисунок 1. Шайбы



Рисунок 2. Подставки для работы с пробирками (для разведения)

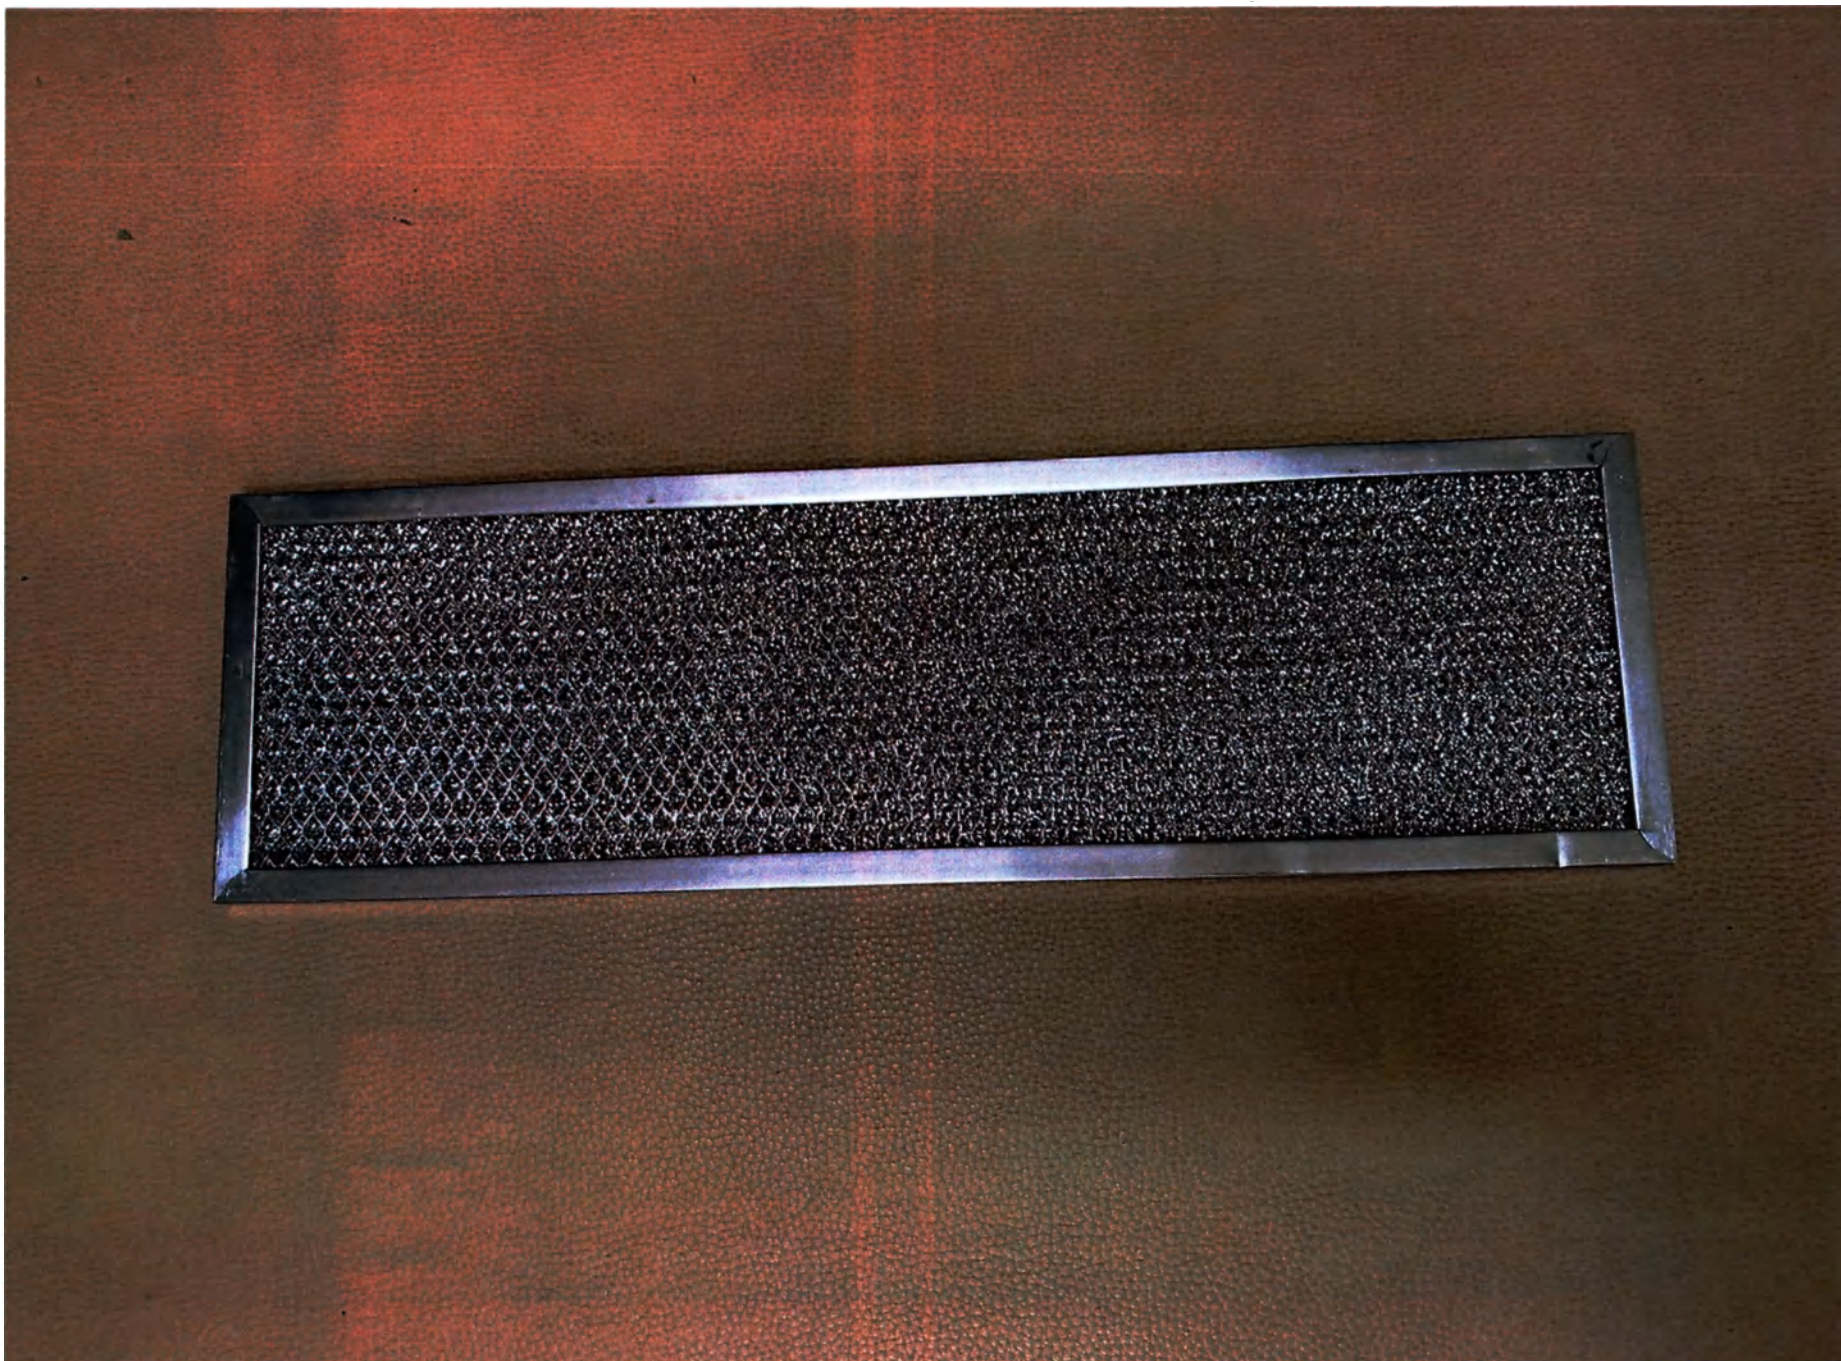


Рисунок 99. Фильтр вентилятора



Упаковка. Фотография транспортной упаковки медицинского изделия.

Всего прошито и пронумеровано
200 листа (ов).

ООО «Сименс Здравоохранение»

