


УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Свето-Кислородные Технологии»

А.С.Мартынов

20 20 г.

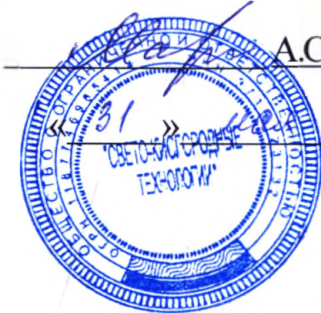

ФОТОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ ОБЩЕГО ВИДА
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Световоды хирургические МВЛ


ТУ 32.50.50-002-34784846-2020


производства:


Общество с ограниченной ответственностью "Свето-Кислородные Технологии" (ООО «Свето-Кислородные Технологии»),
Россия, 107150, Москва г, Бойцовая ул, дом № 27, офис 406.


E-mail: nerpa44@rambler.ru


2022

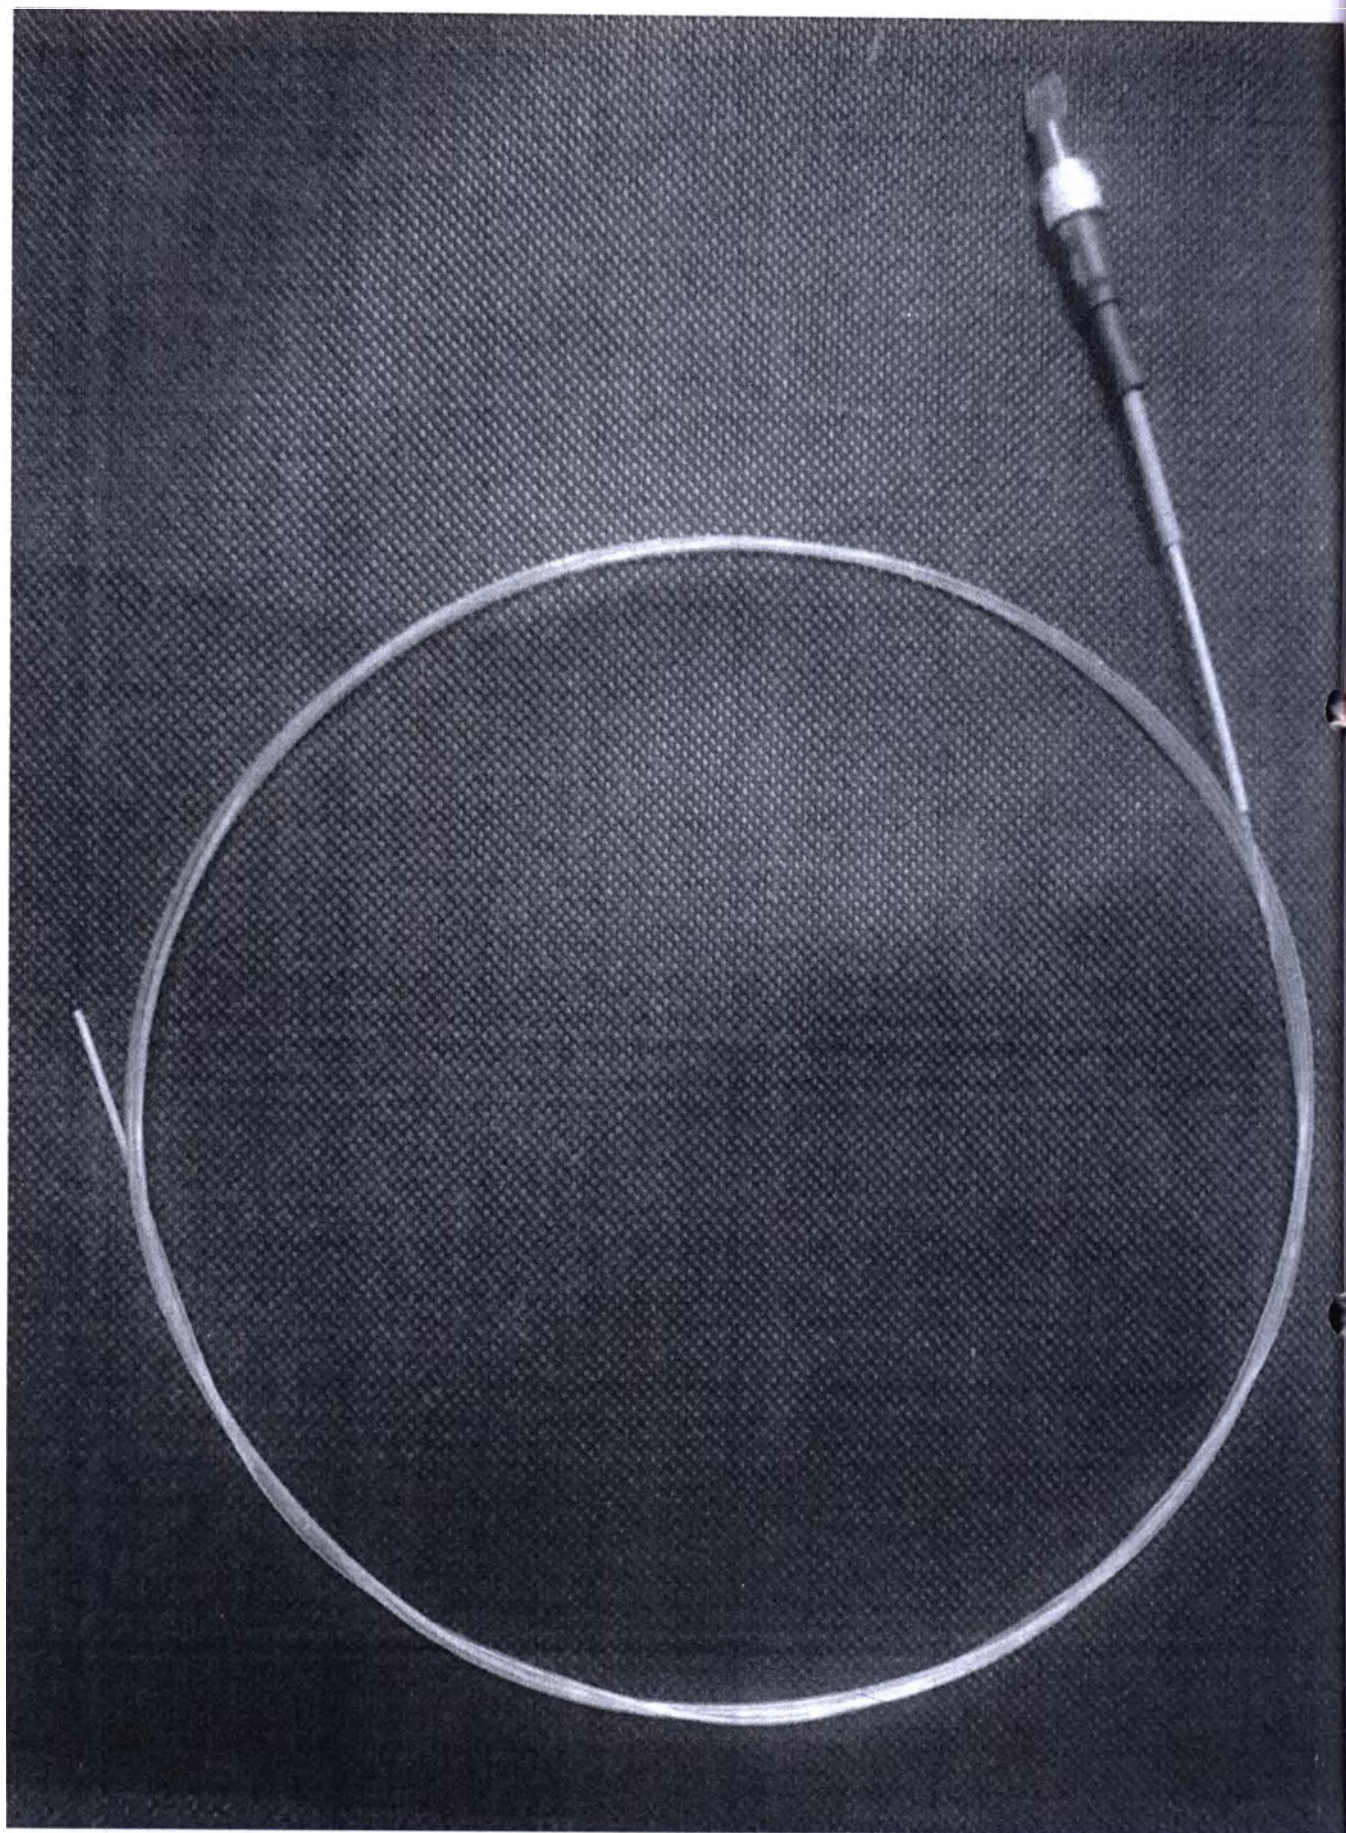


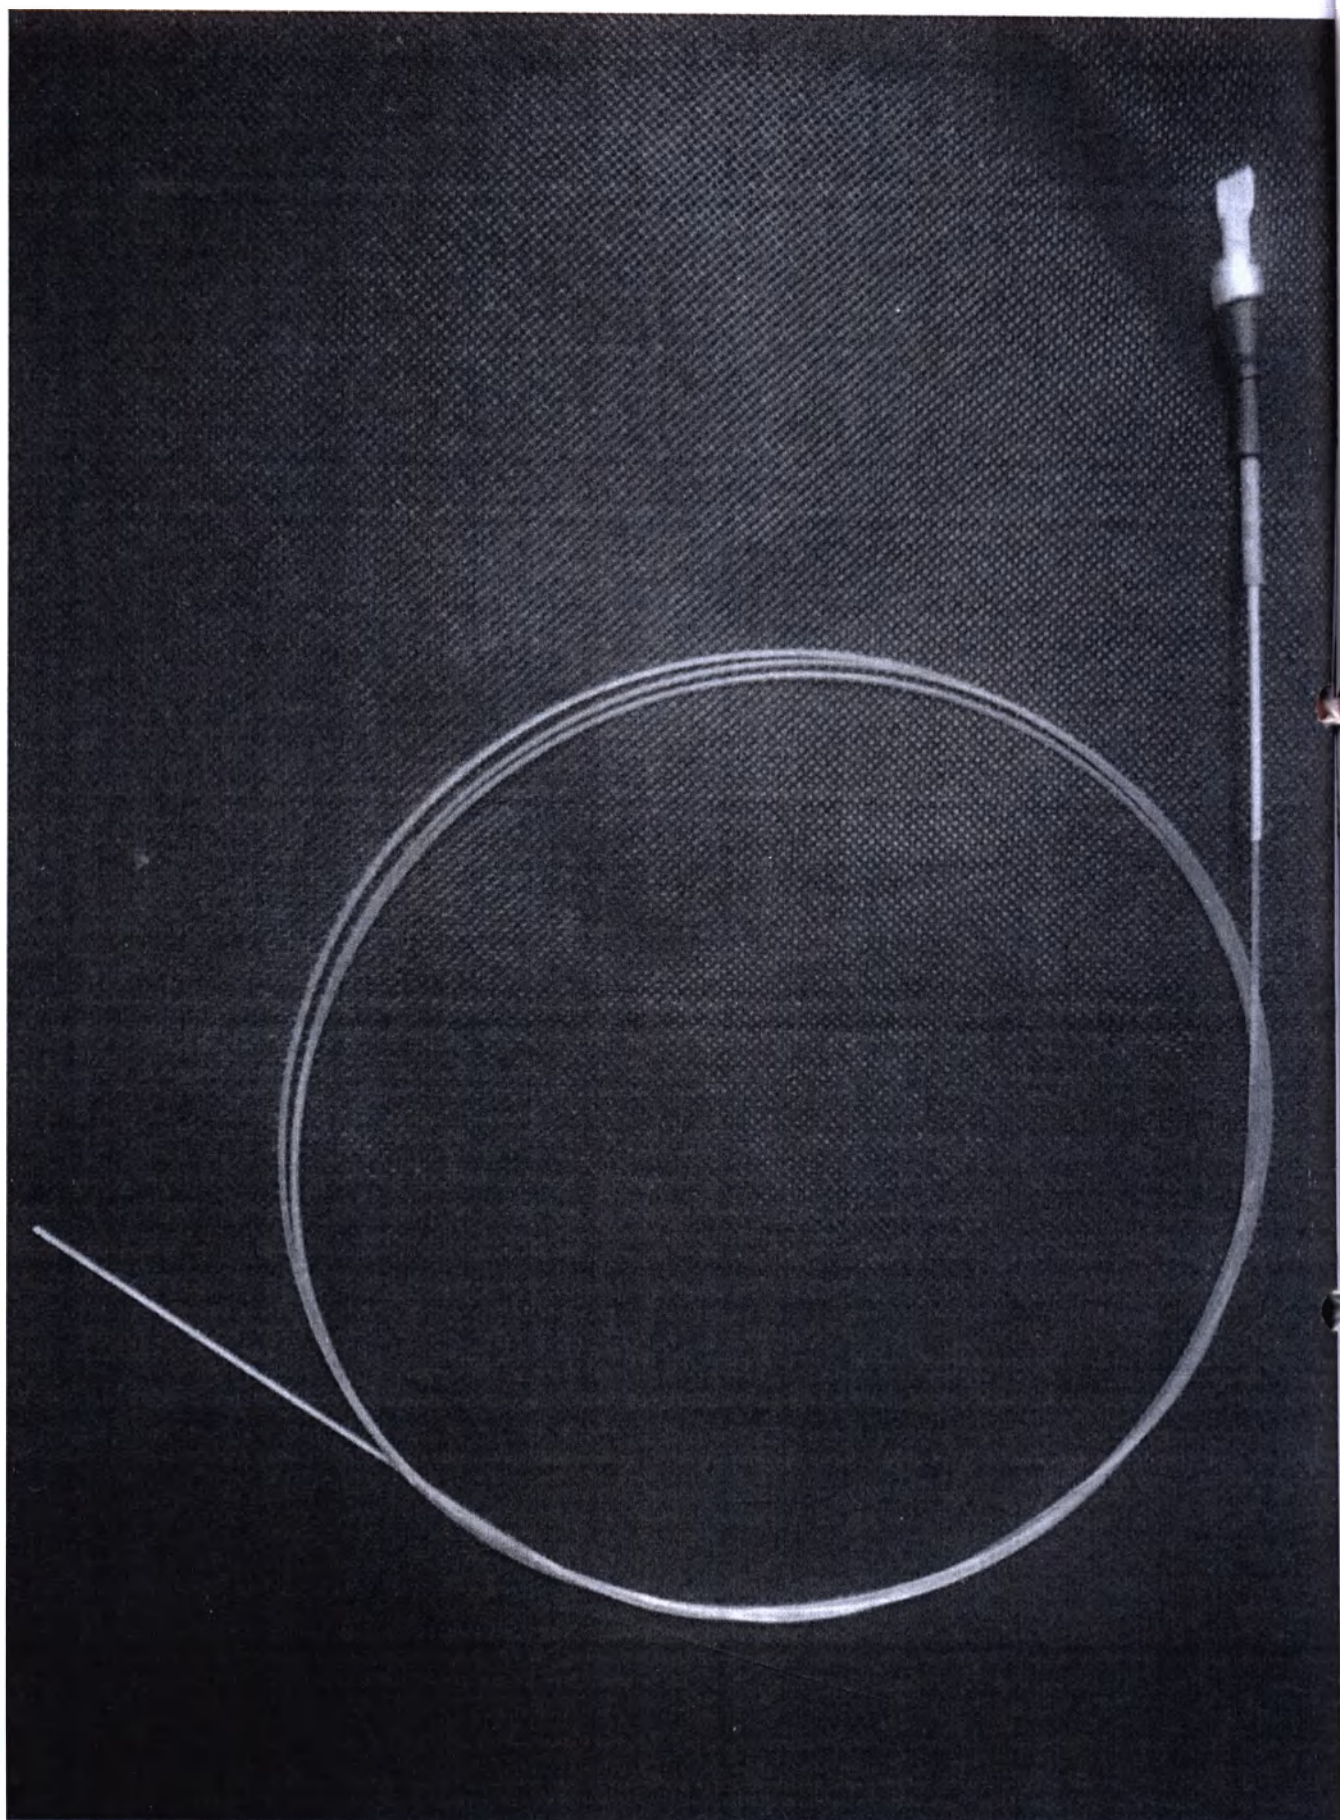


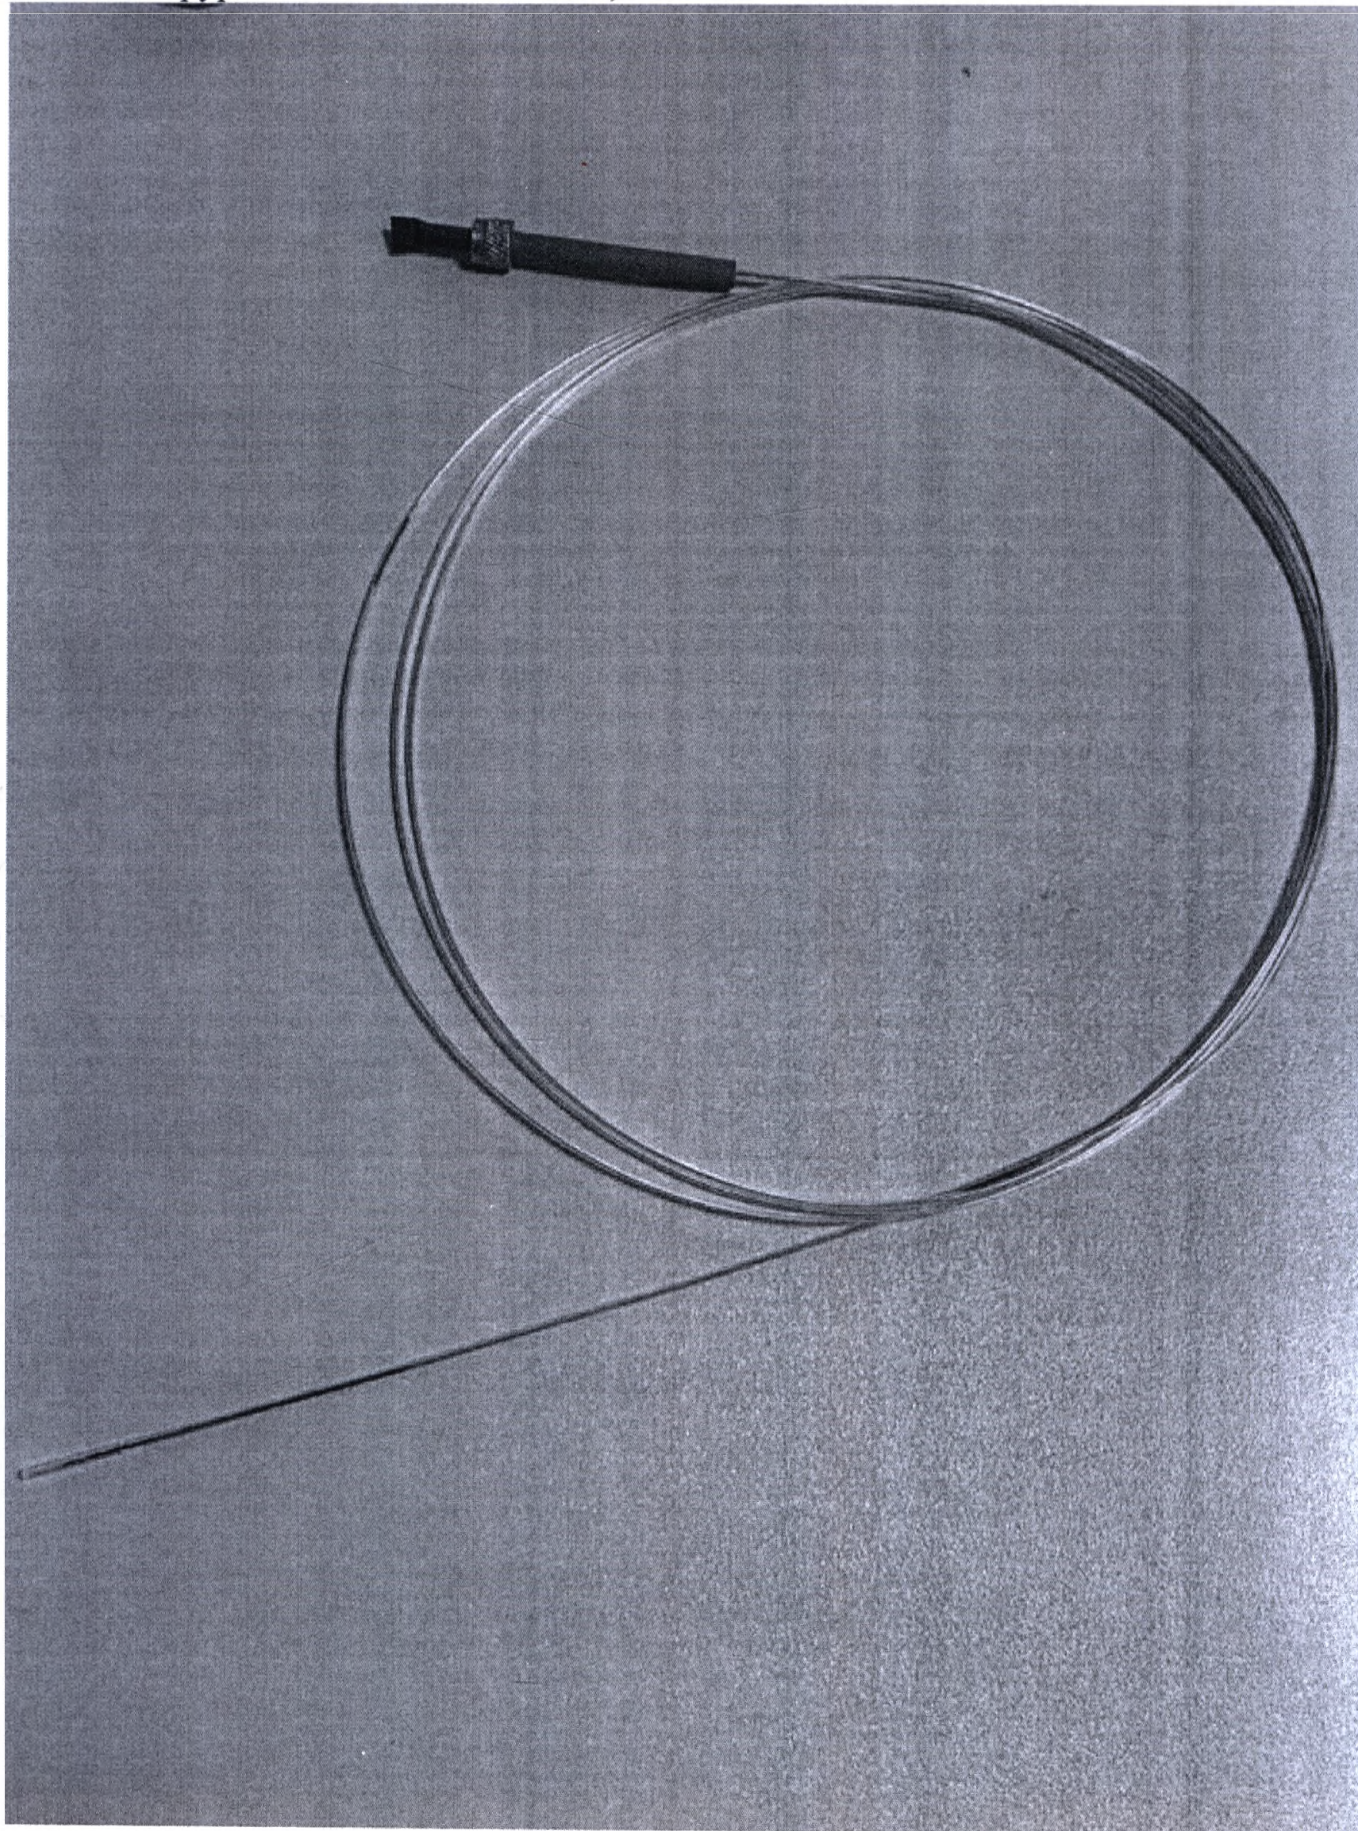


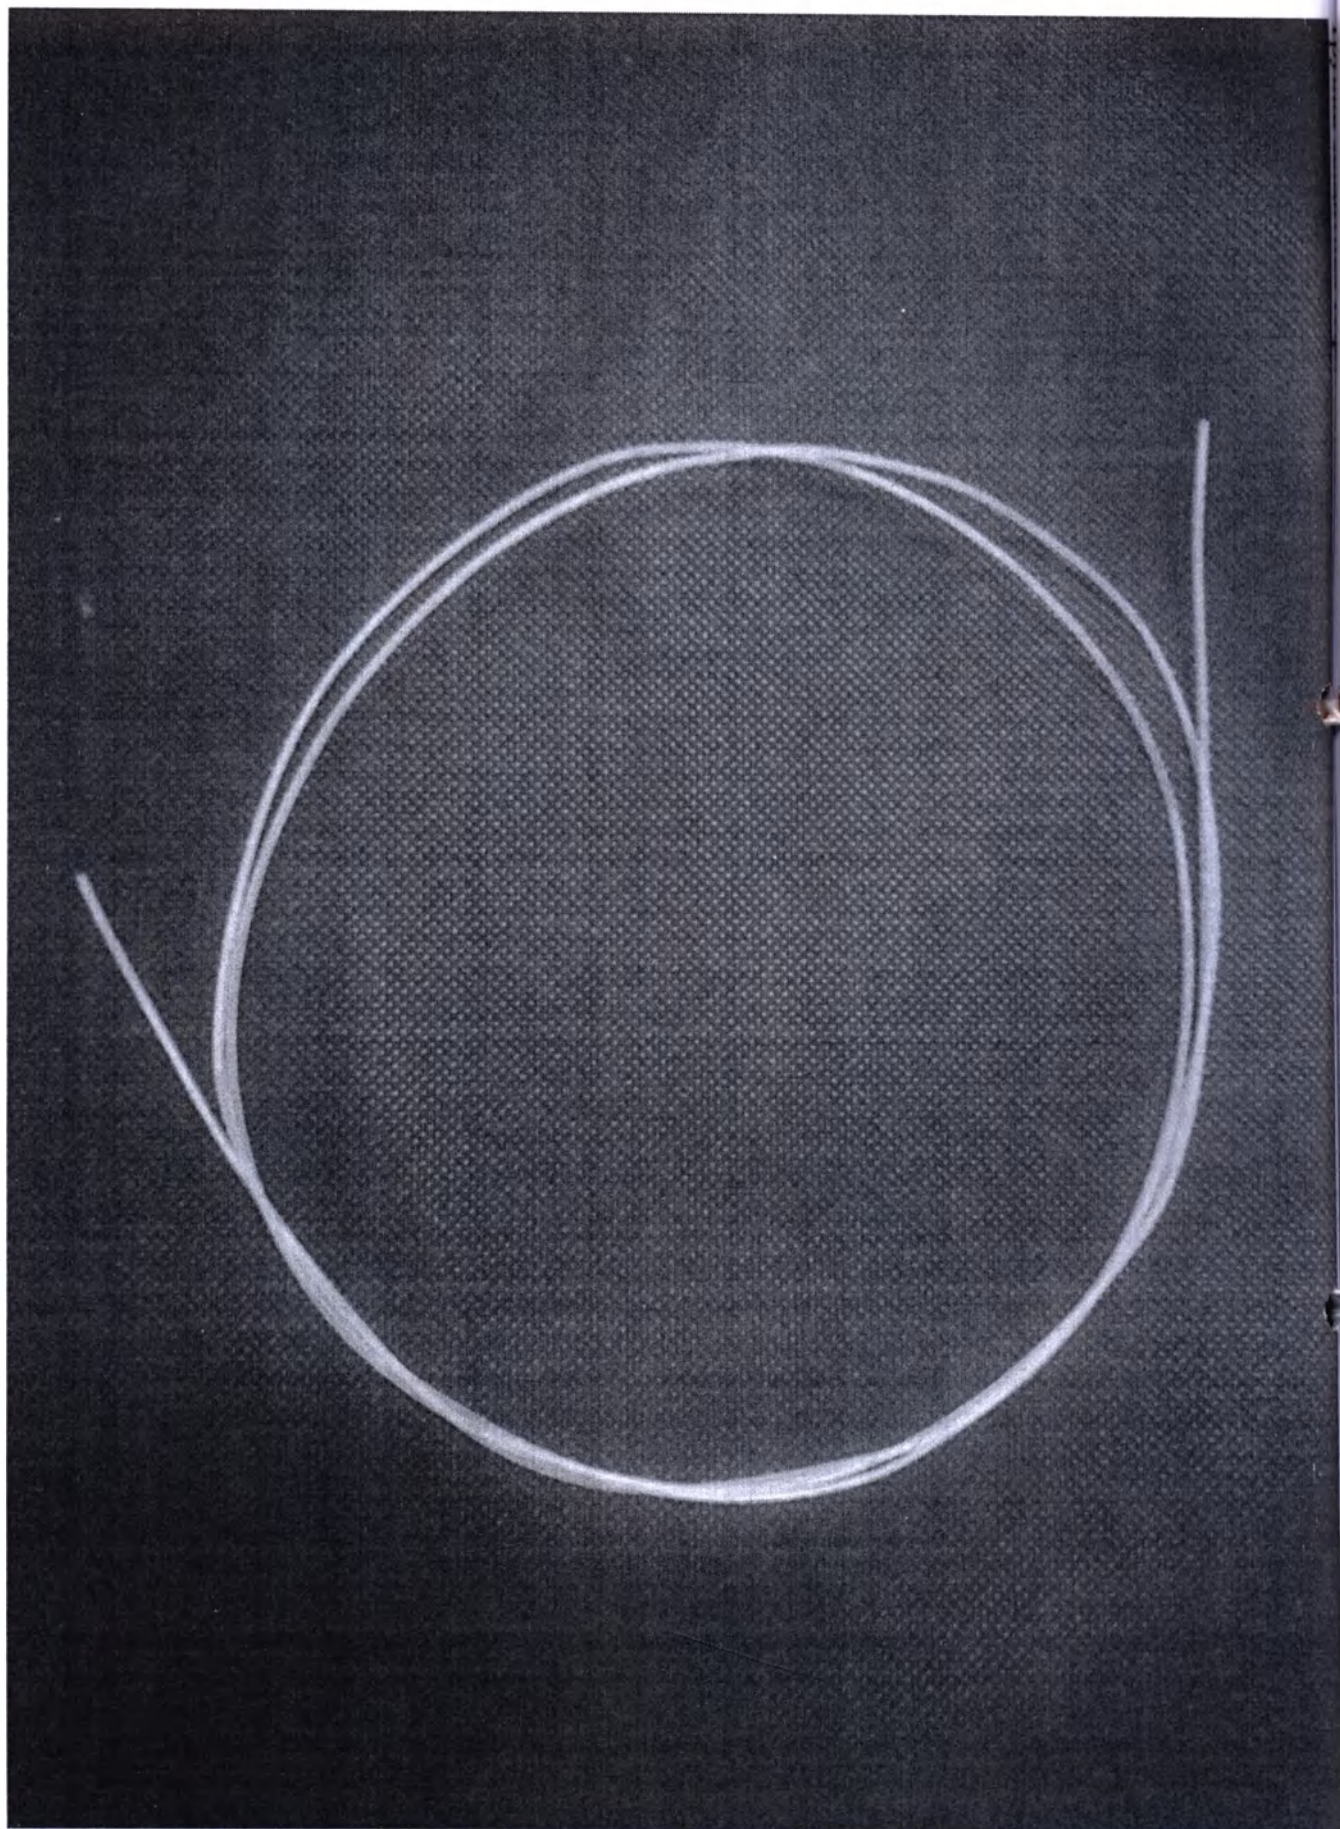

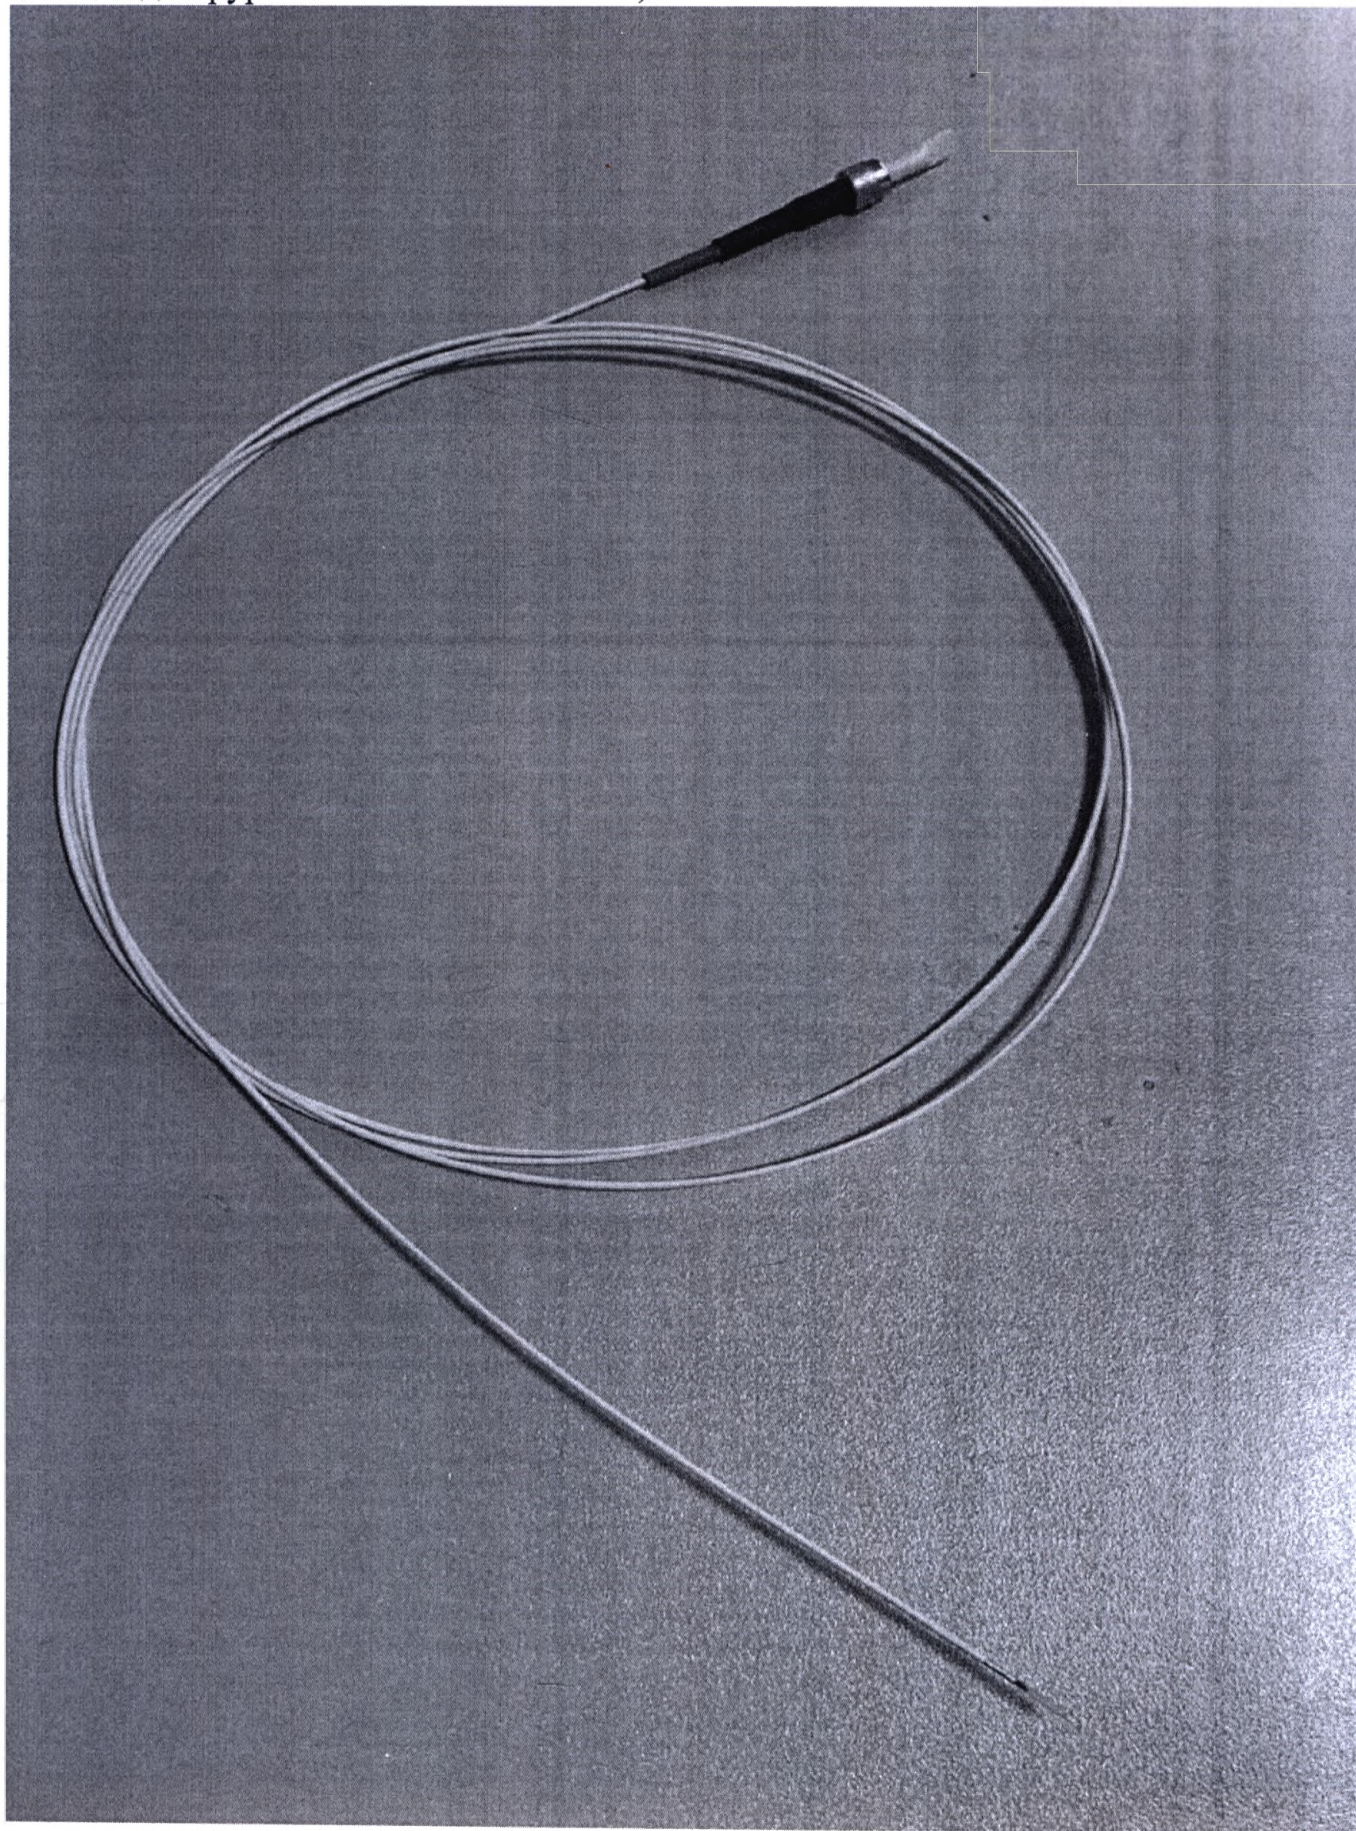

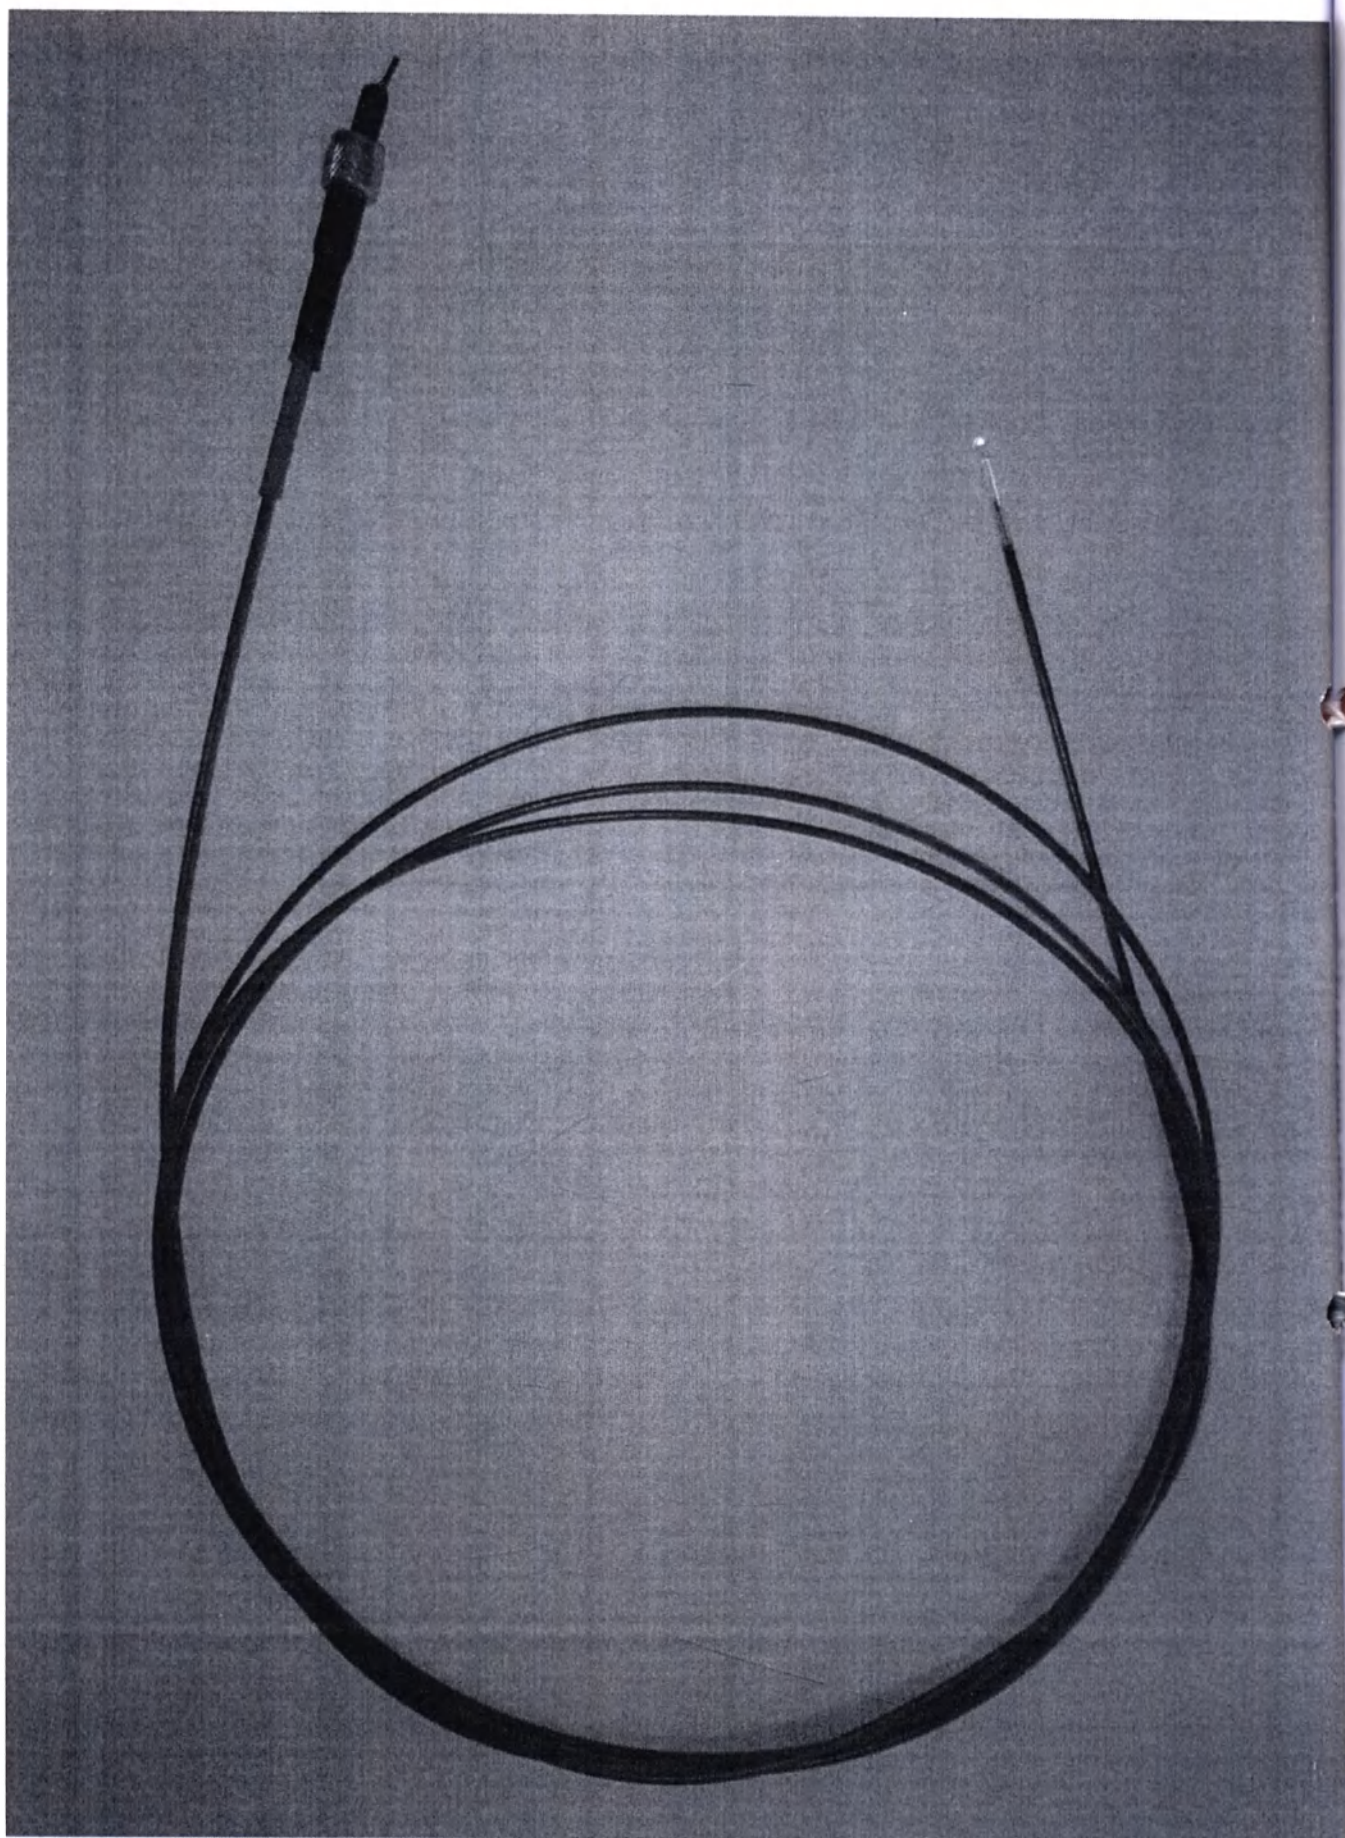

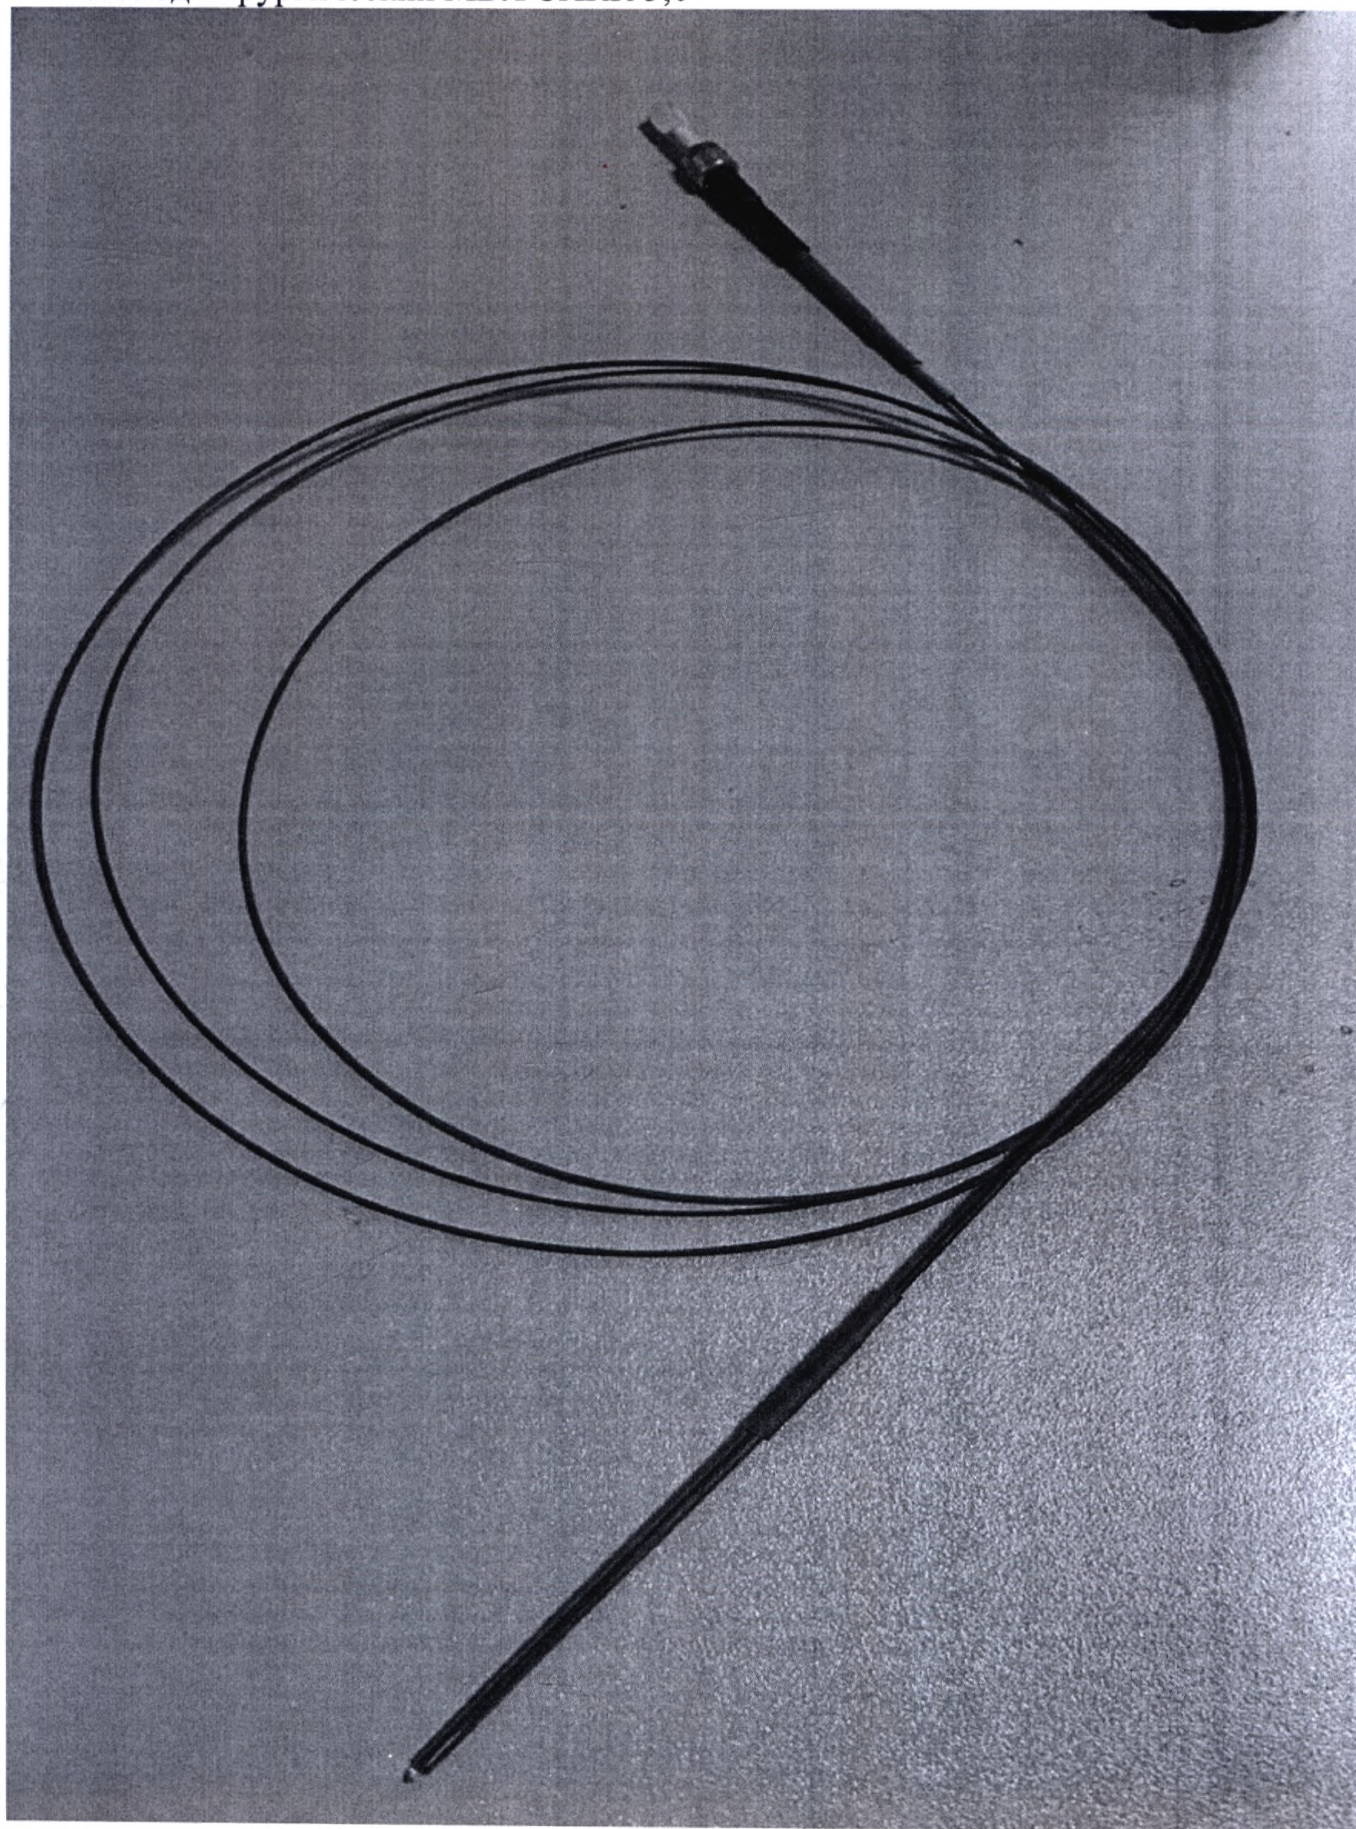

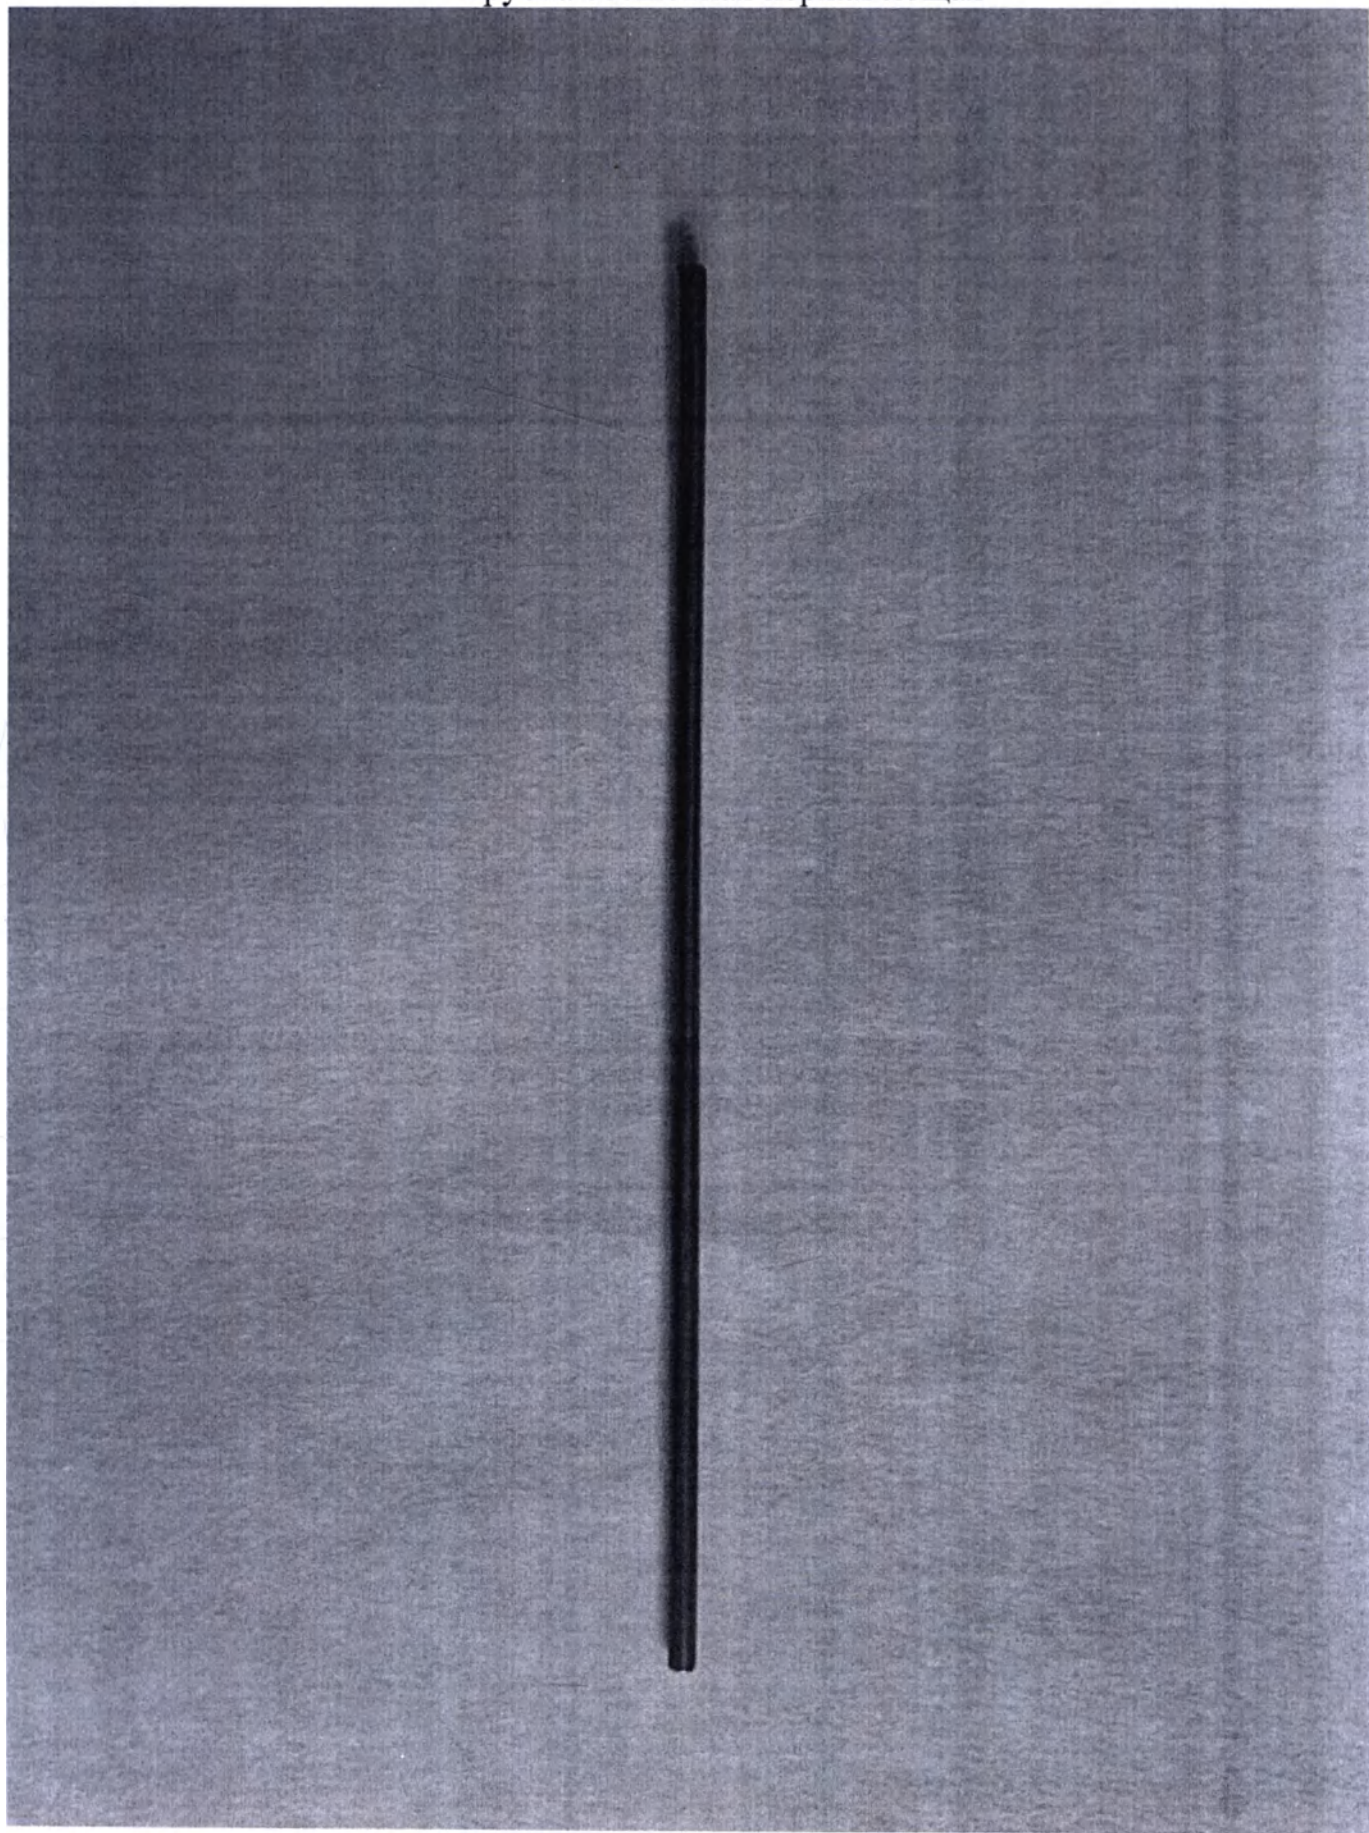

Общество с ограниченной ответственностью
"Свето-Кислородные Технологии"

Световод хирургический МВЛ СХКК 1,9

ТУ 32.50.50-002-34784846-2020



НЕТОКСИЧНО

LOT

Дата стерилизации:


Срок сохранения стерильности с момента стерилизации 2 года.

Максимальное количество циклов повторной стерилизации: 5

– ПОВТОРНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЗМОЖНО ТОЛЬКО ПОСЛЕ ОЧИСТКИ,
ДЕЗИНФЕКЦИИ И СТЕРИЛИЗАЦИИ, В СООТВЕТСТВИИ С МЕТОДАМИ,
УКАЗАННЫМИ В ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ!



Общество с ограниченной ответственностью «Свето-Кислородные Технологии»,
Россия, 107150, Москва г. Бойцовая ул, дом № 27, офис 406.

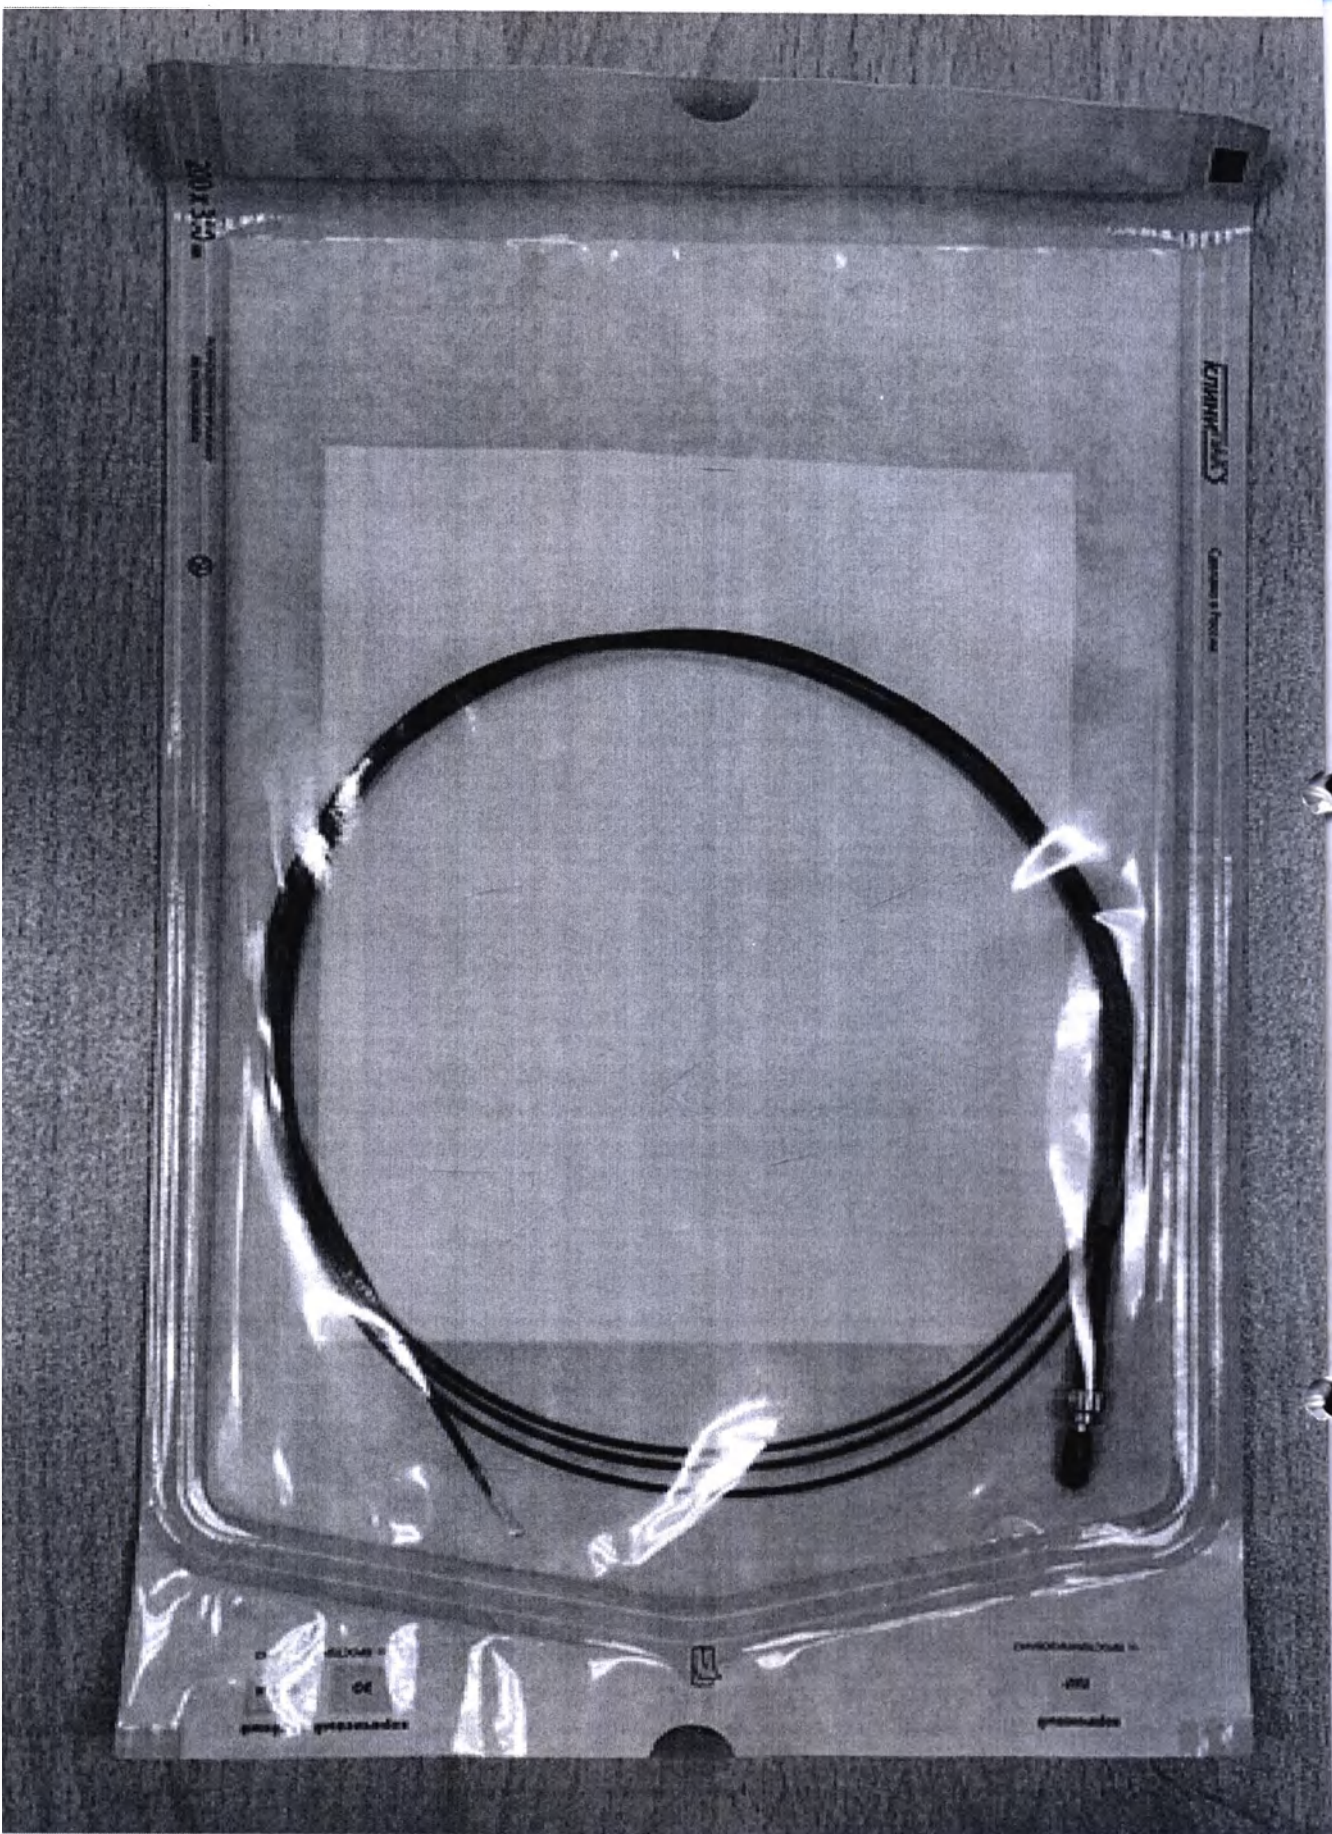

Общество с ограниченной ответственностью
" Свето-Кислородные Технологии "

Световод хирургический МВЛ XXXXXX*

ТУ 32.50.50-002-34784846-2020



НЕТОКСИЧНО



Дата стерилизации:

Срок сохранения стерильности с момента стерилизации 2 года.

Максимальное количество циклов повторной стерилизации: 5

– ПОВТОРНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЗМОЖНО ТОЛЬКО ПОСЛЕ ОЧИСТКИ,
ДЕЗИНФЕКЦИИ И СТЕРИЛИЗАЦИИ, В СООТВЕТСТВИИ С МЕТОДАМИ, УКАЗАННЫМИ В
ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ!



Общество с ограниченной ответственностью «Свето-Кислородные Технологии», Россия,
107150, Москва г, Бойцовая ул, дом № 27, офис 406.

Премьер 12 месяцев

31.05.2022

Ген. директор

Мартьянов

