


# ООО «КОМ СПАН»

115035, Россия, г. Москва, Космодамианская наб., д 40-42, стр. 3, эт. 1, пом.  
XVII, ком. 1 оф. 2 • Тел/факс: (495) 434-45-06

---

УТВЕРЖДАЮ  
Генеральный директор  
ООО «Ком Спан»

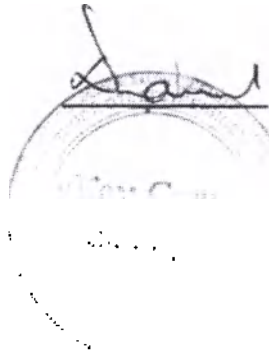

Равал Дхармендра Кумар Чандулал

"21" декабря 2020 г.

**Фотографические изображения медицинского изделия**

**Изделие офтальмологическое вискохирургическое Viscolon**

**Состав:**

Гидроксиэтилметакрилат 2% w/v  
Буферный растворитель q.l.

**Без консервантов.**

Только для внутримышечного введения.

Не для инъекций. Разовое доз.

Для однократного использования.

Не термостойкий.

Хранить при температуре от 2 до 30°С.

Вскрыть не стоит.

Не использовать, если обнаружено помутнение

раствора или посторонние частицы.

Дозы: по рекомендации врача.

Только для применения лицензированным медицинским

работником, обученным употреблению

устройства. **Искон Девайс (Pvt) Лтд.**

**Искон Девайс (Pvt) Лтд.**

**Искон Девайс (Pvt) Лтд.**

**Искон Девайс (Pvt) Лтд.**

**Искон Девайс (Pvt) Лтд.**

**Искон Девайс (Pvt) Лтд.**

**Искон Девайс (Pvt) Лтд.**

**Искон Девайс (Pvt) Лтд.**

**Искон Девайс (Pvt) Лтд.**

**Искон Девайс (Pvt) Лтд.**

**Искон Девайс (Pvt) Лтд.**

**Искон Девайс (Pvt) Лтд.**

**Искон Девайс (Pvt) Лтд.**

**Искон Девайс (Pvt) Лтд.**

**Искон Девайс (Pvt) Лтд.**

**Искон Девайс (Pvt) Лтд.**

**Искон Девайс (Pvt) Лтд.**

**Искон Девайс (Pvt) Лтд.**

**Искон Девайс (Pvt) Лтд.**

**Искон Девайс (Pvt) Лтд.**

**Искон Девайс (Pvt) Лтд.**

**Искон Девайс (Pvt) Лтд.**

**Искон Девайс (Pvt) Лтд.**

**Искон Девайс (Pvt) Лтд.**

**Искон Девайс (Pvt) Лтд.**

**Искон Девайс (Pvt) Лтд.**

**Искон Девайс (Pvt) Лтд.**

**Искон Девайс (Pvt) Лтд.**

**Искон Девайс (Pvt) Лтд.**

**Искон Девайс (Pvt) Лтд.**

**Искон Девайс (Pvt) Лтд.**

**Искон Девайс (Pvt) Лтд.**

**Искон Девайс (Pvt) Лтд.**

**Искон Девайс (Pvt) Лтд.**

**Искон Девайс (Pvt) Лтд.**

**Искон Девайс (Pvt) Лтд.**

**Искон Девайс (Pvt) Лтд.**

**Искон Девайс (Pvt) Лтд.**

**Искон Девайс (Pvt) Лтд.**

**Искон Девайс (Pvt) Лтд.**

**Искон Девайс (Pvt) Лтд.**

**Искон Девайс (Pvt) Лтд.**

**Искон Девайс (Pvt) Лтд.**

**Искон Девайс (Pvt) Лтд.**

**Искон Девайс (Pvt) Лтд.**

**Искон Девайс (Pvt) Лтд.**

**Искон Девайс (Pvt) Лтд.**

**Искон Девайс (Pvt) Лтд.**

**Искон Девайс (Pvt) Лтд.**

**Искон Девайс (Pvt) Лтд.**

**Искон Девайс (Pvt) Лтд.**

**Искон Девайс (Pvt) Лтд.**

**Искон Девайс (Pvt) Лтд.**

**Искон Девайс (Pvt) Лтд.**

**Искон Девайс (Pvt) Лтд.**

**Искон Девайс (Pvt) Лтд.**

**Искон Девайс (Pvt) Лтд.**

**Искон Девайс (Pvt) Лтд.**

**Искон Девайс (Pvt) Лтд.**

**Искон Девайс (Pvt) Лтд.**

**Искон Девайс (Pvt) Лтд.**

**Искон Девайс (Pvt) Лтд.**

**Искон Девайс (Pvt) Лтд.**

**Искон Девайс (Pvt) Лтд.**

**Искон Девайс (Pvt) Лтд.**

**Изделие офтальмологическое вискохирургическое Viscolon**

**Viscolon P.F. Syringe – 2 мл в шприце**

стерильный раствор

предварительно наполненный препарат



Компания Офтальмо-медикал Диагностика (Синдеска)  
Ophthalmics and Diagnostics)

Объем: 2 мл

Участок №15, Ганди Оил Милс Комплаунд, Конта Каре Индия,  
район - ВЕД, ГОРВА, Вадодра, Гуджарат, 390016 (PLOT NO.  
15, GANDHI OIL MILL COMPOUND, CONTA CARE INDIA,  
NEAR BEDC, ODHWA, Vadodra, Gujarat, 390016)

LOT 18G34

07/2018

06/2021

Место производства:

Компания Офтальмо-медикал Диагностика (Синдеска)  
Ophthalmics and Diagnostics)

Адрес: 310/В&Е, Дерия Дабхаса, Падра Талука, Район Вадодра  
- 391440, Гуджарат, Индия (310/В&Е, Dabhasa Village, Padra  
Taluka, Vadodra District - 391440, Gujarat, India)

CE



ISO 9001

ISO 13485

Рег. удостоверение № ФСЗ 2012/12074 от 26.05.2020 г.

Уполномоченный представитель в России

ООО "Искон" Адрес: 119033, Россия, г. Москва, Коломенский наб., д. 40-42, стр. 3, эт. 2, пом. XVII, пом. 1, оф. 2 Телефон: +7 (495) 434 43 00

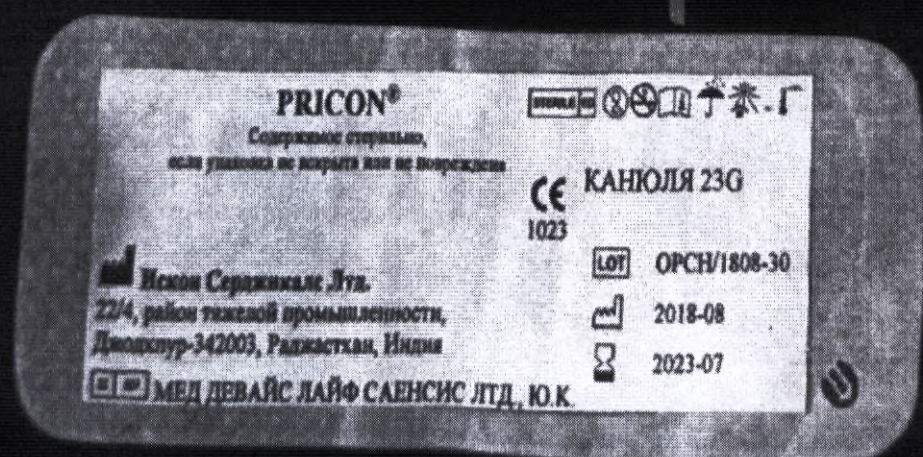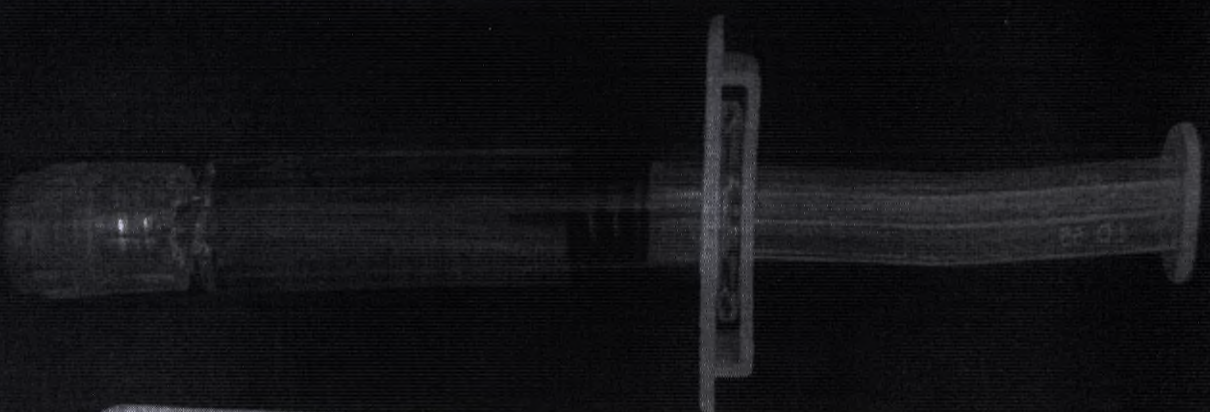

Viscolon P.F. Syringe – 2 мл в шприце с канюлей 23G

**Состав:**

Гидроксиэтилметакрилат 2% м/в  
Водный буферный растворитель q.d.

Без консервантов.

Только внутриматочное использование.

Не для инъекций. Разовая доза.

Для однократного использования.

Не замораживать.

Хранить при температуре от 2° до 30° C.

Беречь от света.

Не использовать, если обнаружено помутнение  
раствора или посторонние частицы.

Доза: по рекомендации врача.

Только для применения дипломированными  
медицинскими работниками, имеющими удостоверение

Министерства Здравоохранения (Ministry of Health)

Лицензия Минздрава, РЕСП. ЛУС. ЗД.

Видеокассета

Видеокассета

Уполномоченный представитель в России

ООО "Ком Стил" Адрес: 115035, Россия, г. Москва, Коммунальный наб., д. 40-42, стр. 3, эт. 1, пом. XVI, кв. 1, оф. 2. Телефон: +7 (495) 434 43 06.

**Индельне офтальмологическое вискохирургическое Viscolon**

**Viscolon Plus P.F. Syringe – 2 мл в шприце**

стерильный раствор

предварительно механической щипки

**ВЫСОКАЯ ВЯЗКОСТЬ**



Контракты Офтальмологии и Диагностика (Contract Ophthalmology and Diagnostic)

Объем 2 мл

Участок №15, Ганди Олл Милл Комплаунд, Конта Сакр Индия, район 4  
BIDC, GORWA, Вадодра, Гуджарат, 390016 (PLOT NO. 15, GANDHI OIL  
MILL COMPOUND, CONTA SAKR INDIA, NEAR BIDC, GORWA,  
Vadodra, Gujarat, 390016)

LOT 18L75

07/2018

06/2021

Место производства:

Контракты Офтальмологии и Диагностика (Contract Ophthalmology and Diagnostic)

Адрес: 310/B&E, Деревня Дабхика, Падра Таппа, Район Вадодра -  
391440, Гуджарат, Индия (310/B&E, Dabhika Village, Padra Taluka,  
Vadodra District - 391440, Gujarat, India)

Рег. удостоверение № ФСЗ 2012/12074 от 26.03.2020 г.

CE

CE

**PRICON®**

Содержимое стерильно,  
если упаковка не вскрыта или не повреждена

СТАНДАРТЫ

CE КАНЮЛЯ 23G

1023

LOT ORCH/1808-30


2018-06

2023-07

Искон Серджиалс Дхд.  
22/4, район тяжелой промышленности,  
Джодхпур-342003, Раджастхан, Индия

МЕД ДЕВАЙС ЛАЙФ СЛЕНСИС ЛТД. Ю.К.

Viscolon Plus P.F. Syringe – 2 мл в шприце с канюлей 23G;

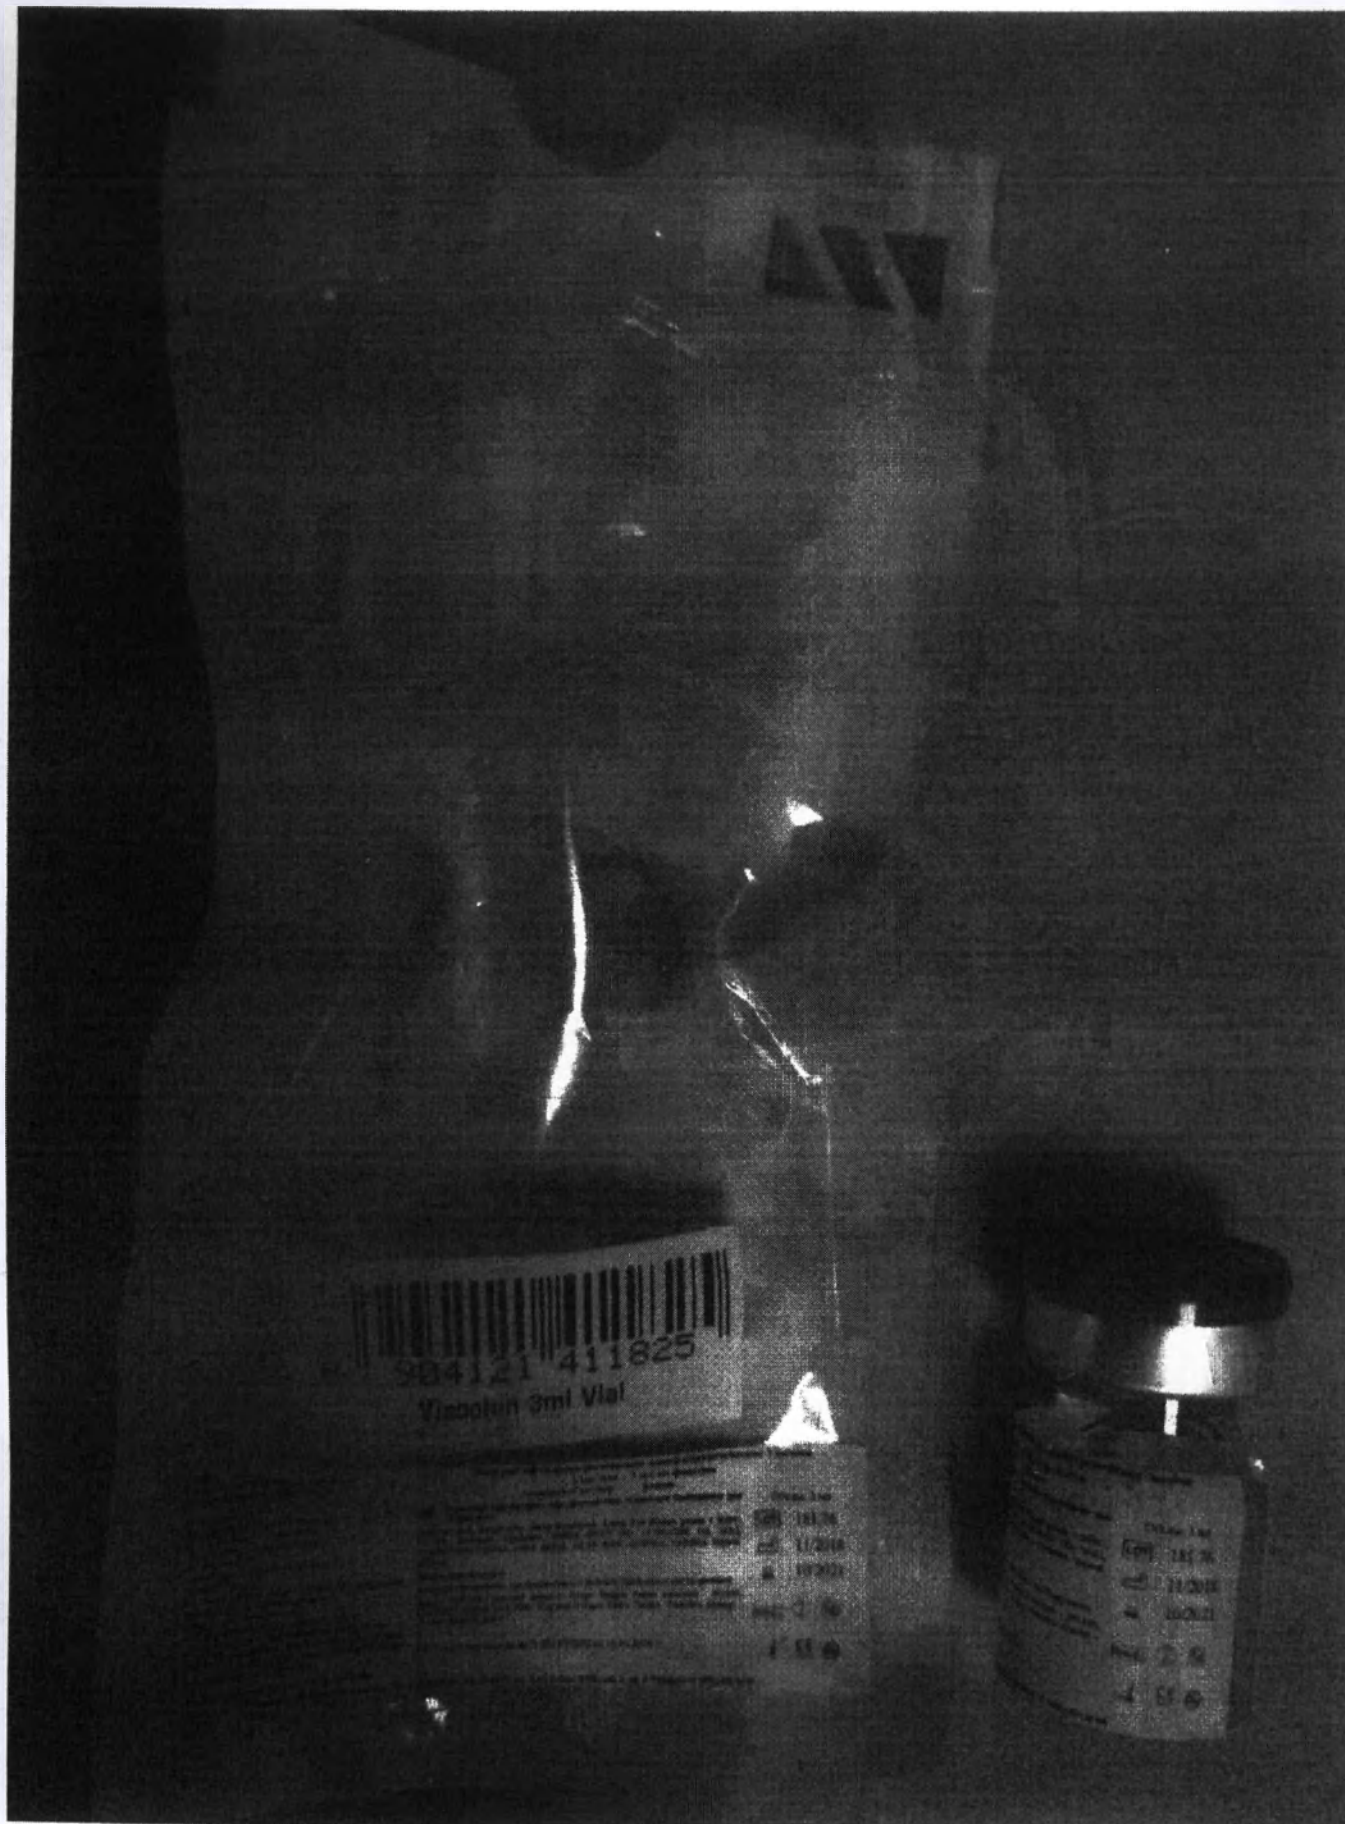

Viscolon – 3 мл во флаконе;



Viscolon – 5 мл во флаконе.