

Утверждаю
Генеральный директор
ООО «Результат-Аудит»




Г. В.Родина

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ


Стенты мочеточниковые Tria в вариантах исполнения

Стенты мочеточниковые Tg1a в вариантах исполнения:


- 1) Стент Tg1a жесткий, с плетеной нитью, 4.8F, длина 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 см, в составе:
 - стент Tg1a – 1 шт.
 - позиционер – 1 шт.
- 2) Стент Tg1a жесткий, 6F, 7F, 8F, длина 20, 22, 24, 26, 28, 30 см, в составе:
 - стент Tg1a – 1 шт.
 - позиционер – 1 шт.
- 3) Стент Tg1a жесткий, без боковых отверстий, 6F, 7F, 8F, длина 20, 22, 24, 26, 28, 30 см, в составе:
 - стент Tg1a – 1 шт.
 - позиционер – 1 шт.
- 4) Стент Tg1a мягкий, 6F, 7F, 8F, длина 20, 22, 24, 26, 28, 30 см, в составе:
 - стент Tg1a – 1 шт.
 - позиционер – 1 шт.
- 5) Стент Tg1a мягкий, без боковых отверстий, 6F, 7F, длина 20, 22, 24, 26, 28, 30 см, в составе:
 - стент Tg1a – 1 шт.
 - позиционер – 1 шт.

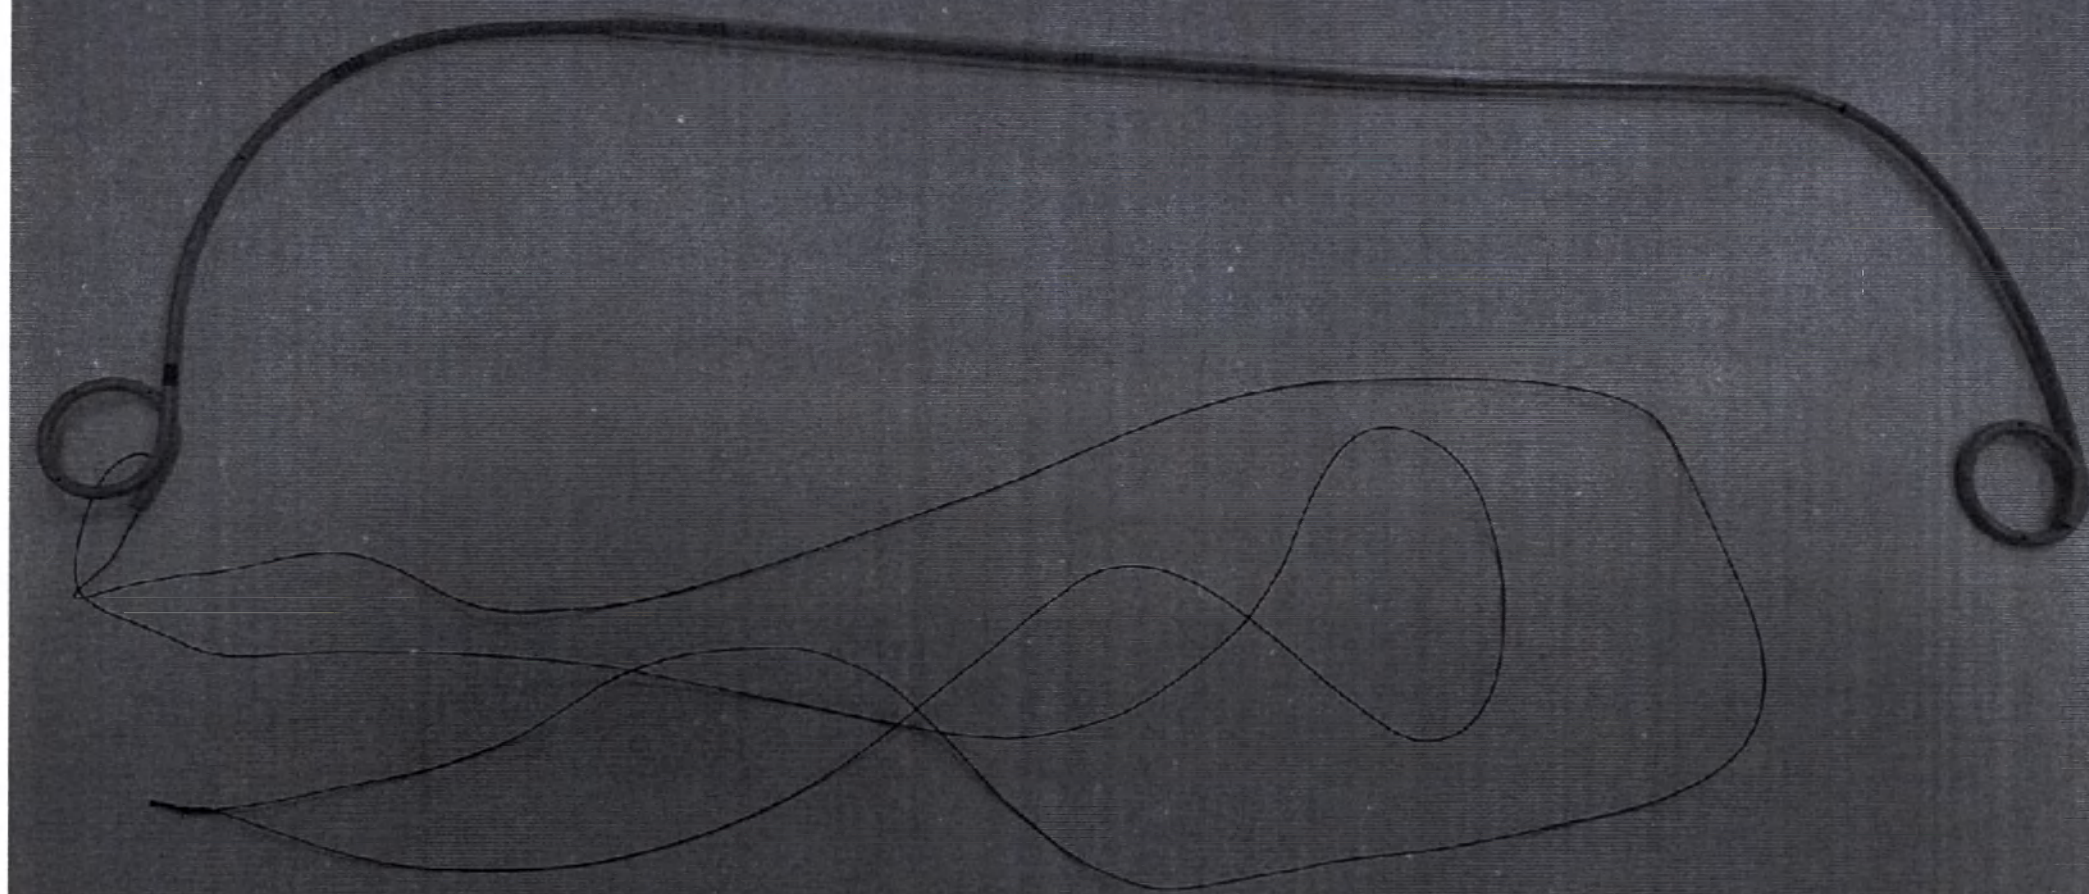


Стент Tria жесткий, с плетеной нитью, 4.8F, длина 30 см

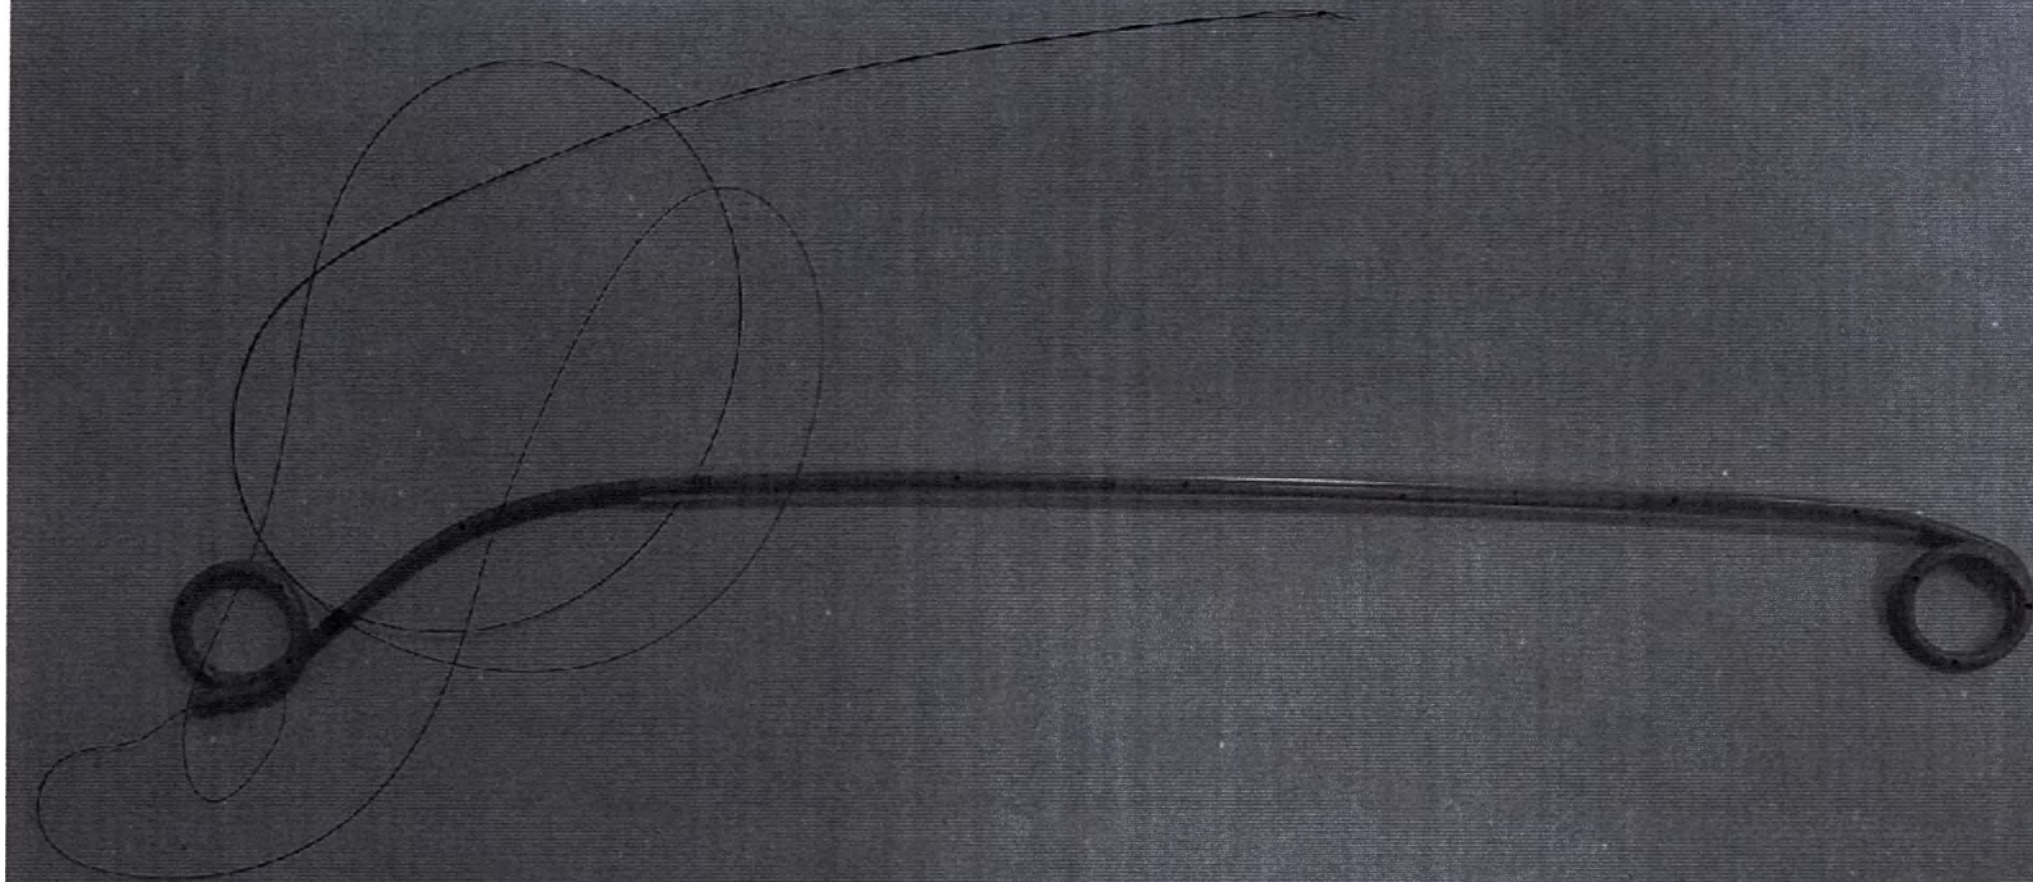


Стент Tgia жесткий, 6F, длина 20 см

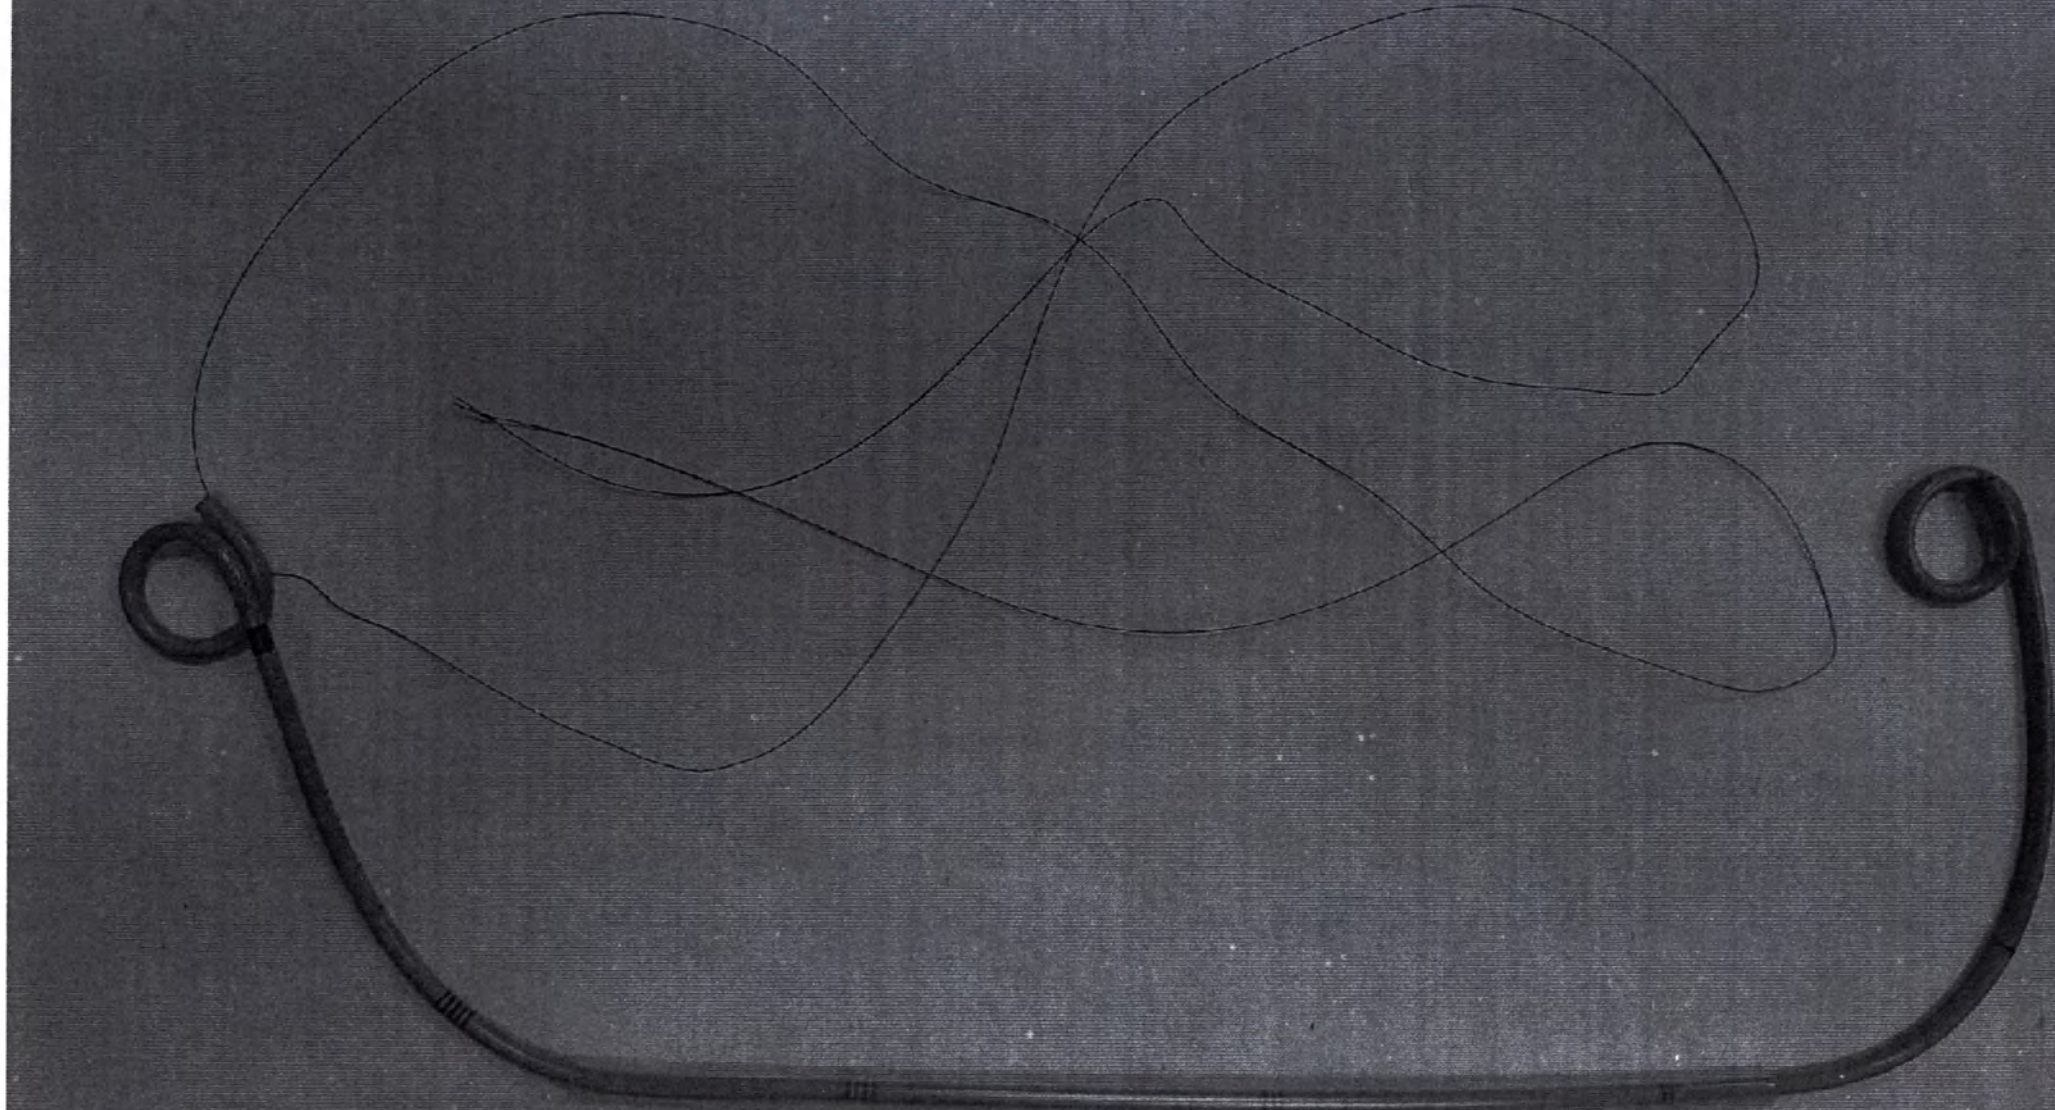

Стент Tg1a жесткий, без боковых отверстий, 7F, длина 30 см

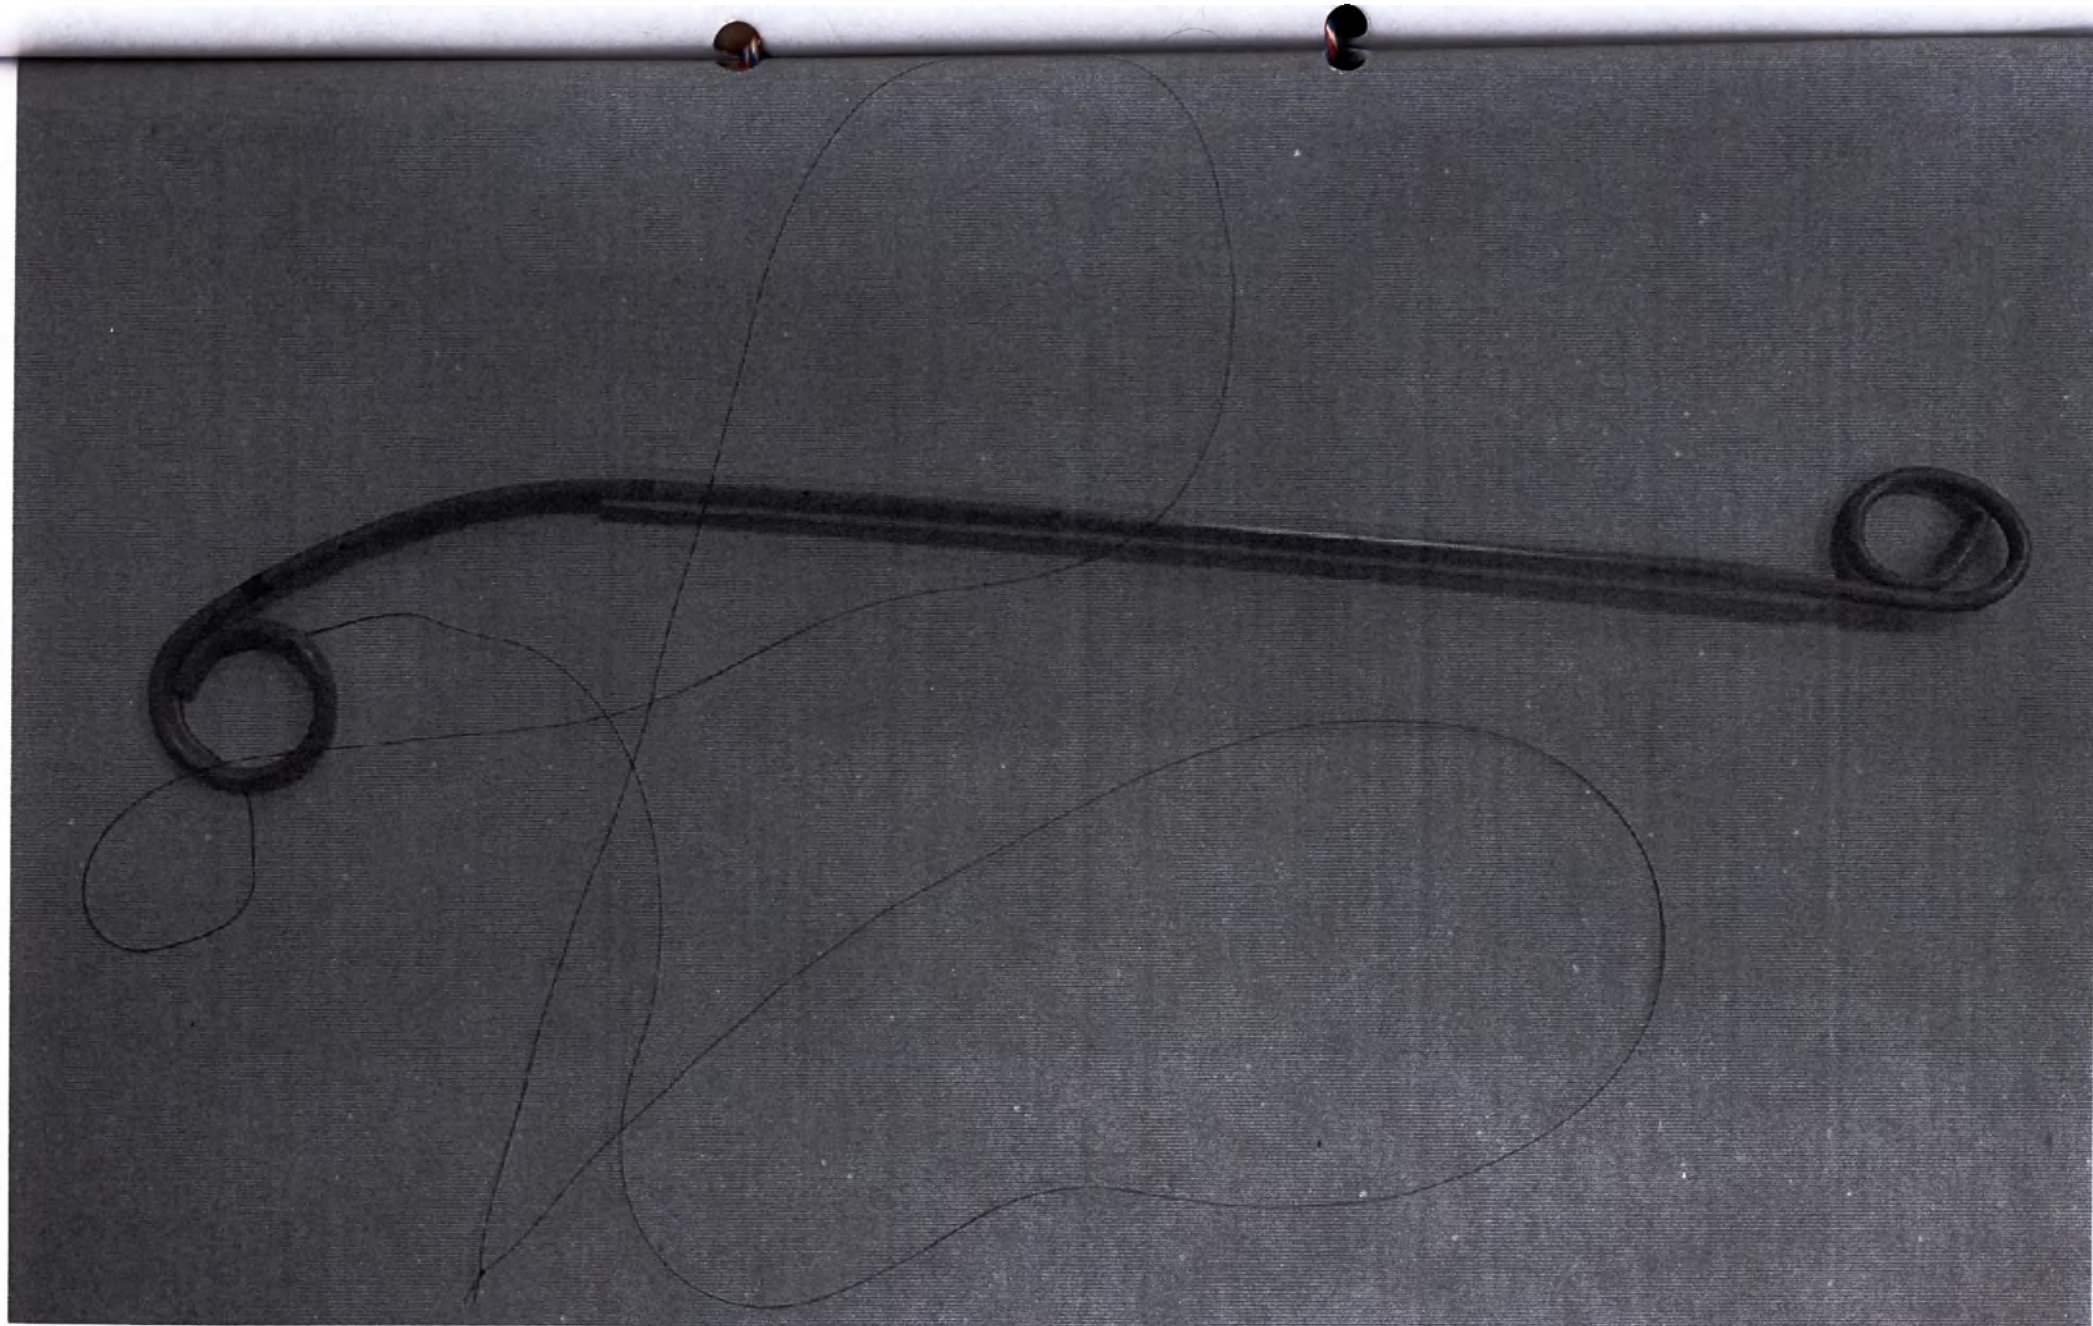


Стент Тгіа мягкий, 8F, длина 20 см

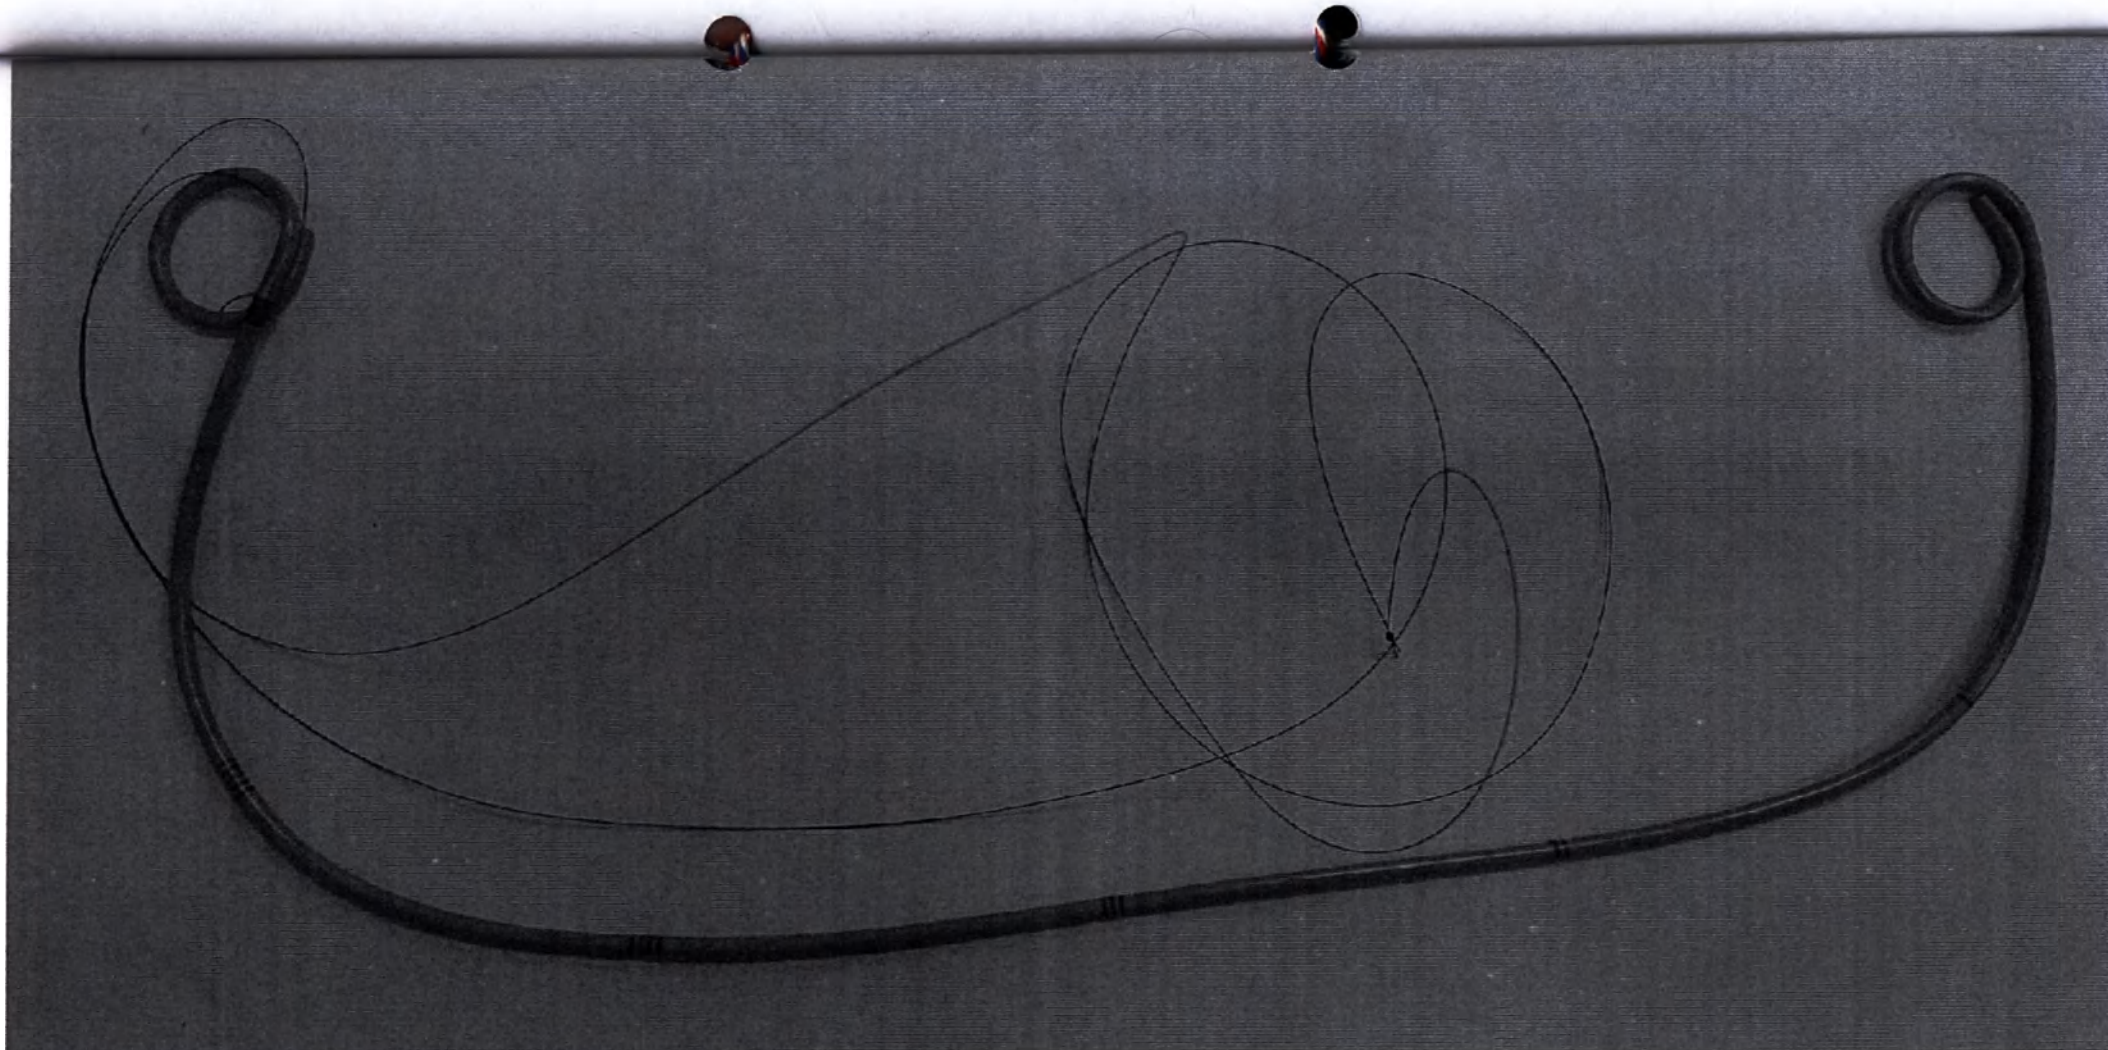

Стент Tgia мягкий, без боковых отверстий, 6F, длина 30 см

Позиционер

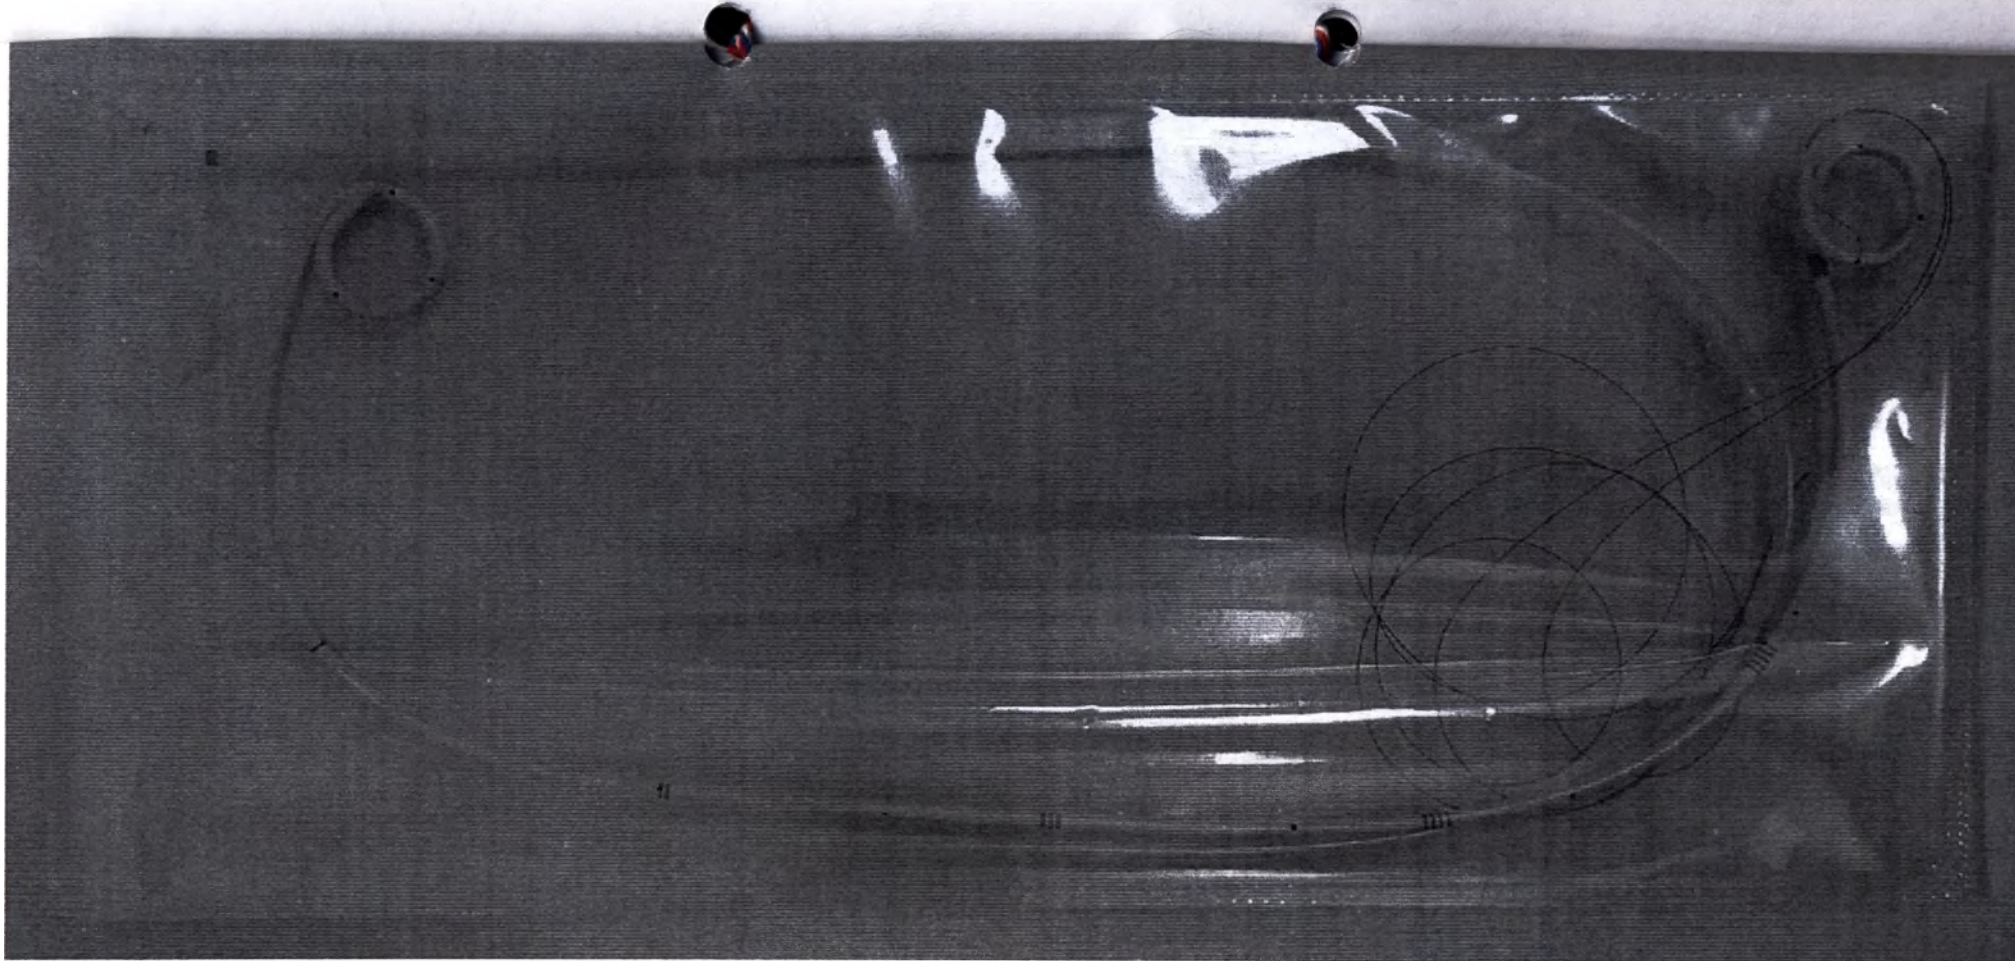

Первичная упаковка медицинского изделия

Boston
Scientific

Tri[™] Soft

WITH SIDE HOLES

6F
(2.0mm)
x30cm

Ureteral Stent

Stent ureteral, Stent ureteral, Ureterstent, Stentureteral, Ureterstent,
Ureterstent, Quottrippen indoperdection (stent), Stentureteral, Ureterstent,
Ureterstent, Ureterstent, Stent uroterodowu, Ureterstent, Uretra
Stent, Vitis angiodisnolig, Stentureteral, Ureterstent

☒ Contains (1)

☒ Q.0081a (Q.97mm)
Accessories: Adapters

☒ M4
Stent

☒ P.0
Stent (1) P.0



GTIN08714729953968

LOT

26242128

REF

Serial No.

M0061903250

☒ Use By

2023-10-23

Boston Scientific

Tri[™] Soft

6F (2.0mm) x 30cm

GTIN 08714729953968

LOT M0061903250

REF 26242128

Boston Scientific

Tri[™] Soft

6F (2.0mm) x 30cm

GTIN 08714729953968

LOT M0061903250

REF 26242128

Boston Scientific

Tri[™] Soft

6F (2.0mm) x 30cm

GTIN 08714729953968

LOT M0061903250

REF 26242128




031

CE 2797

STERILE EO

Sealed unit
after use.



Model: COSTA 11CA

2546 11113111


PRODA

E. COVIL, A. L. M. A.

COSTA 11CA

ТОВАРНО-УПАКОВКА ПРОДАВАЕТСЯ В ОТДЕЛЬНУЮ ОПАКОВКУ. В ОТДЕЛЬНУЮ ОПАКОВКУ ВХОДИТ ПОДРОБНОЕ
ИЗЪЯТИЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ ОТДЕЛЬНОГО ПЛАСТИКА

Индивидуальная упаковка медицинского изделия



Tria™ Soft


WITH SIDE HOLES

Ureteral Stent

Urinary Urea Nitrogen, Serum Urea Nitrogen, Urinary Creatinine

Spisak izdanih publikacija, stranica i godina izdavanja. Spisak izdanih publikacija, stranica i godina izdavanja.

Intestinal Bacteria

Boston
Scientific

Boston Scientific

5

(2.0 mm)

x30cm

Boston Scientific

Tria™ Soft

WITH SIDE HOLES

Ureteral Stent

[illegible]

GTIN 08714729353968

107

26242128

REF Reading No. M0061903250

Use Of

2023-10-23


CE 2797

Made in COSTA RICA

2545 First Street
Proper, VA 22080El Corral, Mejillales
Crista Blanca

THE

407-2597-0004



02 6987 4720 info@hsc.com.au www.hsc.com.au


55

This article may be protected by a patent or other rights. For more information, see the article in this journal.

STERILE EO

Sterilized using ethylene oxide.

Потребительская упаковка медицинского изделия

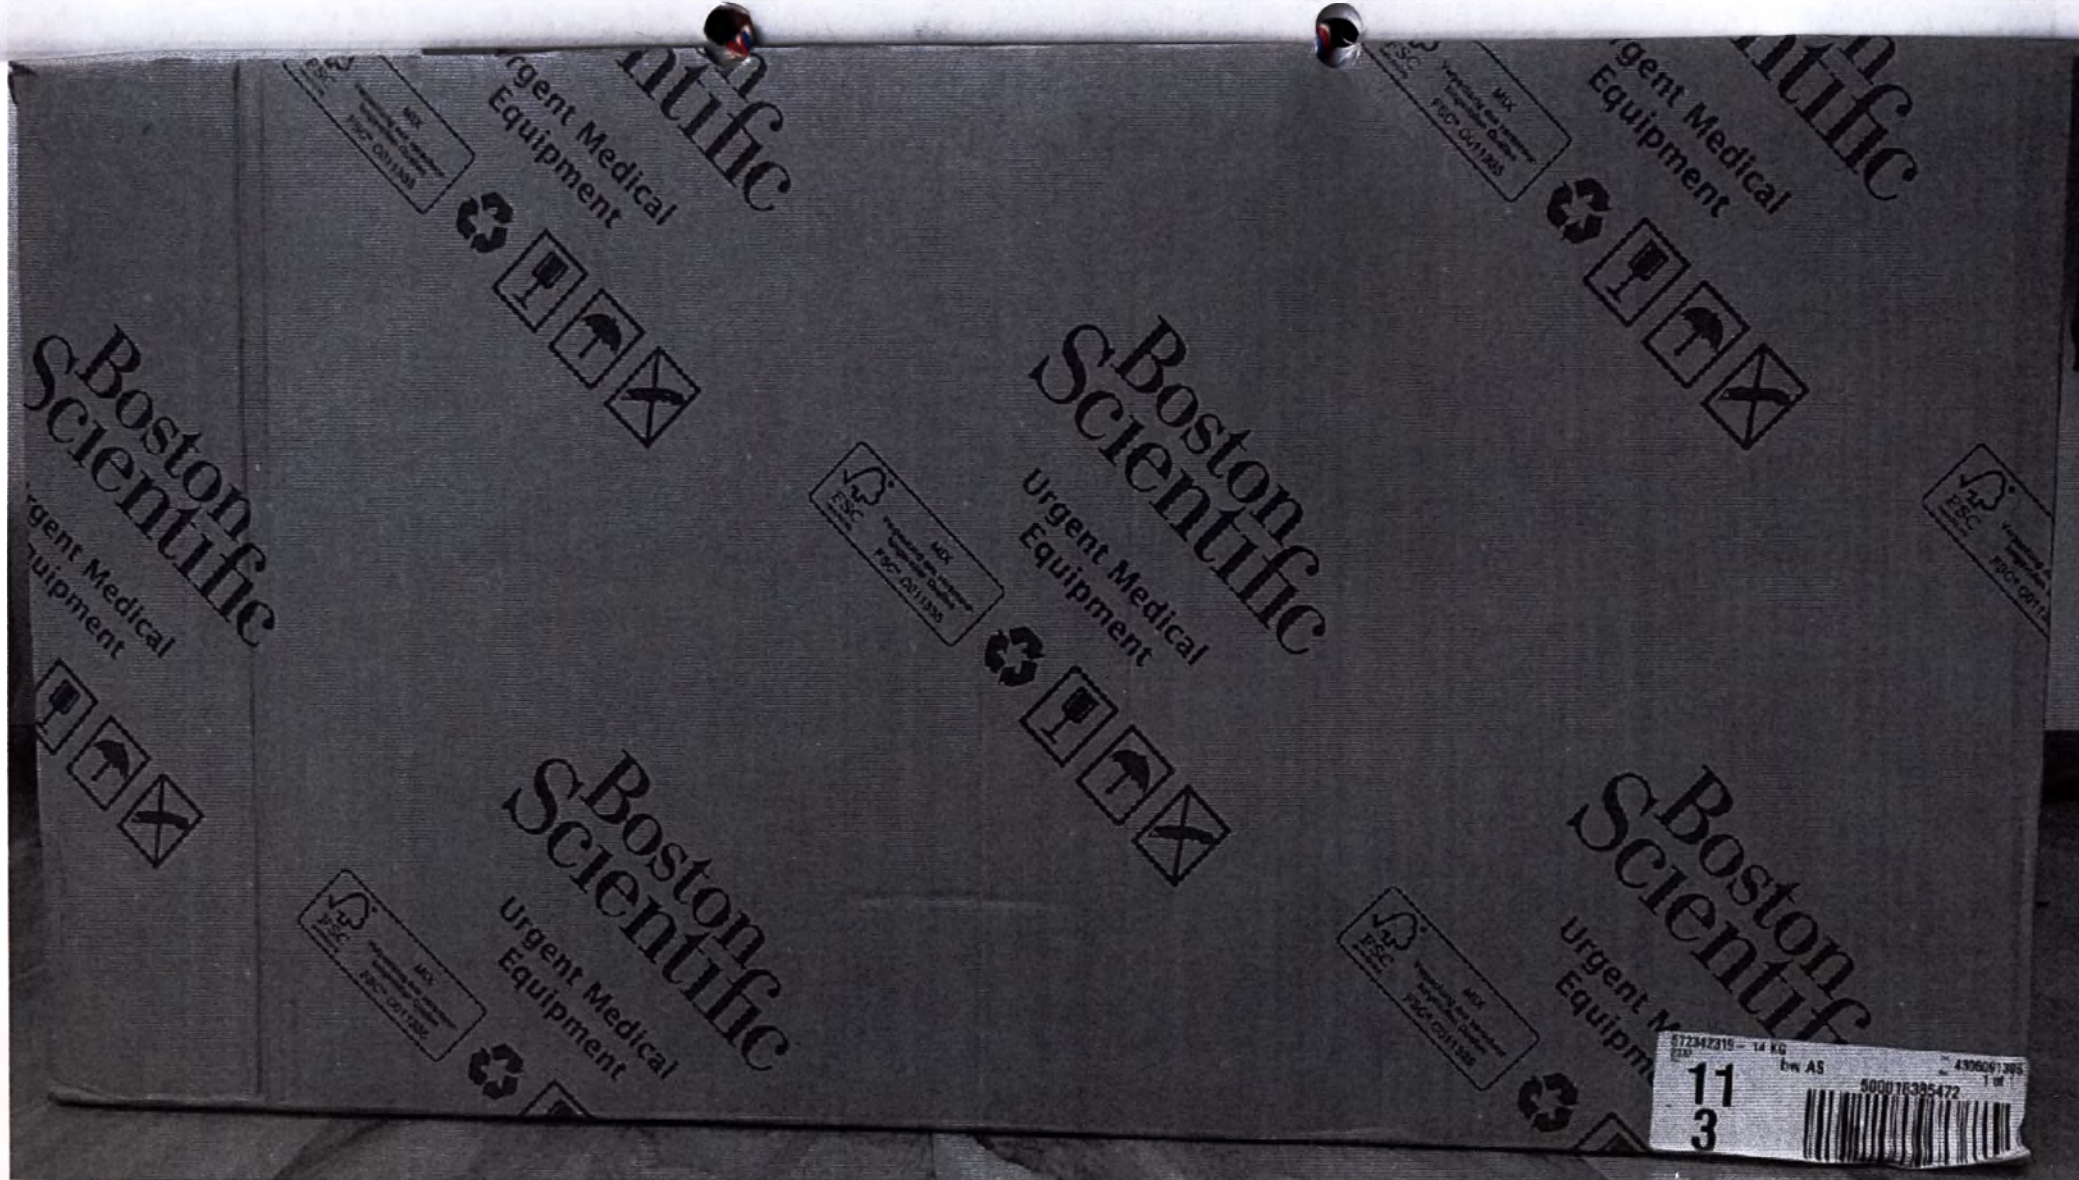

Транспортная упаковка медицинского изделия

Макет русскоязычной маркировки

Стенты мочеточниковые Tg1a в вариантах исполнения

Стент Tg1a жесткий, 6F, длина 20 см, в составе:

- стент Tg1a – 1 шт.
- позиционер – 1 шт.

Регистрационное удостоверение

От:

№

Только для однократного использования

Стерильно

Дата изготовления/срок хранения, указанный на
оригинальной упаковке

[штрих-код]

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Инструкции по применению для этого изделия поставляются в электронной форме через Интернет.

Посетите веб-сайт **www.bostonscientific-elabeling.com**, чтобы скачать инструкции по применению в формате переносимого документа (PDF) Adobe, и имейте при себе этикетку от продукции для сверки. Бесплатная версия программы Adobe Reader, которая используется для работы с файлами PDF, доступна на веб-сайте **www.Adobe.com**.

Если у вас возникли затруднения при получении онлайн-доступа к инструкции по применению, либо если вы хотели бы получить бумажную копию, обратитесь в Службу поддержки клиента компании Boston Scientific или в аналогичную службу в вашей стране. Вы бесплатно получите печатную копию в течение семи дней.

Примечание: эти инструкции по применению регулярно обновляются. Наиболее актуальная версия доступна на вышеуказанном веб-сайте

Adobe® и Reader® являются товарными знаками компании Adobe Systems Incorporated.

Пропнуковано и пронумеровано

13 лист *об*

Генеральный Директор
ООО "Результат-Аудит"
Г.В. Родина

Родина

