



Фотографические изображения общего вида на медицинское изделие

**Калибраторы для обеспечения правильности количественного определения
прокальцитонина (PCT) иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и
плазме крови человека на иммунохимических анализаторах Alinity i «B·R·A·H·M·S
Прокальцитонин Калибраторы (Alinity i B·R·A·H·M·S PCT Calibrators)»**

(размером не менее 18 x 24 сантиметра)



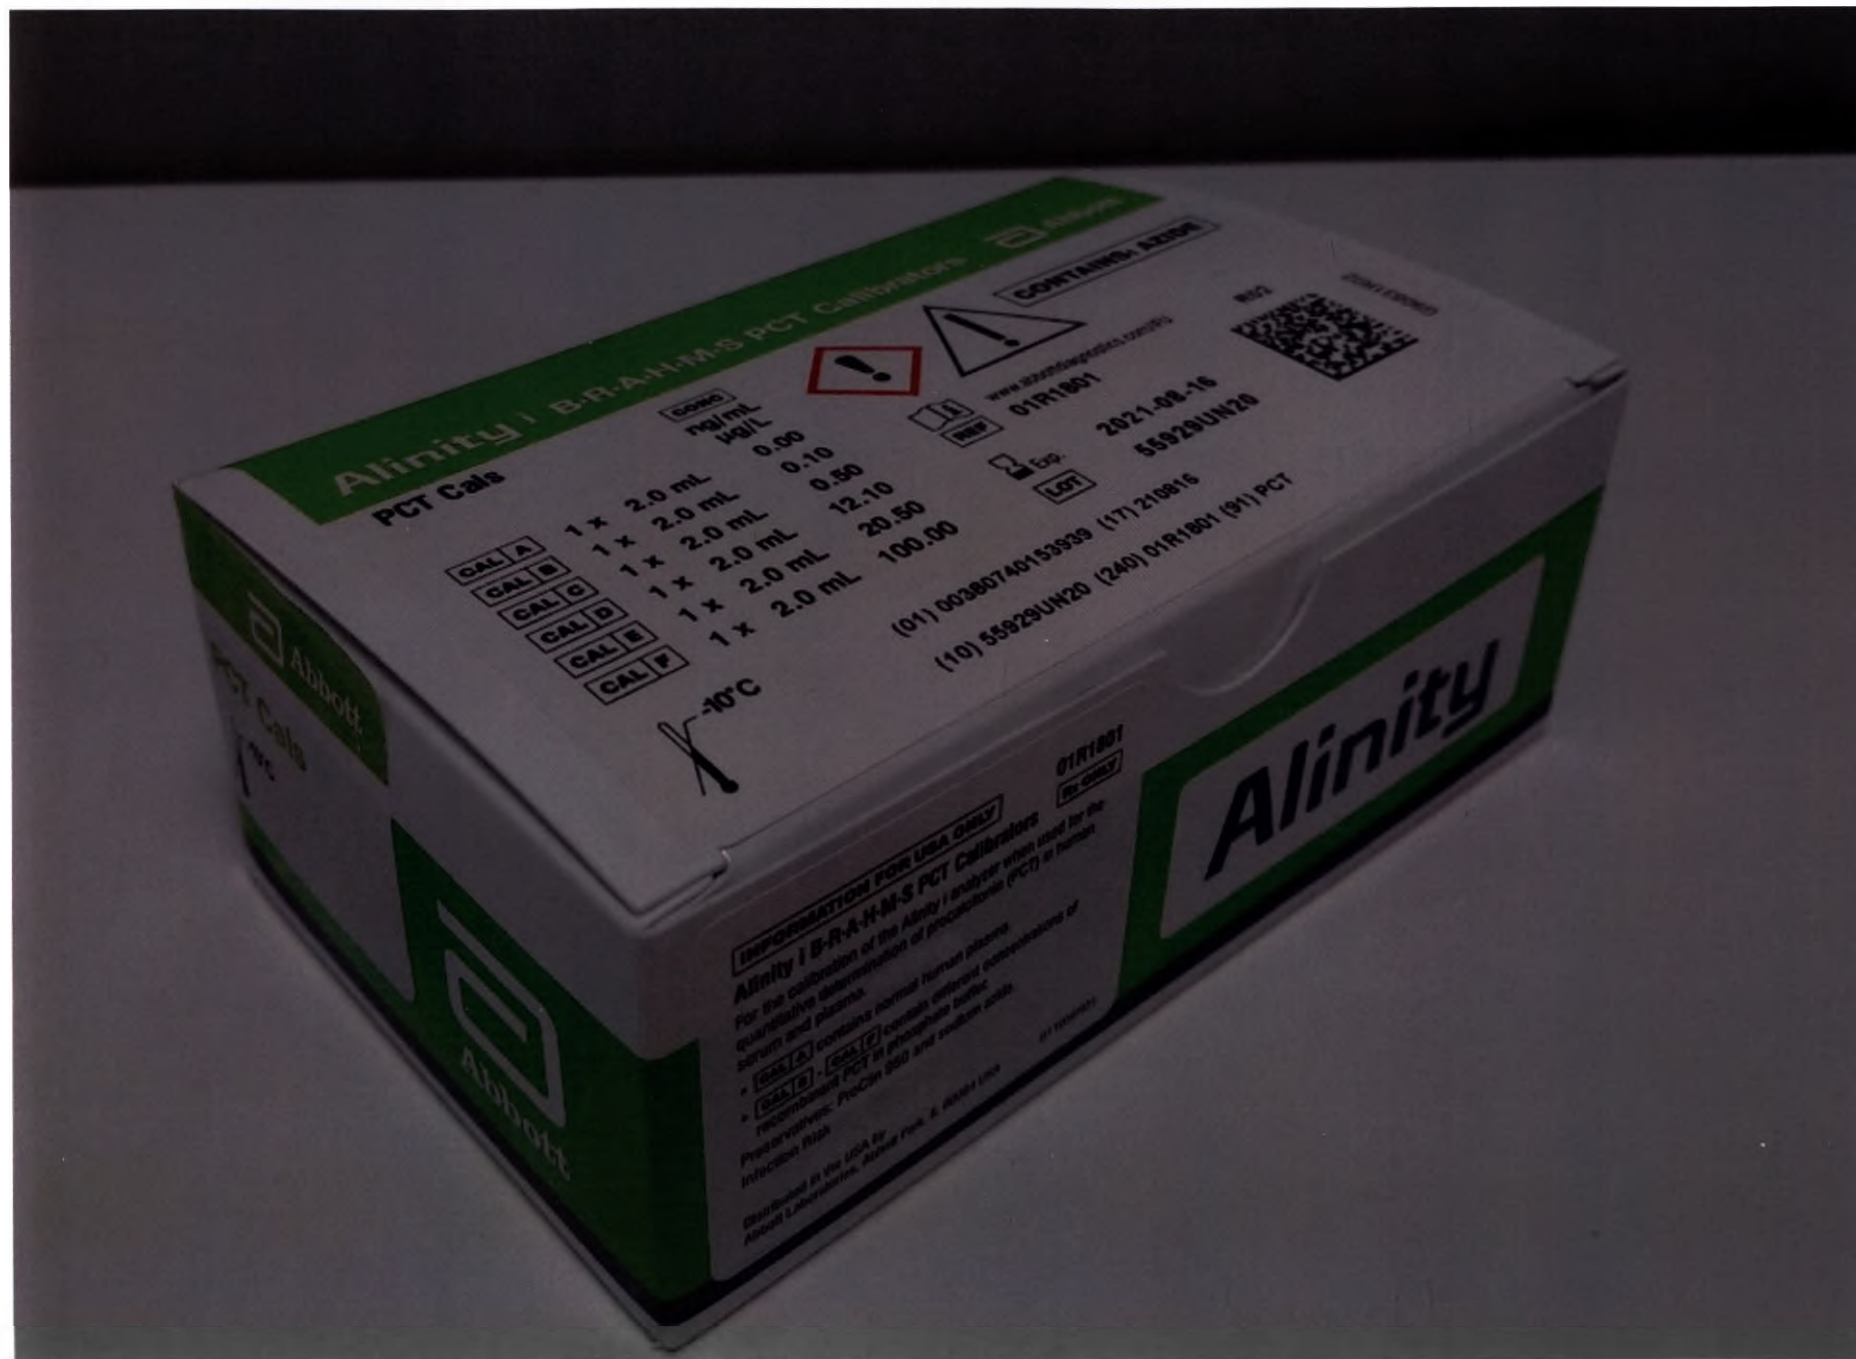

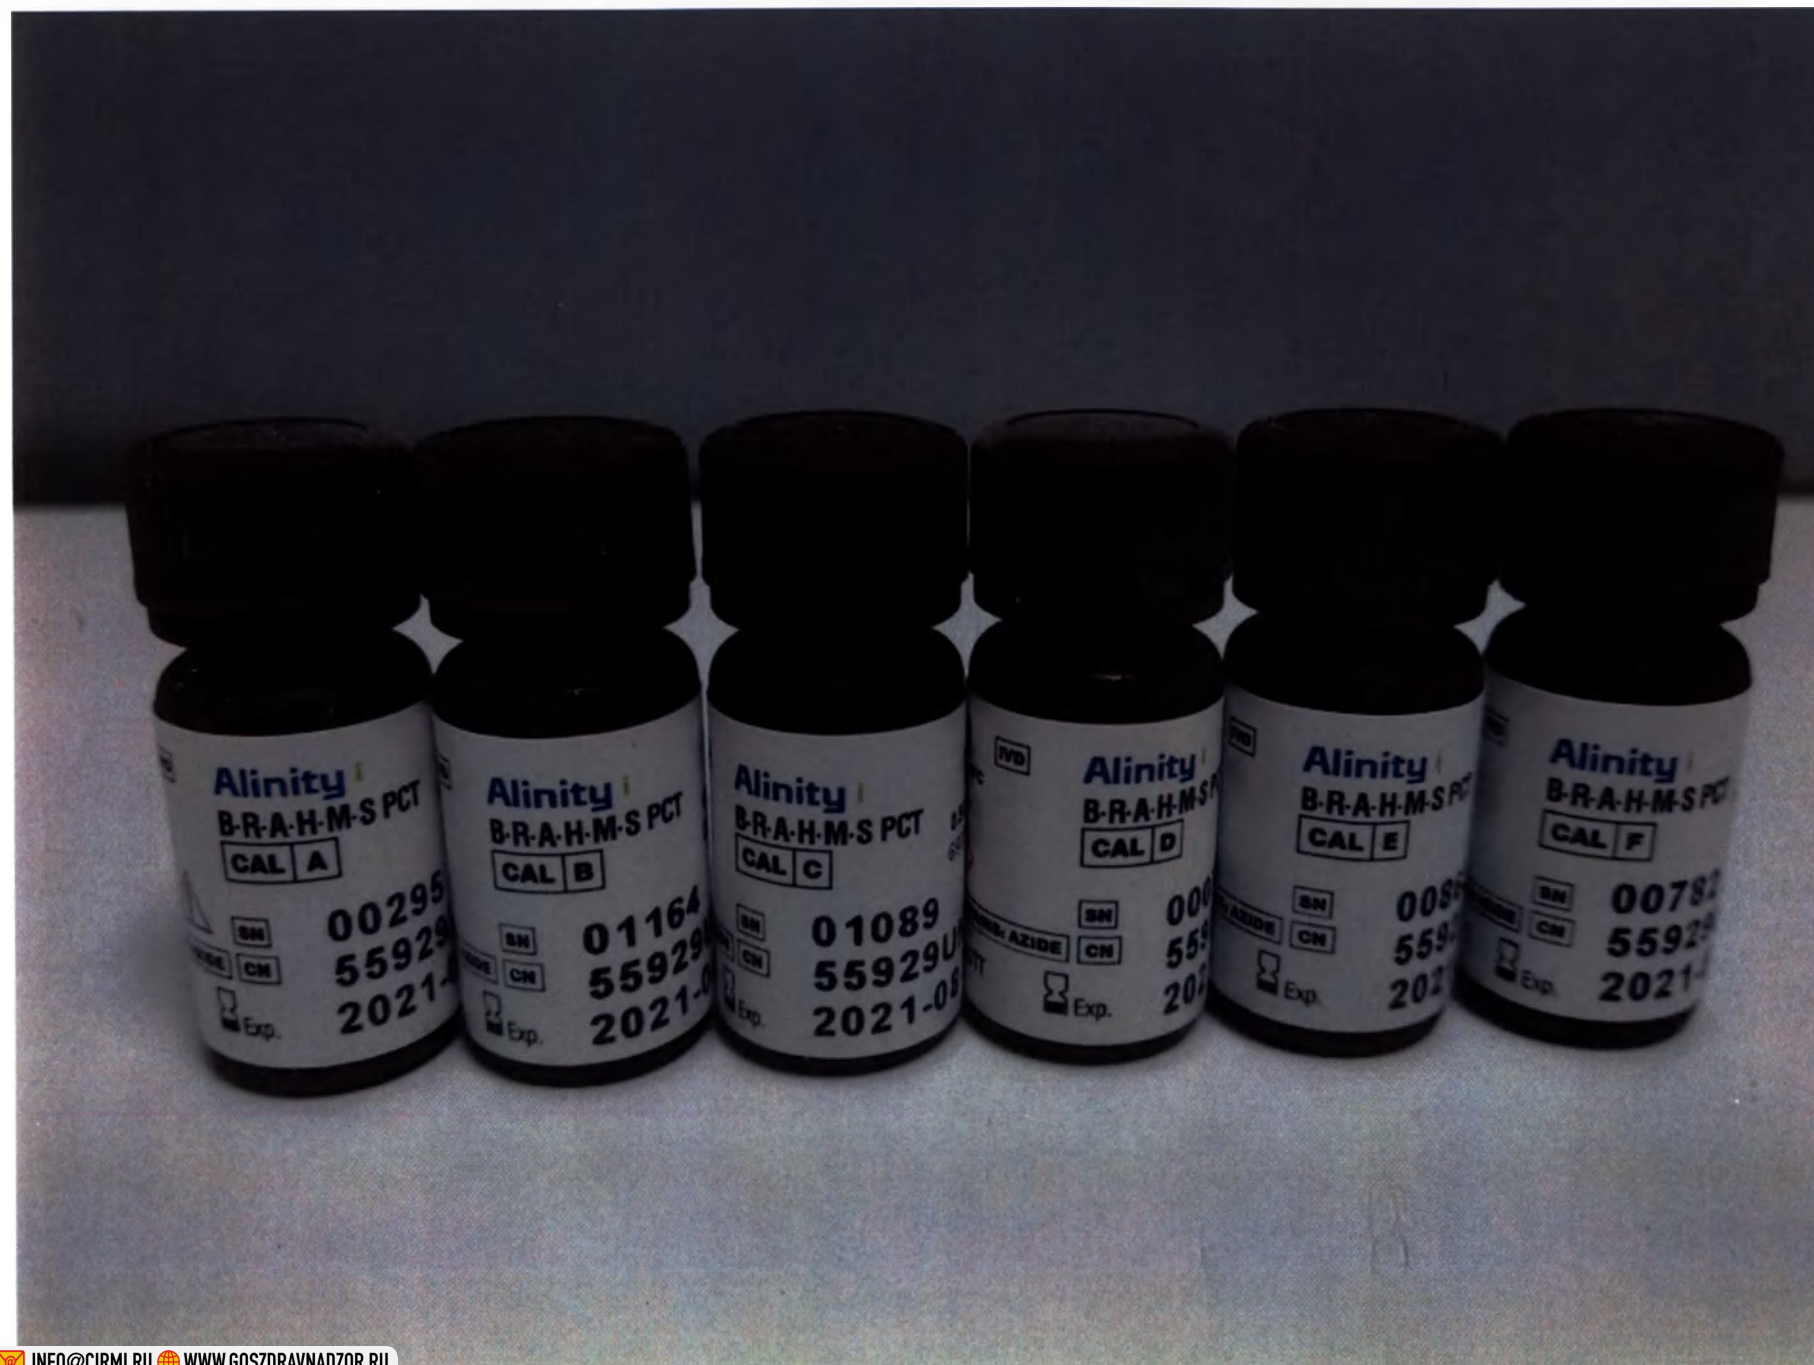

всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

4 листов

Подпись



Макет маркировки на медицинское изделие

**Калибраторы для обеспечения правильности количественного определения
прокальцитонина (PCT) иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме
крови человека на иммунохимических анализаторах Alinity i «B·R·A·H·M·S
Прокальцитонин Калибраторы (Alinity i B·R·A·H·M·S PCT Calibrators)»**

Макет маркировки медицинского изделия для обращения на территории Российской Федерации В·R·A·H·M·S Прокальцитонин Калибраторы (Alinity i В·R·A·H·M·S PCT Calibrators), Кат № 01R1801



01R1801



Калибраторы для обеспечения правильности количественного определения прокальцитонина (PCT) иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови человека на иммунохимических анализаторах Alinity i «В·R·A·H·M·S Прокальцитонин Калибраторы (Alinity i В·R·A·H·M·S PCT Calibrators)»

в составе:

- Калибратор А (Alinity i В·R·A·H·M·S PCT CAL A) - 1 флакон х 2,0 мл;
- Калибратор В (Alinity i В·R·A·H·M·S PCT CAL B) - 1 флакон х 2,0 мл;
- Калибратор С (Alinity i В·R·A·H·M·S PCT CAL C) - 1 флакон х 2,0 мл;
- Калибратор D (Alinity i В·R·A·H·M·S PCT CAL D) - 1 флакон х 2,0 мл;
- Калибратор E (Alinity i В·R·A·H·M·S PCT CAL E) - 1 флакон х 2,0 мл;
- Калибратор F (Alinity i В·R·A·H·M·S PCT CAL F) - 1 флакон х 2,0 мл;

Инструкция по применению.

Производитель: «Эбботт Ирландия, Диагностическое подразделение» (Abbott Ireland Diagnostics Division), Finisklin Business Park, Sligo, Ireland (Ирландия)

Место производства: Fisher Diagnostics, A Division of Fisher Scientific Company, LLC, A Part of Thermo Fisher Scientific, Inc., 8365 Valley Pike, Middletown, Virginia, 22645, USA

Страна происхождения: США

РУ № ____/____ от ____/____/____ / Инструкция по применению на русском языке: www.corelaboratory.abbott

Серия, использовать до, условия хранения указаны в графических символах. Расшифровку графических символов см. в инструкции.

Данный продукт содержит полученные от человека и/или потенциально инфекционные компоненты.


Авторизованный представитель изготовителя на территории России и других стран СНГ:

Общество с ограниченной ответственностью «Эбботт Лэбораториз», 125171, Россия, г. Москва, Ленинградское шоссе, 16А, строение 1,


Тел: +7 (495) 258 42 80; Факс: +7 (495) 258 42 81

Макет маркировки компонентов медицинского изделия В·Р·А·Н·М·S Прокальцитонин
Калибраторы (Alinity i В·Р·А·Н·М·S PCT Calibrators), Кат № 01R1801


- Калибратор А (Alinity i В·Р·А·Н·М·S PCT CAL A) - 1 флакон х 2,0 мл

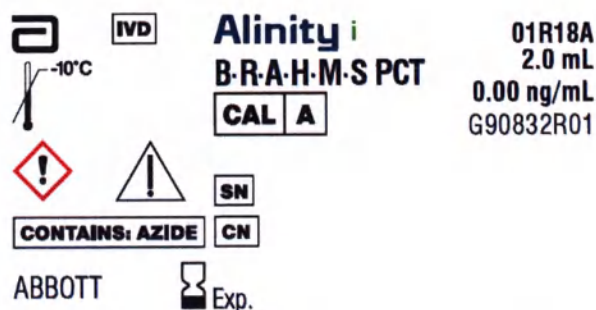


- Калибратор В (Alinity i В·Р·А·Н·М·S PCT CAL B) - 1 флакон х 2,0 мл

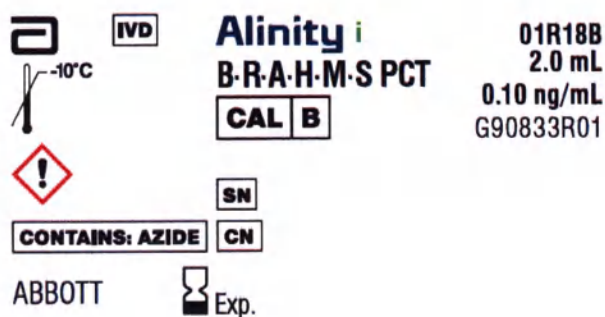


- Калибратор С (Alinity i В·Р·А·Н·М·S PCT CAL C) - 1 флакон х 2,0 мл

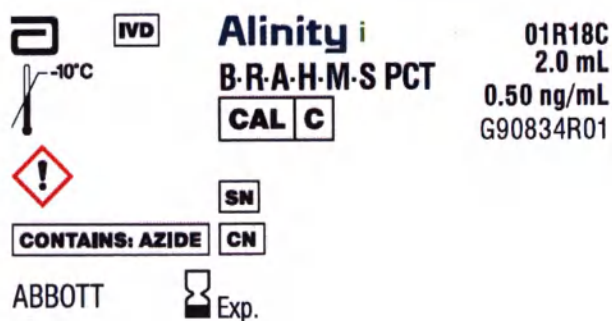


- Калибратор D (Alinity i В·Р·А·Н·М·S PCT CAL D) - 1 флакон х 2,0 мл

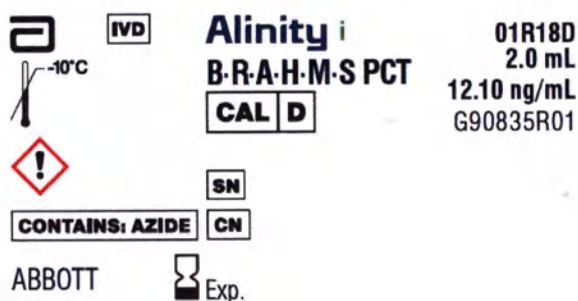

- Калибратор E (Alinity i B·R·A·H·M·S PCT CAL E) - 1 флакон х 2,0 мл

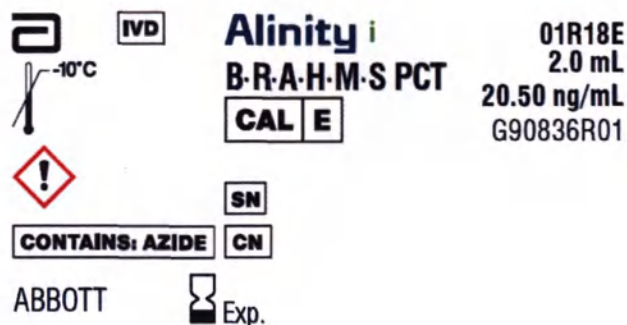

- Калибратор F (Alinity i B·R·A·H·M·S PCT CAL F) - 1 флакон х 2,0 мл

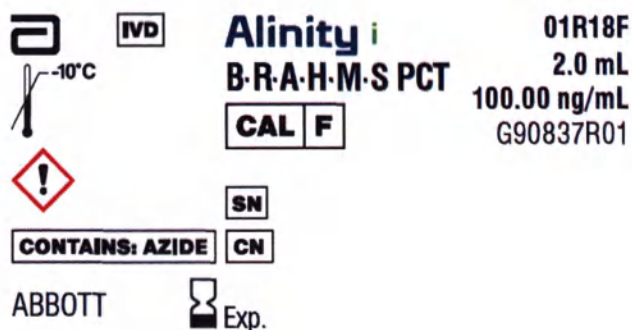

Сведения о стандартах, применяемых к этикетке на МИ:

Стандарт	Наименование стандарта
ГОСТ Р ИСО 18113-1-2015	Медицинские изделия для диагностики <i>in vitro</i> . Информация, предоставляемая изготовителем (маркировка). Часть 1. Термины, определения и общие требования
ГОСТ Р ИСО 18113-2-2015	Медицинские изделия для диагностики <i>in vitro</i> – Информация, предоставляемая производителем (маркировка) – Часть 2: Реагенты для диагностики <i>in vitro</i> для профессионального применения
ГОСТ Р ИСО 15223-1-2020	Изделия медицинские. Символы, применяемые при маркировании медицинских изделий, на этикетках и в сопроводительной документации. Часть 1. Основные требования

Расшифровка символов представлена в инструкции.

всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

5 листов

Подпись

