

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ООО «Дентис Имплант»
Сорокина О.А.

«17» декабря 2021 г.



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ


Светильник стоматологический Luvis

Производитель: Dentis Co., Ltd.: 99, Seongseoseo-Ro, Dalseo-Gu, Daegu, Корея

Тел. 82-53-583-2804 Факс 82-53-583-2806

www.dentis.co.kr / www.luvis.co.kr

Светильник стоматологический Luvis C500, вариант исполнения C50-H0M1B1, C50-H2M1B1
Голова световая C500

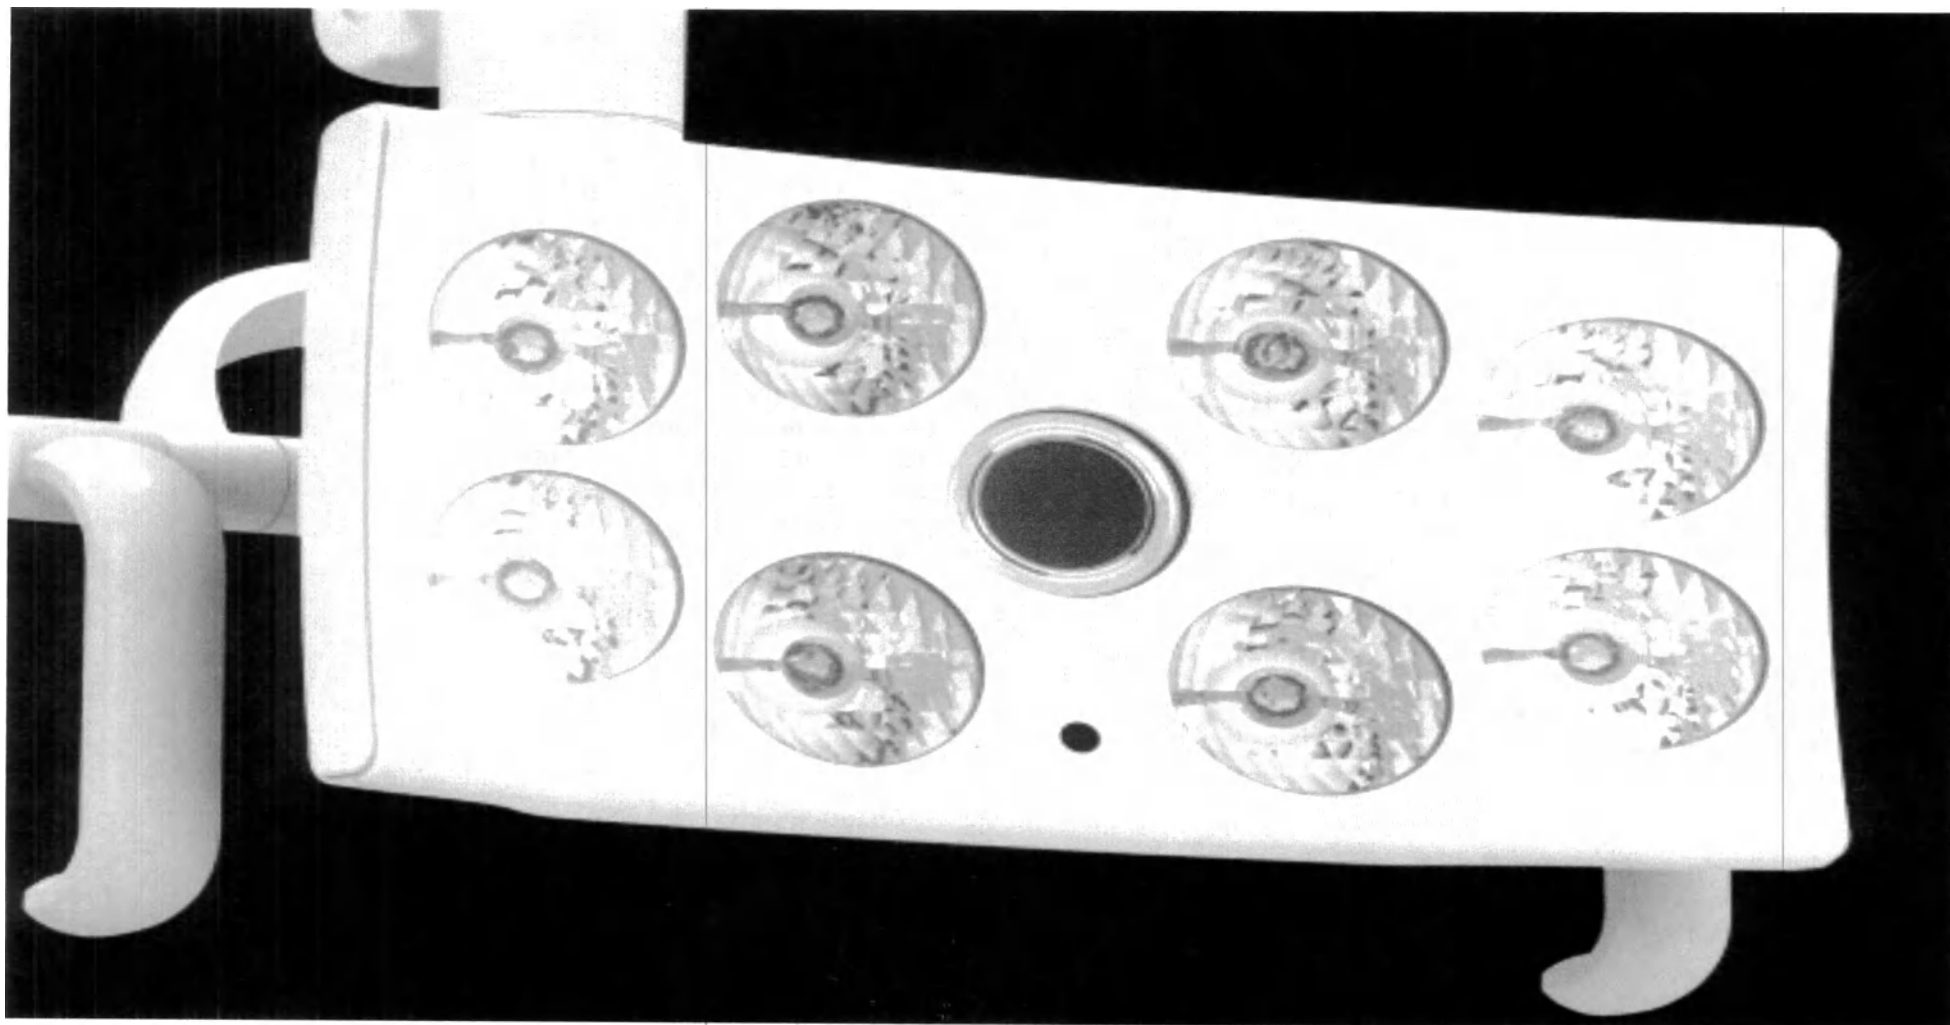


Голова световая светильника без пластиковой накладки




Голова световая светильника с пластиковой накладкой


Светильник стоматологический Luvis C500, вариант исполнения C50-C2M1B1, крепление на стоматологическую установку

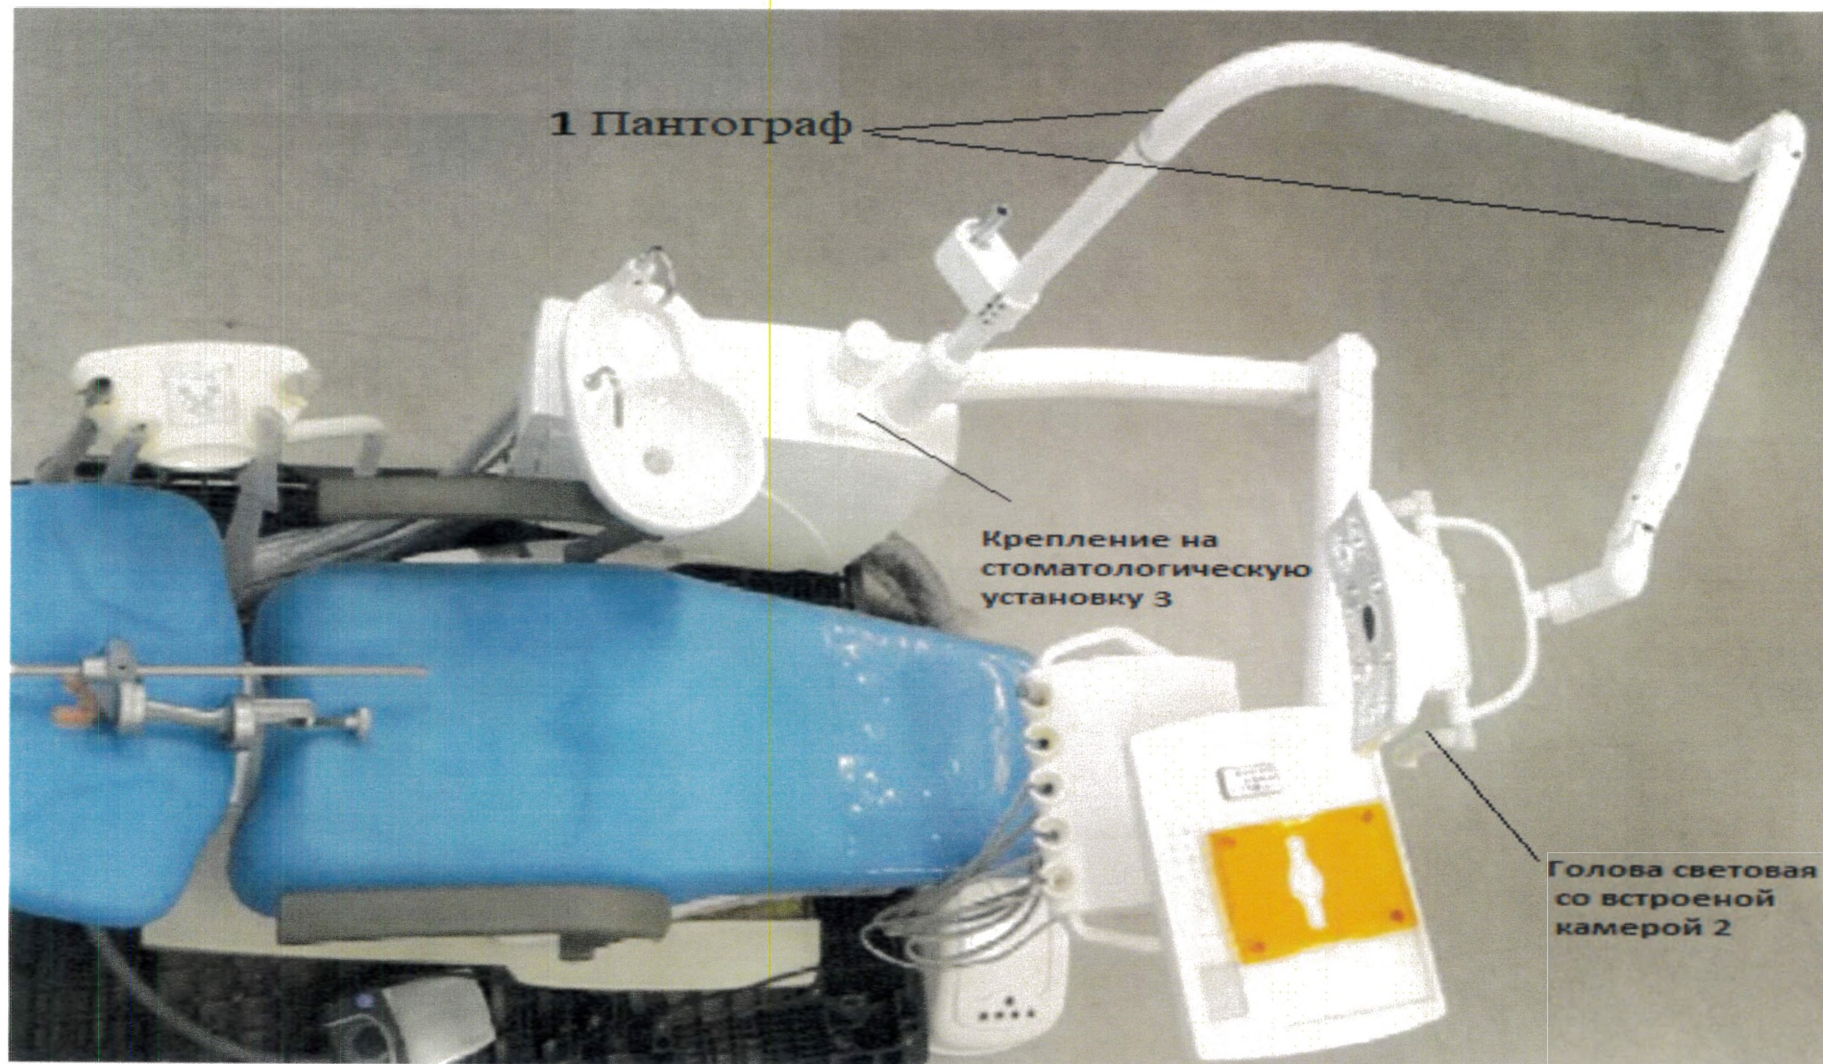


Светильник стоматологический Luvis C500, вариант исполнения C50-E2M1B1, крепление на потолок

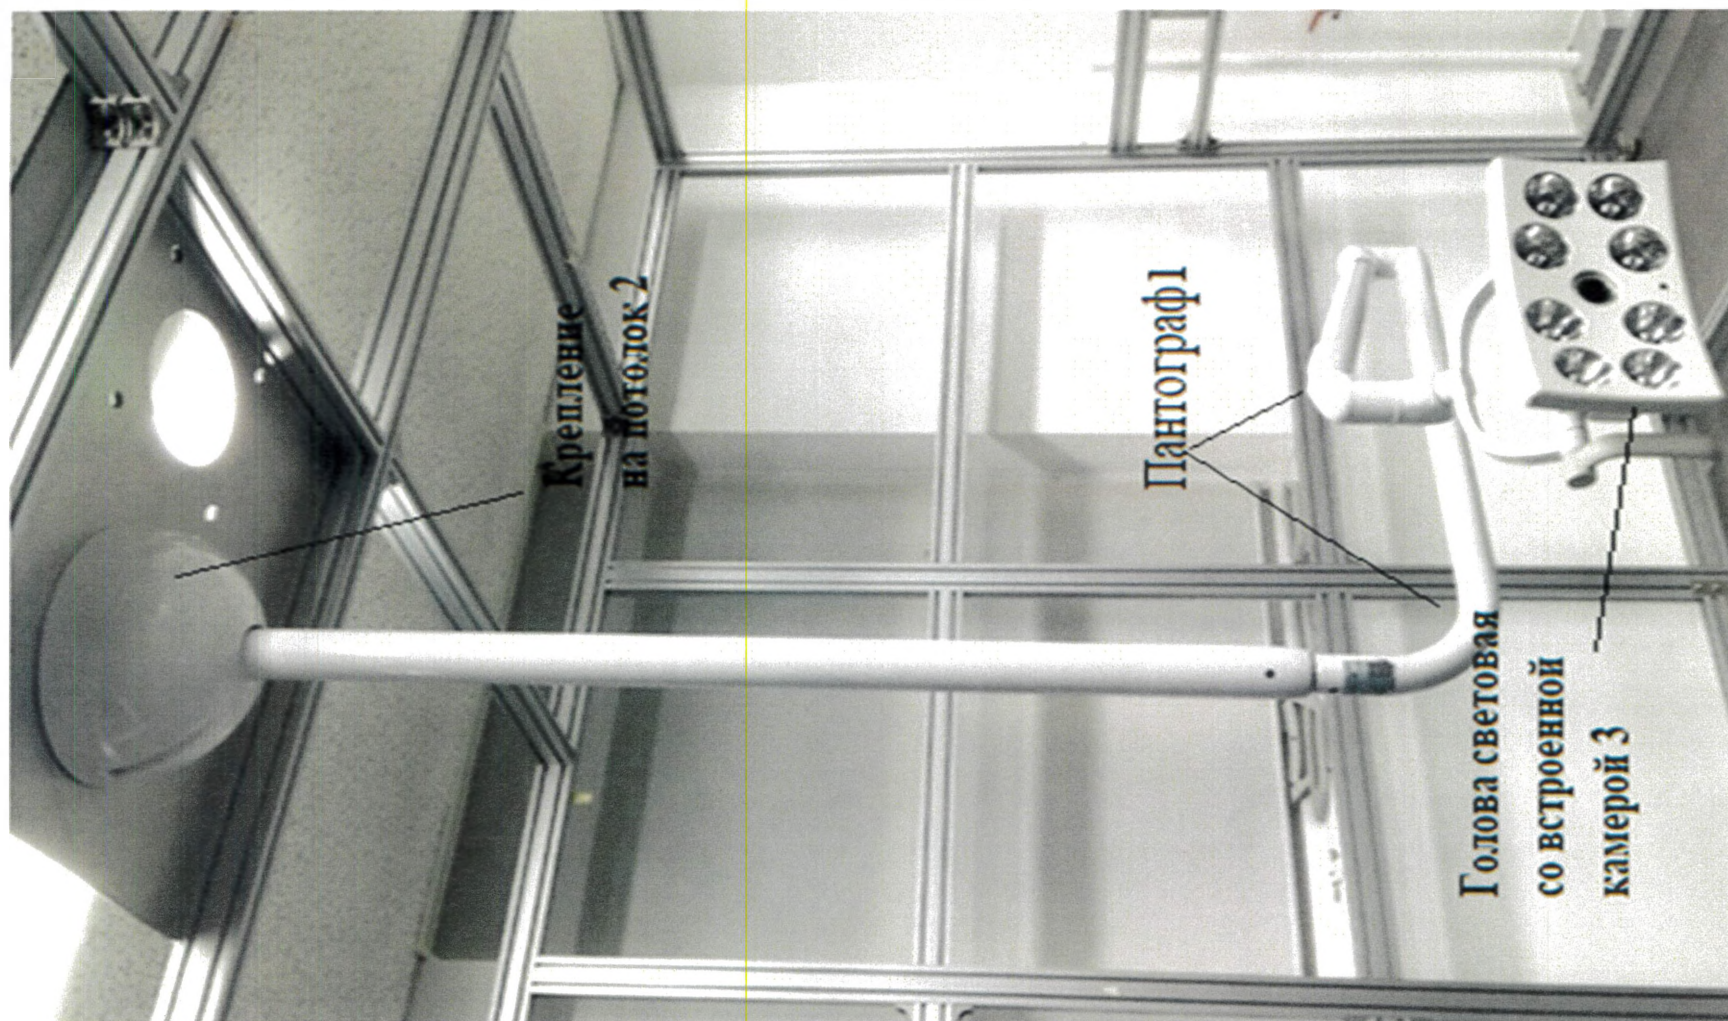


Светильник стоматологический Luvis C500, вариант исполнения C50-W2M1B1, крепление на стену

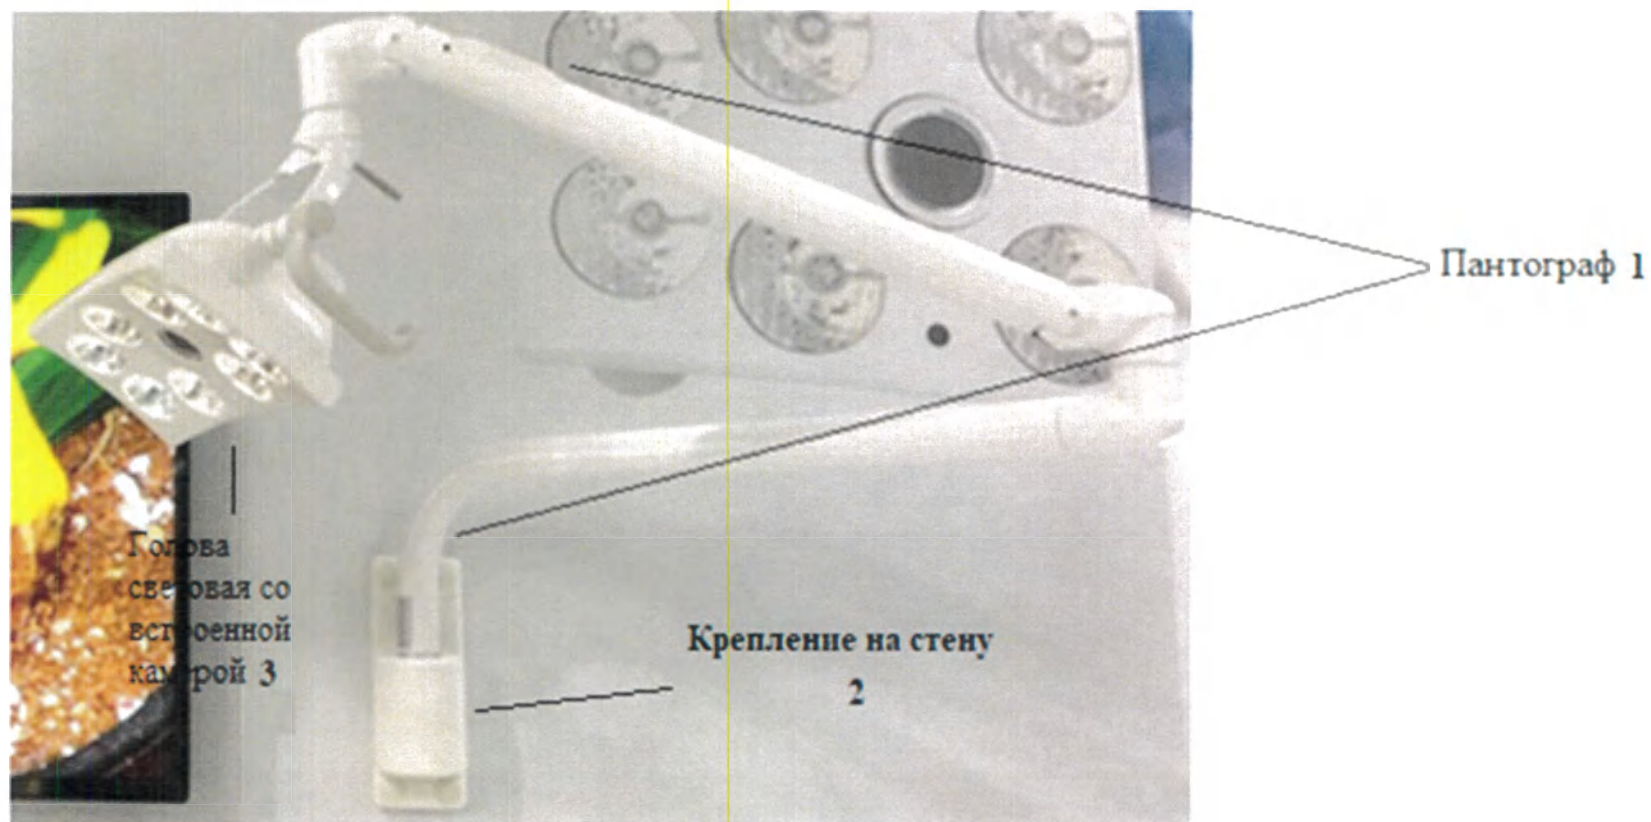

Светильник стоматологический Luvis C500, вариант исполнения C50-M2M1B1, крепление мобильное

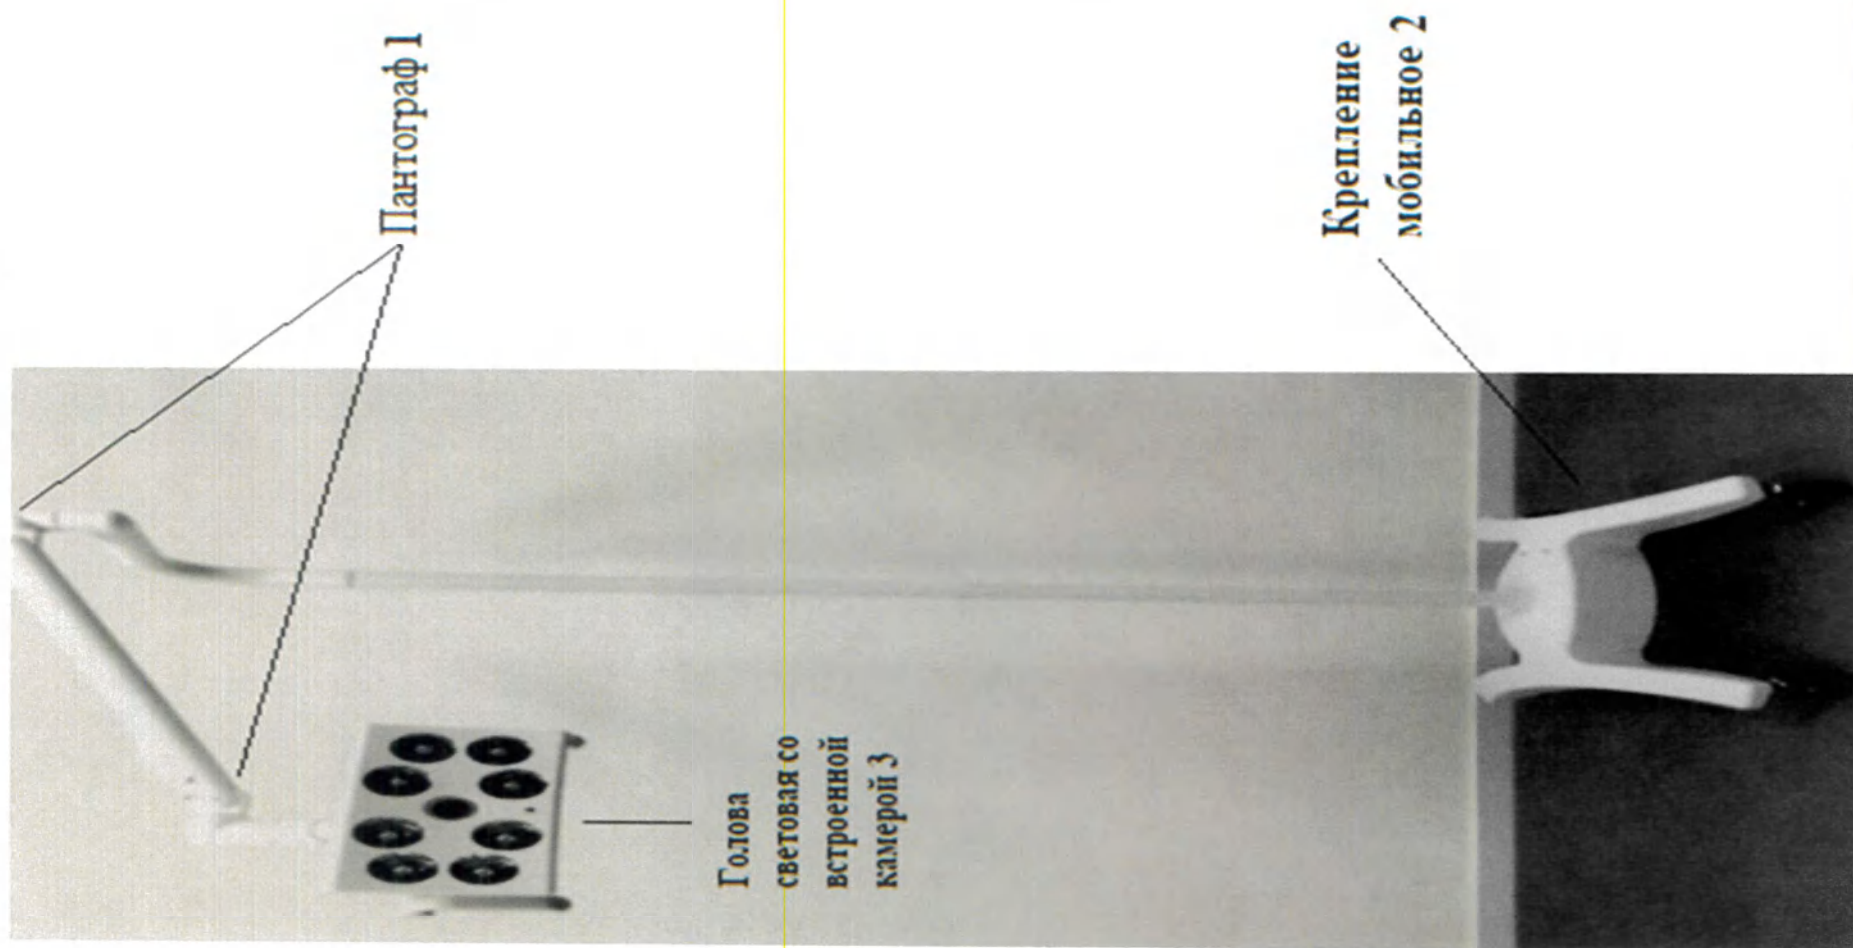



Светильник стоматологический Luvis C500, вариант исполнения C50-M2M1B1, крепление мобильное в полной комплектации

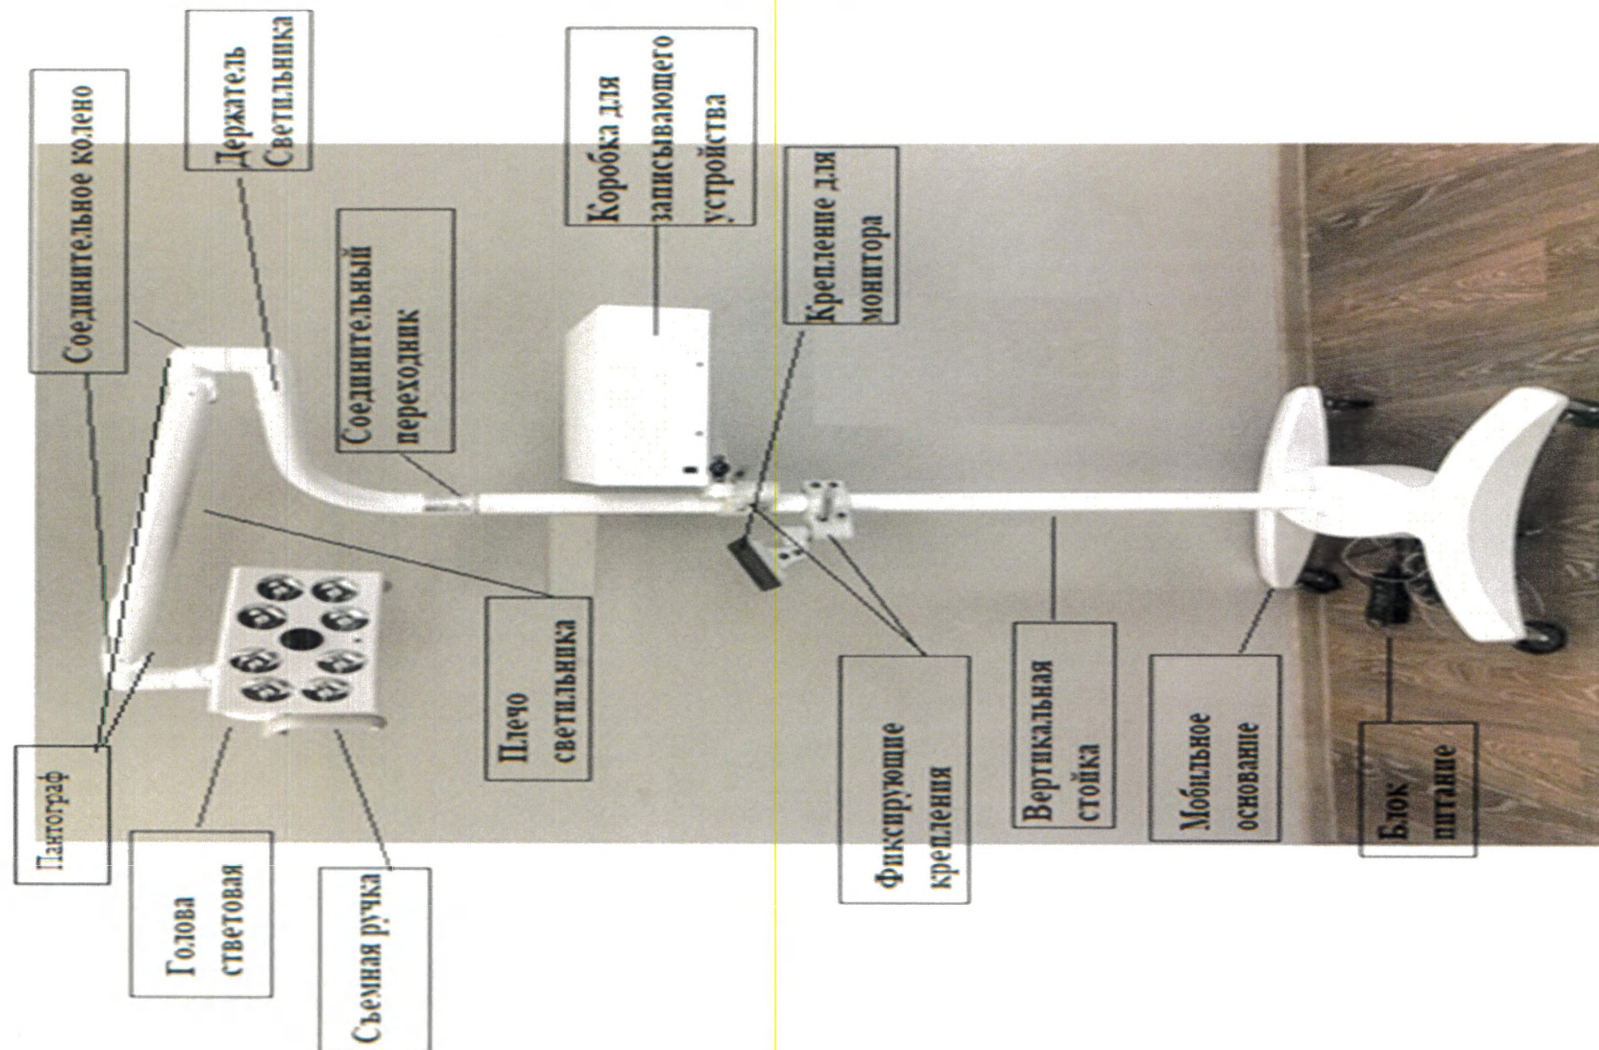

Светильник стоматологический Luvis C300, вариант исполнения C30-C0S0A1, крепление на стоматологическую установку

Голова световая C300

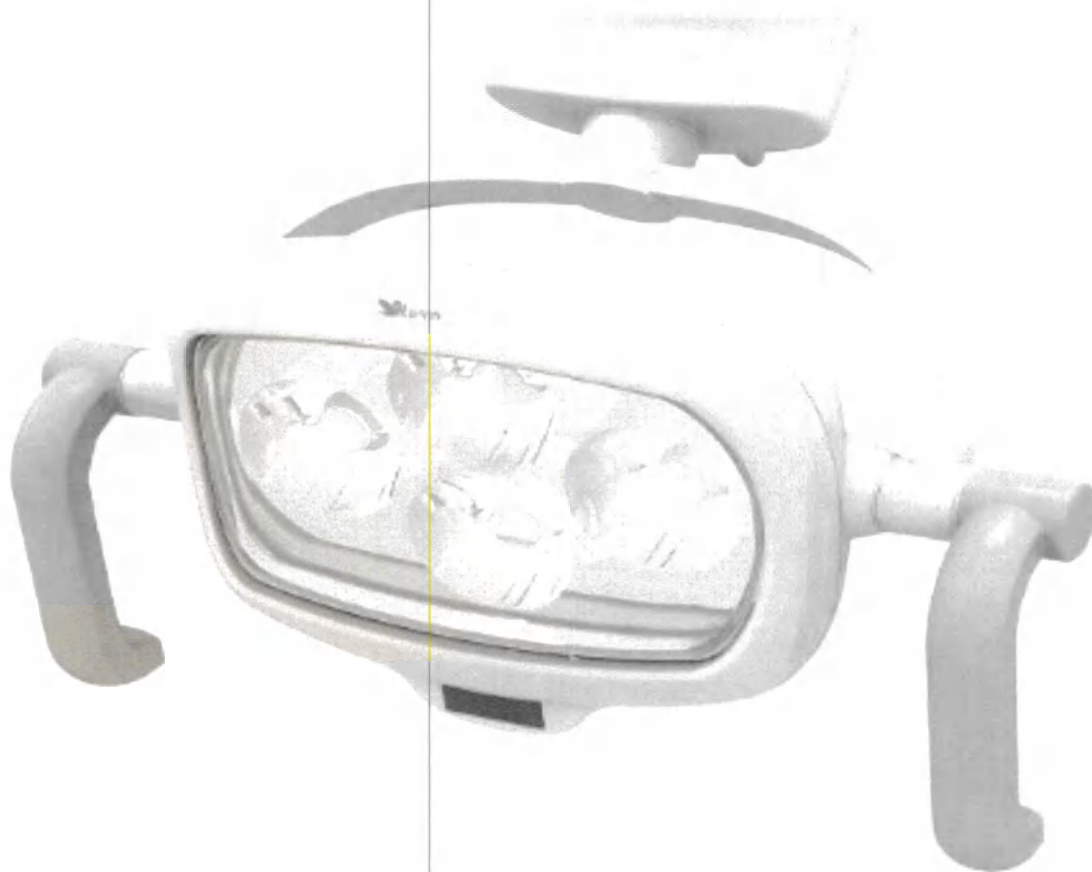


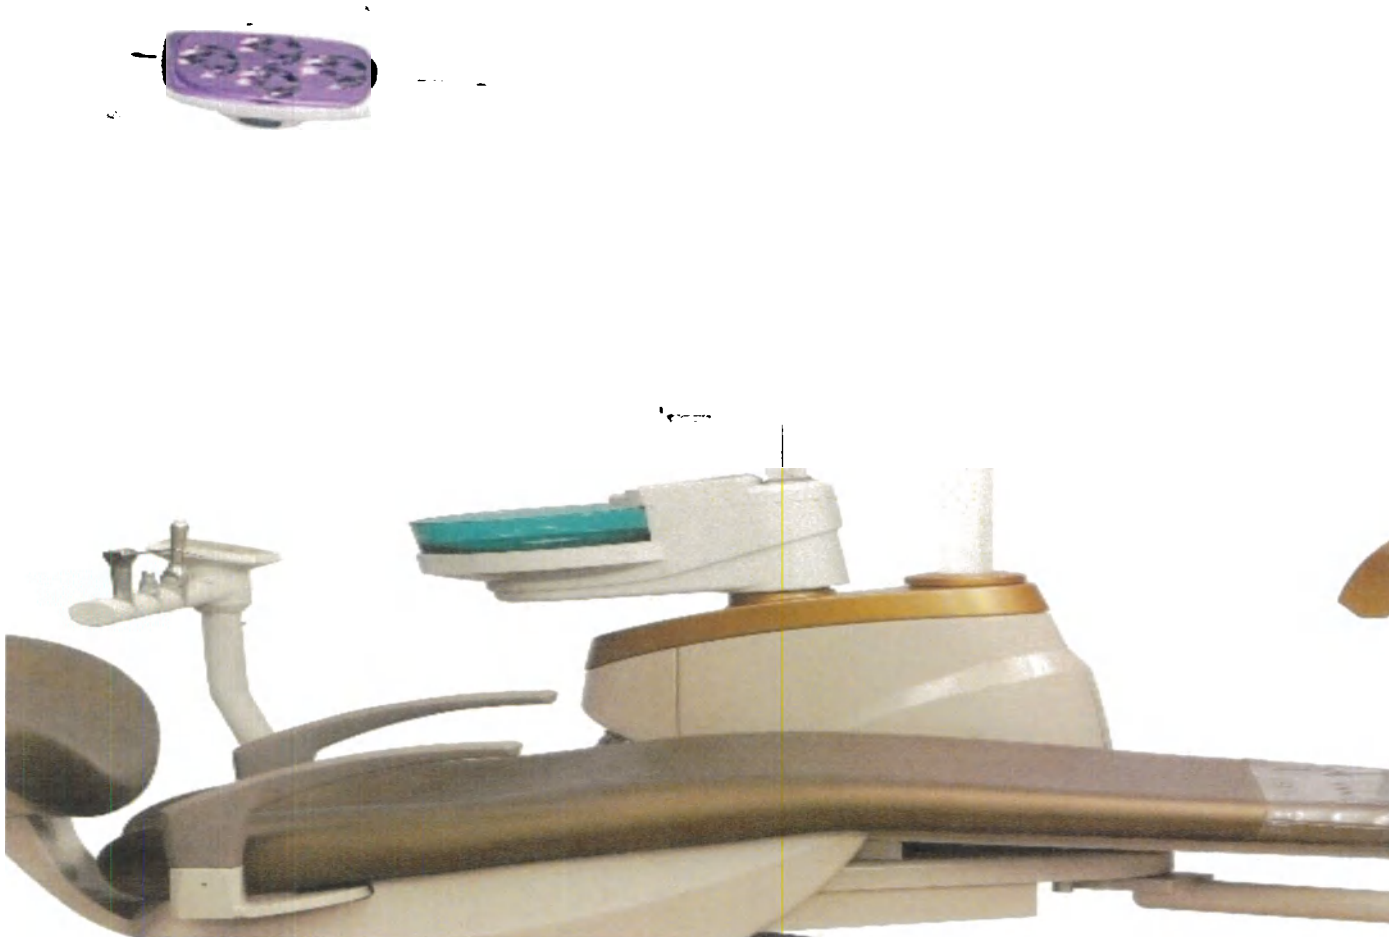


Крепление на стоматологическую установку

Светильник стоматологический Luvix C400, вариант исполнения C40-C0S0A1, крепление на стоматологическую установку

Голова световая C400

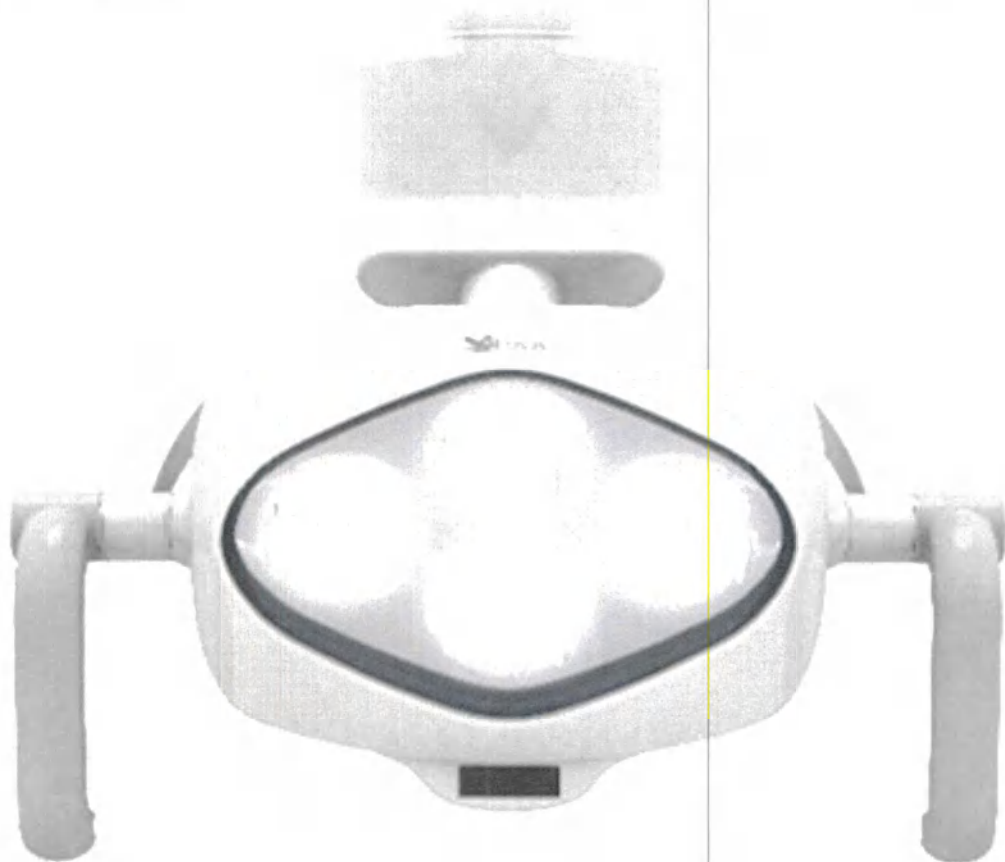

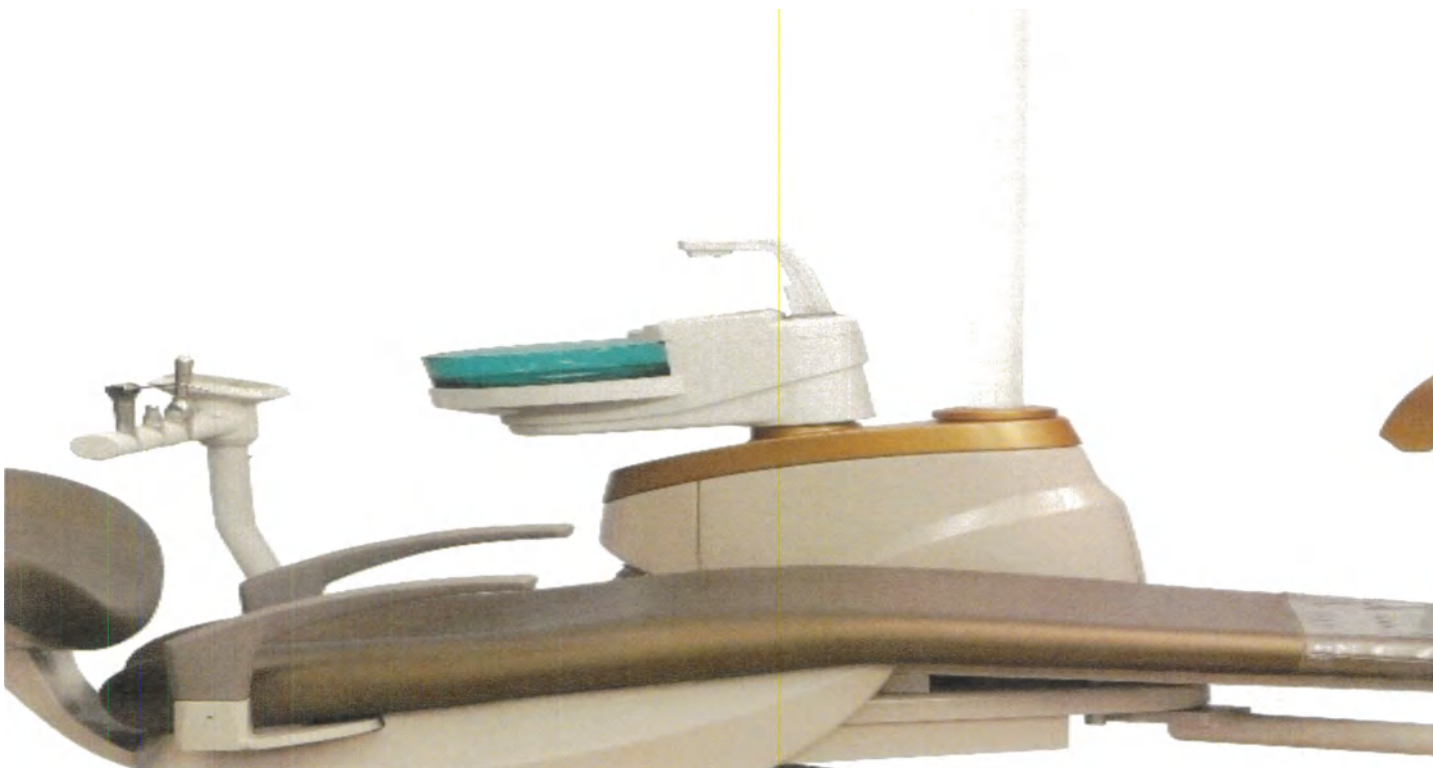


Крепление на стоматологическую установку

Крепление переходное (для светильника стоматологического Luvix C500\C300\C400)


- Арт. EL100T-M3016:

- Арт. EL100T-M3009:

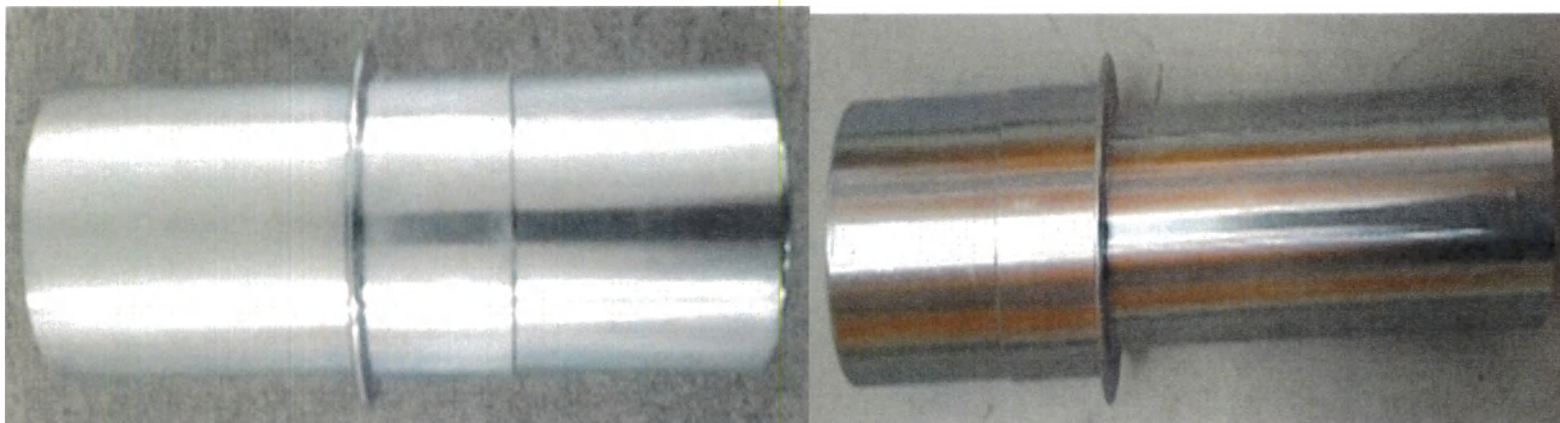


- Арт. EL100T-M3001:


- Арт. EL100T-M3004:

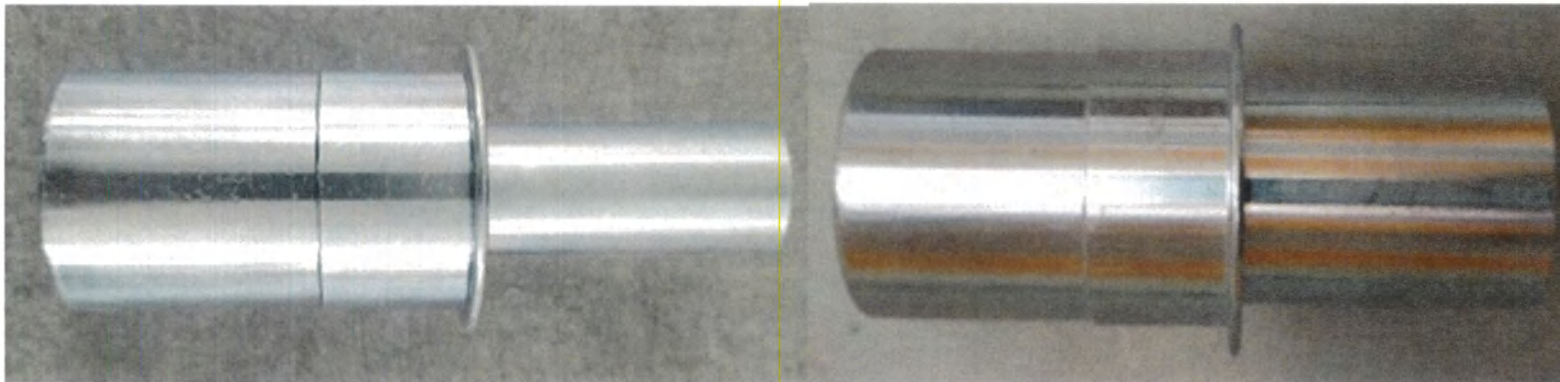


- Арт. EL100T-M3008:

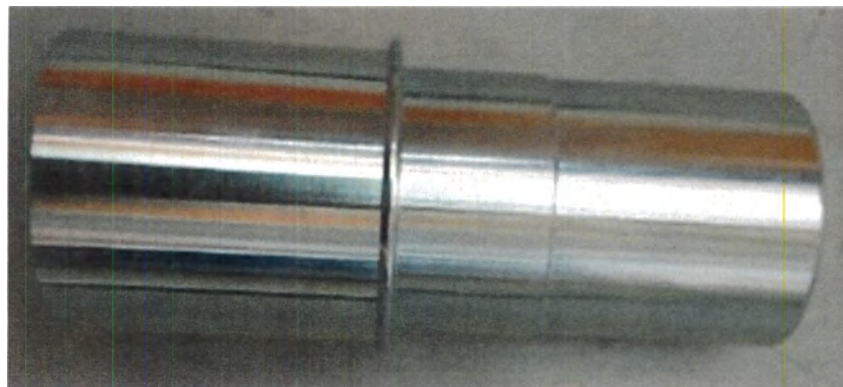


- Арт. EL100T-M3006:

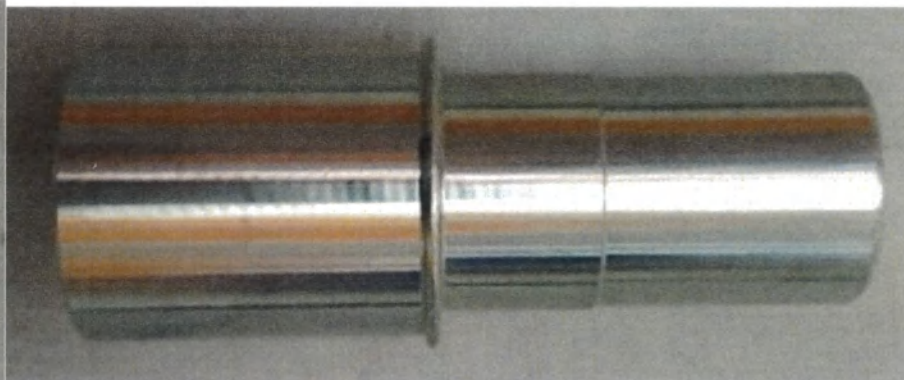

- Арт. EL100A-CC010:

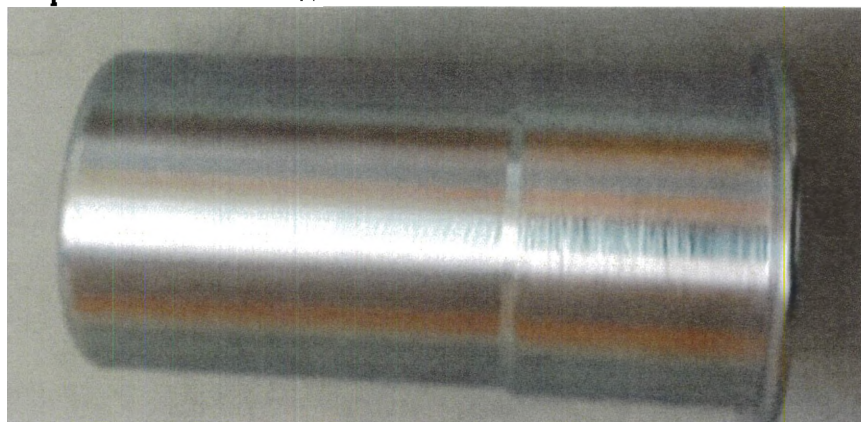


- Арт. EL100T-M3018:

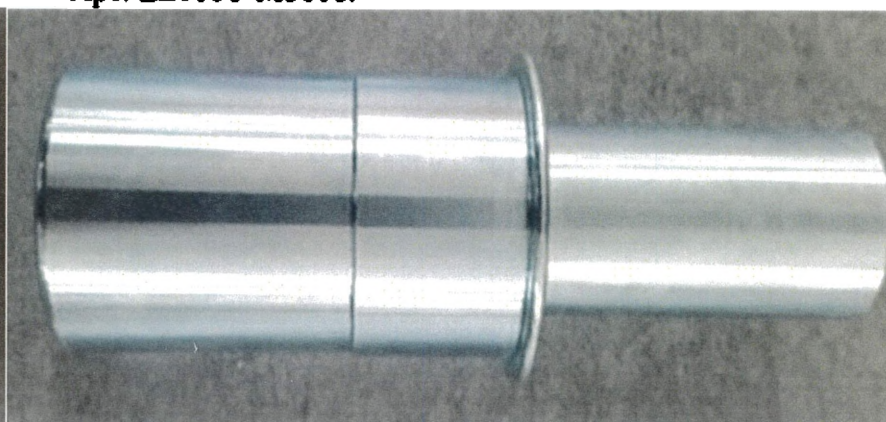


Конвертер SC-HDR01S (арт. RL10IT-HG010):




Коробка для записывающего устройства (Арт. RL10AC-CL010 и RL10AC-CL020)

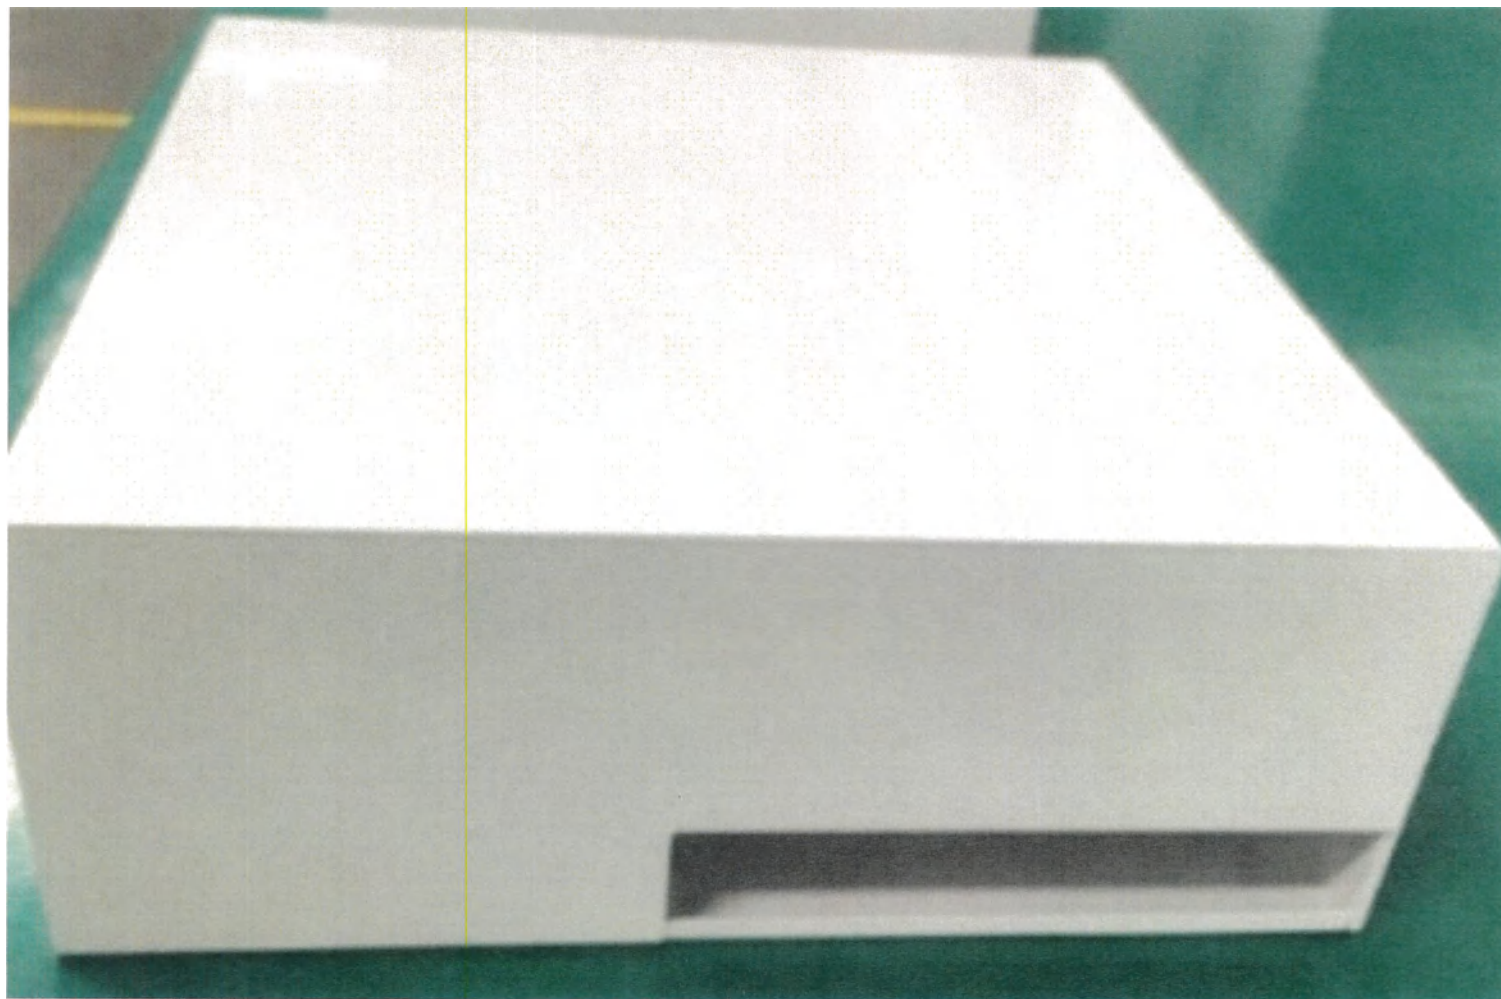


Полка-крепление (Арт. RL10IA-ZR020)

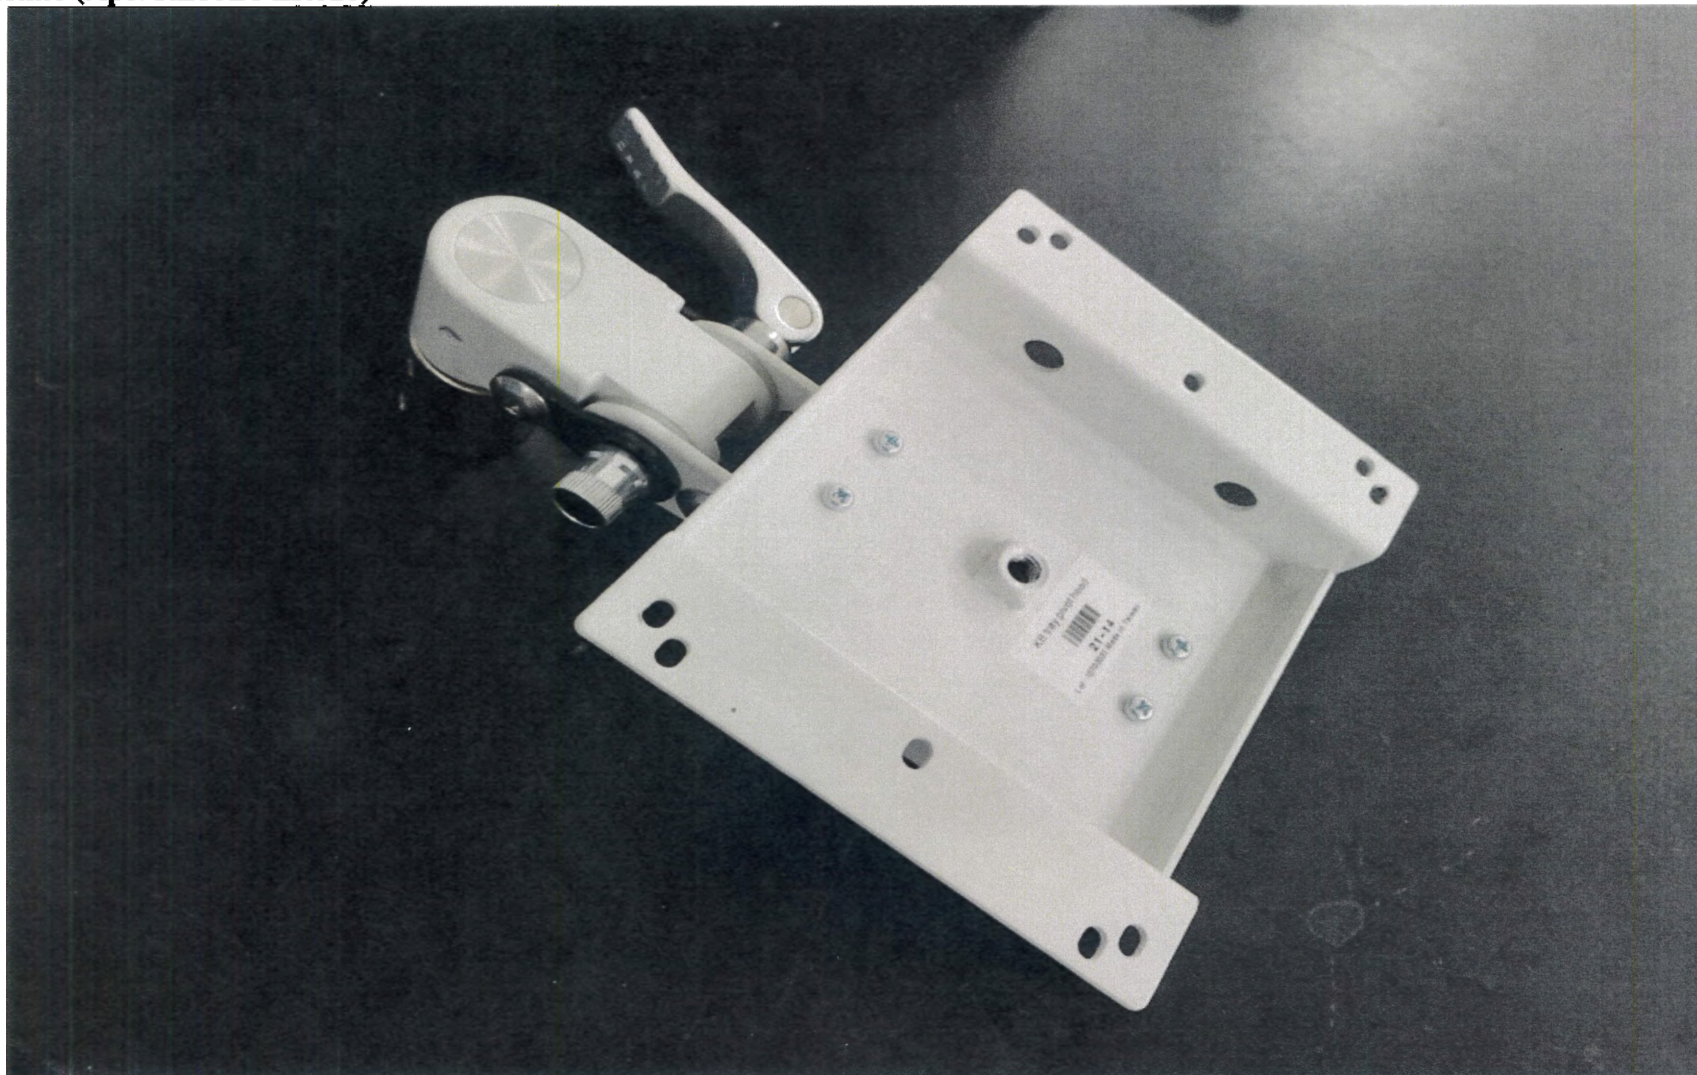

Крепление фиксирующее (Арт. RL10IA-ZR010)

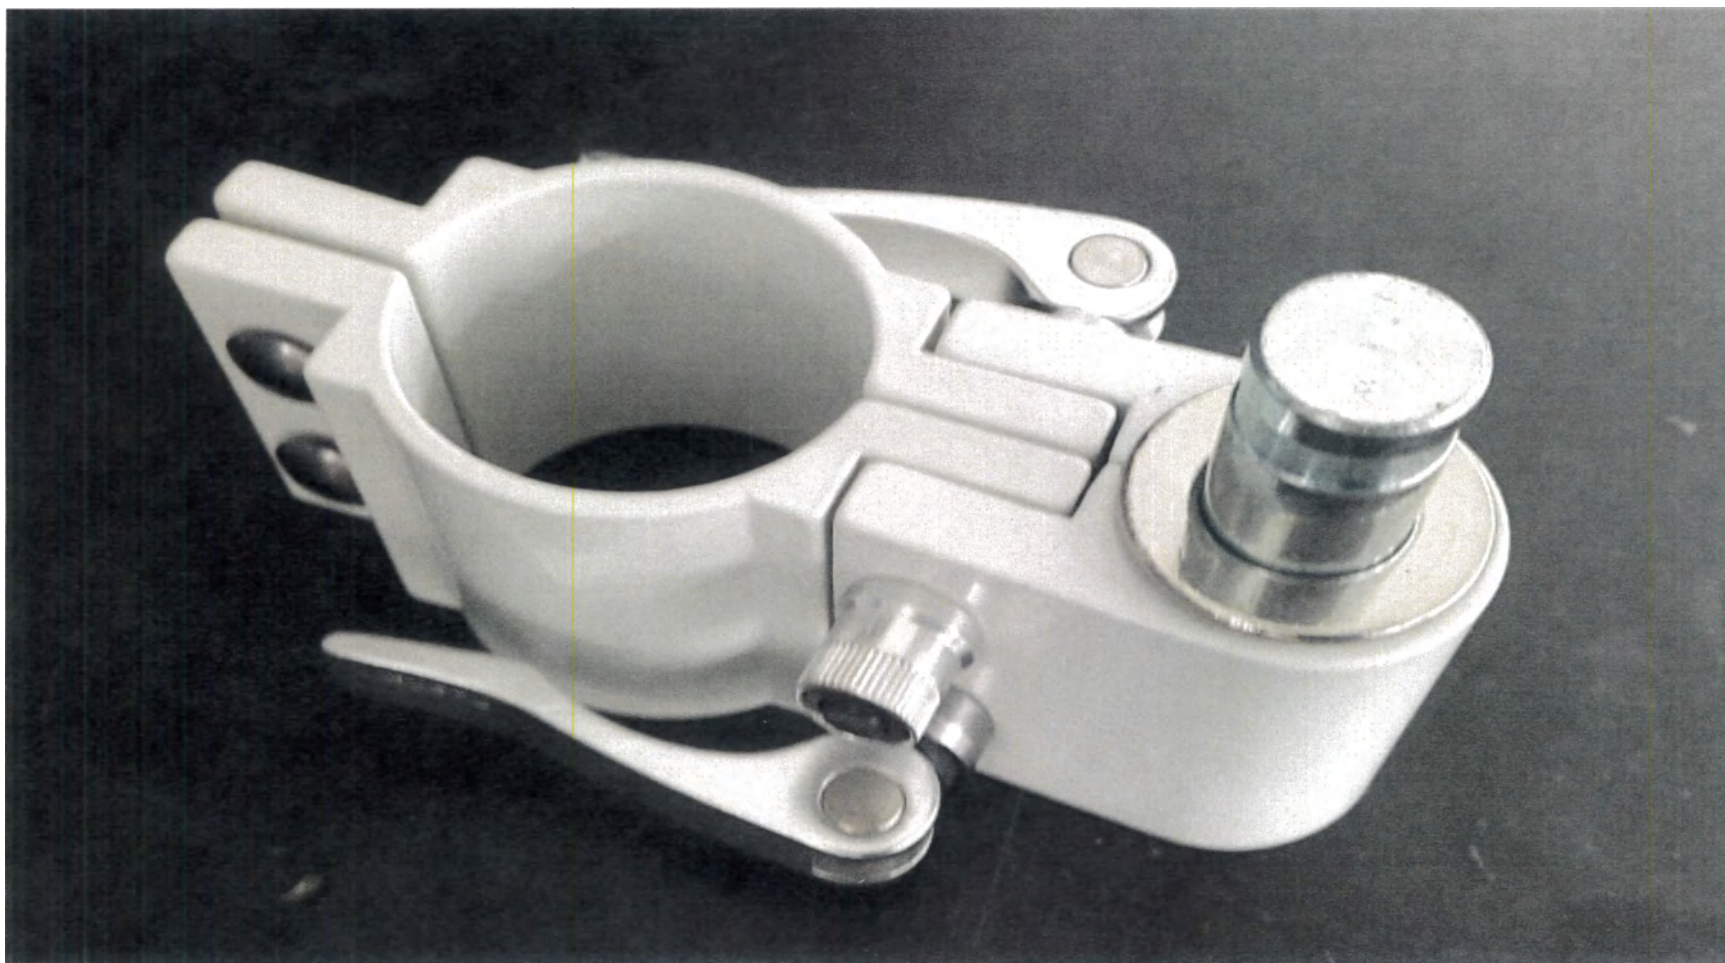

Крепление для монитора (Арт. RL10IA-ZR030)

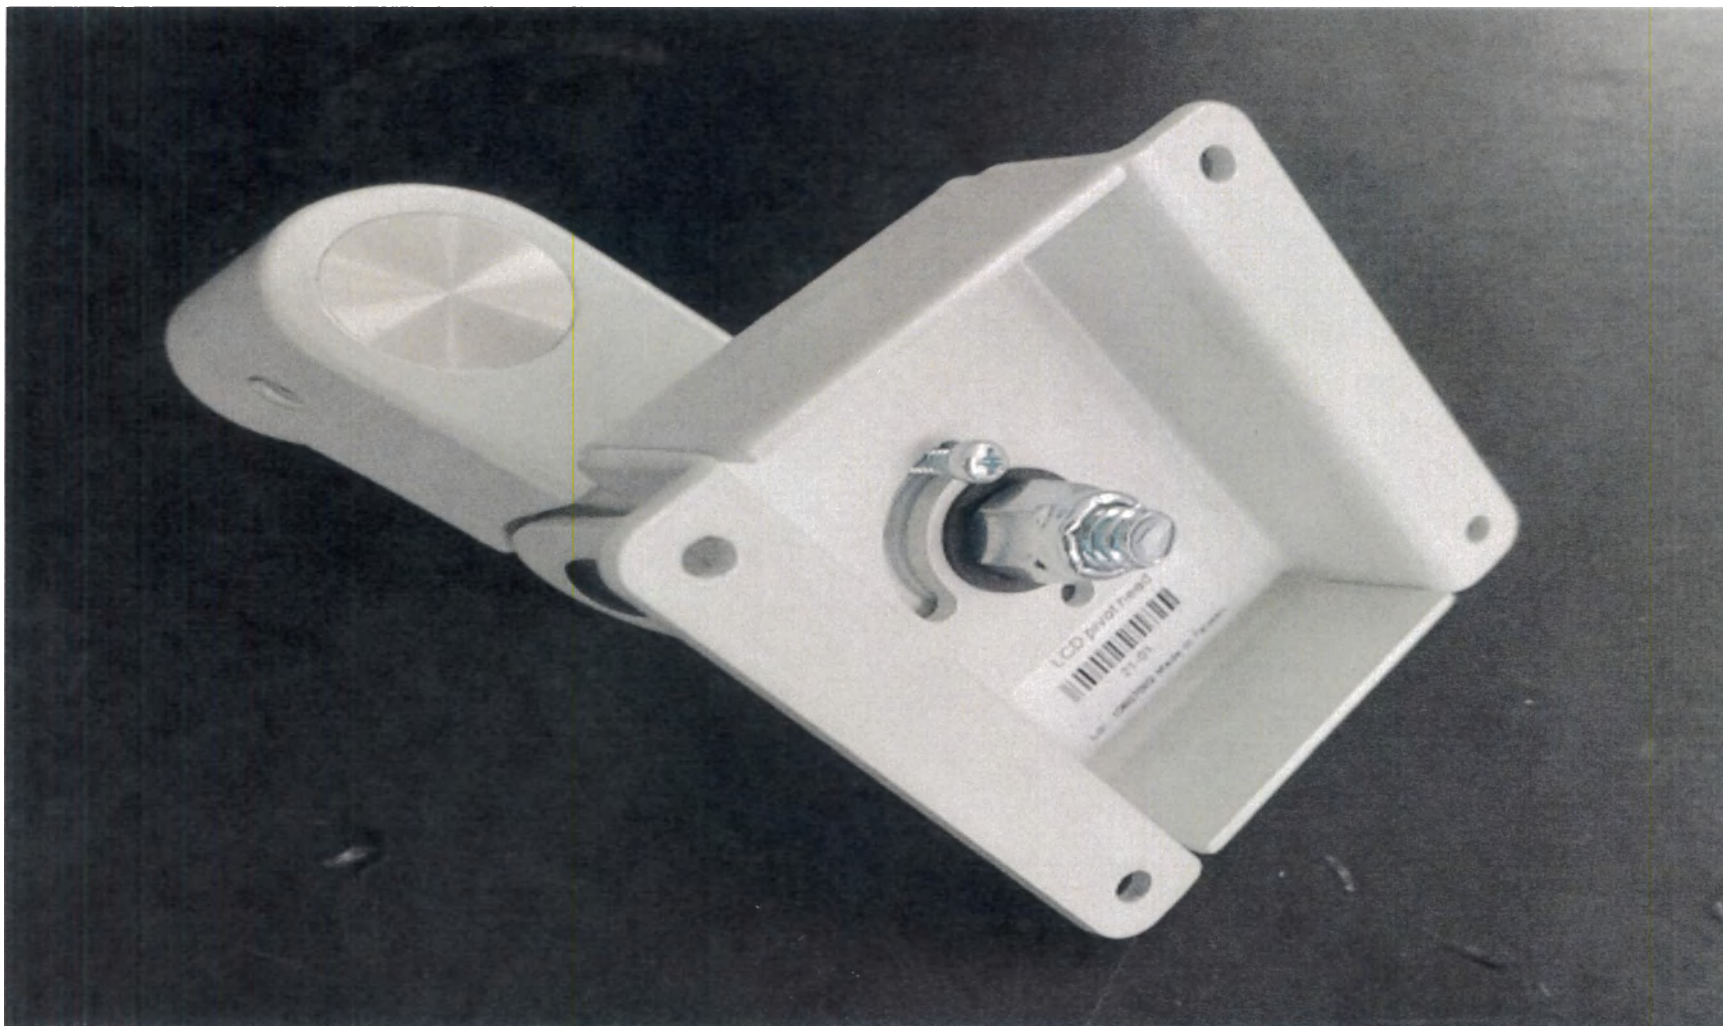

Крепление на стоматологическую установку (Арт. SL105A-A31100)




Часть крепления	фотография
Плечо светильника	
Держатель светильника	

Крепление на стену (Арт. SL2S3A-A1010-AS)



Часть крепления	фотография
Плечо светильника	
Держатель светильника	
Крепление на стену	

Крепление мобильное (Арт. RL10IA-CC020)


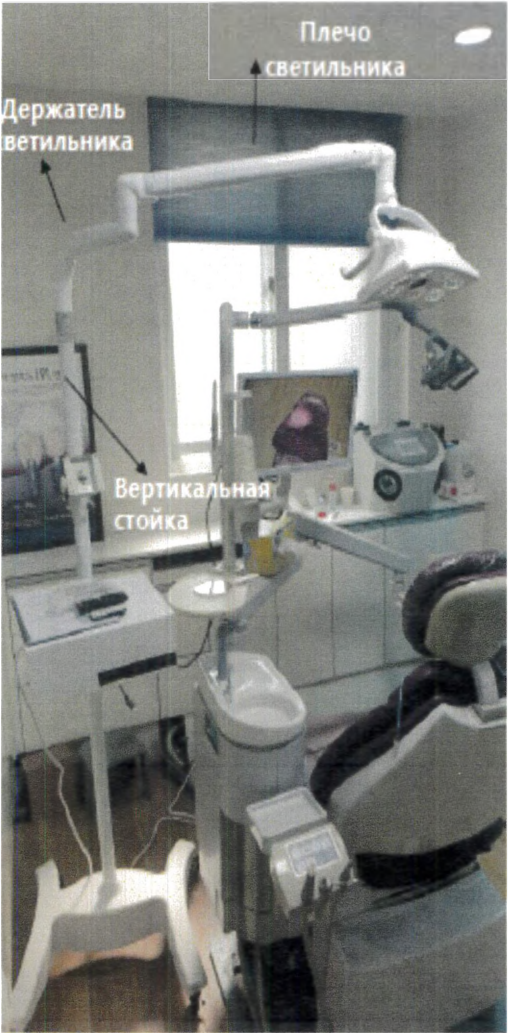


Часть крепления	фотография
Плечо светильника	
Держатель светильника	
Вертикальная стойка	



Часть крепления	фотография	
Фиксирующее крепление Полка крепление		
Коробка для записывающего устройства		
Крепление для монитора		

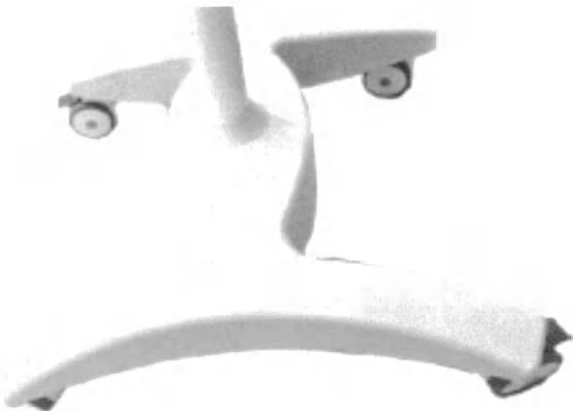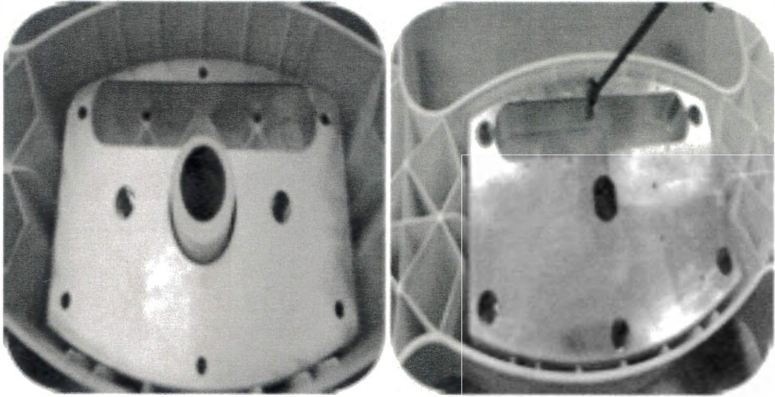


Часть крепления	фотография	
Мобильное основание		
Груз утяжелитель		

Крепление на потолок (Арт. PL10AA-0010)




Часть крепления	фотография
Плечо светильника	
Держатель светильника	
Потолочная Вертикальная стойка	

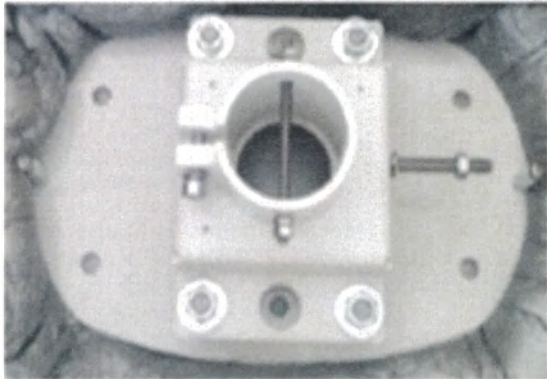

Часть крепления	фотография
Крепление на потолок	
Крышка потолочного крепления	

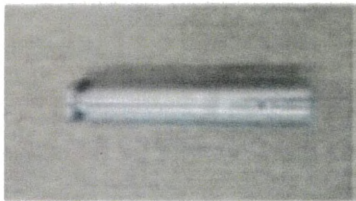

Часть крепления	фотография
Крепление к потолочной вертикальной стойке	
Поворотный переходник с фиксирующей шайбой	

МАРКИРОВКА для РФ

Основная маркировочная табличка производителя для РФ:

ИЗДЕЛИЕ			   IP x0    
МОДЕЛЬ	REF	масса ____ кг	
ХАРАКТЕРИСТИКИ	Напряжение переменного тока ____ В, ____ Гц ____ ВА		
СЕРИЙНЫЙ НОМЕР	LOT	Соответствующая запись	
ГОД, МЕСЯЦ		Соответствующая запись	
Медицинское электрическое оборудование QC PASS Сделано в Корее  Дентис Ко., Лтд., 99, Сеонгсеосо-ро, Дальсео-гу, г. Тэгу, Корея Тел.: 053-583-2804, факс: 053-583-2806			
Уполномоченный представитель производителя: ООО «Дентис Имплант», Россия, 125430, г Москва, ул. Митинская, дом №36, корпус 1. Тел.: +7 (495) 663-8688			

Линия отреза

Расшифровка символов:

На маркировке оборудования и/или в руководстве используются следующие символы:

Обозначения	Значение
	Маркировка CE. Изделие имеет маркировку CE и соответствует требованиям Директивы о медицинских изделиях 93/42/ЕЕС с поправками, внесенными в него в соответствии с 2007/47/ЕС, Приложение I и Приложение VII.
	Рекомендации
	Не выбрасывайте в обычные бытовые отходы
	Внимание!
	ОСТОРОЖНО!
	Соблюдать требования Руководства по эксплуатации
	Обратитесь к инструкции по эксплуатации
	Не толкать/Не наклонять
	Не садится
	Не вставать
	Хранить в сухом месте

Обозначения	Значение
	Не вешать на крючки
	Осторожно! Хрупкое
	Верх!
	Не ставьте друг на друга более 5 ящиков
	Производитель
	Дата производства
	Температура в пределах 0°C ~ 40°C
	Относительная влажность в пределах 0 ~ 80%
	Международный символ вторичной переработки или лента Мебиуса
	Только для использования внутри помещения (блок питания)
	Соответствует требованиям технического регламента "Ограничения на использование опасных материалов в производстве электрического и электронного оборудования" при повышенном напряжении (блок питания)



XP Power
www.xppower.com
MODEL:
AFM60US15

INPUT: 100-240V~1.5A

50-60Hz


OUTPUT: 15.0V $\equiv$ 4.0A



C  US
E321744 UL60601-1



For medical equipment



Efficiency Level 

CAUTION:

FOR INDOOR USE ONLY

S/N: 1407-00974

MADE IN CHINA

Маркировочная табличка блока питания:

ПЕРЕВОД:

XP Power	XP Power
Model	Модель
INPUT: 100-240V-1,5A 50-60Hz OUTPUT: 15.0V-4.0A	ВХОД: 100-240 В-1,5 А 50-60 Гц ВЫХОД: 15.0 В -4.0 А
E	Уровень эффективности V
CAUTION:	ОСТОРОЖНО:
FOR INDOOR USE ONLY	ТОЛЬКО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ПОМЕЩЕНИИ
S/N	СЕРИЙНЫЙ НОМЕР
MADE IN CHINA	ПРОИЗВЕДЕНО В КИТАЕ

Маркировочная табличка. Для наклейки пластиковой

Пластиковая наклейка

для Светильника стоматологического Luvis C500

REF RL10IH-MJ090



 Дентис Ко., Лтд.
99, Сеонгсеосо-ро, Дальсео-гу, г. Тэгу, Корея
Тел.: 053-583-2804, факс: 053-583-2806

Уполномоченный представитель производителя: ООО
«Дентис Имплант», Россия, 125430, г. Москва, ул. Митинская,
дом 36, корпус 1. Тел.: +7 (495) 663 -8688

Маркировочная табличка. Для пульта дистанционного управления

Пульт дистанционного управления

для Светильника стоматологического Luvis C500

REF **RL10IH-MJ050**







Дентис Ко., Лтд.

99, Сеонгсеосо-ро, Дальсео-гу, г. Тэгу, Корея

Тел.: 053-583-2804, факс: 053-583-28066

Уполномоченный представитель производителя: ООО
«Дентис Имплант», Россия, 125430, г. Москва, ул. Митинская,
дом 36, корпус 1. Тел.: +7 (495) 663 -8688

Маркировочная табличка.

Для крепления переходного (для светильника стоматологического Luvis C500/C300/C400):

Крепление переходное

для Светильника стоматологического Luvis C500/C400/C300

REF







Дентис Ко., Лтд.

99, Сеонгсеосо-ро, Дальсео-гу, г. Тэгу, Корея

Тел.: 053-583-2804, факс: 053-583-28066


Уполномоченный представитель производителя: ООО «Дентис
Имплант», Россия, 125430, г. Москва, ул. Митинская, дом 36, корпус 1.
Тел.: +7 (495) 663 -8688

Для конвертера SC-HDR01S

Конвертер SC-HDR01S

для Светильника стоматологического Luvis C500

REF RL10IT-HG010







Дентис Ко., Лтд.

99, Сеонгсеосо-ро, Дальсео-гу, г. Тэгу, Корея

Тел.: 053-583-2804, факс: 053-583-28066

Уполномоченный представитель производителя: ООО
«Дентис Имплант», Россия, 125430, г. Москва, ул.
Митинская, дом 36, корпус 1. Тел.: +7 (495) 663 -8688

Коробка для записывающего устройства

Коробка для записывающего устройства для Светильника стоматологического Luvis C500

REF RL10AC-CL010 /RL10AC-CL020



 Дентис Ко., Лтд.
99, Сеонгсеосо-ро, Дальсео-гу, г. Тэгу, Корея
Тел.: 053-583-2804, факс: 053-583-28066

Уполномоченный представитель производителя: ООО «Дентис
Имплант», Россия, 125430, г. Москва, ул. Митинская, дом 36, корпус 1.
Тел.: +7 (495) 663 -8688

Полка-крепление

Полка-крепление

для Светильника стоматологического Luvis C500



RL10IA-ZR020







Дентис Ко., Лтд.

99, Сеонгсеосо-ро, Дальсео-гу, г. Тэгу, Корея

Тел.: 053-583-2804, факс: 053-583-28066

Уполномоченный представитель производителя: ООО

«Дентис Имплант», Россия, 125430, г. Москва, ул. Митинская,
дом 36, корпус 1. Тел.: +7 (495) 663 -8688

Крепление Фиксирующее

Крепление Фиксирующее

для Светильника стоматологического Luvis C500

REF

RL10IA-ZR010







Дентис Ко., Лтд.

99, Сеонгсеосо-ро, Дальсео-гу, г. Тэгу, Корея

Тел.: 053-583-2804, факс: 053-583-28066

Уполномоченный представитель производителя: ООО «Дентис
Имплант», Россия, 125430, г. Москва, ул. Митинская, дом 36, корпус 1.
Тел.: +7 (495) 663 -8688

Крепление для монитора

для Светильника стоматологического Luvis C500



RL10IA-ZR030








Дентис Ко., Лтд.

99, Сеонгсеосо-ро, Дальсео-гу, г. Тэгу, Корея

Тел.: 053-583-2804, факс: 053-583-28066

Уполномоченный представитель производителя: ООО «Дентис
Имплант», Россия, 125430, г. Москва, ул. Митинская, дом 36, корпус 1.
Тел.: +7 (495) 663 -8688

Маркировка транспортной упаковки.

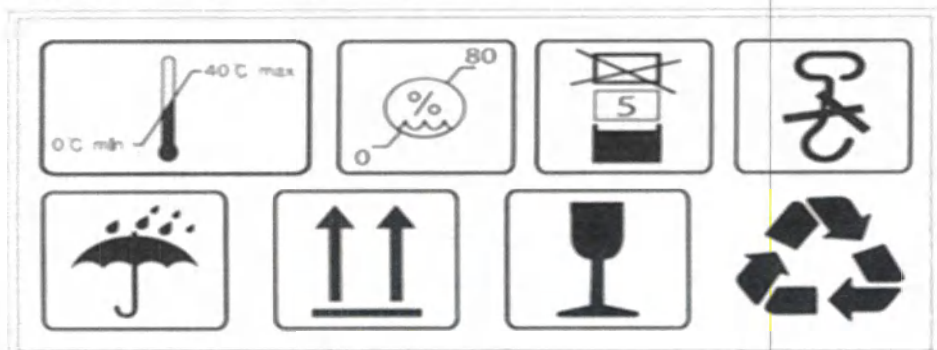

Дентис Ко., Лтд.

99, Сеонгсеосо-ро, Дальсео-гу, г. Тэгу, Корея
Тел.: 053-583-2804, факс: 053-583-28066

Уполномоченный представитель производителя:
ООО «Дентис Имплант», Россия, 125430, г. Москва,
ул. Митинская, дом 36, корпус 1. Тел.: +7 (495) 663 -
8688

ИЗДЕЛИЕ

Соответствующая запись

МОДЕЛЬ

Соответствующая запись



БРУТТО, кг

Соответствующая запись

НЕТТО, кг

Соответствующая запись

**ГОД, МЕСЯЦ
упаковки**

Соответствующая запись

ВСЕГО ПРОШЛО И
СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ
ЛИСТОВ 44

Генеральный
директор

Сергеев С.Н.



17.12.21