

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор ООО «РегМед проф.»



_____ Стенина И.А.

_____ 2021г.




ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

«Инструмент хирургический офтальмологический для имплантации интраокулярных линз»

Производства Открытое акционерное общество «ФизИОЛ», Бельгия (Public limited company PhysIOL, Belgium)

Инструмент хирургический офтальмологический для имплантации интраокулярных линз, в составе:

*На фотографиях представлен демонстрационный образец, о чем сообщает надпись фраза «NOT FOR HUMAN USE»

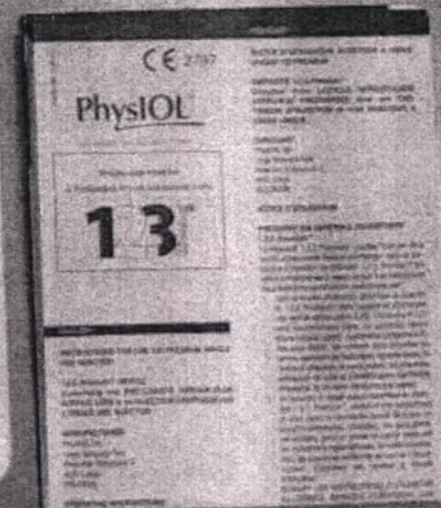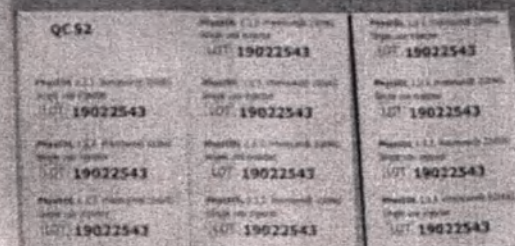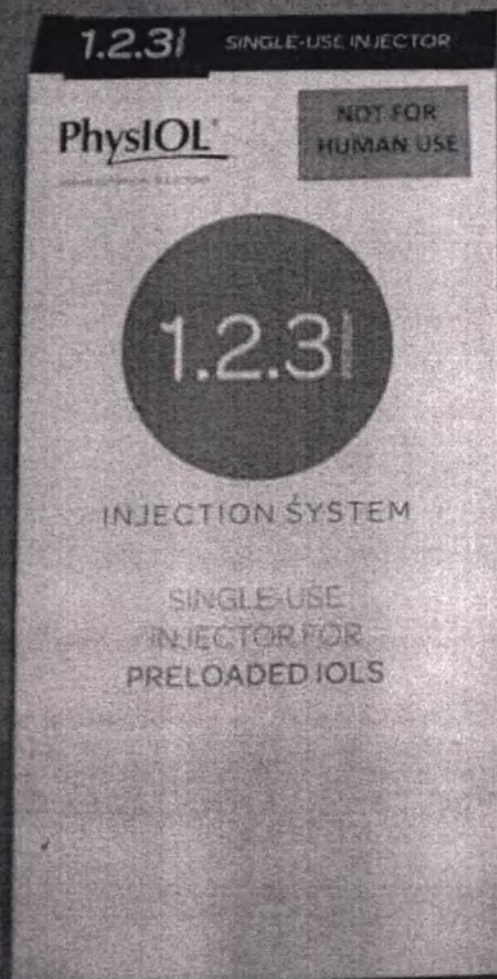

PhysIOL[®]

ADVANCED OPTICAL SOLUTIONS

NOT FOR
HUMAN USE

1.2.3^{PREMIUM}

INJECTION SYSTEM

SINGLE-USE
INJECTOR FOR
PRELOADED IOLS

STERILE 2



PhysIOL 1.2.3. Premium® 226NG

Single use injector for PhysIOL
preloaded acrylic IOL

Injecteur à usage unique pour LIO
acrylique préchargée PhysIOL

LOT 19022543



2024-01

DO NOT RSTERILIZE

CE 2797




(01)05414846500030(17)240130(21)19022543



Manufactured by

PhysIOL s.a.
Lige Science Park
Allée des Noisetiers 4
4031 Lige
Belgium
www.physiol.eu

- инжектор одноразовый 1.2.3.Premium – 1 шт.

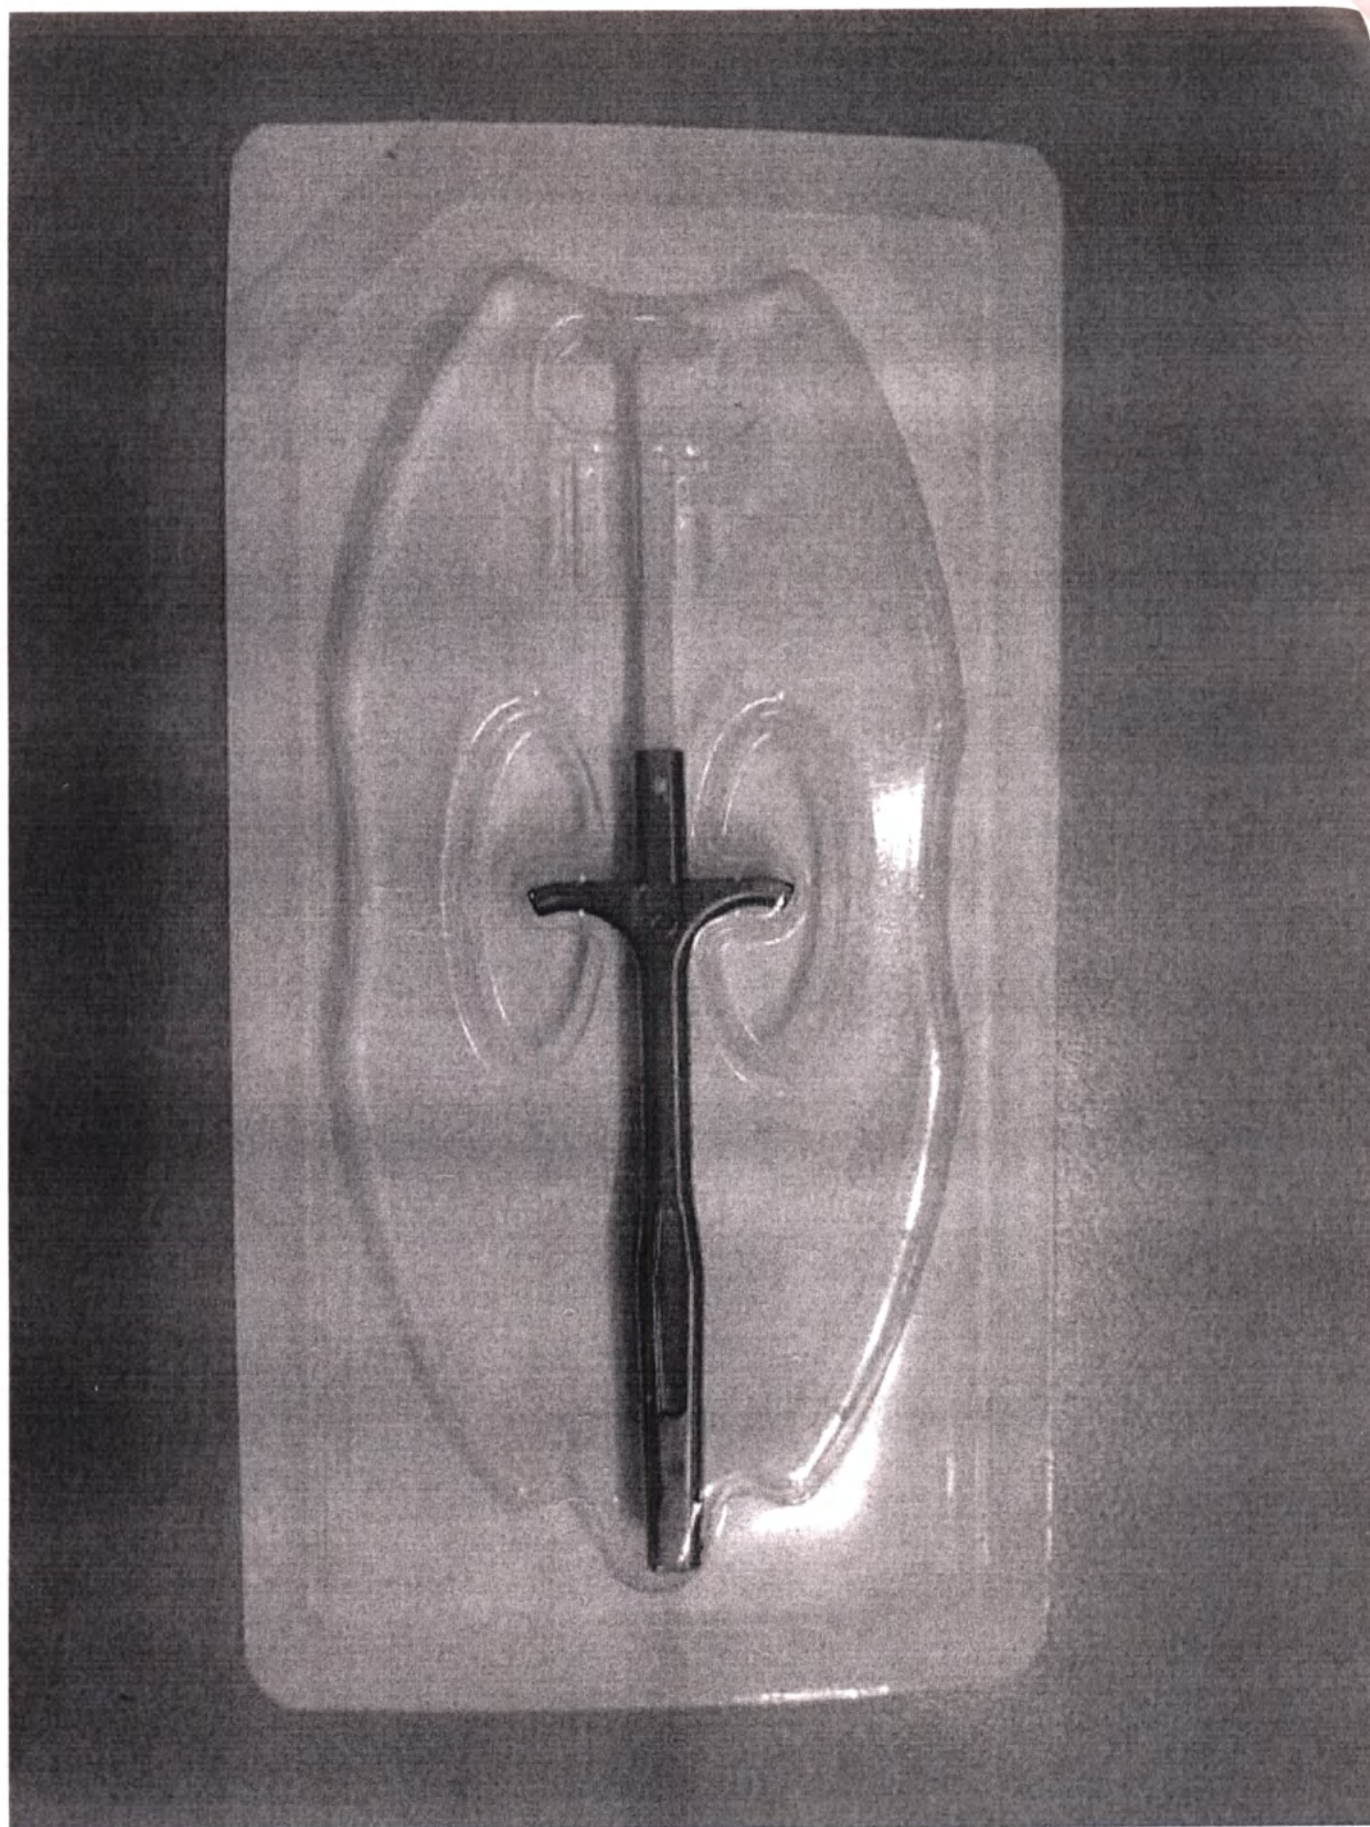

PhysIOL®

PhysIOL® 1.2.3.Premium®
Single use injector for PhysIOL®
preloaded acrylic intraocular lens

- Injecteur à usage unique pour implant intraoculaire acrylique préchargé PhysIOL®
- Einmalinjektor für PhysIOL® Acryl vorgeladene Intraokularlinse
- Injector voor éénmalig gebruik bedoeld voor PhysIOL® intraoculaire voorgeladen acryl implantaat
- Injector a uso único para lentes intraoculares acrílicas precargadas PhysIOL®



2024-01

LOT

19022543

STERILE

EO



0226NG



CE 2797

- Do not use if package is opened or damaged.
- Ne pas utiliser si l'emballage est ouvert ou endommagé.
- Nicht verwenden falls die Verpackung geöffnet oder beschädigt ist.
- Niet gebruiken als de verpakking geopend of beschadigd is.
- No usar si el embalaje estuviera abierto o dañado.



PhysIOL - Allée des Noisetiers, 4
B-4031 Liège (Belgium)
www.physiol.be

- этикетка - 11 шт.;

QC52

PhysIOL 1.2.3. Premium® 226NG
Single use injector

LOT 19022543

PhysIOL 1.2.3. Premium® 226NG
Single use injector

LOT 19022543

PhysIOL 1.2.3. Premium® 226NG
Single use injector

LOT 19022543

PhysIOL 1.2.3. Premium® 226NG
Single use injector

LOT 19022543

PhysIOL 1.2.3. Premium® 226NG
Single use injector

LOT 19022543

PhysIOL 1.2.3. Premium® 226NG
Single use injector

LOT 19022543

PhysIOL 1.2.3. Premium® 226NG
Single use injector

LOT 19022543

PhysIOL 1.2.3. Premium® 226NG
Single use injector

LOT 19022543

PhysIOL 1.2.3. Premium® 226NG
Single use injector

LOT 19022543

PhysIOL 1.2.3. Premium® 226NG
Single use injector

LOT 19022543

PhysIOL 1.2.3. Premium® 226NG
Single use injector

LOT 19022543

- инструкция по применению – 1 шт.

FRANCAIS

CE 2797

EMB158 1947

PhysIOL®

ADVANCED OPTICAL SOLUTIONS

**Single-use injector
& Preloaded Acrylic Intraocular Lens**

123®
Premium®

NOTICE D'UTILISATION INJECTEUR A USAGE UNIQUE 123 PREMIUM

DISPOSITIF 1.2.3. Premium®

Composé d'une LENTILLE INTRAOCULAIRE ACRYLIQUE PRECHARGEE dans une CARTOUCHE D'INJECTION et d'un INJECTEUR A USAGE UNIQUE

FABRICANT

PhysIOL SA
Liege Science Park
Allée des Noisetiers 4
4031 Liège
BELGIQUE

NOTICE D'UTILISATION

PRESENTATION GENERALE DU DISPOSITIF

1.2.3. Premium®

Le dispositif 1.2.3. Premium® permet l'injection de la lentille intraoculaire fournie préchargée dans sa cartouche d'injection. Le dispositif 1.2.3. Premium® est prêt à l'emploi et est à usage unique. Il se compose de deux éléments conditionnés individuellement :

1. Une cartouche d'injection spécifique au dispositif 1.2.3. Premium® dans laquelle est préchargée une lentille intraoculaire (LIO). Cartouche et LIO sont conditionnées dans un conteneur rempli d'une solution saline. L'ensemble cartouche-LIO, mis sous blister, est contenu dans un boîtier en carton reprenant les indications réglementaires, la notice d'utilisation, la carte patient, les étiquettes adhésives de suivi et d'identification. Cartouche d'injection et LIO sont stérilisées à la vapeur.
2. Un injecteur à usage unique spécifique au dispositif 1.2.3. Premium®, constitué d'un corps (bleu) et d'un piston à l'extrémité duquel se trouve un coussin déformable. L'injecteur mis sous blister, est contenu dans un boîtier en carton reprenant les indications réglementaires, la notice d'utilisation, les étiquettes adhésives de suivi et d'identification. L'injecteur est stérilisé à l'oxyde d'éthylène.

SUIVANT LES INSTRUCTIONS D'UTILISATION ILLUSTREES REPRISES CI-DESSOUS, juste

ENGLISH

INSTRUCTIONS FOR USE 123 PREMIUM SINGLE USE INJECTOR

1.2.3. Premium® DEVICE

Comprising one PRE-LOADED INTRAOCULAR ACRYLIC LENS in an INJECTION CARTRIDGE and a SINGLE USE INJECTOR

MANUFACTURER

PhysIOL SA
Liege Science Park
Allée des Noisetiers 4
4031 Liège
BELGIUM

OPERATING INSTRUCTIONS

Спасибо и всего
хорошего
Ваша дочь
Анна А.А.

