

**Фотографические изображения общего вида
медицинского изделия**

**Набор реагентов для количественного определения иммуноглобулина G (IgG) в сыворотке или плазме крови человека имунотурбидиметрическим методом на биохимических анализаторах Alinity c
«Иммуноглобулин G Реагенты для Alinity c (Immunoglobulin G)»**

Фотографическое изображение МИ ИВД Иммуноглобулин G Реагенты для Alinity с (Immunoglobulin G), 4 картриджа по 90 тестов, упаковка, вид снаружи



Фотографическое изображение МИ ИВД Иммуноглобулин G Реагенты для Alinity с (Immunoglobulin G), 4 картриджа по 90 тестов, упаковка, вид изнутри





1 скреплено печатью

3

Лаборатория

Подпись _____

«Эбботт Лэбораториз»
Limited liability company
Abbott Laboratories

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ЭББОТТ ЛЭБОРАТОРИЗ»
ОГРН 1047700009000
ИНН 7707083893
ОБЪЕКТ ОБЛОГА
МОСКВА • БУЛЬВАР НЕЖИТОВСКИЙ, 10
ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ

Макет маркировки на медицинское изделие

**Набор реагентов для количественного определения иммуноглобулина G
(IgG) в сыворотке или плазме крови человека
иммунотурбидиметрическим методом
на биохимических анализаторах Alinity c
«Иммуноглобулин G Реагенты для Alinity c (Immunoglobulin G)»**

Макет маркировки медицинского изделия для пользователей Российской Федерации,
вариант исполнения: 4 картриджа по 90 тестов

		09P6224		
Набор реагентов для количественного определения иммуноглобулина G (IgG) в сыворотке или плазме крови человека имунотурбидиметрическим методом на биохимических анализаторах Alinity c «Имуноглобулин G Реагенты для Alinity c (Immunoglobulin G)» 4 картриджа по 90 тестов, в составе: Реагент 1 (Alinity c IgG R1) – 4 x 19,8 мл; Реагент 2 (Alinity c IgG R2) – 4 x 19,4 мл; Инструкция по применению / Производитель: Эбботт Ирландия, Диагностическое подразделение, Abbott Ireland Diagnostics Division, Lisnamuck, Longford, Longford, Ireland / Место производства: Abbott Ireland Diagnostics Division, Lisnamuck, Longford, Co. Longford, Ireland / Страна происхождения: Япония / РУ № ____/____ от ____г. / Инструкция по применению на русском языке: www.corelaboratory.abbott/IFU / Серия, использовать до, условия хранения указаны в графических символах. Расшифровку графических символов см. в инструкции. Авторизованный представитель изготовителя на территории России и других стран СНГ: ООО «Эбботт Лэбораториз», 125171, Россия, г. Москва, Ленинградское шоссе, д.16А, строение 1 Тел.: +7 (495) 258 42 80; Факс: +7 (495) 258 42 81				

Маркировка медицинского изделия Иммуноглобулин G Реагенты для Alinity с
(Immunoglobulin G), 4 картриджа по 90 тестов

	 2°C 8°C	IgG REF 09P6224 LOT Exp.	 4 x 90	 4 x 19.8 mL 4 x 19.4 mL	R1 R2	 2°C 8°C	Alinity c IVD CE 0123	Abbott Immunoglobulin G	Abbott Diagnostica Division Leimnack, Longford Co. Longford Ireland +353-43-3331000 MANUFACTURED FOR Abbott Laboratories PRODUCT OF JAPAN
---	--	--	--	---	-------------------------------	--	---	---	--

Information for USA only

The Immunoglobulin G assay is used for the quantitation of IgG in human serum or plasma on the Alinity c system.


- (*) Active ingredient: polyethylene glycol (50 g/L), inactive ingredient: buffer, Preservative: sodium azide (0.1%).
- (**) Active ingredient: anti-human IgG goat serum (<50%), inactive ingredient: buffer, Preservative: sodium azide (0.1%).

Distributed in the USA by Abbott Laboratories, Abbott Park, IL 60064 USA

CONTAINS: AZIDE

H143Z7R02

Макет маркировки блока компонентов медицинского изделия Иммуноглобулин G Реагенты для Alinity c (Immunoglobulin G), картридж на 90 тестов:

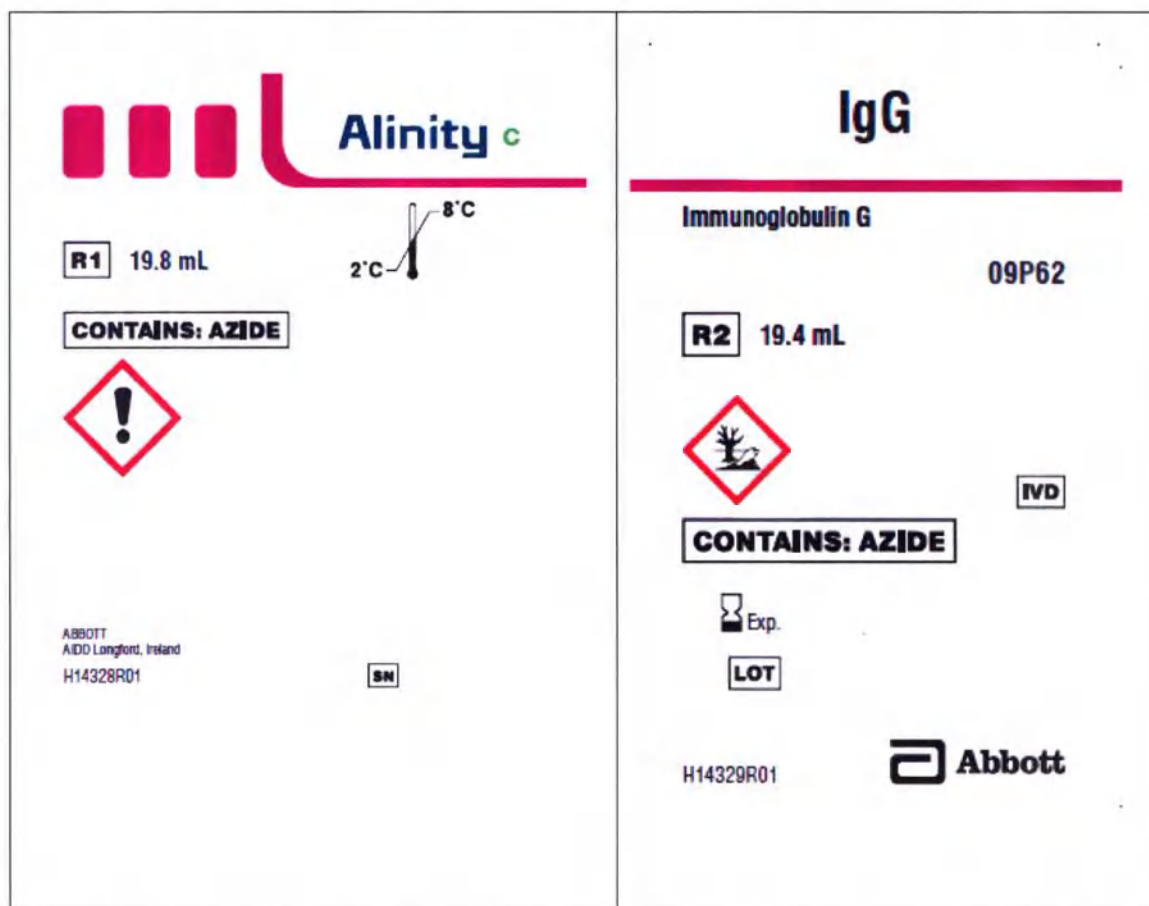

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью
4 листов

