

Руководитель группы регистрации
ООО «Сименс Здоровоохранение»



Н.А. Горшкова
2021 г.

**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ
ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ IN VITRO**

**«Набор реагентов для определения свободной бета-субъединицы хорионического
гонадотропина человека на анализаторах иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Free
Beta Human Chorionic Gonadotropin (Atellica IM FBHCG))»**

производства «Сименс Хелскеа Диагностикс Инк.», Siemens Healthcare Diagnostics Inc., США

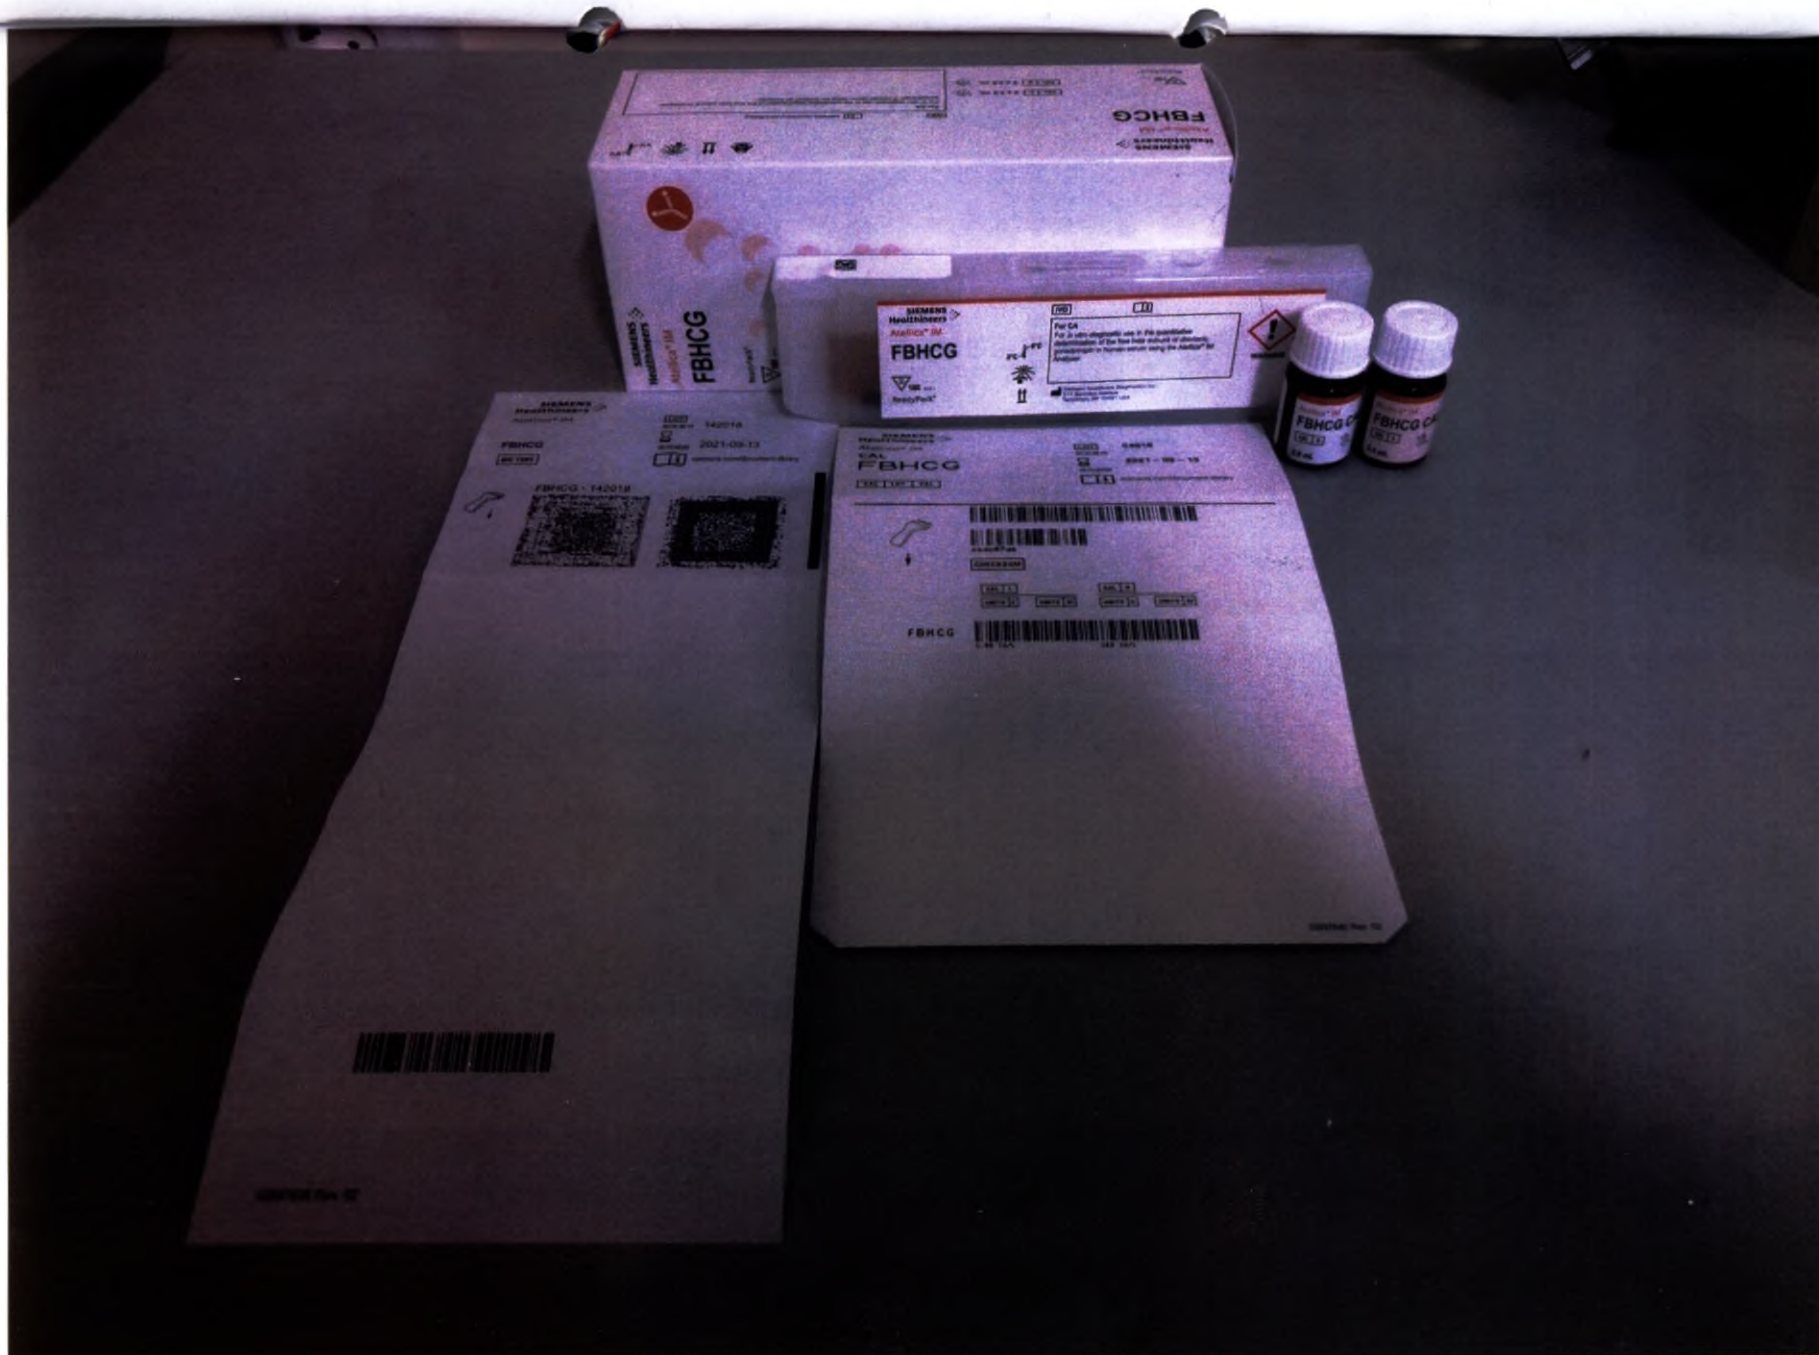


Рисунок 1. Набор реагентов для определения свободной бета-субъединицы хорионического гонадотропина человека на анализаторах иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Free Beta Human Chorionic Gonadotropin (Atellica IM FBHCG)): Фасовка 100 тестов. Общий вид.



Рисунок 2. Набор реагентов для определения свободной бета-субъединицы хорионического гонадотропина человека на анализаторах иммунохимических серий Atellica (Atellica IM Free Beta Human Chorionic Gonadotropin (Atellica IM FBHCG)); Фасовка 500 тестов. Общий вид.



Рисунок 3. Набор реагентов для определения свободной бета-субъединицы хорионического гонадотропина человека на анализаторах

ООО ЦРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU (Atellica IM Free Beta Human Chorionic Gonadotropin (Atellica IM FBHCG)): Фасовка 500 тестов. Общий вид.

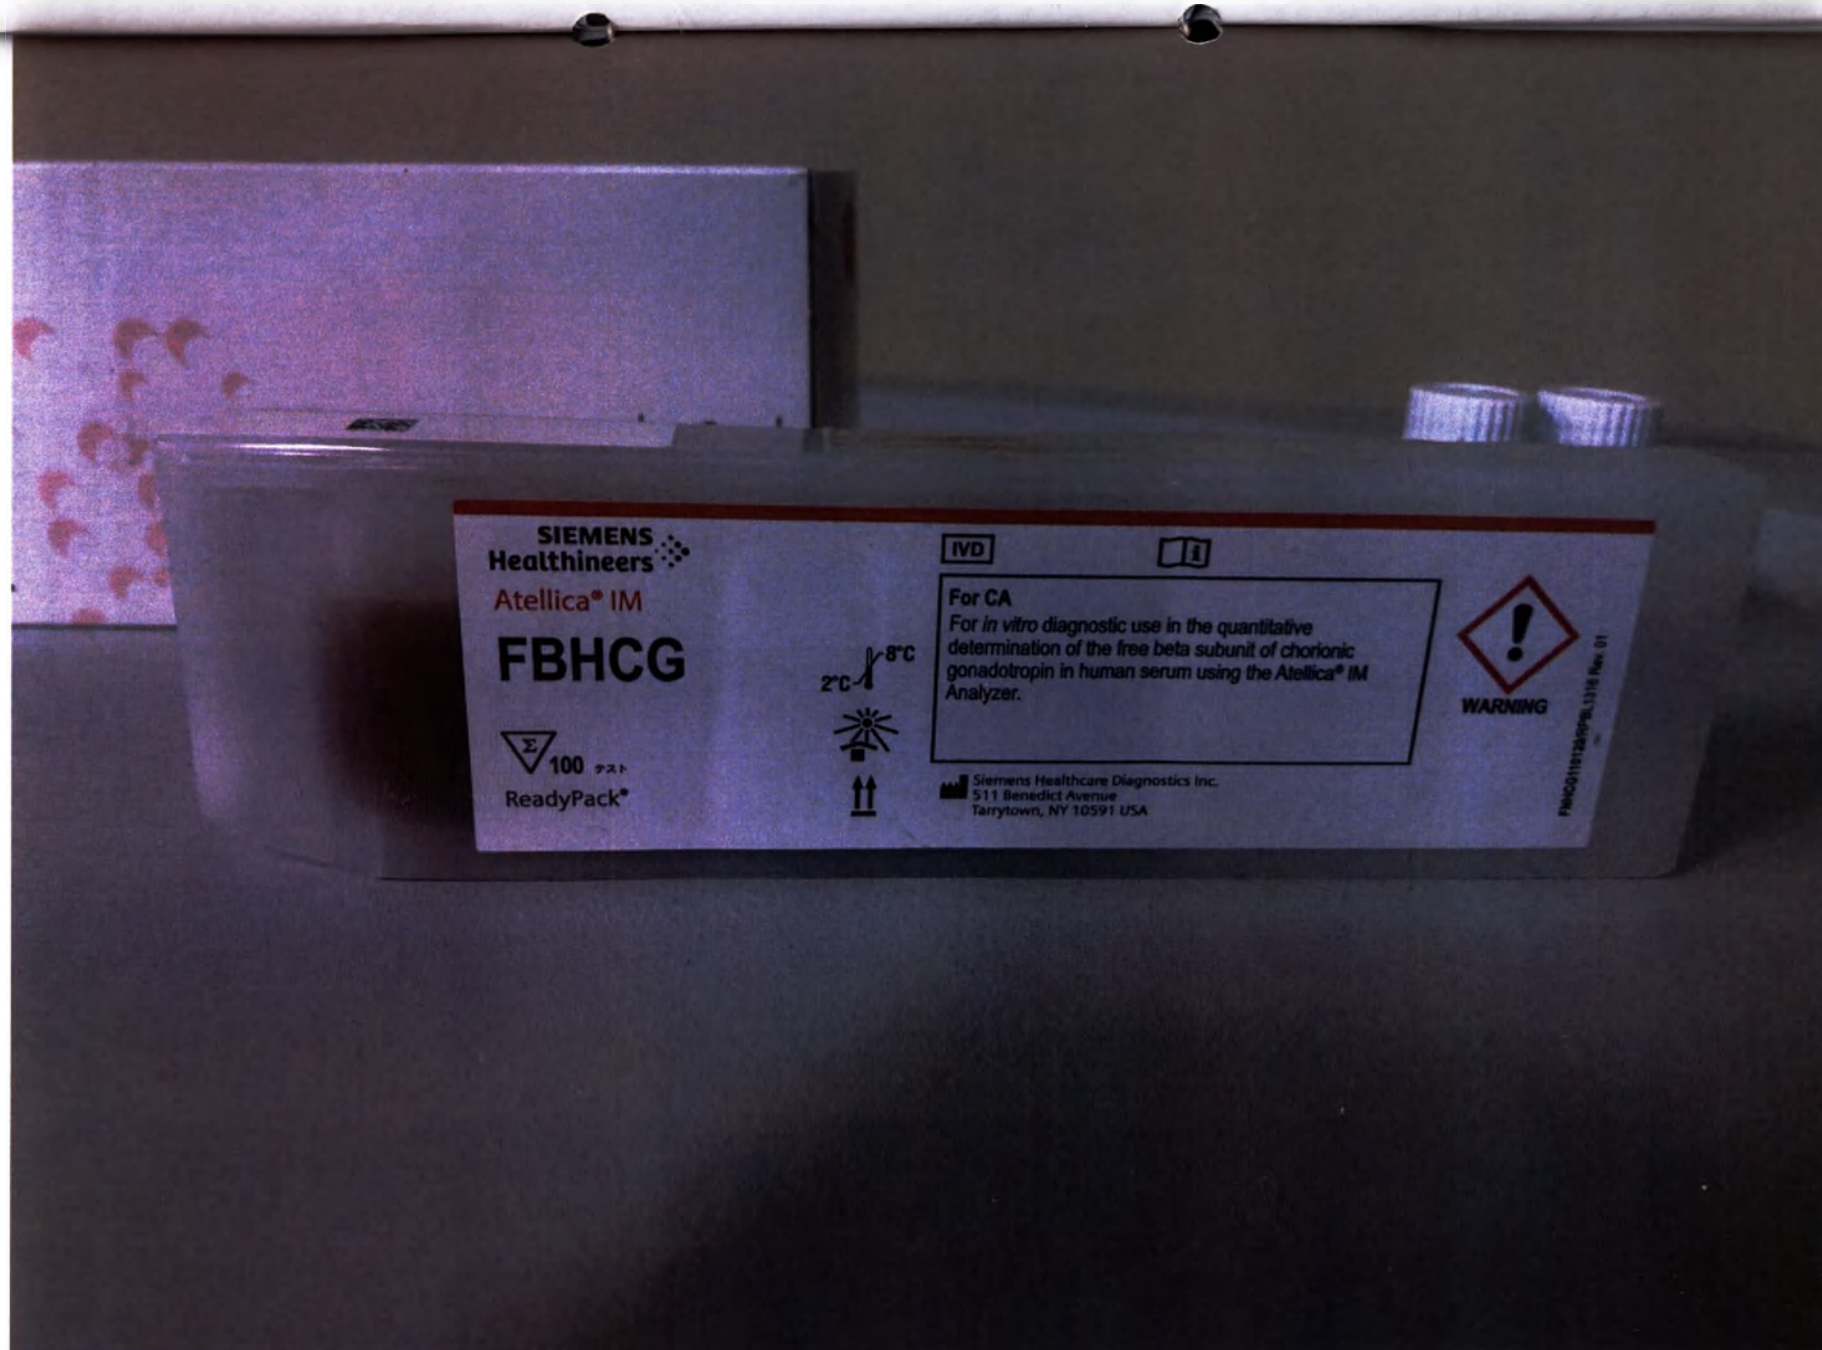


Рисунок 4. Набор реагентов для определения свободной бета-субъединицы хорионического гонадотропина человека на анализаторах иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Free Beta Human Chorionic Gonadotropin (Atellica IM FBHCG)): Основной реагент Atellica IM

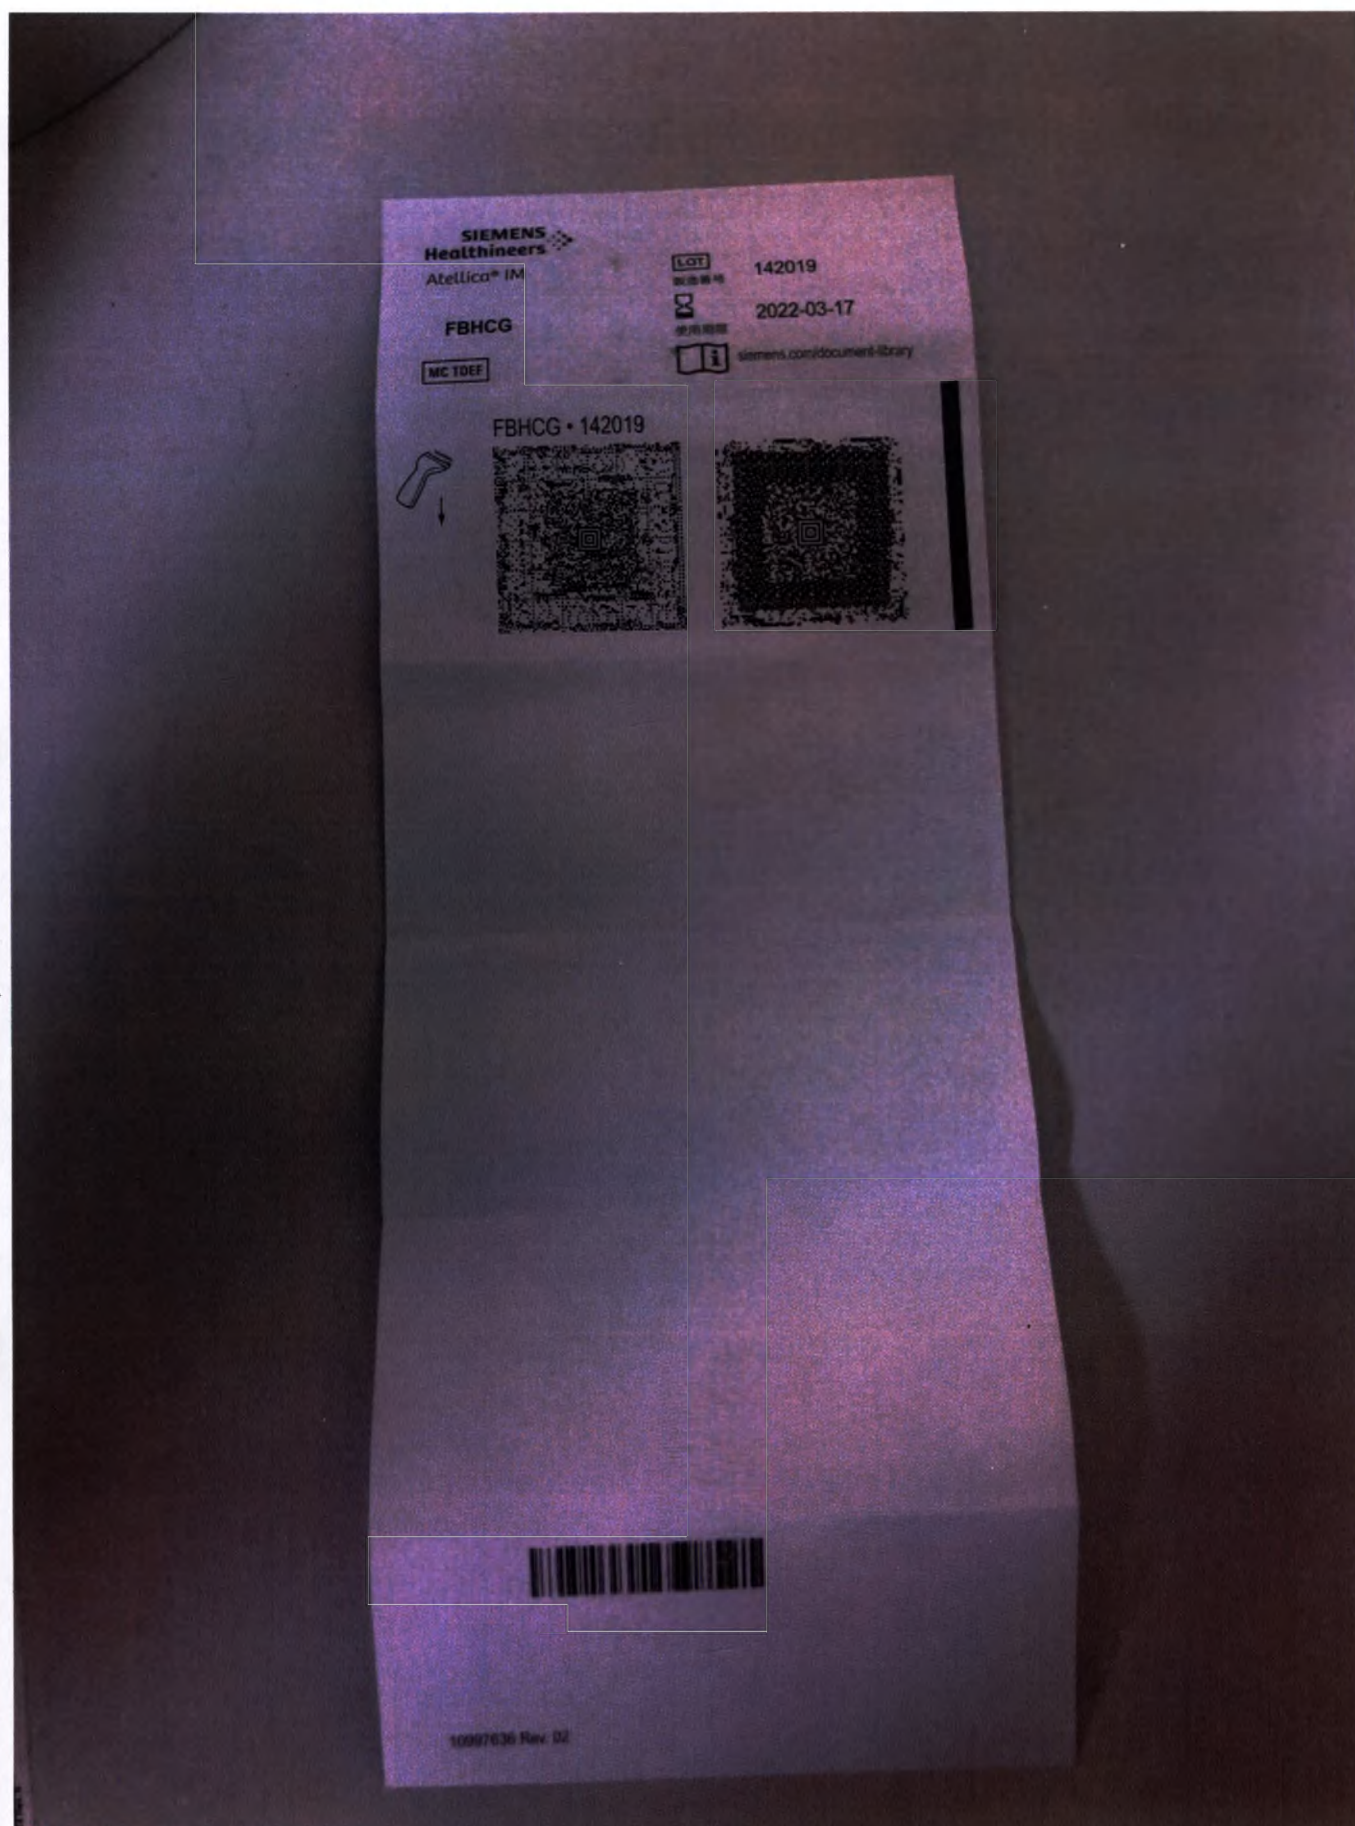


Рисунок 5. Набор реагентов для определения свободной бета-субъединицы хорионического гонадотропина человека на анализаторах иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Free Beta Human Chorionic Gonadotropin (Atellica IM FBHCG)): Вкладыш со штрих-кодом MC TDEF для Atellica IM FBHCG.



Рисунок 6. Набор реагентов для определения свободной бета-субъединицы хорионического гонадотропина человека на анализаторах иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Free Beta Human Chorionic Gonadotropin (Atellica IM FBHCG)): Калибратор с низкой концентрацией



Рисунок 7. Набор реагентов для определения свободной бета-субъединицы хорионического гонадотропина человека на анализаторах иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Free Beta Human Chorionic Gonadotropin (Atellica IM FBHCG)): Калибратор с низкой концентрацией

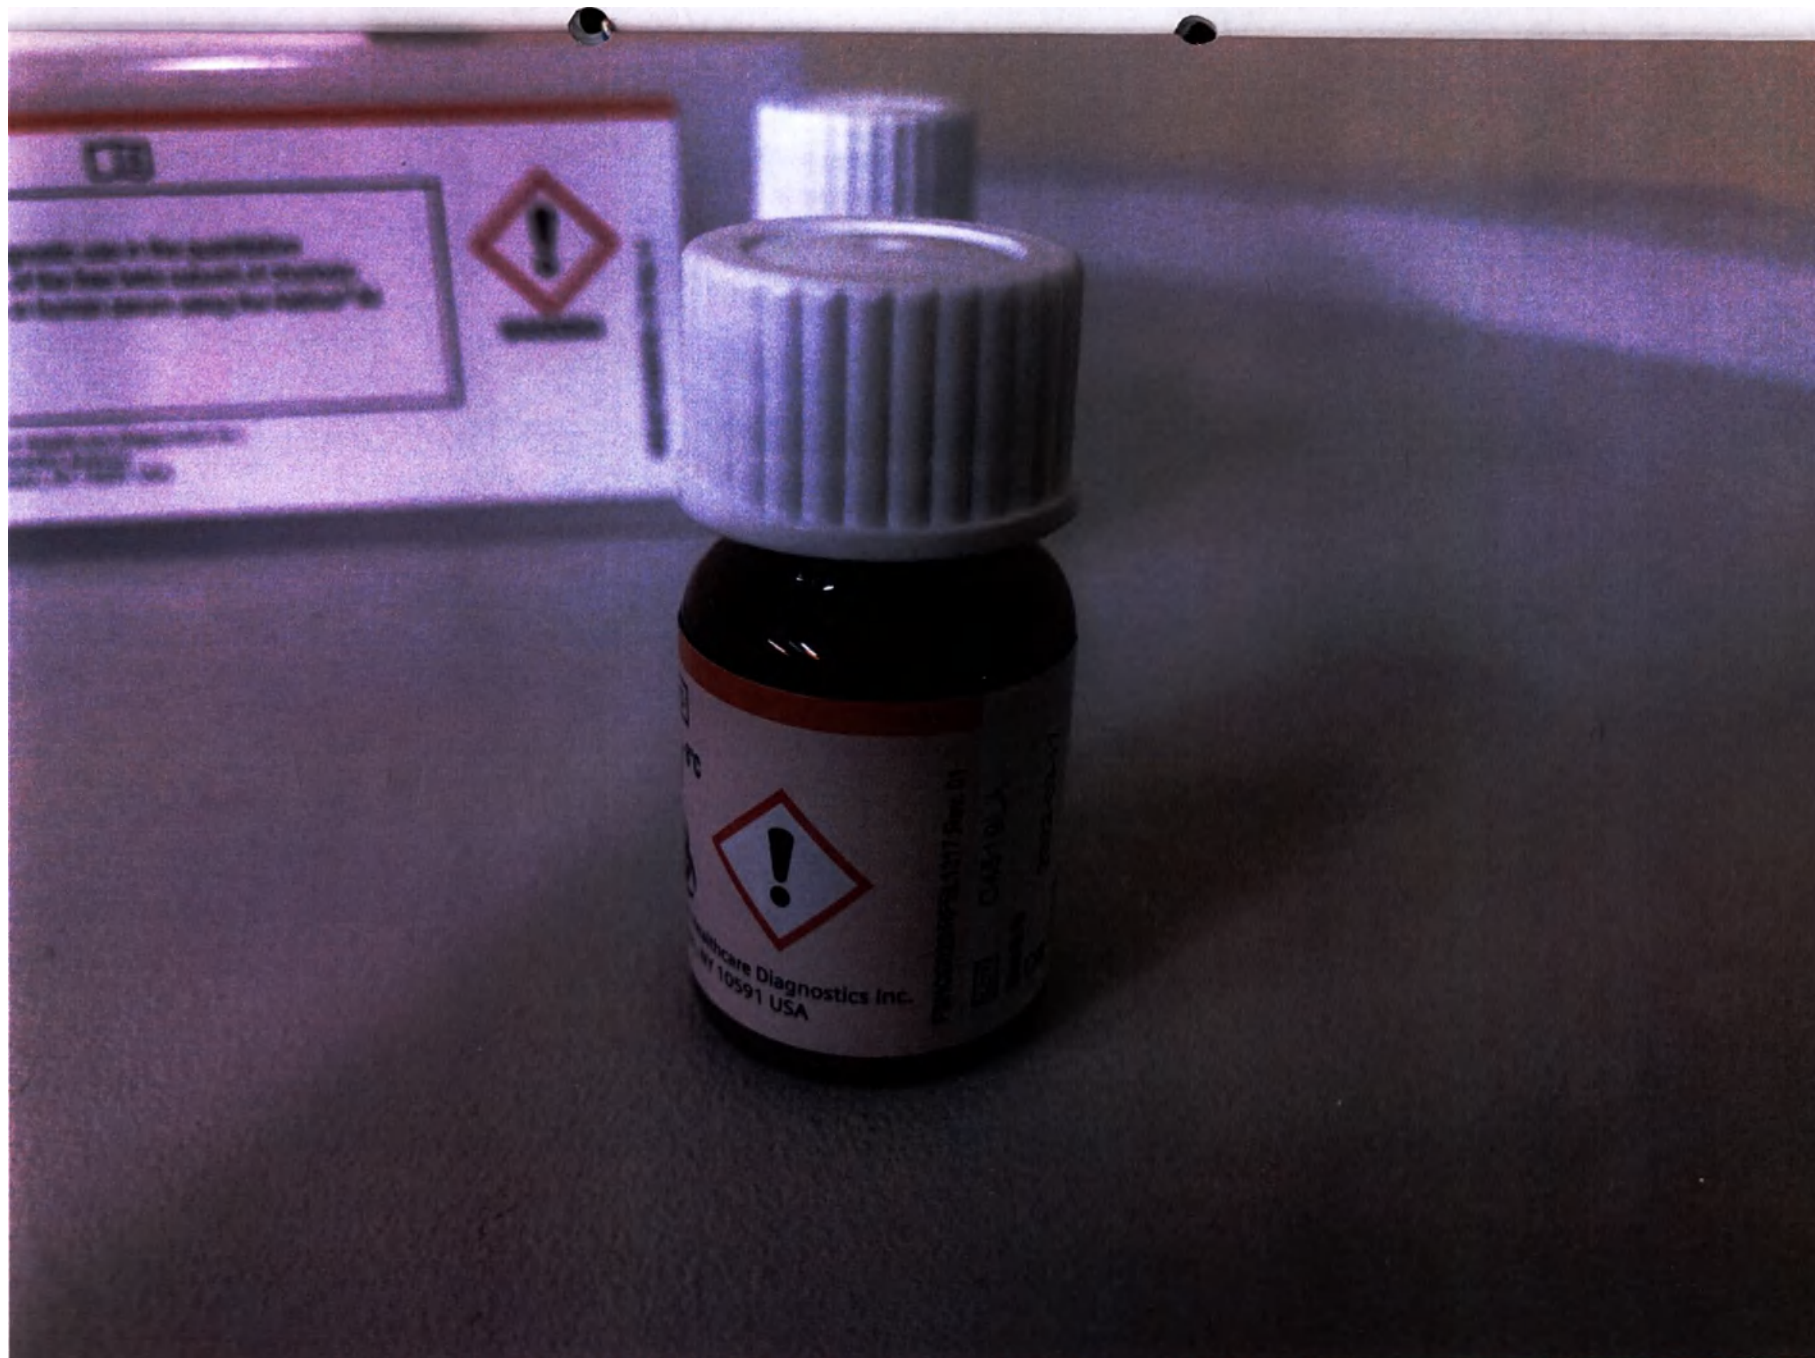


Рисунок 8. Набор реагентов для определения свободной бета-субъединицы хорионического гонадотропина человека на анализаторах иммунохимического ряда Atellica (Atellica IM Free Beta Human Chorionic Gonadotropin (Atellica IM FBHCG)): Калибратор с низкой концентрацией

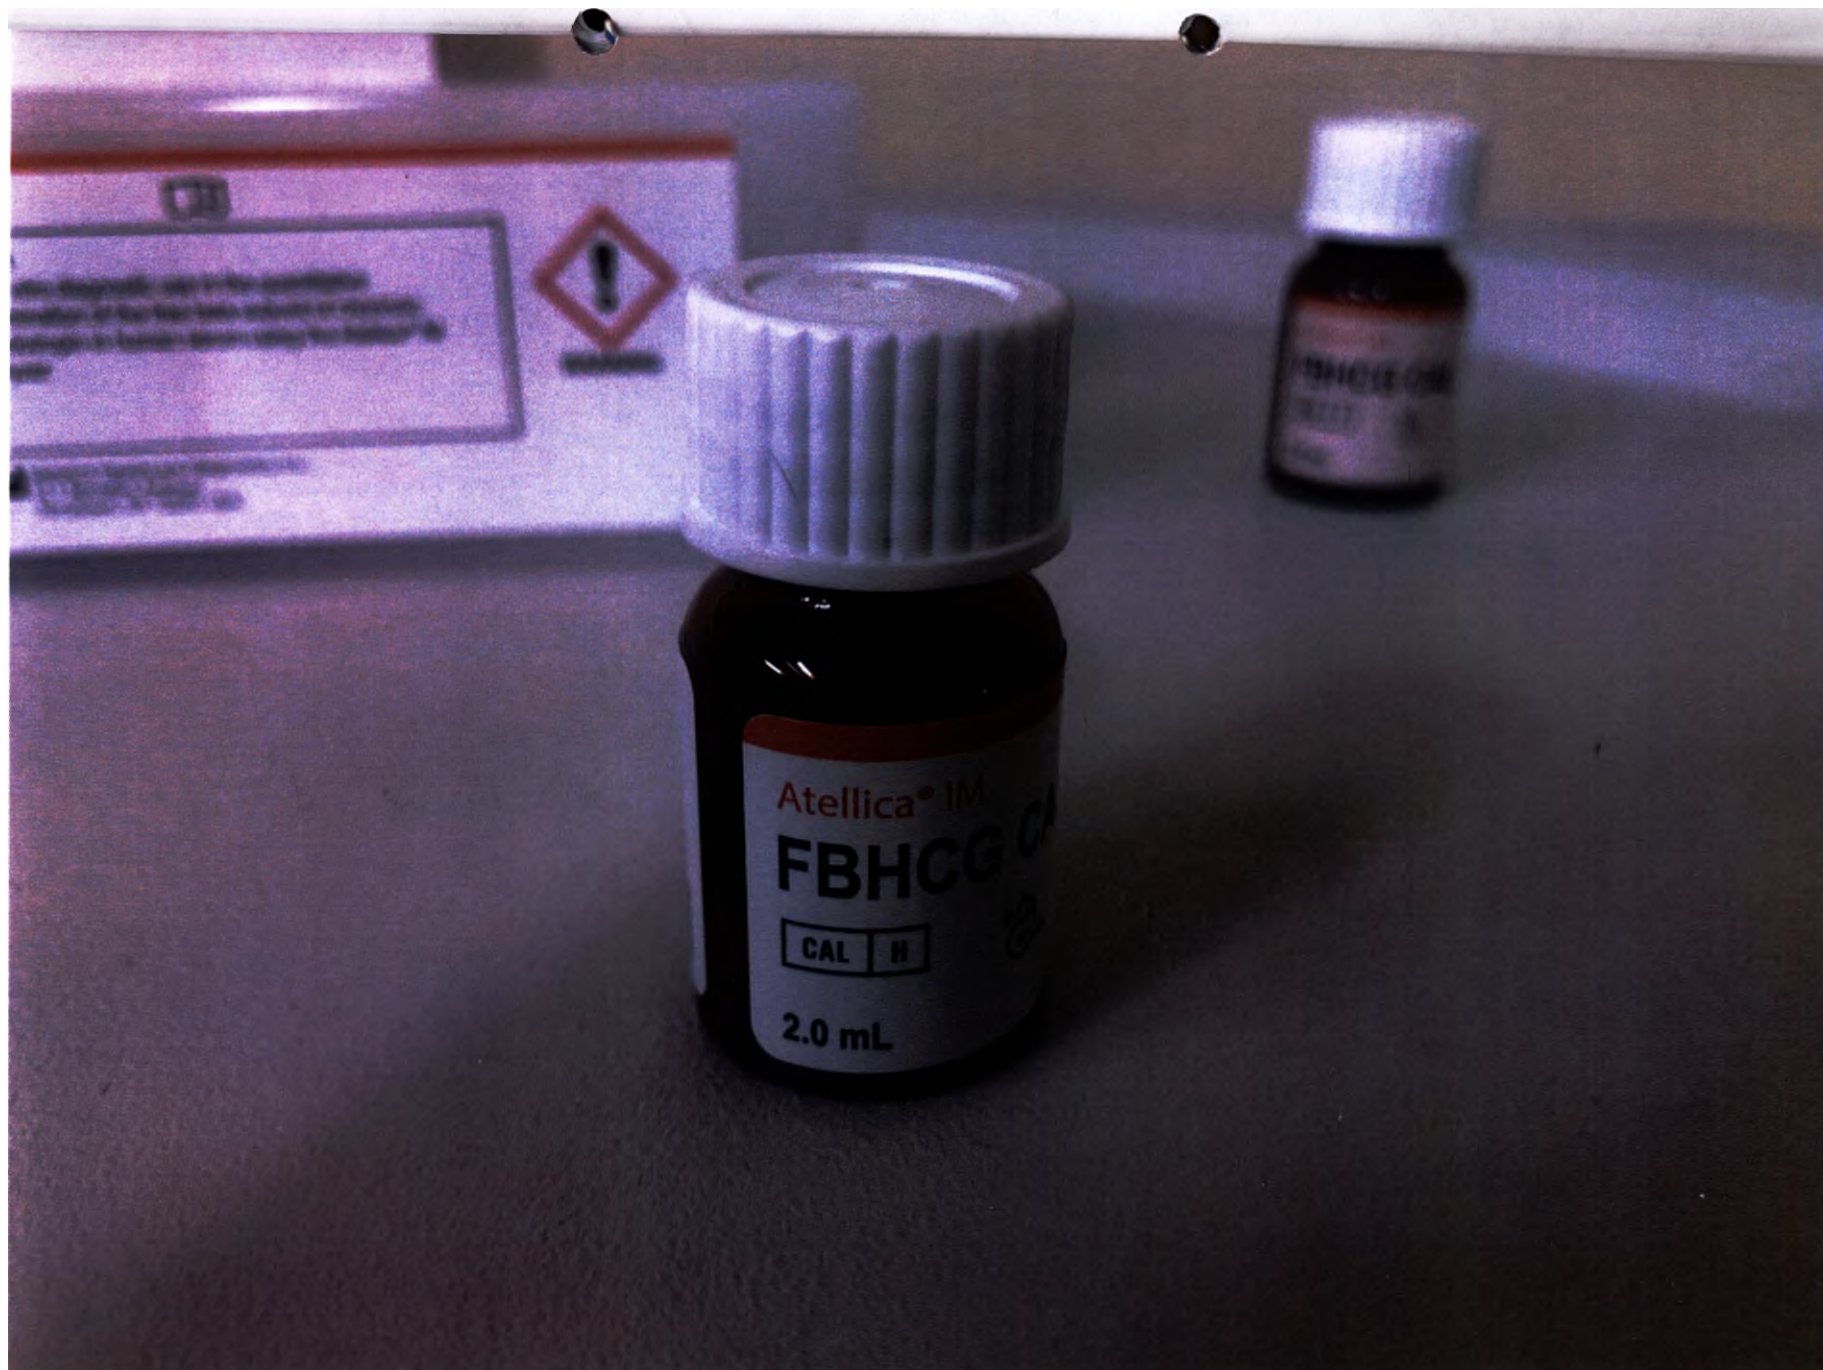


Рисунок 9. Набор реагентов для определения свободной бета-субъединицы хорионического гонадотропина человека на анализаторах иммунохимической серии Atellica (Atellica IM Free Beta Human Chorionic Gonadotropin (Atellica IM FBHCG)): Калибратор с высокой концентрацией свободного бета-субъединицы хорионического гонадотропина человека (Atellica IM FBHCG CAL H, 2,0 мл).

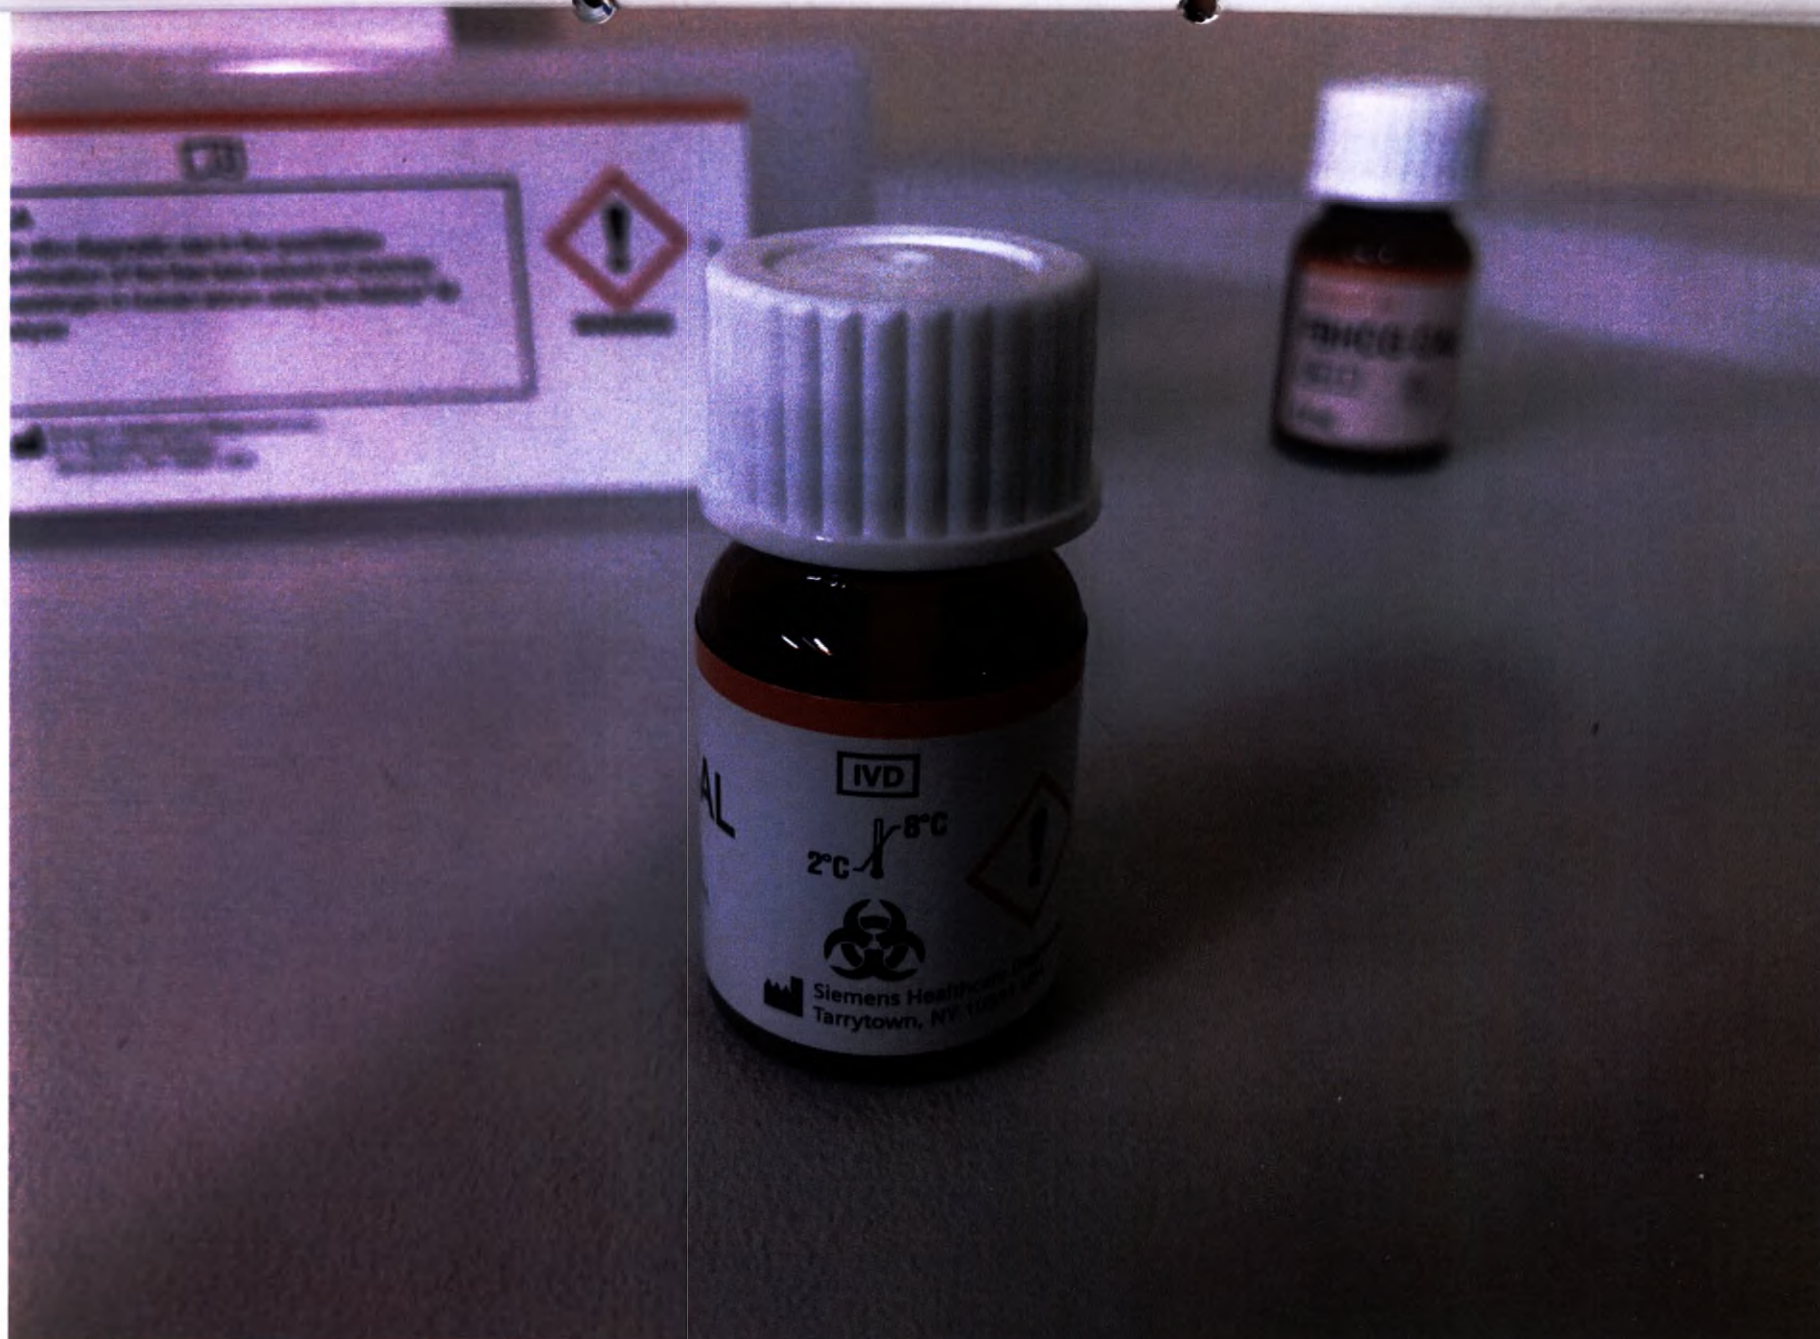


Рисунок 10. Набор реагентов для определения свободной бета-субъединицы хорионического гонадотропина человека на анализаторах иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Free Beta Human Chorionic Gonadotropin (Atellica IM FBHCG)): Калибратор с высокой

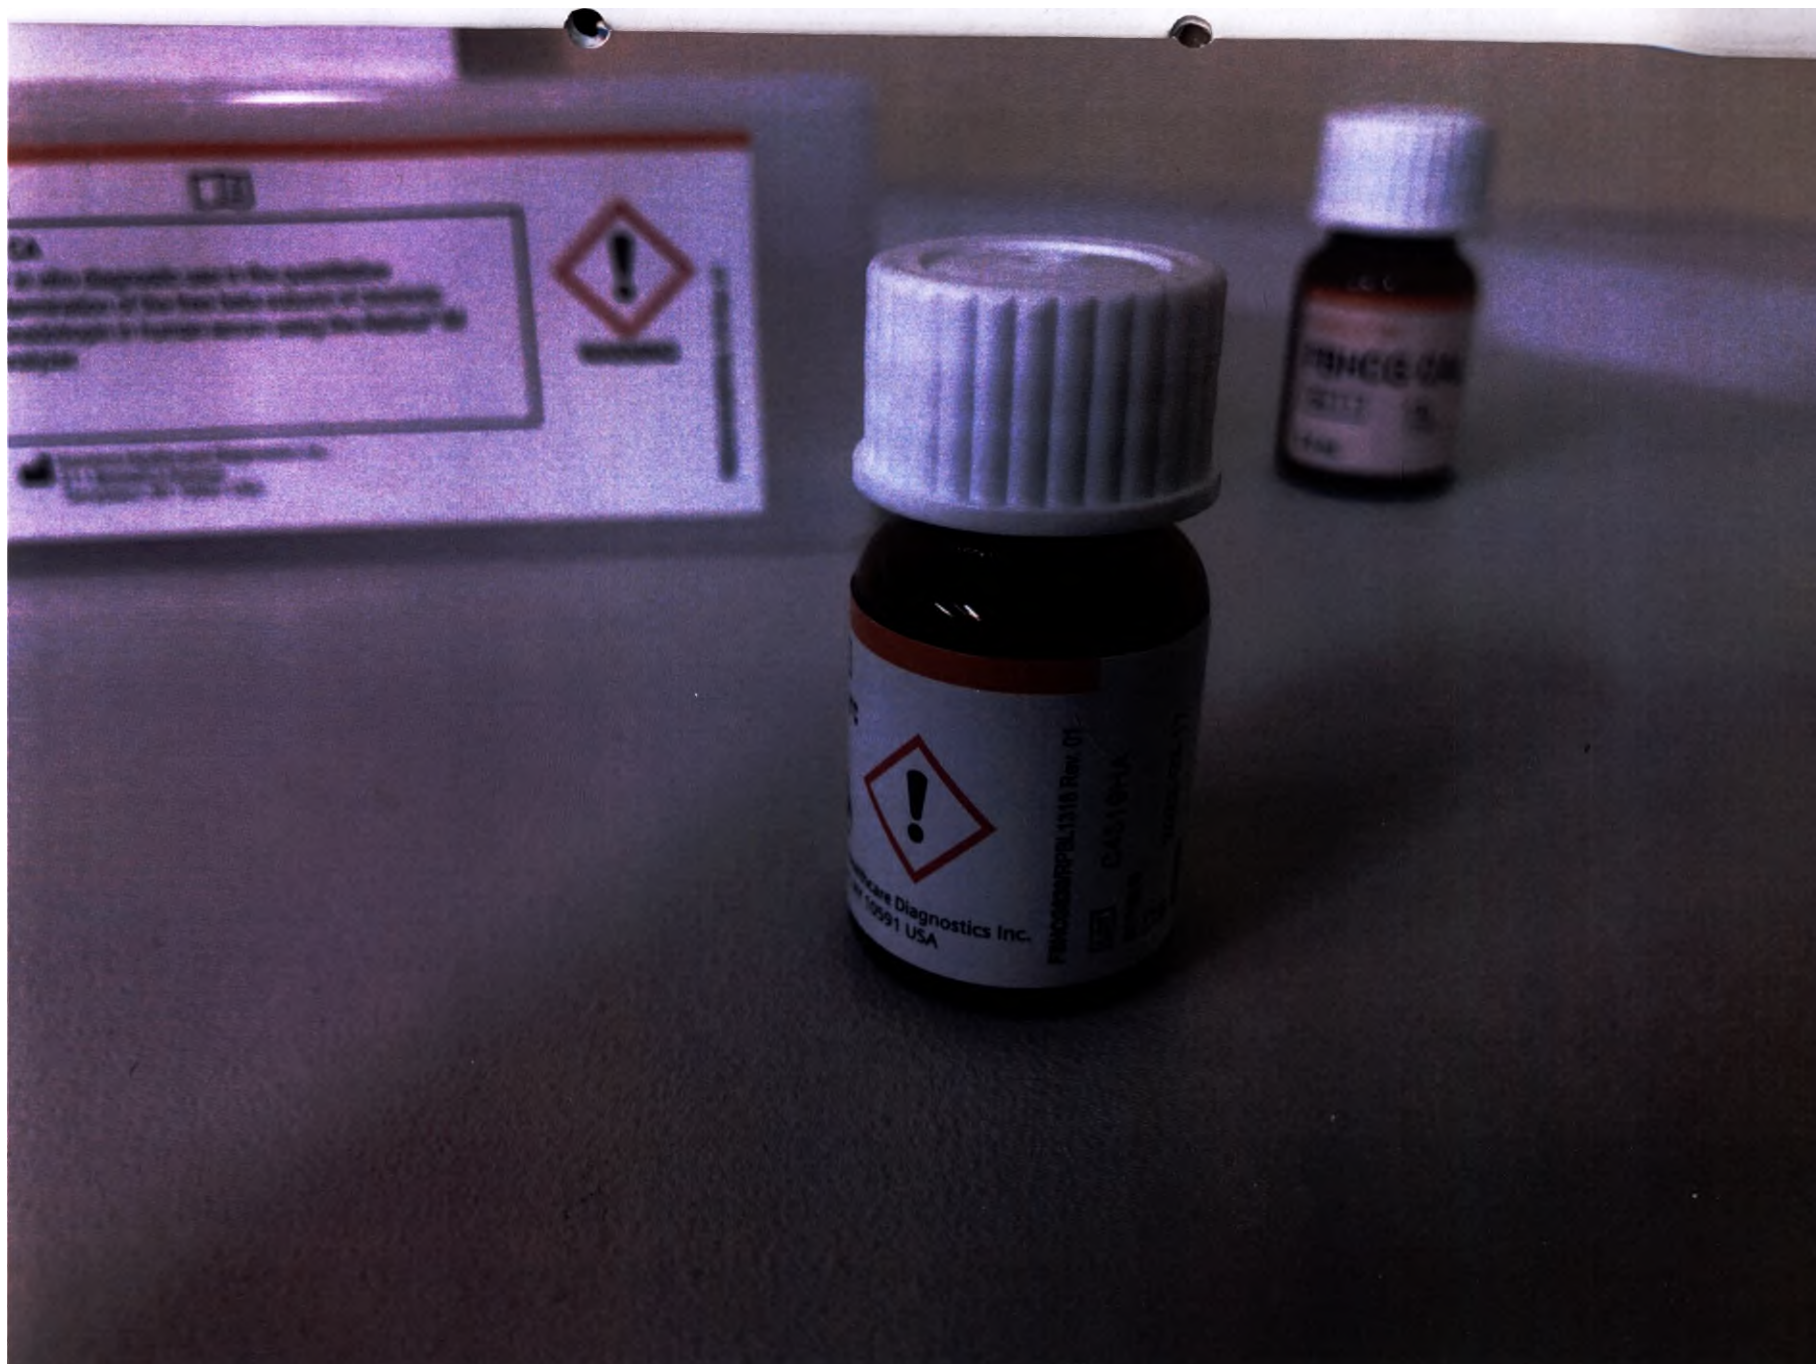


Рисунок 11. Набор реагентов для определения свободной бета-субъединицы хорионического гонадотропина человека на анализаторах иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Free Beta Human Chorionic Gonadotropin (Atellica IM FBHCG)): Калибратор с высокой

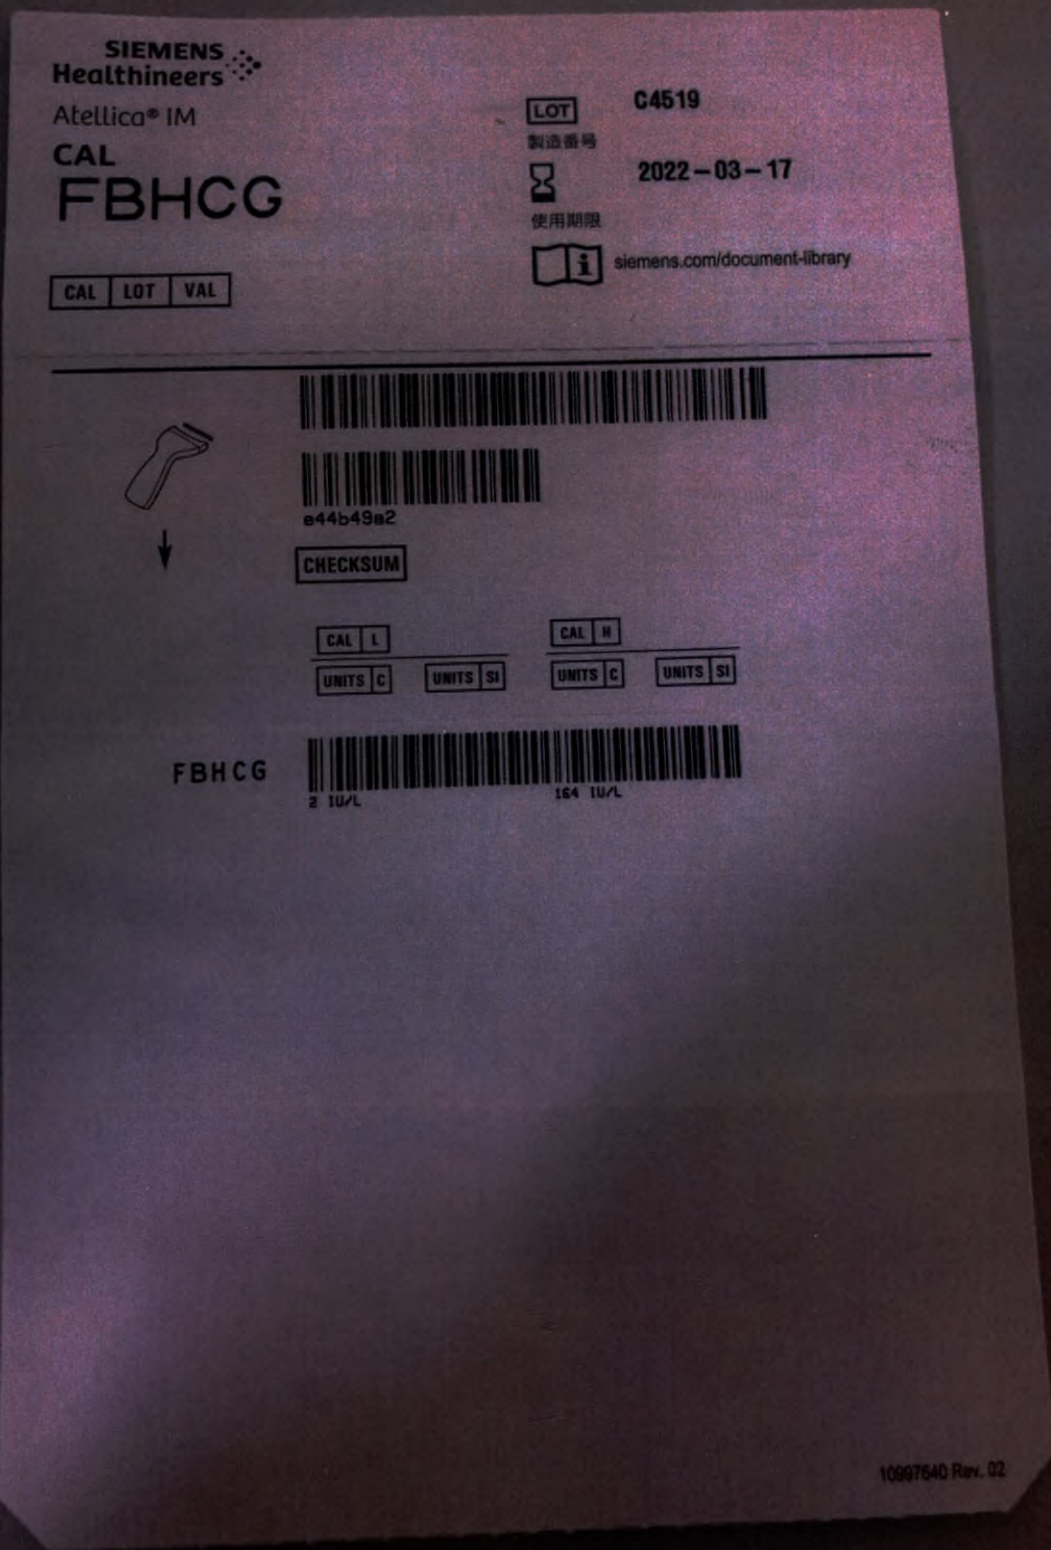


Рисунок 12. Набор реагентов для определения свободной бета-субъединицы хорионического гонадотропина человека на анализаторах иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Free Beta Human Chorionic Gonadotropin (Atellica IM FBHCG)): Лист значений параметров лота калибратора Atellica IM FBHCG CAL.

Всего прошито и пронумеровано
3 листа (ов).

ООО «Сиенс Здравеохранение»

