

Руководитель группы регистрации
ООО «Сименс Здравоохранение»



Н.А. Горшкова
_____ 2021 г.

**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ
ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ IN VITRO**

«Мульти-Дилуент 13 для анализаторов иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Multi-Diluent 13)»

производства «Сименс Хелскеа Диагностикас Инк.», Siemens Healthcare Diagnostics Inc., США

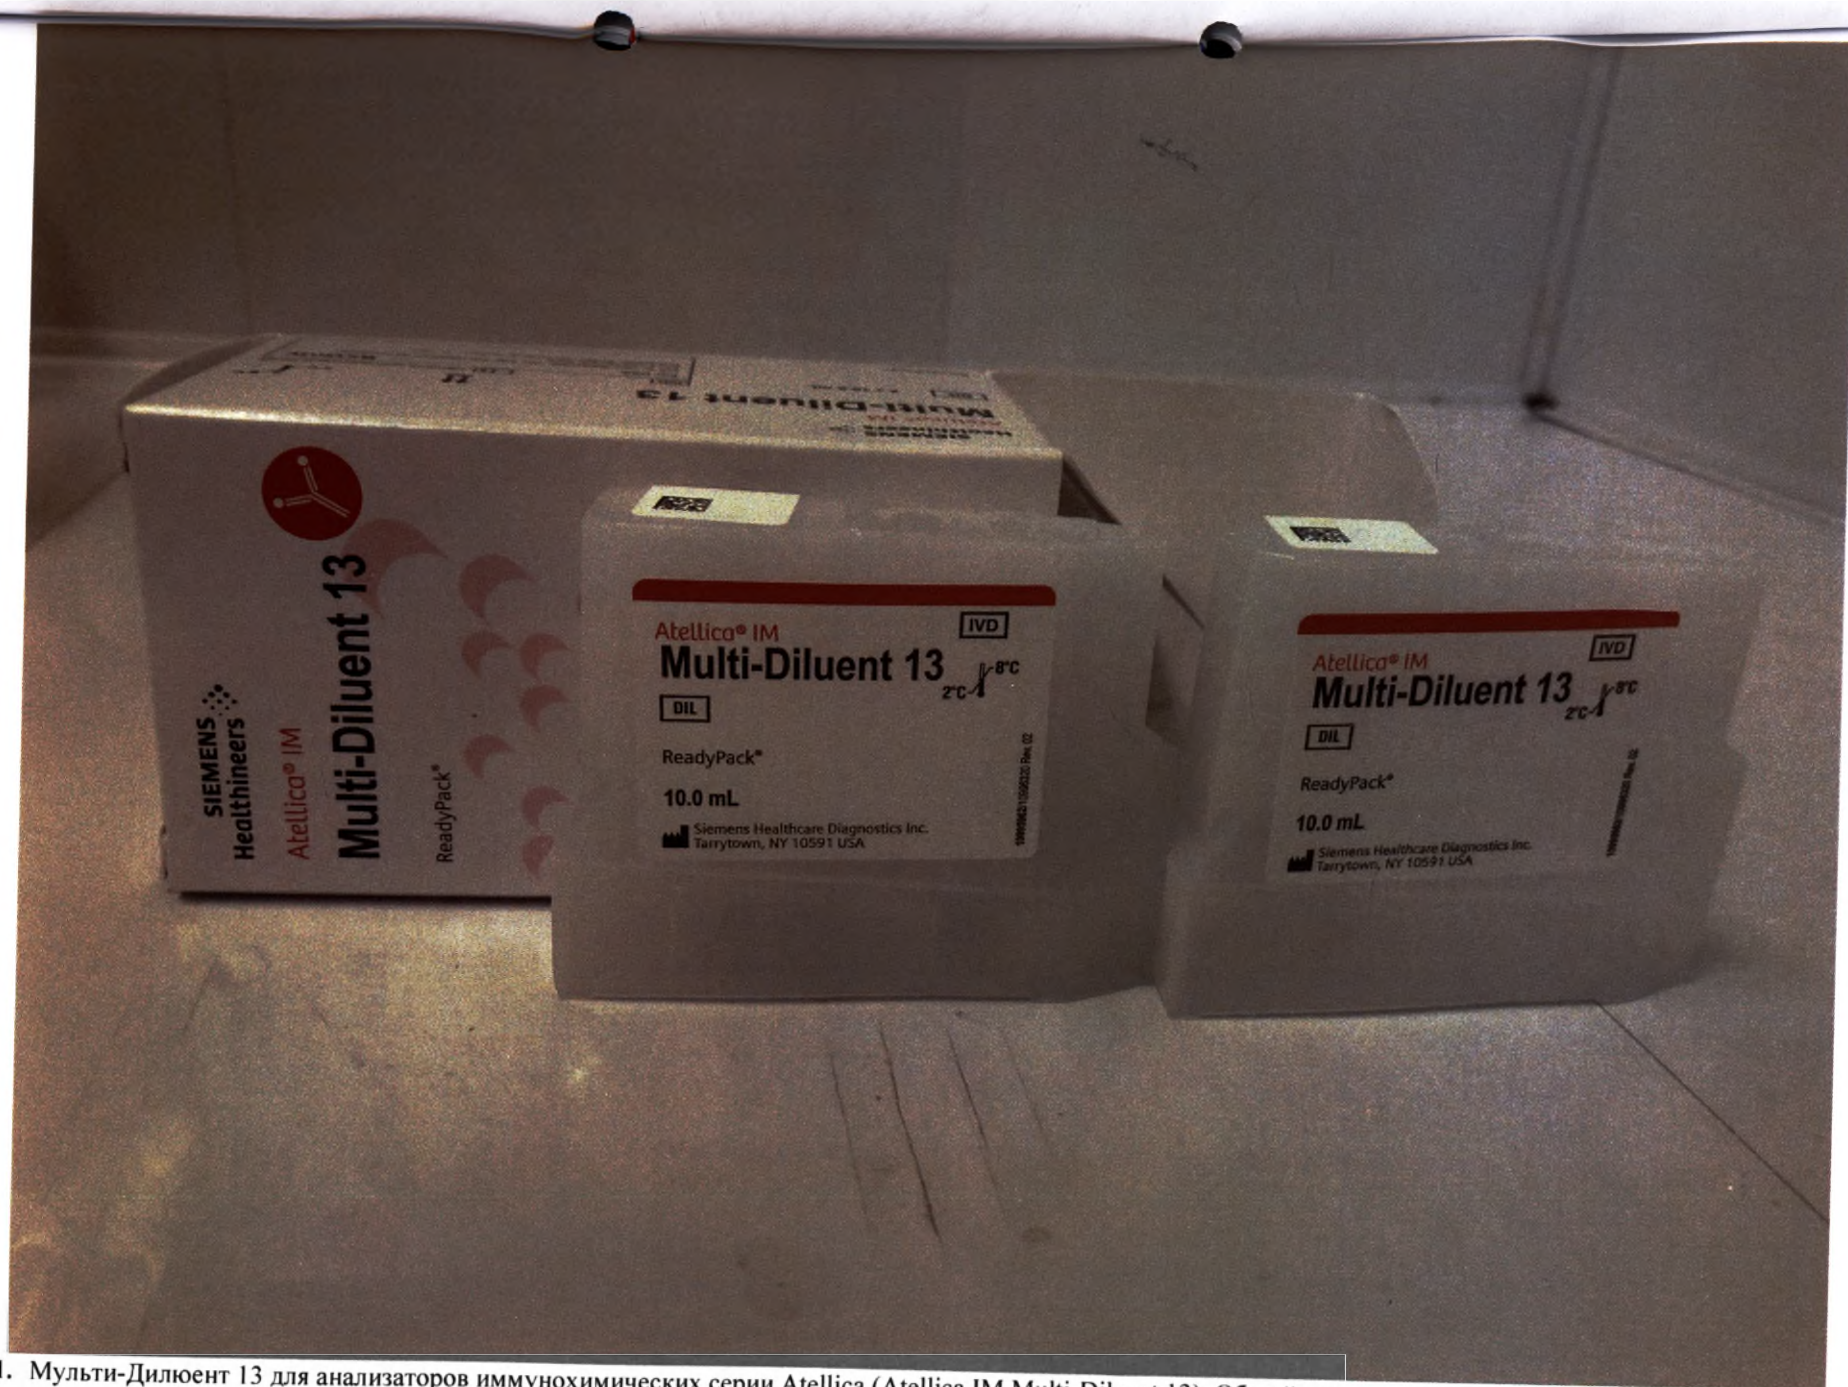


Рисунок 1. Мульти-Дилуент 13 для анализаторов иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Multi-Diluent 13). Общий вид

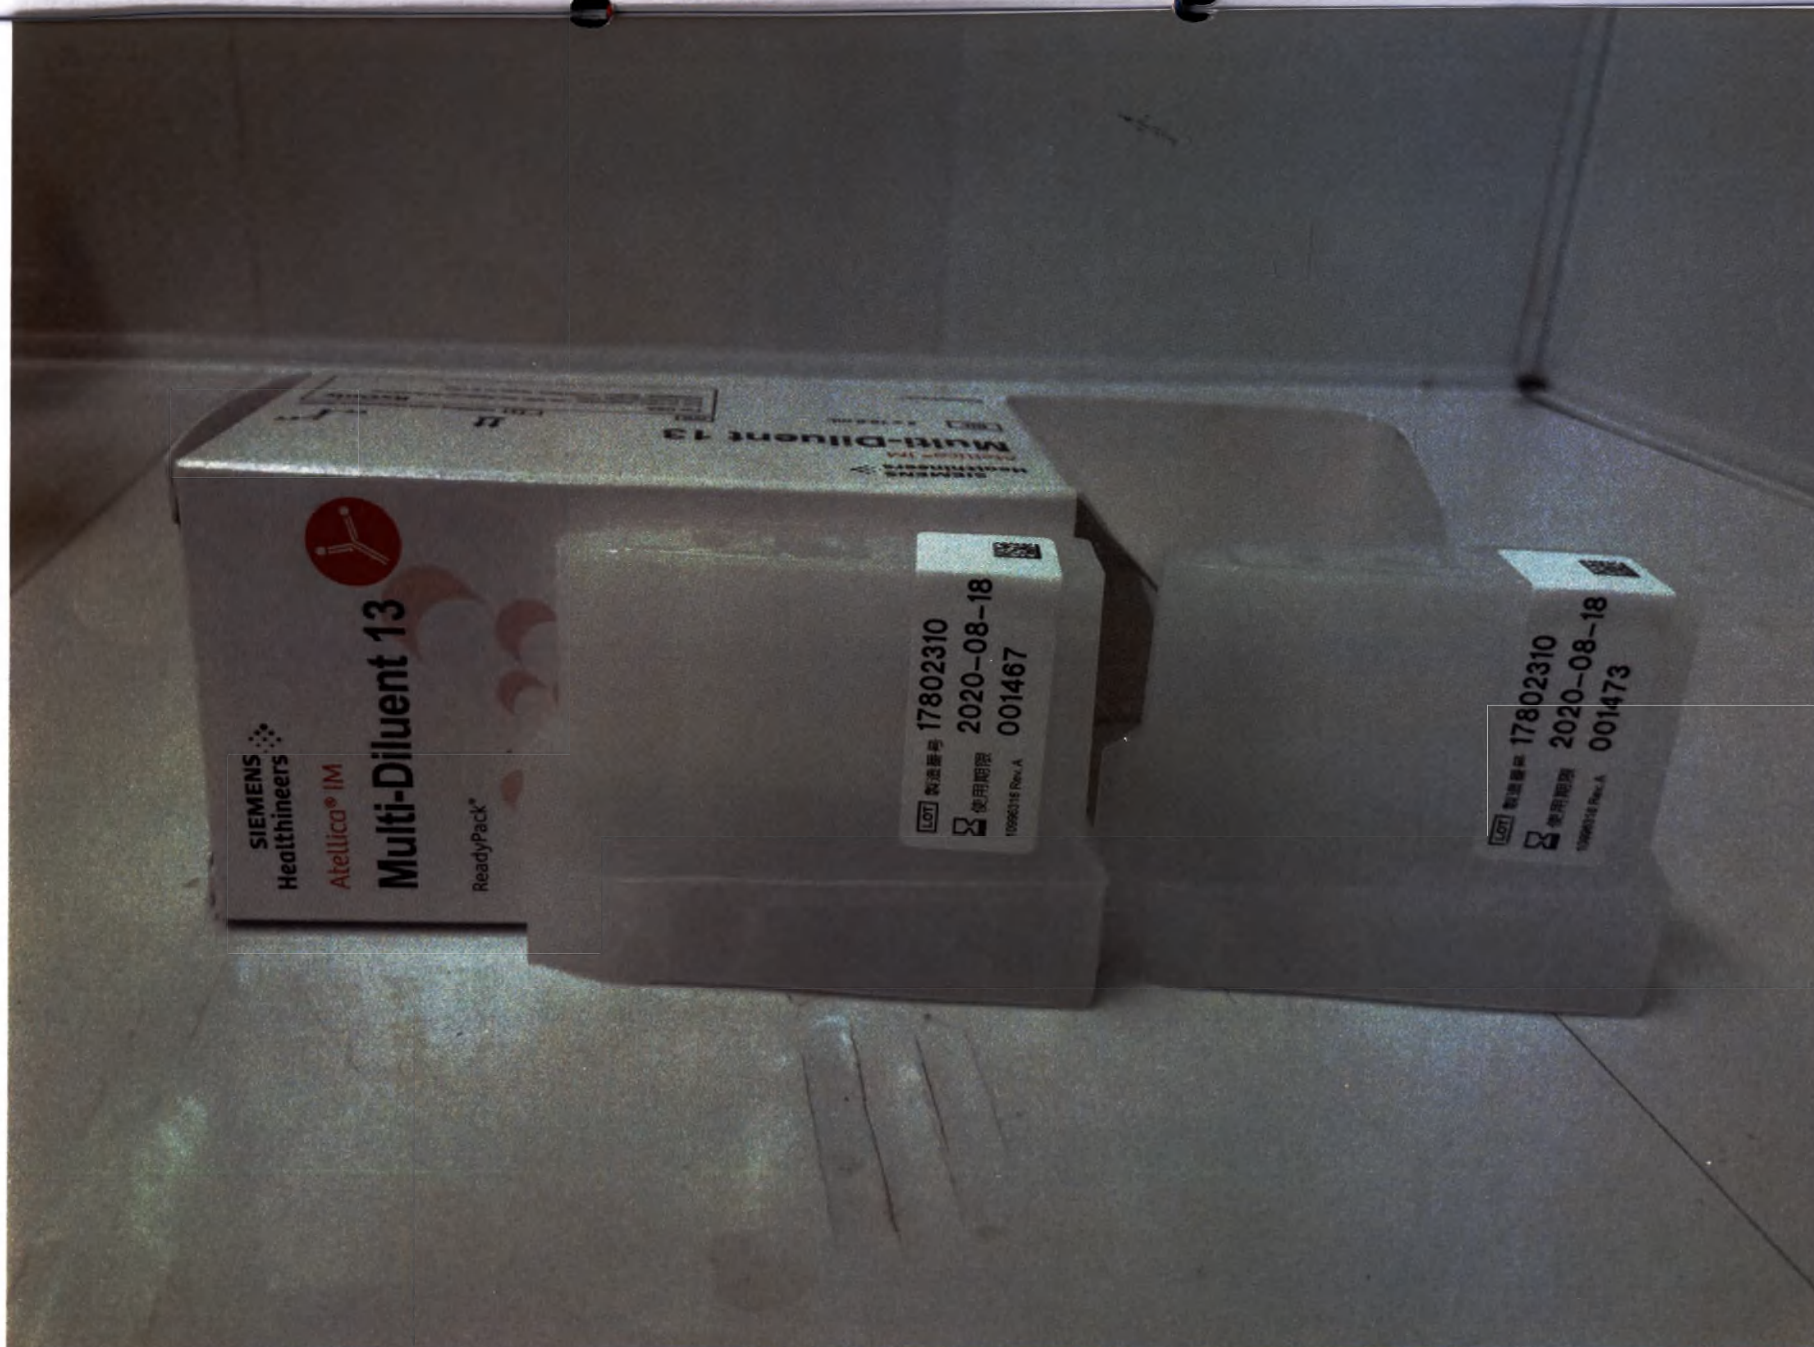


Рисунок 2. Мульти-Дилуэнт 13 для анализаторов иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Multi-Diluent 13). Общий вид

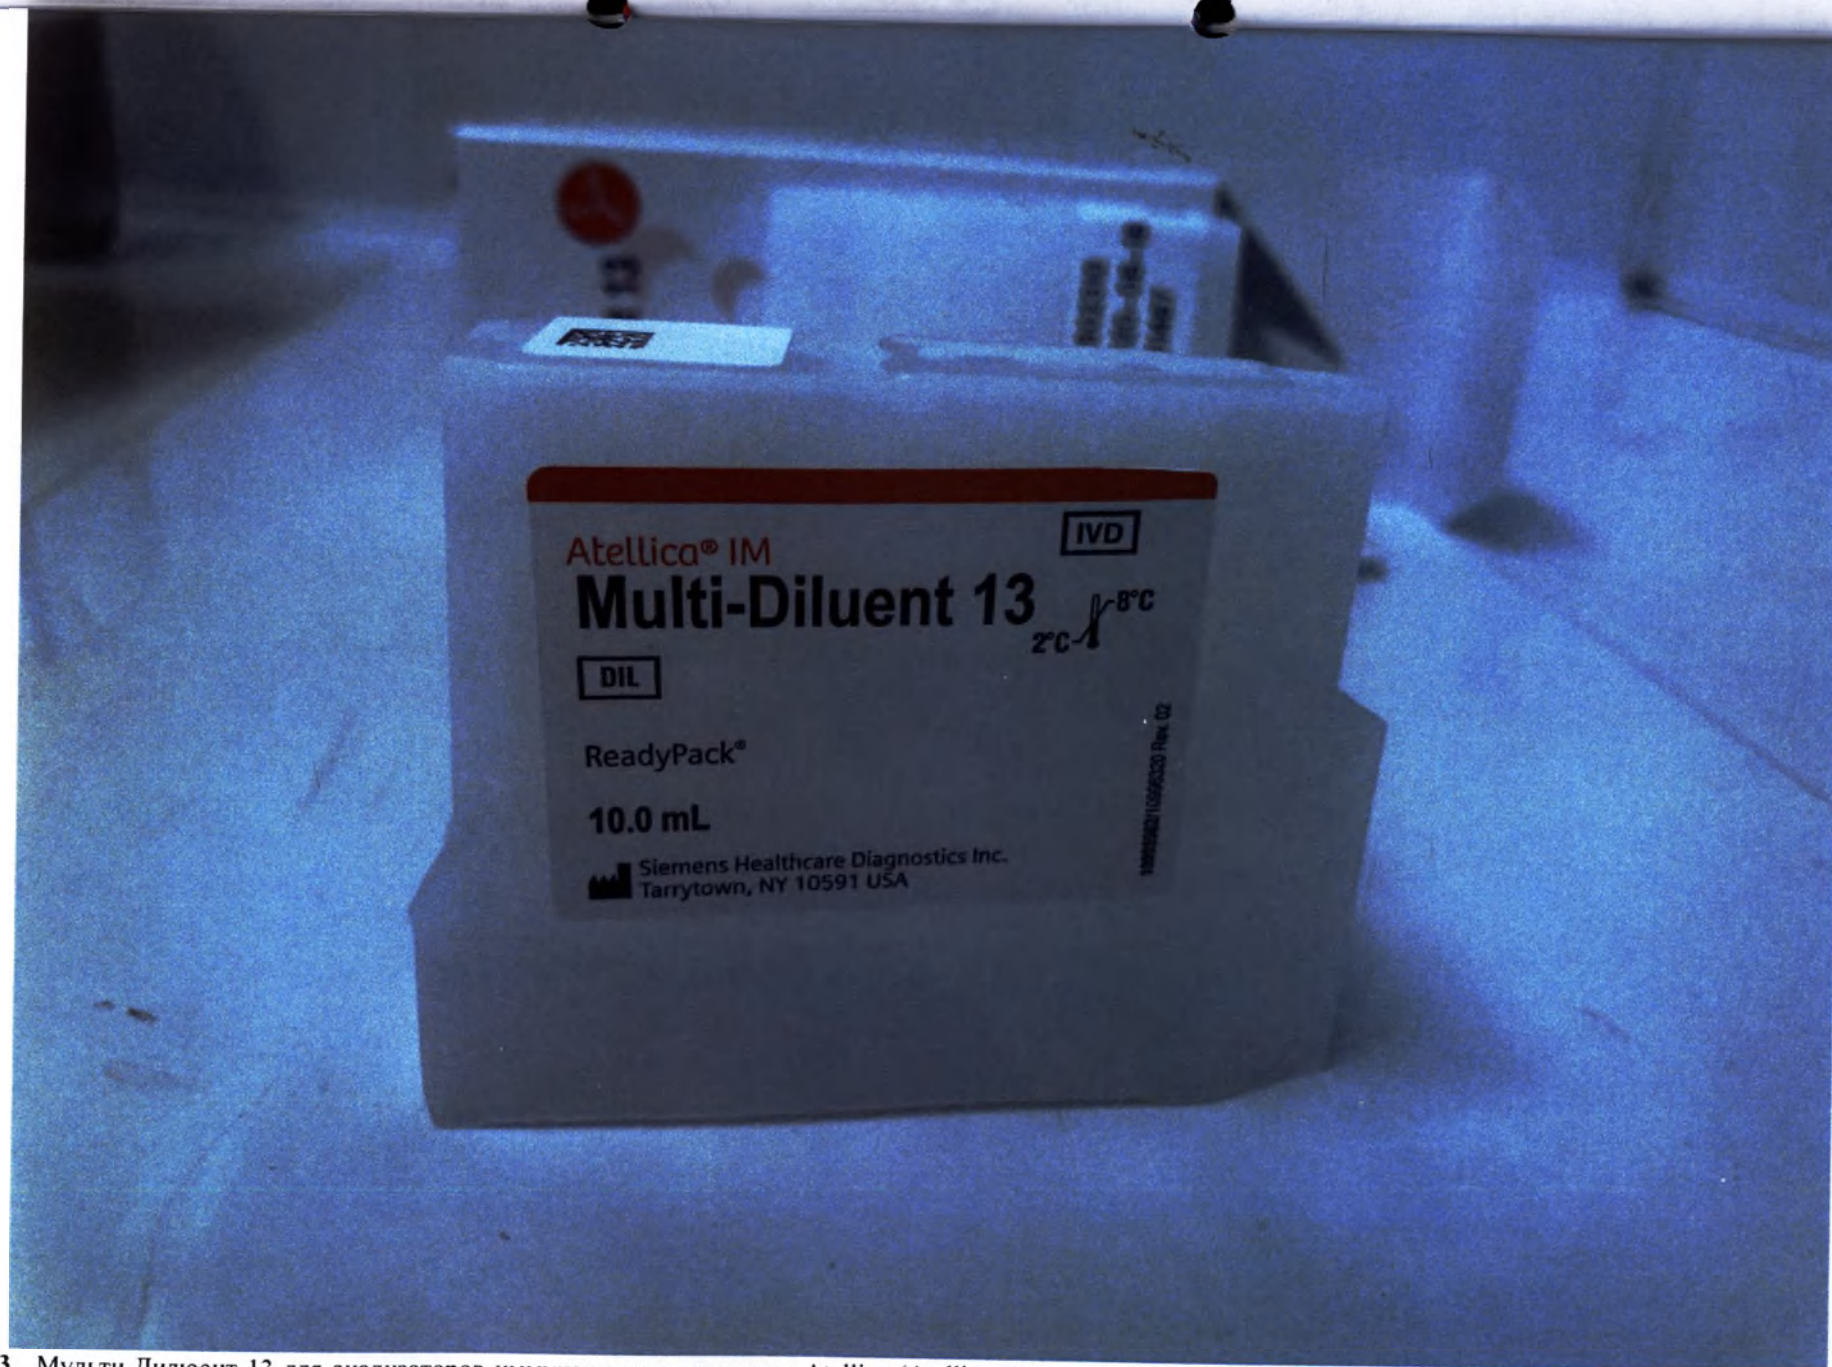


Рисунок 3. Мульти-Дилуэнт 13 для анализаторов иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Multi-Diluent 13): 1. Мульти-Дилуэнт 13 (Atellica IM Multi-Diluent 13) – 10,0 мл/упаковка

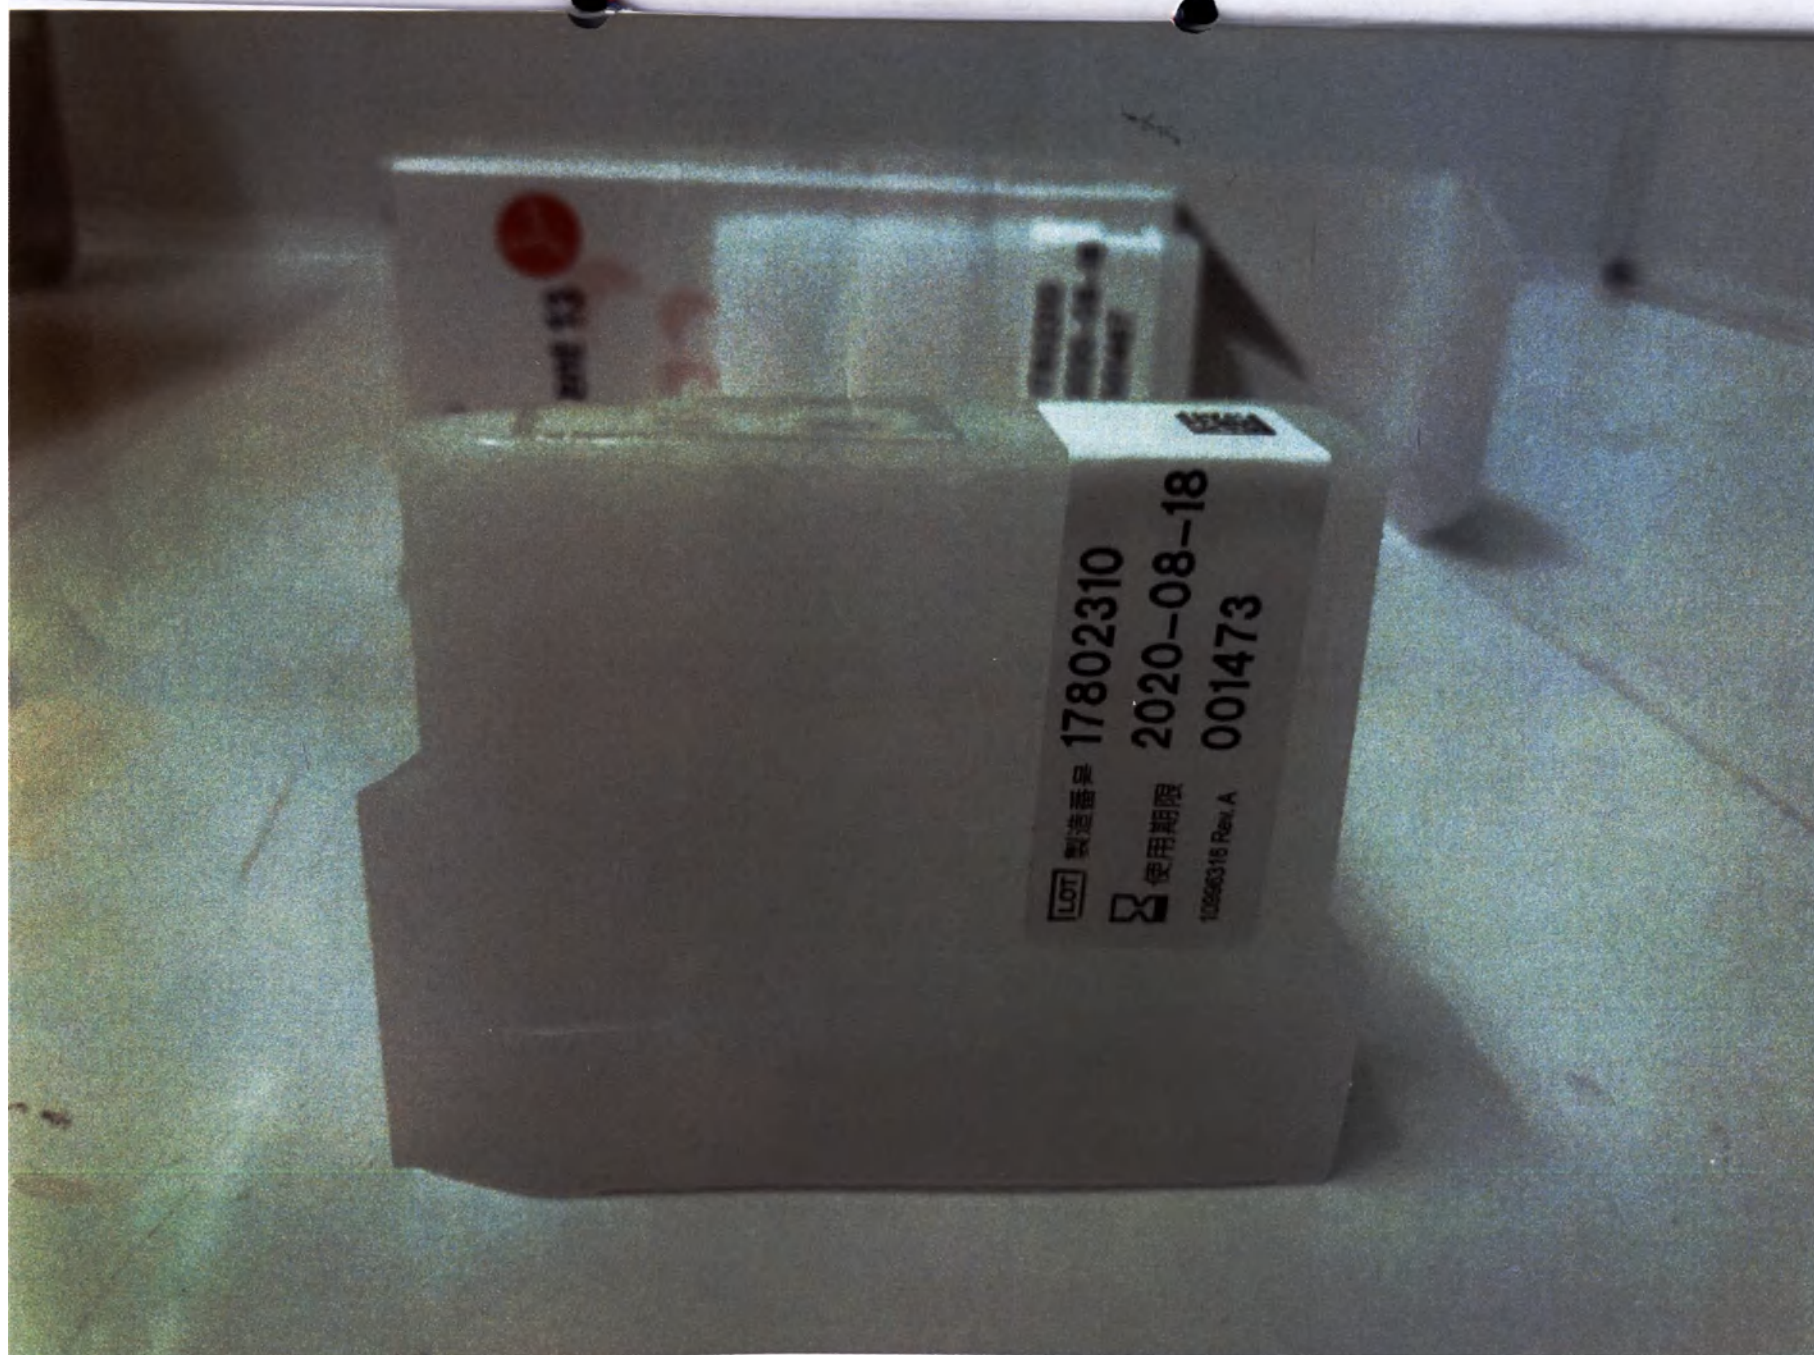


Рисунок 4. Мульти-Дилуэнт 13 для анализаторов иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Multi-Diluent 13): 1. Мульти-Дилуэнт 13 (Atellica IM Multi-Diluent 13) – 10,0



Всего прошито и пронумеровано
8 листа (ов).

ООО «Сименс Здравоохранение»

