

Руководитель группы регистрации
ООО «Сименс Здравоохранение»



Н.А. Горшкова
2021 г.

**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ
ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ IN VITRO**

**«Набор реагентов для определения ассоциированного с беременностью плазменного
протеина-А на анализаторах иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Pregnancy-
Associated Plasma Protein-A (Atellica IM PAPP-A))»**

производства «Сименс Хелскеа Диагностикс Инк.», Siemens Healthcare Diagnostics Inc., США

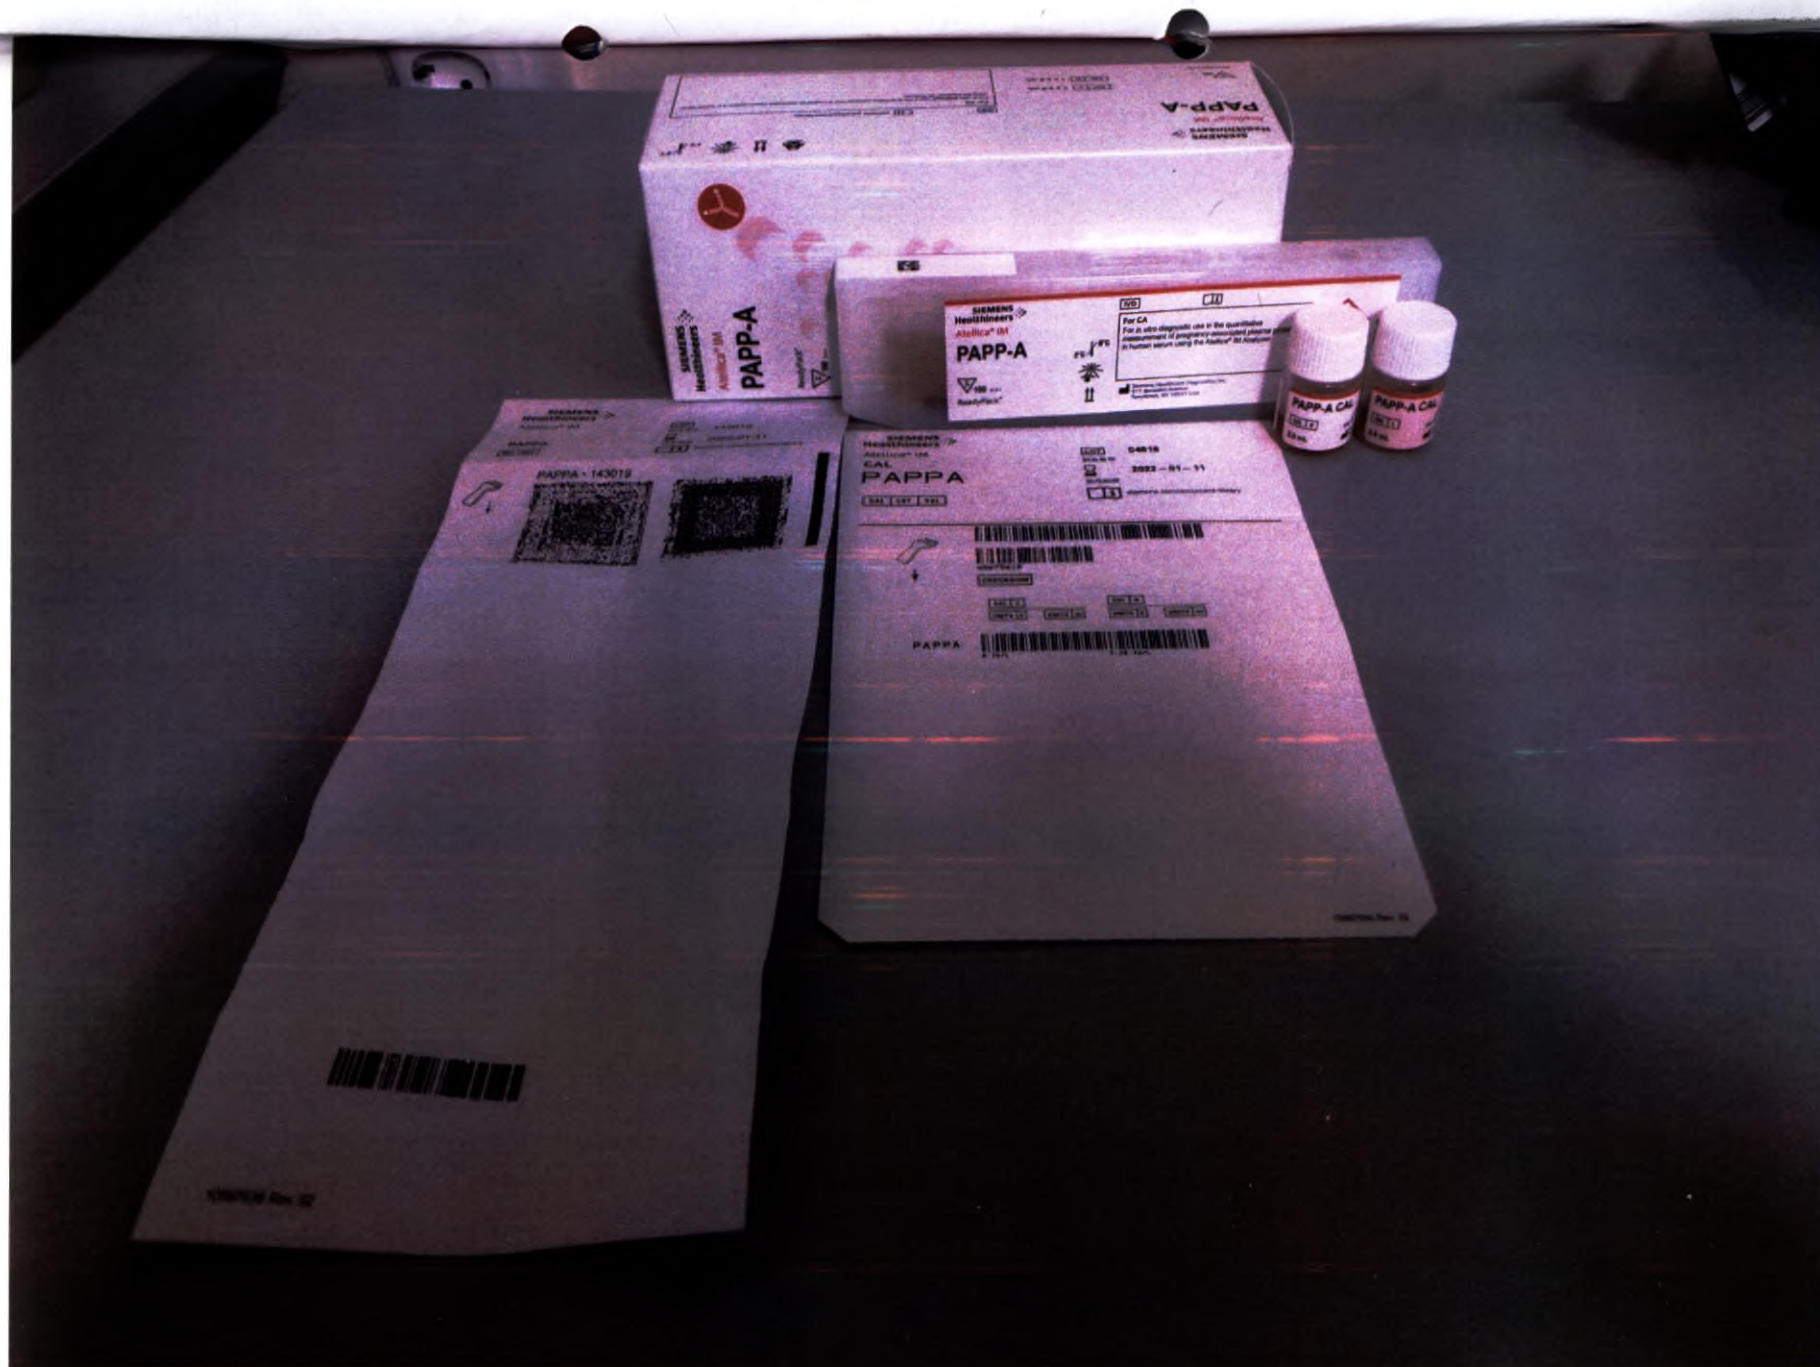


Рисунок 1. Набор реагентов для определения ассоциированного с беременностью плазменного протеина-А на анализаторах иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Pregnancy-Associated Plasma Protein-A (Atellica IM PAPP-A)): Фасовка 100 тестов. Общий вид.



Рисунок 2. Набор реагентов для определения ассоциированного с беременностью плазменного протеина-А на анализаторах иммунохимических

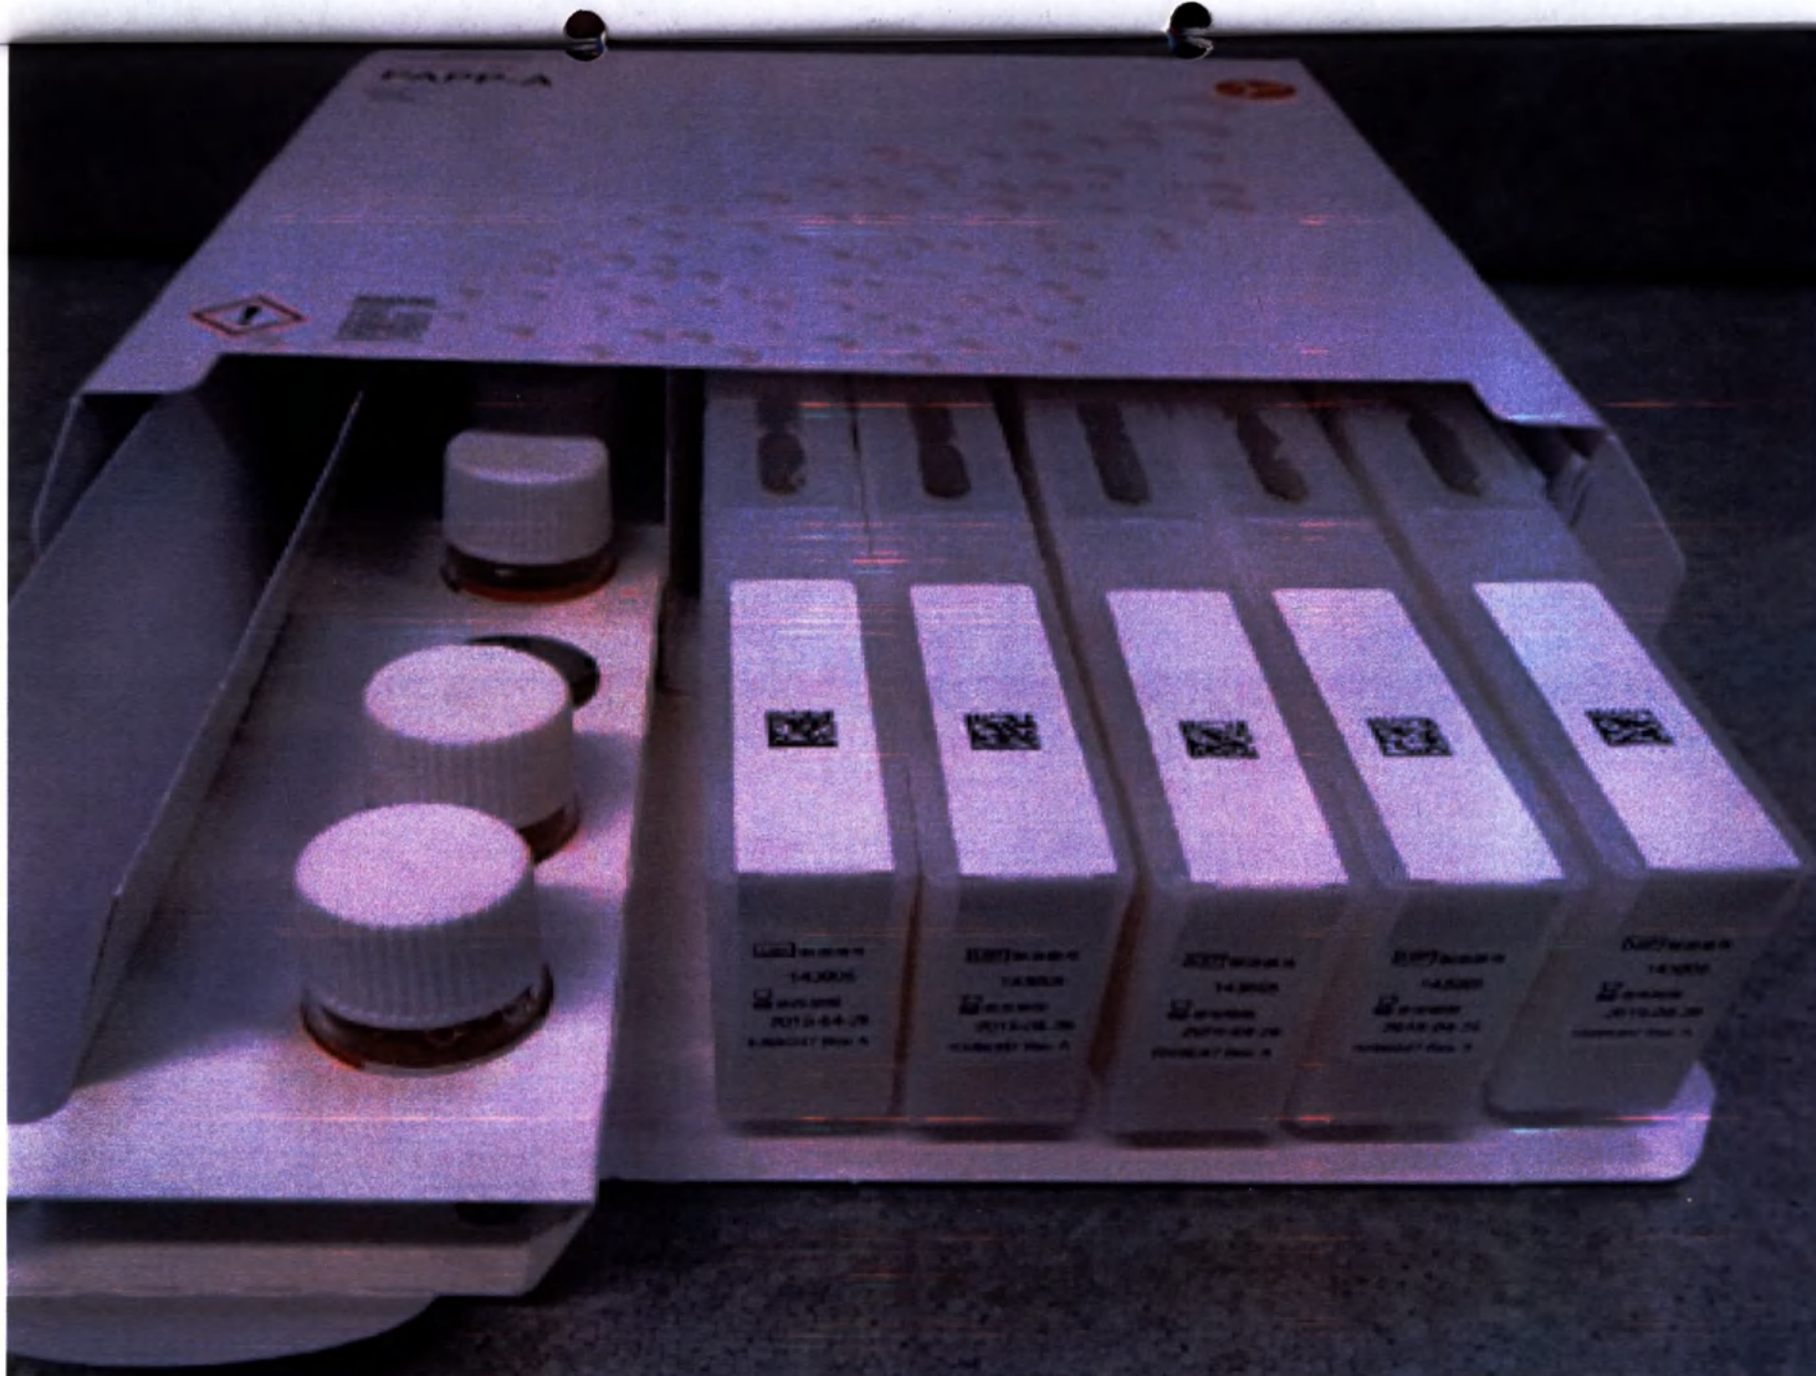


Рисунок 3. Набор реагентов для определения ассоциированного с беременностью плазменного протеина-А на анализаторах иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Pregnancy-Associated Plasma Protein-A (Atellica IM PAPP-A)): Фасовка 500 тестов. Общий вид.

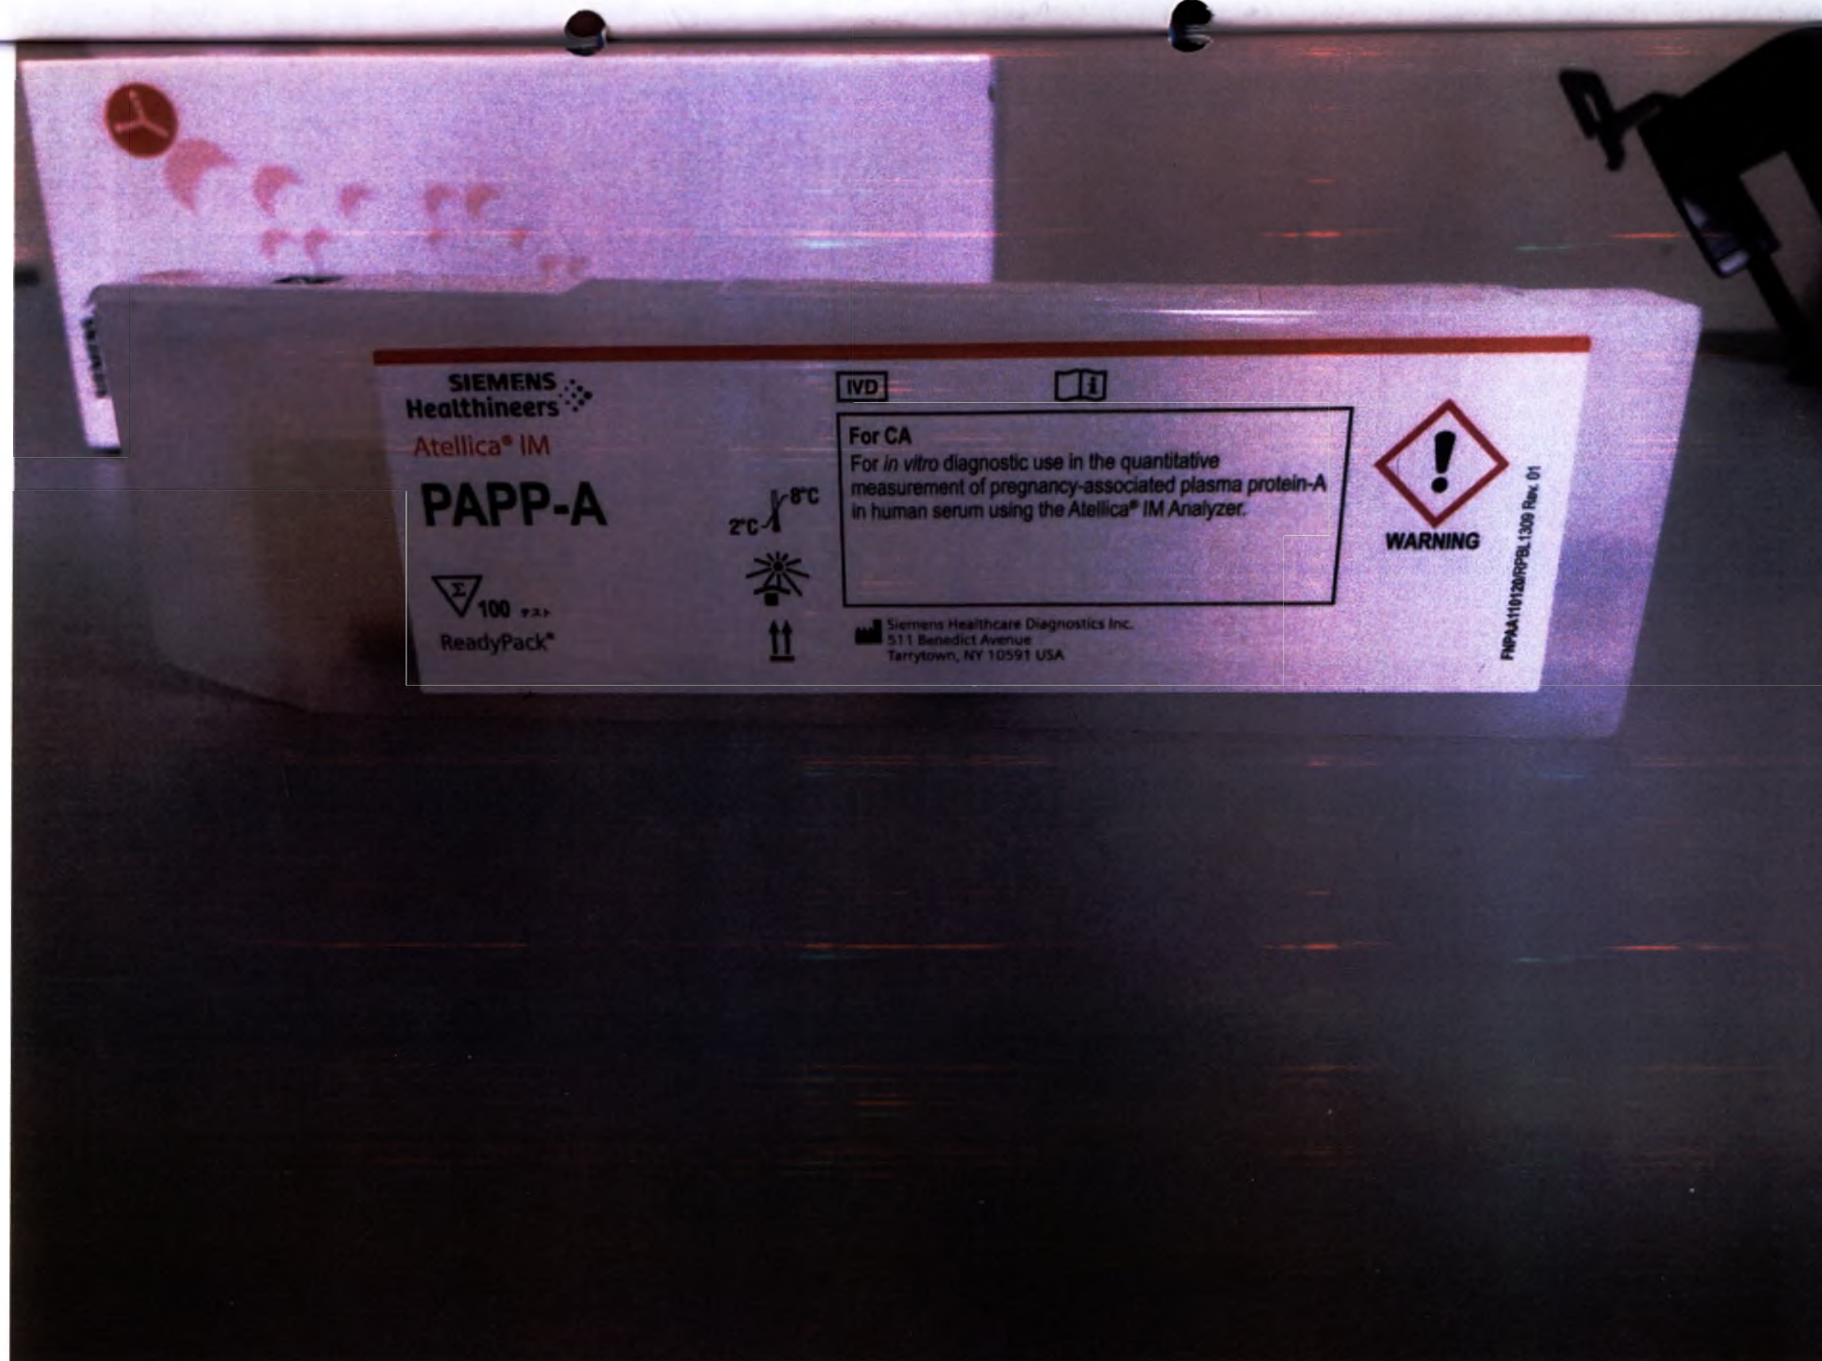


Рисунок 4. Набор реагентов для определения ассоциированного с беременностью плазменного протеина-A на анализаторах иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Pregnancy-Associated Plasma Protein-A (Atellica IM PAPP-A)): Основной реагент Atellica IM PAPP-A.



Рисунок 5. Набор реагентов для определения ассоциированного с беременностью плазменного протеина-A в анализаторах иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Pregnancy-Associated Plasma Protein-A (Atellica IM PAPP-A)): Вкладыш со штрих-кодом MC TDEF для Atellica IM PAPP-A.

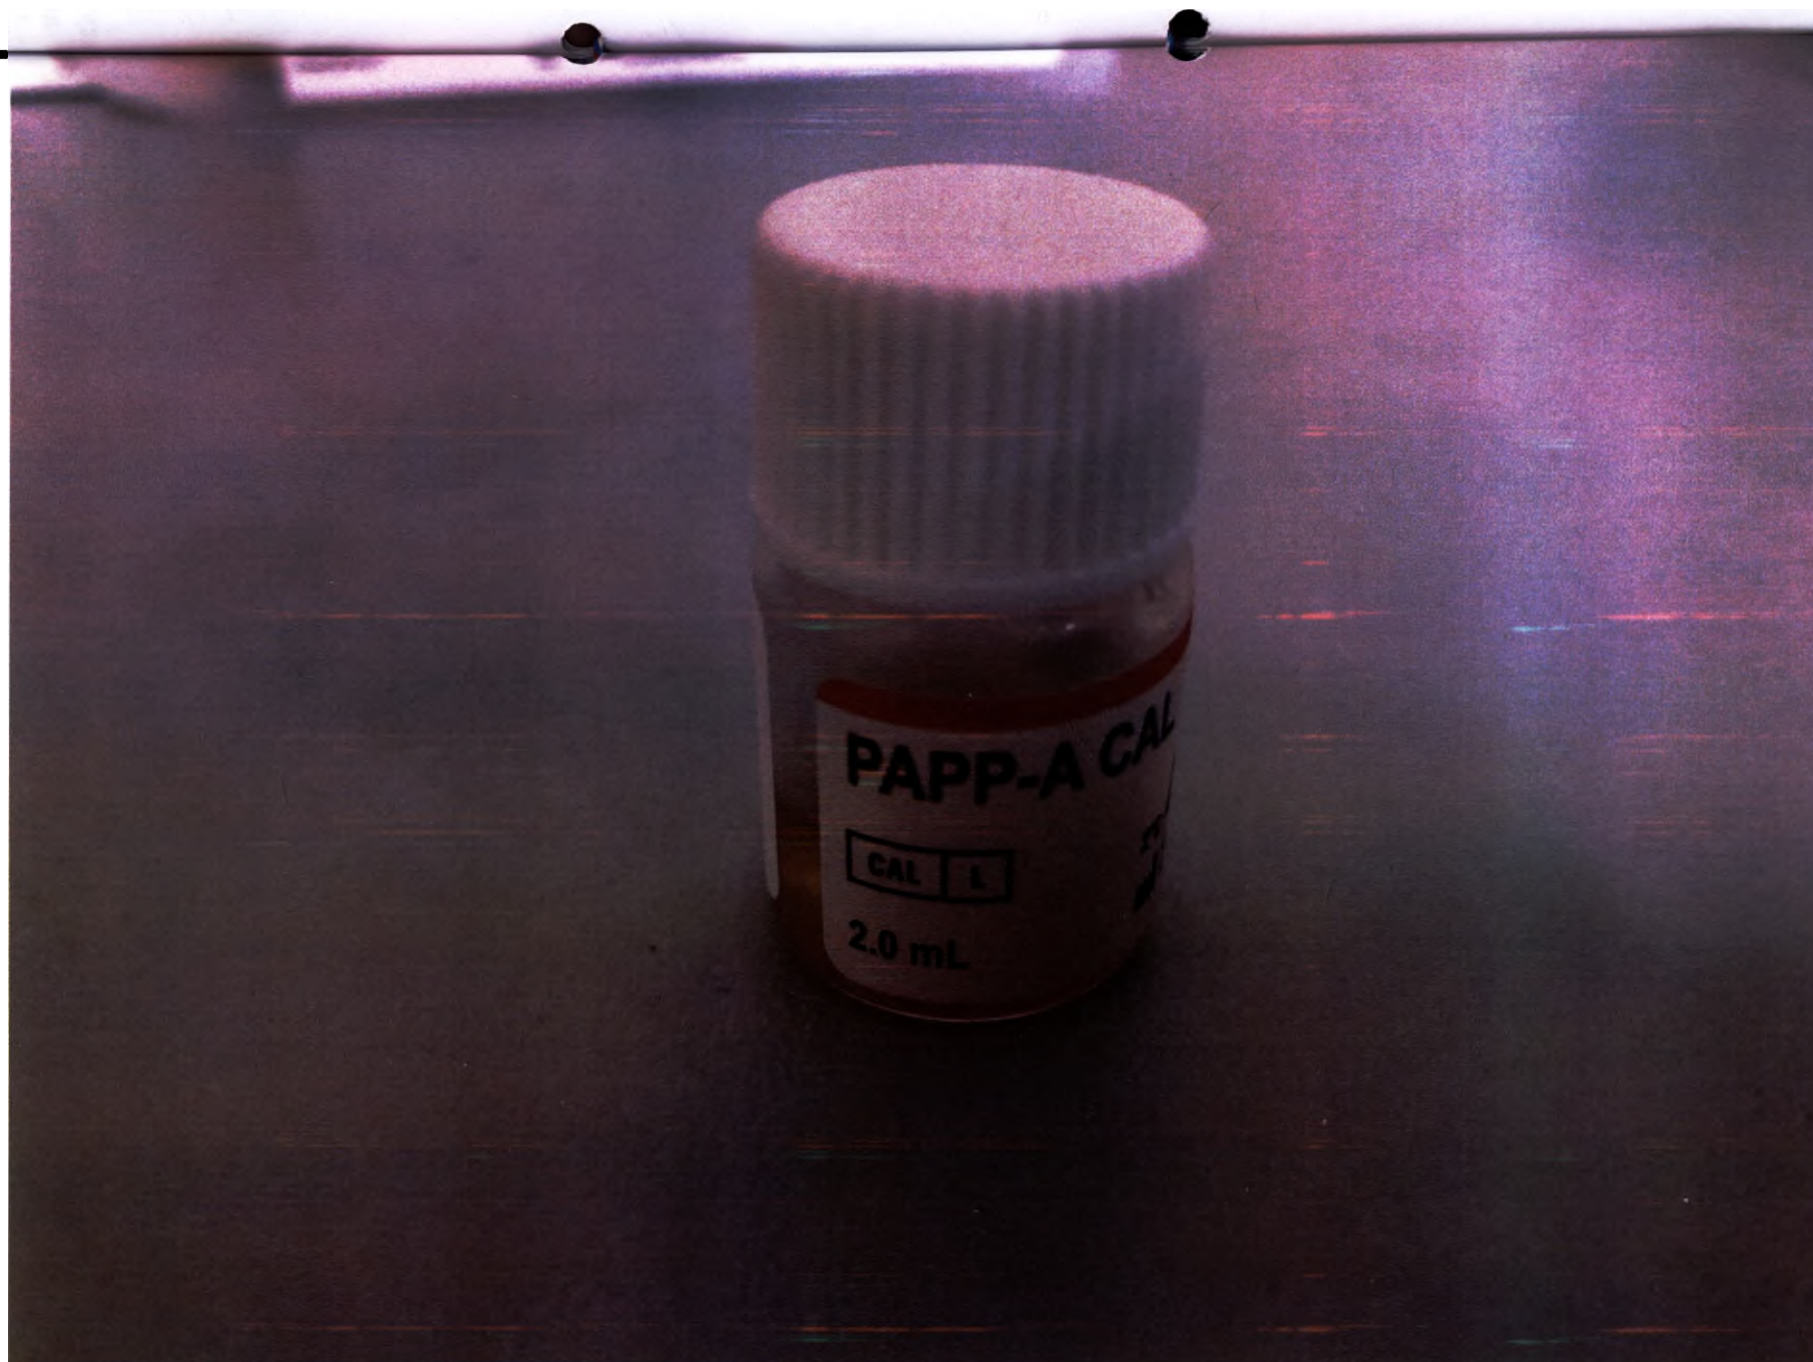


Рисунок 6. Набор реагентов для определения ассоциированного с беременностью плазменного протеина-А на анализаторах иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Pregnancy-Associated Plasma Protein-A (Atellica IM PAPP-A)): Калибратор с низкой концентрацией Atellica IM PAPP-A



Рисунок 7. Набор реагентов для определения ассоциированного с беременностью плазменного протеина-А на анализаторах иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Pregnancy-Associated Plasma Protein-A (Atellica IM PAPP-A)): Калибратор с низкой концентрацией Atellica IM PAPP-A

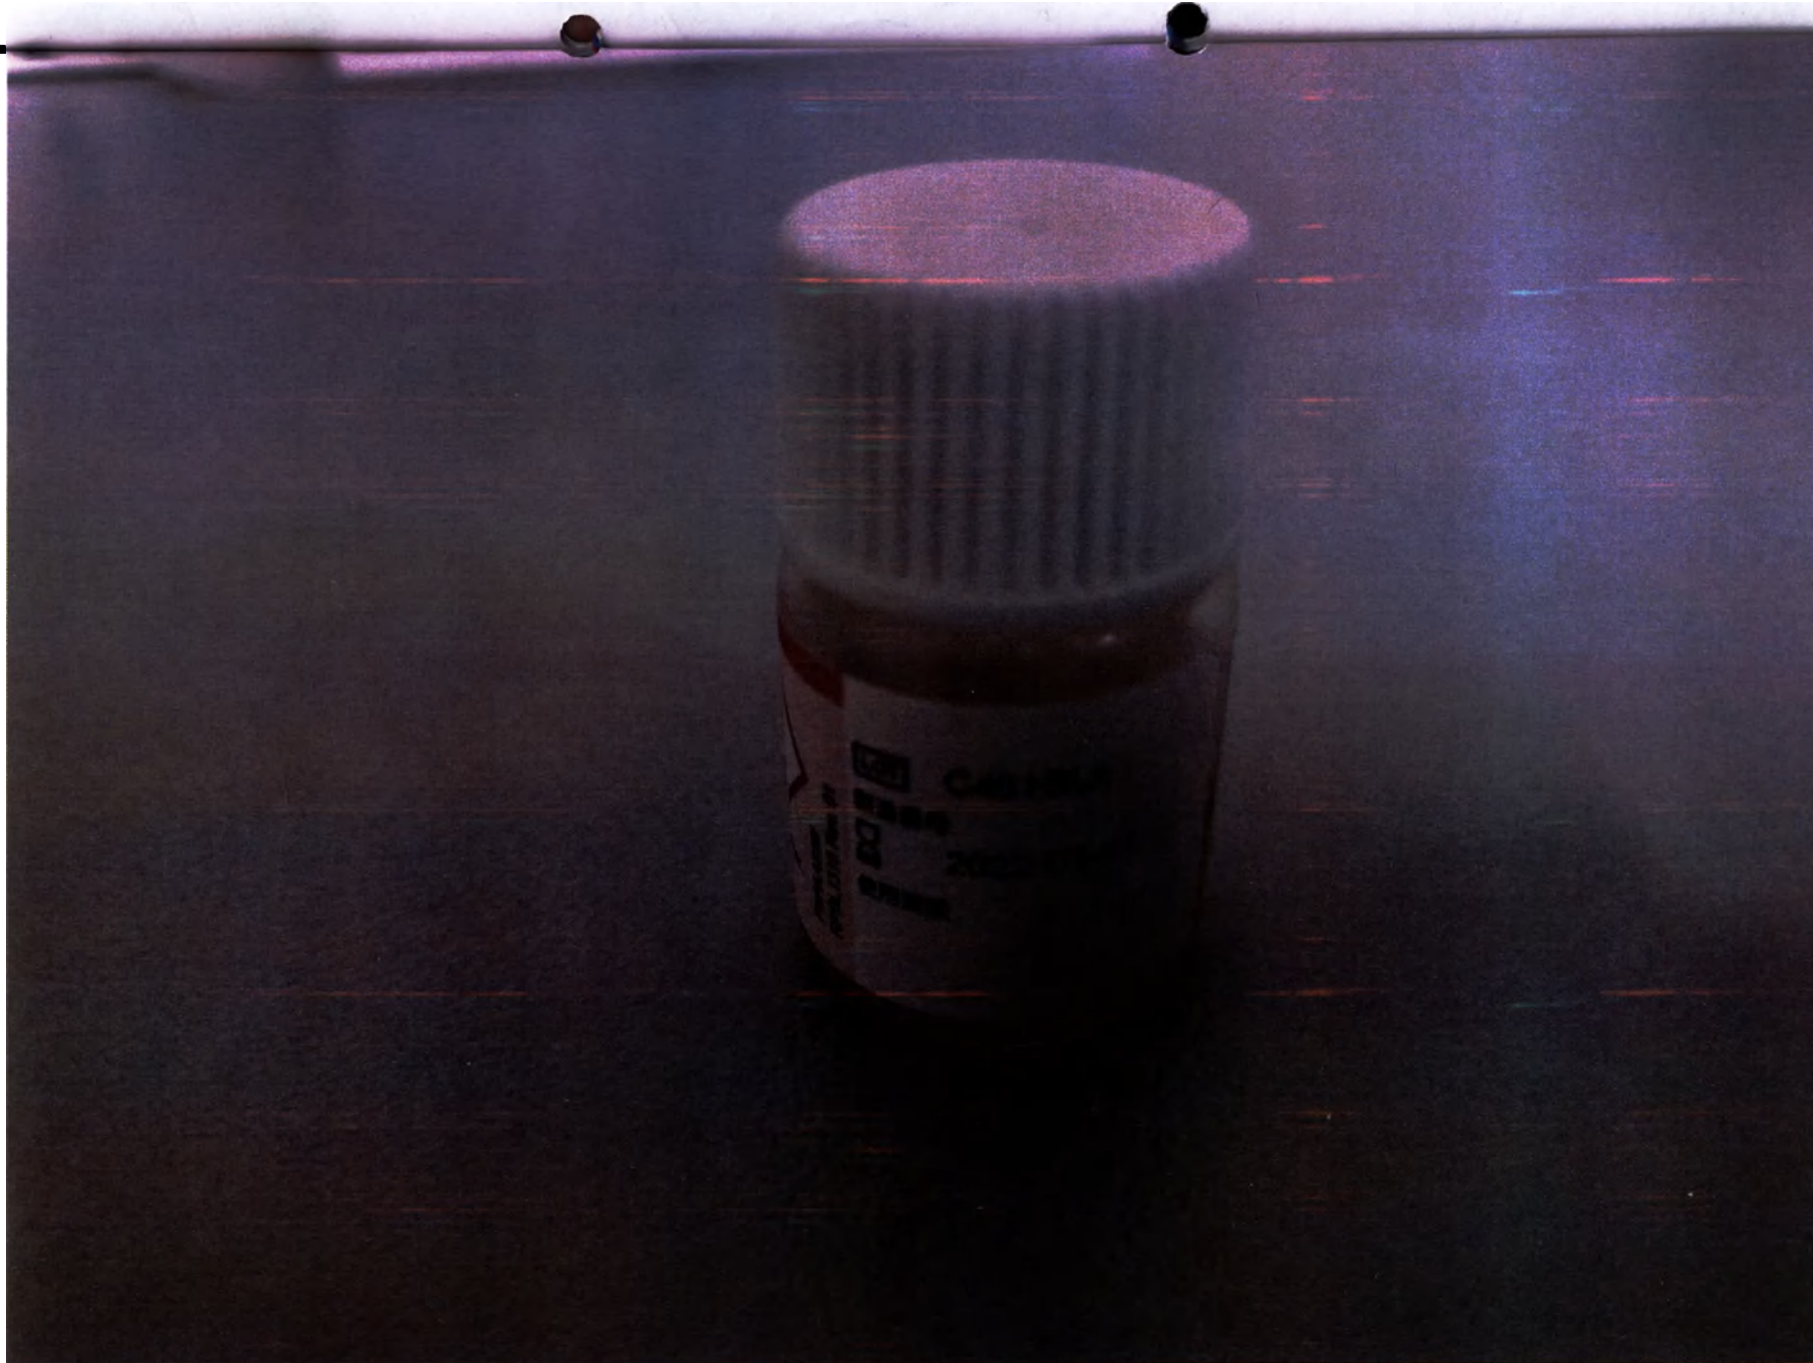


Рисунок 8. Набор реагентов для определения ассоциированного с беременностью плазменного протеина-А на анализаторах иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Pregnancy-Associated Plasma Protein-A (Atellica IM PAPP-A)): Калибратор с низкой концентрацией Atellica IM PAPP-A

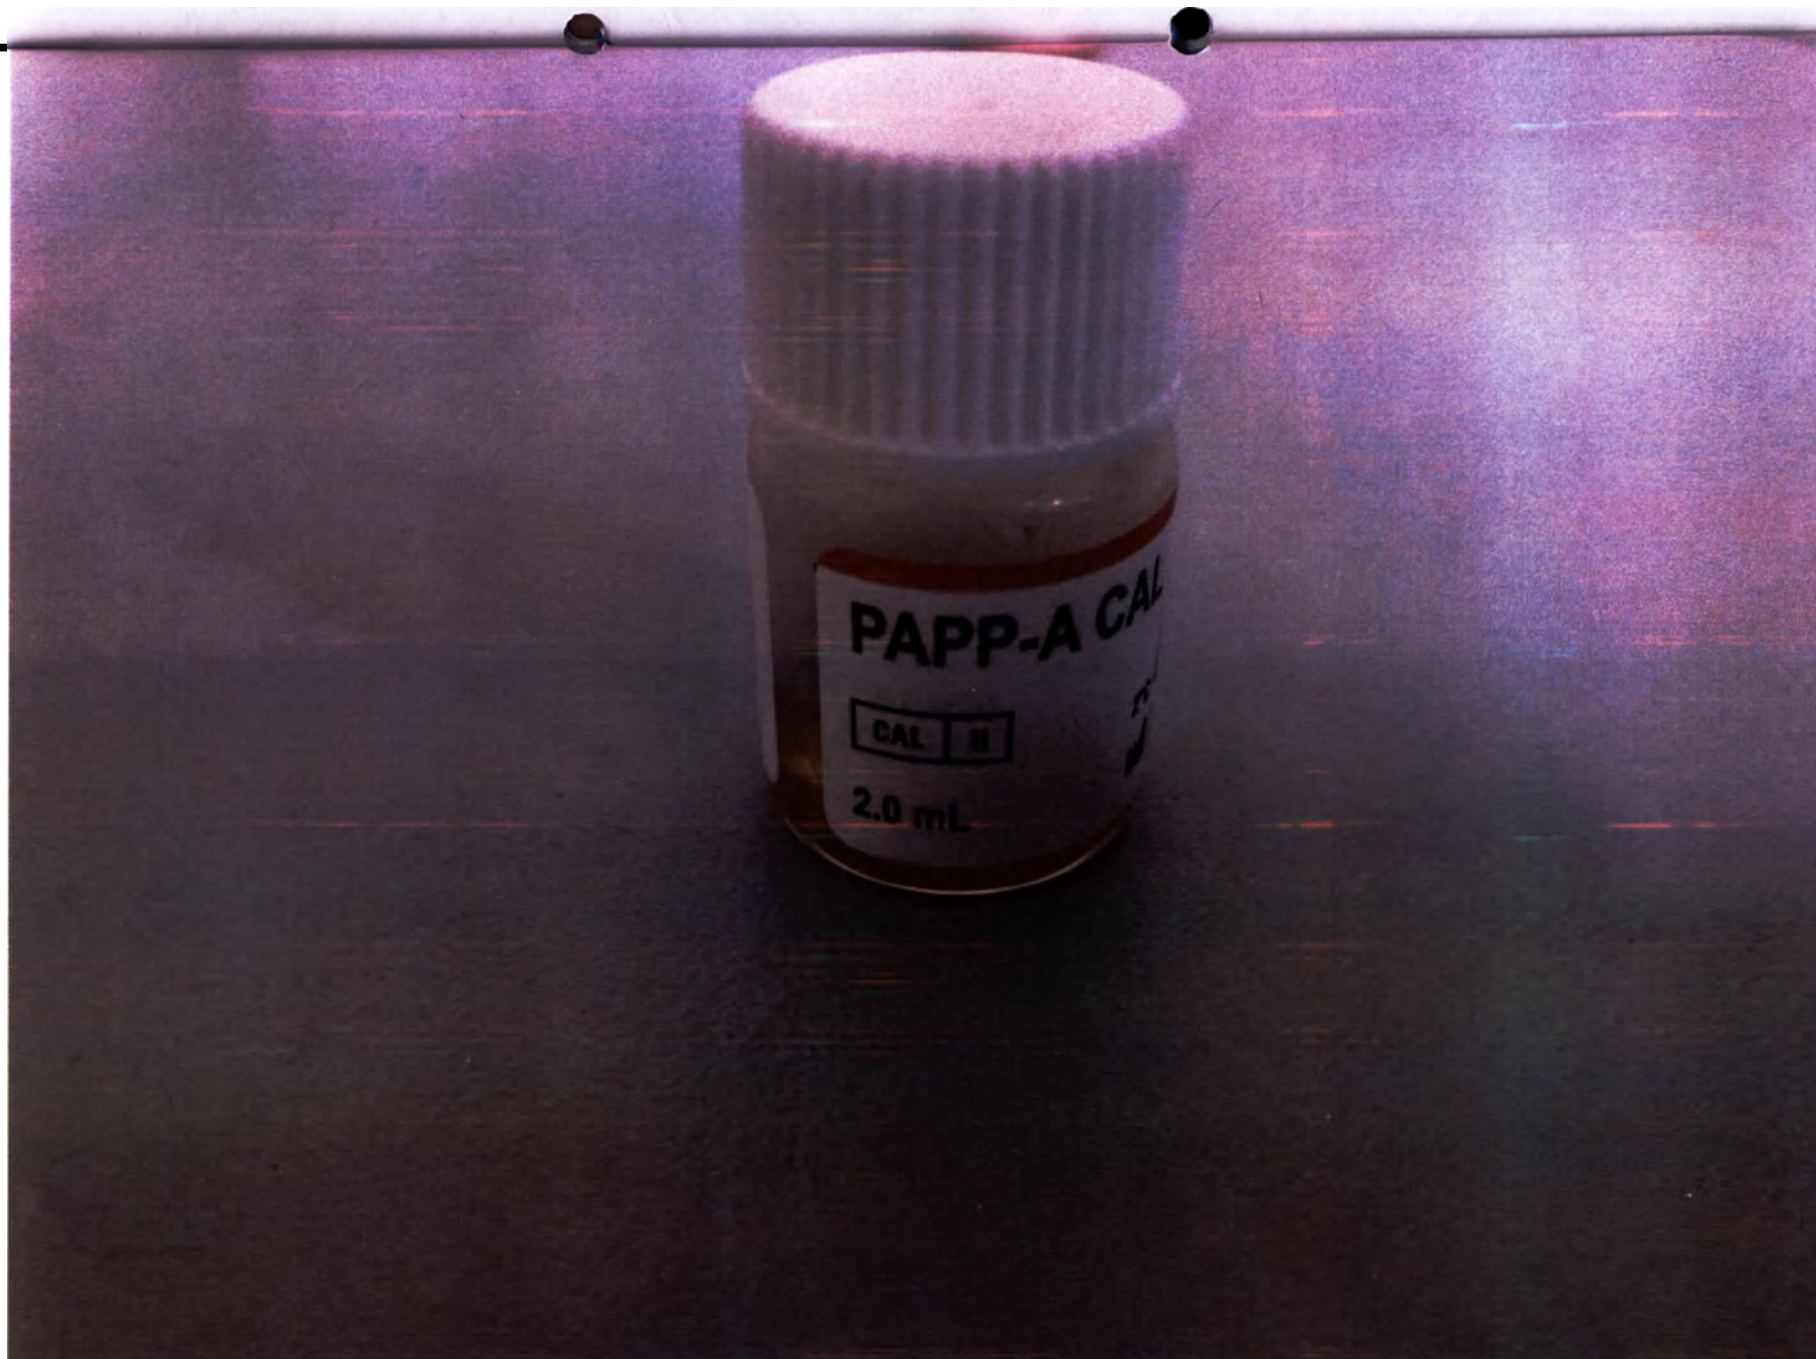


Рисунок 9. Набор реагентов для определения ассоциированного с беременностью плазменного протеина-А на анализаторах иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Pregnancy-Associated Plasma Protein-A (Atellica IM PAPP-A)): Калибратор с высокой концентрацией Atellica IM PAPP-A

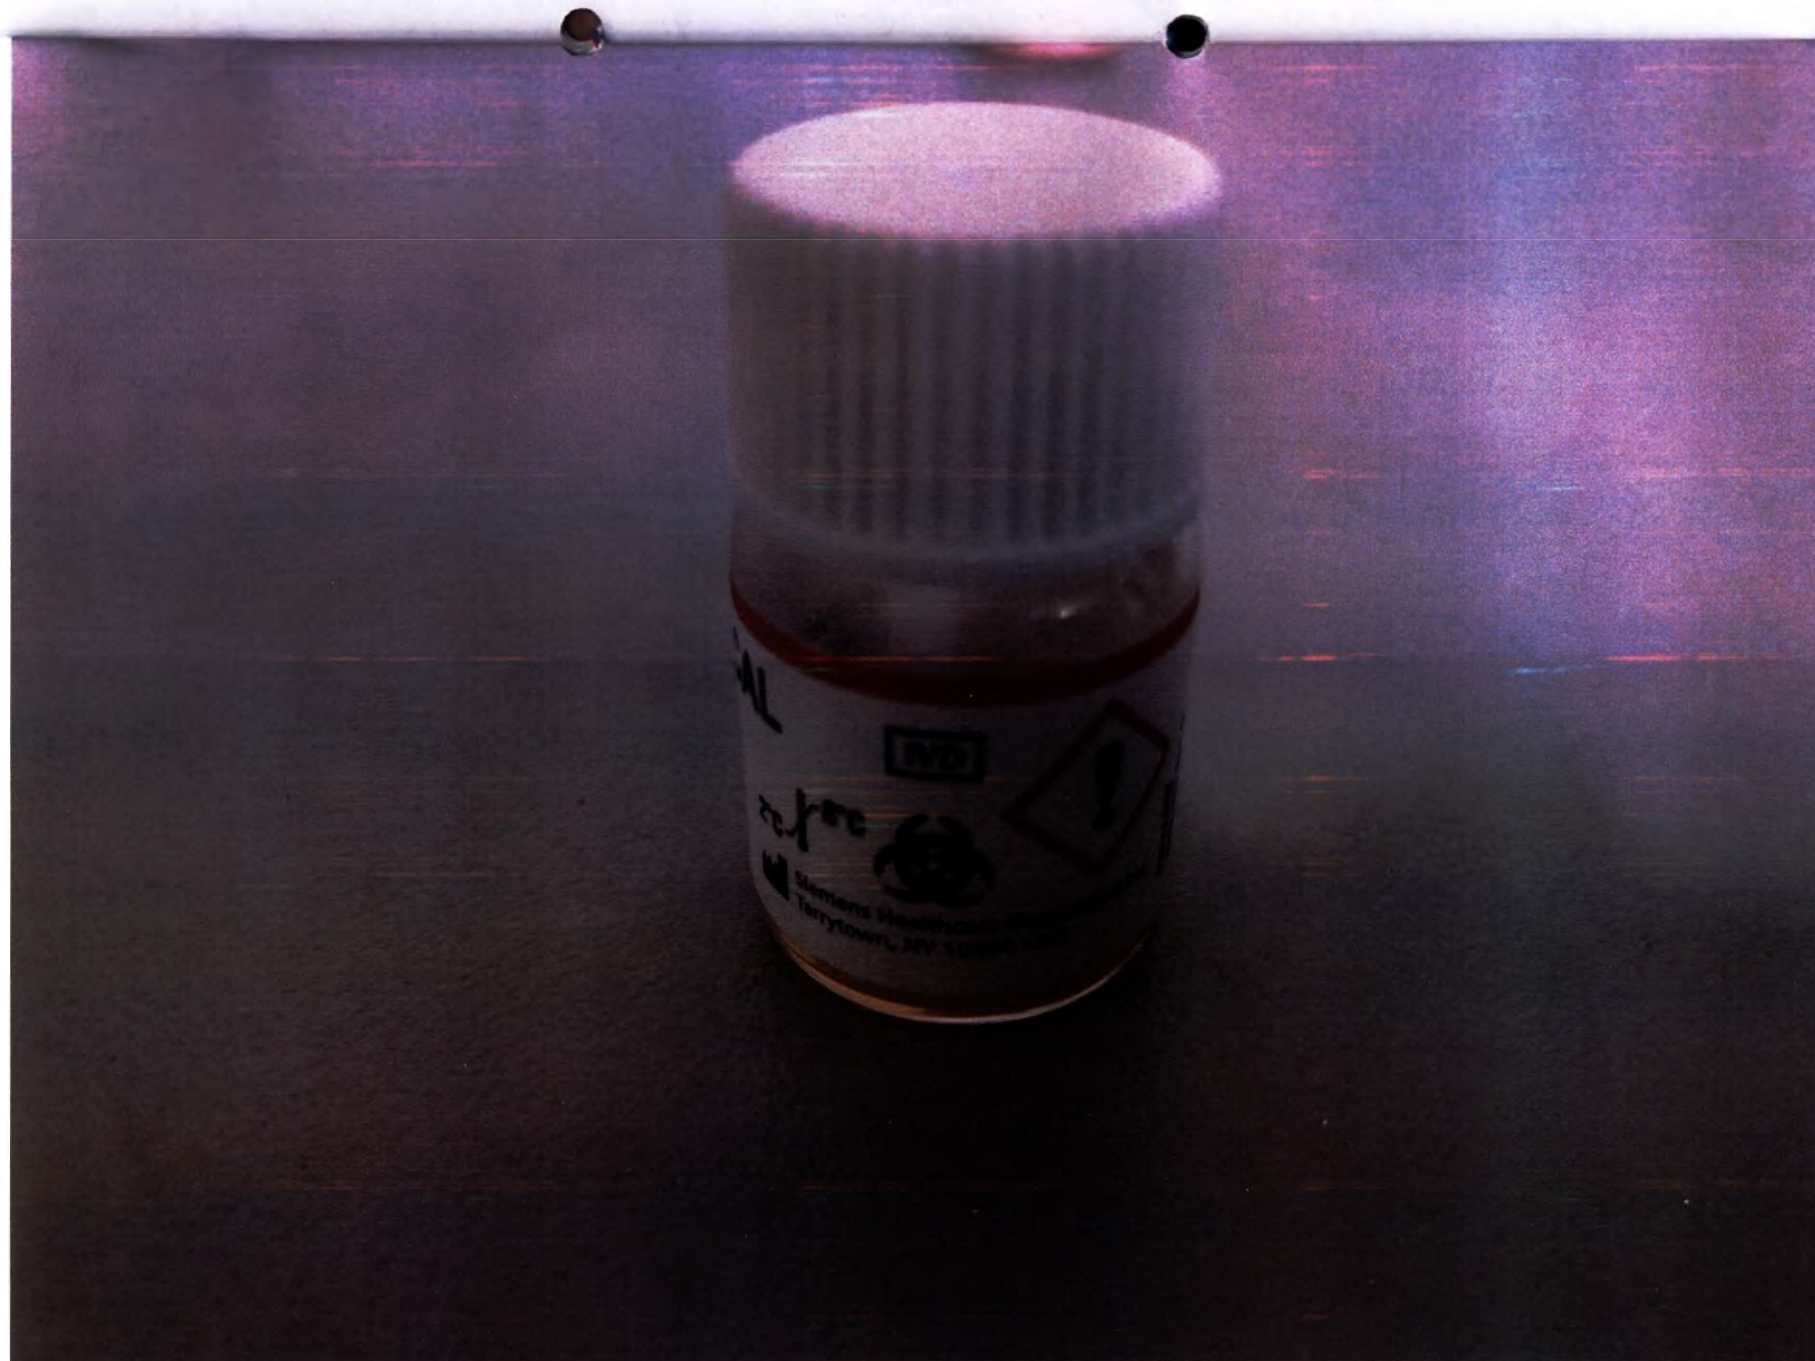


Рисунок 10. Набор реагентов для определения ассоциированного с беременностью плазменного протеина-А на анализаторах иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Pregnancy-Associated Plasma Protein-A (Atellica IM PAPP-A)): Калибратор с высокой концентрацией Atellica IM PAPP-A



Рисунок 11. Набор реагентов для определения ассоциированного с беременностью плазменного протеина-А на анализаторах иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Pregnancy-Associated Plasma Protein-A (Atellica IM PAPP-A)): Калибратор с высокой концентрацией Atellica IM PAPP-A

SIEMENS
Healthineers

Atellica® IM

CAL

PAPPA

CAL LOT VAL

LOT

C4619

製造番号



使用期限

2022-01-11



[siemens.com/document-library](https://www.siemens.com/document-library)



a9e79a19

CHECKSUM

CAL L

UNITS C

UNITS SI

CAL H

UNITS C

UNITS SI

PAPPA



8 IU/L

7.18 IU/L

10097640 Rev. 02

Рисунок 12. Набор реагентов для определения ассоциированного с беременностью плазменного протеина А (АТРА) в калибраторах иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Pregnancy-Associated Protein (PAPPA) (Atellica IM PAPP-A)): Лист значений параметров лота калибратора Atellica IM PAPP-A

