


**Фотографические изображения общего вида
медицинского изделия**

**Набор реагентов для количественного определения C4 компонента системы
комплемента в сыворотке или плазме крови человека
иммунотурбидиметрическим методом
на биохимических анализаторах Alinity c
«C4 компонент системы комплемента Реагенты для Alinity c (Complement C4)»**

Фотографическое изображение МИ ИВД С4 компонент системы комплемента Реагенты для Alinity с (Complement C4), 2 картриджа по 150 тестов, упаковка, вид снаружи



Фотографическое изображение МИ ИВД С4 компонент системы комплемента Реагенты для Alinity с (Complement C4), 2 картриджа по 150 тестов, упаковка, вид изнутри

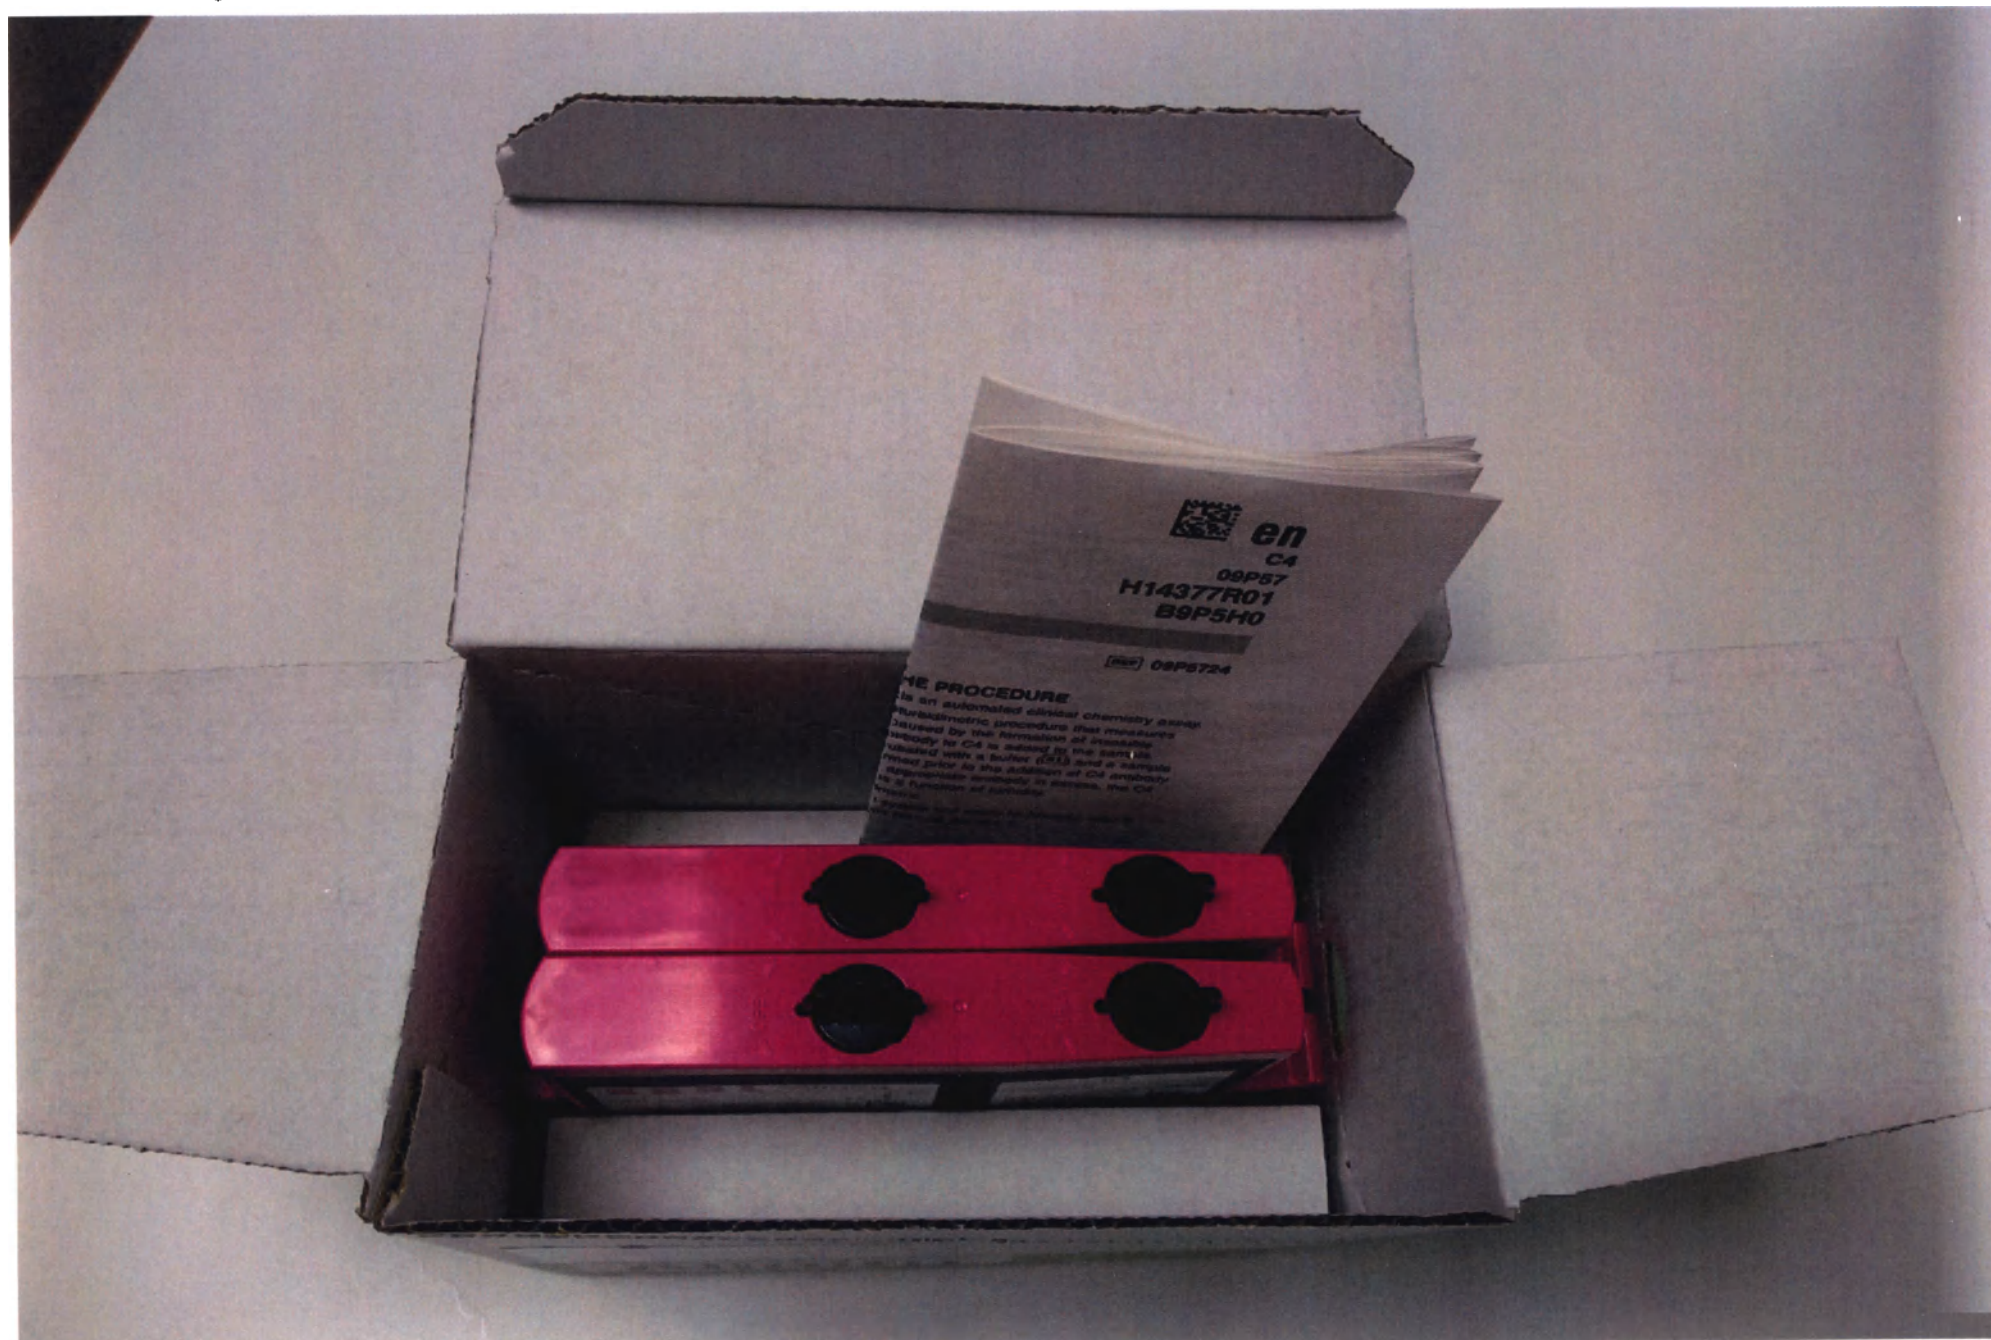

Фотографическое изображение МИ ИВД С4 компонент системы комплемента Реагенты для Alinity c (Complement C4), 2 картриджа по 150 тестов, упаковка, состав



Фотографическое изображение МИ ИВД С4 компонент системы компонента Реагенты для Alinity с (Complement C4), картридж на 150 тестов



Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

5 ЛИСТОВ

Подпись _____



Макет маркировки на медицинское изделие

**Набор реагентов для количественного определения C4 компонента
системы комплемента в сыворотке или плазме крови человека
иммунотурбидиметрическим методом
на биохимических анализаторах Alinity c
«C4 компонент системы комплемента Реагенты для Alinity c (Complement C4)»**

**Макет маркировки медицинского изделия для пользователей Российской Федерации,
вариант исполнения: 2 картриджа по 150 тестов**



09P5724



**Набор реагентов для количественного определения C4 компонента системы комплемента в
сыворотке или плазме крови человека иммунотурбидиметрическим методом
на биохимических анализаторах Alinity c**

«C4 компонент системы комплемента Реагенты для Alinity c (Complement C4)»

2 картриджа по 150 тестов, в составе: Реагент 1 (Alinity c Complement C4 R1) – 2 x 31,6 мл;
Реагент 2 (Alinity c Complement C4 R2) – 2 x 11,8 мл; Инструкция по применению / Производитель:
Эбботт Ирландия, Диагностическое подразделение, Abbott Ireland Diagnostics Division,
Lisnamuck, Longford, Co. Longford, Ireland / Место производства: Abbott Ireland Diagnostics
Division, Lisnamuck, Longford, Co. Longford, Ireland / Страна происхождения: Япония / РУ №
____/____ от ____ г. / Инструкция по применению на русском языке:
www.corelaboratory.abbott/IFU / Серия, использовать до, условия хранения указаны в
графических символах. Расшифровку графических символов см. в инструкции.

Авторизованный представитель изготовителя на территории России и других стран СНГ:
ООО «Эбботт Лэбораториз», 125171, Россия, г. Москва, Ленинградское шоссе, д.16А, строение 1
Тел.: +7 (495) 258 42 80; Факс: +7 (495) 258 42 81

Маркировка медицинского изделия С4 компонент системы компонента Реагенты для Alinity c (Complement C4), 2 картриджа по 150 тестов

C4

Complement C4

C4

REF **09P5724**

 www.corelaboratory.abbott/IFU

 Exp.  LOT

 2°C 8°C

 2°C 8°C

 R1  R2

2 x 31.6 mL
2 x 11.8 mL

Abbott

Alinity c

CONTAINS: AZIDE


H14372802

 Abbott Ireland
Diagnostics Division
Lissansack, Longford
Co. Longford
Ireland
+353-43-3331000

MANUFACTURED FOR
Abbott Laboratories

IVD **CE** 0123

**Макет маркировки блока компонентов медицинского изделия C4 компонент системы
комплемента Реагенты для Alinity c (Complement C4), картридж на 150 тестов:**

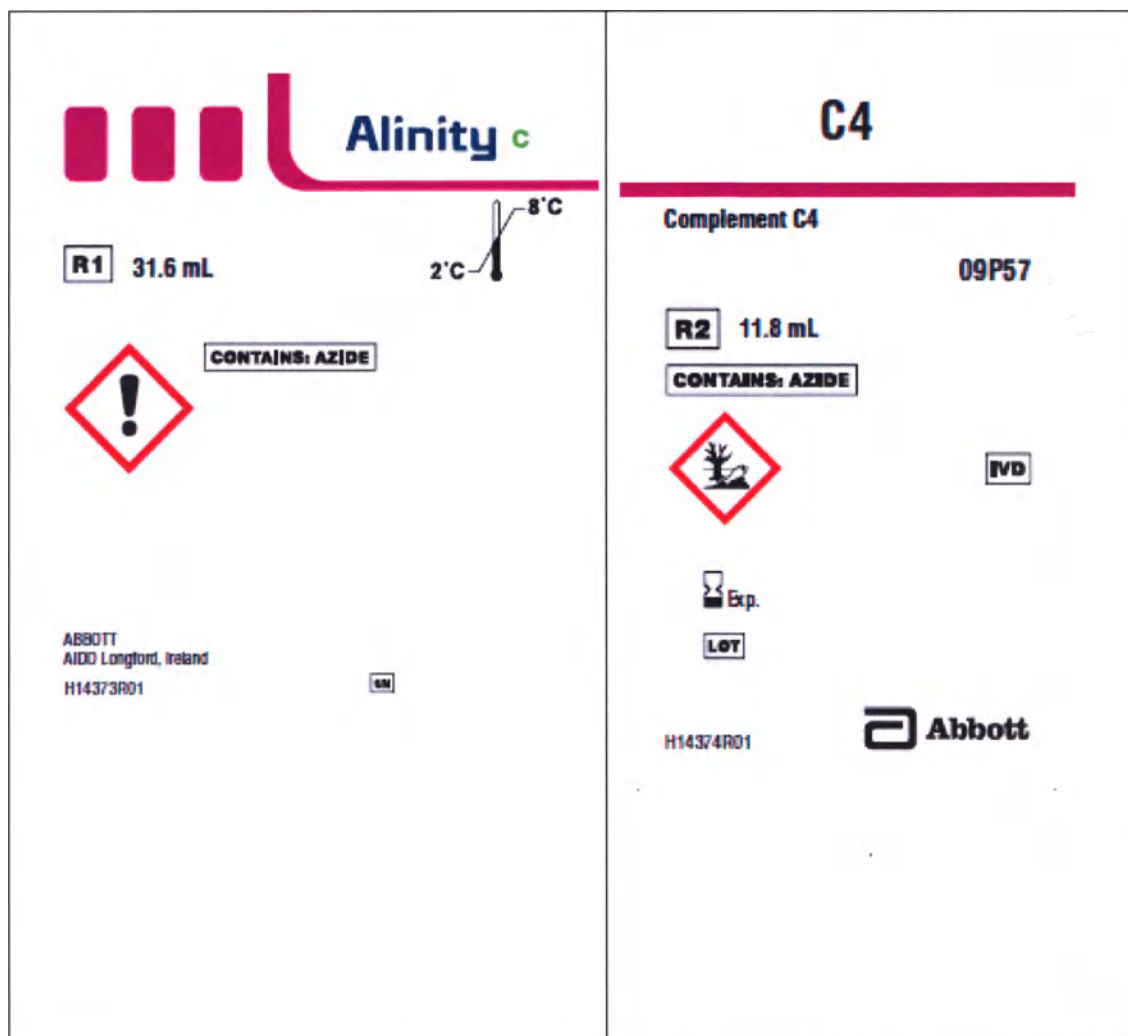

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью
4 листов

