

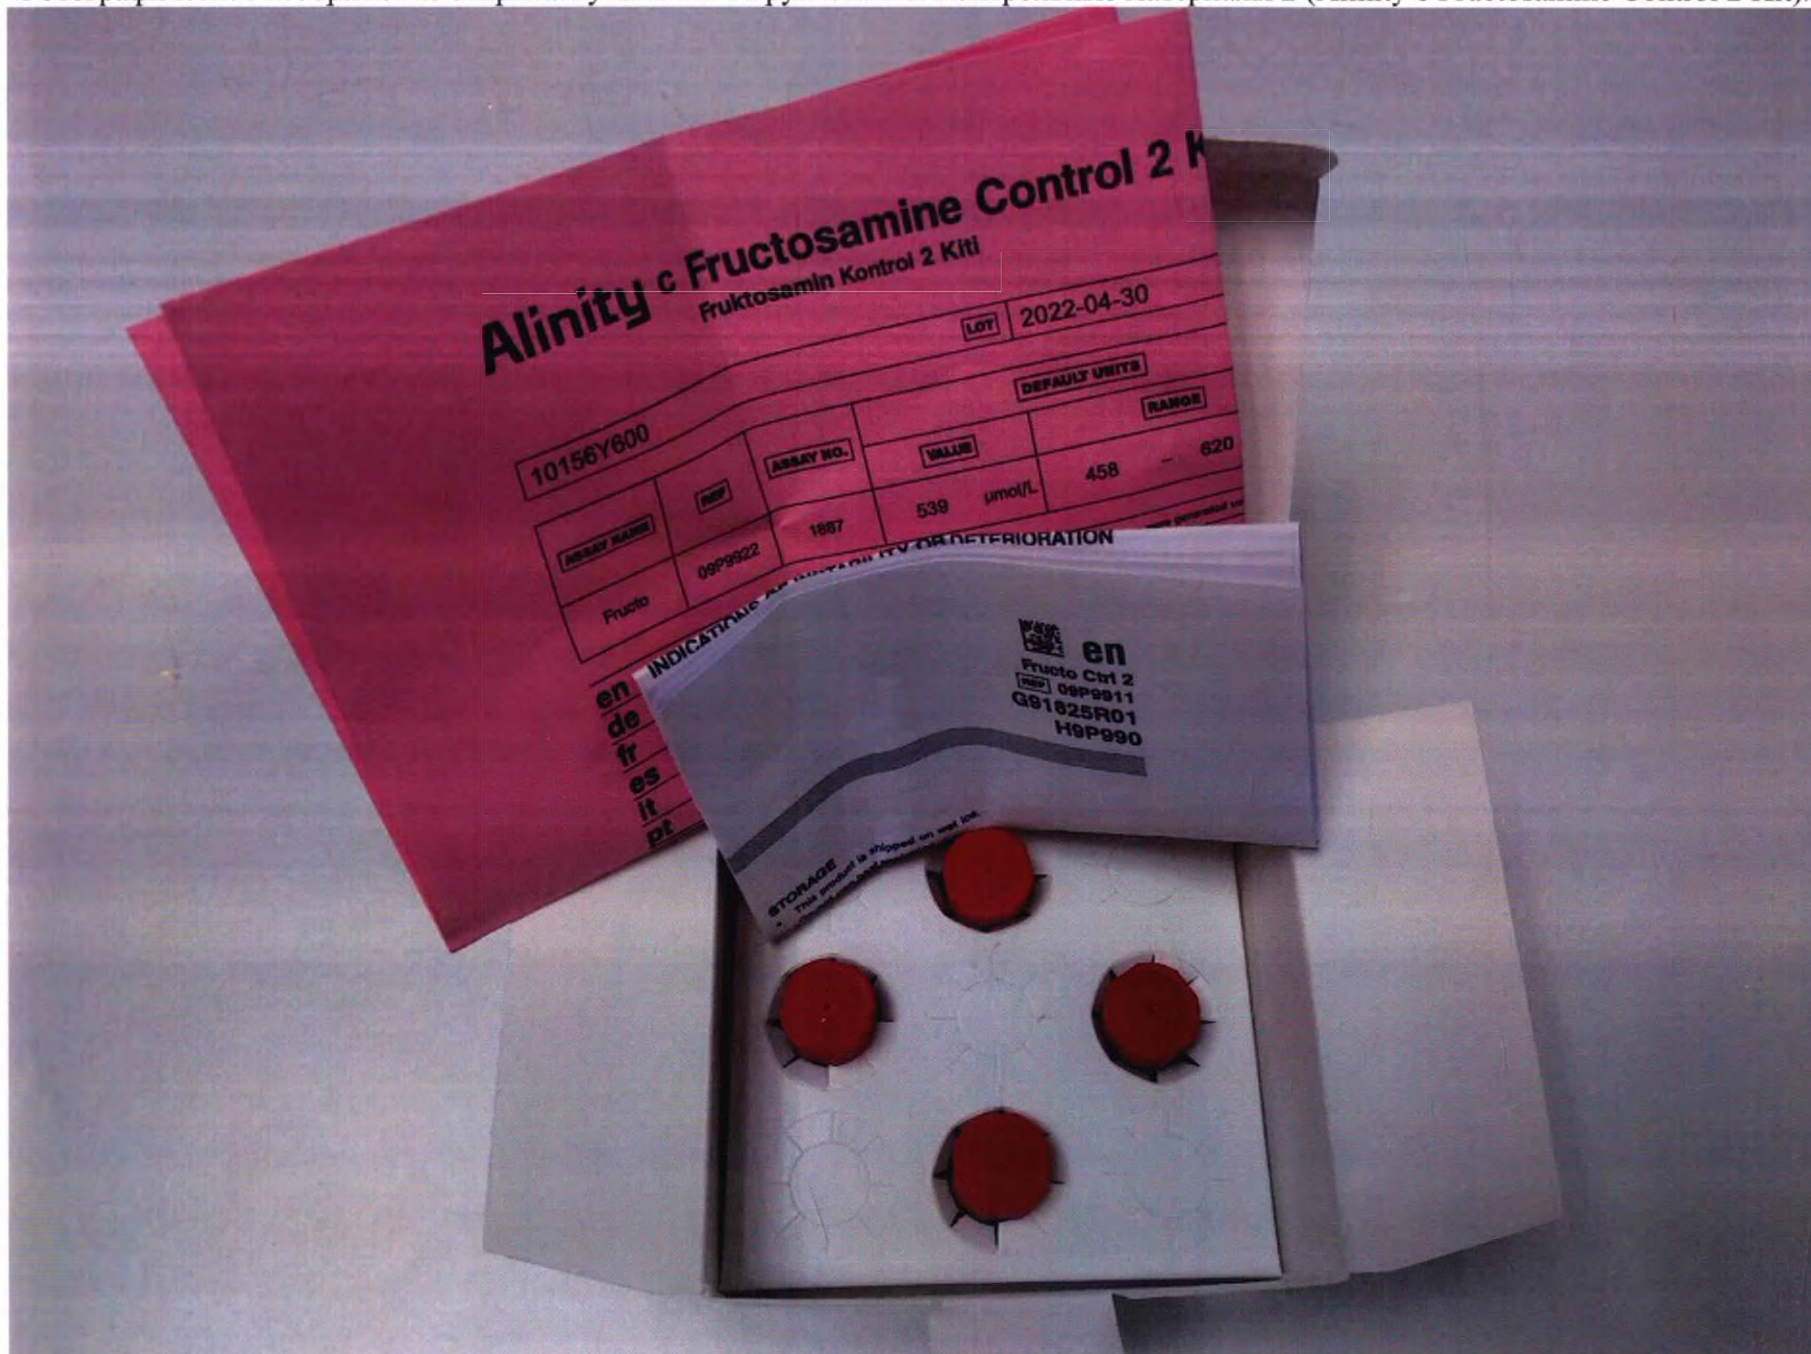
Фотографические изображения общего вида на медицинское изделие

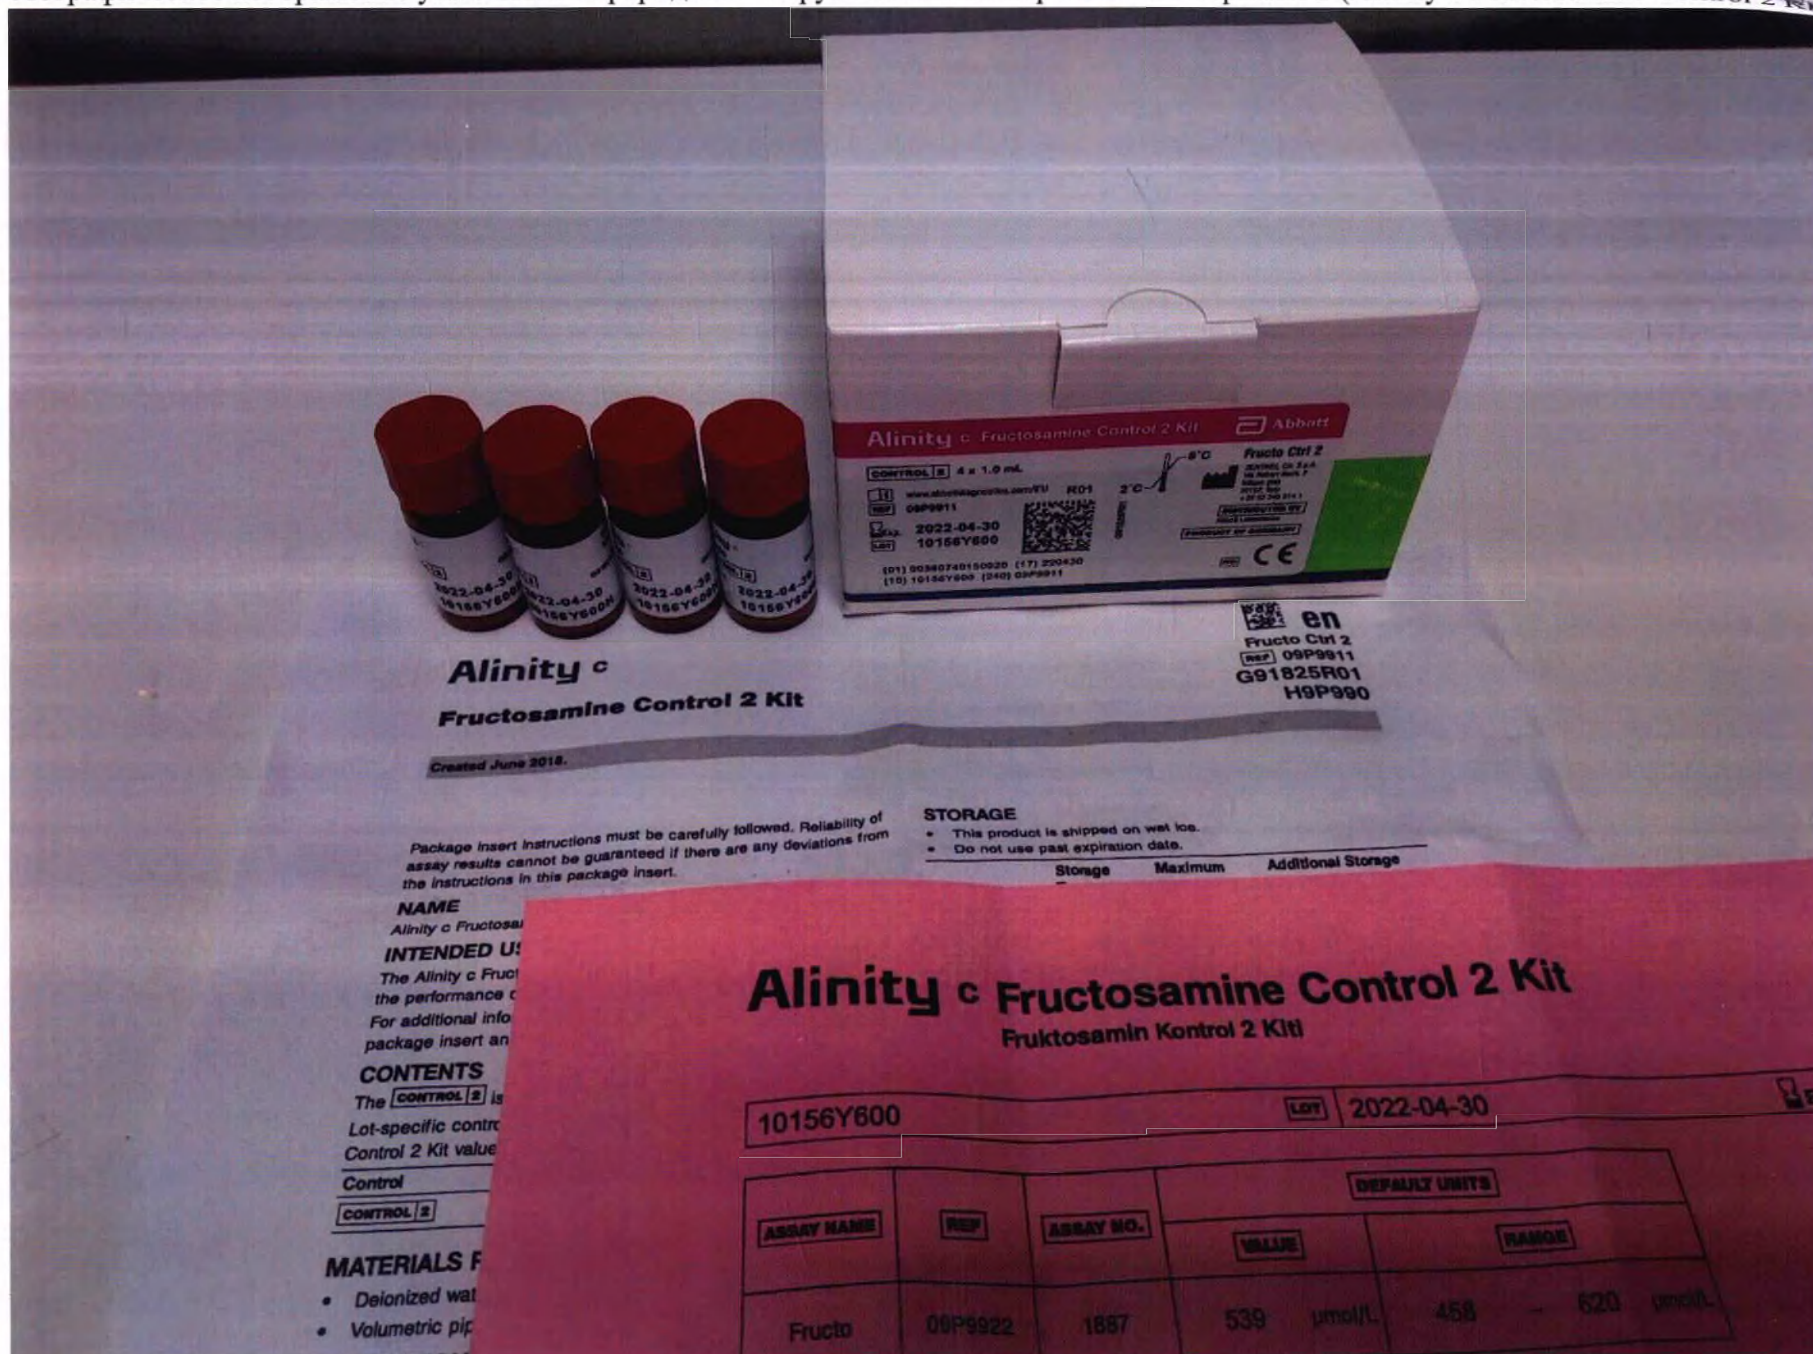
**Набор контрольных материалов 2 для подтверждения воспроизводимости и
правильности определения уровня фруктозамина в сыворотке или плазме крови
человека кинетическим колориметрическим методом на биохимических
анализаторах Alinity с «Фруктозамин Контрольные материалы 2 (Alinity с
Fructosamine Control 2 Kit)»**

(размером не менее 18 x 24 сантиметра)



Фотографическое изображение открытой упаковки «Фруктозамин Контрольные материалы 2 (Alinity с Fructosamine Control 2 Kit)»





Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

4 листов

Подпись



Макет маркировки на медицинское изделие

**Набор контрольных материалов 2 для подтверждения
воспроизводимости и правильности определения уровня
фруктозамина в сыворотке или плазме крови человека
кинетическим колориметрическим методом на
биохимических анализаторах Alinity с «Фруктозамин
Контрольные материалы 2 (Alinity с Fructosamine Control 2
Kit)»**

**REF****09P99-11****IVD**

Набор контрольных материалов 2 для подтверждения воспроизводимости и правильности определения уровня фруктозамина в сыворотке или плазме крови человека кинетическим колориметрическим методом на биохимических анализаторах Alinity с «Фруктозамин Контрольные материалы 2 (Alinity с Fructosamine Control 2 Kit)»

В составе:

- Контрольный материал 2 (Alinity с Fructosamine Control 2) – 4 x 1,0 мл;
- Инструкция по применению;
- Таблица значений

Производитель: «СЕНТИНЕЛЬ К. С.п.А.» (SENTINEL CH. S.p.A.), Via Robert Koch, 2, Milano (MI), 20152, Italy (Италия)

Место производства: SENTINEL CH. S.p.A., Via Robert Koch, 2, Milano (MI), 20152, Italy

Страна происхождения: Германия / РУ № ____/____ от ____/____/____ Инструкция по применению на русском языке: www.corelaboratory.abbott/IFU


Серию, срок годности, условия хранения, страну происхождения и графические символы см. на оригинальной упаковке. Расшифровку графических символов см. в инструкции.

Данный продукт содержит полученные от человека и/или потенциально инфекционные компоненты.


Авторизованный представитель изготовителя на территории России и других стран СНГ:

Общество с ограниченной ответственностью «Эбботт Лэбораториз», 125171, Россия, г. Москва, Ленинградское шоссе, 16А, строение 1,

Тел: +7 (495) 258 42 70 (80); Факс: +7 (495) 258 42 71 (81)

Fructo Ctrl 2**Alinity с Fructosamine Control 2 Kit****Abbott****CONTROL 2** 4 x 1.0 mL www.abbottdiagnostics.com/IFU**REF** 09P9911

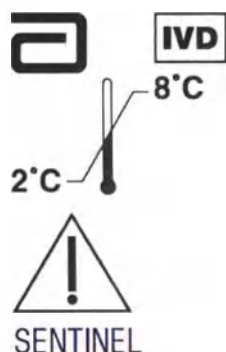
Exp.

LOT**Fructo Ctrl 2** SENTINEL CH. S.p.A.
Via Robert Koch, 2
Milano (MI)
20152, Italy
+39 02 345 514 1**DISTRIBUTED BY**

Abbott Laboratories

PRODUCT OF GERMANY

Макет маркировки каждого компонента медицинского изделия

**Alinity с**
Fructo**CONTROL 2**

Exp.

CN**09P99**
1.0 mL

G91827R01

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

2 листов

Подпись

