

Фотографические изображения медицинского изделия
«Набор реагентов для количественного определения карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT) в сыворотке крови человека методом капиллярного электрофореза для диагностики in vitro «Капель CDT» по ТУ 21.20.23-091-45549798-2021

Всего листов - 2

Генеральный директор
ООО «Люмэкс-маркетинг»



Климова И.О.




20.03.2022

Лист 1 из 2

ООО "Лангмю-Маркетинг"
 ИНН 50-07-0000000
 ОГРН 1055000000000
 Адрес: 190000, Санкт-Петербург, ул. Мухоморова, д. 1, лит. А, этаж 1
 Контакт: 8 (800) 707-00-00
 Сайт: www.langmu-marketing.ru

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
 НА МЕДИЦИНСКОМ МЕДИЦИНСКОМ
 НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ КОЛИЧЕСТВЕННОГО
 ОПРЕДЕЛЕНИЯ КАРБОГЕЛЛАТ ДЕФИЦИТНОГО
 ТРАНСФЕРРИНА (СДТ) В СЫВОРОТКЕ КРОВИ ЧЕЛОВЕКА
 МЕТОДОМ КАПИЛЛЯРНОГО ЭЛЕКТРОФОРЕЗА
 ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ IN VITRO «КАП.Э. СДТ»
 № ТУ 21.20.23-491-45549788-2021

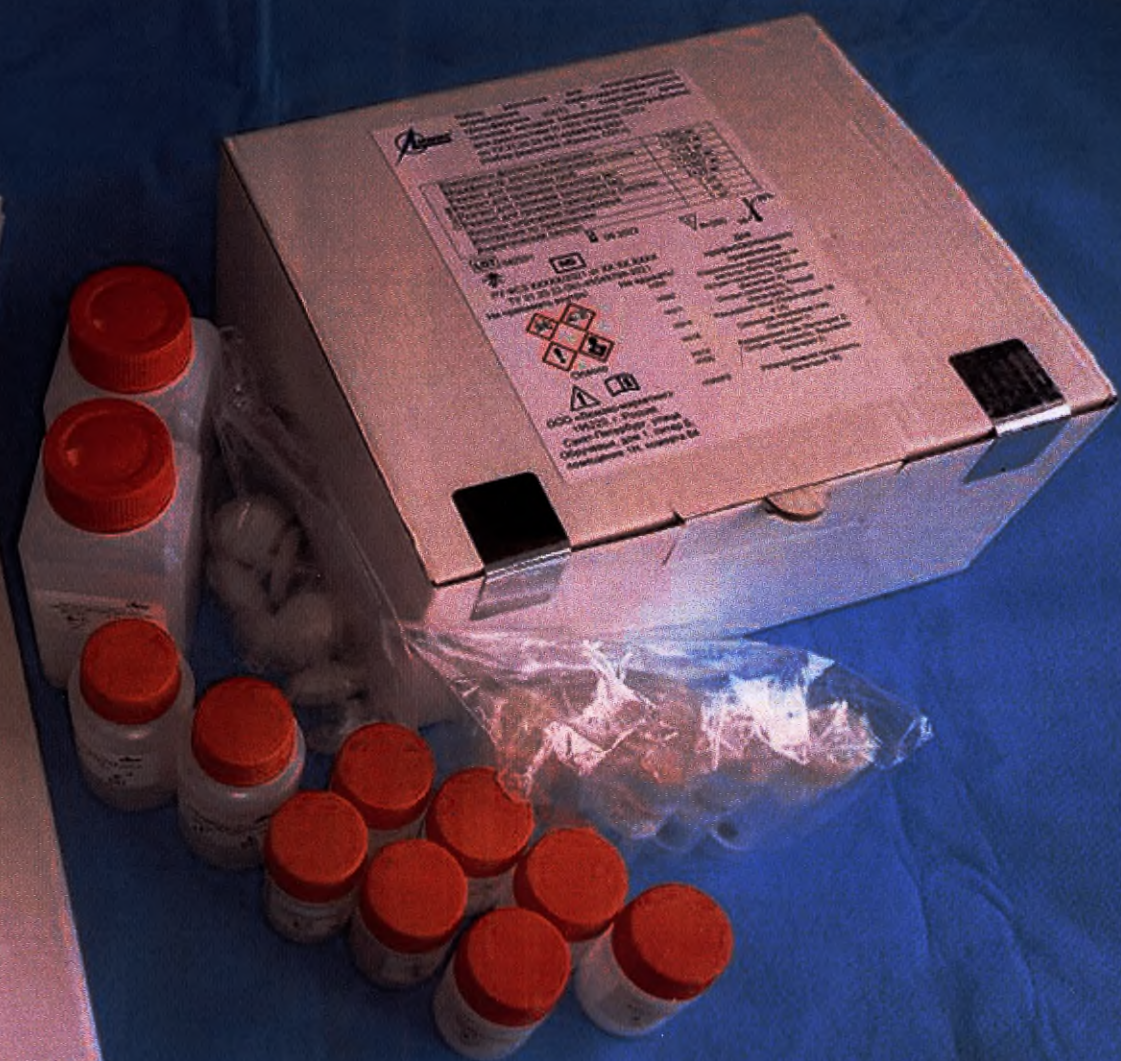

Пронумеровано, прошито
и скреплено печатью на _____
2 (два) _____ листах



ООО МЭКС-МАРКЕТИНГ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ИЛИМОВА ИРИНА
ОЛЕГОВНА

Образцы маркировки медицинского изделия «Набор реагентов для количественного определения карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT) в сыворотке крови человека методом капиллярного электрофореза для диагностики in vitro «Капель CDT» по по ТУ 21.20.23-091-45549798-2021

1. Маркировка транспортной упаковки

 Набор реагентов для количественного определения карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT) в сыворотке крови человека методом капиллярного электрофореза для диагностики in vitro «Капель CDT» по ТУ 21.20.23-091-45549798-2021

Состав	Компоненты фоновой электролита	7×685 мг
	Модификатор электроосмотического потока	1×1000 мг
	Реагент для подготовки проб	7×16 мг
	Реагент для промывки капилляра №1	1×2000 мг
	Реагент для промывки капилляра №2	1×1907 мг
	Реагент для проверки пригодности Системы	2×25 мг
	Фильтры шприцевые одноразовые	7 шт.
	Инструкция по применению	1 шт.
Аналитический паспорт		1 шт.

LOT 032021 08.2022 08.2021 25 25°C

Масса транспортной упаковки нетто/брутто
Масса нетто потребительской упаковки
Число потребительских упаковок

250 г
2 шт.

 Опасно	H200	Коррозионное воздействие на металлы (Категория 1)
	H302	Острая токсичность, Оральное (Категория 4)
	H311	Острая токсичность, Кожный (Категория 3)
	H314	Разъедание кожи (Подкатегория 1B и 1A)
	H318	Серьезное повреждение глаз (Категория 1)
	H319	Раздражение глаз (Категория 2)
H330	Острая токсичность, Вдыхание (Категория 2)	
H360FD	Репродуктивная токсичность (Категория 1B)	

ООО «Ломикс-маркетинг»
195220, г. Санкт-Петербург,
ул. Обручевых, д. 1, литер Б,
помещение 1Н, комната 84

2. Маркировка потребительской упаковки

 Набор реагентов для количественного определения карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT) в сыворотке крови человека методом капиллярного электрофореза для диагностики in vitro «Капель CDT» по ТУ 21.20.23-091-45549798-2021 (Набор реагентов «Капель CDT»)

Состав	Компоненты фоновой электролита	7×685 мг
	Модификатор электроосмотического потока	1×1000 мг
	Реагент для подготовки проб	7×16 мг
	Реагент для промывки капилляра №1	1×2000 мг
	Реагент для промывки капилляра №2	1×1907 мг
	Реагент для проверки пригодности Системы	2×25 мг
	Фильтры шприцевые одноразовые	7 шт.
	Инструкция по применению	1 шт.
Аналитический паспорт		1 шт.

LOT 032021 08.2022 08.2021 15 25°C

ПУ ФСЗ XXXXX/2021 от XX.XX.XXXX
ТУ 21.20.23-091-45549798-2021

Не принимать внутрь! Не вдыхать!

Для профессионального применения

 Опасно	H200	Коррозионное воздействие на металлы (Категория 1)
	H302	Острая токсичность, Оральное (Категория 4)
	H311	Острая токсичность, Кожный (Категория 3)
	H314	Разъедание кожи (Подкатегория 1B и 1A)
	H318	Серьезное повреждение глаз (Категория 1)
	H319	Раздражение глаз (Категория 2)
H330	Острая токсичность, Вдыхание (Категория 2)	
H360FD	Репродуктивная токсичность (Категория 1B)	

ООО «Ломикс-маркетинг»
195220, г. Санкт-Петербург,
ул. Обручевых, д. 1, литер Б,
помещение 1Н, комната 84

3. Маркировка компонентов фонового электролита




**Набор реагентов «Капель CDT»
Компоненты фонового электролита**

LOT 032021 685 мг 



Опасно
H319
H360FD



15-25°C



 08.2022

MD

4. Маркировка модификатора электроосмотического потока




**Набор реагентов «Капель CDT»
Модификатор электроосмотического
потока**

LOT 032021 1000 мг 



Опасно
H290 H330 H314
H302 H311 H318



15-25°C



 08.2022


MD

5. Маркировка реагента для проверки пригодности Системы



**Набор реагентов «Капель CDT»
Реагент для проверки пригодности
Системы**

LOT 032021 25 мг 



15-25°C



 08.2022


MD

6. Маркировка реагента для подготовки проб



**Набор реагентов «Капель CDT»
Реагент для подготовки проб**

LOT 032021 16 мг 




15-25°C



 08.2022

MD

7. Маркировка реагента для промывки капилляра №1

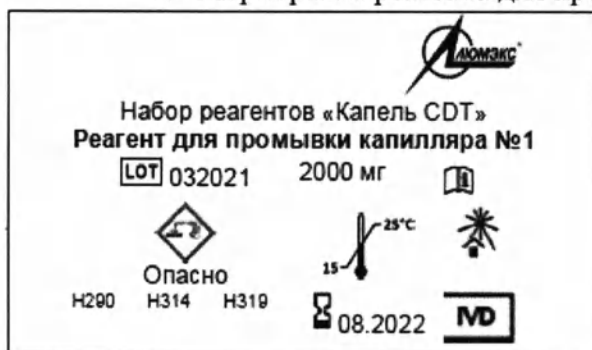

8. Маркировка реагента для промывки капилляра №2



Генеральный директор
ООО «Люмэкс-маркетинг»

Климова И.О.



25.03.2022





Пронумеровано, прошито
и скреплено печатью на _____
3 (три) листах

ООО «ЛЮМЭКС-МАРКЕТИНГ»
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ИЛИМОВА ИРИНА
ОЛЕГОВНА

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Ирина", written over the printed name of the General Director.

Набор реагентов "Капель СДТ"

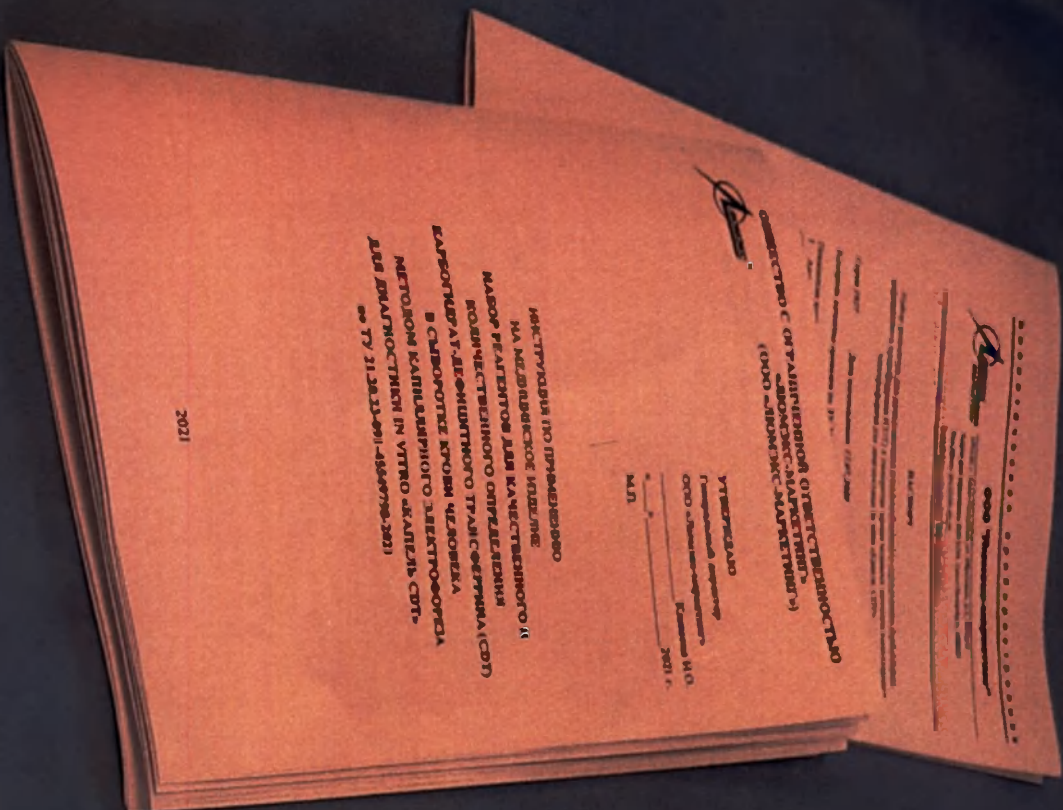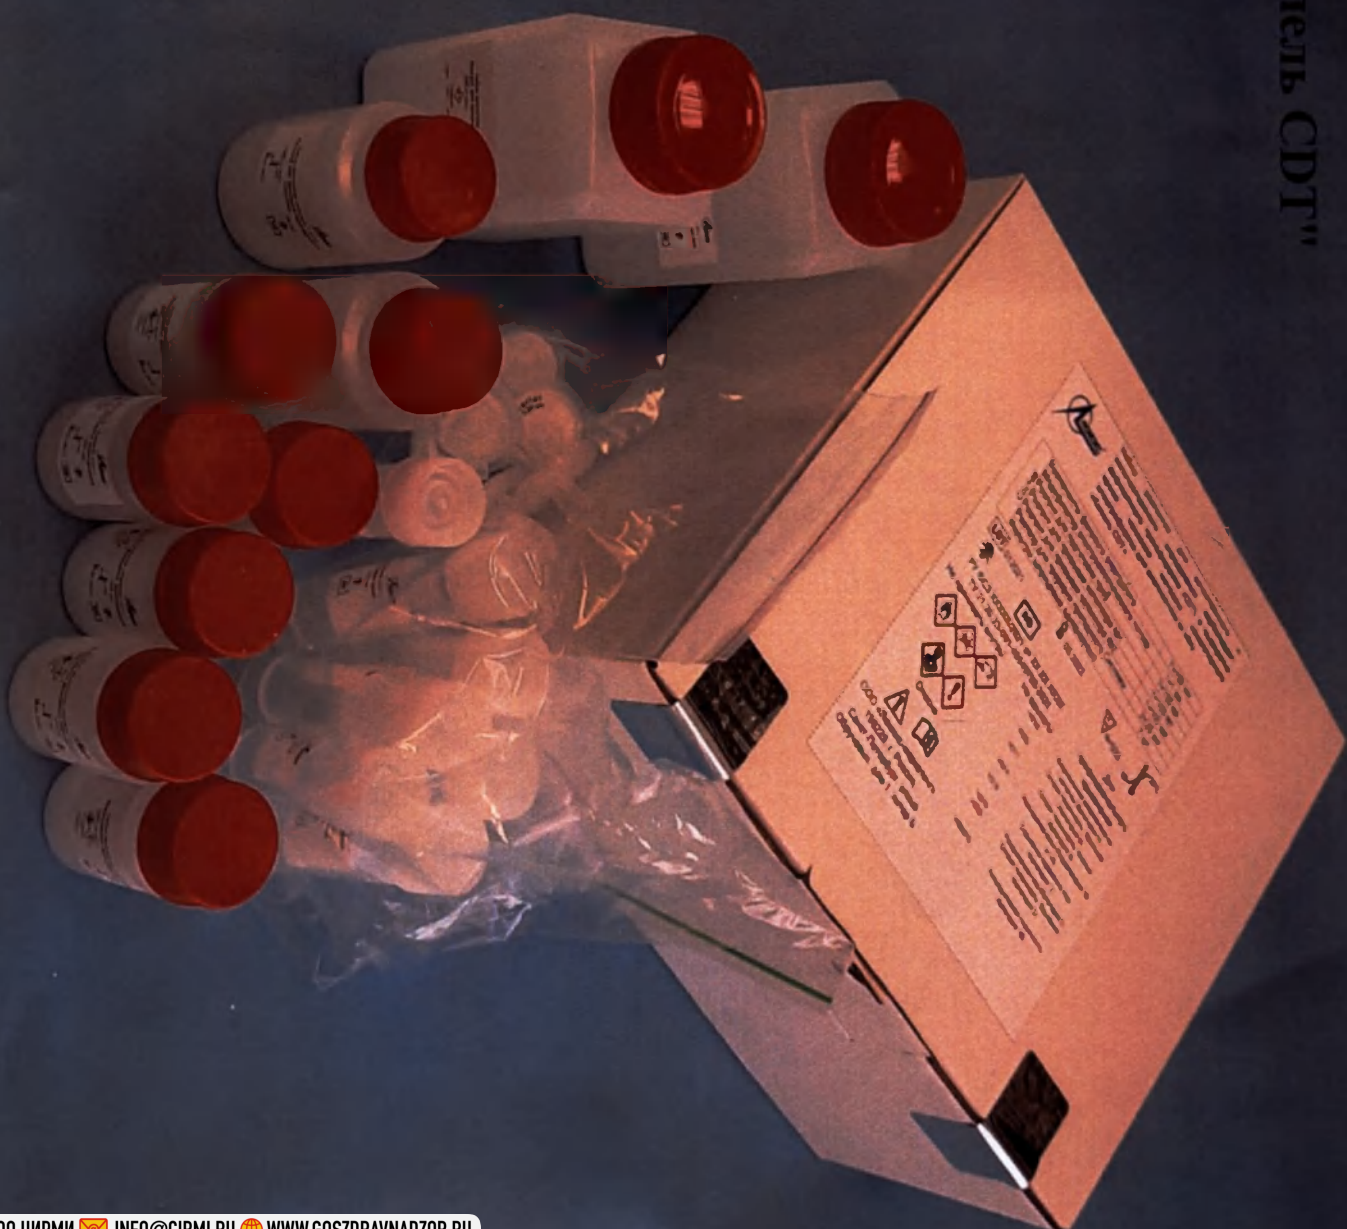

Образцы маркировки медицинского изделия «Набор реагентов для количественного определения карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT) в сыворотке крови человека методом капиллярного электрофореза для диагностики in vitro «Капель CDT»

1. Маркировка транспортной упаковки

 Набор реагентов для количественного определения карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT) в сыворотке крови человека методом капиллярного электрофореза для диагностики in vitro «Капель CDT» по ТУ 21.20.23-091-45549798-2021

Состав	Компоненты фонового электролита	7×685 мг
	Модификатор электроосмотического потока	1×1000 мг
	Реагент для подготовки проб	7×16 мг
	Реагент для промывки капилляра №1	1×2000 мг
	Реагент для промывки капилляра №2	1×1907 мг
	Реагент для проверки пригодности Системы	2×25 мг
	Фильтры шприцевые одноразовые	7 шт.
	Инструкция по применению	1 шт.
Аналитический паспорт		1 шт.

LOT 032021 08.2022 08.2021 15-25°C

Масса транспортной упаковки нетто/брутто / г
Масса нетто потребительской упаковки 250 г
Число потребительских упаковок 2 шт.

	H290	Коррозионное воздействие на металлы (Категория 1)
	H302	Острая токсичность, Оральное (Категория 4)
	H311	Острая токсичность, Кожный (Категория 3)
	H314	Разъедание кожи (Подкатегория 1B и 1A)
	H318	Серьезное поражение глаз (Категория 1)
	H319	Раздражение глаз (Категория 2)
	H330	Острая токсичность, Вдыхание (Категория 2)
	H360FD	Репродуктивная токсичность (Категория 1B)

Опасно

ООО «Люмэкс-маркетинг»
195220, г. Россия, Санкт-Петербург, улица Обручевых, дом 1, литер Б

2. Маркировка потребительской упаковки

 Набор реагентов для количественного определения карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT) в сыворотке крови человека методом капиллярного электрофореза для диагностики in vitro «Капель CDT» по ТУ 21.20.23-091-45549798-2021 (Набор реагентов «Капель CDT»)

Состав	Компоненты фонового электролита	7×685 мг
	Модификатор электроосмотического потока	1×1000 мг
	Реагент для подготовки проб	7×16 мг
	Реагент для промывки капилляра №1	1×2000 мг
	Реагент для промывки капилляра №2	1×1907 мг
	Реагент для проверки пригодности Системы	2×25 мг
	Фильтры шприцевые одноразовые	7 шт.
	Инструкция по применению	1 шт.
Аналитический паспорт		1 шт.

LOT 032021 08.2022 08.2021 15-25°C

ПУ ФСЗ XXXXX/2021 от XX.XX.XXXX
ТУ 21.20.23-091-45549798-2021

Не принимать внутрь! Не вдыхать!

	H290	Коррозионное воздействие на металлы (Категория 1)
	H302	Острая токсичность, Оральное (Категория 4)
	H311	Острая токсичность, Кожный (Категория 3)
	H314	Разъедание кожи (Подкатегория 1B и 1A)
	H318	Серьезное поражение глаз (Категория 1)
	H319	Раздражение глаз (Категория 2)
	H330	Острая токсичность, Вдыхание (Категория 2)
	H360FD	Репродуктивная токсичность (Категория 1B)

Опасно

ООО «Люмэкс-маркетинг»
195220, г. Россия, Санкт-Петербург, улица Обручевых, дом 1, литер Б

Для профессионального применения

3. Маркировка компонентов фонового электролита



Набор реагентов «Капель CDT»
Компоненты фонового электролита

LOT 032021 685 мг 

 Опасно
H310
H360FD

 25°C
15



 08.2022 **MD**

4. Маркировка модификатора электроосмотического потока



Набор реагентов «Капель CDT»
Модификатор электроосмотического потока

LOT 032021 1000 мг 

 Опасно
H290 H330 H314
H302 H311 H318

 25°C
15




 08.2022 **MD**

5. Маркировка реагента для проверки пригодности Системы




Набор реагентов «Капель CDT»
Реагент для проверки пригодности Системы

LOT 032021 25 мг 

 25°C
15




 08.2022 **MD**

6. Маркировка реагента для подготовки проб




Набор реагентов «Капель CDT»
Реагент для подготовки проб

LOT 032021 16 мг 

 25°C
15



 08.2022 **MD**

7. Маркировка реагента для промывки капилляра №1


Набор реагентов «Капель CDT»
Реагент для промывки капилляра №1
LOT 032021 2000 мг 
 Опасно
H290 H314 H319
 25°C
15
08.2022 

8. Маркировка реагента для промывки капилляра №2


Набор реагентов «Капель CDT»
Реагент для промывки капилляра №2
LOT 032021 1907 мг 
 Опасно
H319 H360FD
 25°C
15
08.2022 



Пронумеровано, прошито
и скреплено печатью на _____

3 (три) листах

ООО «ДЖАКС-МАРКЕТИНГ»
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ЕЛИНОВА ИРИНА
ОЛГОВНА

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Irina", written over the typed name of the General Director.