

Согласовано

ООО «МЕДИКОР»

Организация

420138, Республика Татарстан, г. Казань, проспект

Победы, д. 466, кв. 46.

Адрес

Генеральный директор

Должность

Протасова А.А..

Фамилия, Имя

«23» декабря 2021 года

Дата ДД.ММ.ГГГГ

Подпись Signature



Фотографические изображения

Устройство для рентгенэндоваскулярных процедур ПОТОК в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-15624048-2021.

2021



Рис. 1. Устройство для рентгенэндоваскулярных процедур ПОТОК в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-15624048-2021.
Транспортная упаковка.


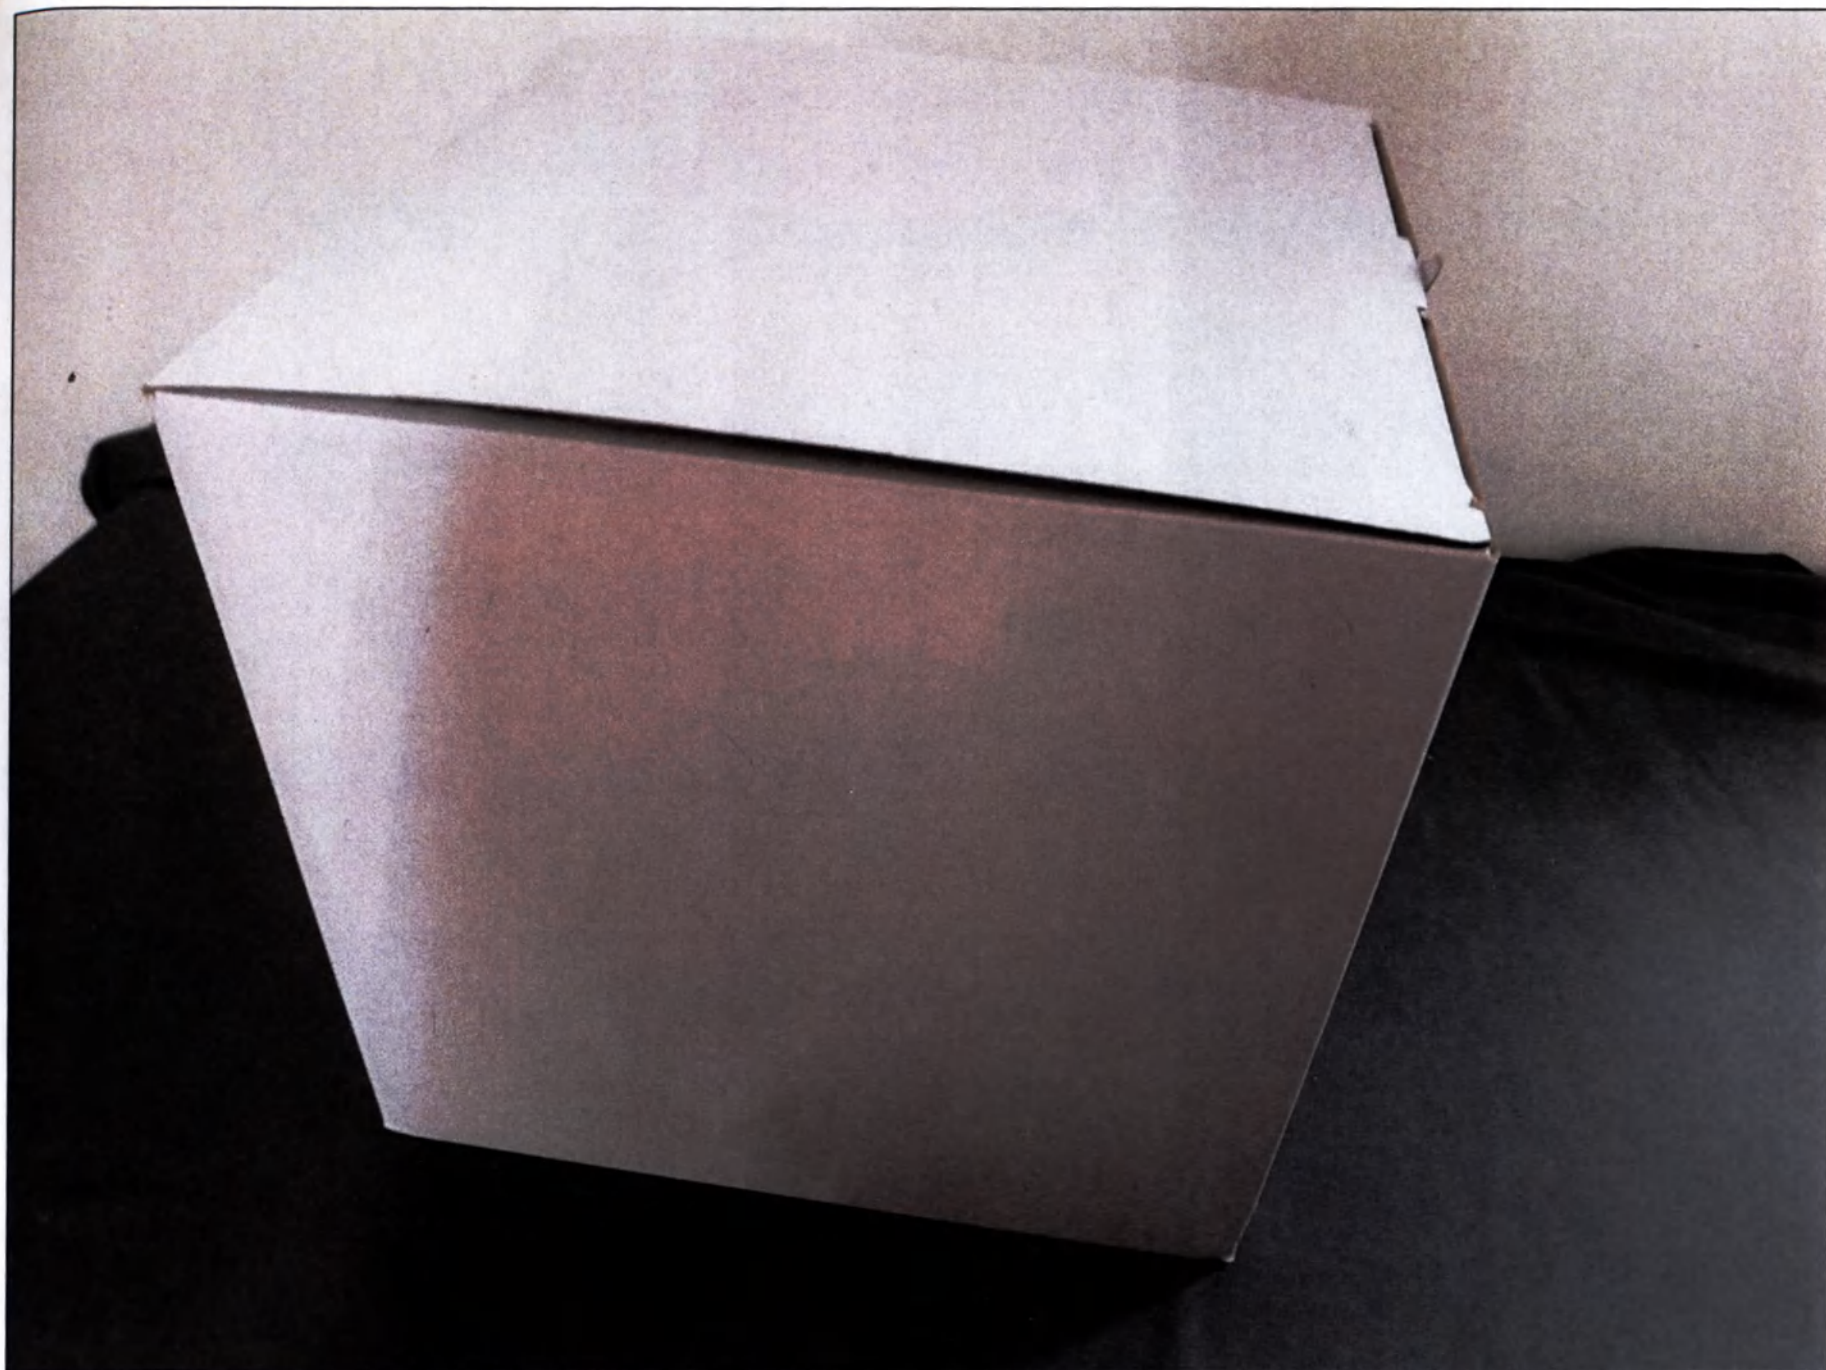


Рис. 2. Устройство для рентгенэндоваскулярных процедур ПОТОК в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-15624048-2021. Вторичная упаковка.

Устройство для рентгенэндоваскулярных
процедур ПОТОК СТ1 по ТУ
32.50.13-003-15624048-2021

Регистрационное удостоверение
№ ИВРРР от DD.MM.YYYY

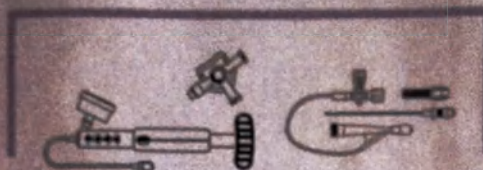

Состав:

1. Индифератор СТ, длина 20 см,
диаметр до 30 атм - 1 шт.
2. 3-канальный катетер - 1 шт.
3. У-образный тросик проводки - 1 шт.
4. Датчик давления - 1 шт.
5. Устройство для введения проводника - 1 шт.
6. Рамка - 1 шт.

Максимальное давление: 80 бар
Максимальная скорость: 20 мм

REF 617105

LOT SM621282

20210706

20240705



«Внимание! Осмотрите с
изготовителем по применению»

«Внимание! Не используйте
при повреждении упаковки»

Предупреждения и меры предосторожности:

В закрытой, неповрежденной упаковке содержимое стерильно и
апротектно. Только для однократного использования. Не стерилизуйте
модель на повторно. Производитель не несет ответственности за
любое использование в случае использования повторно
предназначенного изделия.

Организация с ограниченной ответственностью «МЭДИСОР»
420104, Республика Татарстан, г. Казань, проспект Габдуллы, д. 40Б, кв. 40.
Телефон: +7(843)7070009
Электронная почта:
medisor@medisor.ru
Материалы: медицинский
Состав: медицинский
420104, Республика Татарстан, г. Казань, проспект Габдуллы, д. 40Б, кв. 40.
Телефон: +7(843)7070009
Электронная почта:
medisor@medisor.ru
Материалы: медицинский
Состав: медицинский




Рис. 4. Устройство для рентгенэндоваскулярных процедур ПОТОК СТ1 по ТУ 32.50.13-003-15624048-2021, в составе. Маркировка на первичной упаковке.

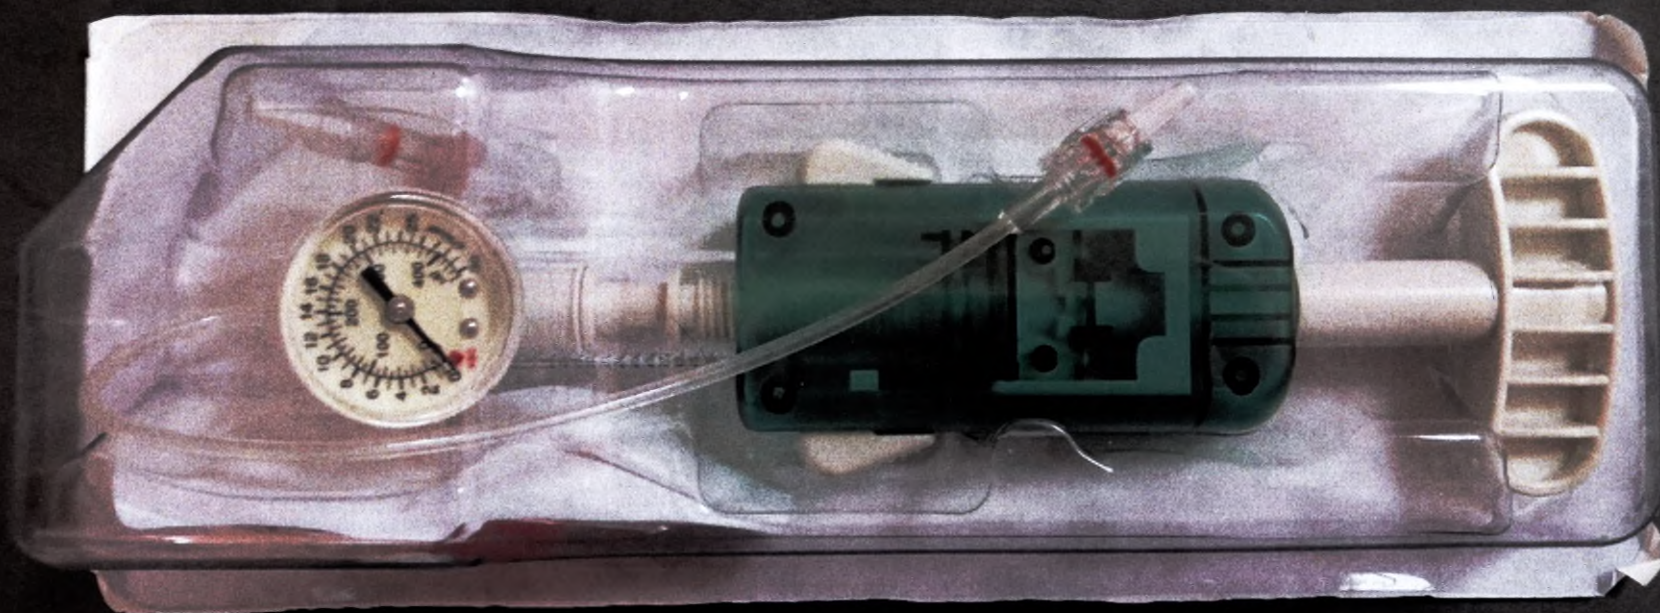


Рис. 5. Устройство для рентгенэндоваскулярных процедур ПТОК СТ1 по ТУ 32.50.13-003-15624048-2021, в составе. Первичная упаковка.



Рис. 6. Индефлятор СТ, объем 20 мл, давление до 30 атм

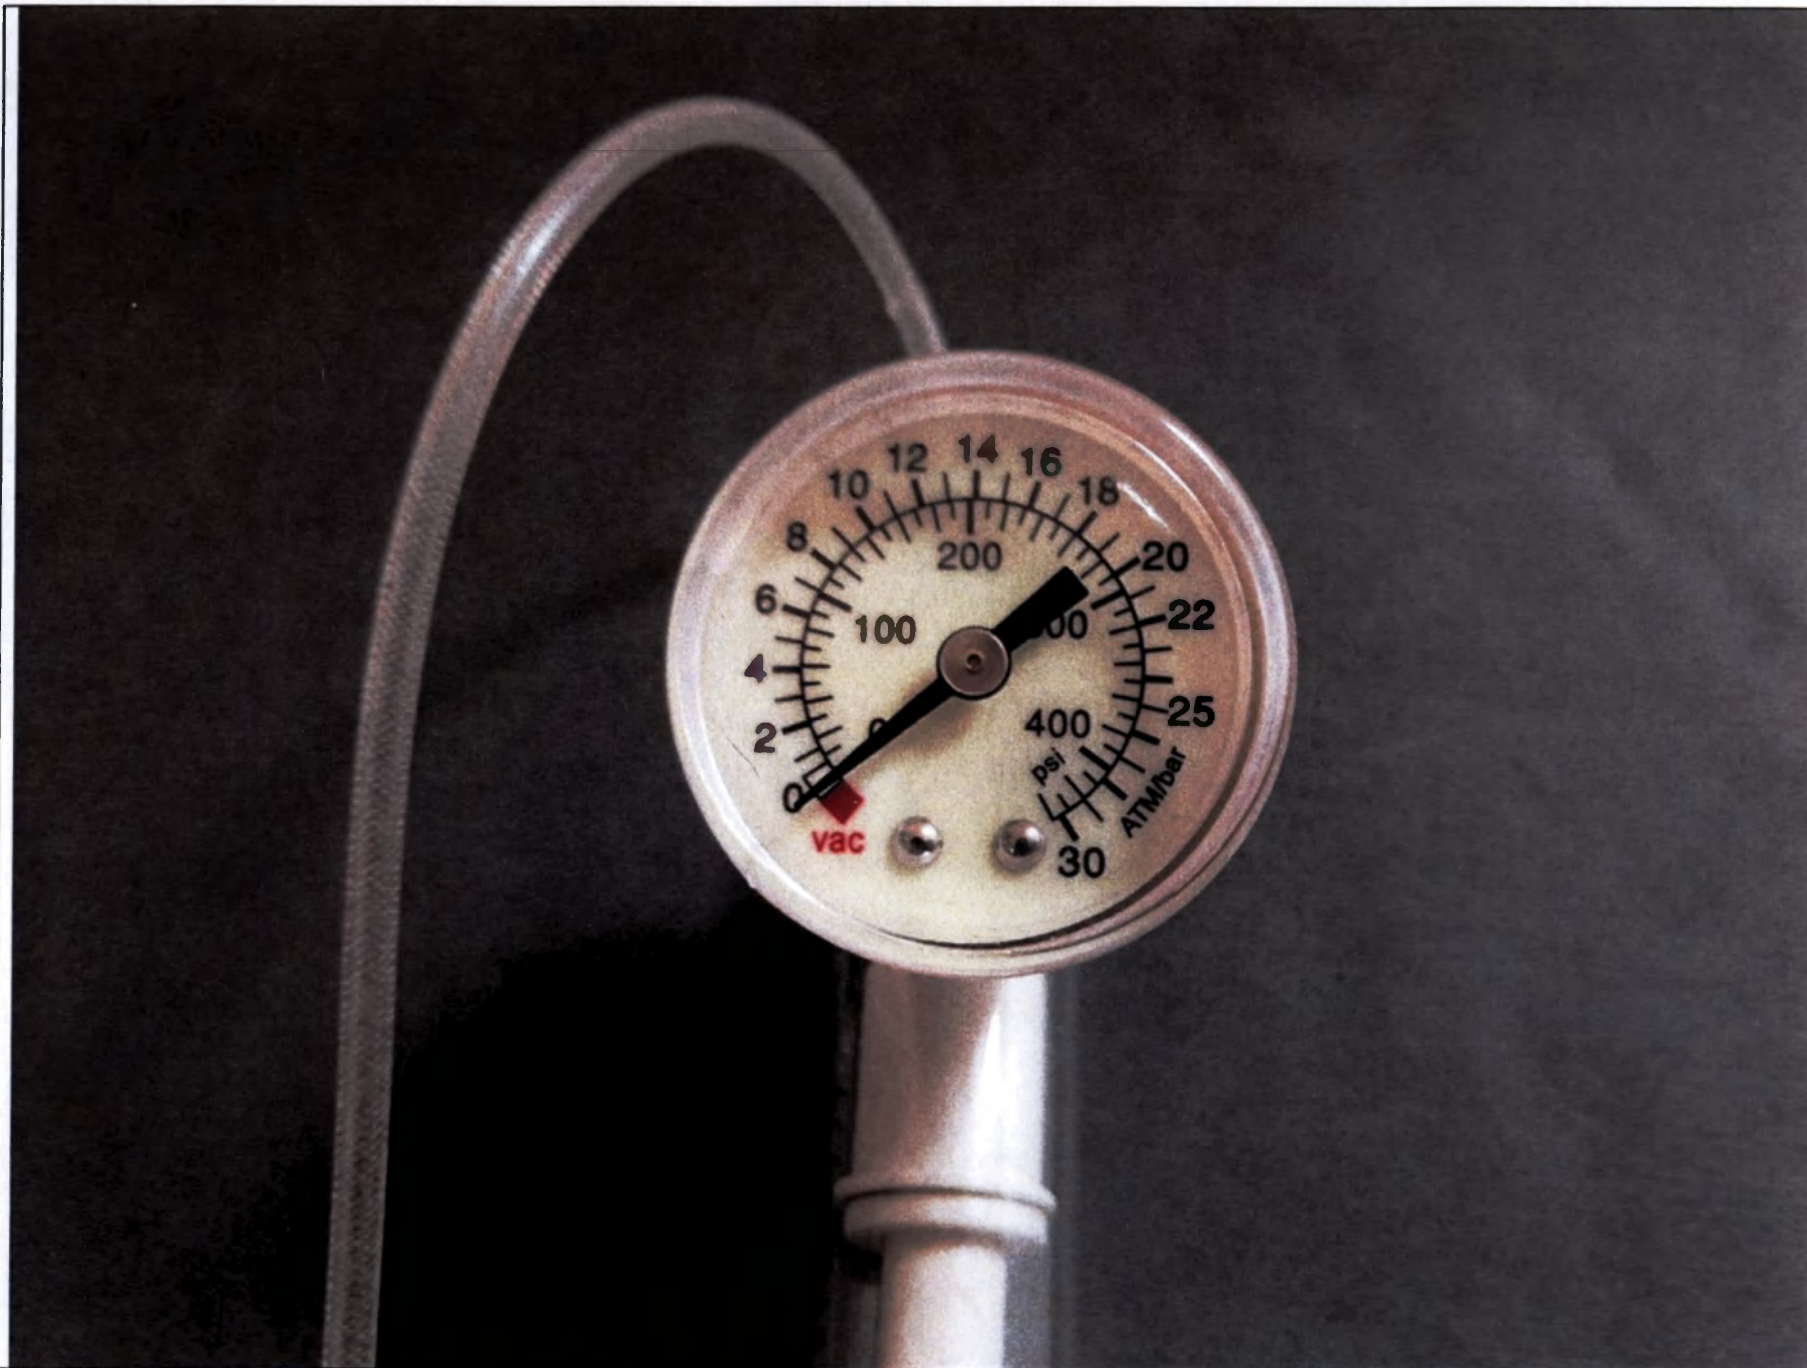


Рис. 7. Индефлятор СТ, объем 20 мл, давление до 30 атм.



Рис. 8. 3-ходовой кран

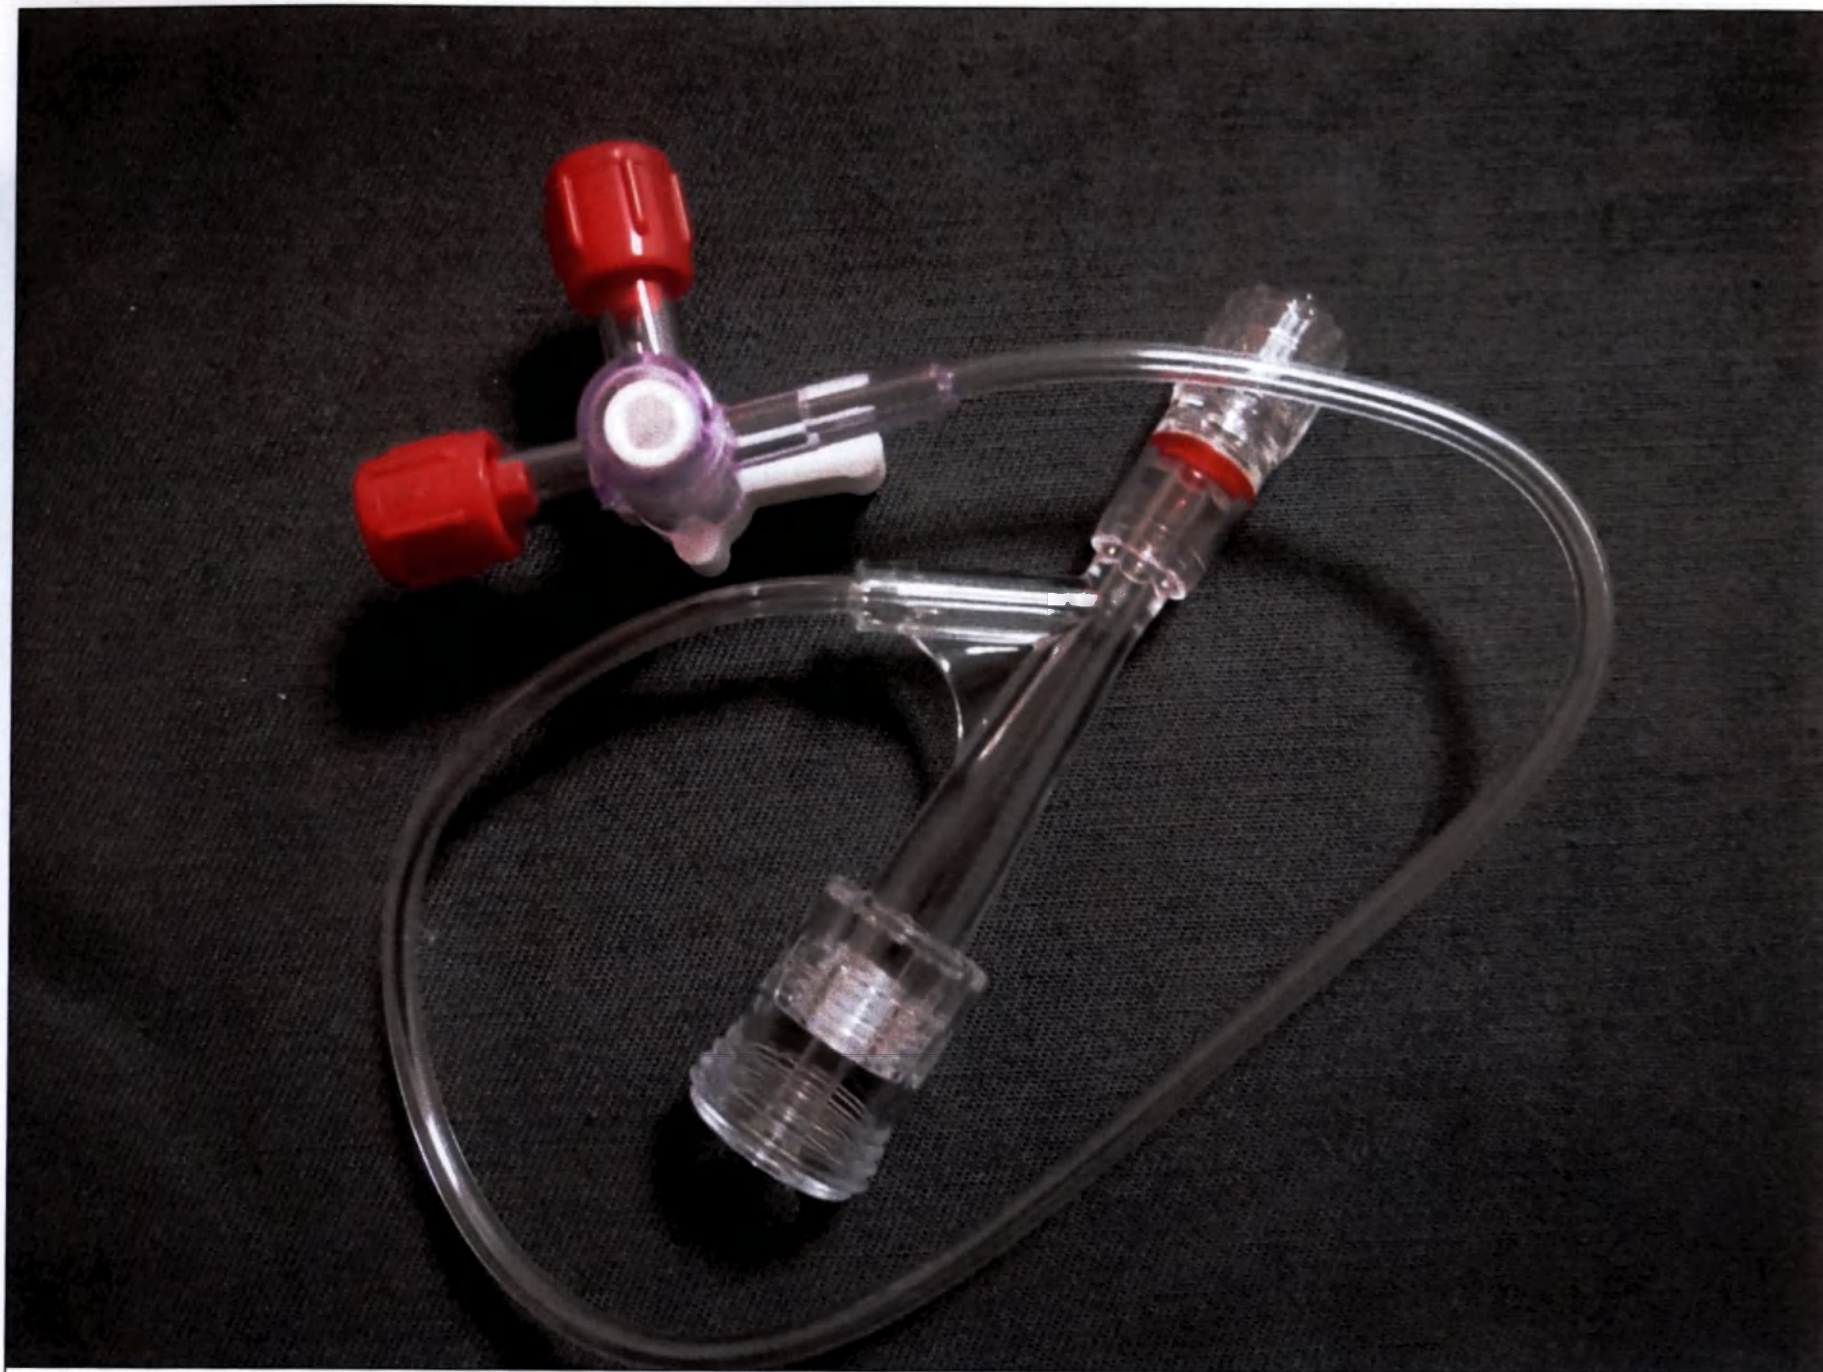


Рис. 9. Y-коннектор типа пуш-пул

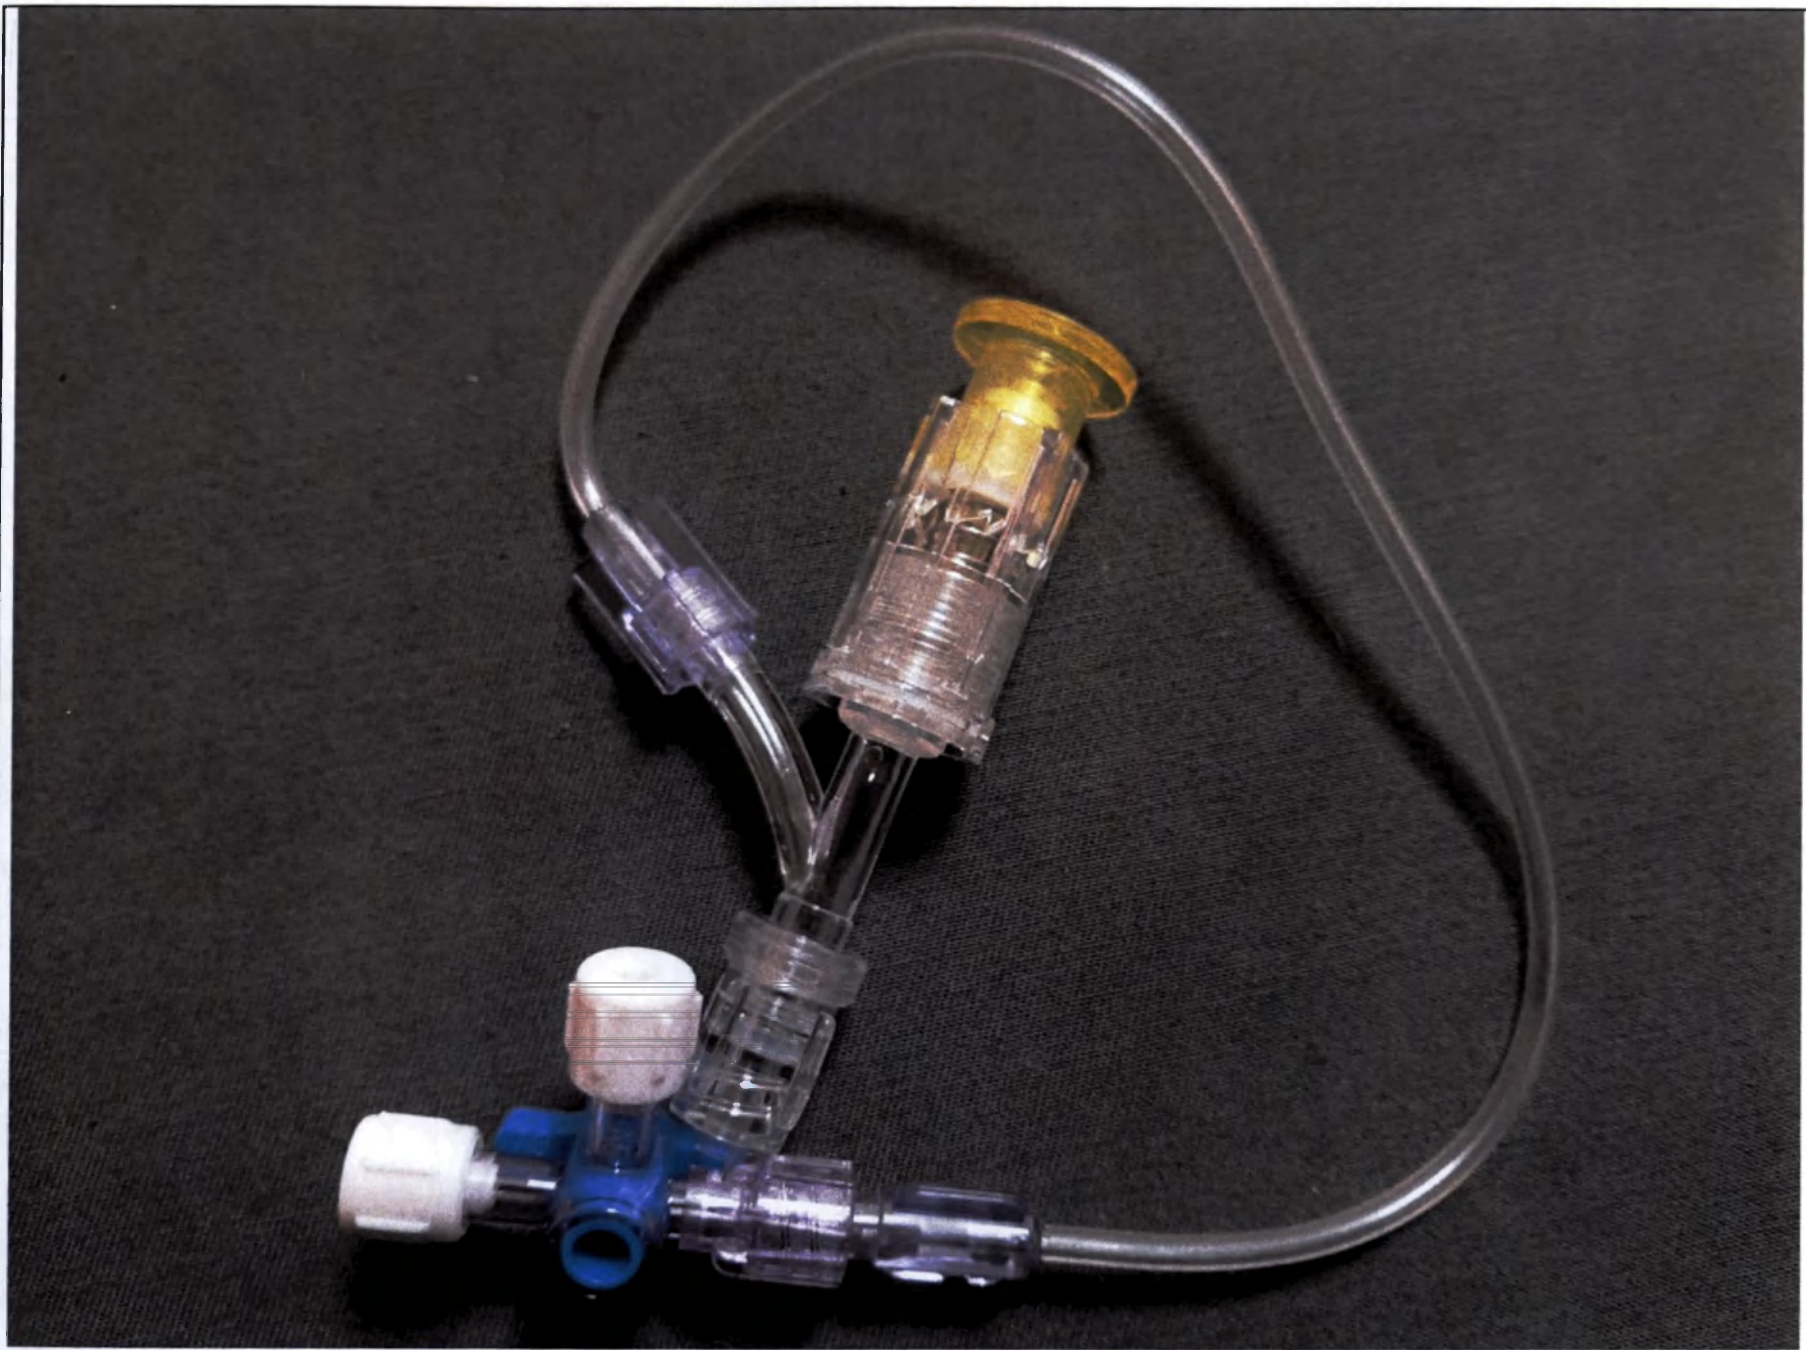


Рис. 10. Y-коннектор типа пуш-клик с боковой линией



Рис. 11. Устройство для введения проводника



Рис. 12. Торкер

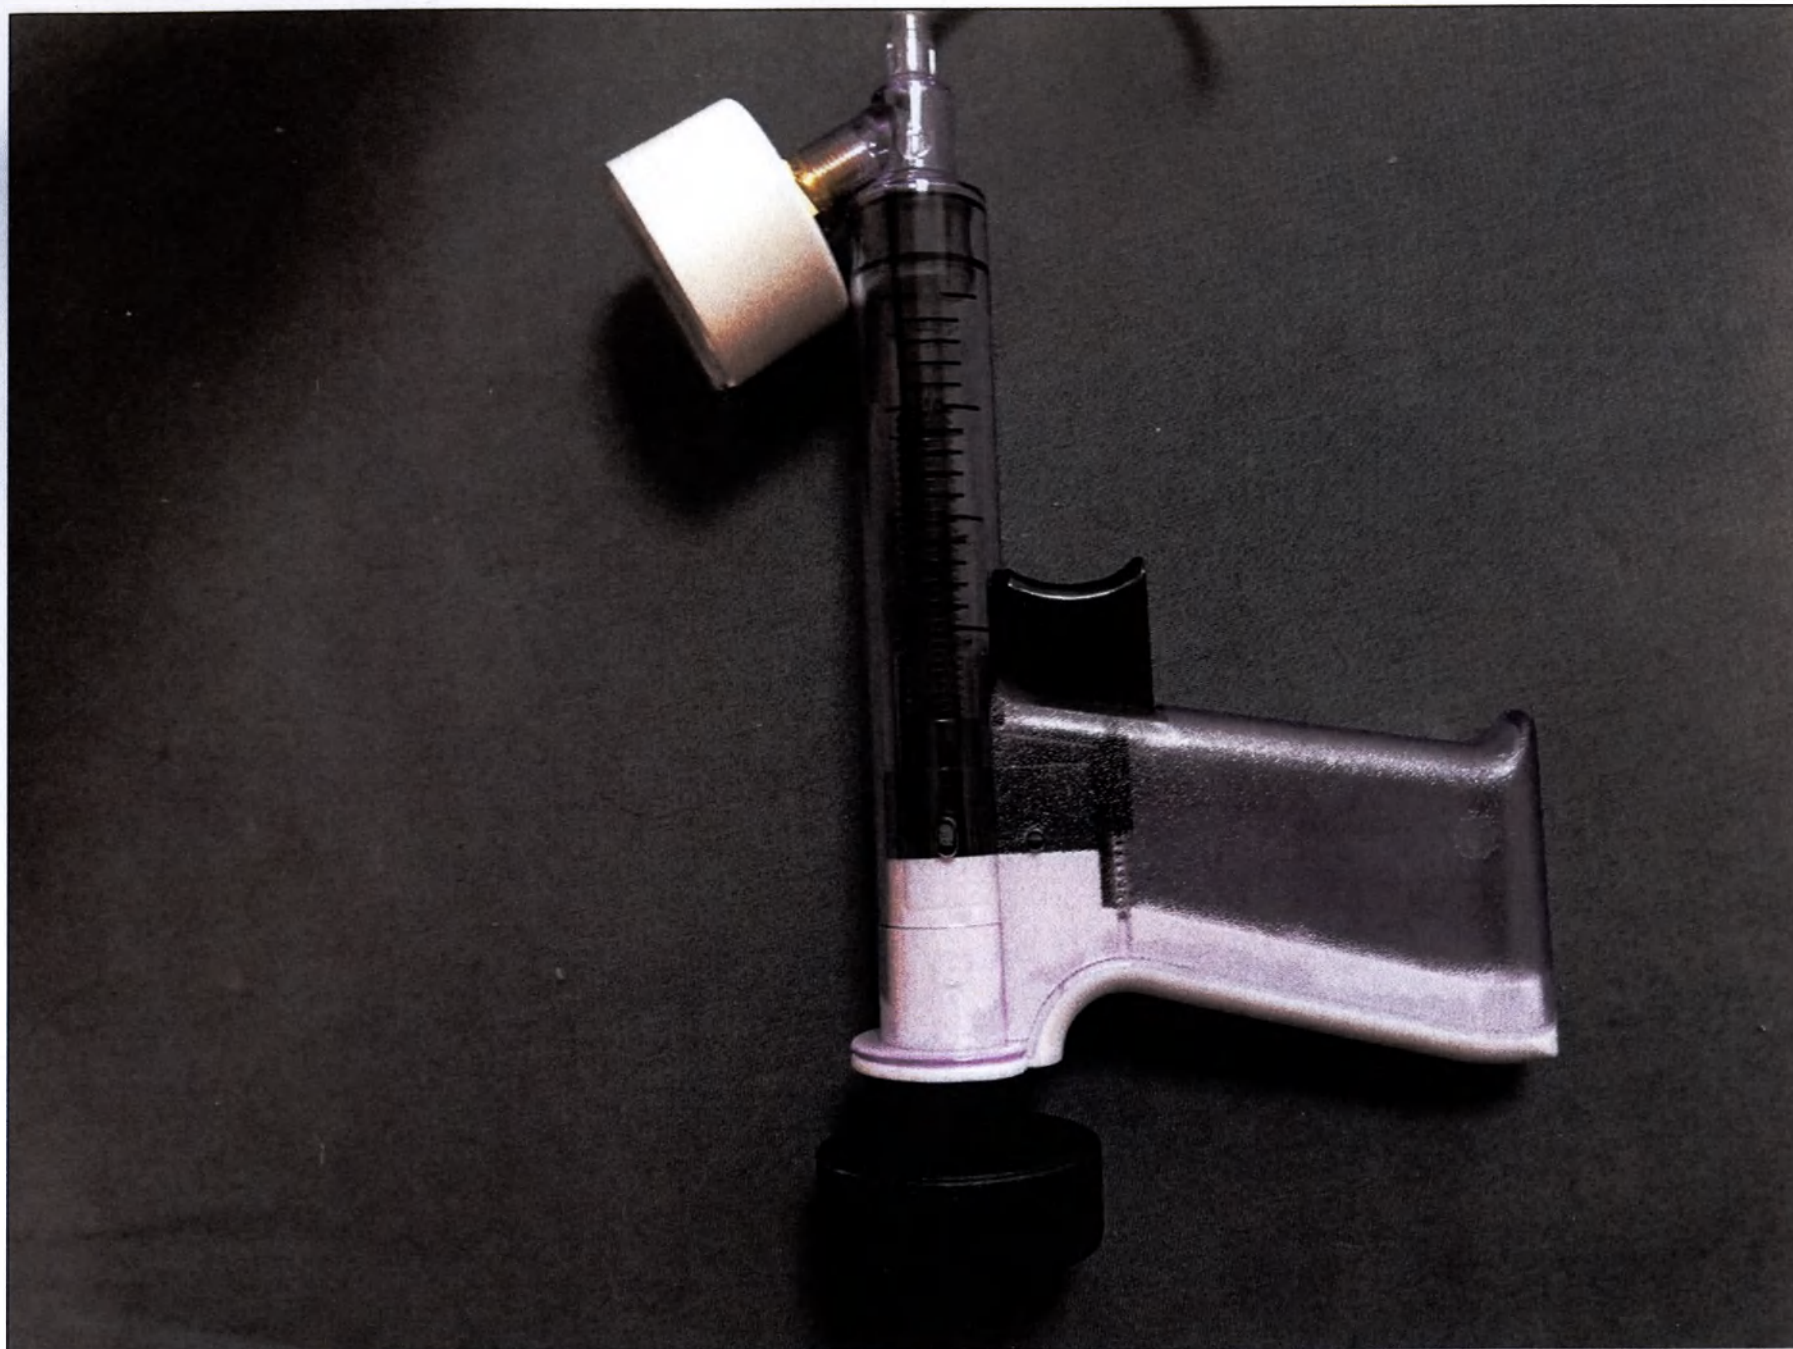


Рис. 13. Устройство для рентгенэндоваскулярных процедур ПОТОК GT1 по ТУ 32.50.13-003-15624048-2021



Рис. 14. Устройство для рентгенэндоваскулярных процедур ПОТОК SGT1 по ТУ 32.50.13-003-15624048-2021

Устройство для рентгенэндоваскулярных процедур
ПОТОК 5GT2 по ТУ 32.50.13-003-15624048-2021
Регистрационное удостоверение № ВР8988 от 09.08.2021


Максимальное давление: 30 бар
Максимальная мощность: 20 Вт

Состав:

1. Радиочастотный генератор (RCG) - 1 шт.
2. 5-метровый кабель - 1 шт.
3. 7-метровый кабель для чреспищеводного введения - 1 шт.
4. Кабель для чреспищеводного введения - 1 шт.
5. Устройство для введения катетера - 1 шт.
6. Терморегулятор - 1 шт.

Предупреждения и меры предосторожности:

«Вскрытия, непереносимости, аллергии, отека легких, кровотечения, инсульта, инфаркта миокарда, тромбоза, эмболии, пневмонии, абсцесса, перитонита, сепсиса, почечной недостаточности, гипотонии, брадикардии, остановки сердца, смерти». Препараты не имеют противопоказаний к применению. Препараты не имеют противопоказаний к применению. Препараты не имеют противопоказаний к применению.



617127 20210706

00621282 20240705

Общество с ограниченной ответственностью «Медсервис»
430138, Республика Татарстан, г. Казань, проспект
Победы, д. 48Б, кв. 4Б.
Телефон: +7(843)7876029
Официальный сайт:
Электронная почта:

Место производства:
Shanghai Medical Co., Ltd [Shanghai Medical Co., Ltd]
1018 3rd road, 1018 Industrial Zone, Pingtan Town,
Ningbo City, Ningbo, Zhejiang, China
Сделано в Китае



Рис. 15. Устройство для рентгенэндоваскулярных процедур ПОТОК в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-15624048-2021.
Маркировка на вторичной упаковке.

Всего прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 15 листов (-а)
Генеральный директор ООО «МЕДИКОР»
Протасова А.А.

