

ООО «МЕДИКОР»

Организация

420138, Республика Татарстан, г. Казань, проспект
Победы, д. 466, кв. 46.

Адрес

Генеральный директор

Должность

Протасова А.А.

Фамилия, Имя

22 сентября 2021 г.
Дата ДД.ММ.ГГГГ

Подпись



Фотографические изображения

Материалы расходные для рентгенэндоваскулярных процедур по ТУ 32.50.13-005-15624048-2021.

2021



Рис. 1. Материалы расходные для рентгенэндоваскулярных процедур по ТУ 32.50.13-005-15624048-2021. Транспортная упаковка.


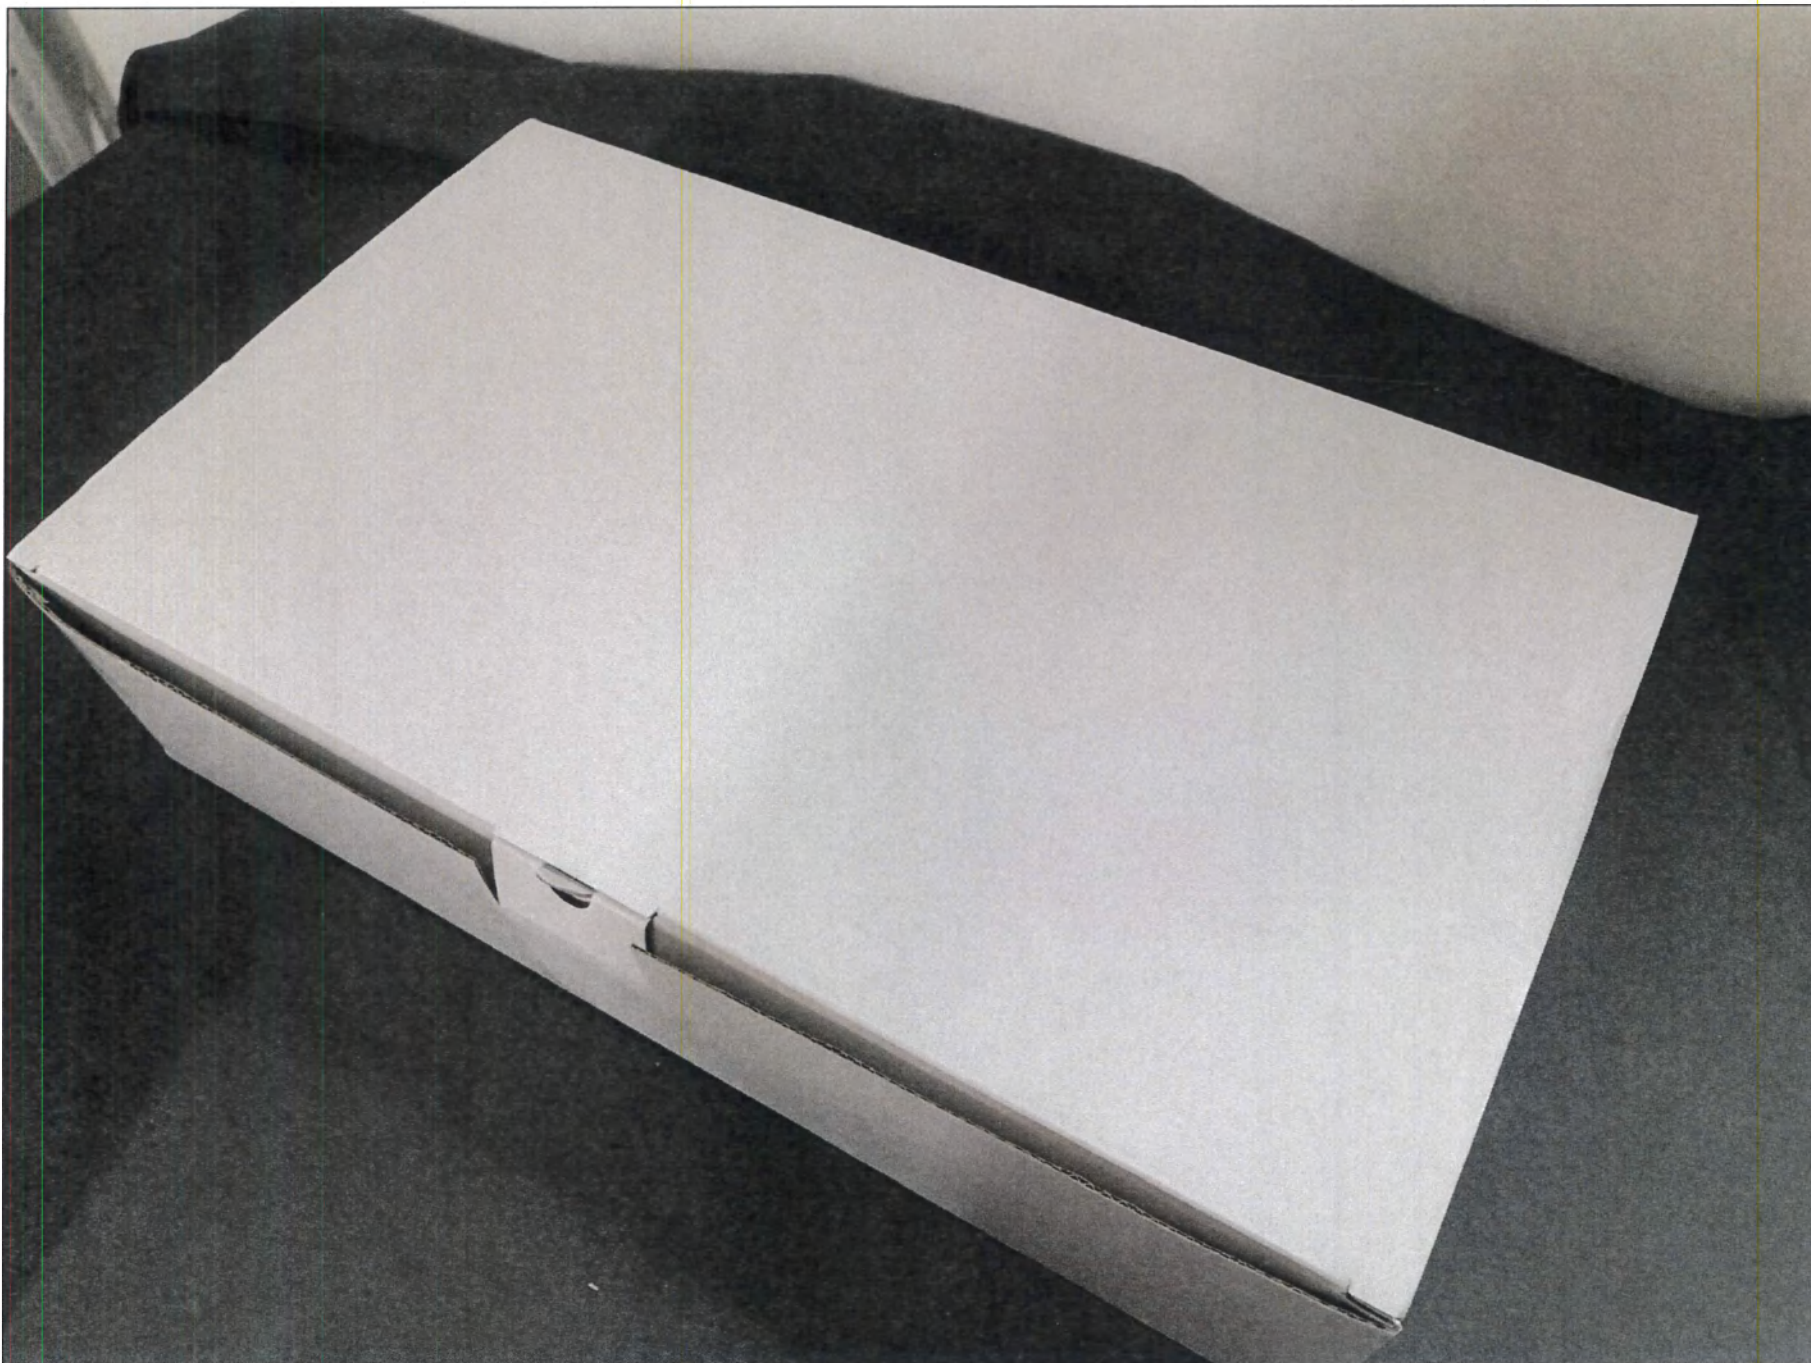


Рис. 2. Система гемостатического клапана, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-005-15624048-2021. Вторичная упаковка.

Игла ангиографическая, длина
3.8 см, диаметр 21G по ТУ
32.50.13-005-15624048-2021

Регистрационное удостоверение
от DD.MM.YYYY



REF 630008 20210703

LOT SM621276 20240702



Общество с ограниченной
ответственностью «МЕДИКОР»
420138, Республика Татарстан, г. Казань,
проспект Победы, д. 46б, кв. 46
Телефон: +79167676029
Официальный сайт:
Электронная почта:

Место производства:
Shunmei Medical Co., Ltd
(Шунмей Медикал Ко., Лтд)
Yifa 3rd road, Yifa Industrial Zone, Pingtan
Town, Huiyang District, Huizhou,
Guangdong, China
Сделано в Китае



Рис. 3. Система гемостатического клапана, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-005-15624048-2021. Маркировка на вторичной упаковке.

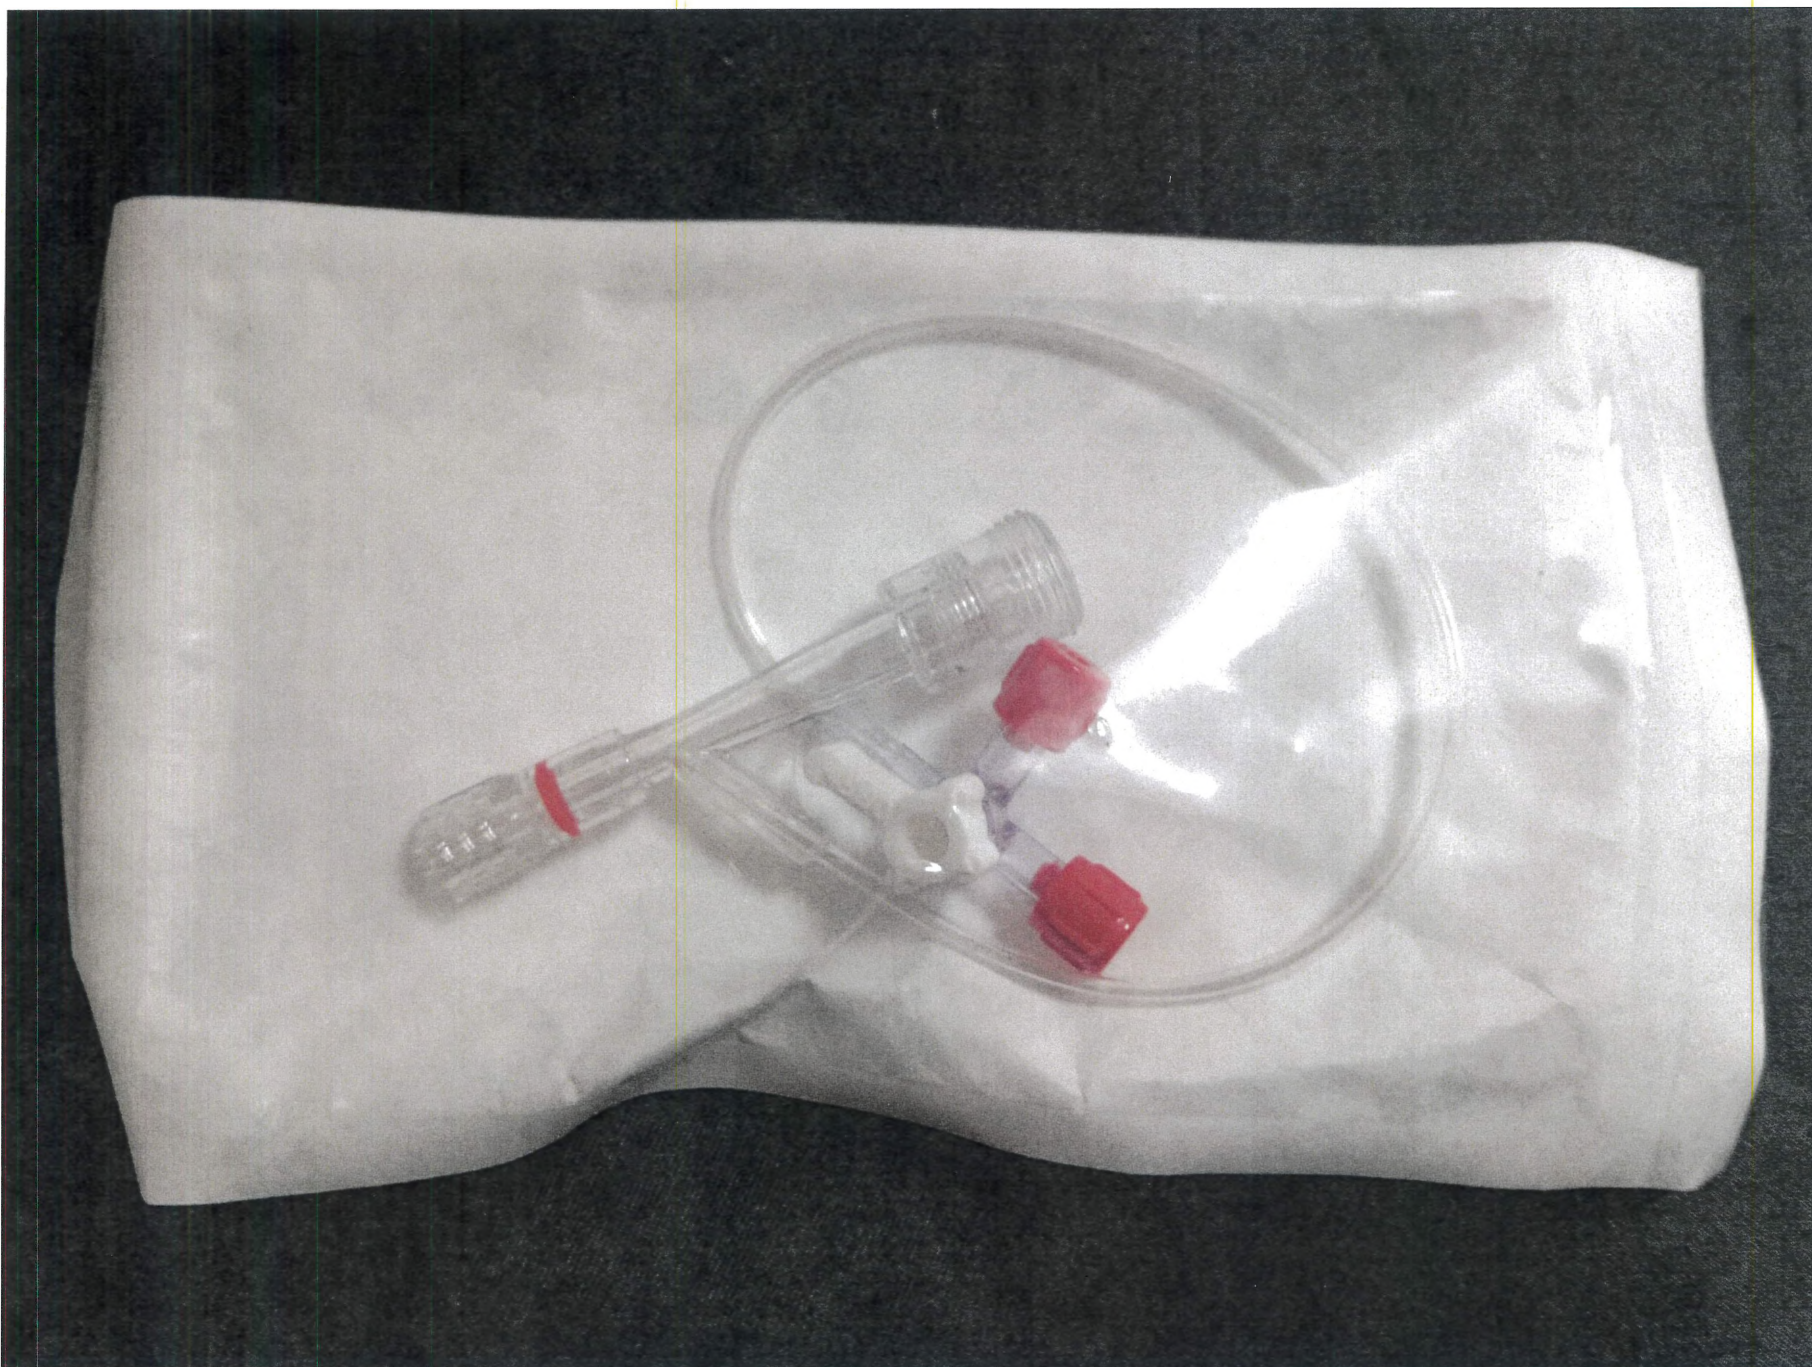


Рис. 5. Система гемостатического клапана типа пуш-пул по ТУ 32.50.13-005-15624048-2021, в составе. Первичная упаковка.

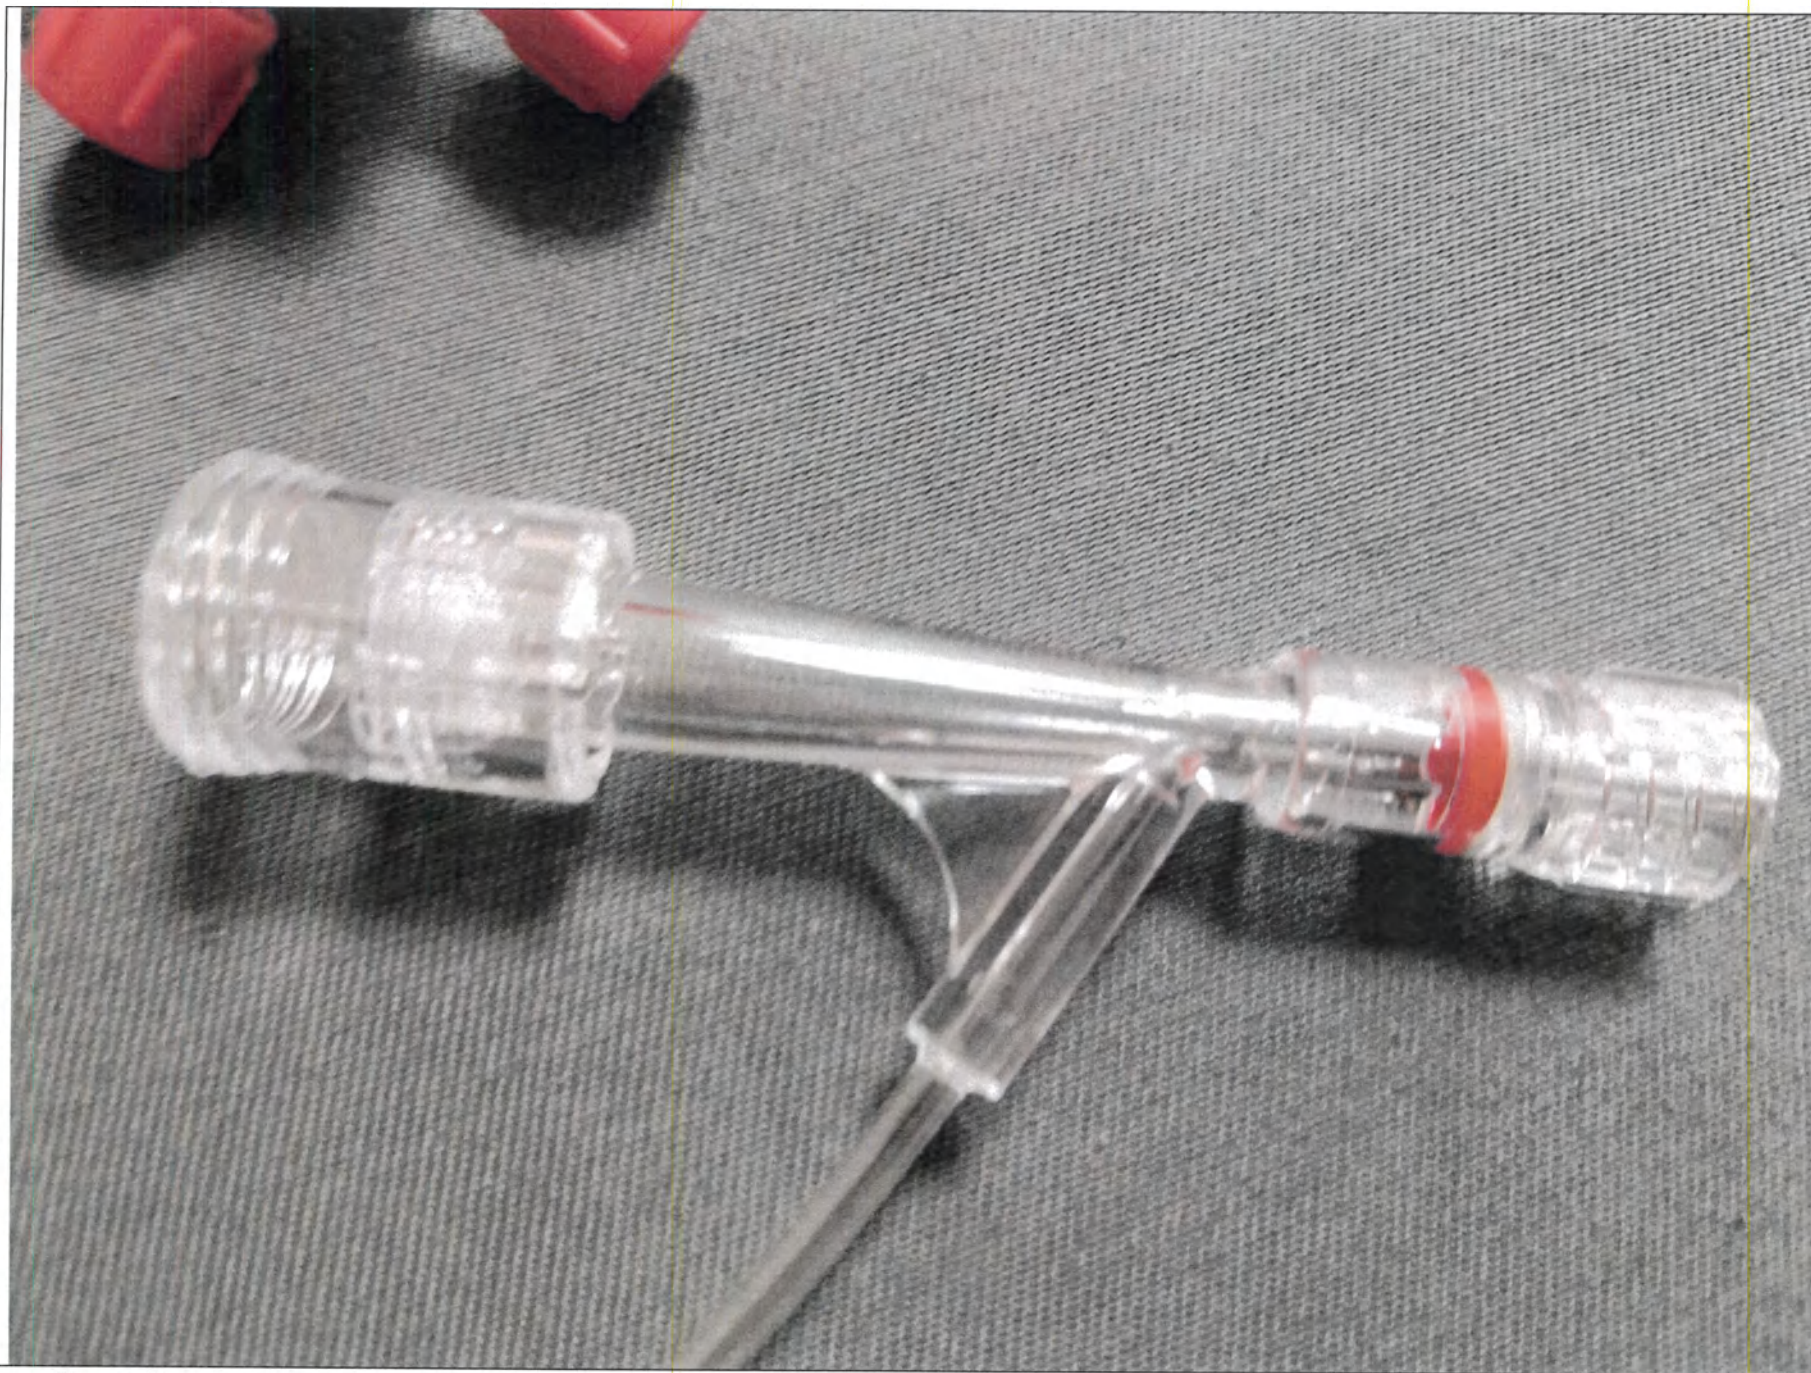


Рис. 6. Y-коннектор типа пуш-пул

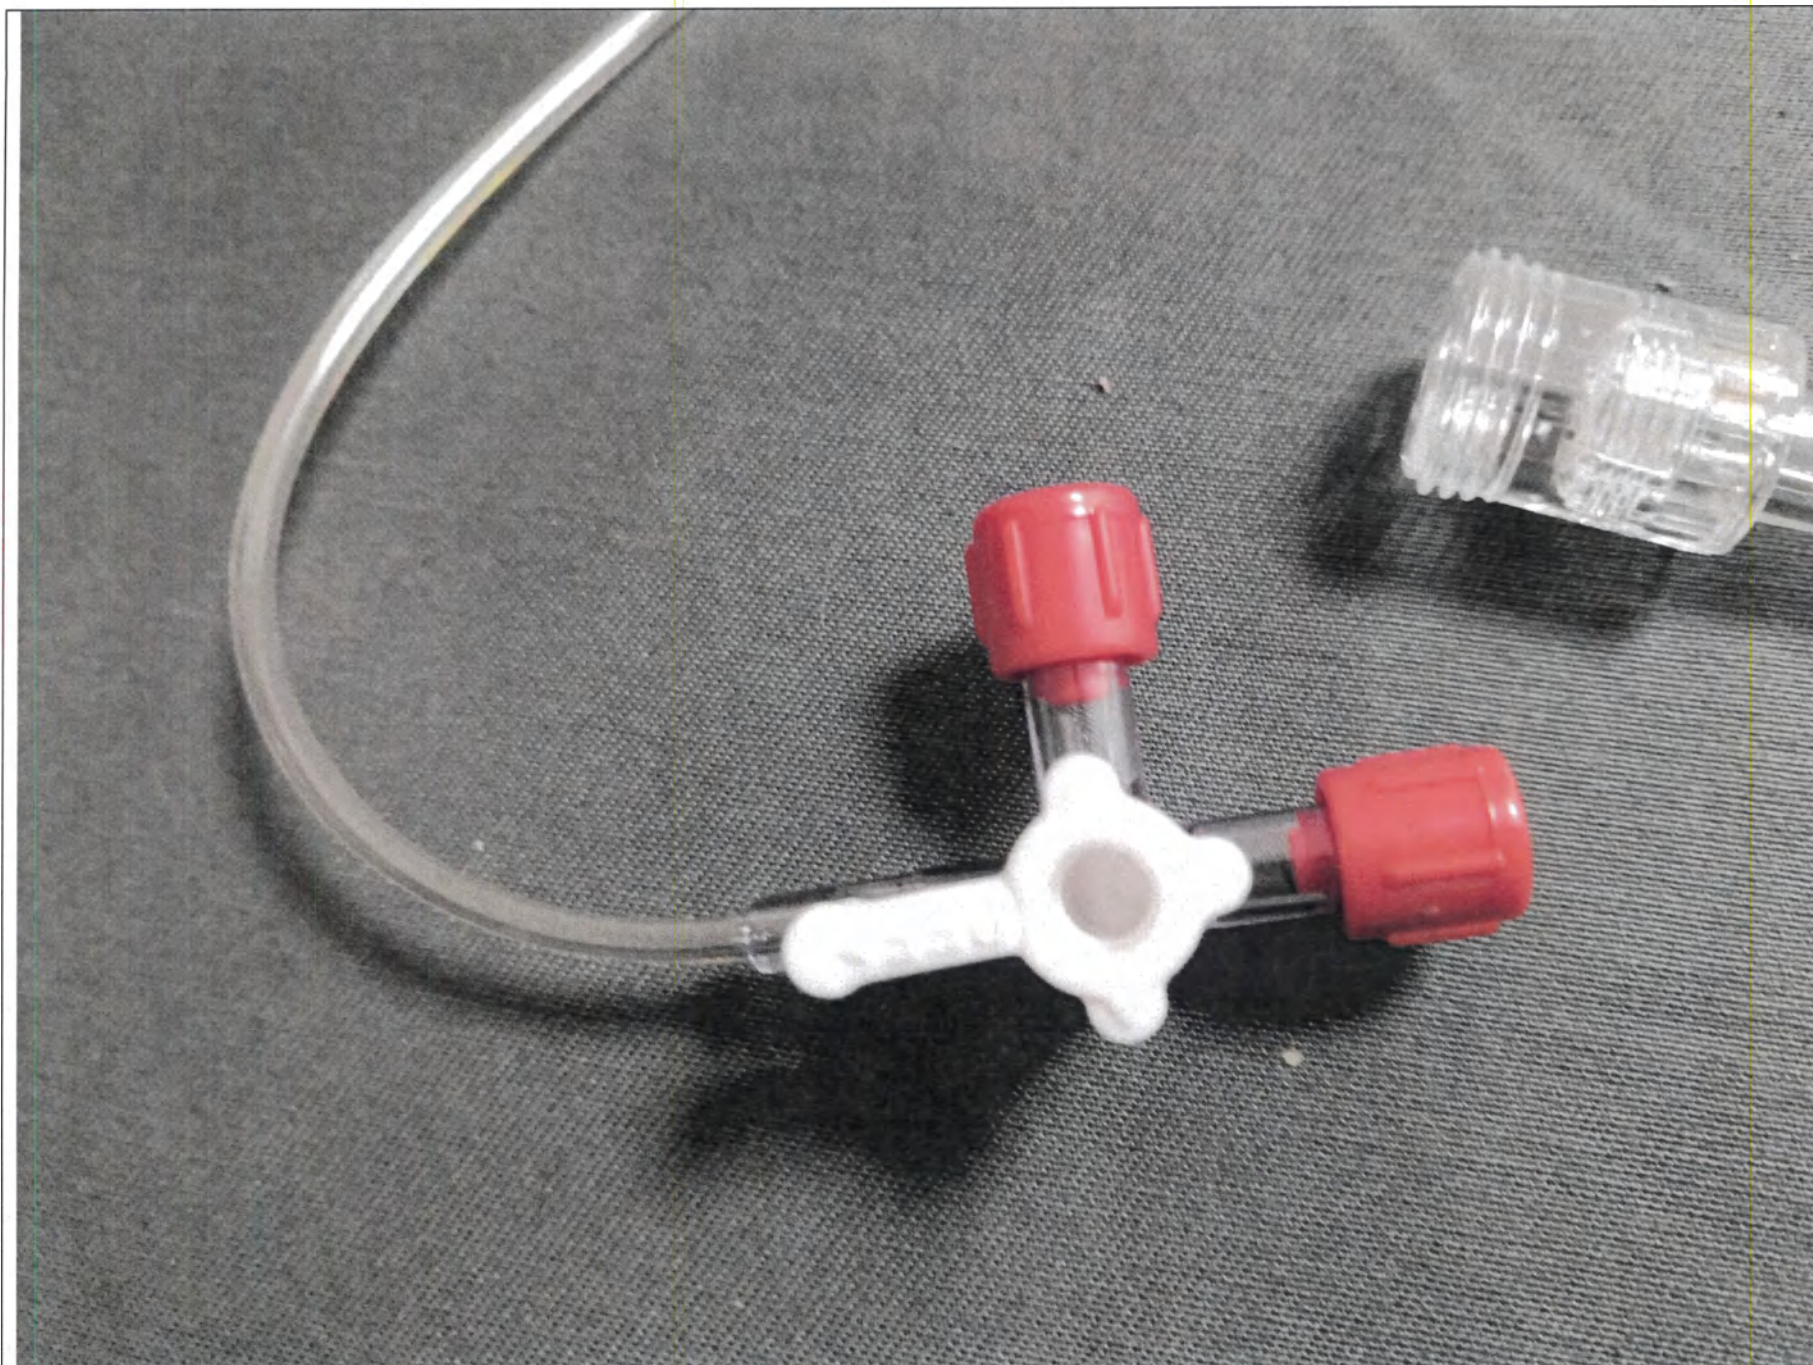


Рис. 7. Боковая линия с краником, длина 25 см

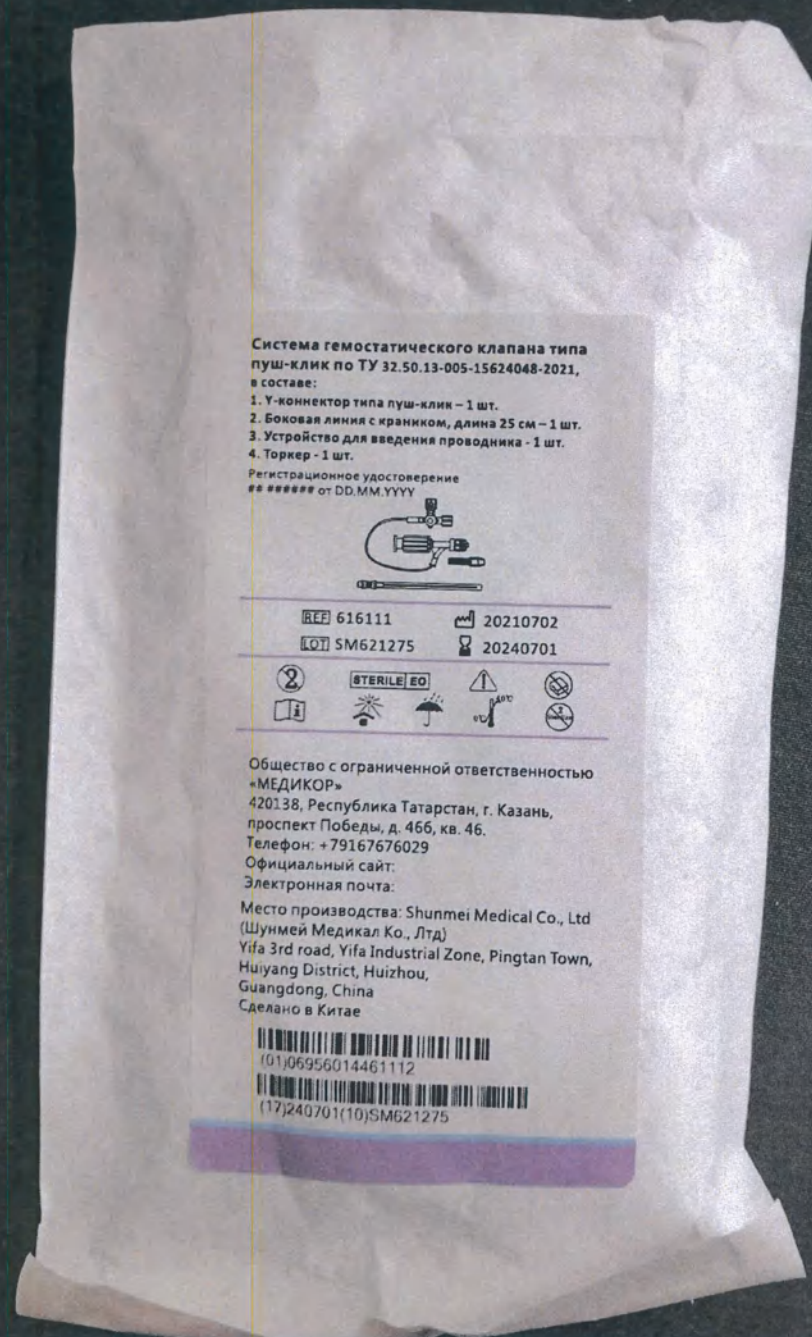


Рис. 8. Система гемостатического клапана типа пуш-клик по ТУ 32.50.13-005-15624048-2021, в составе.

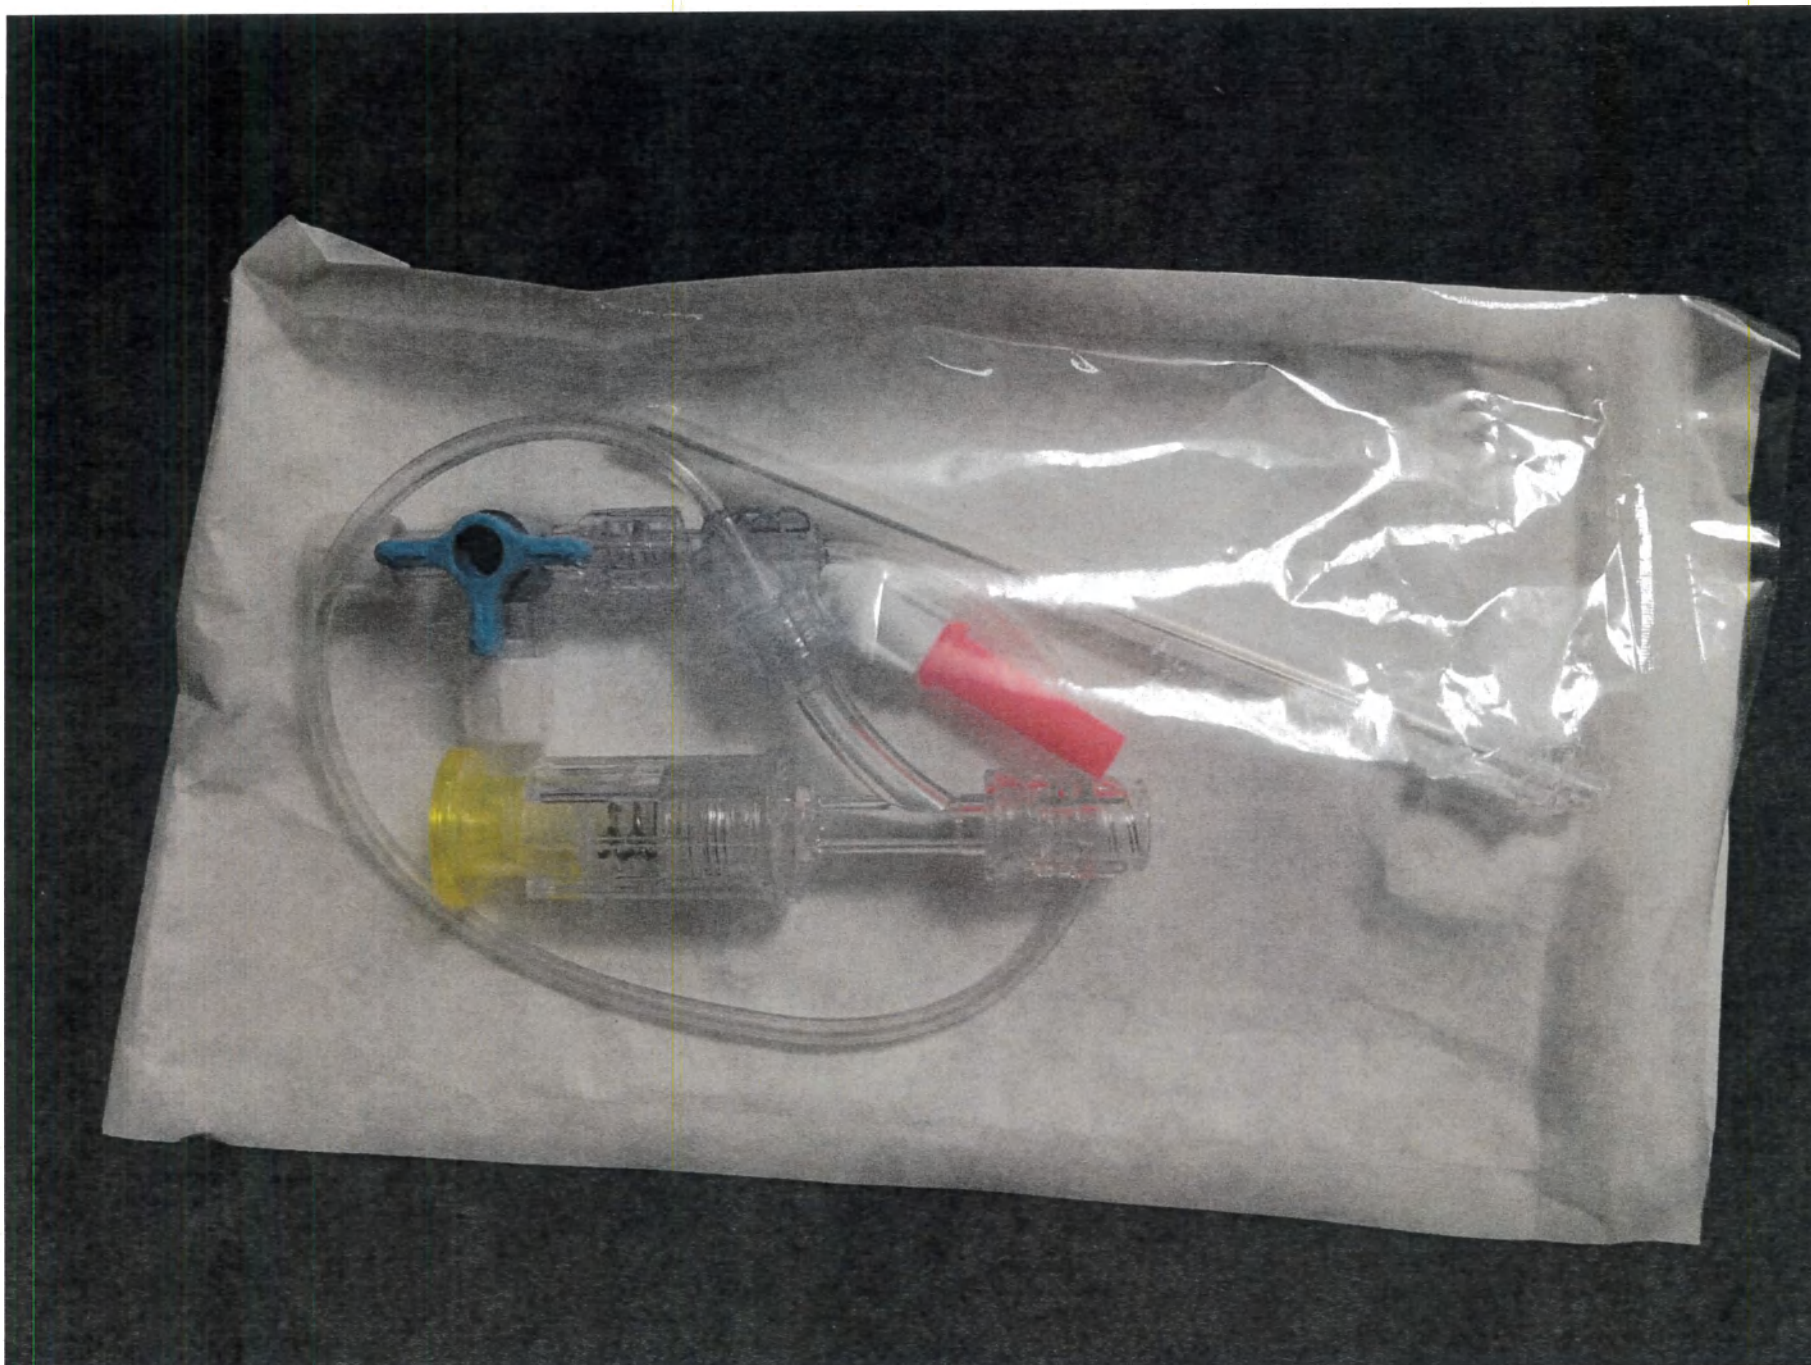


Рис. 9. Система гемостатического клапана типа пуш-клик по ТУ 32.50.13-005-15624048-2021, в составе. Первичная упаковка.

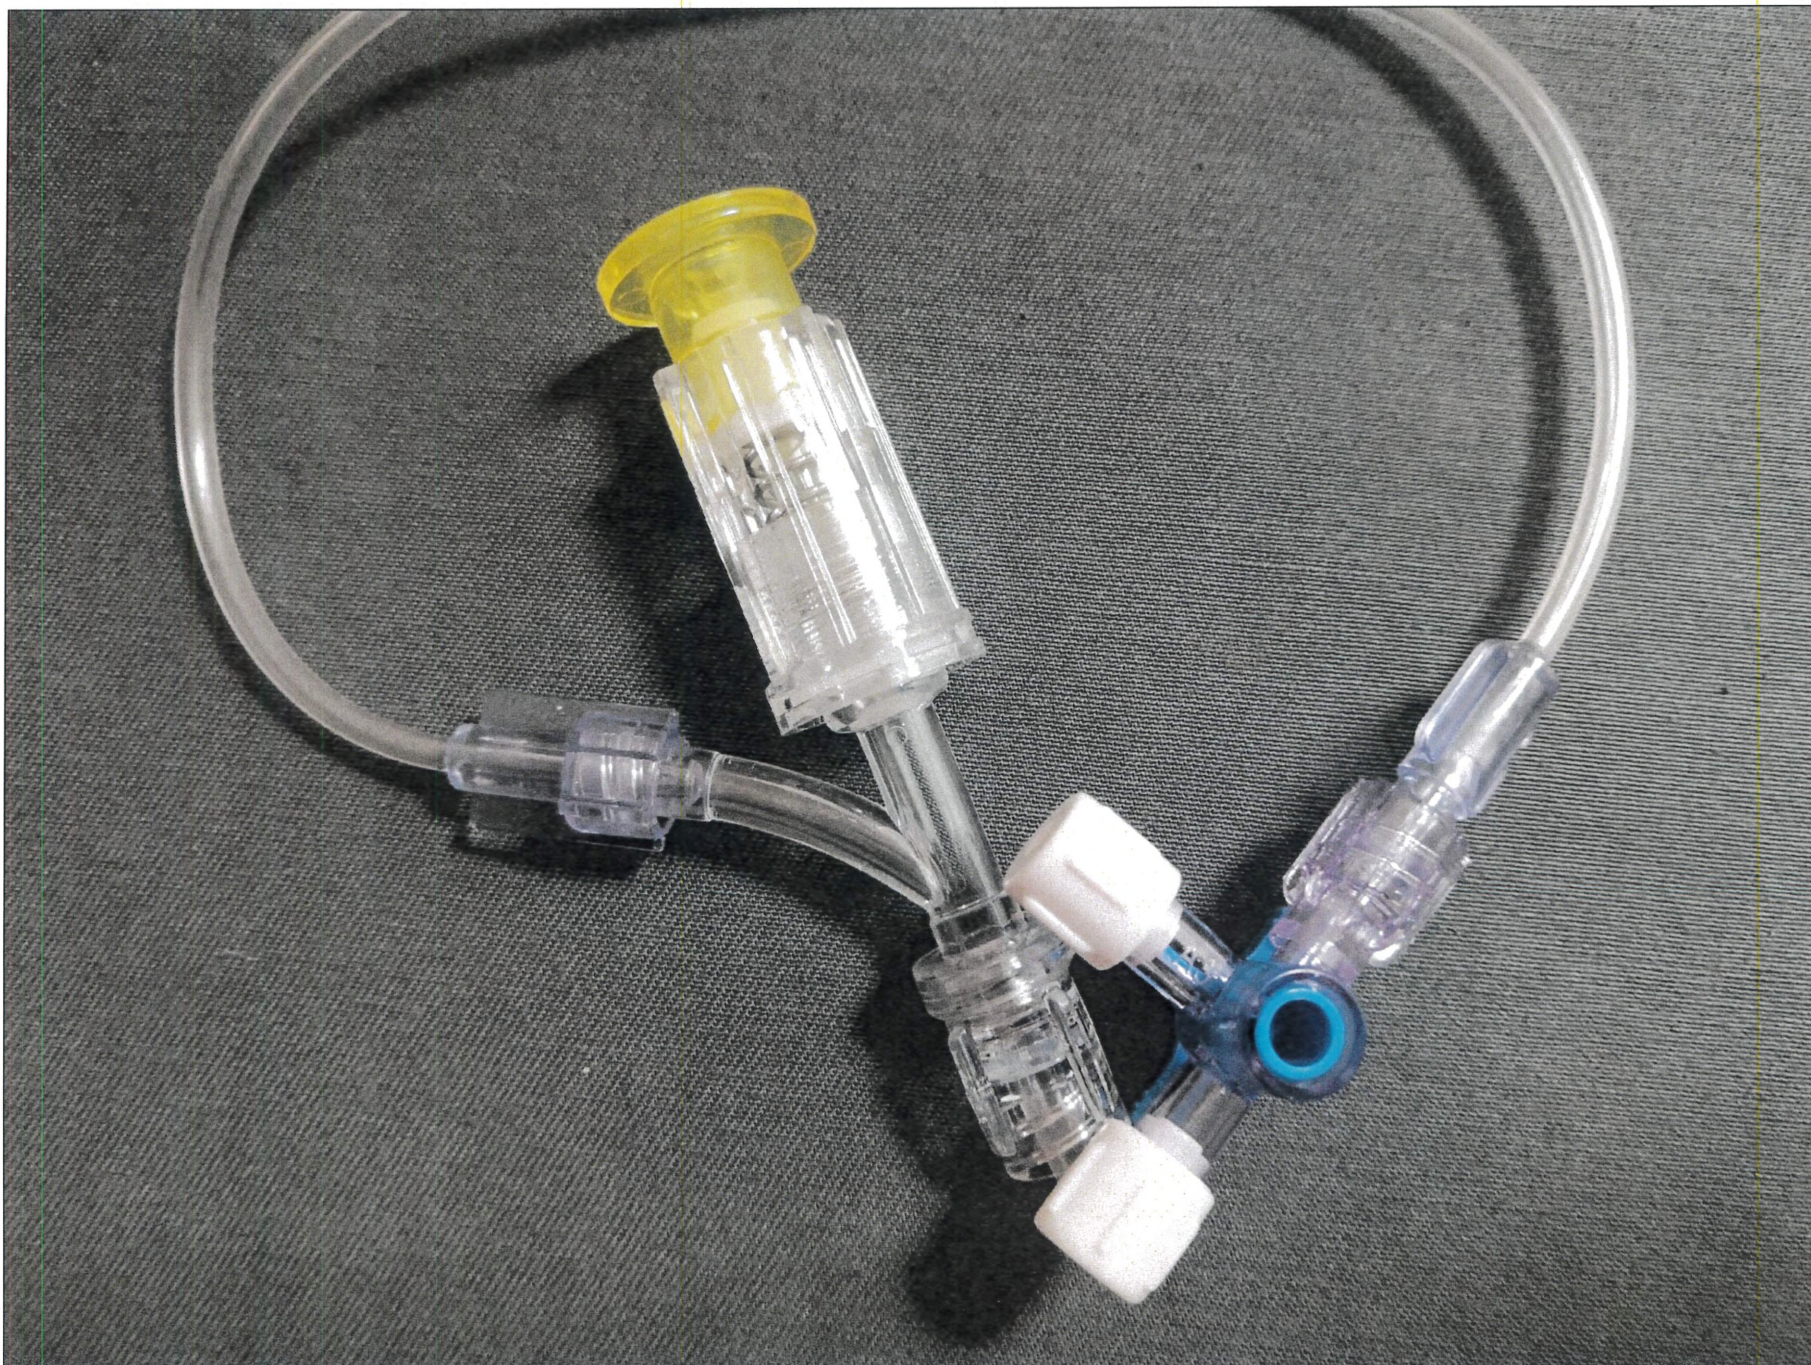


Рис. 10. Y-коннектор типа пуш-клик

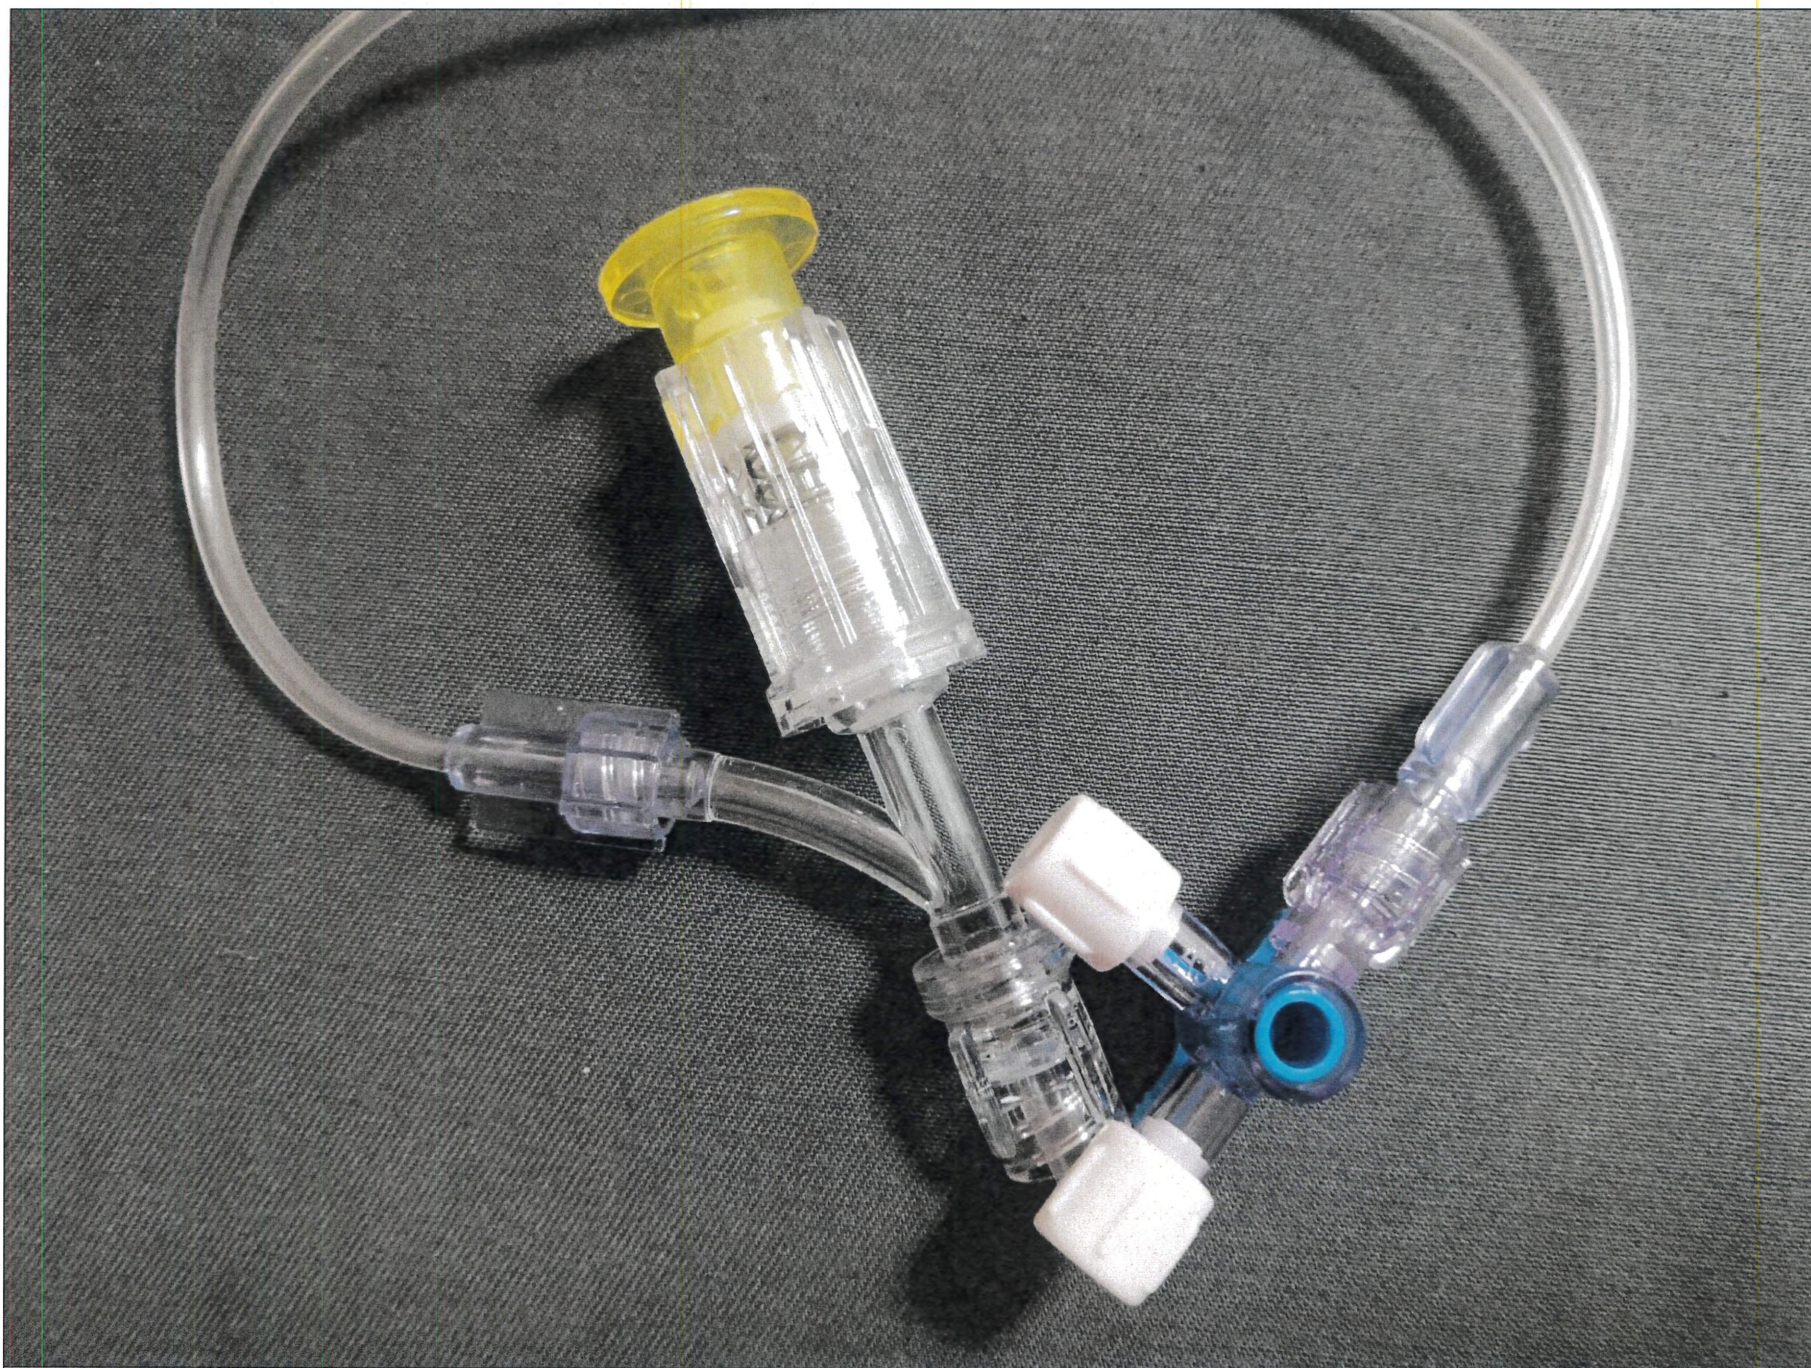


Рис. 11. Боковая линия с краником, длина 25 см

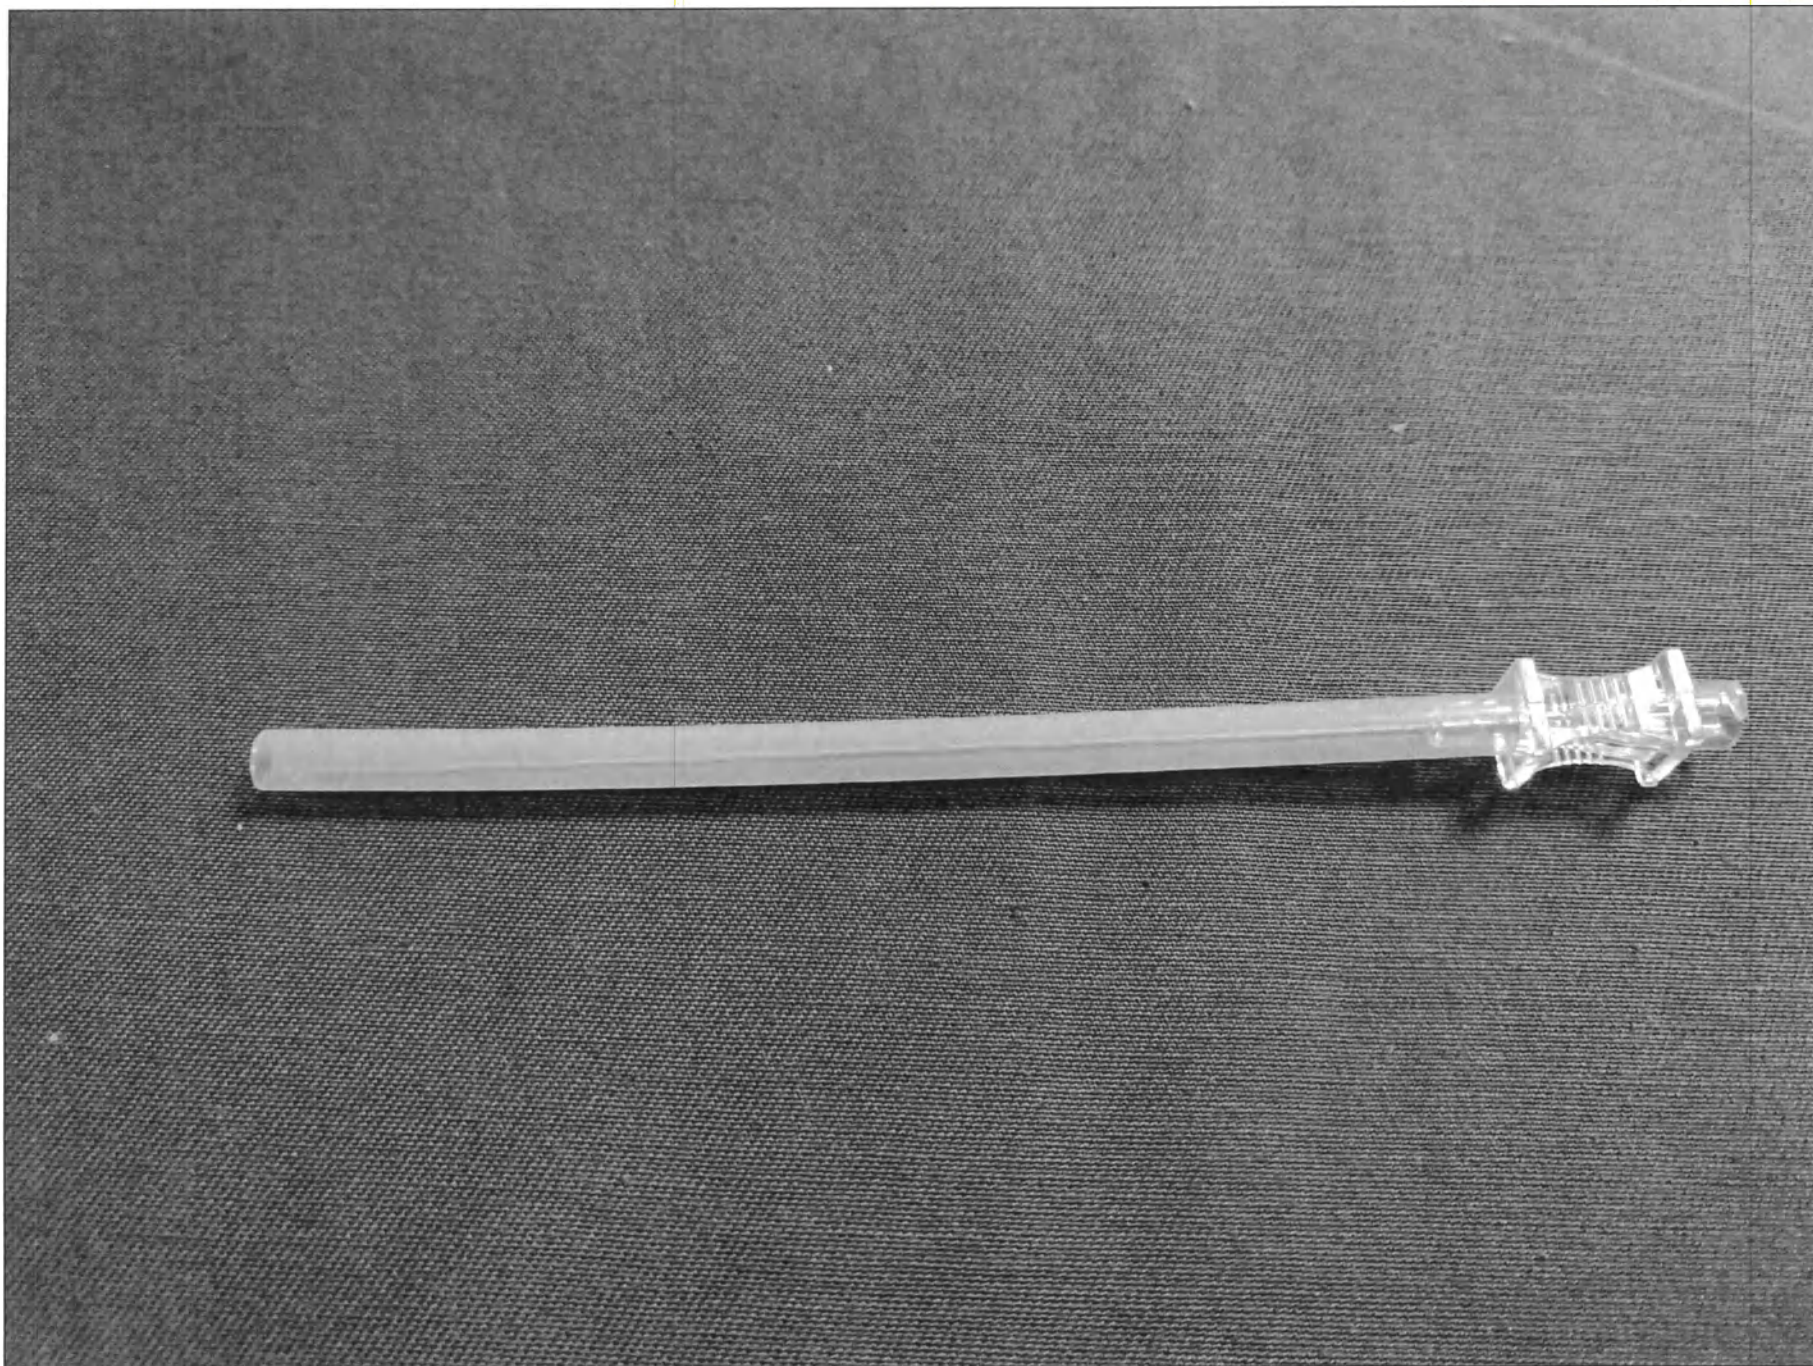


Рис. 12. Устройство для введения проводника - 1 шт


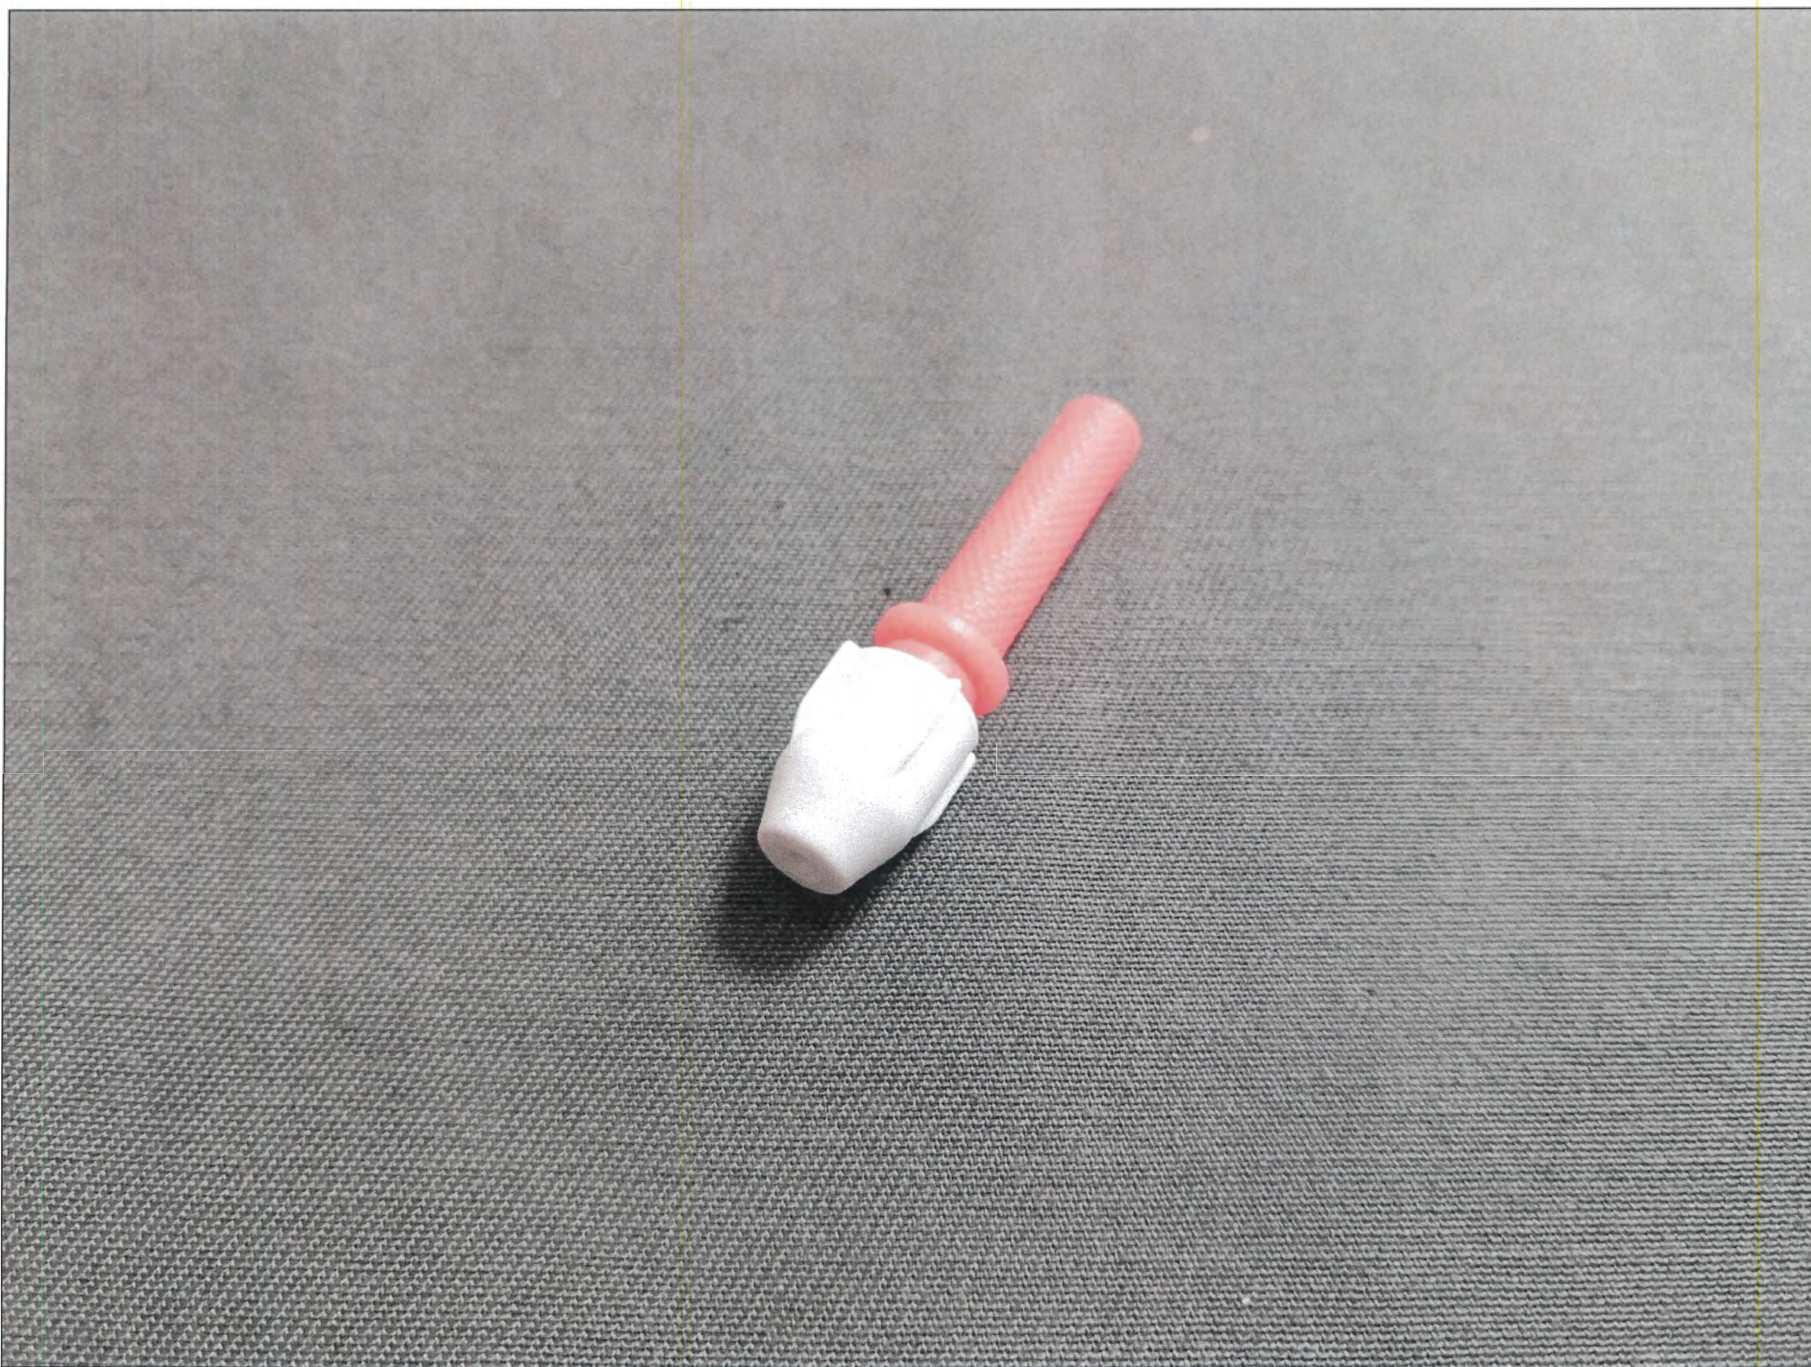



Рис. 13. Торкер

3-х ходовой кран высокого давления
по ТУ 32.50.13-005-15624048-2021

Регистрационное удостоверение
№ 000000 от DD.MM.YYYY



Предупреждения:
1. Срок сохранения стерильности 3 года. пожалуйста, подтвердите дату стерилизации перед использованием, запрещено использование с истекшим сроком годности. 2. Этот продукт является одноразовым продуктом, категорически запрещается повторная стерилизация, повторное использование.



REF 614102 20210708
LOT SM621276 20240702

Общество с ограниченной
ответственностью «МЕДИКОР»
420138, Республика Татарстан, г.
Казань, проспект Победы, д. 466,
кв. 46.

Телефон: +79167676029

Официальный сайт:

Электронная почта:

Место производства:

Shunmei Medical Co., Ltd

(Шунмэй Медикал Ко., Лтд)

Yifa 3rd road, Yifa Industrial Zone,

Pingtian Town, Huiliang District,

Huizhou, Guangdong, China

Сделано в Китае



101100956014441022



(17)240702 (000000) 0000

Рис. 14. 3-х ходовой кран высокого давления по ТУ 32.50.13-005-15624048-2021. Первичная упаковка.

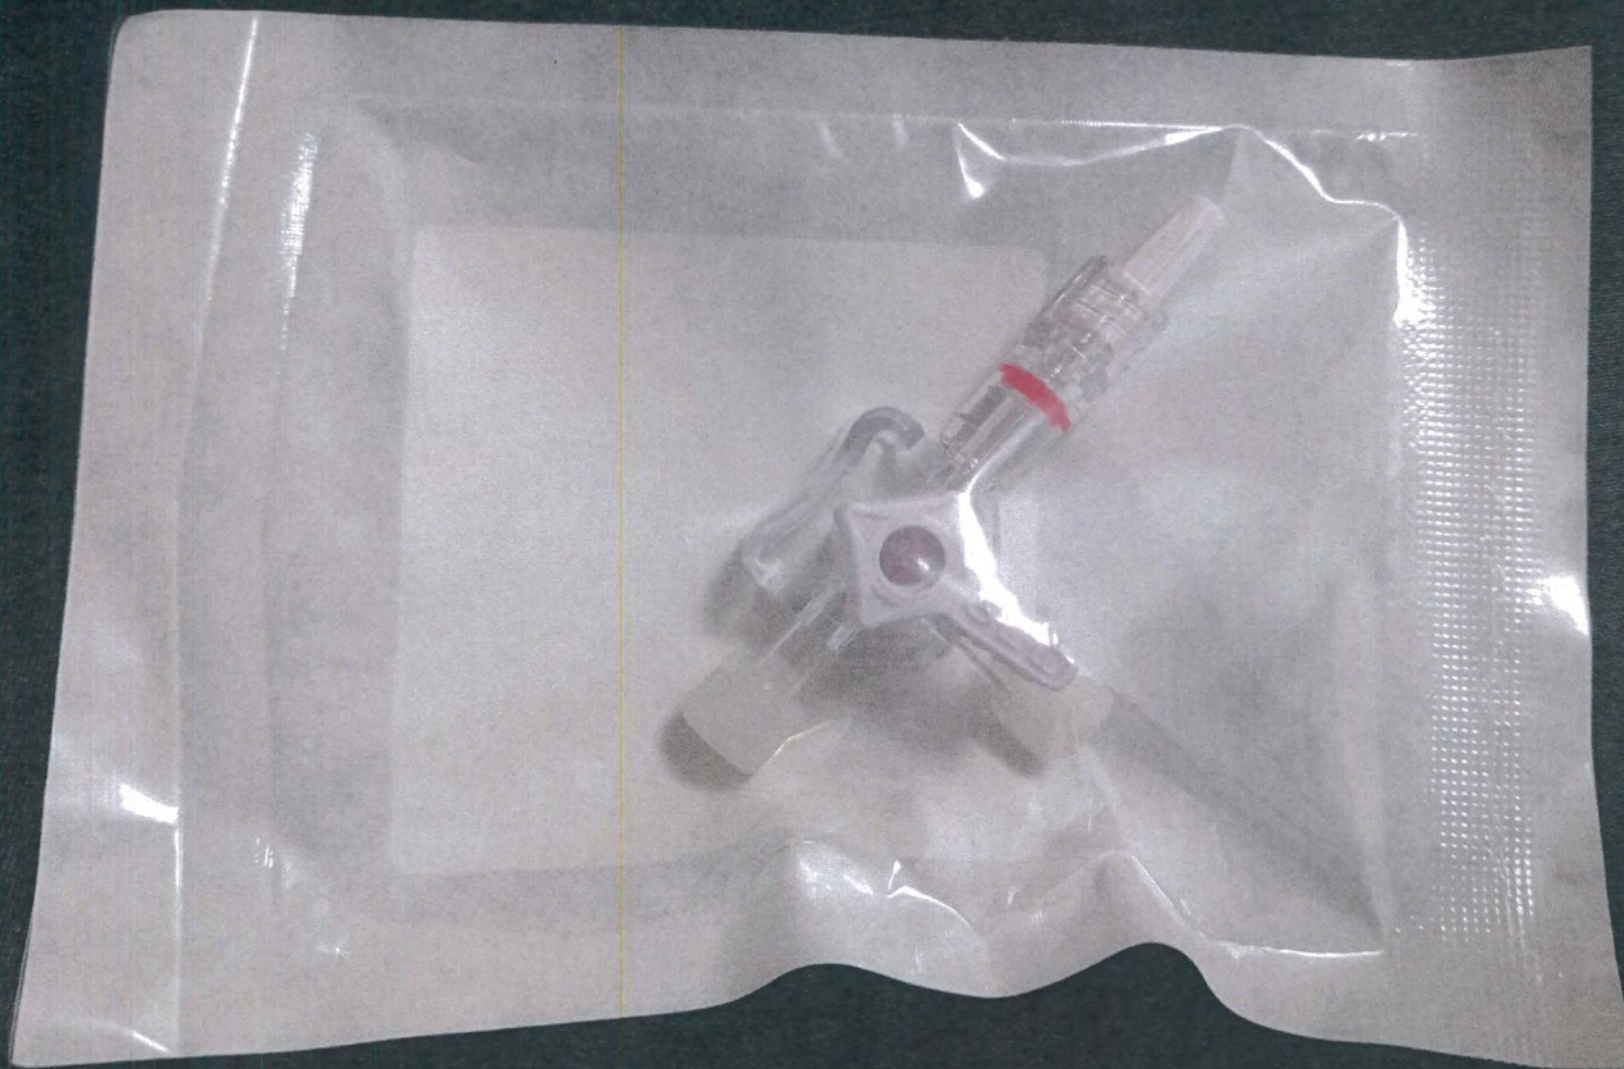



Рис. 15. 3-х ходовой кран высокого давления по ТУ 32.50.13-005-15624048-2021. Первичная упаковка.



Рис. 16. 3-х ходовой кран высокого давления по ТУ 32.50.13-005-15624048-2021.

Игла ангиографическая, длина
3.8 см, диаметр 21G по ТУ
32.50.13-005-15624048-2021

Регистрационное удостоверение
от DD.MM.YYYY



REF 630008 20210703

LOT SM621276 20240702



Общество с ограниченной
ответственностью «МЕДИКОР»
420138, Республика Татарстан, г. Казань,
проспект Победы, д. 466, кв. 46.
Телефон: +79167676029
Официальный сайт:
Электронная почта:

Место производства:
Shunmei Medical Co., Ltd
(Шунмей Медикал Ко., Лтд)
Yifa 3rd road, Yifa Industrial Zone, Pingtan
Town, Huiyang District, Huizhou,
Guangdong, China
Сделано в Китае



(01)06956014400081



(17)240702(10)SM621276

Рис. 17. Игла ангиографическая, длина 3.8 см, диаметр 21G. Первичная упаковка.

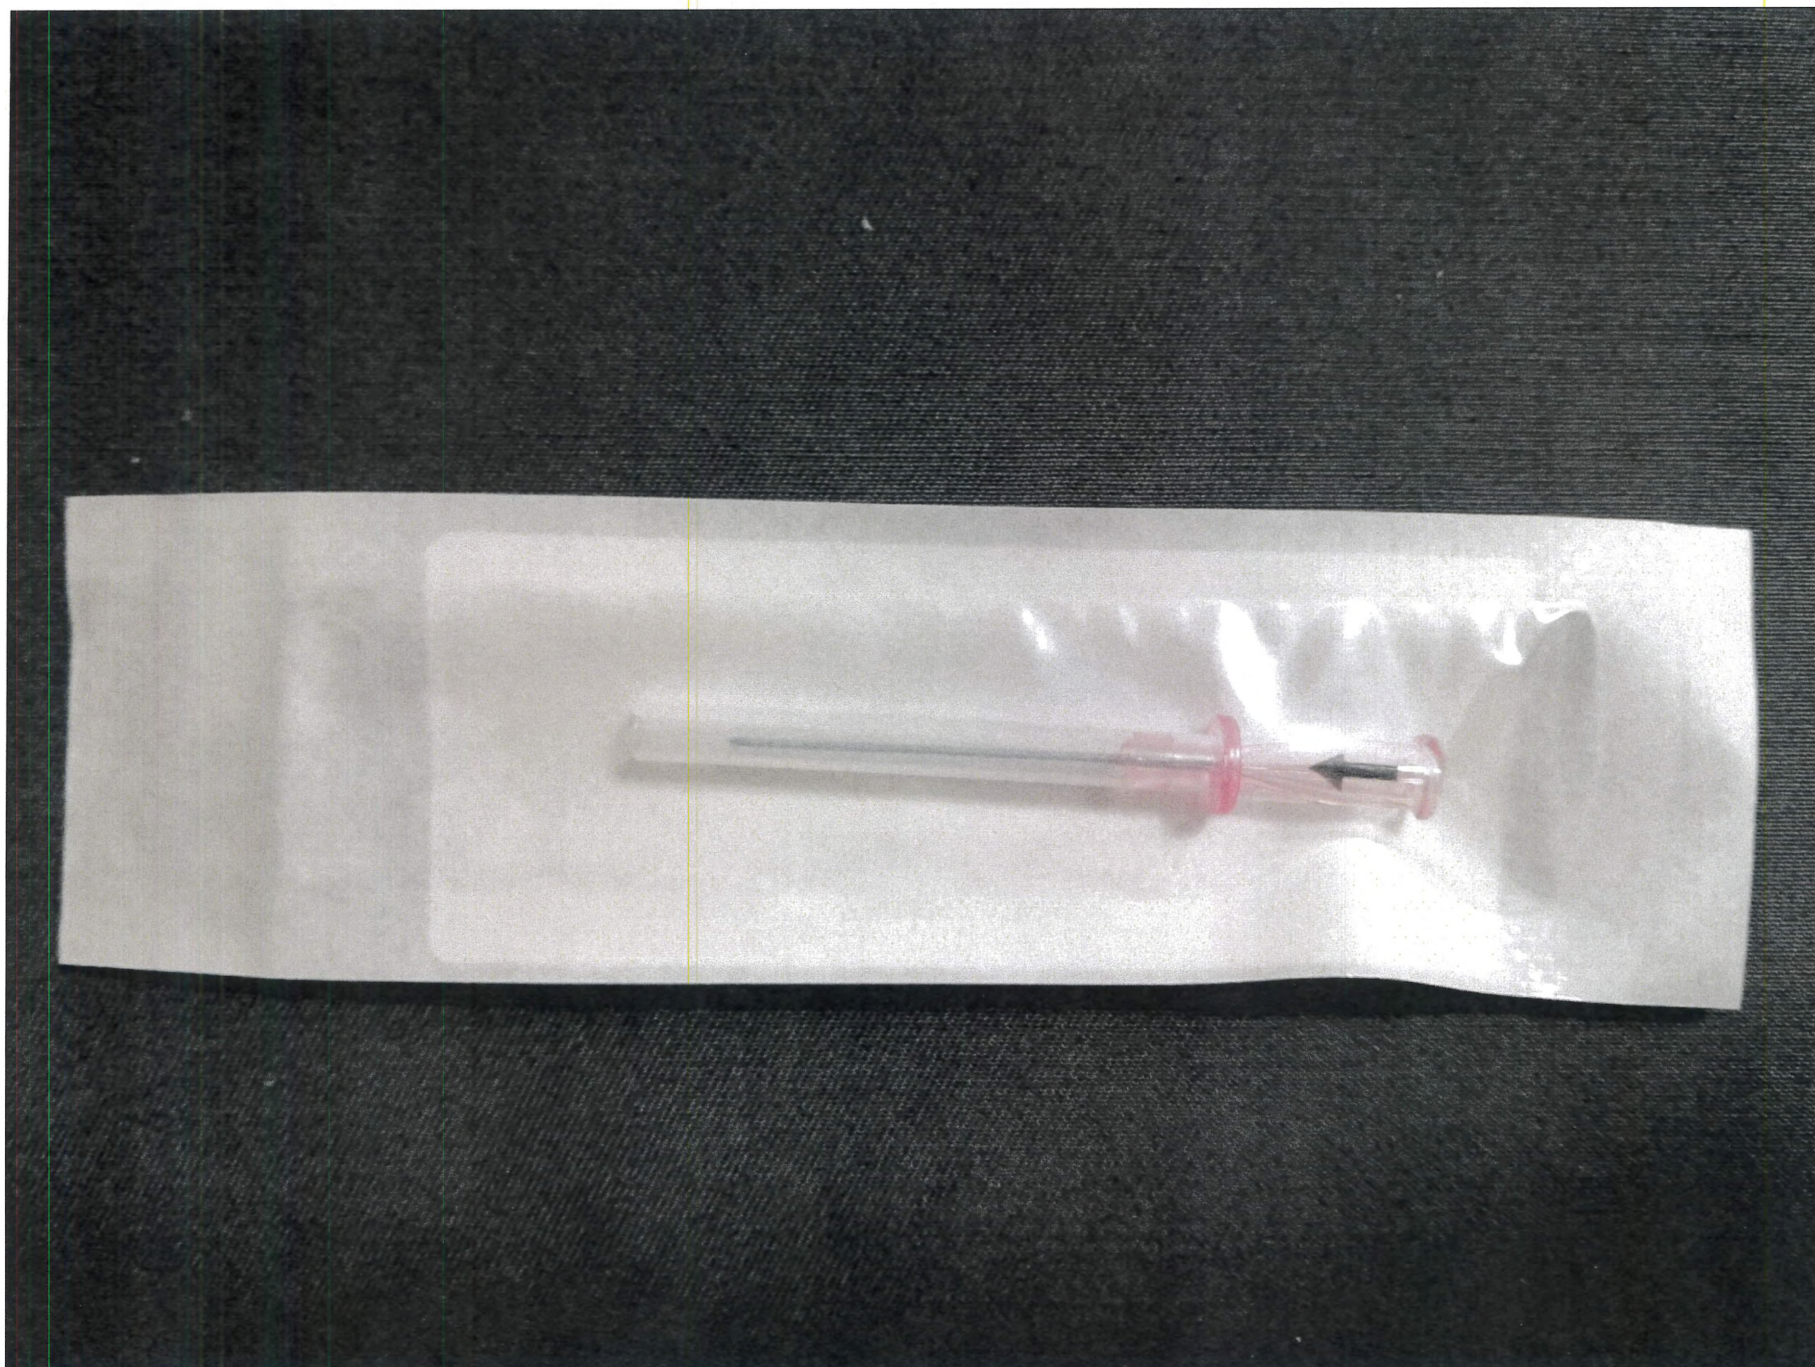



Рис. 18. Игла ангиографическая, длина 3.8 см, диаметр 21G. Первичная упаковка.



Рис. 19. Игла ангиографическая, длина 3.8 см, диаметр 21G.

**Линия соединительная высокого
давления, длина 10 см по ТУ
32.50.13-005-15624048-2021**


Регистрационное удостоверение
***** от DD.MM.YYYY



Длина: 10CM Давление: 1200Пси

REF 611112 20210703

LOT SM621276 20240702




Общество с ограниченной ответственностью «МЕДИКОР»
420138, Республика Татарстан, г. Казань,
проспект Победы, д. 466, кв. 46.
Телефон: +79167676029
Официальный сайт:
Электронная почта:

Место производства: Shunmei Medical Co., Ltd
(Шунмей Медикал Ко., Лтд)
Yifa 3rd road, Yifa Industrial Zone, Pingtan Town,
Huizhou District, Huizhou,
Guangdong, China
Сделано в Китае



(01)06956014411124



(17)240702(10)SM621276

Рис. 20. Линия соединительная высокого давления, длина 10 см, 15 см, 30 см, 35 см, 50 см, 60 см, 70 см, 75 см, 90 см, 100 см, 120 см по ТУ 32.50.13-005-15624048-2021. Первичная упаковка.


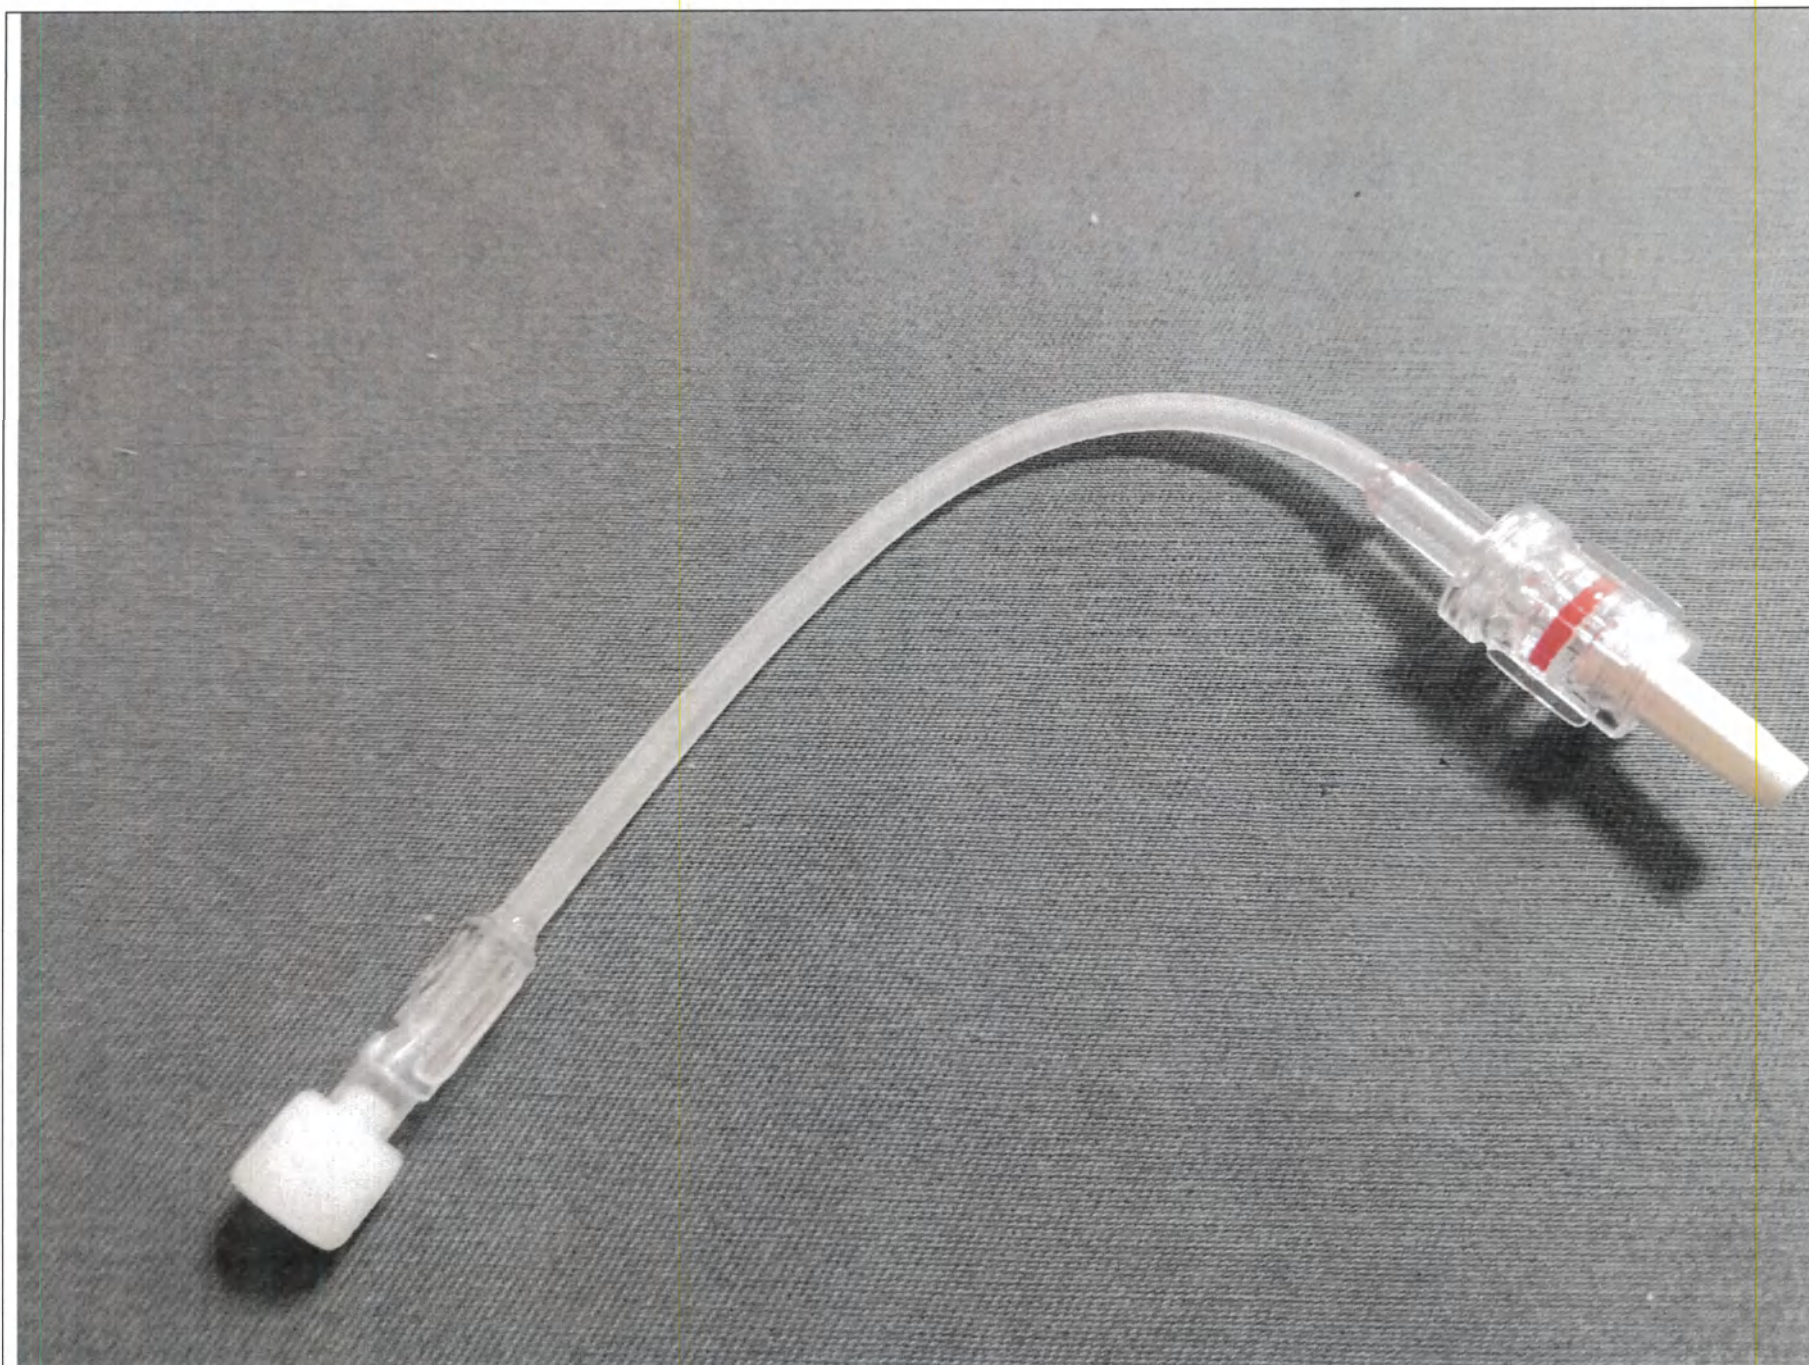


Рис. 21. Линия соединительная высокого давления, длина 10 см, 15 см, 30 см, 35 см, 50 см, 60 см, 70 см, 75 см, 90 см, 100 см, 120 см по
ТУ 32.50.13-005-15624048-2021

Линия соединительная низкого
давления, длина 15 см по ТУ
32.50.13-005-15624048-2021

Регистрационное удостоверение
от DD.MM.YYYY



Длина: 15CM Давление: 500Пси

REF 611215

20210703

LOT SM621276

20240702



STERILE EO



Общество с ограниченной ответственностью «МЕДИКОР»
420138, Республика Татарстан, г. Казань,
проспект Победы, д. 466, кв. 46.
Телефон: +79167676029
Официальный сайт:
Электронная почта:

Место производства: Shunmei Medical Co., Ltd
(Шунмей Медикал Ко., Лтд)
Yifa 3rd road, Yifa Industrial Zone, Pingtan Town,
Huiyang District, Huizhou,
Guangdong, China
Сделано в Китае



(01)06956014412152



(17)240702(10)SM621276

Рис. 22. Линия соединительная низкого давления, длина 15 см, 30 см, 35 см, 50 см, 60 см, 75 см, 90 см, 100 см, 120 см, 130 см, 150 см, 200 см по ТУ 32.50.13-005-15624048-2021

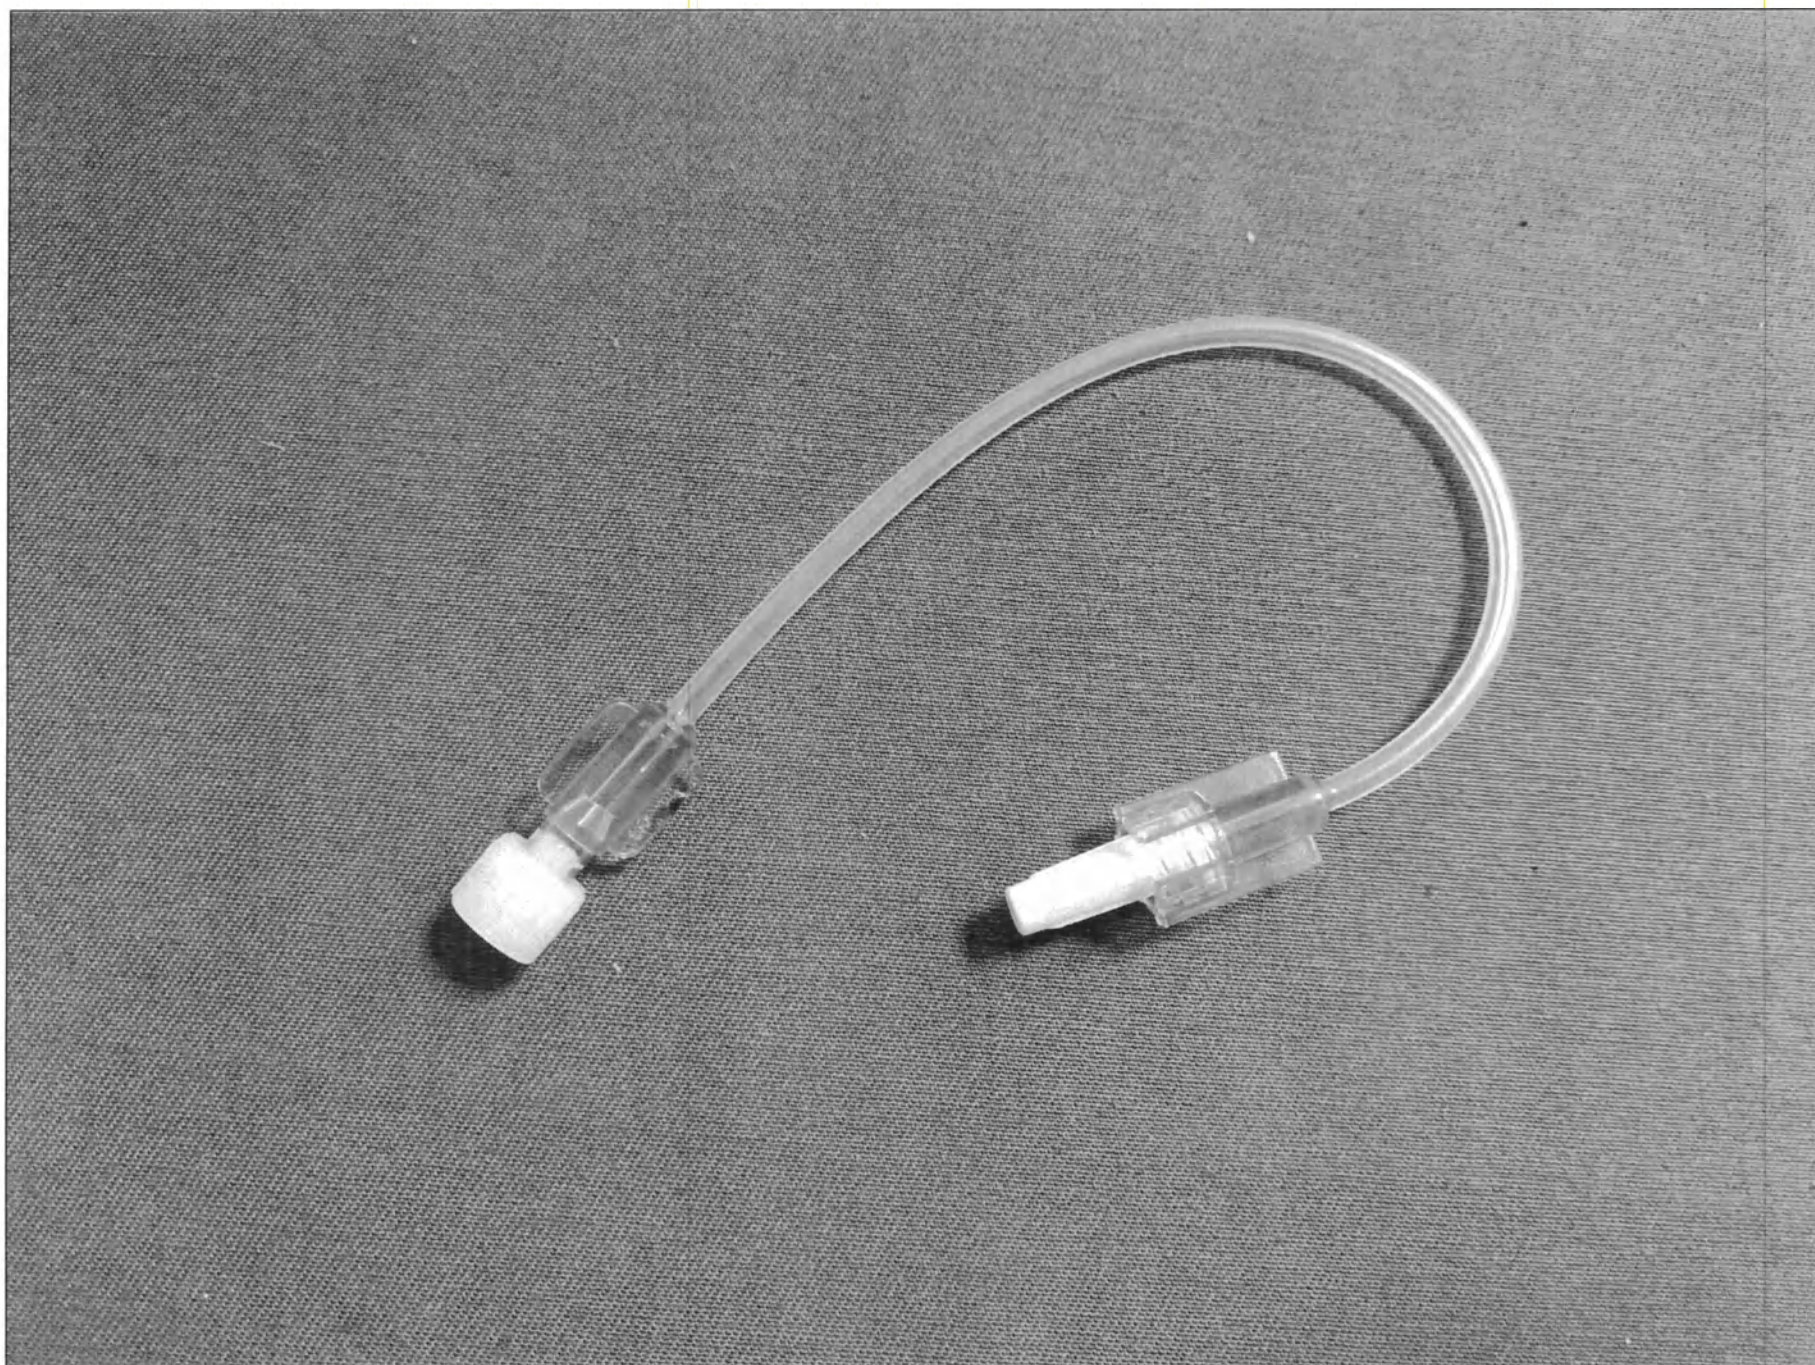


Рис. 23. Линия соединительная низкого давления, длина 15 см, 30 см, 35 см, 50 см, 60 см, 75 см, 90 см, 100 см, 120 см, 130 см, 150 см, 200 см по ТУ 32.50.13-005-15624048-2021

Всего прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 25 листов (-а)
Генеральный директор ООО «МЕДИКОР»
Протасова А.А.

А.А. Протасова

