

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
АО «Эрба Рус»
Иконников М. В.
«27» август 2022г.



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Дополнение 1

**Реагент Дако ДАБ усилитель для иммуногистохимических исследований (Dako DAB Enhancer),
варианты исполнения**

Реагент Дако ДАБ усилитель для иммуногистохимических исследований (Dako DAB Enhancer), варианты исполнения:

1. Реагент Дако ДАБ усилитель для иммуногистохимических исследований (Dako DAB Enhancer), в составе:

- Раствор усилителя ДАБ -1 флакон (110 мл во флаконе на 125 мл);
- Сертификат анализа – 1шт.;
- Инструкция по применению.

2. Реагент Дако ДАБ усилитель для иммуногистохимических исследований (Dako DAB Enhancer), в составе:

- Раствор усилителя ДАБ - 1 флакон (30 мл во флаконе на 30 мл);
- Сертификат анализа – 1шт.;
- Инструкция по применению.

Примечание – Далее по тексту наименование медицинского изделия сокращенно – Усилитель ДАБ, изделие

СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

До 01 декабря 2020г.

«Дако Норс Америка, Инк.» (Dako North America, Inc.)

6392 Via Real Carpinteria, California 93013 USA (США)

После 01 декабря 2020г.

«Аджилент Текнолоджис, Инк.» (Agilent Technologies, Inc.)

5301 Стивенс Крик Бульвар Санта Клара, Калифорния 95051 США

(5301 Stevens Creek Blvd. Santa Clara, CA 95051 United States)

МЕСТО ПРОИЗВОДСТВА:

До 01 декабря 2020г.

«Дако Норс Америка, Инк.» (Dako North America, Inc.)

6392 Виа Риал Карпинтерия, Калифорния 93013 США

(6392 Via Real Carpinteria, CA 93013 USA)

После 01 декабря 2020г.

«Аджилент Текнолоджис, Инк.» (Agilent Technologies, Inc.)

6392 Виа Риал Карпинтерия, Калифорния 93013 США

(6392 Via Real Carpinteria, CA 93013 USA)


Реагент Дако ДАБ усилитель для иммуногистохимических исследований (Dako DAB Enhancer), варианты исполнения:

1. Реагент Дако ДАБ усилитель для иммуногистохимических исследований (Dako DAB Enhancer), в составе:

- Раствор усилителя ДАБ -1 флакон (110 мл во флаконе на 125 мл);
- Сертификат анализа – 1шт.;
- Инструкция по применению.



Пакет из полиэтилена с zip- замком

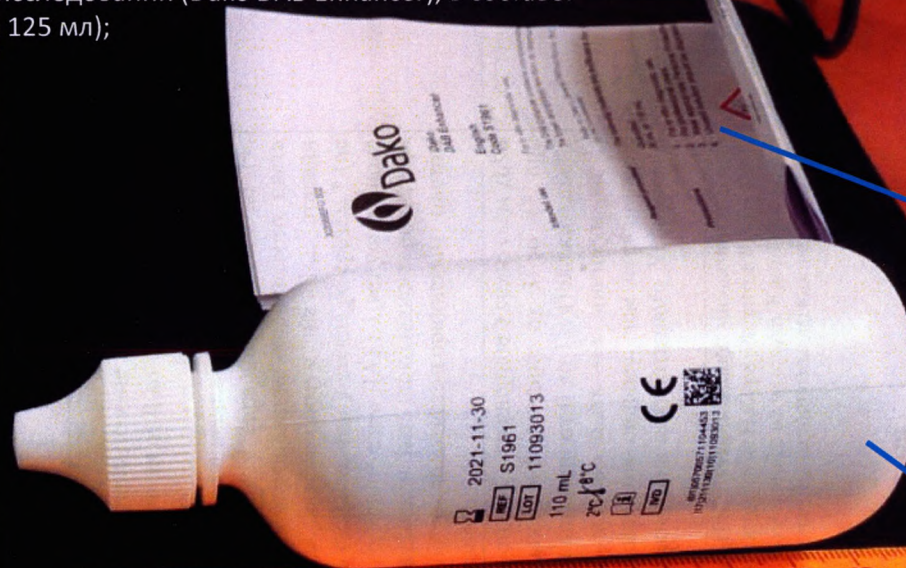

Инструкция по применению

Раствор усилителя ДАБ -1 флакон (110 мл во флаконе на 125 мл)

Общий вид медицинского изделия, лот (код партии) 11093013.

Сертификат анализа	
Общая информация об изделии Наименование: Усилитель ДАБ, 110 мл Код партии: 11093013 Дата изготовления: 30 ноября 2021 г.	Спецификация Наименование: Усилитель ДАБ, 110 мл Код партии: 11093013 Дата изготовления: 30 ноября 2021 г.
Описание изделия Усилитель ДАБ, 110 мл Код партии: 11093013 Дата изготовления: 30 ноября 2021 г.	Спецификация Наименование: Усилитель ДАБ, 110 мл Код партии: 11093013 Дата изготовления: 30 ноября 2021 г.
Утверждение и дата выпуска Утвержден: [подпись] Дата: 20 ноября 2021 г.	Утверждение и дата выпуска Утвержден: [подпись] Дата: 22 ноября 2021 г.

Сертификат анализа – 1шт.

[На бланке компании «Аджилент Дако»]

Сертификат анализа

Общая информация об изделии

Описание: Усилитель ДАБ, 110 мл
Код: S196131-2

Хранение: См. этикетку изделия

Данные, касающиеся серии:

Лот (код партии): 11093013
Дата истечения срока годности: 30 ноября 2021 г.

Спецификации:

Испытание	Спецификация	Результат
ИГХ: окраска стекла со срезом* без Усилителя ДАБ (номер по каталогу S 1961)	Положительное окрашивание от 2+ до 3+ при фоновом окрашивании от 0 до 1+.	Соответствует
Окраска стекла со срезом* Усилителем ДАБ (номер по каталогу S 1961)	Положительное окрашивание коричневого цвета от 3 до 4+ при фоновом окрашивании от 0 до 1+. Положительное окрашивание коричневого цвета должно быть как минимум на 1/2 степени окрашивания сильнее, чем у стекла со срезом* (не обработанного Усилителем ДАБ). Цвет усиленного окрашивания должен быть шоколадно-коричневым по сравнению с золотисто-коричневым цветом стекла со срезом*.	Соответствует
окраска референтного стекла** с Усилителем ДАБ	Референтное стекло, окрашенное Усилителем ДАБ - положительное окрашивание от 3 до 4+ при фоновом окрашивании от 0 до 1+. Положительное окрашивание должно быть как минимум на 1/2 степени окрашивания сильнее, чем окрашивание стекла со срезом* (не обработанного Усилителем ДАБ).	Соответствует

*Зафиксированная в формалине и залитая в парафин (FFPE) ткань небной миндалины человека

** Предметные стекла с контрольными клеточными линиями из Набора реагентов PD-L1 IHC 22C3 зафиксированные в формалине, залитые в парафин клеточные линии, полученные от человека. Клеточная линия MCF-7 происходит из аденокарциномы груди человека. NCI-H226 происходит из карциномы легких человека [NIN NCI-H226 и MCF-7 (номер ATCC: CRL-5826™)].


Утверждение отделом контроля качества	ДЖОН СТ. ОНГЕ	Дата	20 ноября 2019 г.
Утверждение отделом обеспечения качества	МАРИЦЕЛА БОЛАНОС	Дата	22 ноября 2019 г.

«Аджилент Текнолоджис, Инк.» | 5301 Стивенс Крик Бульвар | Санта Клара, Калифорния 95051 | Соединенные Штаты Америки | Тел.: +44 161 492 7050 | www.agilent.com


Реагент Дако ДАБ усилитель для иммуногистохимических исследований (Dako DAB Enhancer), варианты исполнения:

1. Реагент Дако ДАБ усилитель для иммуногистохимических исследований (Dako DAB Enhancer), в составе:

- Раствор усилителя ДАБ -1 флакон (110 мл во флаконе на 125 мл);
- Сертификат анализа – 1 шт.;
- Инструкция по применению.

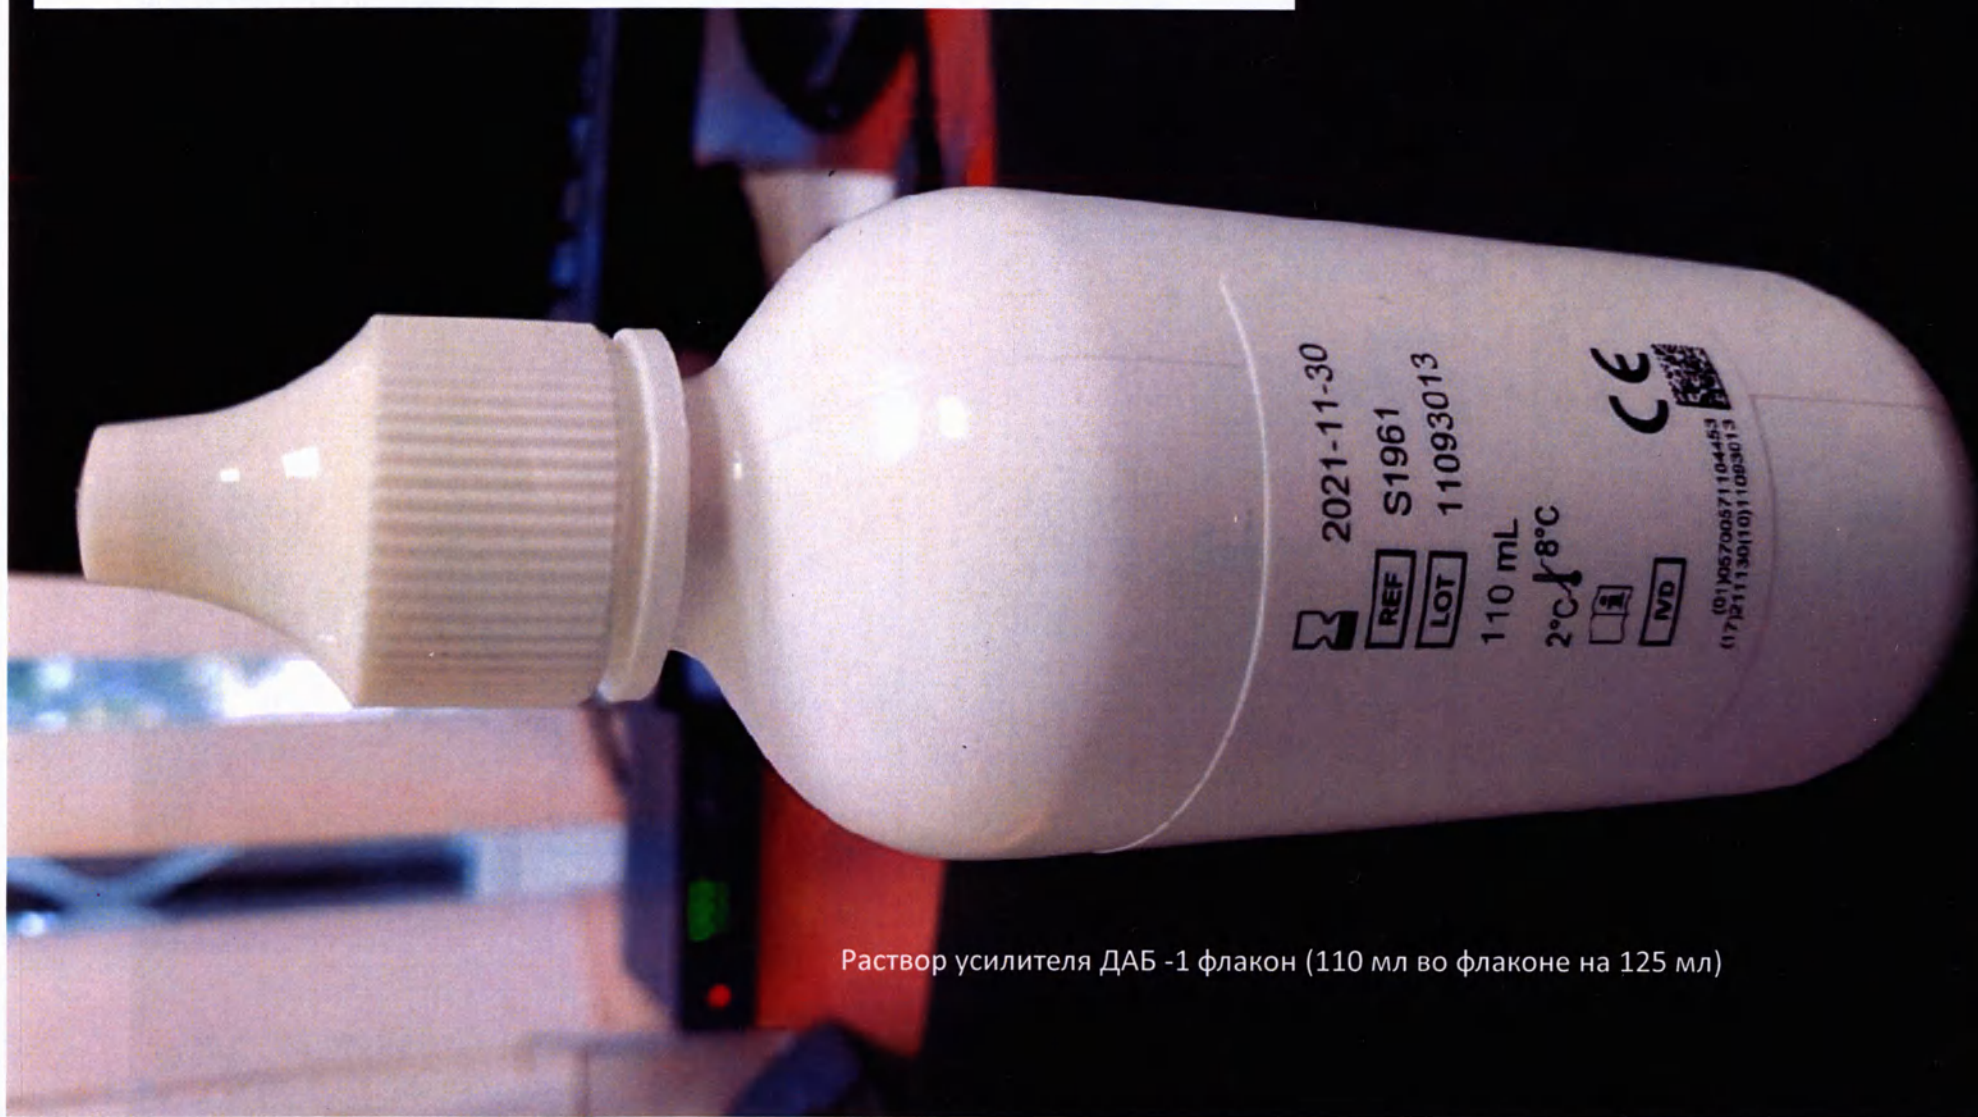

Раствор усилителя ДАБ -1 флакон (110 мл во флаконе на 125 мл)

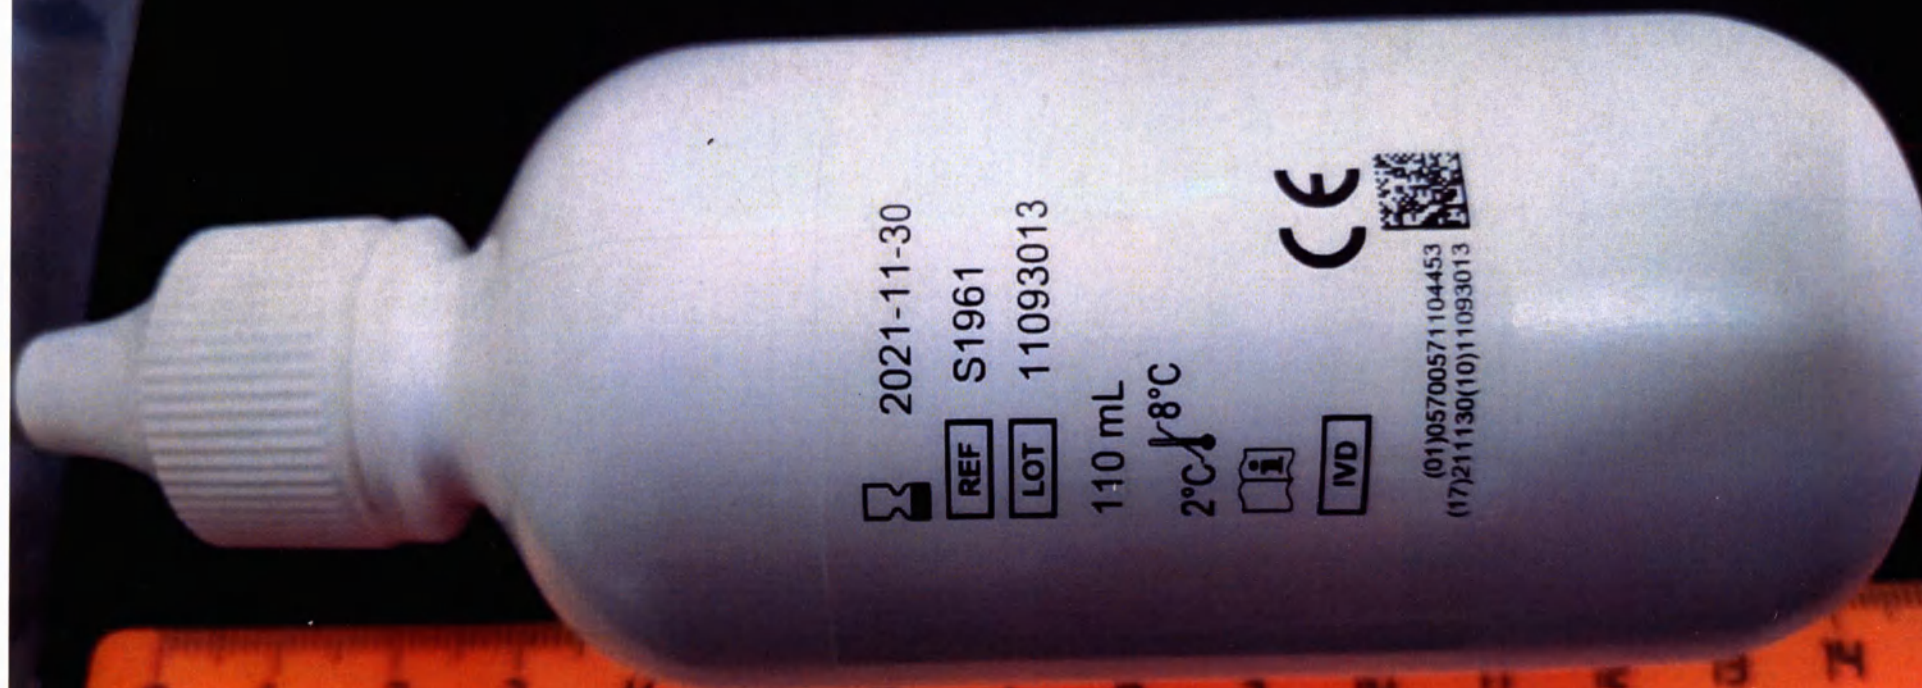

2021-11-30

REF S1961

LOT 11093013

110 mL

2°C/8°C



IVD

CE



(01)05700571104453
(17)211130(10)11093013

MAZARI

Раствор усилителя ДАБ -1 флакон (110 мл во флаконе на 125 мл)

Раствор усилителя ДАБ -1 флакон (110 мл во флаконе на 125 мл)





Вариант исполнения I (лот (код партии) 11093013)
изображение пакета из полиэтилена с зип- замком



Dako
DAB Enhancer

CE

 2021-11-30

 REF S1961

 LOT 11093013

110 mL

2°C/8°C



IVD


Dako North America, Inc.
6392 Via Real
Carpinteria, CA 93013 USA
+1 805 566 6655



Warning



(01)05700571104453(17)211130(10)11093013

Вариант исполнения 1 (лот (код партии) 11093013):



Изображение маркировки пакета из полиэтилена с зип- замком

Изображение общего вида медицинского изделия:

Реагент Дако ДАБ усилитель для иммуногистохимических исследований (Dako DAB Enhancer), варианты исполнения:

2. Реагент Дако ДАБ усилитель для иммуногистохимических исследований (Dako DAB Enhancer), в составе:

- Раствор усилителя ДАБ - 1 флакон (30 мл во флаконе на 30 мл);
- Сертификат анализа - 1 шт.;
- Инструкция по применению.

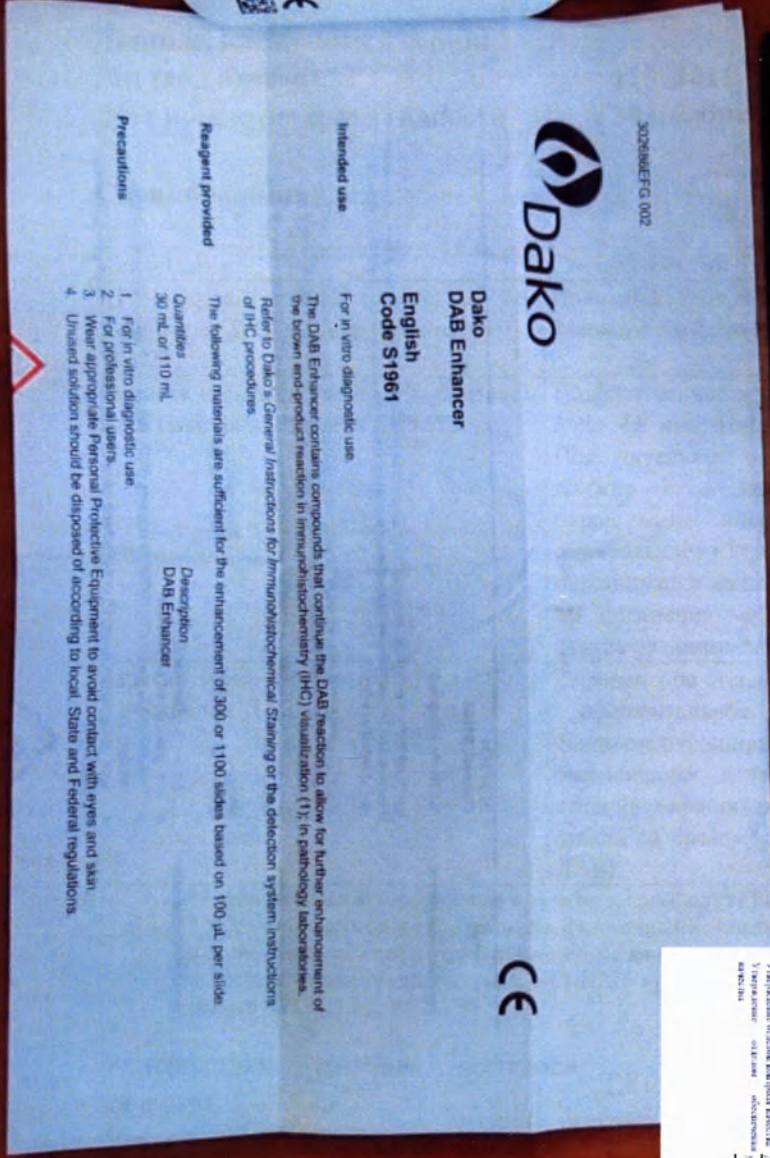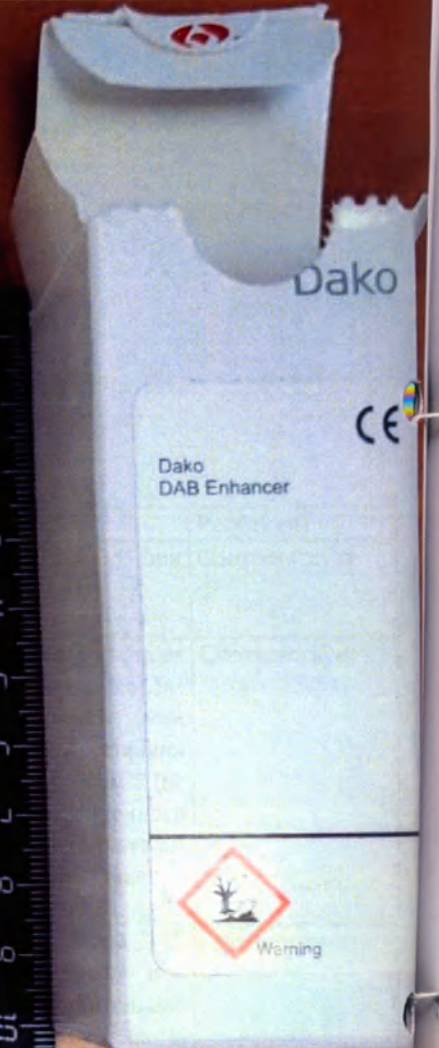

Общая информация об изделии		Сертификат анализа	
Наименование:	Усилитель ДАБ, 30 мл	Идентификационный номер:	11190283
Датум, к которому срок:	30 октября 2022 г.	Дата изготовления:	30 октября 2022 г.
Спецификация		Результат	
ИЗДАНИЕ: 01	01	ИЗДАНИЕ: 01	01
Наименование:	Усилитель ДАБ, 30 мл	Идентификационный номер:	11190283
Датум, к которому срок:	30 октября 2022 г.	Дата изготовления:	30 октября 2022 г.
Спецификация		Результат	
ИЗДАНИЕ: 01	01	ИЗДАНИЕ: 01	01
Наименование:	Усилитель ДАБ, 30 мл	Идентификационный номер:	11190283
Датум, к которому срок:	30 октября 2022 г.	Дата изготовления:	30 октября 2022 г.

[На бланке компании «Аджилент Дако»]

Сертификат анализа

Общая информация об изделии

Описание: Усилитель ДАБ, 30 мл
Код: S196131-2

Хранение: См. этикетку изделия

Данные, касающиеся серии:

Лот (код партии): 11093011
Дата истечения срока годности: 30 ноября 2021 г.

Спецификации:

Испытание	Спецификация	Результат
ИГХ: окраска стекла со срезом* без Усилителя ДАБ (номер по каталогу S 1961)	Положительное окрашивание от 2+ до 3+ при фоновом окрашивании от 0 до 1+.	Соответствует
Окраска стекла со срезом* Усилителем ДАБ (номер по каталогу S 1961)	Положительное окрашивание коричневого цвета от 3 до 4+ при фоновом окрашивании от 0 до 1+. Положительное окрашивание коричневого цвета должно быть как минимум на 1/2 степени окрашивания сильнее, чем у стекла со срезом* (не обработанного Усилителем ДАБ). Цвет усиленного окрашивания должен быть шоколадно-коричневым по сравнению с золотисто-коричневым цветом стекла со срезом*.	Соответствует
окраска референтного стекла** с Усилителем ДАБ	Референтное стекло, окрашенное Усилителем ДАБ - положительное окрашивание от 3 до 4+ при фоновом окрашивании от 0 до 1+. Положительное окрашивание должно быть как минимум на 1/2 степени окрашивания сильнее, чем окрашивание стекла со срезом* (не обработанного Усилителем ДАБ).	Соответствует


*Зафиксированная в формалине и залитая в парафин (FFPE) ткань небной миндалины человека

** Предметные стекла с контрольными клеточными линиями из Набора реагентов PD-L1 IHC 22C3 зафиксированные в формалине, залитые в парафин клеточные линии, полученные от человека. Клеточная линия MCF-7 происходит из аденокарциномы груди человека. NCI-H226 происходит из карциномы легких человека [NIH NCI-H226 и MCF-7 (номер ATCC: CRL-5826™)].


Утверждение отделом контроля качества ДЖОН СТ. ОНГЕ Дата 20 ноября 2019 г.

Утверждение отделом обеспечения качества МАРИЦЕЛА БОЛАНОС Дата 22 ноября 2019 г.

«Аджилент Текнолоджис, Инк.» | 5301 Стивенс Крик Бульвар | Санта Клара, Калифорния 95051 | Соединенные Штаты Америки | Тел.: +44 161 492 7050 | www.agilent.com

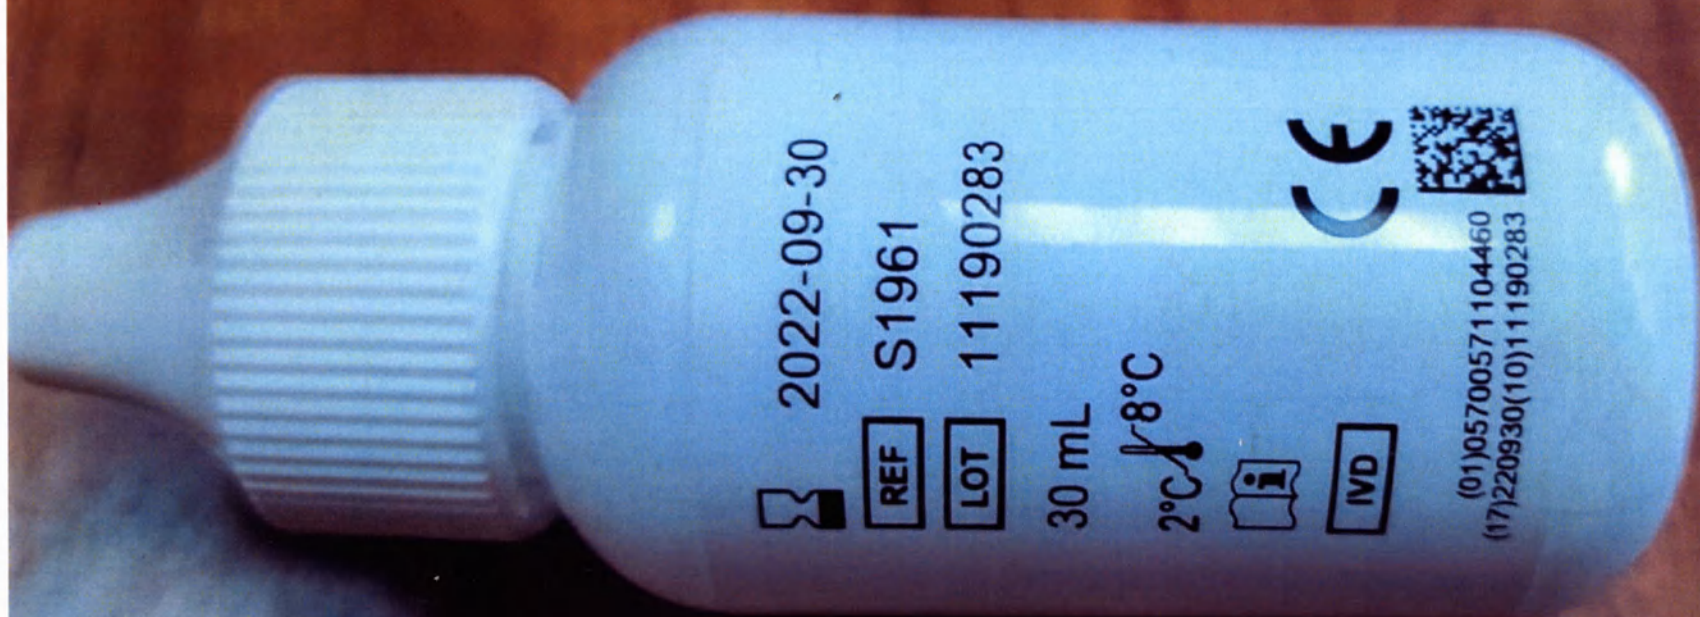

Раствор усилителя ДАБ - 1 флакон (30 мл во флаконе на 30 мл),
лот (код партии) 11190283.

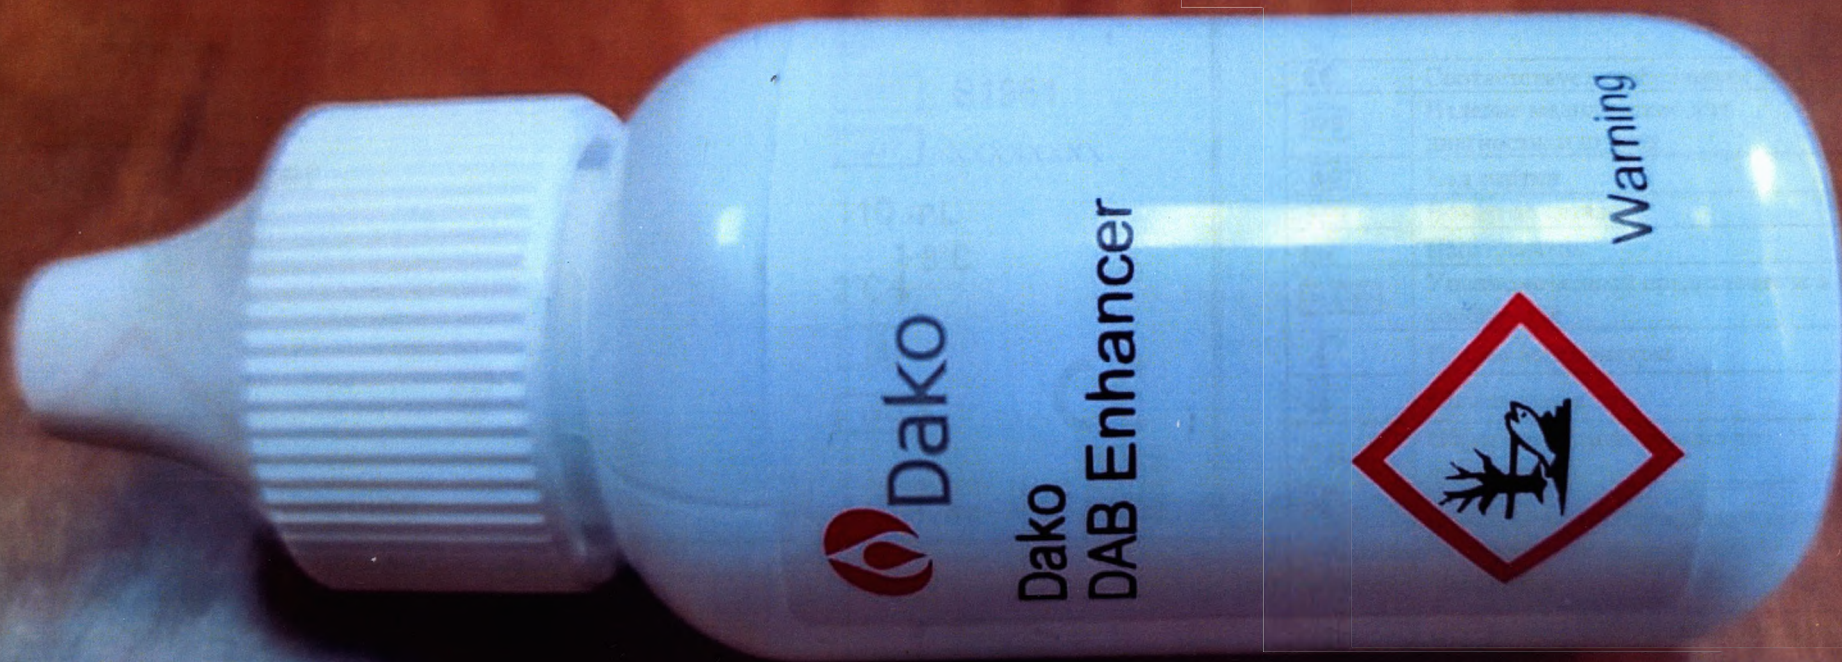


Раствор усилителя ДАБ - 1 флакон (30 мл во флаконе на 30 мл)

Макет маркировки флакона Усилителя ДАБ (на флаконе 110 мл), вариант исполнения 1


Перевод на русский язык

Dako DAB Enhancer - Реагент Дако ДАБ усилитель для иммуногистохимических исследований (Dako DAB Enhancer), варианты исполнения

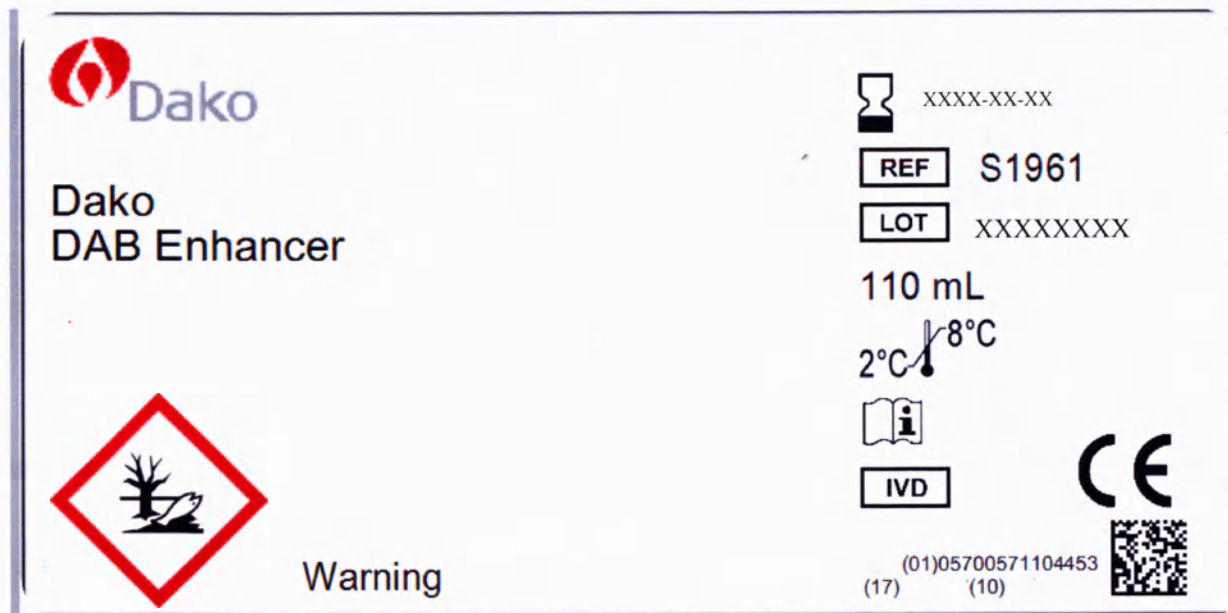

CE	Соответствует требованиям ЕС
IVD	Изделие медицинское для диагностики in vitro
LOT	Код партии
REF	Номер по каталогу
ИЗГОТОВИТЕЛЬ	Изготовитель
ЕС РЕП	Уполномоченный представитель в Европейском сообществе
ПРЕДЕЛ ТЕМПЕРАТУРЫ	Предел температуры
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДО	Использовать до
ОБРАТИТЕСЬ К ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ	Обратитесь к инструкции по применению
ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	Опасность для окружающей среды
Warning	Осторожно
ОСТОРОЖНО! ОБРАТИТЕСЬ К ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ	Осторожно! Обратитесь к инструкции по применению
СОДЕРЖИМОГО ДОСТАТОЧНО ДЛЯ n- ТЕСТОВ	Содержимого достаточно для n- тестов

Макет маркировки Усилителя ДАБ (на зип-пакете для флакона 110мл), вариант исполнения 1

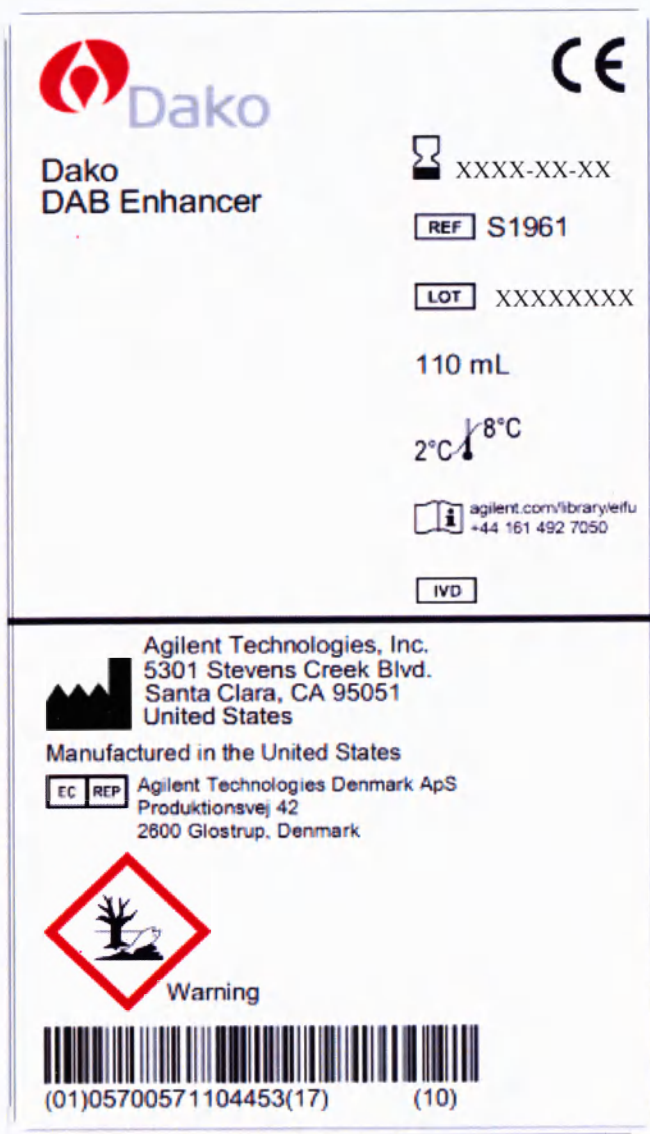

Перевод на русский язык

Dako DAB Enhancer-Реагент Дако ДАБ усилитель для иммуногистохимических исследований (Dako DAB Enhancer), варианты исполнения

CE	Соответствует требованиям ЕС
IVD	Изделие медицинское для диагностики in vitro
LOT	Код партии
REF	Номер по каталогу
Factory	Изготовитель
EC REF	Уполномоченный представитель в Европейском сообществе
Thermometer	Предел температуры
Flask	Использовать до
Book	Обратитесь к инструкции по применению
Biohazard	Опасность для окружающей среды
Warning	Осторожно
Warning	Осторожно! Обратитесь к инструкции по применению
Sigma	Содержимого достаточно для n- тестов

«Аджилент Текнолоджис, Инк.» (Agilent Technologies, Inc.)

5301 Стивенс Крик Бульвар

Санта Клара, Калифорния 95051 США

(5301 Stevens Creek Blvd.

Santa Clara, CA 95051 United States)

Произведено в США (Manufactured in the United States)

Осторожно (Warning)


«Аджилент Текнолоджис Денмарк АпС» (Agilent Technologies Denmark ApS)

Продуктионсвей 42 2600 Глоstrup, Дания (Produktionsvej 42 2600 Glostrup, Denmark)

Макет маркировки флакона Усилителя ДАБ (на флаконе 30 мл), вариант исполнения 2

Перевод на русский язык

Dako DAB Enhancer-Реагент Дако ДАБ усилитель для иммуногистохимических исследований (Dako DAB Enhancer), варианты исполнения

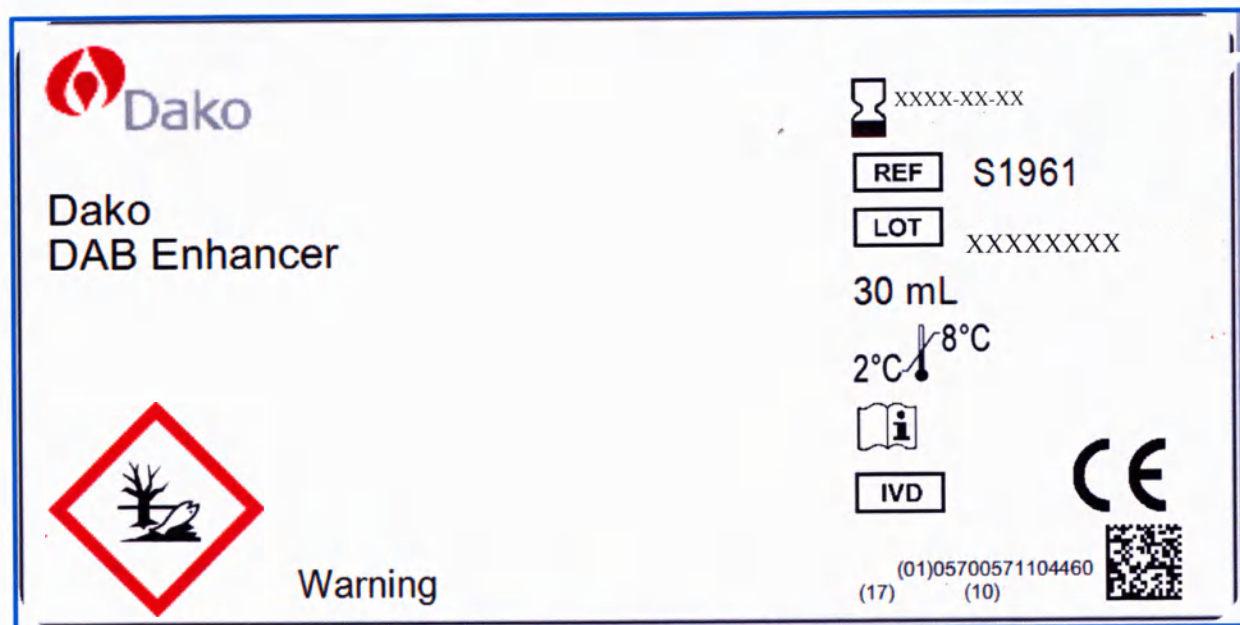

CE	Соответствует требованиям ЕС
IVD	Изделие медицинское для диагностики in vitro
LOT	Код партии
REF	Номер по каталогу
ИЗГОТОВИТЕЛЬ	Изготовитель
ЕС РЕП	Уполномоченный представитель в Европейском сообществе
ПРЕДЕЛ ТЕМПЕРАТУРЫ	Предел температуры
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДО	Использовать до
ОБРАТИТЕСЬ К ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ	Обратитесь к инструкции по применению
ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	Опасность для окружающей среды
Warning	Осторожно
ОСТОРОЖНО! ОБРАТИТЕСЬ К ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ	Осторожно! Обратитесь к инструкции по применению
СОДЕРЖИМОГО ДОСТАТОЧНО ДЛЯ n- ТЕСТОВ	Содержимого достаточно для n- тестов

Макет маркировки картонной коробки Усилителя ДАБ (с флаконом 30 мл), вариант исполнения 2

Перевод на русский язык

Dako DAB Enhancer-Реагент Дако ДАБ усилитель для иммуногистохимических исследований (Dako DAB Enhancer), варианты исполнения

Dako
DAB Enhancer



XXXX-XX-XX

REF S1961

LOT XXXXXXXX

30 mL

2°C / 8°C



agilent.com/library/eifu
+44 161 492 7050

IVD



Warning



Agilent Technologies, Inc.
5301 Stevens Creek Blvd.
Santa Clara, CA 95051
United States

Manufactured in the United States

EC REP

Agilent Technologies Denmark ApS
Produktionsvej 42
2600 Glostrup, Denmark

CE	Соответствует требованиям ЕС
IVD	Изделие медицинское для диагностики in vitro
LOT	Код партии
REF	Номер по каталогу
Factory icon	Изготовитель
EC REP	Уполномоченный представитель в Европейском сообществе
Thermometer icon	Предел температуры
Hourglass icon	Использовать до
Information icon	Обратитесь к инструкции по применению
Flame icon	Опасность для окружающей среды
Warning	Осторожно
Warning triangle icon	Осторожно! Обратитесь к инструкции по применению
Sigma icon	Содержимого достаточно для n- тестов

«Аджилент Текнолоджис, Инк.» (Agilent Technologies, Inc.)

5301 Стивенс Крик Бульвар
Санта Клара, Калифорния 95051 США
(5301 Stevens Creek Blvd.

Santa Clara, CA 95051 United States)


Произведено в США (Manufactured in the United States)

Осторожно (Warning)

«Аджилент Текнолоджис Денмарк АпС» (Agilent Technologies Denmark ApS)

Продуктионсвей 42 2600 Глоstrup, Дания (Produktionsvej 42 2600 Glostrup, Denmark)

Макет маркировки- стикера на русском языке



Только для профессионального применения

Реагент Дако ДАБ усилитель для иммуногистохимических исследований (Dako DAB Enhancer), варианты исполнения:

1. Реагент Дако ДАБ усилитель для иммуногистохимических исследований (Dako DAB Enhancer), в составе:

- Раствор усилителя ДАБ -1 флакон (110 мл во флаконе на 125 мл);
- Сертификат анализа -1 шт.;
- Инструкция по применению.

Регистрационное удостоверение № _____

Срок годности см. на упаковке (изделие стабильно максимально 24 мес. с момента производства. После вскрытия изделие стабильно до окончания срока годности, дата окончания срока годности отпечатана на флаконе изделия.)

Температура хранения см. на упаковке

Номер лота (код партии) см. на упаковке

Объем см. на упаковке.

Производитель: «Аджилент Текнолоджис, Инк.» (Agilent Technologies, Inc.)

5301 Stevens Creek Blvd. Santa Clara, CA 95051 United States (5301 Стивенс Крик Бульвар Санта Клара, Калифорния 95051 США)

Место производства:

Agilent Technologies, Inc. («Аджилент Текнолоджис, Инк.») 6392 Via Real Carpinteria, CA 93013 United States (6392 Виа Риал Карпинтерия, Калифорния 93013 США)

Осторожно! Опасность для окружающей среды.

Изделие предназначено для диагностики in-vitro

Уполномоченный представитель производителя на территории

РФ: Акционерное общество «Эрба Рус» (АО «Эрба Рус»)

РФ, 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, д.32 стр. 15, эт.5 пом. I ком. 35А, 37, 38, 39

Тел.: +7 (495) 755-78-81, +7 (495) 755-78-92. E-mail: sale@erbamannheim.com

Макет маркировки- стикера на русском языке



300



Только для профессионального применения

Реагент Дако ДАБ усилитель для иммуногистохимических исследований (Dako DAB Enhancer), варианты исполнения:

2. Реагент Дако ДАБ усилитель для иммуногистохимических исследований (Dako DAB Enhancer), в составе:

- Раствор усилителя ДАБ - 1 флакон (30 мл во флаконе на 30 мл);
- Сертификат анализа -1 шт.;
- Инструкция по применению.

Регистрационное удостоверение № _____

Срок годности см. на упаковке (изделие стабильно максимально 24 мес. с момента производства. После вскрытия изделие стабильно до окончания срока годности, дата окончания срока годности отпечатана на флаконе изделия.)

Температура хранения см. на упаковке

Номер лота (код партии) см. на упаковке

Объем см. на упаковке.

Производитель: «Аджилент Текнолоджис, Инк.» (Agilent Technologies, Inc.)

5301 Stevens Creek Blvd. Santa Clara, CA 95051 United States (5301 Стивенс Крик Бульвар Санта Клара, Калифорния 95051 США)

Место производства:

Agilent Technologies, Inc. («Аджилент Текнолоджис, Инк.») 6392 Via Real Carpinteria, CA 93013 United States (6392 Виа Риал Карпинтерия, Калифорния 93013 США)

Осторожно! Опасность для окружающей среды.

Изделие предназначено для диагностики in-vitro

Уполномоченный представитель производителя на территории

РФ: Акционерное общество «Эрба Рус» (АО «Эрба Рус»)

РФ, 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, д.32 стр. 15, эт.5 пом. I ком. 35А, 37, 38, 39

Тел.: +7 (495) 755-78-81, +7 (495) 755-78-92. E-mail: sale@erbamannheim.com

24

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

20 (двадцать) листов
цифрами прописью
Должность Генеральный директор
Подпись [подпись] / Владимиров
« 24 » апреля 20 22 г. М.П.



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ

Системы детекции EnVision FLEX+, Mouse, High pH (Link)

(ЭнВижн ФЛЕКС+, мышинные, высокий pH (Линк))

РУ № ФСЗ 2010/08215

номер по каталогу K8002,

предоставленной в ФГБУЗ ГЦГ и Э ФМБА для проведения испытаний

МИ ИВД: «Антитело моноклональное мышинное к PD-L1 человека, клон 22C3, для выявления клеток, экспрессирующих PD-L1, иммуногистохимическим методом (Monoclonal Mouse Anti-Human PD-L1 Clone 22C3)»,

производства Agilent Technologies, Inc., USA («Аджилент Текнолоджиз, Инк.», США); РУ № РЗН 2021/15703

и

«Реагента Дако ДАБ усилитель для иммуногистохимических исследований (Dako DAB Enhancer), варианты исполнения»

EnVision™ FLEX+, Mouse, High pH (Link)



2021-01-31



REF K8002



LOT 11155274



400-600

2°C / 8°C



Store in the dark



EnVision™ FLEX
PEROXIDASE-BLOCKING
REAGENT

EnVision™ FLEX
/HRP


EnVision™ FLEX
DAB+ CHROMOGEN

EnVision™ FLEX
SUBSTRATE BUFFER


EnVision™ FLEX
WASH BUFFER (20x)

EnVision™ FLEX
TARGET RETRIEVAL SOLUTION
HIGH pH (50x)

EnVision™ FLEX+
MOUSE (LINKER)



Danger



Dako Denmark ApS
Produktionsvej 42
DK-2800 Glostrup
+45 44 85 95 00

Manufactured by Dako North America, Inc
for Dako Denmark ApS

2021-04-30

REF K8000/K8002
K8007/K8010
K8012/K8023
K8024

LOT 11155268

1 L

20°C

DM831

CE

010657005/2020051

Dako

Evolution™ FLEX (20x)

WASH BUFFER

DM831

Warning

2021-04-30

REF K8000/K8002
K8007/K8010
K8012/K8023
K8024

LOT 11155268

1 L

20°C

DM831

CE

010657005/2020051

Dako

Evolution™ FLEX (20x)

WASH BUFFER

DM831

Warning

2021-04-30

REF K8000/K8002
K8007/K8010
K8012/K8023
K8024

LOT 11155268

1 L

20°C

DM831

CE

010657005/2020051

Dako

Evolution™ FLEX (20x)

WASH BUFFER

DM831

Warning

2021-04-30

REF K8000/K8002
K8007/K8010
K8012/K8023
K8024

LOT 11155268

1 L

20°C

DM831

CE

010657005/2020051

ENVISION™ FLEX+, Mouse, High pH (Lunk)



2021-01-31

K0902

11155274

400-500


20/9°C


Store in the dark

ENVISION™ FLEX+
PREDIGESTED COCKING
REAGENT
Product: FLEX+
Cat#: 11155274
ENVISION™ FLEX+
SALT CONCENTRATION
Product: FLEX+
Cat#: 11155274
ENVISION™ FLEX+
SALT CONCENTRATION
Product: FLEX+
Cat#: 11155274

20/9°C

Store in the dark

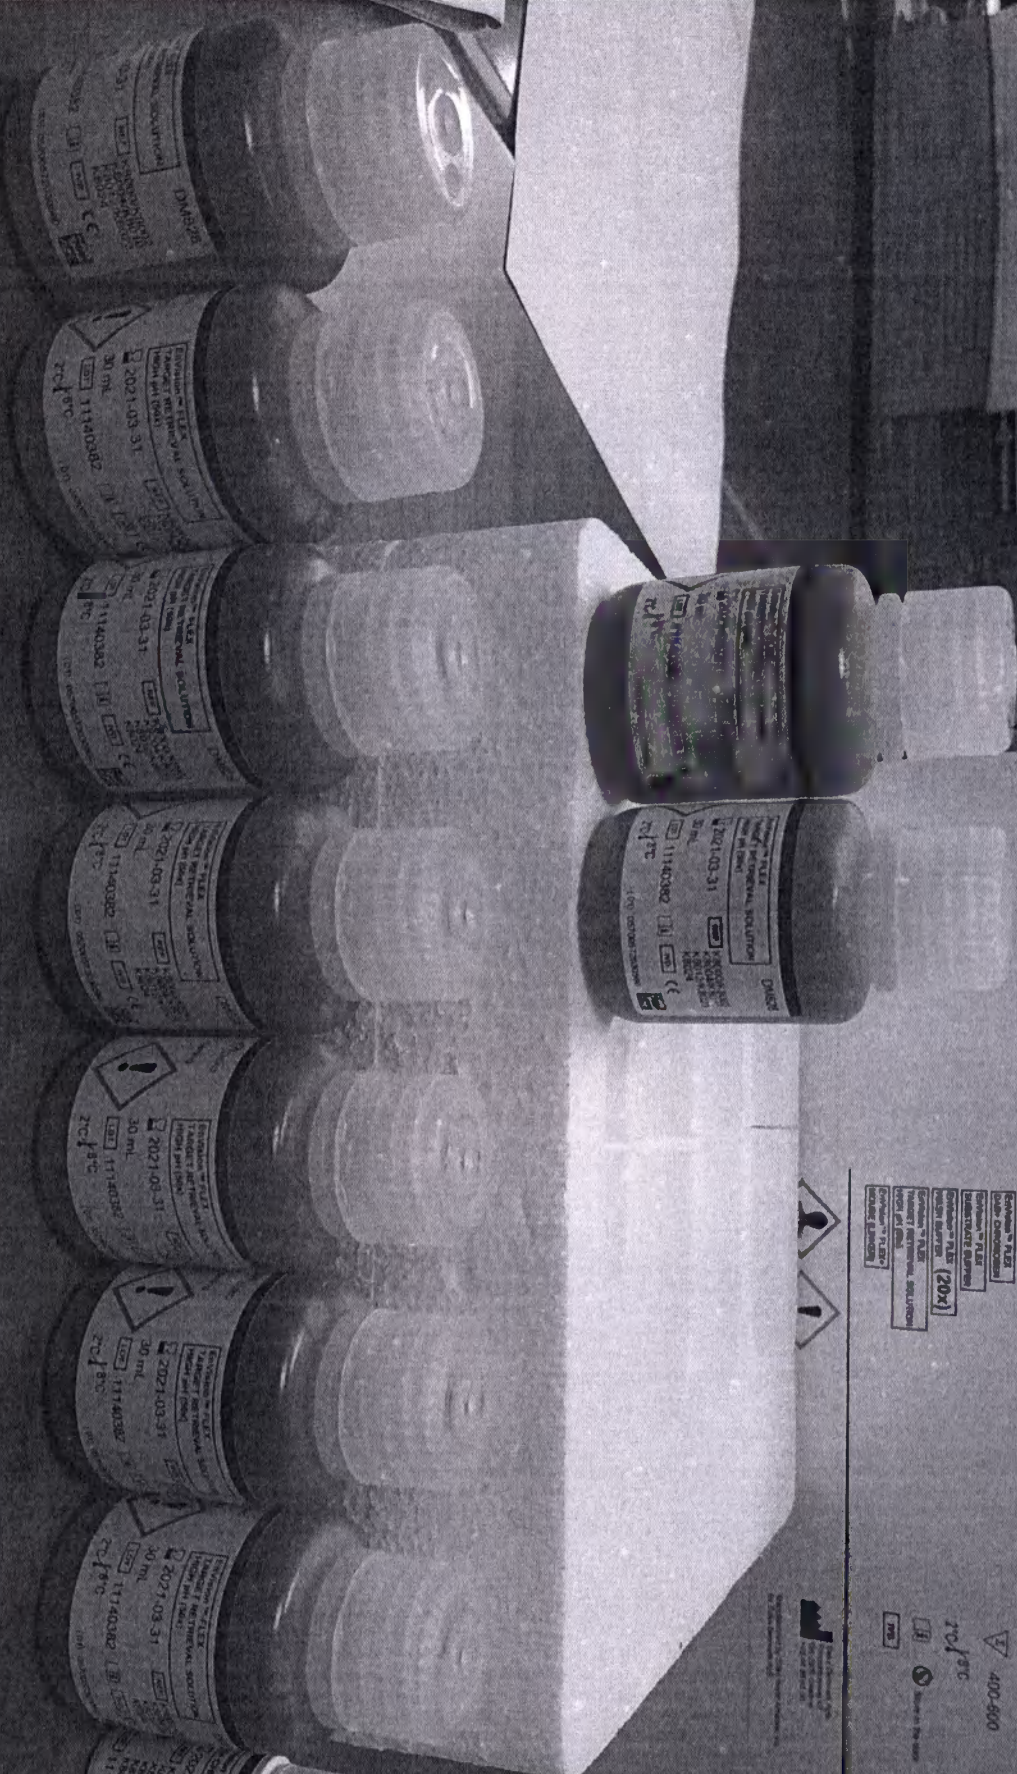

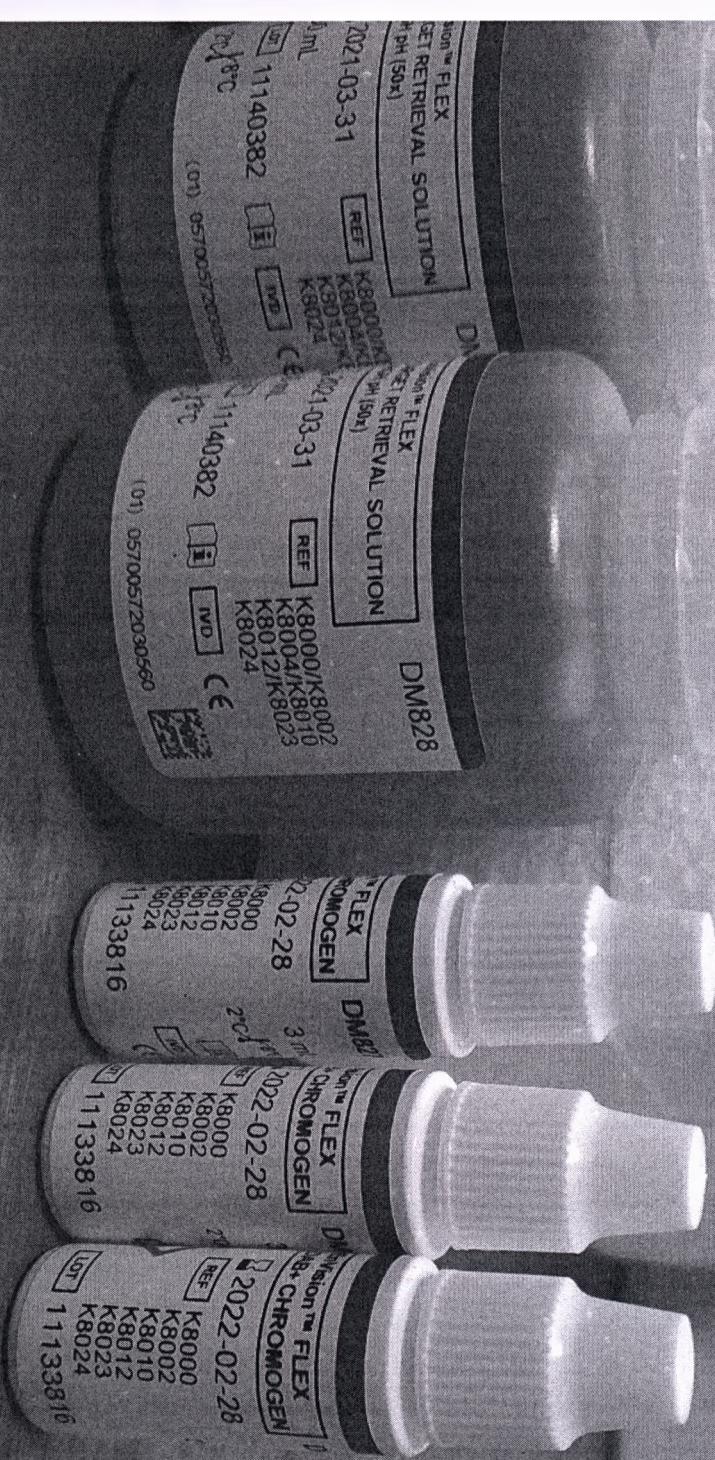

EnVision[®] FLEX+ Multi-Path Reader



174C

2021-03-31

REF K8000
K8002
K8023

LOT 11153200

40 mL

2021-03-31

REF K8000
K8002
K8023

LOT 11153200

40 mL

2021-03-31

REF K8000
K8002
K8023

LOT 11153200

40 mL

2021-01-31

REF K8000
K8002
K8023

LOT 11133819

40 mL

2021-01-31

REF K8000
K8002
K8023

LOT 11133819

40 mL

2021-01-31

REF K8000
K8002
K8023

LOT 11133819

40 mL

 2021-02-28

REF K8002
K8021

LOT 11133822

40 mL

2°C  8°C



IVD

CE

 2021-02-28

REF K8002
K8021

LOT 11133822

40 mL

2°C  8°C



IVD

CE

 2021-02-28

REF K8002
K8021

LOT 11133822

40 mL

2°C  8°C



IVD

CE



Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

8 (восемь) листов
цифрами прописью
Должность Генеральный директор
Подпись [подпись] / Иванов И.И.
« 18 » мая 2022 г. М.П.

