

**Физиотерапевтический программный комплекс ФПК «Андро-Гин», с принадлежностями по ТУ
26.60.13-001-29186439-2017**

Производства: Общество с ограниченной ответственностью «ФИЗИОТЕХ», Россия, 123458, г. Москва, ул. Маршала Прошлякова, д. 6, стр. 6, помещение III.

Рисунок 1.

Аппарат ФПК «Андро-Гин».

Рисунок 2.

Излучатель магнитно-лазерный внутриполостной с электростимулятором.

Рисунок 3.

Излучатель лазерный с электростимулятором (уретральный).

Рисунок 4.

Головка излучающая магнитно-лазерная терапевтическая.

Рисунок 5.

Электрод для накожной электростимуляции.

Рисунок 6.

Очки для цветоритмотерапии.

Рисунок 7.

Электрод пластинчатый индифферентный для электростимуляции.

Рисунок 8.

Световод.

Рисунок 9.

Кабель световодный магистральный.

Рисунок 10.

Катетер уретральный.

Рисунок 11.

Кабель естевой.

Рисунок 12.

Наконечник для внутриполостного излучателя.

Рисунок 13.

Программное обеспечение ФПК "Андро-Гин".

Рисунок 14.

Кабель соединительный с компьютером.

Рисунок 15.

Тесты Люшера.

Рисунок 16.

Методические рекомендации.

Рисунок 17.

Паспорт-руководство по эксплуатации.

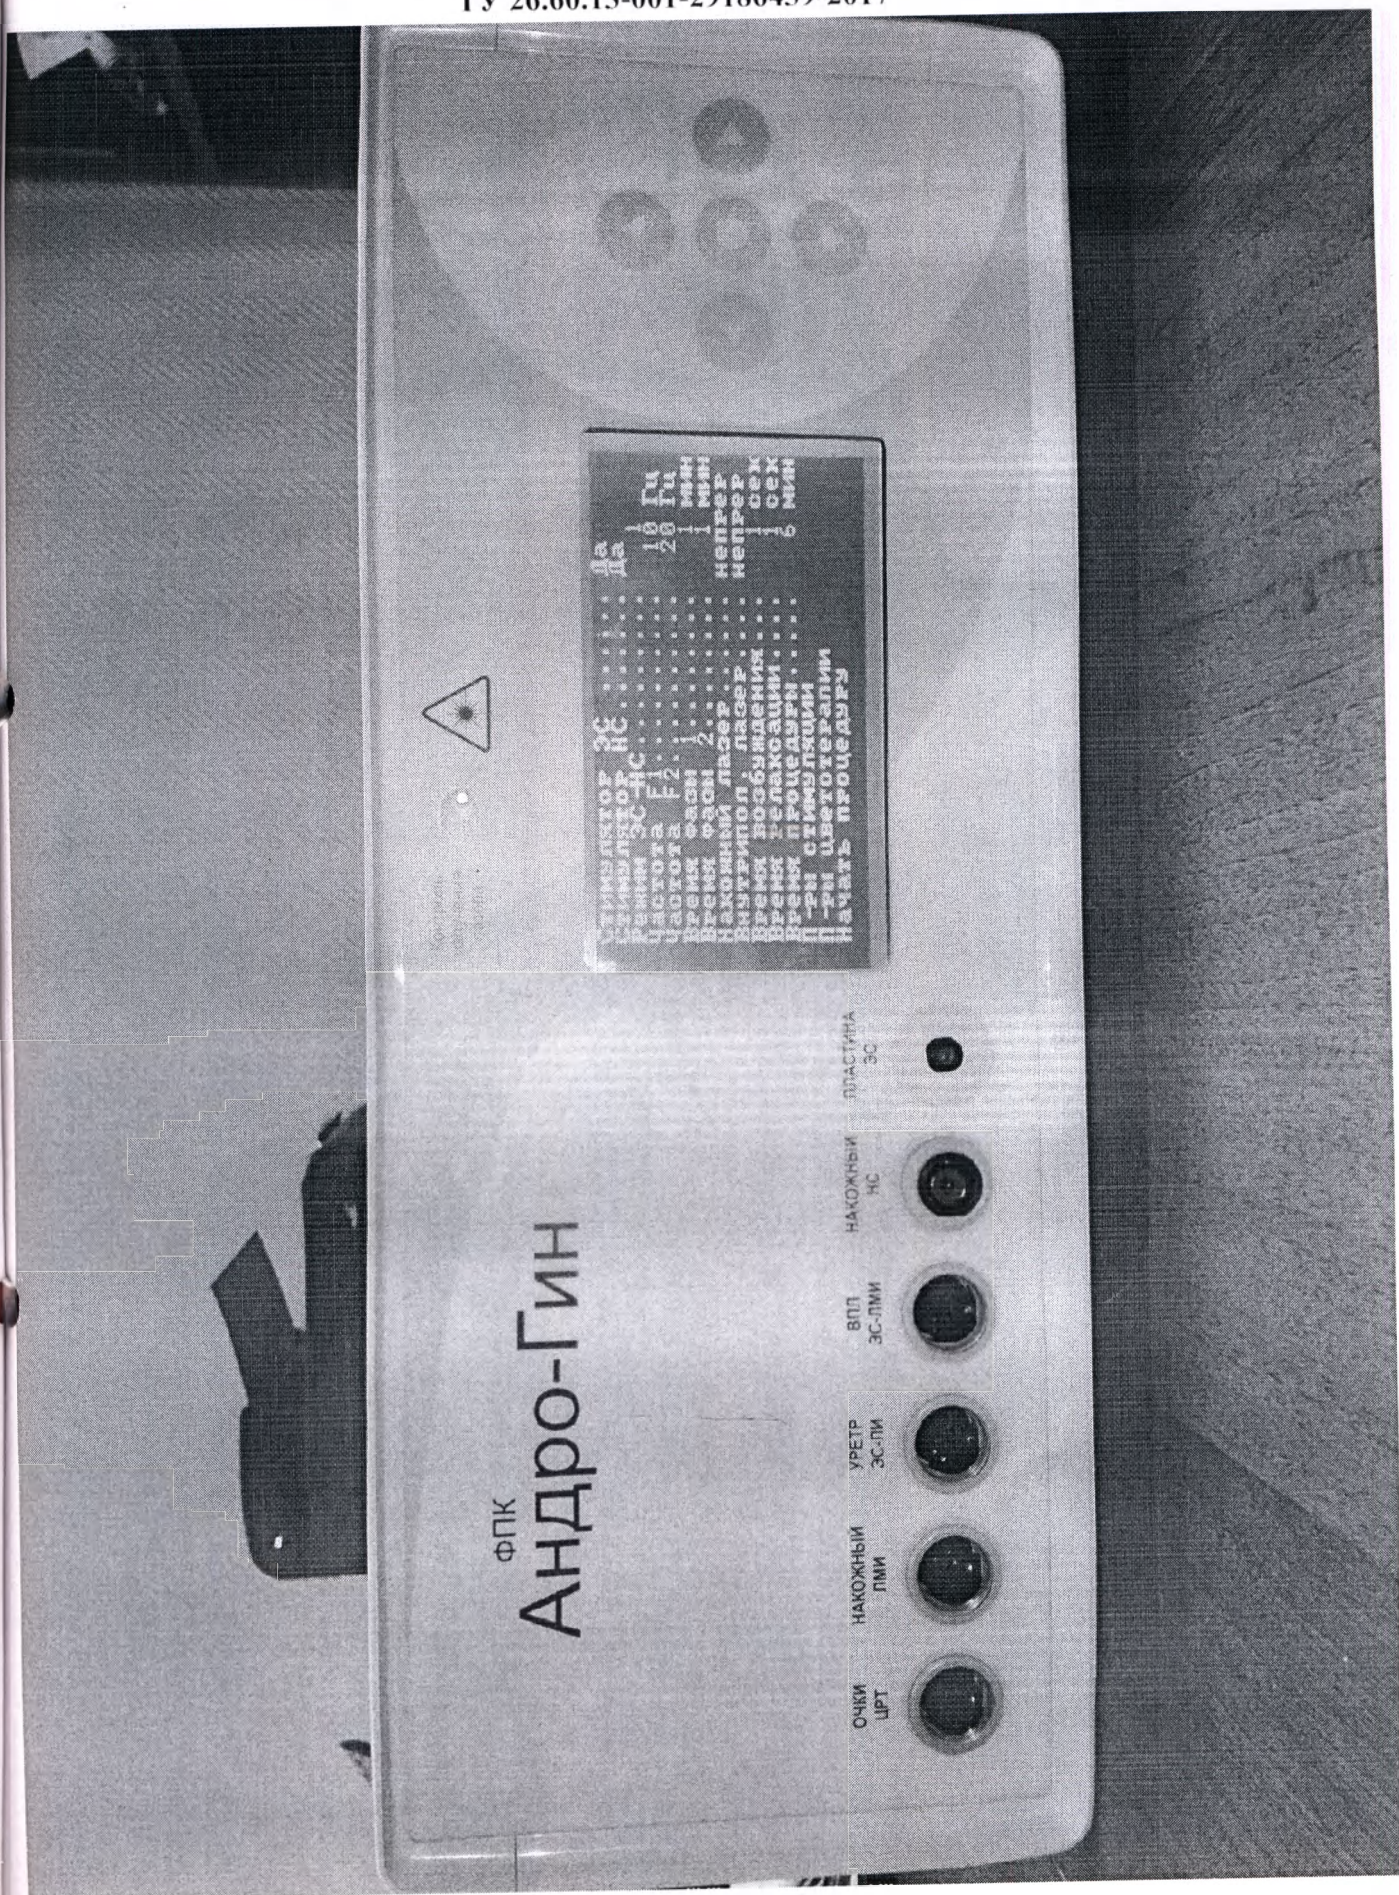


Рисунок 1.



Рисунок 2.

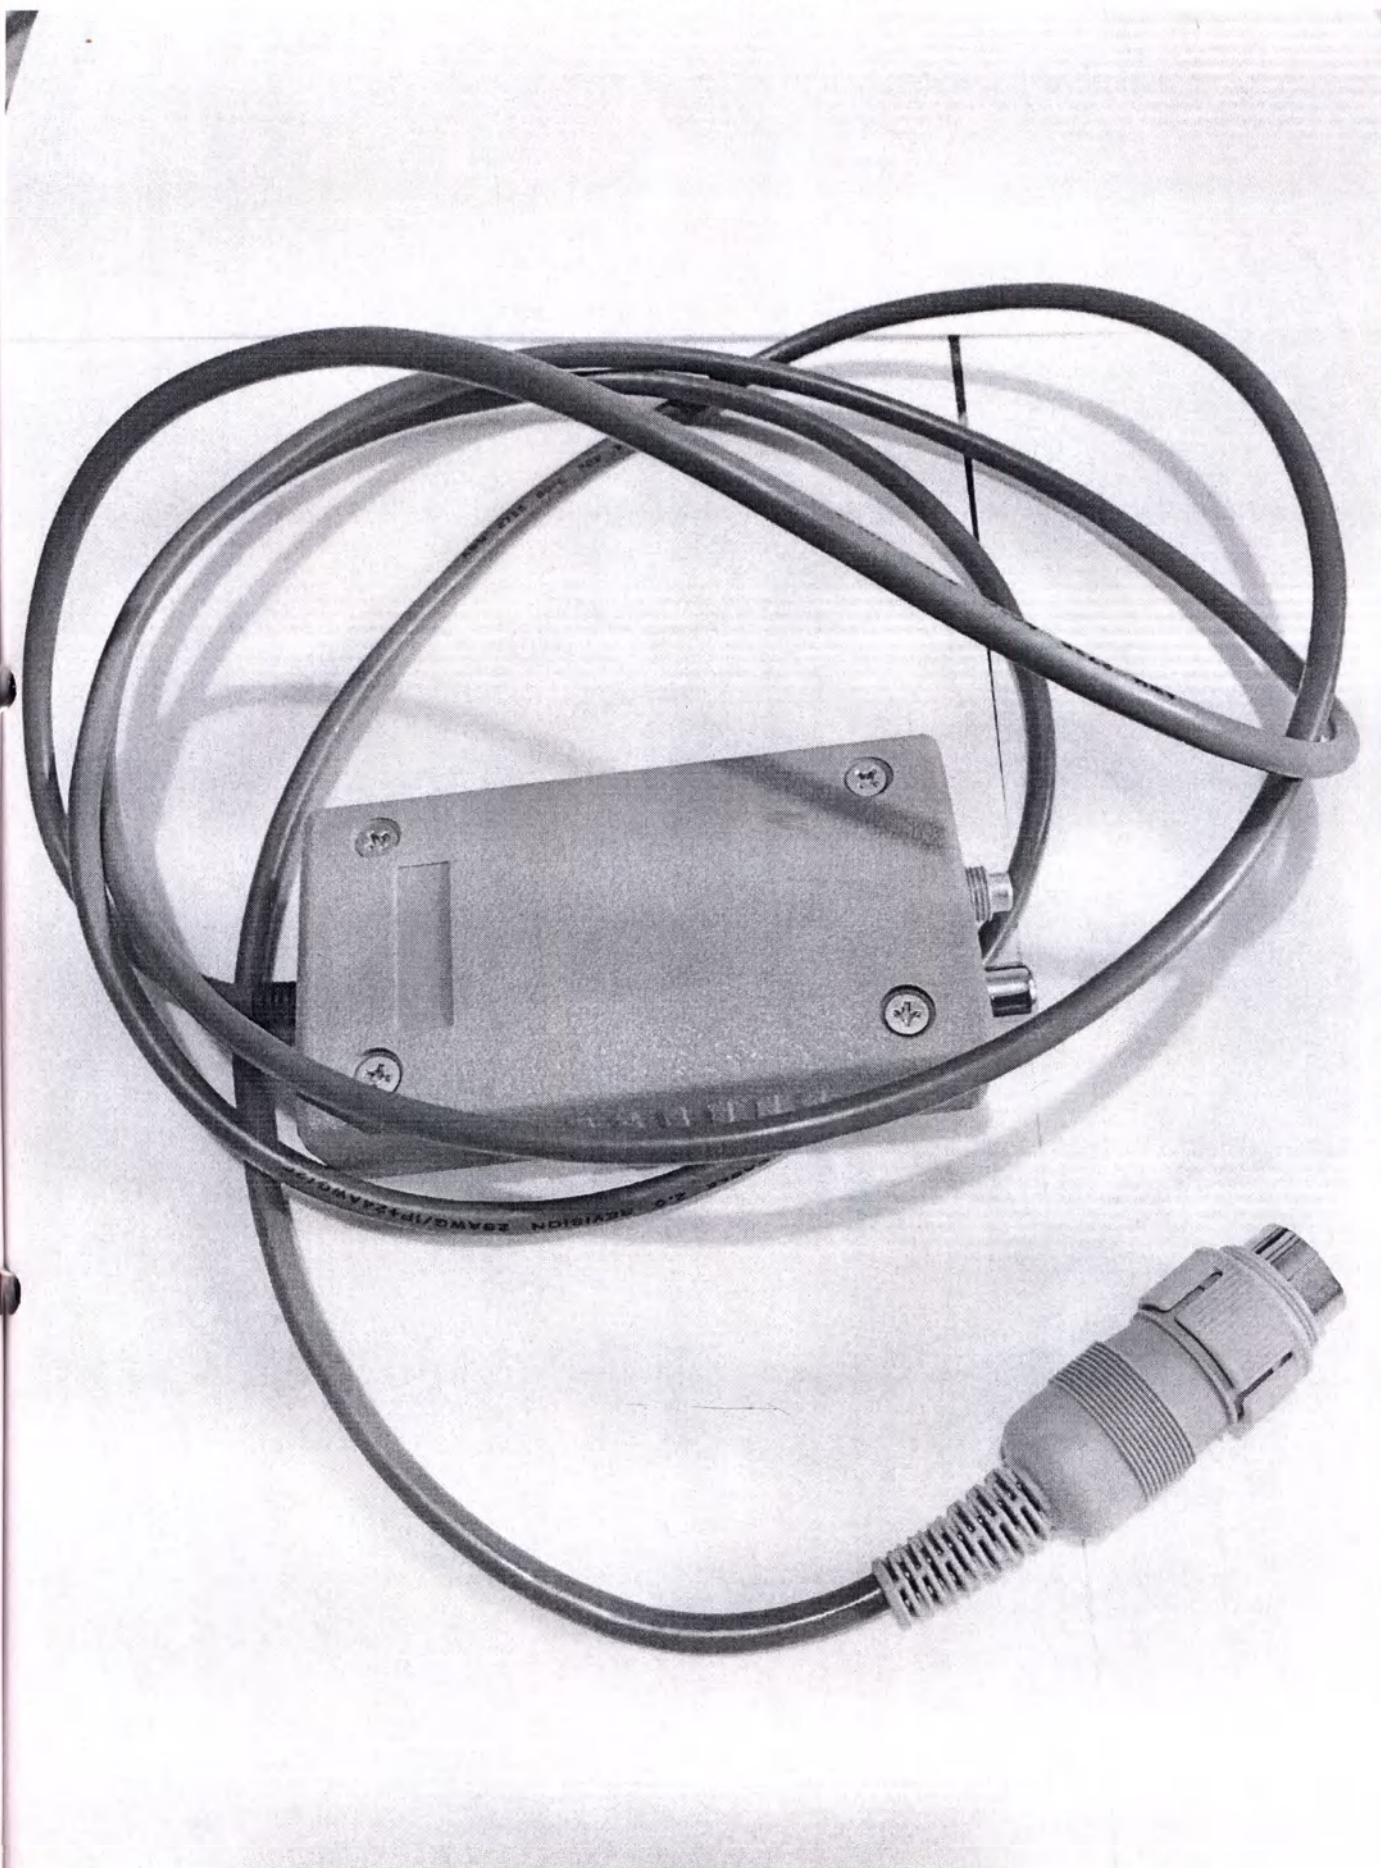


Рисунок 3.

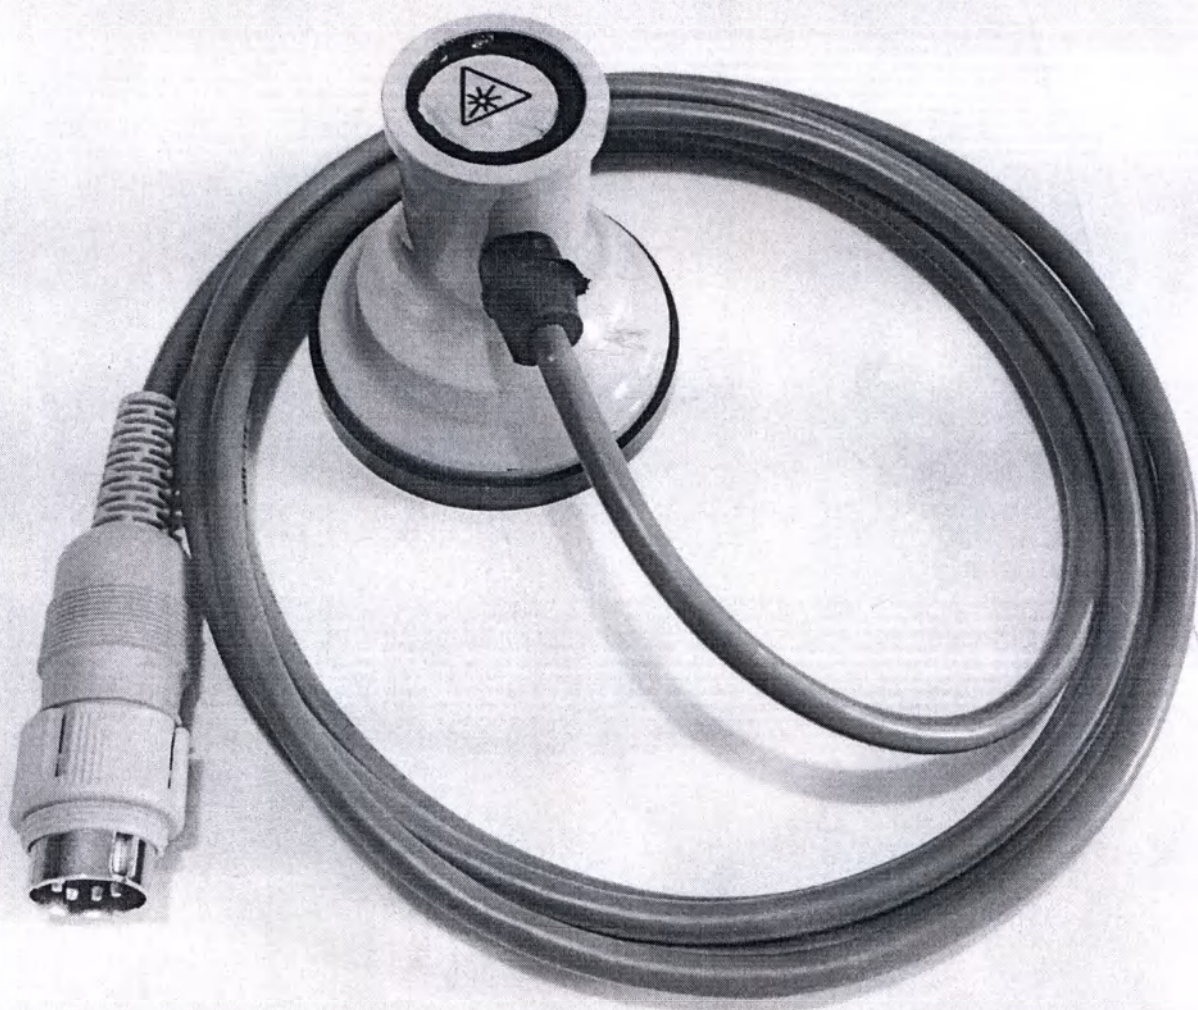


Рисунок 4.



Рисунок 5.

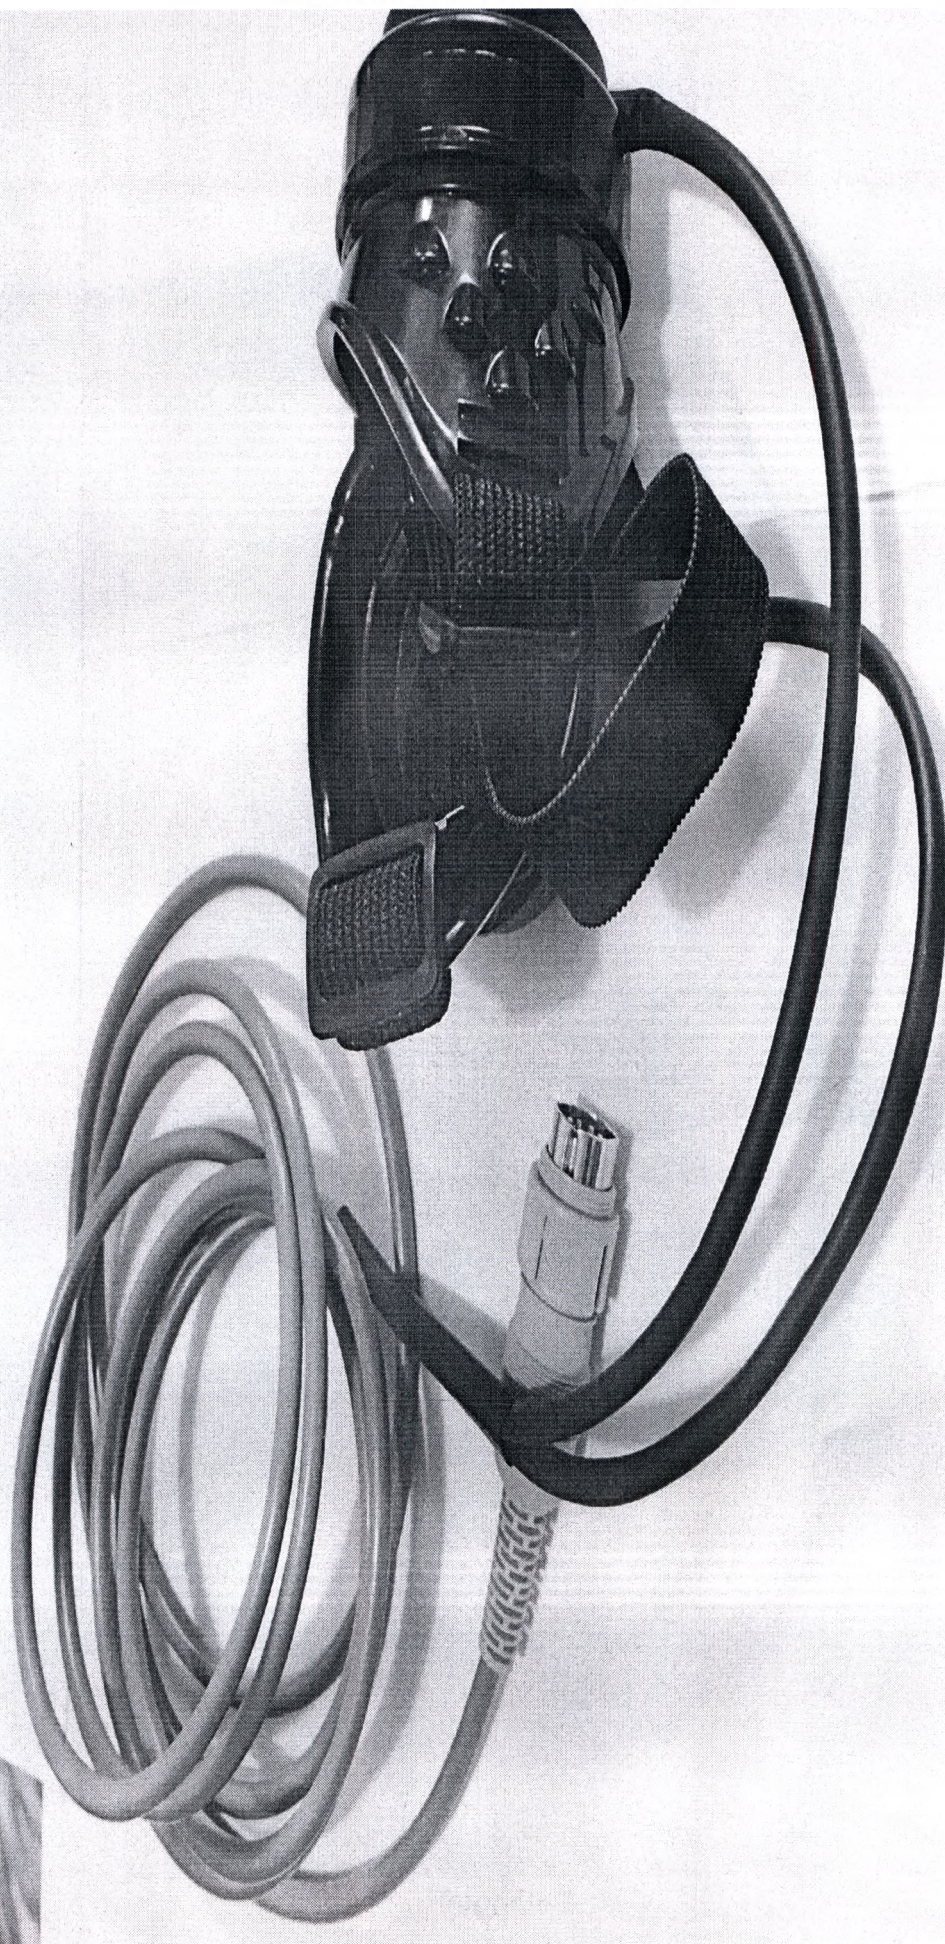


Рисунок 6.

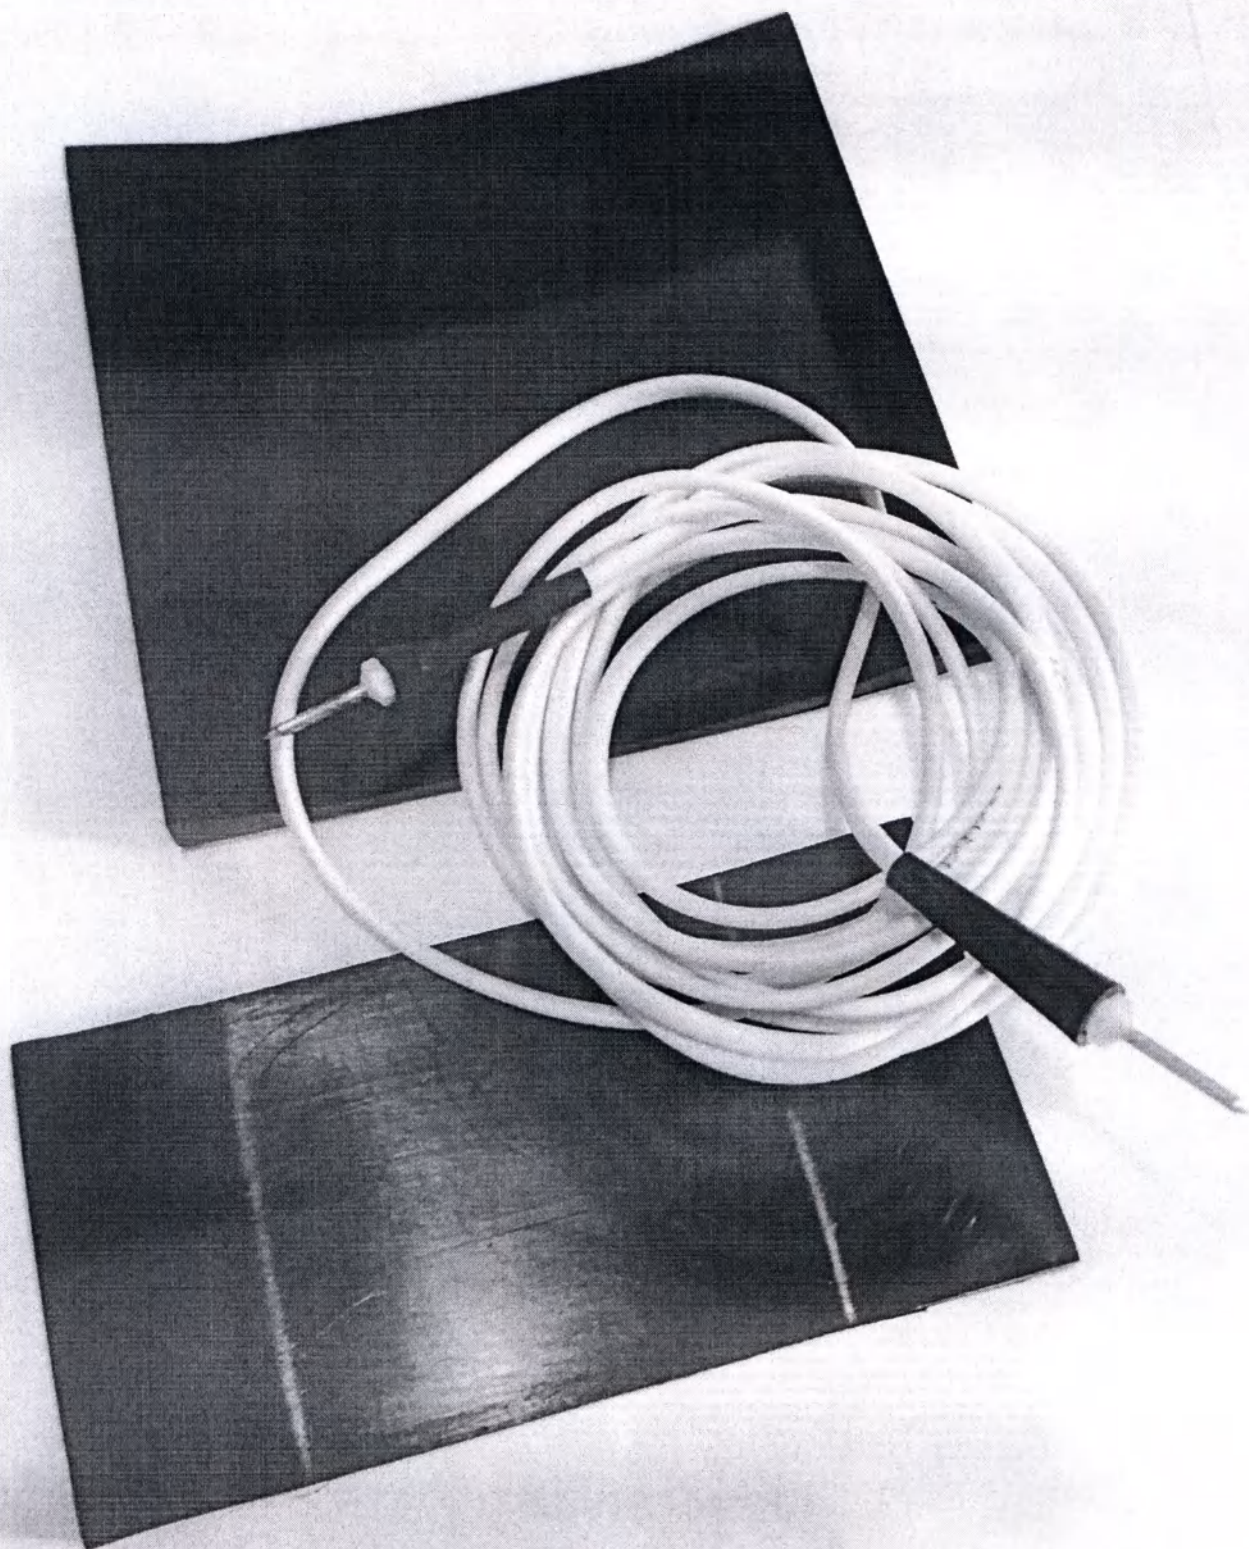


Рисунок 7.

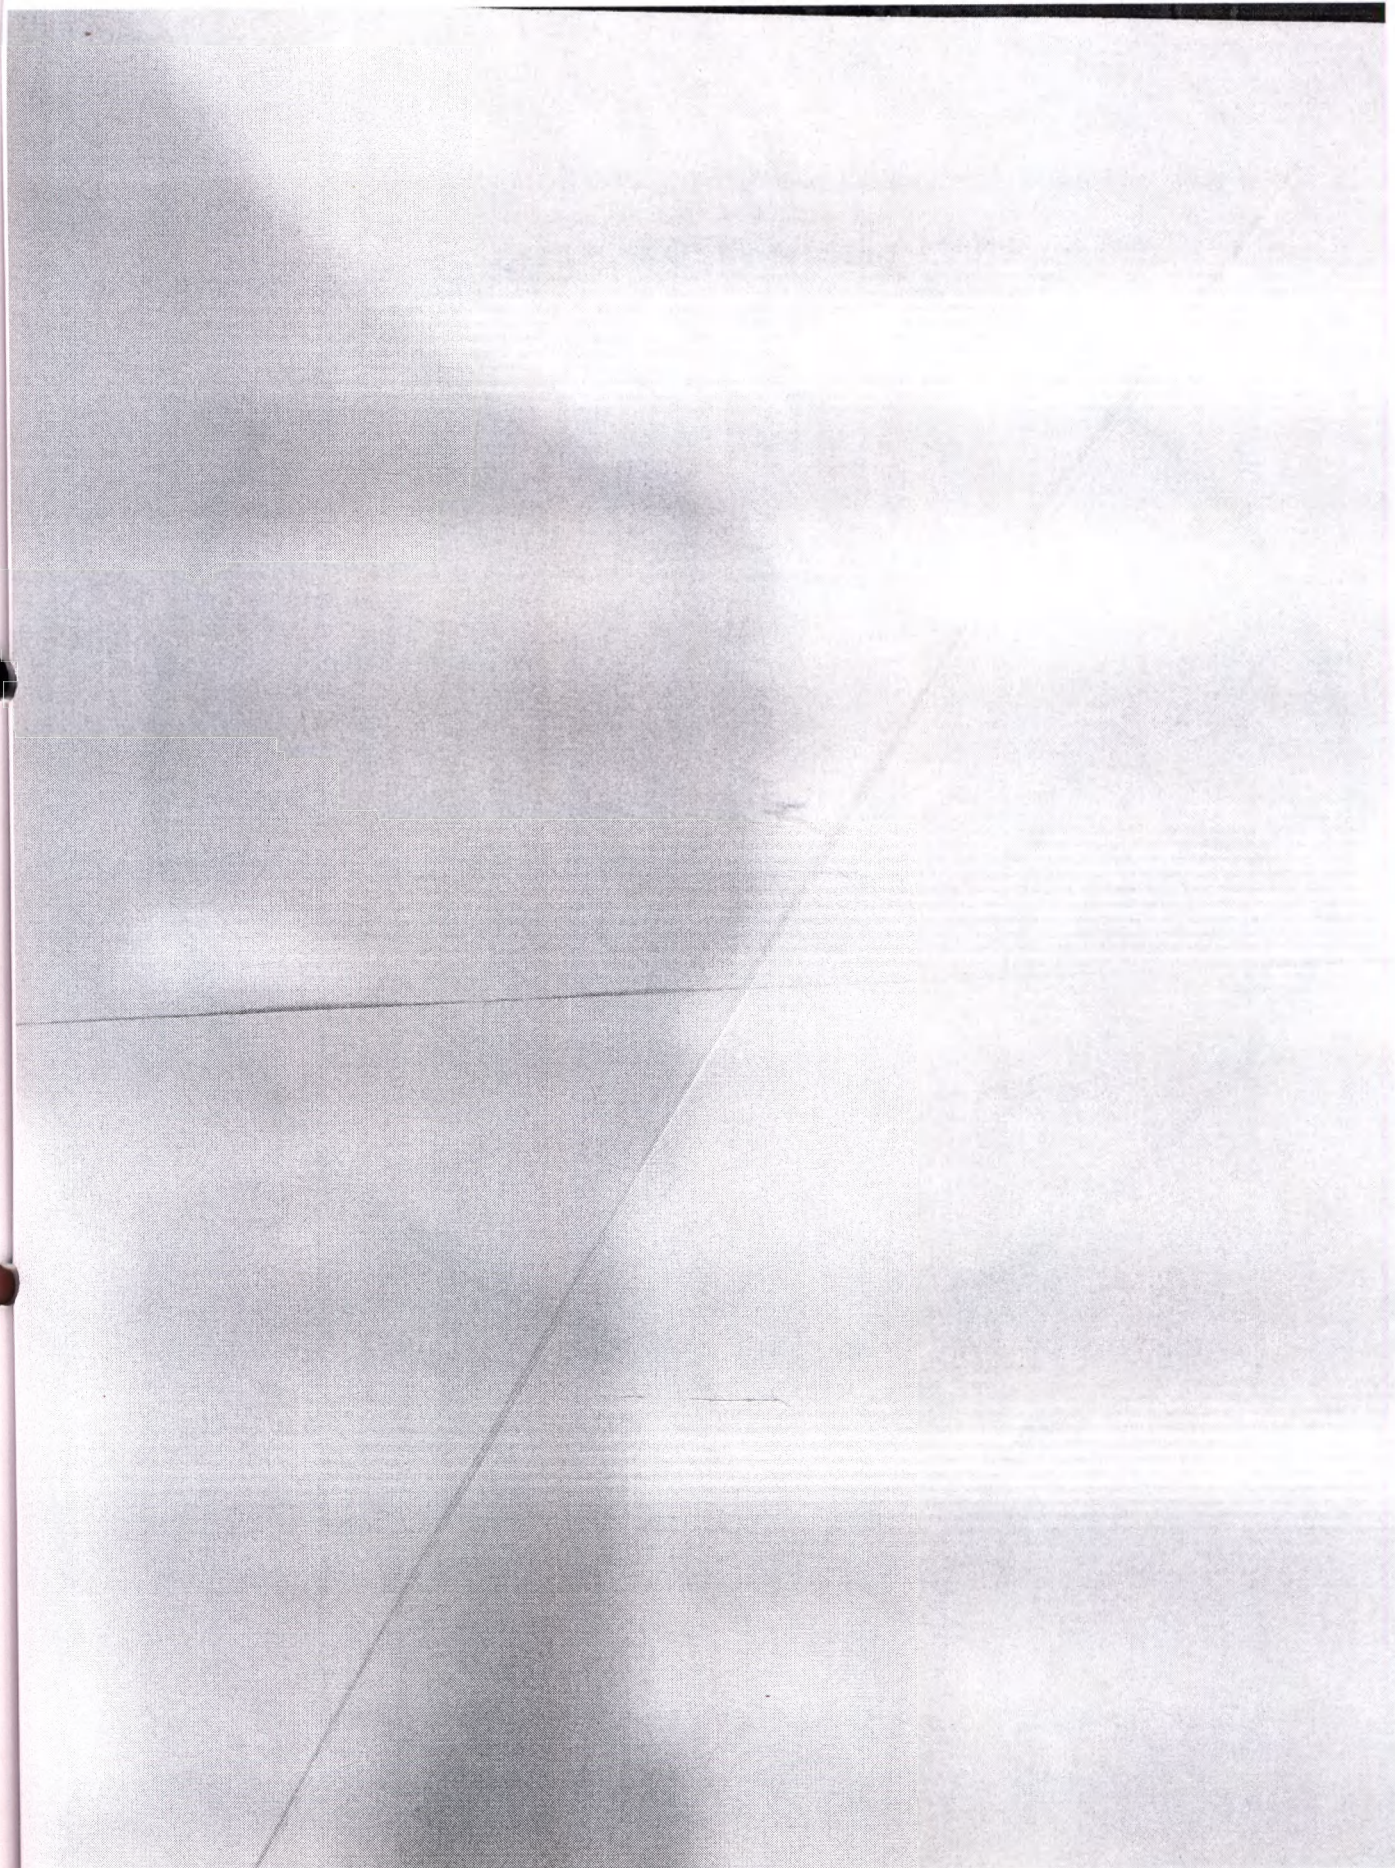


Рисунок 8.

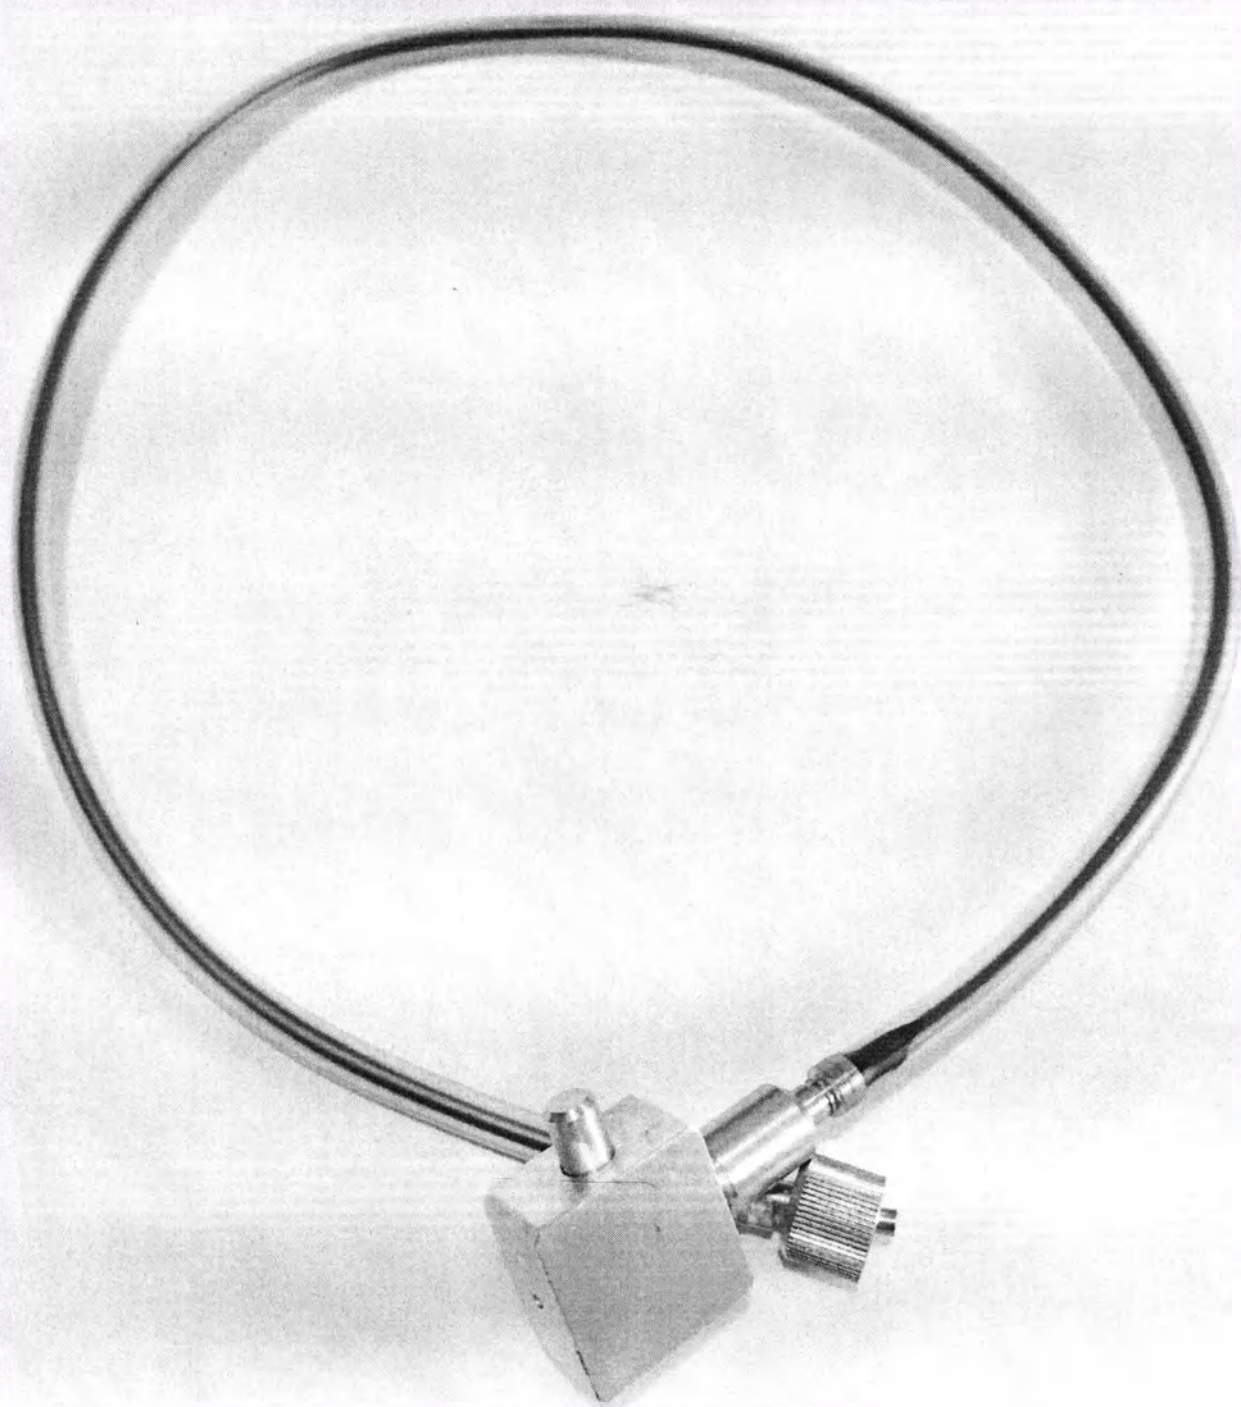


Рисунок 9.

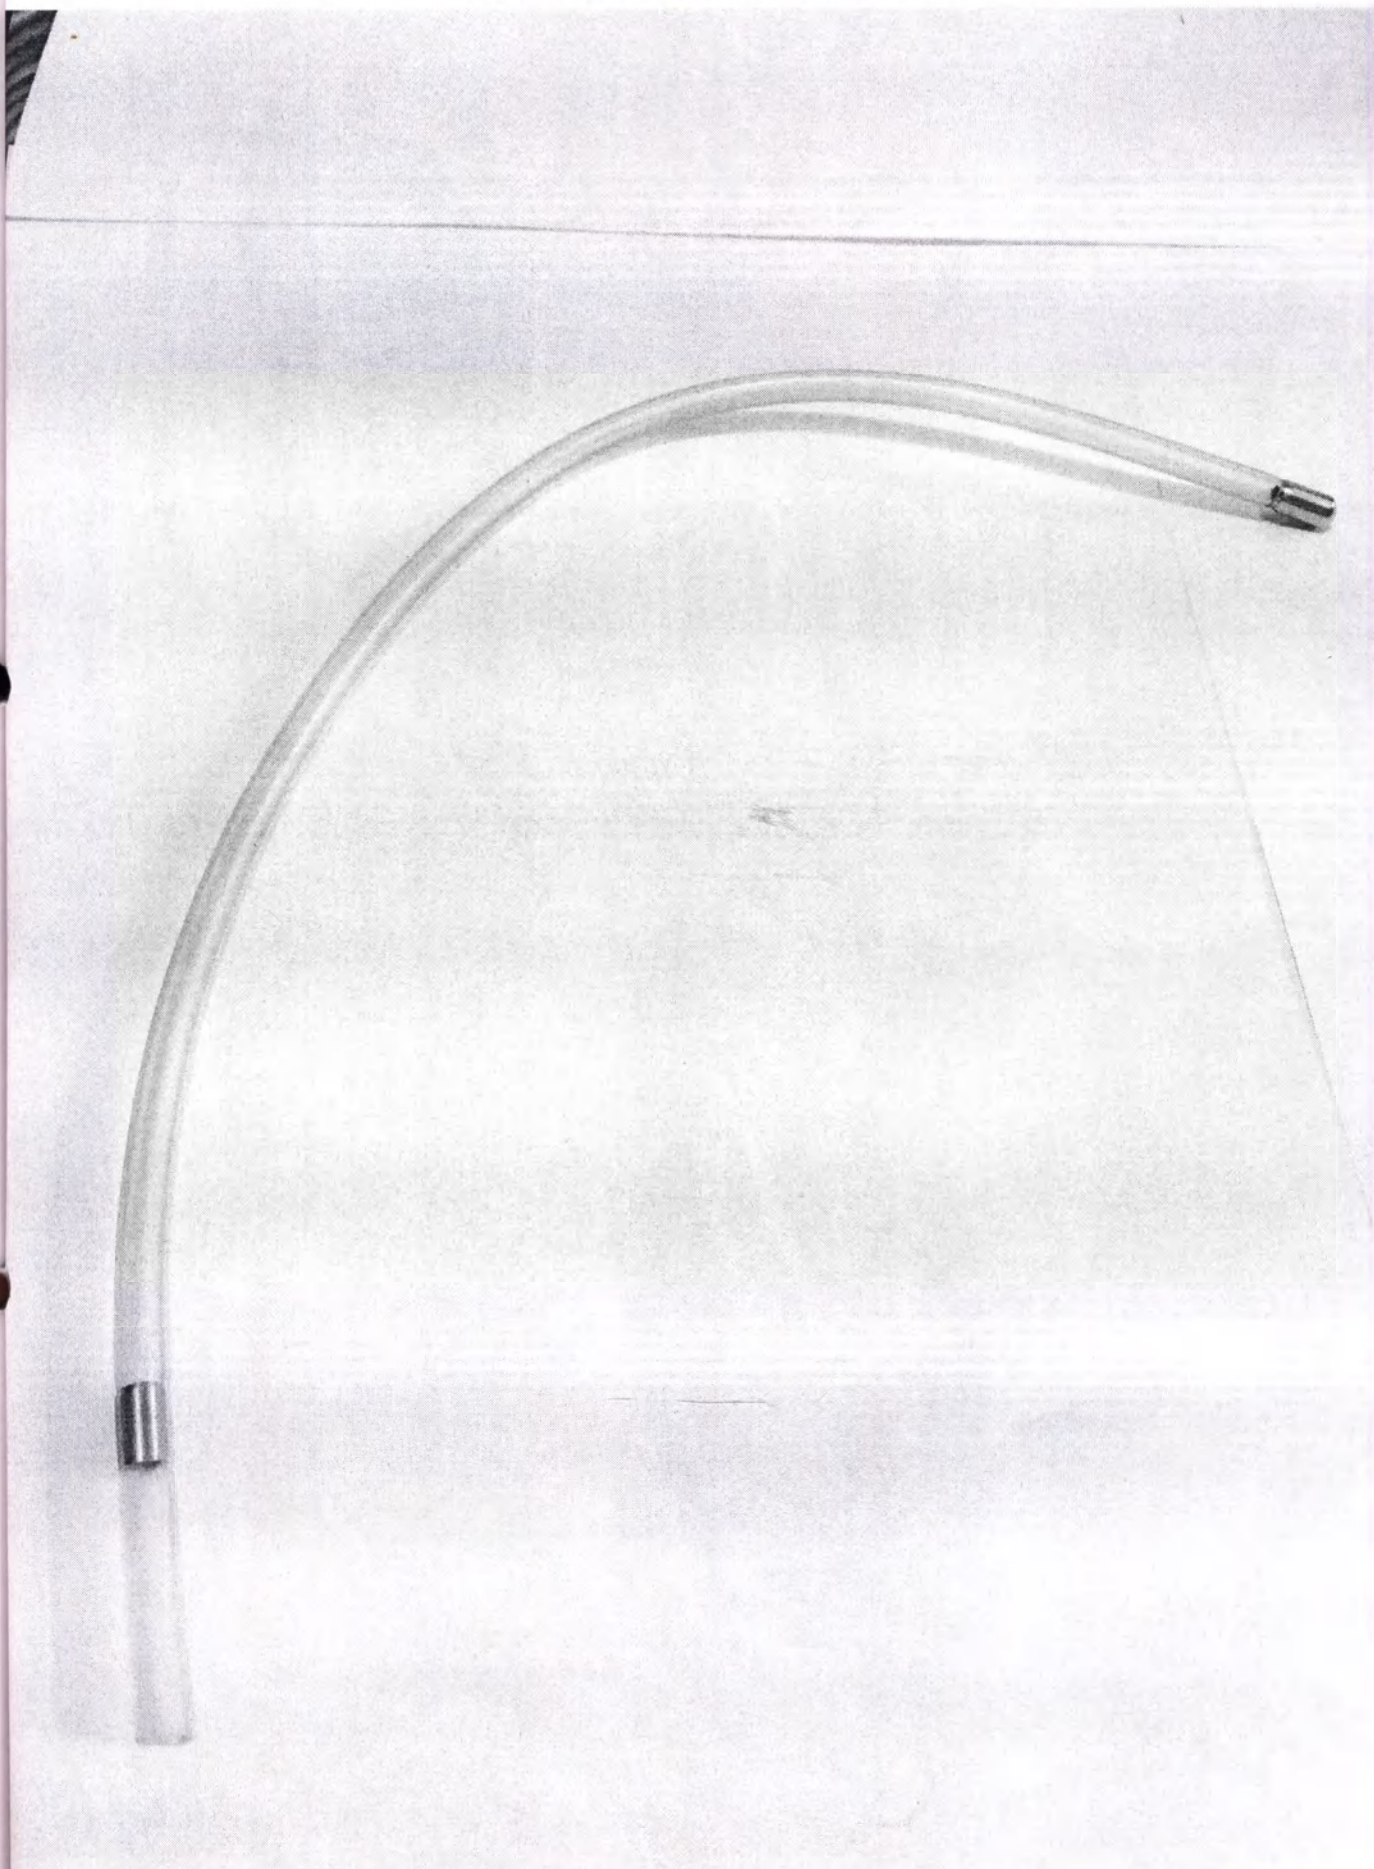


Рисунок 10.



Рисунок 11.

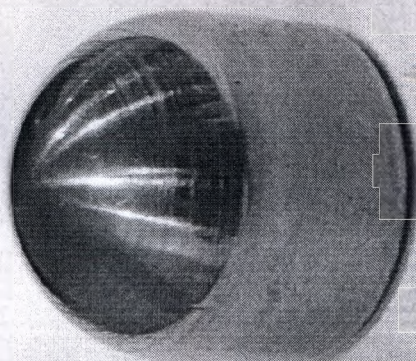


Рисунок 12.

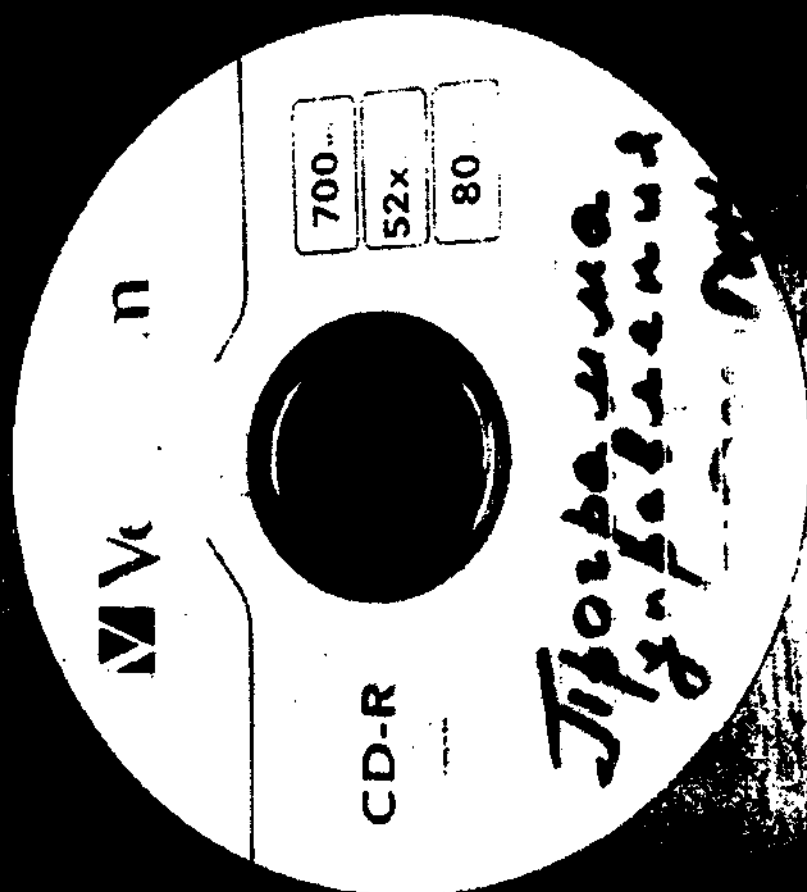


Рисунок 13.

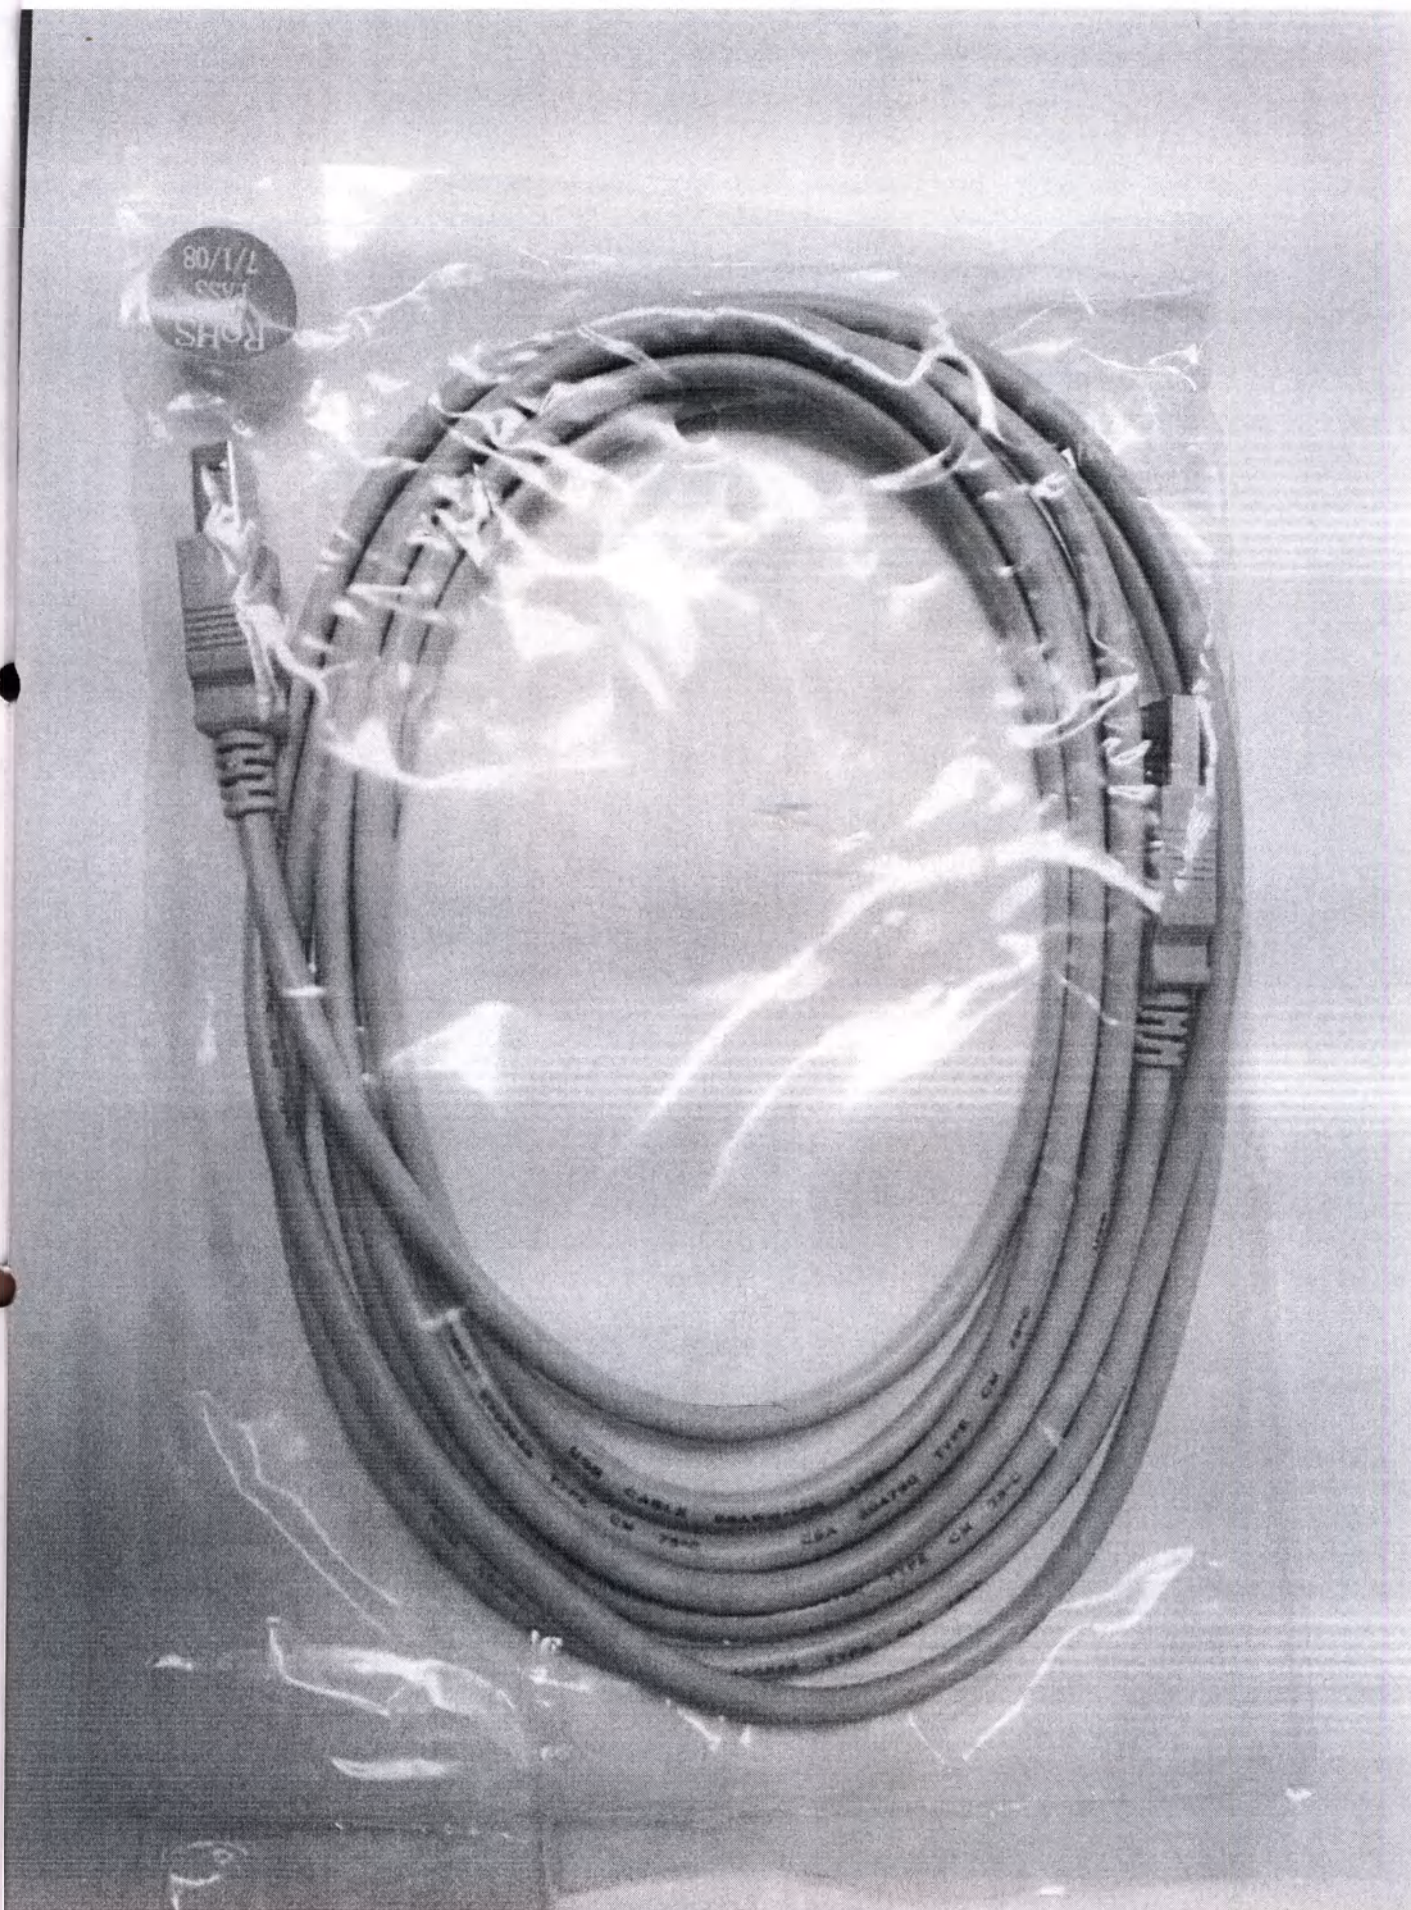


Рисунок 14.



ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ

ВОСЬМИЦВЕТОВОЙ тест ЛЮШЕРА

руководство по использованию

Рисунок 15.

ООО «ФИЗИОТЕХ»

ПРИМЕНЕНИЕ ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО
ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА
ФПК «Андро-Гин»
ПРИ ЛЕЧЕНИИ УРОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

г. Москва

Рисунок 16.

Физиотерапевтический программный комплекс
ФПК «Андро-Гин»

Паспорт
с техническим описанием и инструкцией
по эксплуатации

ООО «ФИЗИОТЕХ»
г. Москва

Рисунок 17.

Всего прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью 18 листов

Генеральный директор

И.Е.Маниото

