

Фотографические изображения общего вида
«Тест для выявления скрытой крови в кале (Экспресс-тест для определения скрытой крови)».
Состав №1
Комплект 1, серия 001 от 2019.02., срок годности до 2021.02.

ИнВитроТест


Условия хранения: при температуре от плюс 2
Замораживание не допускается.

21.20.23-001-1139015-24
Система № 1
Комплект №1 (10 определений)
№ лота (серия) 01

№ п/п	Наименование компонента Характеристики	Описание
Внешний вид компонентов		
1.	Тест-полоска 10 шт.	Тест-полоска представляет собой мембрану, наклеенную на твердую подложку. Тест-полоска упакована в индивидуальную фольгированную упаковку 120x60 мм, защищенную от влаги.
2.	Пробирка 10 шт.	Пластиковая пробирка с откалиброванным объемом со встроенным индикатором содержания экстрагирующей буфер (2 мл).
Технические характеристики		
3.	pH экстрагирующего буферного раствора для подготовки проб	От 7,2 до 7,4
Специфические характеристики		
4.	Время достижения устойчивых результатов (СОП-001), мин.	5 минут
5.	Аналитическая чувствительность (СОП- 001), мкг/мл	30
6.	ИнВитроТест Тест для выявления скрытой крови в моче (Экспресс-тест для определения скрытой крови) Тест-полоска 187 001 02 2021	



Комплект 2, серия 003 от 2019.02., срок годности до 2021.02.

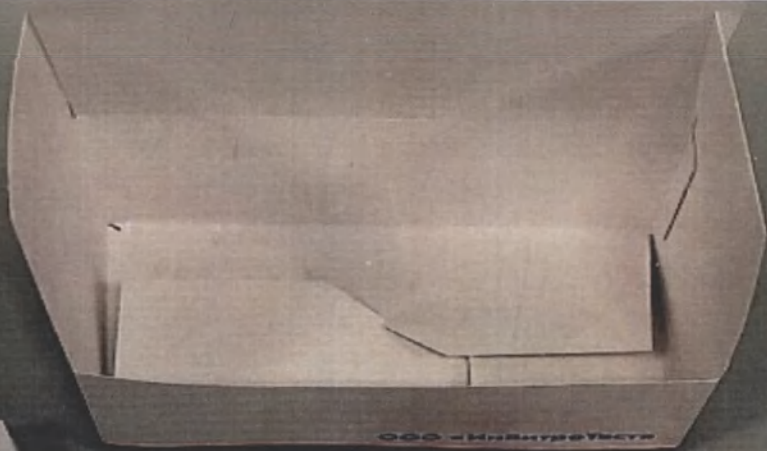

Инструкция по применению
Тест-полоски для определения уровня глюкозы в моче
в моче (глюкоза) с помощью тест-полоски ИнВитроТест

Составляющие:
1. Тест-полоска (20 шт.)
2. Пробирка (20 шт.)
3. Упаковка (20 шт.)

Условия хранения: при температуре от +5 до +25 °С в сухом месте.

ТУ 21.20.33-001-11299515-2020
Составляющие:
1. Тест-полоска (20 шт.)
2. Пробирка (20 шт.)
3. Упаковка (20 шт.)


Условия хранения: при температуре от +5 до +25 °С в сухом месте.

№ п/п	Наименование компонента	Характеристики	Описание
1.	Тест-полоска	20 шт.	Тест-полоска, предназначенная для определения уровня глюкозы в моче (глюкоза) с помощью тест-полоски ИнВитроТест. Тест-полоска упакована в индивидуальную фольгированную упаковку 120x60 мм, изготовленную из полипропилена.
2.	Пробирка	20 шт.	Пластиковая пробирка с градуировкой, содержащая 60 мкл калийфосфатного буфера (2 мМ).
3.	Технические характеристики		
3.1.	pH ингибирующего буферного раствора для подготовки проб		От 7,2 до 7,4
4.	Специфические характеристики		
4.1.	Время достижения устойчивых результатов (СОП-001), мин.		5 мин.
4.2.	Аналитическая чувствительность (СОП-001), мМ/л		30
4.3.	Относительная чувствительность		
5.	Относительная чувствительность		

Тест для определения уровня глюкозы в моче (глюкоза) с помощью тест-полоски ИнВитроТест. Тест-полоска 001 02.2021



Комплект 3, серия 005 от 2019.02., срок годности до 2021.02.

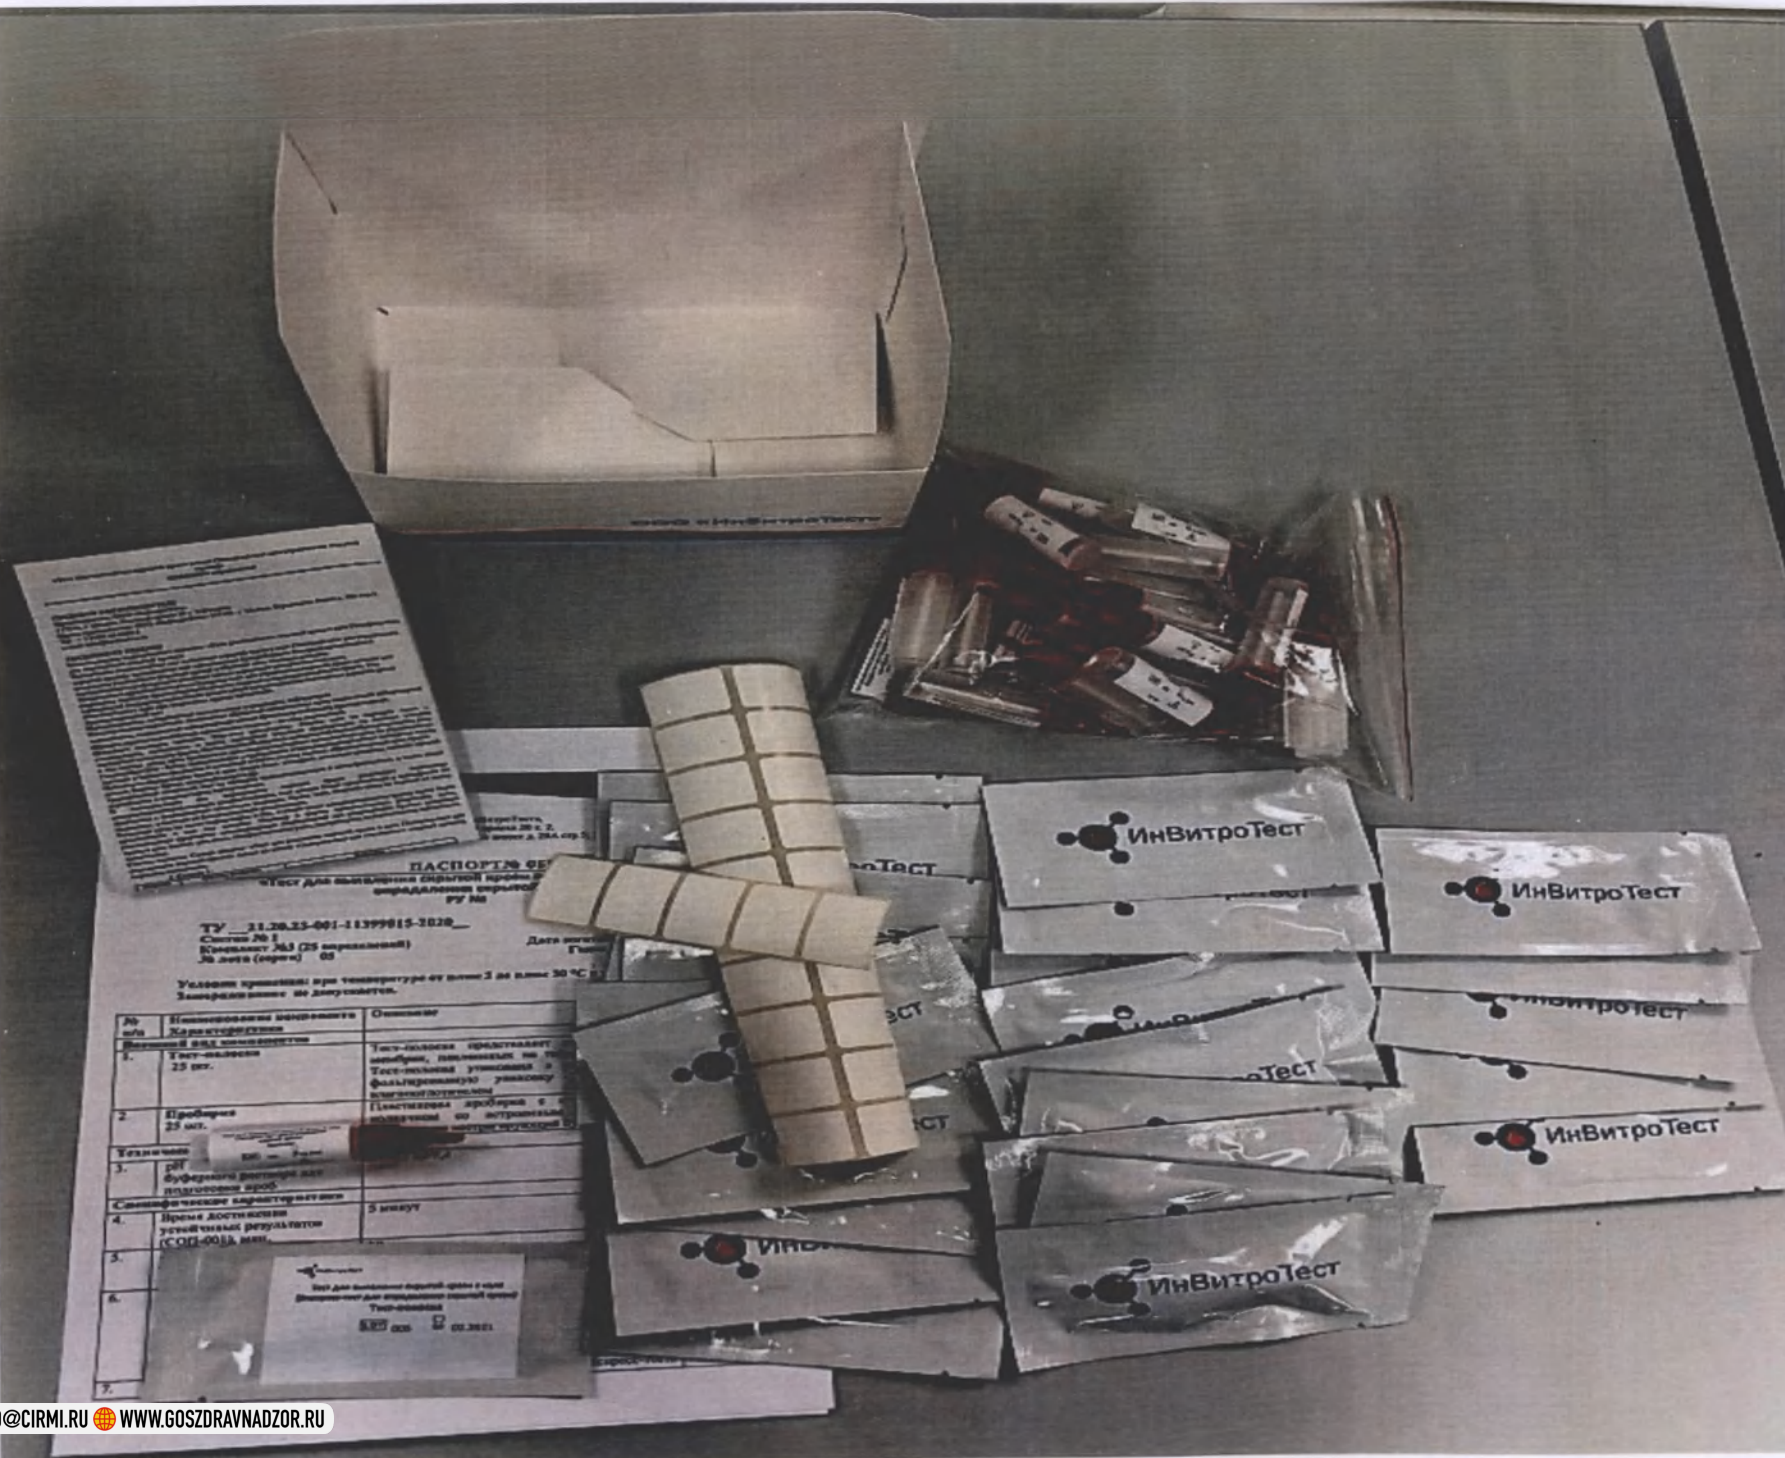

ИнВитроТест
Система № 1
Содержит №3 (25 тестовых наборов)
№ лота (серия) 03

ПАСПОРТ БЕЗВИРУСНОСТИ
Тест для выявления скрытой формы
определенной инфекции
ТВ-10

ТУ 31.20.25-001-11399815-3020
Система № 1
Содержит №3 (25 тестовых наборов)
№ лота (серия) 03

Условия хранения: при температуре от плюс 2 до плюс 30 °С
Замораживание не допускается.

№ п/п	Наименование компонента	Описание
1.	Тест-полоска 25 шт.	Тест-полоска представляет собой, выполненную на тест-полоске, утонченную и фильтрованную утонченную полимерную пленку.
2.	Пробирка 25 шт.	Пластиковая пробирка с 1 мл раствора изотонического раствора.
3.	Указатель pH	Указатель pH
4.	Время достижения устойчивого результата (СОВ-001), мин.	3 минут


Тест для выявления скрытой формы
определенной инфекции
ТВ-10

ИнВитроТест

Комплект 4, серия 009 от 2020.01., срок годности до 2022.01.

Состав №2

Комплект 1, серия 002 от 2019.02., срок годности до 2021.02.

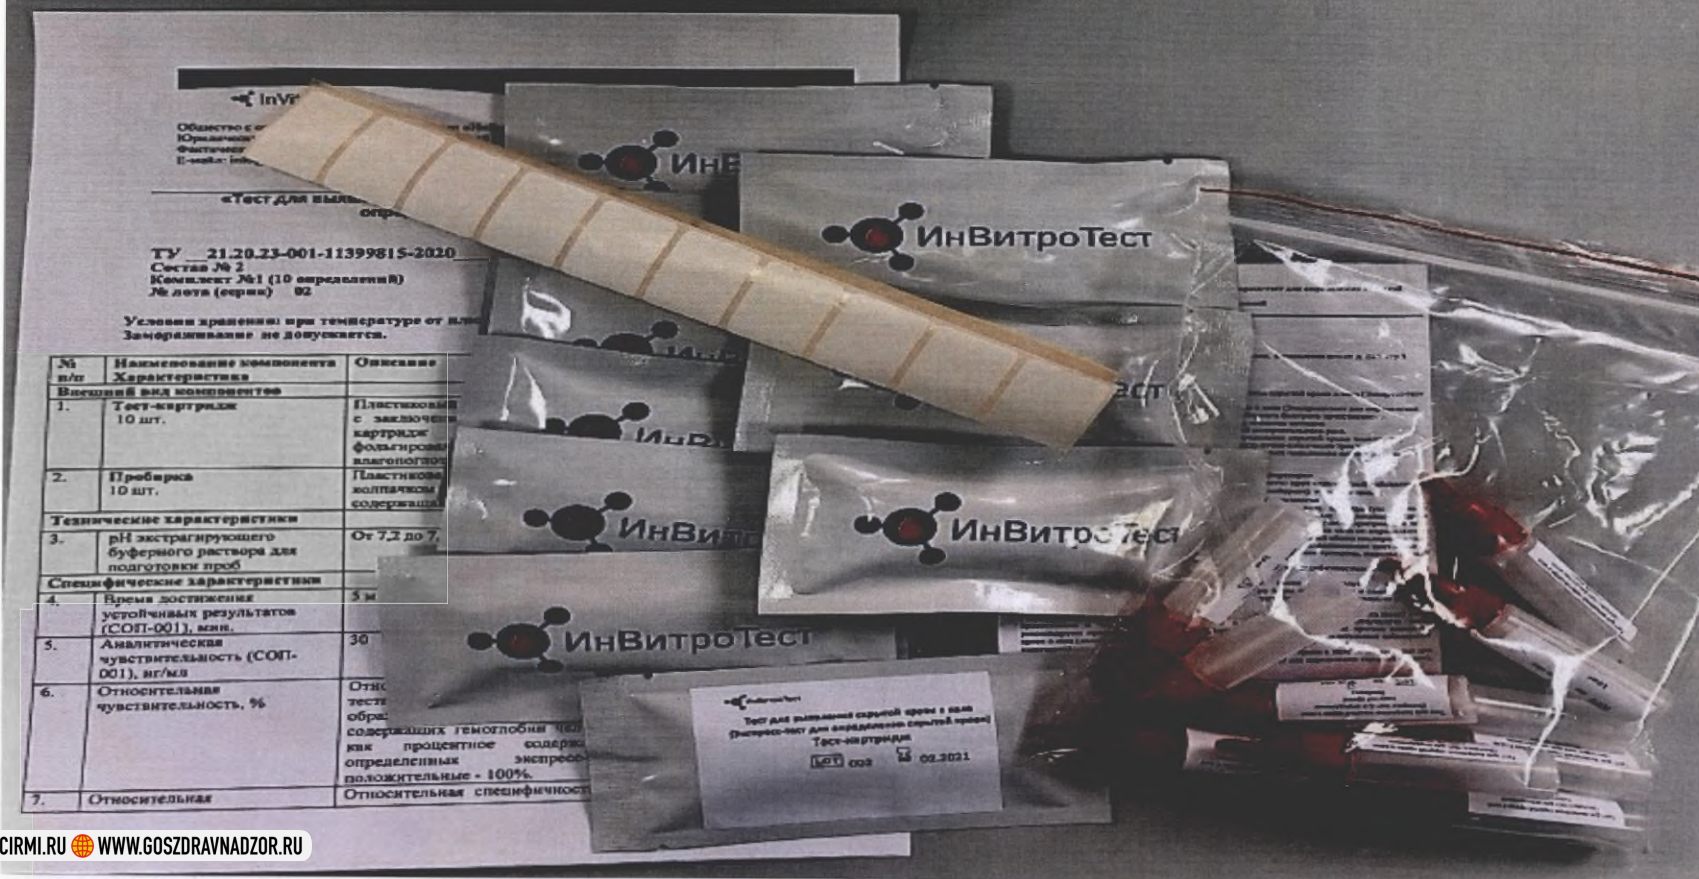

Комплект 2, серия 004 от 2019.02., срок годности до 2021.02.

ООО «ИНВИТРОТЕСТ»

Организация
Юридический адрес
Фактический адрес
E-mail: info@invitrotest.ru

а/тест для выявления
отрицания

ТУ 21.20.23-001-1139815-2020
Серия № 2
Комплект №2 (20 определений)
№ лота (серия) 04

Условия хранения: при температуре от 2 до 8°C
Замораживание не допускается.

№	Наименование количества	Описание
1.	Характеристики Тест-картридж 20 шт.	Пластиковый тест-картридж с закрывающейся крышкой, содержащий 20 порционных порций реагента для выявления отрицания
2.	Пробирка 20 шт.	Пластиковая пробирка с крышкой, содержащая реагент
3.	Технические характеристики рН экстракционного буферного раствора для подготовки пробы	От 7,2 до 7,4
4.	Специфические характеристики Устойчивость	3 минут

InvitroTest

InvitroTest

InvitroTest

InvitroTest

Тест для выявления отрицания при
использовании реагента InvitroTest
Тест-картридж
Код 004 В 02.2021

Комплект 3, серия 006 от 2019.02., срок годности до 2021.02.



Инструкция по применению препарата «ИНВИТРОТЕСТ»
для определения уровня гормонов в крови и моче
с помощью тест-полосок.

1. Назначение: препарат предназначен для определения уровня гормонов в крови и моче с помощью тест-полосок.

2. Состав: препарат содержит тест-полоски, упакованные в блистеры.

3. Форма выпуска: препарат выпускается в виде тест-полосок, упакованных в блистеры.

4. Срок годности: препарат хранится в течение 12 месяцев с даты изготовления.

5. Условия хранения: препарат хранится в сухом, защищенном от света месте при температуре от +5 до +25 °C.

6. Противопоказания: препарат не применяется при беременности и кормлении грудью.

7. Побочные эффекты: препарат не вызывает побочных эффектов.

8. Лекарственное взаимодействие: препарат не взаимодействует с другими лекарственными средствами.

9. Особые указания: препарат применяется только для диагностики, не является средством лечения.

10. Заключение: препарат является эффективным средством для определения уровня гормонов в крови и моче.

ИНВИТРОТЕСТ
«БЕЛ» для определения уровня гормонов в крови и моче с помощью тест-полосок.
Состав: 1. Тест-полоски, упакованные в блистеры.
2. Инструкция по применению.

ТУ 21.10.31-001-1199815-3026
Состав: 1. Тест-полоски, упакованные в блистеры.
2. Инструкция по применению.

Условия хранения: препарат хранится в сухом, защищенном от света месте при температуре от +5 до +25 °C.

Срок годности: препарат хранится в течение 12 месяцев с даты изготовления.

№	Наименование компонента	Единица измерения
1.	Тест-полоски, упакованные в блистеры	1 шт.
2.	Инструкция по применению	1 шт.
3.	Пакетик с тест-полосками	1 шт.
4.	Пакетик с тест-полосками	1 шт.
5.	Пакетик с тест-полосками	1 шт.
6.	Пакетик с тест-полосками	1 шт.
7.	Пакетик с тест-полосками	1 шт.
8.	Пакетик с тест-полосками	1 шт.
9.	Пакетик с тест-полосками	1 шт.
10.	Пакетик с тест-полосками	1 шт.



Комплект 4, серия 010 от 2020.01., срок годности до 2022.01.

The image shows a document with a grid of boxes. The top row contains a box with a triangle, a box with a cross, and a box with a circle. Below these are several rows of text and symbols, including a large 'X' and a large 'Y'. The text is mostly illegible due to the low resolution and high contrast of the image.

Генеральный директор ООО «ИнВитроТест»

 Киреев А.И.



Прошнуровано,
пронумеровано
и скреплено печатью

14 листов

Генеральный директор
ООО

"ИнВитроТест"

Киреев А.И.

20 24

