

**Фотографические изображения медицинского изделия:
Абатменты с комплектующими, для стоматологических
имплантатов, в вариантах исполнения:
«Dental Lab Parts For GeoLink», «Dental Lab Parts For GeoSRN2link»**

**Фотографические изображения медицинского изделия:
Абатменты с комплектующими, для стоматологических имплантатов, в вариантах исполнения:
«Dental Lab Parts For GeoLink», «Dental Lab Parts For GeoSRN2link»**

Производство: GeoMedi Co., Ltd., Korea / ГеоМеди Ко., Лтд., Корея,
#702-703,704, 709-1, Unit D, Indeokwon IT Valley, 40, Imi-ro, Uiwang-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea/ #702-703,704, 709-1, блок Д,
Индеовон ИТ Долина, 40, Ими-ро, Юавонг-си, Кенги-до, Республика Корея.

Список фото:

1. Абатмент с титановым основанием «Dental Lab Parts For GeoLink», артикулы:

Рисунок 1.1.	LL2-SUM13-H
Рисунок 1.2.	LL2-SUM20-H
Рисунок 1.3.	LL2-SUM13-N
Рисунок 1.4.	LL2-SUM20-N
Рисунок 1.5.	LL2-SURO13-H
Рисунок 1.6.	LL2-SURO20-H
Рисунок 1.7.	LL2-SURO13-N
Рисунок 1.8.	LL2-SURO20-N
Рисунок 1.9.	LL2-DER13-H
Рисунок 1.10.	LL2-DER20-H
Рисунок 1.11.	LL2-DER13-N
Рисунок 1.12.	LL2-BLM-R
Рисунок 1.13.	LL2-BLM-N
Рисунок 1.14.	LL2-BLR-R
Рисунок 1.15.	LL2-BLR-N
Рисунок 1.16.	LL2-ITR-O
Рисунок 1.17.	LL2-ITR-N
Рисунок 1.18.	LL2-ITW-O
Рисунок 1.19.	LL2-ITW-N
Рисунок 1.20.	LL2-ACN-H
Рисунок 1.21.	LL2-ACN-N
Рисунок 1.22.	LL2-ACR-H
Рисунок 1.23.	LL2-ACR-N
Рисунок 1.24.	LL2-RP60-E
Рисунок 1.25.	LL2-RP60-N
Рисунок 1.26.	LL2-RPM-E
Рисунок 1.27.	LL2-RPM-N
Рисунок 1.28.	LL2-RPR-E
Рисунок 1.29.	LL2-RPR-N

Рисунок 1.30.	LL2-RPW-E
Рисунок 1.31.	LL2-RPW-N
Рисунок 1.32.	LL2-XV55-H
Рисунок 1.33.	LL2-3ICR-N
Рисунок 1.34.	LL2-XV3-H
Рисунок 1.35.	LL2-XV3-N
Рисунок 1.36.	LL2-XVM-H
Рисунок 1.37.	LL2-XVM-N
Рисунок 1.38.	LL2-XVR-H
Рисунок 1.39.	LL2-XVR-N
Рисунок 1.40.	LL2-XVW-H
Рисунок 1.41.	LL2-XVW-N
Рисунок 1.42.	LL2-3ICW-H
Рисунок 1.43.	LL2-3ICW-N
Рисунок 1.44.	LL2-3IC60-H
Рисунок 1.45.	LL2-3IC60-N
Рисунок 1.46.	LL2-TSV3-H
Рисунок 1.47.	LL2-TSV3-N
Рисунок 1.48.	LL2-TSV4-H
Рисунок 1.49.	LL2-TSV4-N
Рисунок 1.50.	LL2-TSV5-H
Рисунок 1.51.	LL2-TSV5-N
Рисунок 1.52.	LL2-ASR-H
Рисунок 1.53.	LL2-ASR-N
Рисунок 1.54.	LL2-ASW-H
Рисунок 1.55.	LL2-ASW-N
Рисунок 1.56.	LL2-MARR-H
Рисунок 1.57.	LL2-MARR-N
Рисунок 1.58.	LL2-EXR-H
Рисунок 1.59.	LL2-EXR-N
Рисунок 1.60.	LL2-EXW-H
Рисунок 1.61.	LL2-EXW-N
Рисунок 1.62.	LL2-3ICM-H
Рисунок 1.63.	LL2-3ICM-N

2. Абатмент с титановым основанием «Dental Lab Parts For GeoSRN2link», артикулы:

Рисунок 2.1.	SRN2-SUM-H
Рисунок 2.2.	SRN2-SURO-H
Рисунок 2.3.	SRN2-SURO26-H
Рисунок 2.4.	SRN2-ASW-H
Рисунок 2.5.	SRN2-DER-H

Рисунок 2.6.	SRN2-DER26-H
Рисунок 2.7.	SRN2-BLM-R
Рисунок 2.8.	SRN2-BLR-R
Рисунок 2.9.	SRN2-ITR-O
Рисунок 2.10.	SRN2-ITW-O
Рисунок 2.11.	SRN2-ACN-H
Рисунок 2.12.	SRN2-ACR-H
Рисунок 2.13.	SRN2-RPM-E
Рисунок 2.14.	SRN2-RPW-E
Рисунок 2.15.	SRN2-RPR-E
Рисунок 2.16.	SRN2-ASR-H
Рисунок 2.17.	SRN2-TSV5-H
Рисунок 2.18.	SRN2-TSV3-H
Рисунок 2.19.	SRN2-TSV4-H

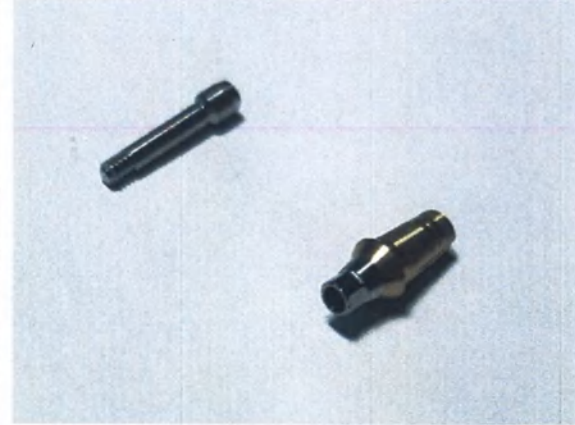
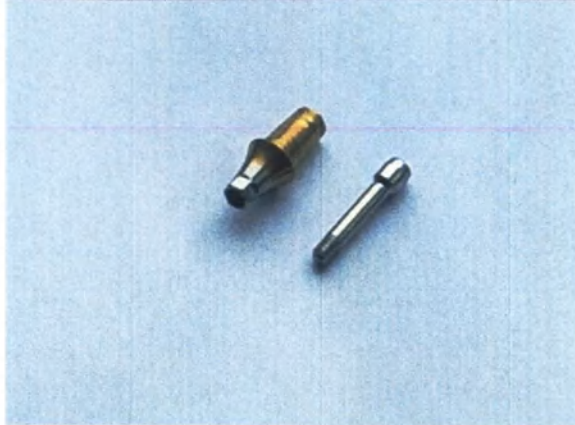
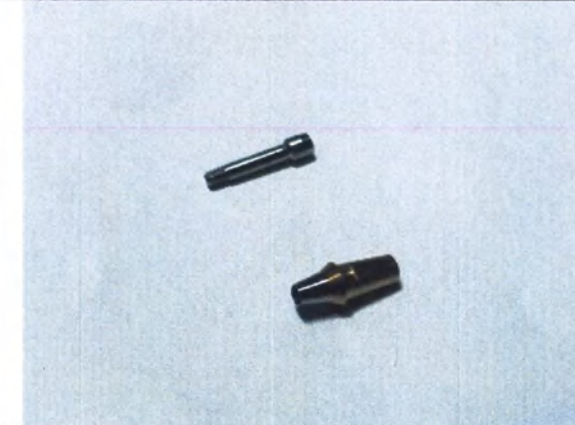
3. Комплектующие: Винты, артикулы:

Рисунок 3.1.	SUMC
Рисунок 3.2.	SUROC
Рисунок 3.3.	EXRC
Рисунок 3.4.	EXWC
Рисунок 3.5.	DERC
Рисунок 3.6.	BLMC
Рисунок 3.7.	BLRC
Рисунок 3.8.	ACNC
Рисунок 3.9.	ACRC
Рисунок 3.10.	RPMC
Рисунок 3.11.	RPRC
Рисунок 3.12.	XV3C
Рисунок 3.13.	XVC
Рисунок 3.14.	3ICC
Рисунок 3.15.	TSVC
Рисунок 3.16.	ASRC
Рисунок 3.17.	ASWC
Рисунок 3.18.	MARRC
Рисунок 3.19.	ITC

4. Упаковка

Рисунок 4.1.	Фото индивидуальной упаковки
Рисунок 4.2.	
Рисунок 4.3.	
Рисунок 4.4	Фото потребительской упаковки

**Абатменты с комплектующими, для стоматологических имплантатов, в вариантах исполнения:
«Dental Lab Parts For GeoLink», «Dental Lab Parts For GeoSRN2link»**

Рисунок 1.1.	Рисунок 1.2.	Рисунок 1.3.
		
Рисунок 1.4.	Рисунок 1.5.	Рисунок 1.6.
		

**Абатменты с комплектующими, для стоматологических имплантатов, в вариантах исполнения:
«Dental Lab Parts For GeoLink», «Dental Lab Parts For GeoSRN2link»**

Рисунок 1.7.	Рисунок 1.8.	Рисунок 1.9.
		
Рисунок 1.10.	Рисунок 1.11.	Рисунок 1.12.
		

**Абатменты с комплектующими, для стоматологических имплантатов, в вариантах исполнения:
«Dental Lab Parts For GeoLink», «Dental Lab Parts For GeoSRN2link»**

Рисунок 1.13.	Рисунок 1.14.	Рисунок 1.15.
		
Рисунок 1.16.	Рисунок 1.17.	Рисунок 1.18.
		

**Абатменты с комплектующими, для стоматологических имплантатов, в вариантах исполнения:
«Dental Lab Parts For GeoLink», «Dental Lab Parts For GeoSRN2link»**

Рисунок 1.19.	Рисунок 1.20.	Рисунок 1.21.
		
Рисунок 1.22.	Рисунок 1.23.	Рисунок 1.24.
		

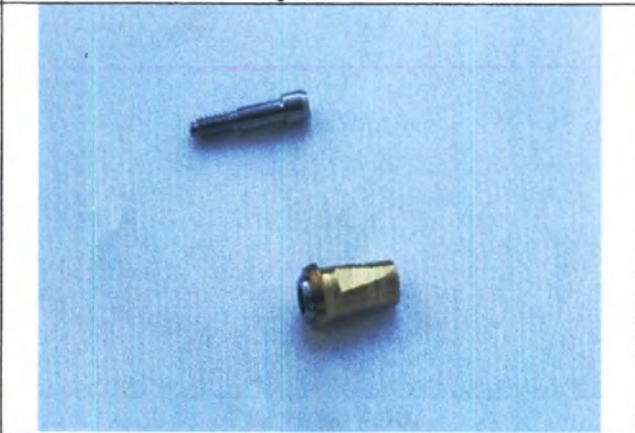
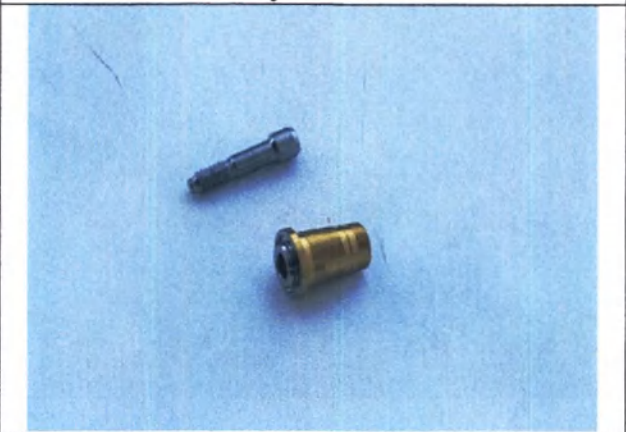
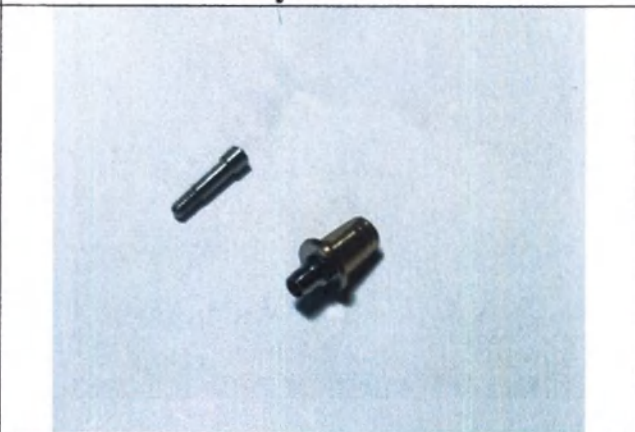
**Абатменты с комплектующими, для стоматологических имплантатов, в вариантах исполнения:
«Dental Lab Parts For GeoLink», «Dental Lab Parts For GeoSRN2link»**

Рисунок 1.25. 	Рисунок 1.26. 	Рисунок 1.27. 
Рисунок 1.28. 	Рисунок 1.29. 	Рисунок 1.30. 

**Абатменты с комплектующими, для стоматологических имплантатов, в вариантах исполнения:
«Dental Lab Parts For GeoLink», «Dental Lab Parts For GeoSRN2link»**

Рисунок 1.31. 	Рисунок 1.32. 	Рисунок 1.33. 
Рисунок 1.34. 	Рисунок 1.35. 	Рисунок 1.36. 

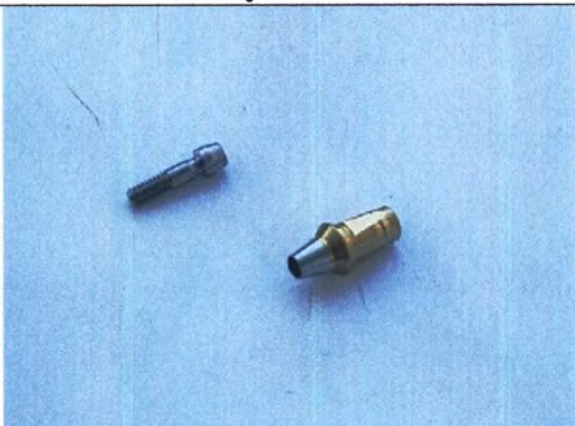
**Абатменты с комплектующими, для стоматологических имплантатов, в вариантах исполнения:
«Dental Lab Parts For GeoLink», «Dental Lab Parts For GeoSRN2link»**

Рисунок 1.37. 	Рисунок 1.38. 	Рисунок 1.39. 
Рисунок 1.40. 	Рисунок 1.41. 	Рисунок 1.42. 

**Абатменты с комплектующими, для стоматологических имплантатов, в вариантах исполнения:
«Dental Lab Parts For GeoLink», «Dental Lab Parts For GeoSRN2link»**

Рисунок 1.43. 	Рисунок 1.44. 	Рисунок 1.45. 
Рисунок 1.46. 	Рисунок 1.47. 	Рисунок 1.48. 

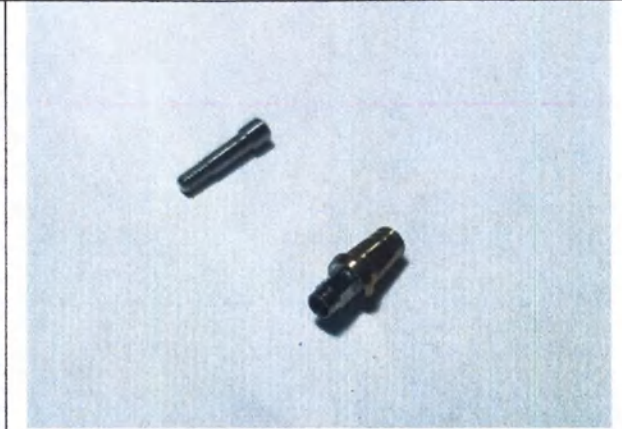
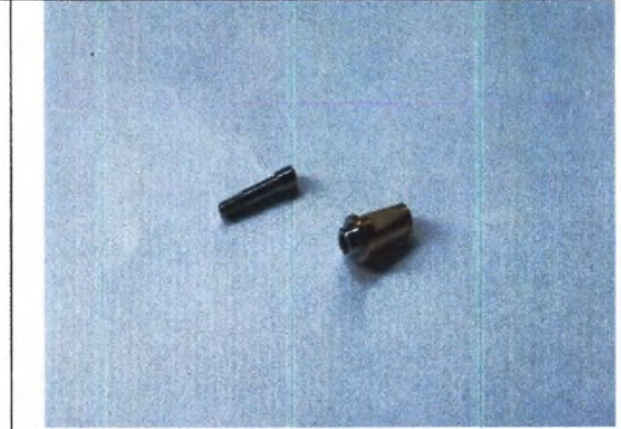
**Абатменты с комплектующими, для стоматологических имплантатов, в вариантах исполнения:
«Dental Lab Parts For GeoLink», «Dental Lab Parts For GeoSRN2link»**

Рисунок 1.49.	Рисунок 1.50.	Рисунок 1.51.
		
Рисунок 1.52.	Рисунок 1.53.	Рисунок 1.54.
		

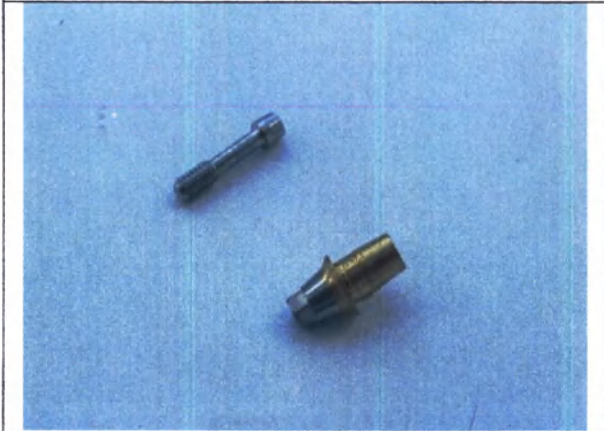
**Абатменты с комплектующими, для стоматологических имплантатов, в вариантах исполнения:
«Dental Lab Parts For GeoLink», «Dental Lab Parts For GeoSRN2link»**

Рисунок 1.55. 	Рисунок 1.56. 	Рисунок 1.57. 
Рисунок 1.58. 	Рисунок 1.59. 	Рисунок 1.60. 

**Абатменты с комплектующими, для стоматологических имплантатов, в вариантах исполнения:
«Dental Lab Parts For GeoLink», «Dental Lab Parts For GeoSRN2link»**

Рисунок 1.61. 	Рисунок 1.62. 	Рисунок 1.63. 
Рисунок 2.1. 	Рисунок 2.2. 	Рисунок 2.3. 

**Абатменты с комплектующими, для стоматологических имплантатов, в вариантах исполнения:
«Dental Lab Parts For GeoLink», «Dental Lab Parts For GeoSRN2link»**

Рисунок 2.4. 	Рисунок 2.5. 	Рисунок 2.6. 
Рисунок 2.7. 	Рисунок 2.8. 	Рисунок 2.9. 

**Абатменты с комплектующими, для стоматологических имплантатов, в вариантах исполнения:
«Dental Lab Parts For GeoLink», «Dental Lab Parts For GeoSRN2link»**

Рисунок 2.10.	Рисунок 2.11.	Рисунок 2.12.
		
Рисунок 2.13.	Рисунок 2.14.	Рисунок 2.15.
		

**Абатменты с комплектующими, для стоматологических имплантатов, в вариантах исполнения:
«Dental Lab Parts For GeoLink», «Dental Lab Parts For GeoSRN2link»**

Рисунок 2.16.	Рисунок 2.17.	Рисунок 2.18.
		
Рисунок 2.19.	Рисунок 3.1.	Рисунок 3.2.
		

**Абатменты с комплектующими, для стоматологических имплантатов, в вариантах исполнения:
«Dental Lab Parts For GeoLink», «Dental Lab Parts For GeoSRN2link»**

Рисунок 3.3.	Рисунок 3.4.	Рисунок 3.5.
		
Рисунок 3.6.	Рисунок 3.7.	Рисунок 3.8.
		

**Абатменты с комплектующими, для стоматологических имплантатов, в вариантах исполнения:
«Dental Lab Parts For GeoLink», «Dental Lab Parts For GeoSRN2link»**

Рисунок 3.9.	Рисунок 3.10.	Рисунок 3.11.
		
Рисунок 3.12.	Рисунок 3.13.	Рисунок 3.14.
		

**Абатменты с комплектующими, для стоматологических имплантатов, в вариантах исполнения:
«Dental Lab Parts For GeoLink», «Dental Lab Parts For GeoSRN2link»**

Рисунок 3.15.	Рисунок 3.16.	Рисунок 3.17.
		
Рисунок 3.18.	Рисунок 3.19.	Рисунок 4.1.
		

**Абатменты с комплектующими, для стоматологических имплантатов, в вариантах исполнения:
«Dental Lab Parts For GeoLink», «Dental Lab Parts For GeoSRN2link»**

Рисунок 4.2.



Рисунок 4.3.



Рисунок 4.4.



Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

22 (АВААЦАТЬ ДВА) листов
цифрами прописью

Должность ГЕН. ДИРЕКТОР

Подпись _____

« 22 » ДЕКАБРЯ 2019 г.

