



Фотографические изображения

медицинского изделия


«Набор реагентов для качественного определения антигенов SARS-CoV-2 «NanoCare COVID-19 Antigen (Ag) Kit» в мазках из носоглотки человека методом иммунохроматографического анализа, LOT: 210427-03, 210812-03»,
производства NanoBioLife Inc. («НаноБиоЛайф Инк.»), Корея

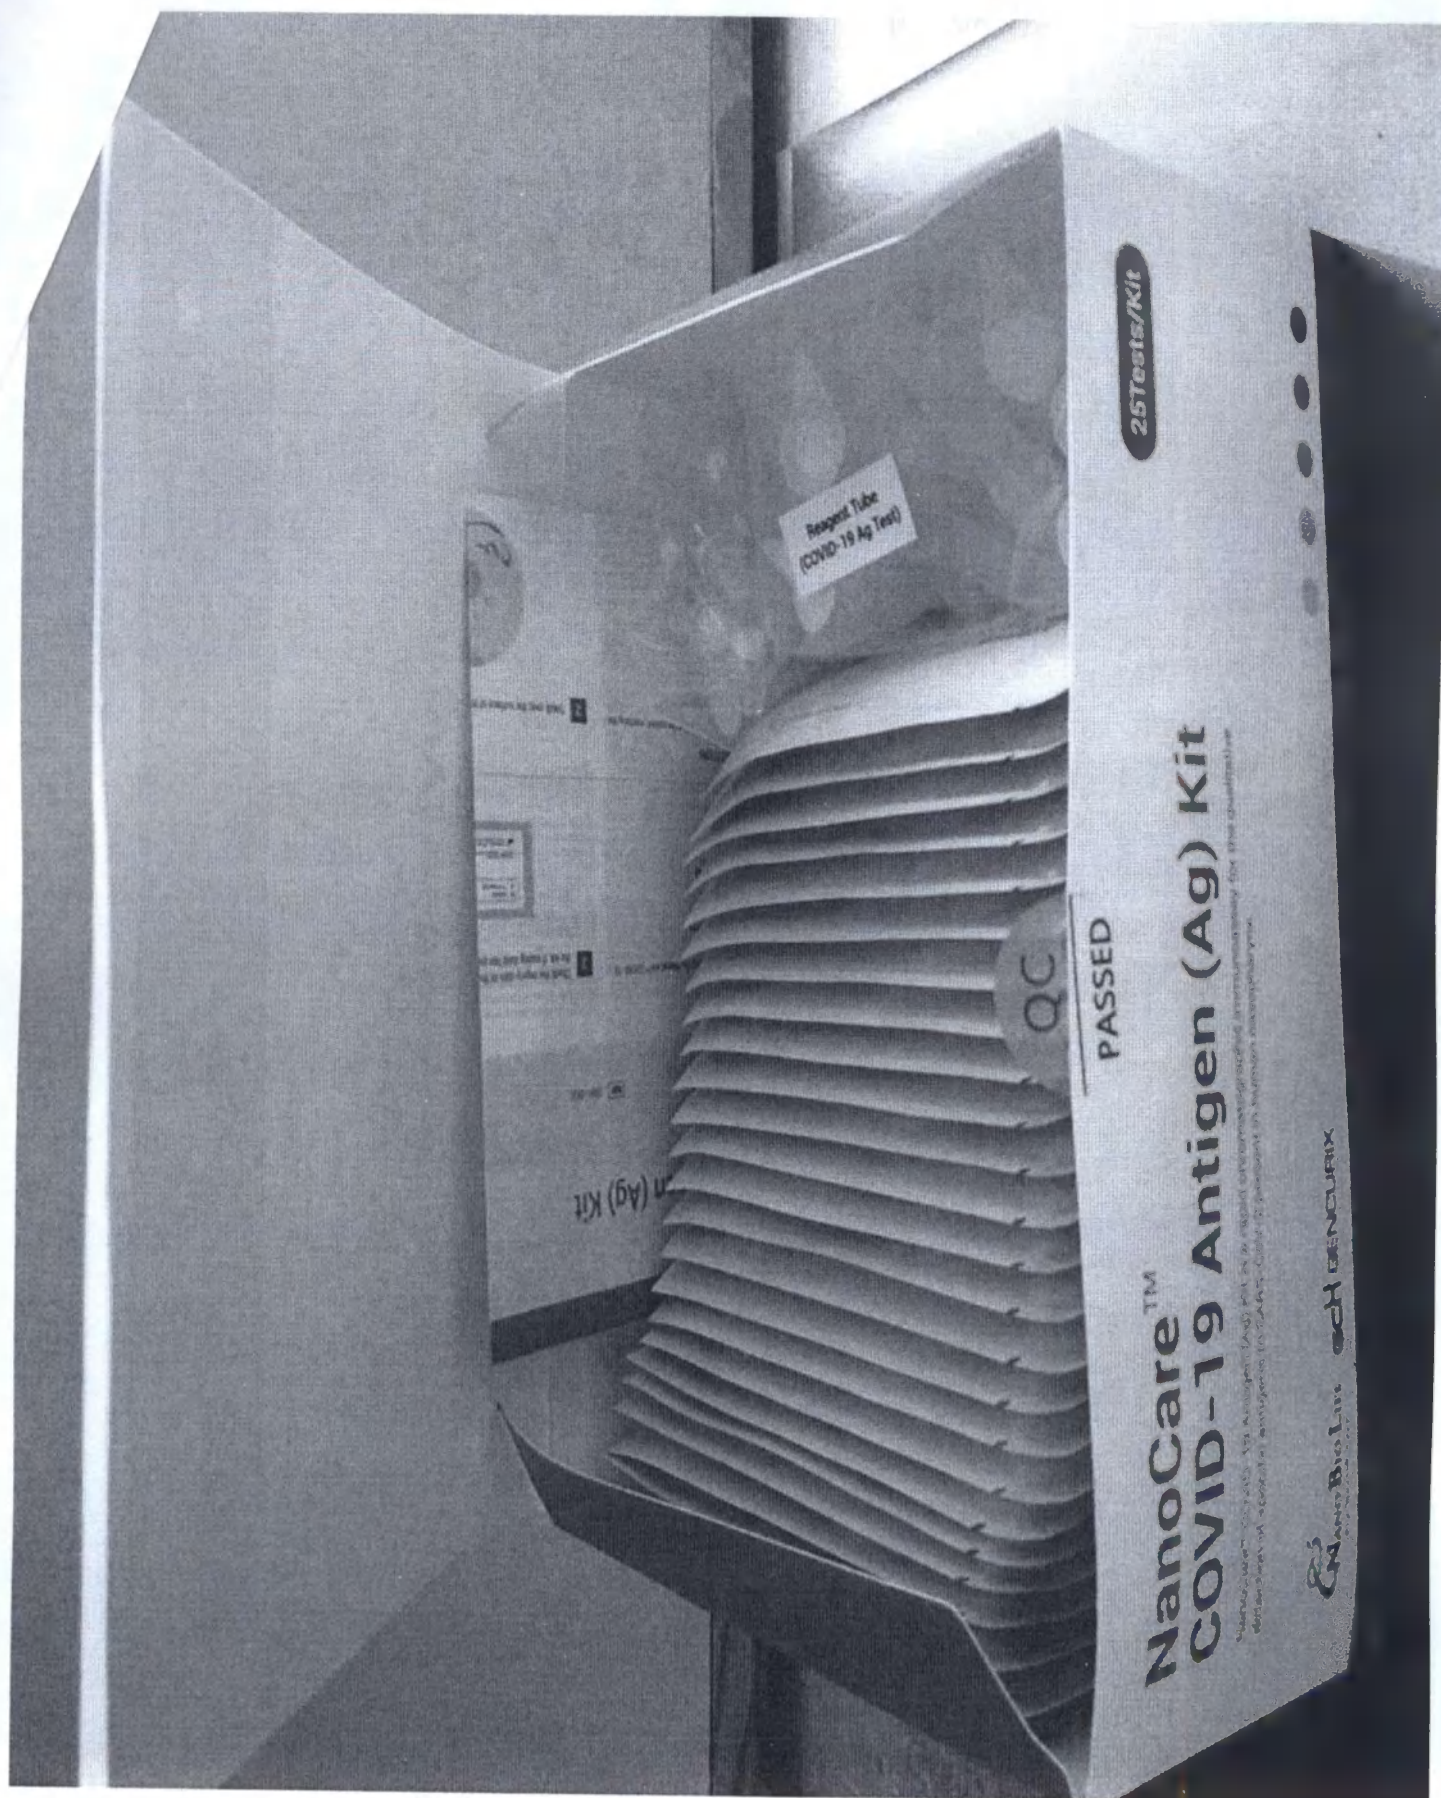



Общий вид тест-набора в открытой упаковке

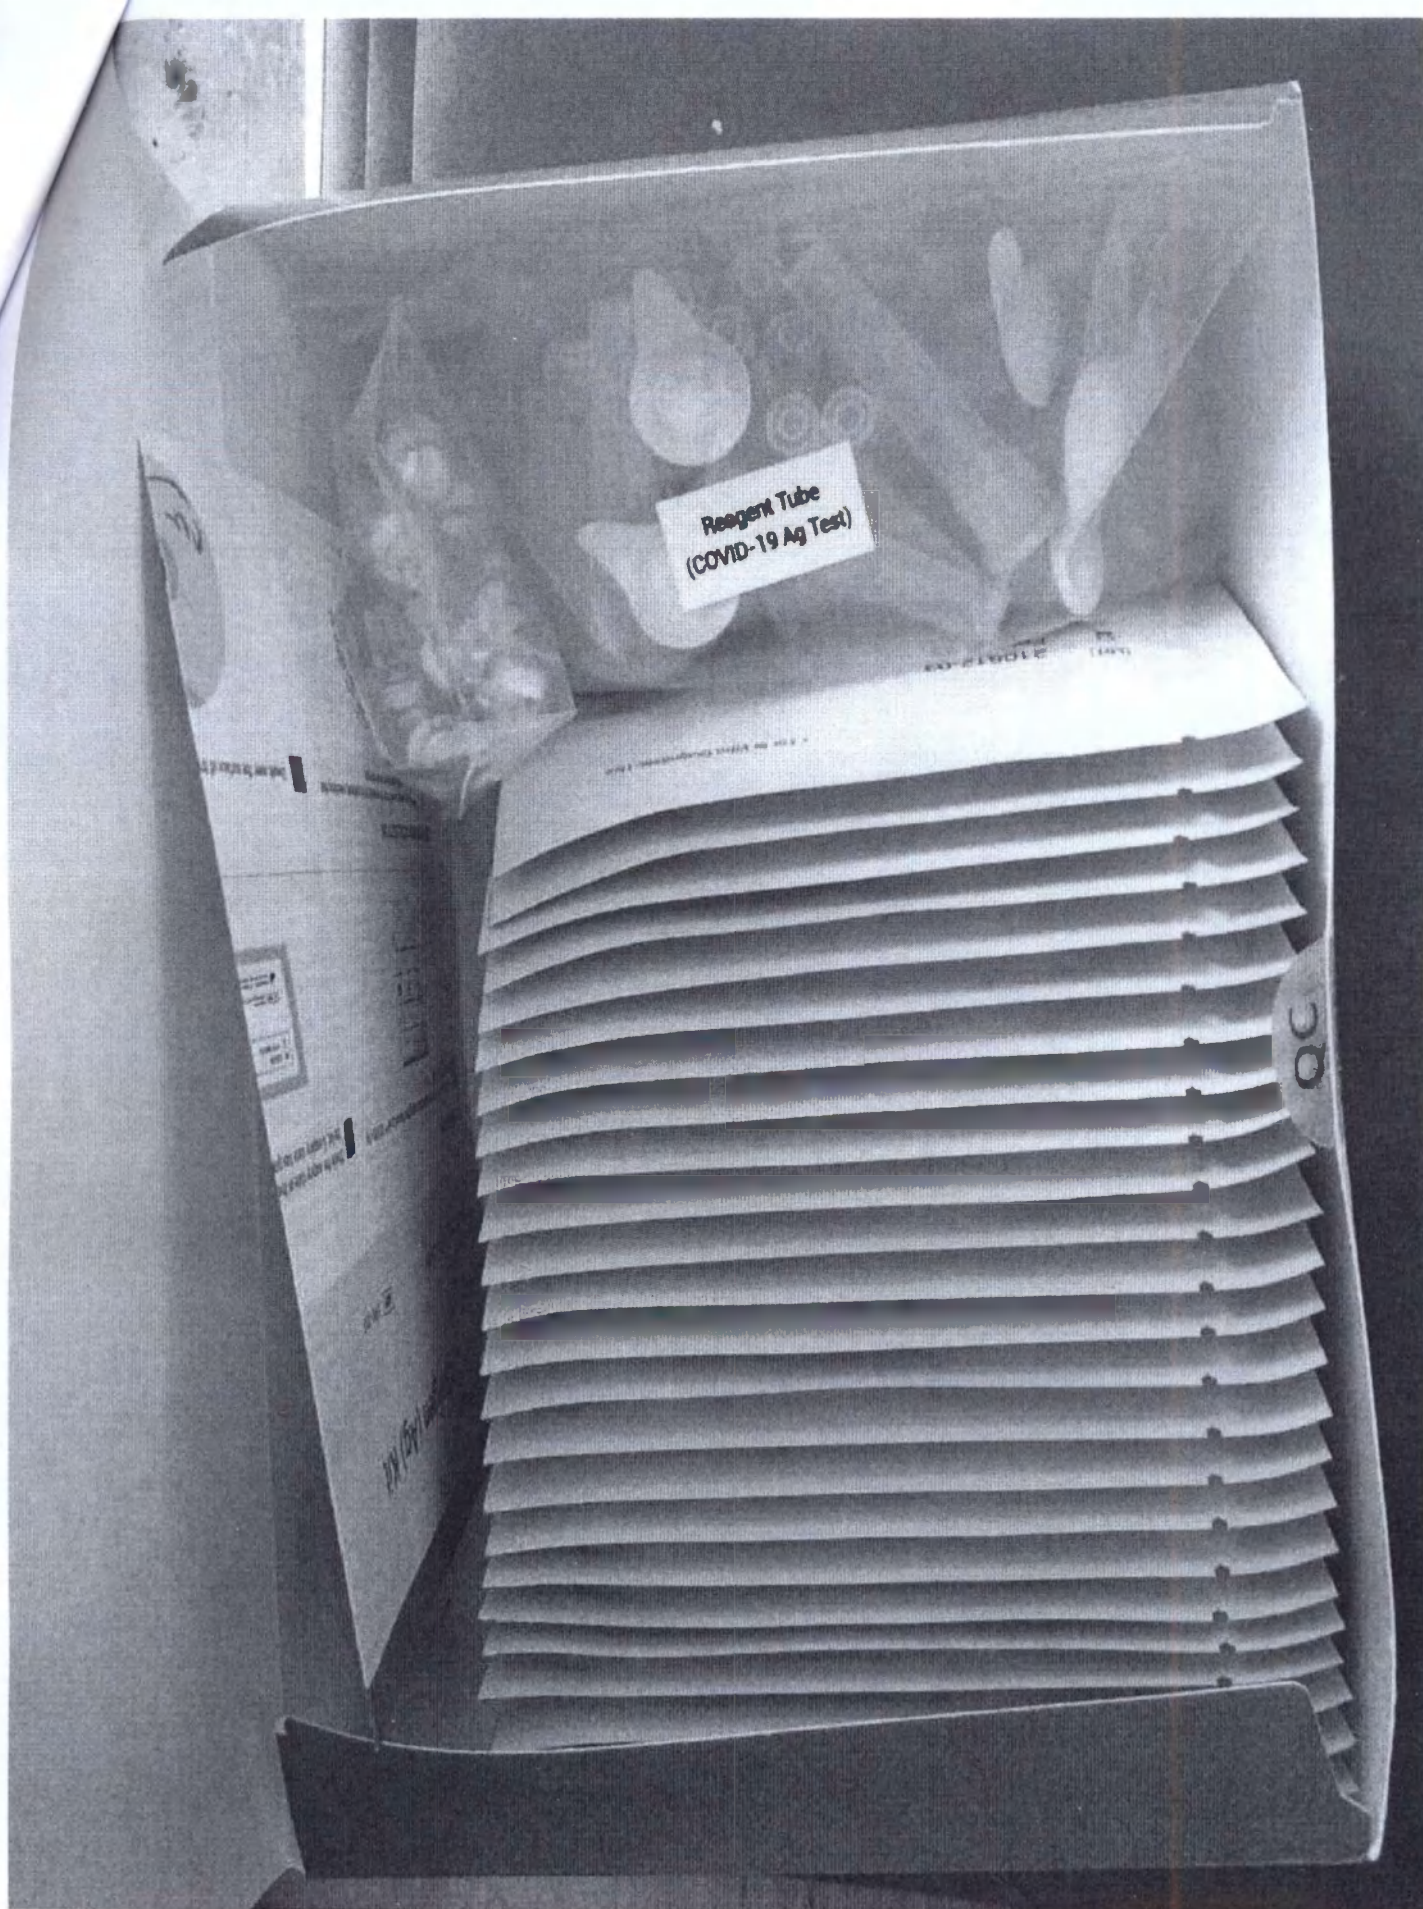

Общий вид тест-набора в открытой упаковке (вид сверху)

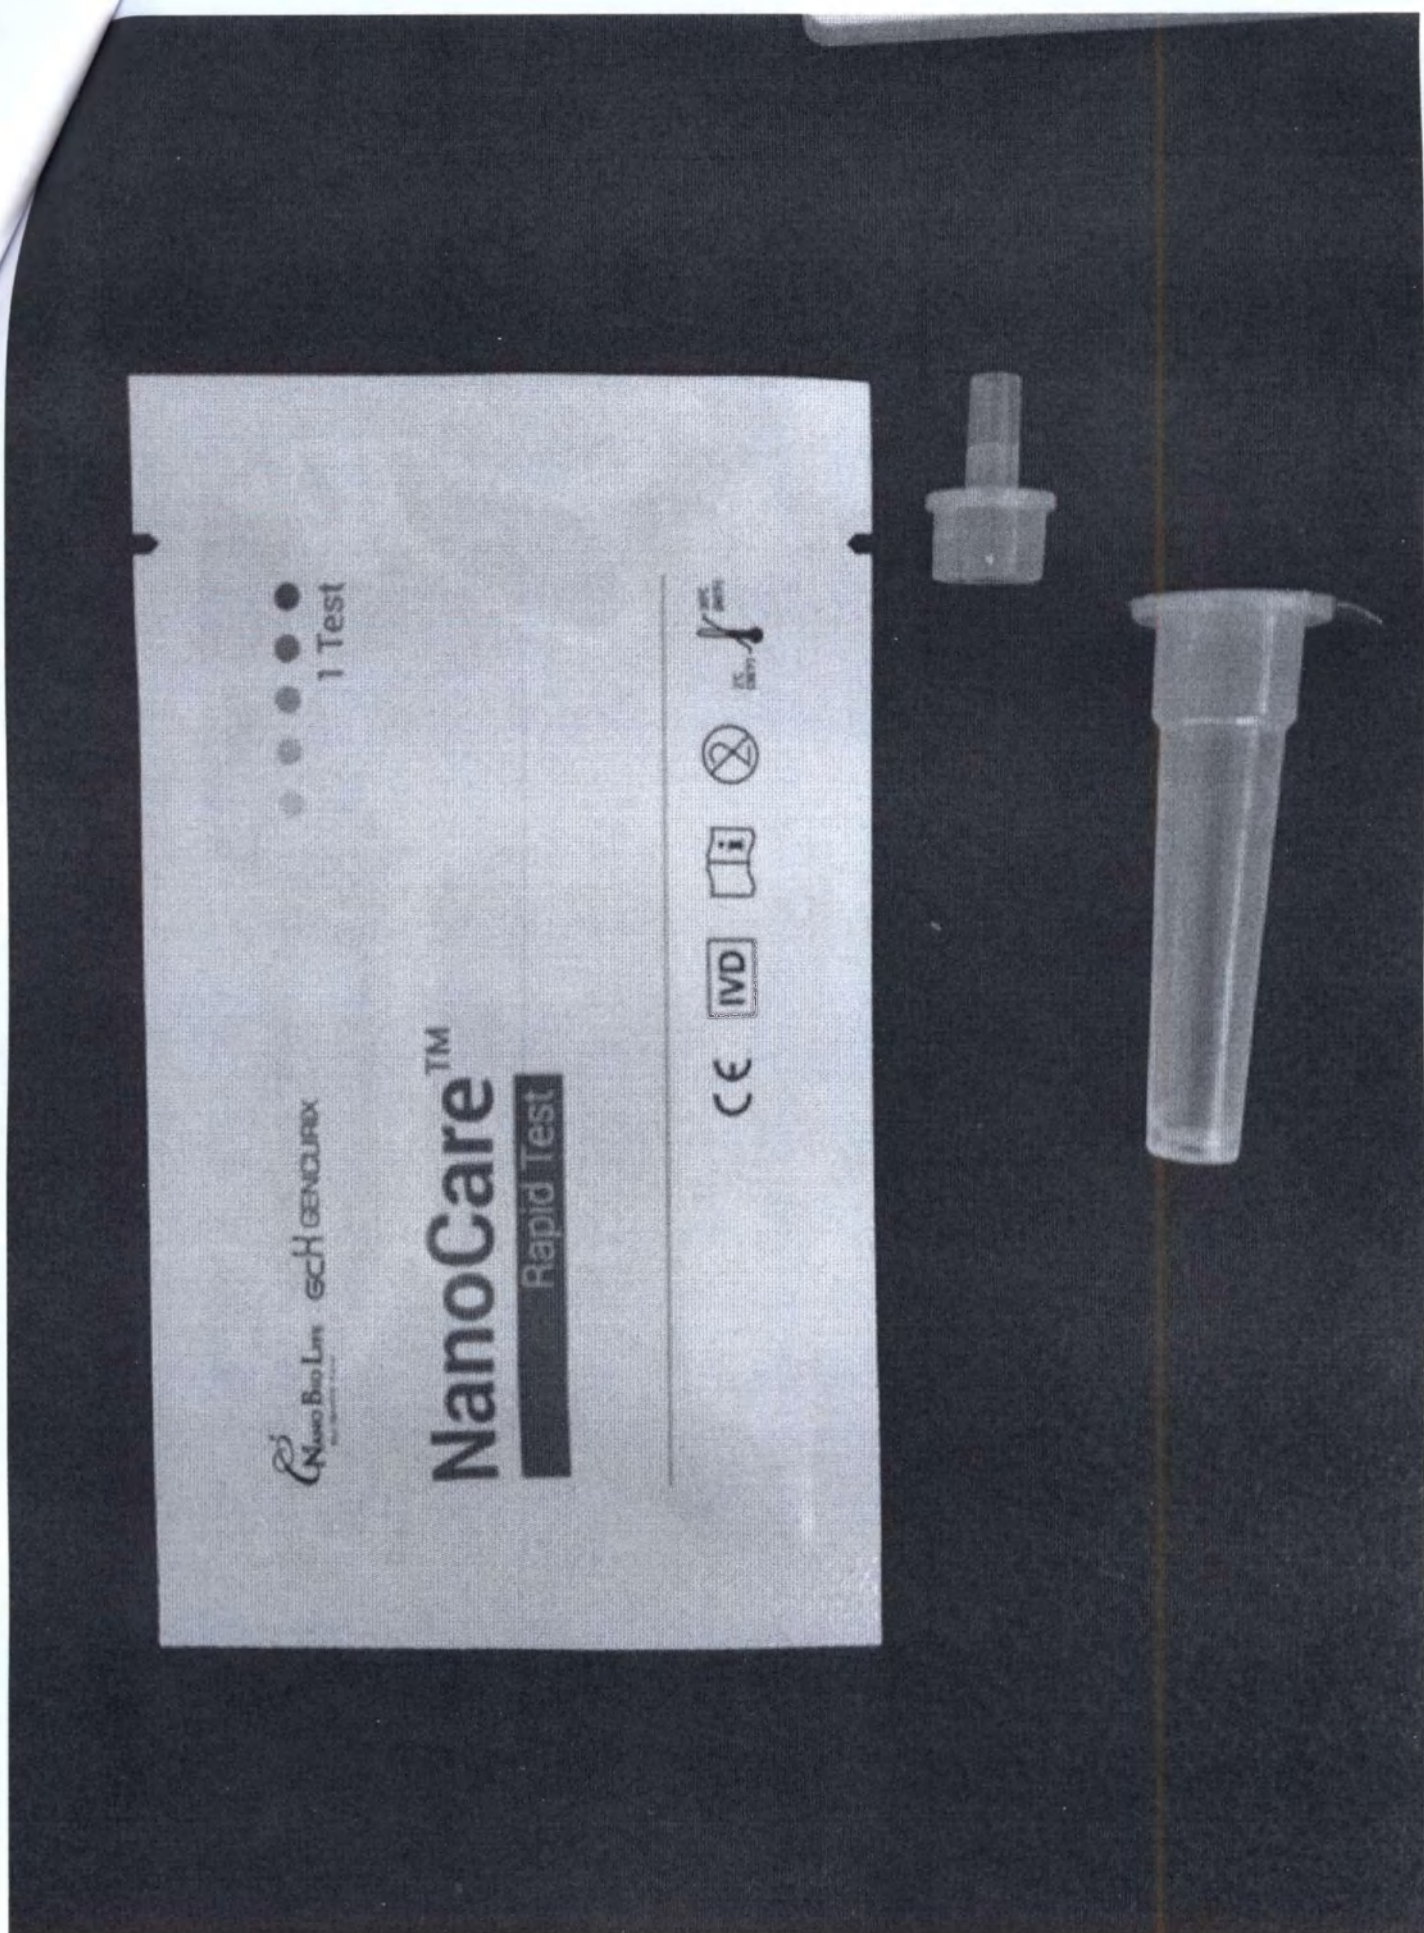

Общий вид тест-набора без упаковки

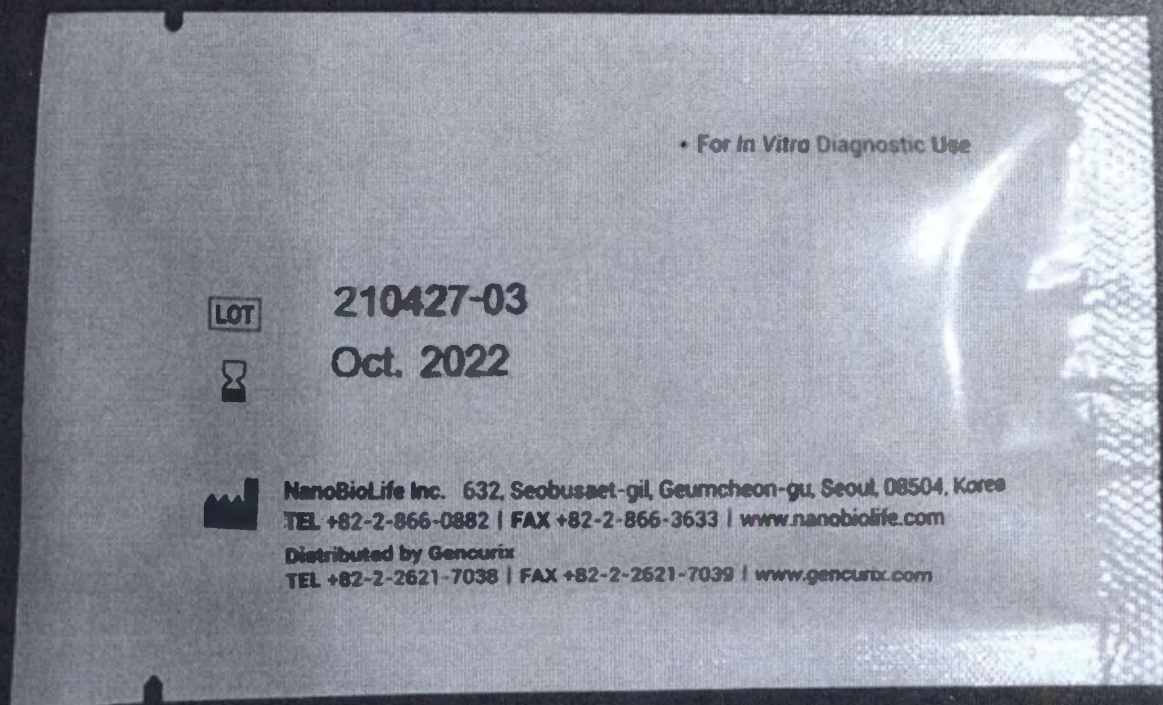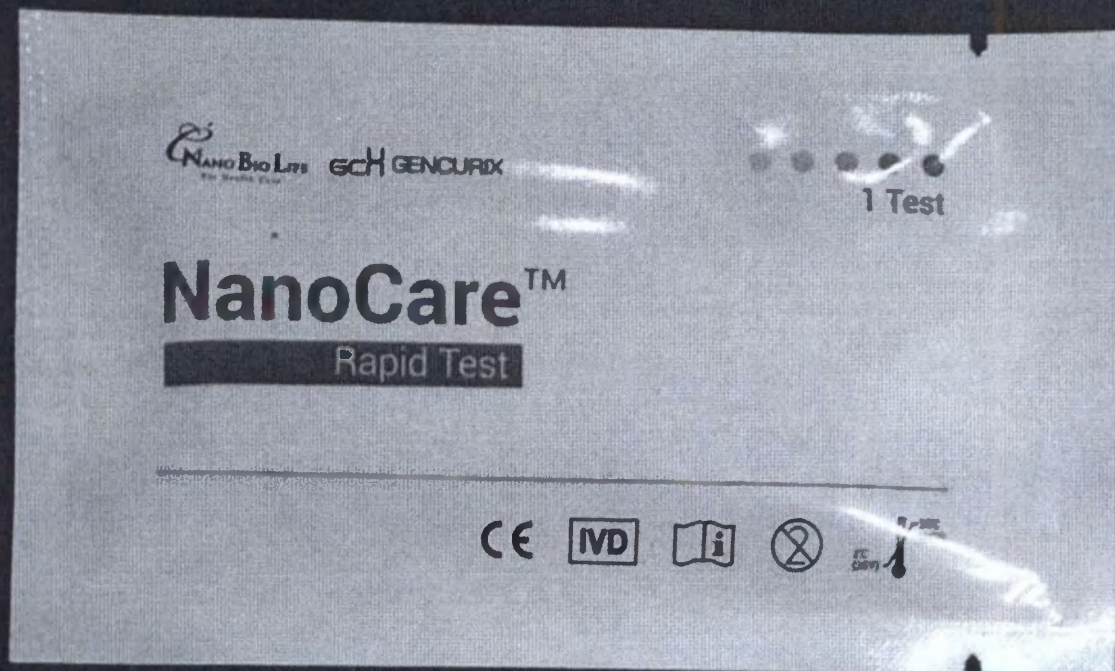

Тестовая кассета (в индивидуальной упаковке в комплекте с осушителем),
LOT 210427-03

NanoBioLife GENCURIX

1 Test

NanoCare™

Rapid Test

CE

IVD



• For In Vitro Diagnostic Use

LOT

210812-03



Feb. 2023




NanoBioLife Inc. 632, Seobusaet-gil, Geumcheon-gu, Seoul, 07044, Korea
TEL +82-2-866-0882 | FAX +82-2-866-3633 | www.nanobiolife.com

Distributed by Gencurix

TEL +82-2-2621-7038 | FAX +82-2-2621-7039 | www.gencurix.com

Тестовая кассета (в индивидуальной упаковке в комплекте с осушителем),
LOT 210812-03

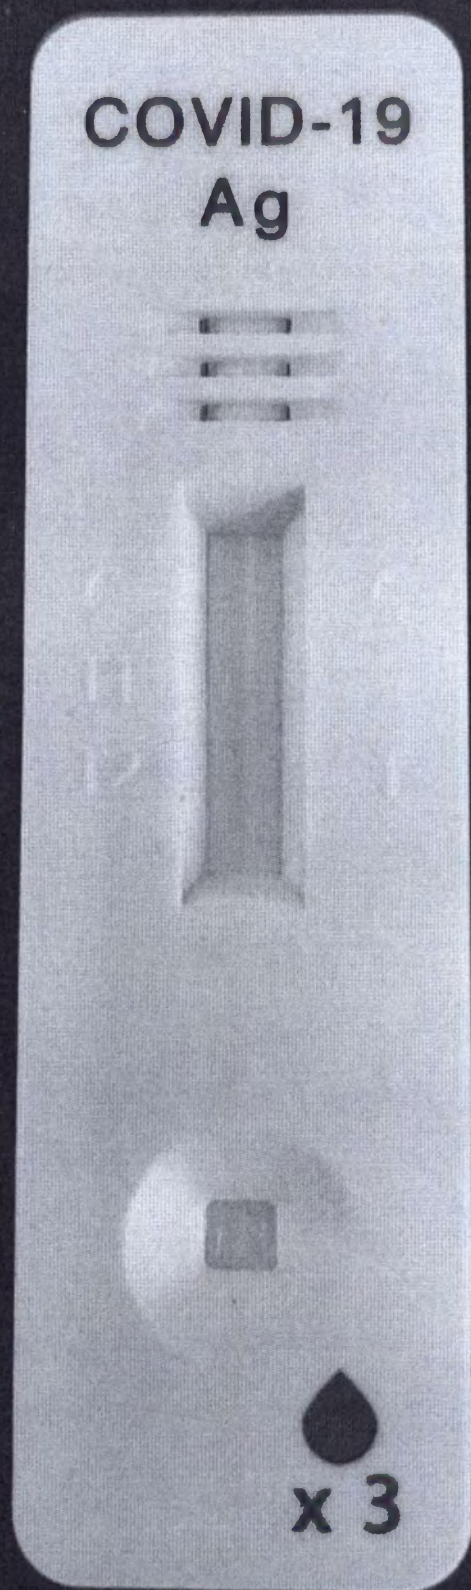

Тестовая кассета без упаковки

SILICA GEL

シリカゲル

DO NOT EAT.
NE PAS MANGER
먹지 마세요.



Valid

Invalid




후레쉬메이커




TEL. (031) 798-6368

2

Осушитель

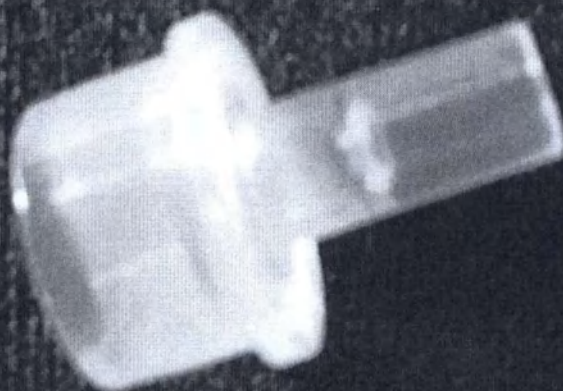

Насадка с капельницей

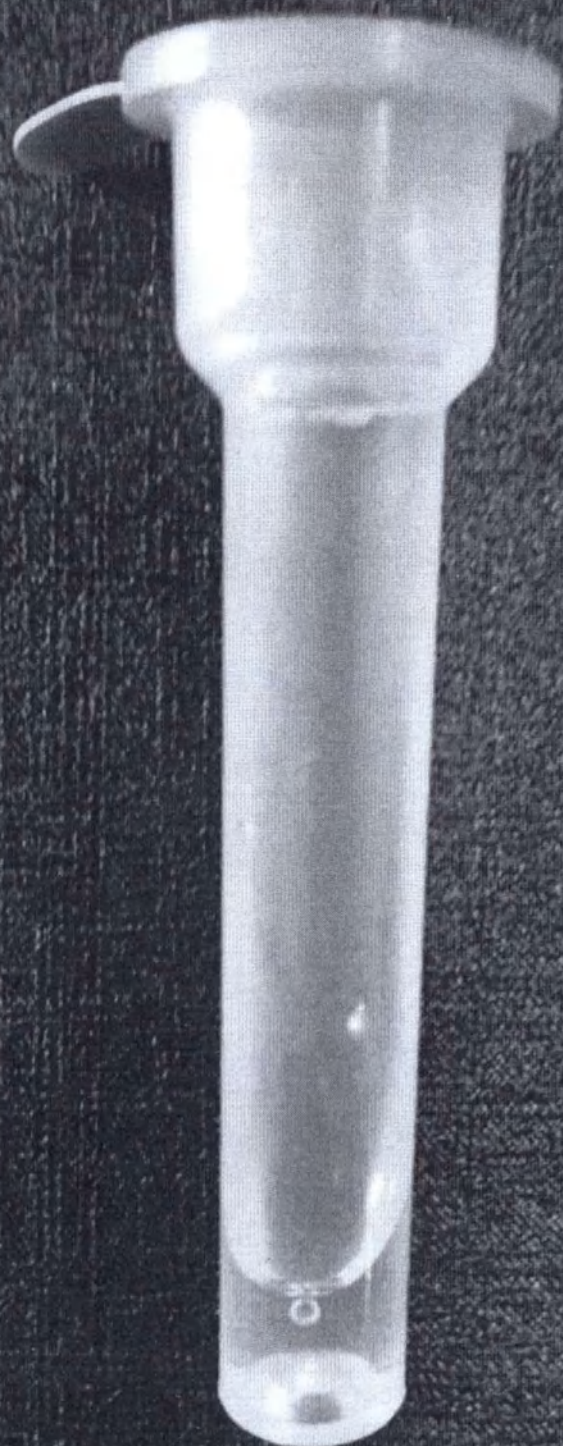


Пробирка с буферным раствором без упаковки



Насадка с капельницей в групповой упаковке в количестве 25 штук



Пробирка с буферным раствором в групповой упаковке в количестве 25 штук

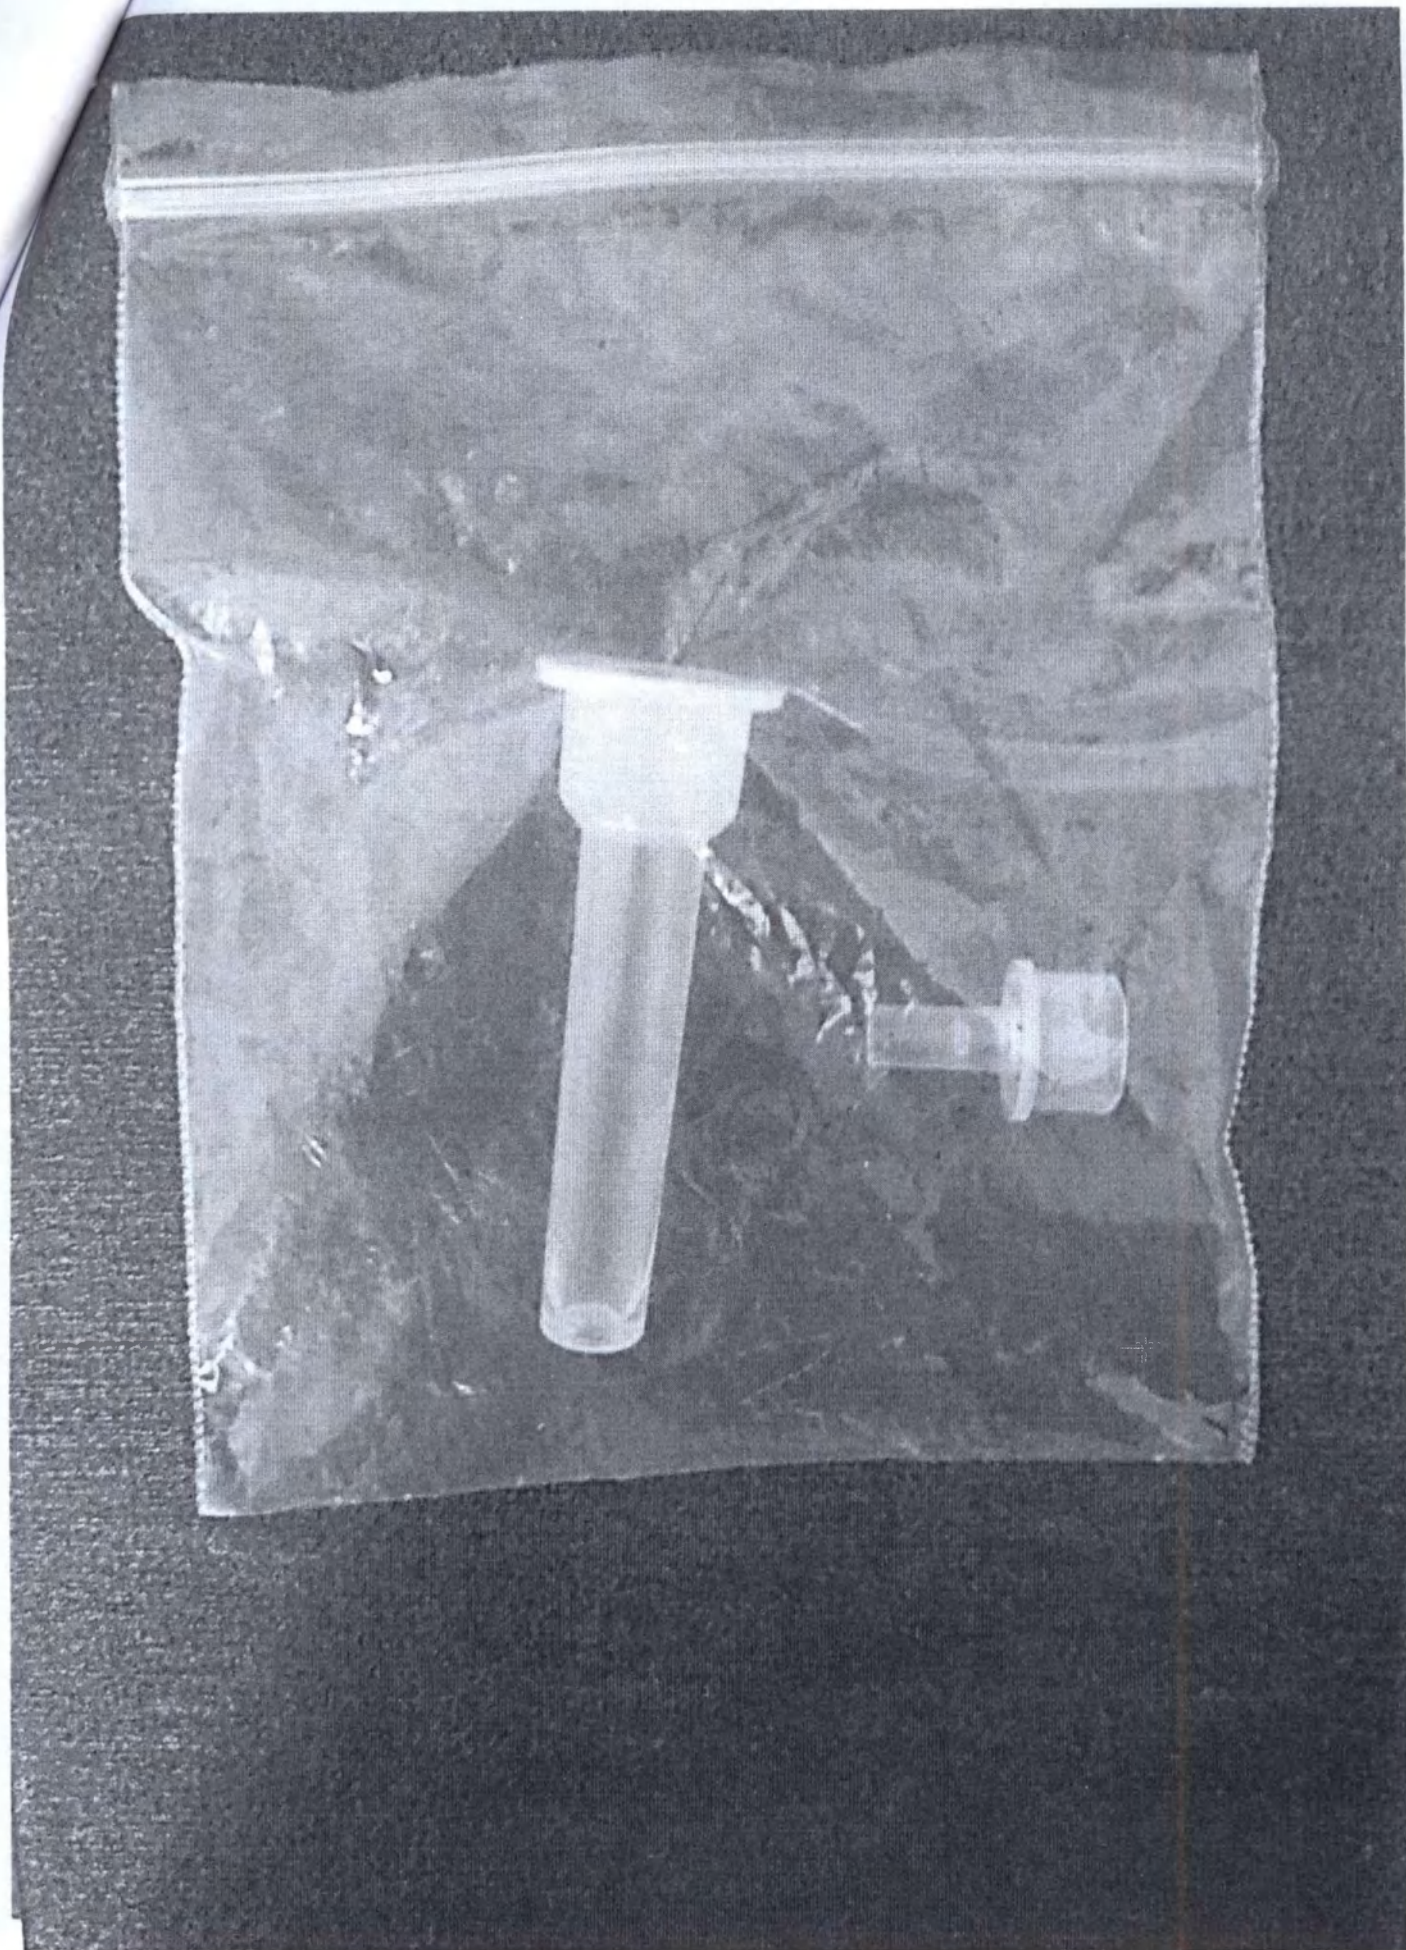

Пробирка с буферным раствором и насадка с капельницей в групповой упаковке для проведения 1 теста

MADE IN KOREA

REF SRK-003

MDSS GmbH

Schiffgraben 41, 30175 Hannover, Germany

www.mdssar.com

EC REP

210427-03
Oct. 2022

LOT



Общий вид вторичной упаковки набора, LOT 210427-03

Общий вид вторичной упаковки набора, LOT 210812-03

REF SRK-003

EC REP

MDSS GmbH
Schiffgraben 41, 30175 Hannover, Germany
www.mdssar.com

MADE IN KOREA

LOT



210812-03
Feb. 2023

NanoCare™ COVID-19 Antigen (Ag) Kit

NanoCare™ COVID-19 Antigen (Ag) Kit is a rapid chromatographic immunoassay for the qualitative detection of specific antigens to SARS-CoV-2 present in human nasopharynx.


NANO BIO LIFE
Bio Health Care

GCH GENCURIX




QC

NanoCare™ COVID-19 Antigen (Ag) Kit

NanoCare™ COVID-19 Antigen (Ag) Kit is a rapid chromatographic immunoassay for the qualitative detection of specific antigens to SARS-CoV-2 present in human nasopharynx.

 **NANO BioLife**  **GCH GENCURIX**
Bio Health Care



Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 12 листов

Генеральный директор
ООО "НаноБиоЛайф"
Соколов Д.С.



Макет маркировочных этикеток

на медицинское изделие

«Набор реагентов для качественного определения антигенов SARS-CoV-2
«NanoCare COVID-19 Antigen (Ag) Kit» в мазках из носоглотки человека
методом иммунохроматографического анализа, LOT: 210427-03, 210812-03»,
производства NanoBioLife Inc. («НаноБиоЛайф Инк.»), Корея

Маркировочная этикетка на «Набор реагентов для качественного определения антигенов SARS-CoV-2 «NanoCare COVID-19 Antigen (Ag) Kit» в мазках из носоглотки человека методом иммунохроматографического анализа, LOT: 210427-03» на 25 тестов

«Набор реагентов для качественного определения антигенов SARS-CoV-2 «NanoCare COVID-19 Antigen (Ag) Kit» в мазках из носоглотки человека методом иммунохроматографического анализа, LOT: 210427-03»

REF SRK-003

LOT 210427-03

 10.2022



IVD



.25

Беречь от детей.

Только для наружного использования



NanoBioLife Inc. («НаноБиоЛайф Инк.»),
632, Seobusaet-gil Geumcheon-gu, Seoul,
Korea

Уполномоченный представитель на территории РФ:
ООО «НаноБиоЛайф», 121354, Россия, Москва,
вн.тер.г. муниципальный округ Можайский, улица
Дорогобужская, дом 14, помещ. 203А

РУ № _____

Состав набора:

1. Тестовая кассета (в индивидуальной упаковке в комплекте с осушителем) - 25 шт.
2. Пробирка с буферным раствором - 25 шт.
3. Насадка с капельницей - 25 шт.
4. Инструкция по применению - 1 шт.

Маркировочная этикетка на «Набор реагентов для качественного определения антигенов SARS-CoV-2 «NanoCare COVID-19 Antigen (Ag) Kit» в мазках из носоглотки человека методом иммунохроматографического анализа, LOT: 210812-03» на 25 тестов

«Набор реагентов для качественного определения антигенов SARS-CoV-2 «NanoCare COVID-19 Antigen (Ag) Kit» в мазках из носоглотки человека методом иммунохроматографического анализа, LOT: 210812-03»

REF SRK-003

LOT 210812-03

 02.2023



IVD



25

Беречь от детей.

Только для наружного использования



NanoBioLife Inc. («НаноБиоЛайф Инк.»),
632, Seobusaet-gil Geumcheon-gu, Seoul,
Korea

Уполномоченный представитель на территории РФ:
ООО «НаноБиоЛайф», 121354, Россия, Москва,
вн.тер.г. муниципальный округ Можайский, улица
Дорогобужская, дом 14, помещ. 203А

РУ № _____

Состав набора:

1. Тестовая кассета (в индивидуальной упаковке в комплекте с осушителем) - 25 шт.
2. Пробирка с буферным раствором - 25 шт.
3. Насадка с капельницей - 25 шт.
4. Инструкция по применению - 1 шт.

Маркировочная этикетка на «Набор реагентов для качественного определения антигенов SARS-CoV-2 «NanoCare COVID-19 Antigen (Ag) Kit» в мазках из носоглотки человека методом иммунохроматографического анализа, LOT: 210427-03» на 1 тест

«Набор реагентов для качественного определения антигенов SARS-CoV-2 «NanoCare COVID-19 Antigen (Ag) Kit» в мазках из носоглотки человека методом иммунохроматографического анализа, LOT: 210427-03»	
REF	SRK-003
LOT	210427-03
	10.2022
	
Беречь от детей. Только для наружного использования	
	NanoBioLife Inc. («НаноБиоЛайф Инк.»), 632, Seobusaet-gil Geumcheon-gu, Seoul, Korea Уполномоченный представитель на территории РФ: ООО «НаноБиоЛайф», 121354, Россия, Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Можайский, улица Дорогобужская, дом 14, помещ. 203А РУ № _____ Состав набора: 1. Тестовая кассета (в индивидуальной упаковке в комплекте с осушителем) - 25 шт. 2. Пробирка с буферным раствором - 25 шт. 3. Насадка с капельницей - 25 шт. 4. Инструкция по применению - 1 шт.

Маркировочная этикетка на «Набор реагентов для качественного определения антигенов SARS-CoV-2 «NanoCare COVID-19 Antigen (Ag) Kit» в мазках из носоглотки человека методом иммунохроматографического анализа, LOT: 210812-03» на 1 тест

«Набор реагентов для качественного определения антигенов SARS-CoV-2 «NanoCare COVID-19 Antigen (Ag) Kit» в мазках из носоглотки человека методом иммунохроматографического анализа, LOT: 210812-03»

REF SRK-003

LOT 210812-03

 02.2023



Беречь от детей.

Только для наружного использования



NanoBioLife Inc. («НаноБиоЛайф Инк.»).
632, Seobusaet-gil Geumcheon-gu, Seoul,
Korea

Уполномоченный представитель на территории РФ:
ООО «НаноБиоЛайф», 121354, Россия, Москва,
вн.тер.г. муниципальный округ Можайский, улица
Дорогобужская, дом 14, помещ. 203А

РУ № _____

Состав набора:

1. Тестовая кассета (в индивидуальной упаковке в комплекте с осушителем) - 25 шт.
2. Пробирка с буферным раствором - 25 шт.
3. Насадка с капельницей - 25 шт.
4. Инструкция по применению - 1 шт.

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 5 листов

Генеральный директор
ООО "НаноБиоЛайф"
Соколов Д.С.

