

УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО «Медико-биологический Союз»

М.В. Лосев

« 25 »


2022 г.



Образцы маркировки медицинского изделия

«МБС-Экспресс-ОРВИ» набор реагентов для иммунохроматографического определения антигенов возбудителей острых респираторных вирусных инфекций человека SARS-CoV-2, гриппа А, гриппа В, респираторно-синцитиального вируса (RSV) и аденовируса по ТУ 21.20.23-048-26329720-2021

Внешняя маркировка



Россия, 630090, г. Новосибирск, ул. Инженерная, 16
 Отдел продаж: тел.: (383) 363-77-01, факс: (383) 363-77-09
 e-mail: products@mbu.ru
 http://www.mbu.ru

«МБС-Экспресс-ОРВИ» набор реагентов для
 иммунохроматографического определения антигенов возбудителей
 острых респираторных вирусных инфекций человека SARS-CoV-2, гриппа
 А, гриппа В, респираторно-синцитиального вируса (RSV) и аденовируса
 по ТУ 21.20.23-048-26329720-2021

ПУ № XXX XXX/XXXXX от XX.XX.XXXX г.


Состав набора

1. Тестовое устройство	20 шт.
2. БР - буферный раствор	20 пр.
3. Пробирки	20 шт.
4. Крышки капельницы	20 шт.
5. Штатив под пробирки	1 шт.
6. Инструкция по применению	1 шт.
7. Карточка процедуры	1 шт.



Только для профессионального использования

Для клинической
 лабораторной
 диагностики



IVD

Для клинической лабораторной диагностики

Внутренняя маркировка


ООО «Медико-биологический Союз»			
Тестовое устройство			
LOT	XXXXX	IVD	 
	XX.XX.XXXX	 	 2°C 30°C
«МБС-Экспресс-ОРВИ»			

ООО «Медико-биологический Союз»	
БР - буферный раствор	0,35 мл
LOT XXXXX	IVD 2°C 30°C
	 
XX.XX.XXXX	
«МБС-Экспресс-ОРВИ»	



ООО «Медико-биологический Союз»	
Пробирки	
LOT XXXXX	IVD 2°C 30°C
	 
XX.XX.XXXX	
«МБС-Экспресс-ОРВИ»	

ООО «Медико-биологический Союз»	
Крышки капельницы	
LOT XXXXX	IVD 2°C 30°C
	 
XX.XX.XXXX	
«МБС-Экспресс-ОРВИ»	

Маркировка транспортной тары



Россия, 630090, г. Новосибирск, ул. Инженерная, 16
 Отдел продаж: тел.: (383) 363-77-01, факс: (383) 363-77-09
 e-mail: products@mbu.ru
<http://www.mbu.ru>

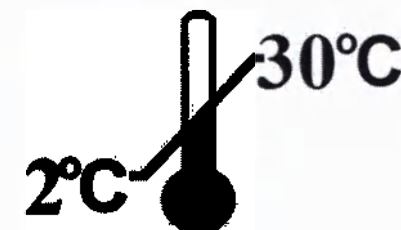

«МБС-Экспресс-ОРВИ» набор реагентов для иммунохроматографического определения антигенов возбудителей острых респираторных вирусных инфекций человека SARS-CoV-2, гриппа А, гриппа В, респираторно-синцитиального вируса (RSV) и аденовируса по ТУ 21.20.23-048-26329720-2021

Кат. №	XX-XXX-XX
Серия	XXXXX
Дата изготовления	XX.XX.XXXX
Срок годности	XX.XX.XXXX
Число потребительских упаковок в транспортной таре	XX шт.
Масса нетто транспортной тары	X,XX кг
Масса брутто транспортной тары	X,XX кг
Масса нетто потребительской упаковки	X,XX кг

Срочный груз

Не бросать

Прошито пронумеровано скреплено
печатью на (4) листах
Директор ООО «Медико-биологический
Союз» М.В.Лосев



УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО «Медико-биологический Союз»

М.В. Лосев

« 23 »

2022 г.




**Фотографические изображения общего вида медицинского
изделия для диагностики in vitro**

**«МБС-Экспресс-ОРВИ» набор реагентов для иммунохроматографического
определения антигенов возбудителей острых респираторных вирусных инфекций
человека SARS-CoV-2, гриппа А, гриппа В, респираторно-синцитиального вируса
(RSV) и аденовируса по ТУ 21.20.23-048-26329720-2021**

Внешняя маркировка набора реагентов





Россия, 630090, г. Новосибирск, ул. Инженерная, 16
Отдел продаж: тел.: (383) 363-77-01, факс: (383) 363-77-09
e-mail: products@mbu.ru
http://www.mbu.ru

«МБС-Экспресс-ОРВИ» набор реагентов для
иммунохроматографического определения антигенов возбудителей
острых респираторных вирусных инфекций человека SARS-CoV-2, гриппа
А, гриппа В, респираторно-синциального вируса (RSV) и аденовируса
по ТУ 21.20.23-048-26329720-2021

РУ № XXX XXX/XXXXX от XX.XX.XXXX г.

Состав набора

1. Тестовое устройство	20 шт.
2. БР - буферный раствор	20 пр.
3. Пробирки	20 шт.
4. Крышки капельницы	20 шт.
5. Штатив под пробирки	1 шт.
6. Инструкция по применению	1 шт.
7. Карточка процедуры	1 шт.



Для клинической
лабораторной
диагностики



ET-VRI-20



21002



01.07.2021



01.07.2023

Только для профессионального использования




Для клинической лабораторной диагностики




Внутренняя маркировка набора реагентов

Упаковка компонента набора реагента «Тестовое устройство»



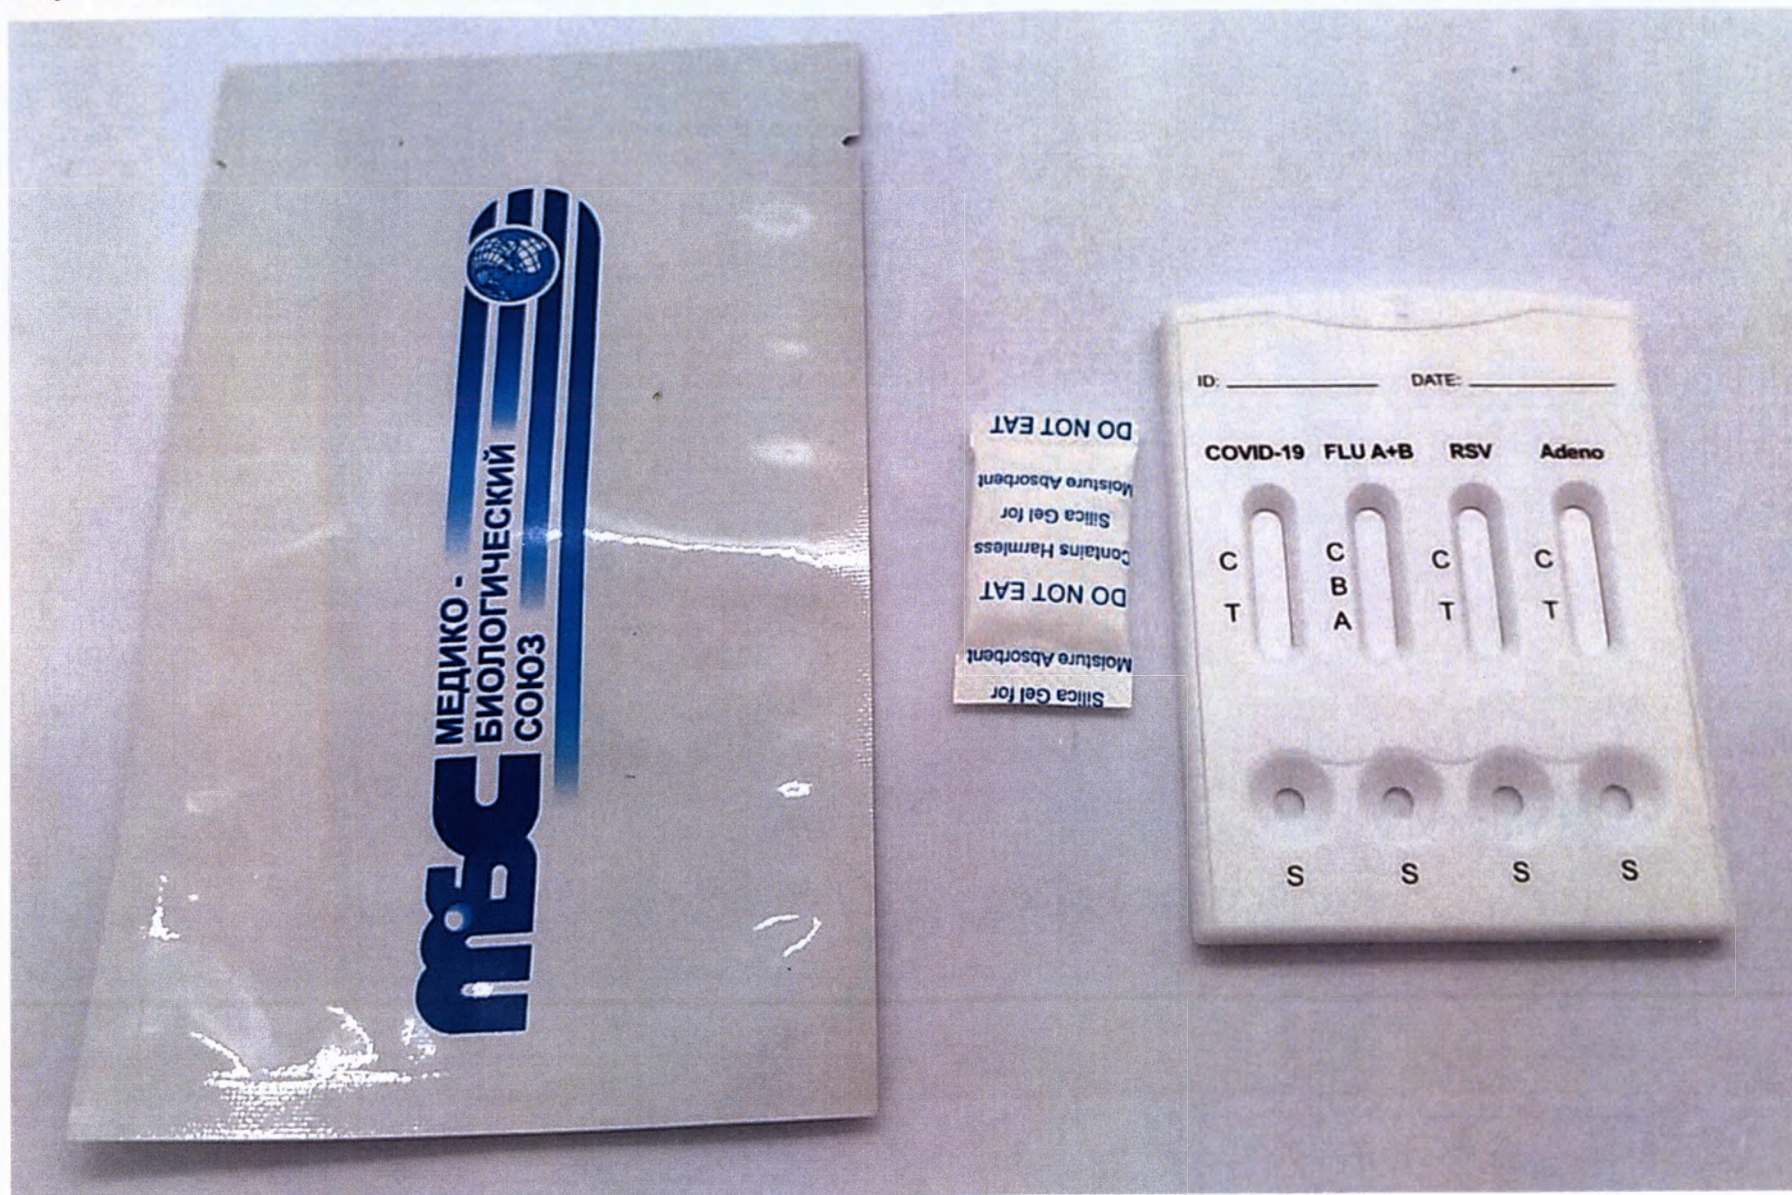


Содержимое упаковки компонента «БР»

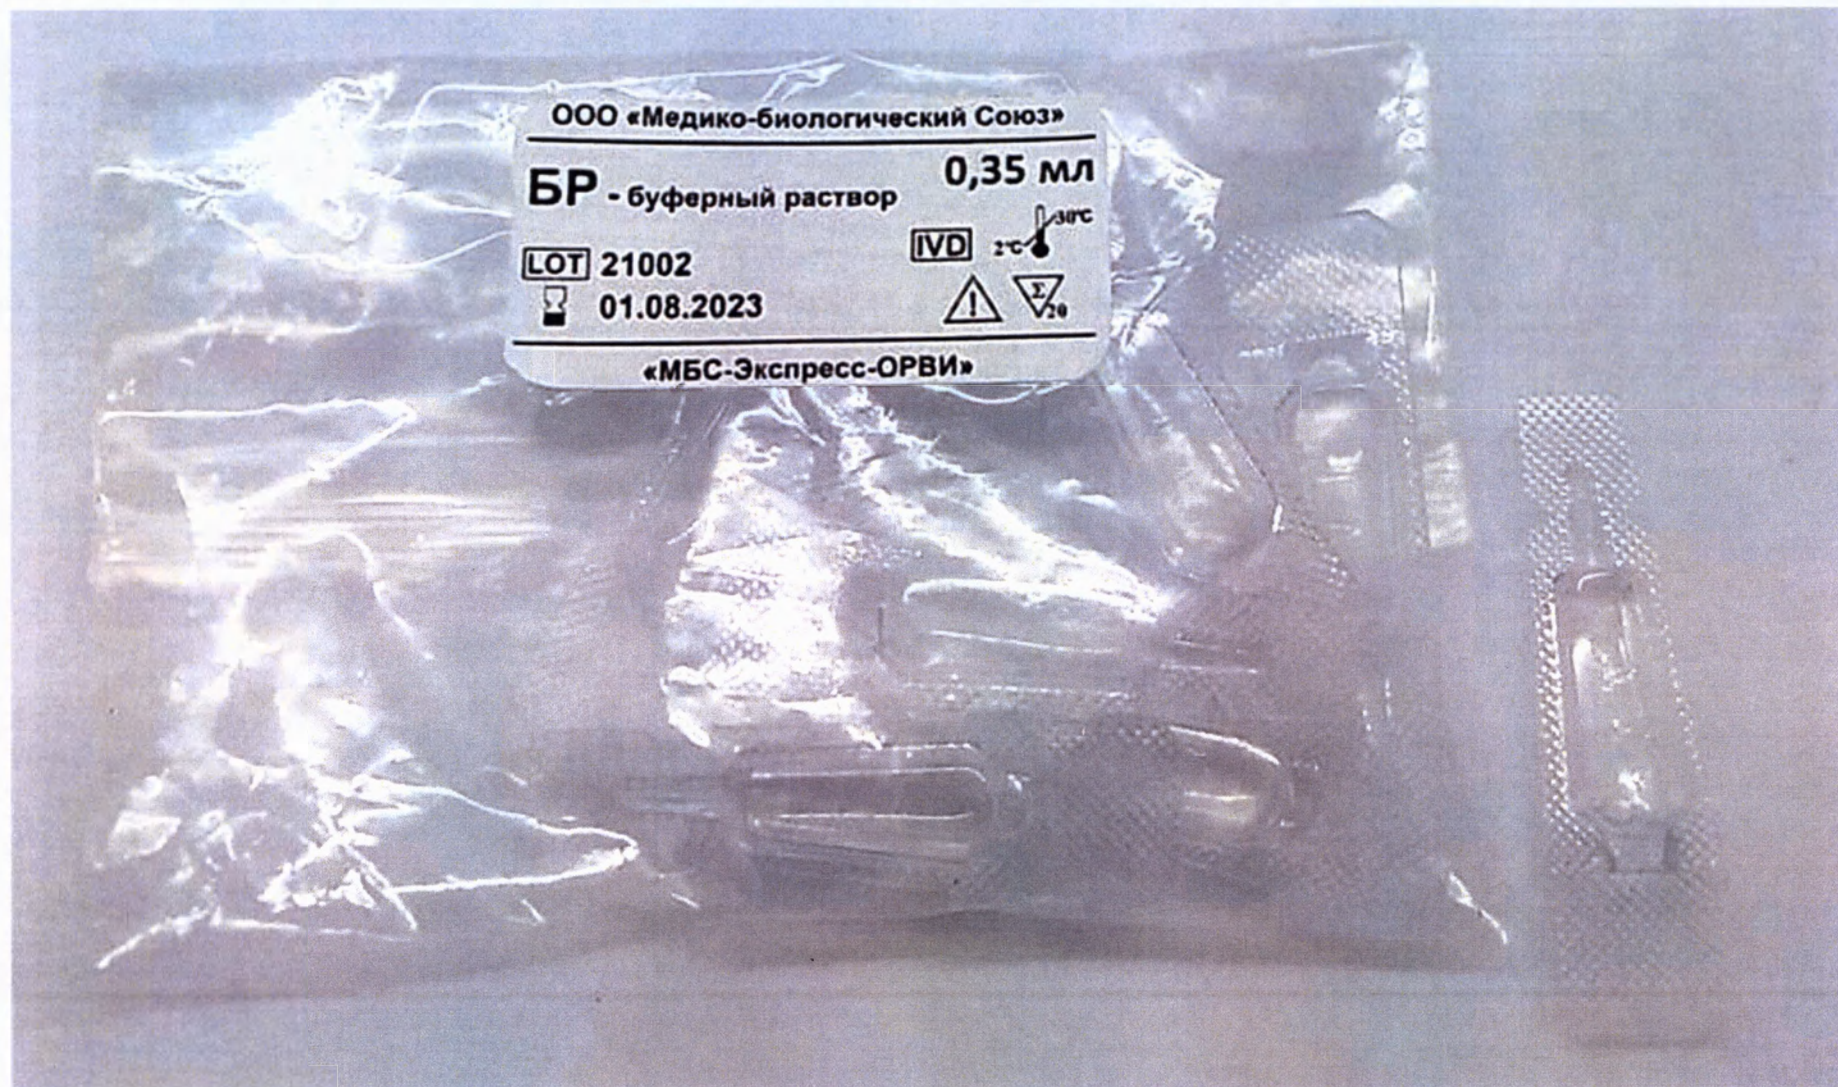


Содержимое упаковки компонента «Крышки капельницы»



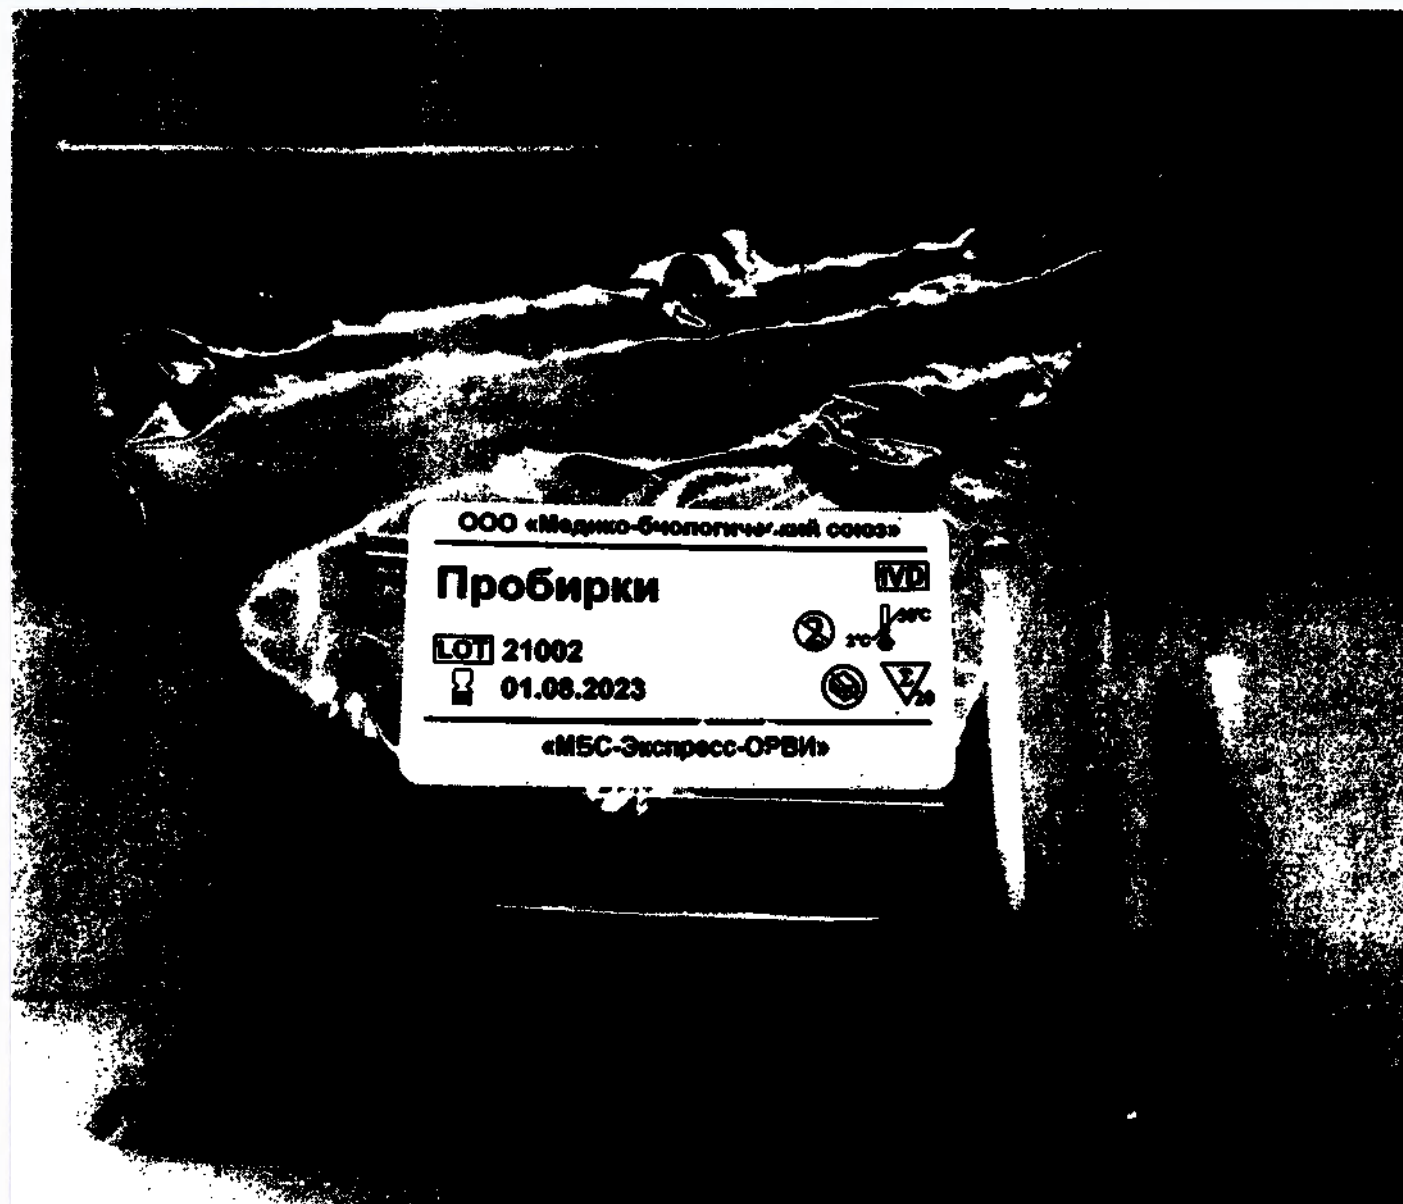

Компонент «Штатив под пробирки»

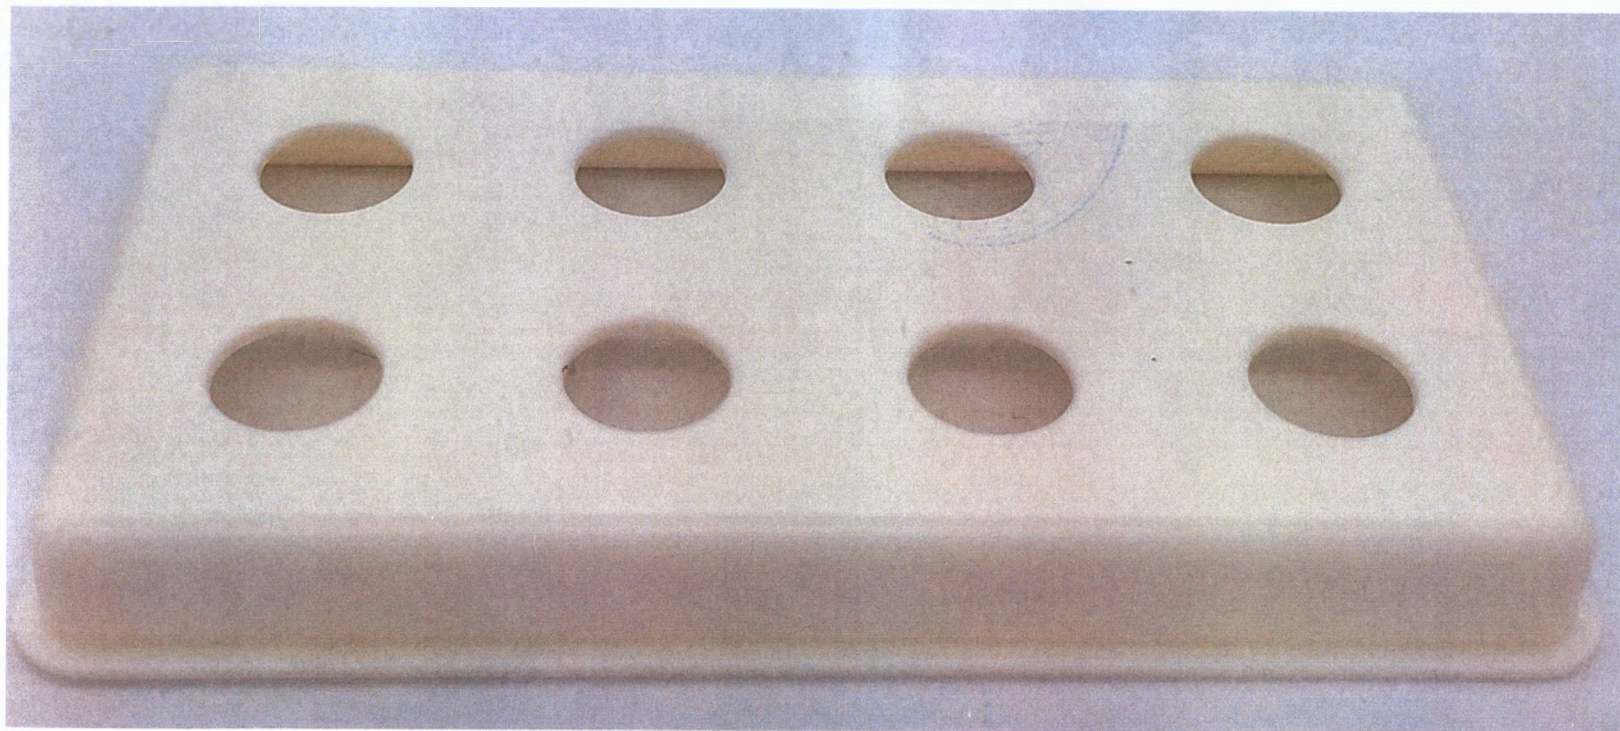

Пропито пронумеровано скреплено
печатью на () листах
Директор ООО «Медико-биологический
Союз» М.В.Лосев

