

Фотографические изображения медицинского изделия:

Абатменты приливаемые кобальт хромовые «Dental Lab Parts For GeoCCM» с комплектующими, для стоматологических имплантатов

Фотографические изображения медицинского изделия:

Абатменты приливаемые кобальт хромовые «Dental Lab Parts For GeoCCM» с комплектующими, для стоматологических имплантатов

Производство: GeoMedi Co.,Ltd., Korea / ГеоМеди Ко., Лтд., Корея,
#702-703,704, 709-1, Unit D, Indeokwon IT Valley, 40, Imi-ro, Uiwang-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea/ #702-703,704, 709-1, блок Д,
Индеовон ИТ Долина, 40, Ими-ро, Юавонг-си, Кенги-до, Республика Корея.

Список фото:

1. Абатменты, артикулы:

Рисунок 1.1.	SUM-H
Рисунок 1.2.	SUM-N
Рисунок 1.3.	DER-H
Рисунок 1.4.	DER-N
Рисунок 1.5.	ASR-H
Рисунок 1.6.	ASR-N
Рисунок 1.7.	ASW-H
Рисунок 1.8.	ASW-N
Рисунок 1.9.	AS3-T
Рисунок 1.10.	MARR-H
Рисунок 1.11.	MARR-N
Рисунок 1.12.	MEPM-E
Рисунок 1.13.	MEPR-E
Рисунок 1.14.	DSMM-T
Рисунок 1.15.	DSMM-N
Рисунок 1.16.	DSMR-T
Рисунок 1.17.	DSMR-N
Рисунок 1.18.	EXM-H
Рисунок 1.19.	EXM-N
Рисунок 1.20.	EXR-H
Рисунок 1.21.	EXR-N
Рисунок 1.22.	EXT-H
Рисунок 1.23.	EXT-N
Рисунок 1.24.	EXW-H
Рисунок 1.25.	EXW-N
Рисунок 1.26.	ISR-O
Рисунок 1.27.	ISR-N
Рисунок 1.28.	ISW-O

Рисунок 1.29.	ISW-N
Рисунок 1.30.	ITRK-O
Рисунок 1.31.	ITRK-N
Рисунок 1.32.	ITR-O
Рисунок 1.33.	ITR-N
Рисунок 1.34.	ITW-O
Рисунок 1.35.	ITW-N
Рисунок 1.36.	TSV3-H
Рисунок 1.37.	TSV3-N
Рисунок 1.38.	TSV4-H
Рисунок 1.39.	TSV4-N
Рисунок 1.40.	TSV5-H
Рисунок 1.41.	TSV5-N
Рисунок 1.42.	XVM-H
Рисунок 1.43.	XVM-N
Рисунок 1.44.	XVR-H
Рисунок 1.45.	XVR-N
Рисунок 1.46.	XVW-H
Рисунок 1.47.	XVW-N
Рисунок 1.48.	3ICM-H
Рисунок 1.49.	3ICM-N
Рисунок 1.50.	3ICR-H
Рисунок 1.51.	3ICR-N
Рисунок 1.52.	RPM-E
Рисунок 1.53.	RPM-N
Рисунок 1.54.	RPR-E
Рисунок 1.55.	RPR-N
Рисунок 1.56.	RPW-E
Рисунок 1.57.	RPW-N
Рисунок 1.58.	BLM-R
Рисунок 1.59.	BLR-R
Рисунок 1.60.	SURO-H
Рисунок 1.61.	SURO-N
Рисунок 1.62.	MUTB-H
Рисунок 1.63.	SUM-H2
Рисунок 1.64.	SUM-N2
Рисунок 1.65.	DER-H2
Рисунок 1.66.	DER-N2

Рисунок 1.67.	ASR-H2
Рисунок 1.68.	ASR-N2
Рисунок 1.69.	ASW-H2
Рисунок 1.70.	ASW-N2
Рисунок 1.71.	AS3-T2
Рисунок 1.72.	MARR-H2
Рисунок 1.73.	MARR-N2
Рисунок 1.74.	MEPM-E2
Рисунок 1.75.	MEPR-E2
Рисунок 1.76.	DSMM-T2
Рисунок 1.77.	DSMM-N2
Рисунок 1.78.	DSMR-T2
Рисунок 1.79.	DSMR-N2
Рисунок 1.80.	EXM-H2
Рисунок 1.81.	EXM-N2
Рисунок 1.82.	EXR-H2
Рисунок 1.83.	EXR-N2
Рисунок 1.84.	EXT-H2
Рисунок 1.85.	EXT-N2
Рисунок 1.86.	EXW-H2
Рисунок 1.87.	EXW-N2
Рисунок 1.88.	ISR-O2
Рисунок 1.89.	ISR-N2
Рисунок 1.90.	ISW-O2
Рисунок 1.91.	ISW-N2
Рисунок 1.92.	ITRK-O2
Рисунок 1.93.	ITRK-N2
Рисунок 1.94.	ITR-O2
Рисунок 1.95.	ITR-N2
Рисунок 1.96.	ITW-O2
Рисунок 1.97.	ITW-N2
Рисунок 1.98.	TSV3-H2
Рисунок 1.99.	TSV3-N2
Рисунок 1.100.	TSV4-H2
Рисунок 1.101.	TSV4-N2
Рисунок 1.102.	TSV5-H2
Рисунок 1.103.	TSV5-N2
Рисунок 1.104.	XVM-H2

Рисунок 1.105.	XVM-N2
Рисунок 1.106.	XVR-H2
Рисунок 1.107.	XVR-N2
Рисунок 1.108.	XVW-H2
Рисунок 1.109.	XVW-N2
Рисунок 1.110.	3ICM-H2
Рисунок 1.111.	3ICM-N2
Рисунок 1.112.	3ICR-H2
Рисунок 1.113.	3ICR-N2
Рисунок 1.114.	RPM-E2
Рисунок 1.115.	RPM-N2
Рисунок 1.116.	RPR-E2
Рисунок 1.117.	RPR-N2
Рисунок 1.118.	RPW-E2
Рисунок 1.119.	RPW-N2
Рисунок 1.120.	BLM-R2
Рисунок 1.121.	BLR-R2
Рисунок 1.122.	SURO-H2
Рисунок 1.123.	SURO-N2
Рисунок 1.124.	MUTB-H2

2. Комплектующие:

Винты без покрытия, (при необходимости) артикулы:

Рисунок 2.1.	SUMC
Рисунок 2.2.	DERC
Рисунок 2.3.	EXMC
Рисунок 2.4.	EXRC
Рисунок 2.5.	EXWC
Рисунок 2.6.	MARRC
Рисунок 2.7.	MEPMC
Рисунок 2.8.	MEPRC
Рисунок 2.9.	DSMMC
Рисунок 2.10.	DSMRC
Рисунок 2.11.	TSVC
Рисунок 2.12.	RPMC
Рисунок 2.13.	RPRC
Рисунок 2.14.	XV3C
Рисунок 2.15.	XVC

Рисунок 2.16.	ITC
Рисунок 2.17.	BLMC
Рисунок 2.18.	BLRC
Рисунок 2.19.	3ICC
Рисунок 2.20.	AS3C
Рисунок 2.21.	ASRC
Рисунок 2.22.	ASWC
Рисунок 2.23.	EXMBC
Рисунок 2.24.	EXRBC
Рисунок 2.25.	EXWBC
Рисунок 2.26.	SUROC
Рисунок 2.27.	MUTBC

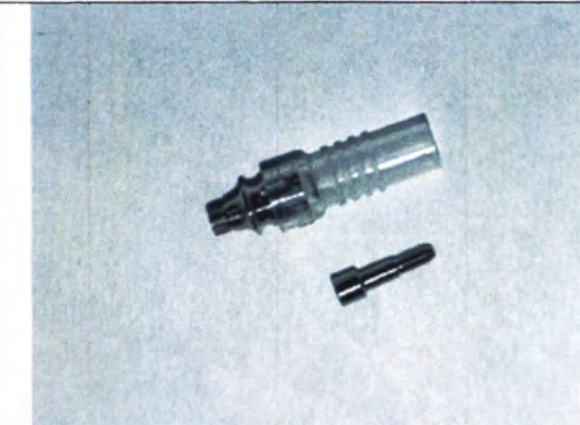
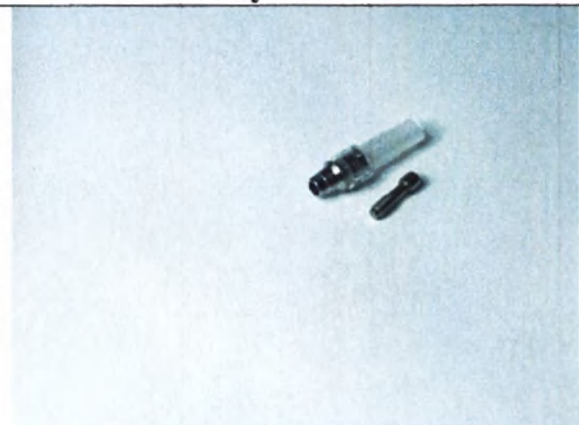
Винты с анодированным покрытием, (при необходимости) артикулы:

Рисунок 3.1.	SUMCT
Рисунок 3.2.	DERCT
Рисунок 3.3.	EXMCT
Рисунок 3.4.	EXRCT
Рисунок 3.5.	EXWCT
Рисунок 3.6.	MARRCT
Рисунок 3.7.	MEPMCT
Рисунок 3.8.	TSVCT
Рисунок 3.9.	RPMCT
Рисунок 3.10.	RPRCT
Рисунок 3.11.	XV3CT
Рисунок 3.12.	XVCT
Рисунок 3.13.	ITCT
Рисунок 3.14.	BLMCT
Рисунок 3.15.	BLRCT
Рисунок 3.16.	3ICCT
Рисунок 3.17.	AS3CT
Рисунок 3.18.	ASRCT
Рисунок 3.19.	ASWCT
Рисунок 3.20.	EXMBCT
Рисунок 3.21.	EXRBCT
Рисунок 3.22.	EXWBCT
Рисунок 3.23.	SUROCT
Рисунок 3.24.	MUTBCT

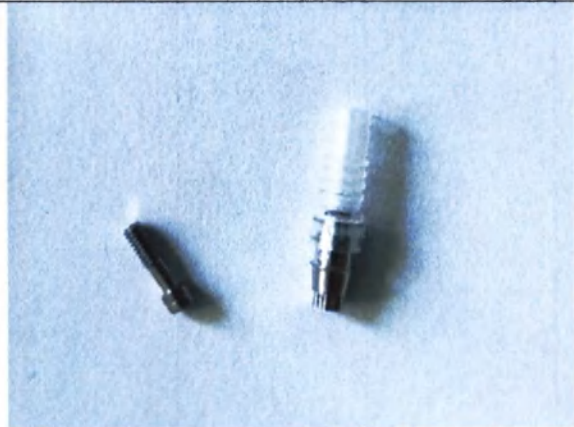
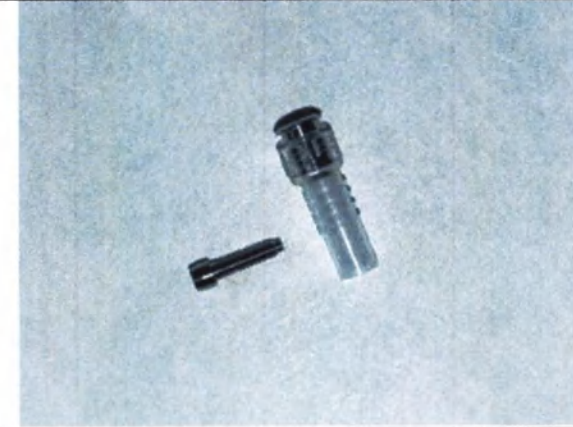
Абатменты приливаемые кобальт хромовые «Dental Lab Parts For GeoCCM» с комплектующими, для стоматологических имплантатов

Рисунок 1.1.	Рисунок 1.2.	Рисунок 1.3.
		
Рисунок 1.4.	Рисунок 1.5.	Рисунок 1.6.
		

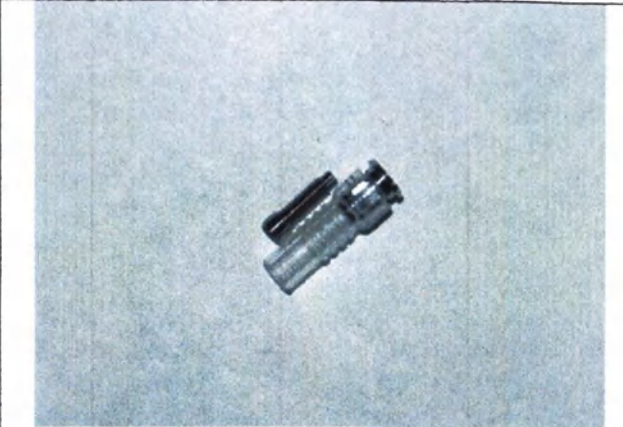
Абатменты приливаемые кобальт хромовые «Dental Lab Parts For GeoCCM» с комплектующими, для стоматологических имплантатов

Рисунок 1.7.	Рисунок 1.8.	Рисунок 1.9.
		
Рисунок 1.10.	Рисунок 1.11.	Рисунок 1.12.
		

Абатменты приливаемые кобальт хромовые «Dental Lab Parts For GeoCCM» с комплектующими, для стоматологических имплантатов

Рисунок 1.13.	Рисунок 1.14.	Рисунок 1.15.
		
Рисунок 1.16.	Рисунок 1.17.	Рисунок 1.18.
		

Абатменты приливаемые кобальт хромовые «Dental Lab Parts For GeoCCM» с комплектующими, для стоматологических имплантатов

Рисунок 1.19. 	Рисунок 1.20. 	Рисунок 1.21. 
Рисунок 1.22. 	Рисунок 1.23. 	Рисунок 1.24. 

Абатменты приливаемые кобальт хромовые «Dental Lab Parts For GeoCCM» с комплектующими, для стоматологических имплантатов

Рисунок 1.25.	Рисунок 1.26.	Рисунок 1.27.
		
Рисунок 1.28.	Рисунок 1.29.	Рисунок 1.30.
		

Абатменты приливаемые кобальт хромовые «Dental Lab Parts For GeoCCM» с комплектующими, для стоматологических имплантатов

Рисунок 1.31.	Рисунок 1.32.	Рисунок 1.33.
		
Рисунок 1.34.	Рисунок 1.35.	Рисунок 1.36.
		

Абатменты приливаемые кобальт хромовые «Dental Lab Parts For GeoCCM» с комплектующими, для стоматологических имплантатов

Рисунок 1.37.	Рисунок 1.38.	Рисунок 1.39.
		
Рисунок 1.40.	Рисунок 1.41.	Рисунок 1.42.
		

Абатменты приливаемые кобальт хромовые «Dental Lab Parts For GeoCCM» с комплектующими, для стоматологических имплантатов

Рисунок 1.43.



Рисунок 1.44.



Рисунок 1.45.



Рисунок 1.46.



Рисунок 1.47.



Рисунок 1.48.



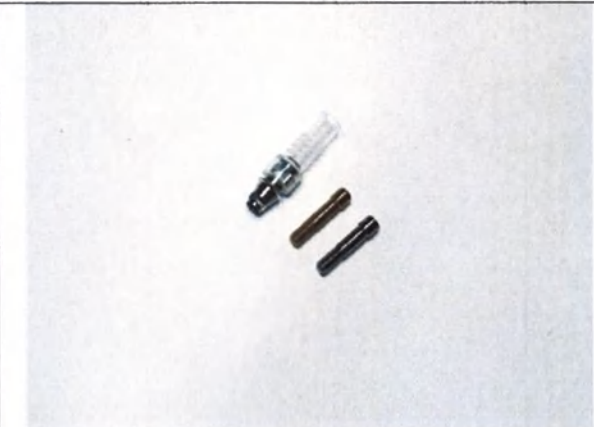
Абатменты приливаемые кобальт хромовые «Dental Lab Parts For GeoCCM» с комплектующими, для стоматологических имплантатов

Рисунок 1.49.	Рисунок 1.50.	Рисунок 1.51.
		
Рисунок 1.52.	Рисунок 1.53.	Рисунок 1.54.
		

Абатменты приливаемые кобальт хромовые «Dental Lab Parts For GeoCCM» с комплектующими, для стоматологических имплантатов

Рисунок 1.55.	Рисунок 1.56.	Рисунок 1.57.
		
Рисунок 1.58.	Рисунок 1.59.	Рисунок 1.60.
		

Абатменты приливаемые кобальт хромовые «Dental Lab Parts For GeoCCM» с комплектующими, для стоматологических имплантатов

Рисунок 1.61. 	Рисунок 1.62. 	Рисунок 1.63. 
Рисунок 1.64. 	Рисунок 1.65. 	Рисунок 1.66. 

Абатменты приливаемые кобальт хромовые «Dental Lab Parts For GeoCCM» с комплектующими, для стоматологических имплантатов

Рисунок 1.67.



Рисунок 1.68.



Рисунок 1.69.



Рисунок 1.70.



Рисунок 1.71.



Рисунок 1.72.



Абатменты приливаемые кобальт хромовые «Dental Lab Parts For GeoCCM» с комплектующими, для стоматологических имплантатов

Рисунок 1.73.



Рисунок 1.74.

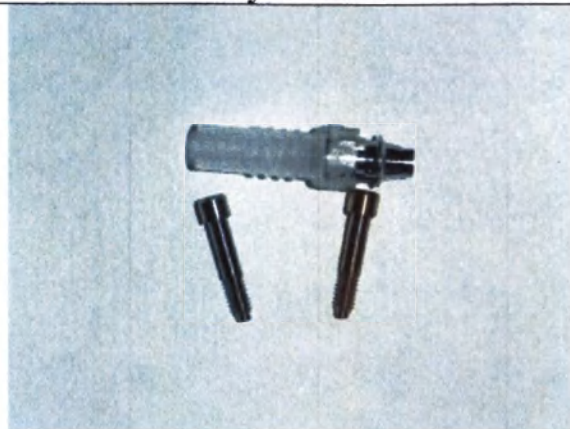


Рисунок 1.75.



Рисунок 1.76.



Рисунок 1.77.

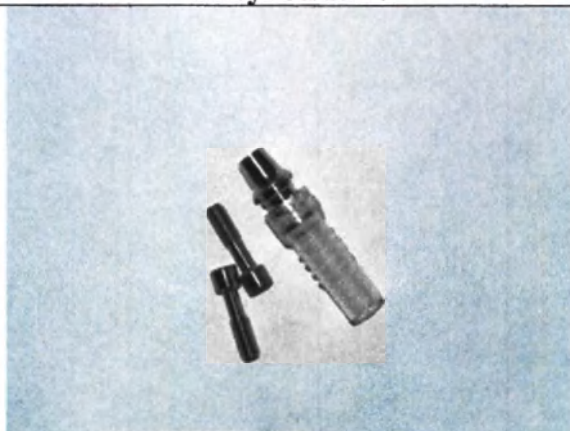


Рисунок 1.78.



Абатменты приливаемые кобальт хромовые «Dental Lab Parts For GeoCCM» с комплектующими, для стоматологических имплантатов

Рисунок 1.79.



Рисунок 1.80.



Рисунок 1.81.



Рисунок 1.82.



Рисунок 1.83.



Рисунок 1.84.



Абатменты приливаемые кобальт хромовые «Dental Lab Parts For GeoCCM» с комплектующими, для стоматологических имплантатов

Рисунок 1.85. 	Рисунок 1.86. 	Рисунок 1.87. 
Рисунок 1.88. 	Рисунок 1.89. 	Рисунок 1.90. 

Абатменты приливаемые кобальт хромовые «Dental Lab Parts For GeoCCM» с комплектующими, для стоматологических имплантатов

Рисунок 1.91.



Рисунок 1.92.



Рисунок 1.93.



Рисунок 1.94.



Рисунок 1.95.



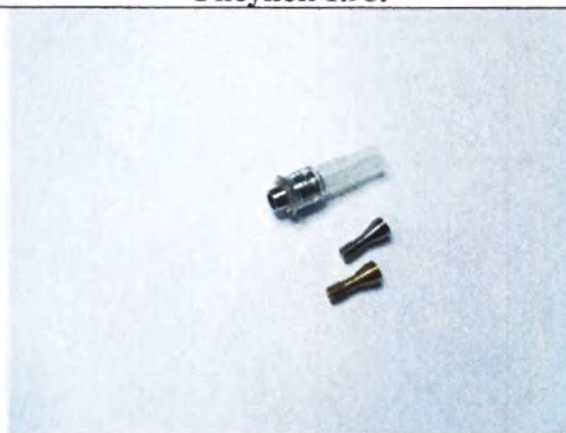


Рисунок 1.96.

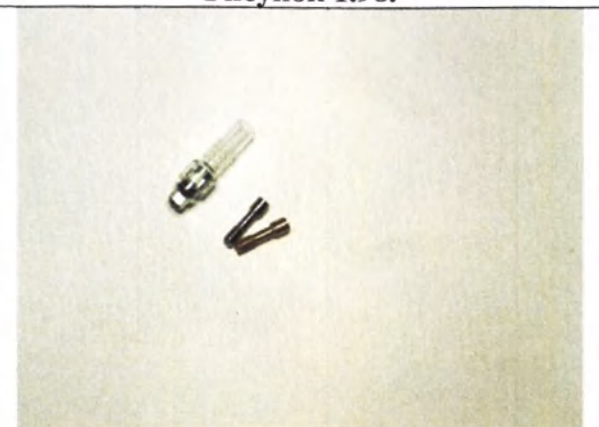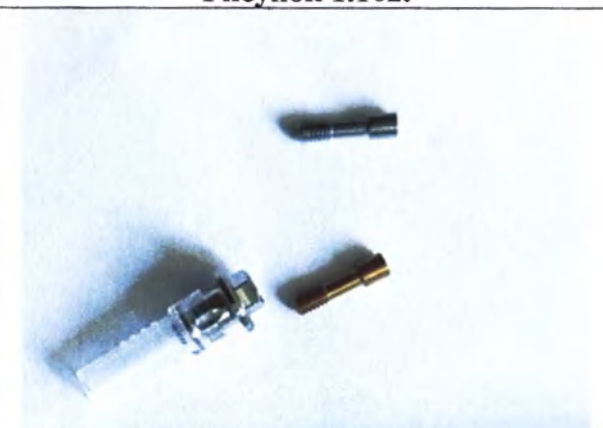

Абатменты приливаемые кобальт хромовые «Dental Lab Parts For GeoCCM» с комплектующими, для стоматологических имплантатов

Рисунок 1.97. 	Рисунок 1.98. 	Рисунок 1.99. 
Рисунок 1.100. 	Рисунок 1.101. 	Рисунок 1.102. 

Абатменты приливаемые кобальт хромовые «Dental Lab Parts For GeoCCM» с комплектующими, для стоматологических имплантатов

Рисунок 1.103. 	Рисунок 1.104. 	Рисунок 1.105. 
Рисунок 1.106. 	Рисунок 1.107. 	Рисунок 1.108. 

Абатменты приливаемые кобальт хромовые «Dental Lab Parts For GeoCCM» с комплектующими, для стоматологических имплантатов

Рисунок 1.109.



Рисунок 1.110.



Рисунок 1.111.



Рисунок 1.112.





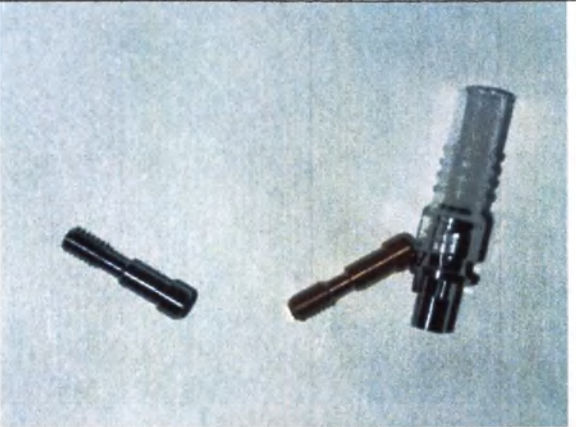
Рисунок 1.113.



Рисунок 1.114.

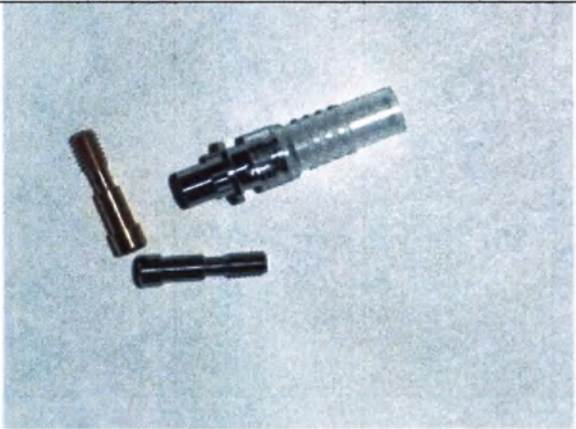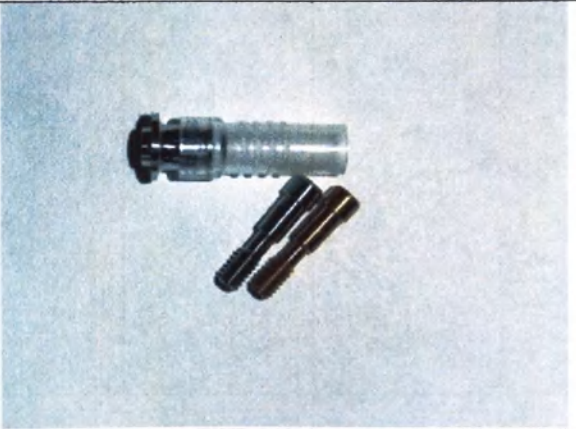

Абатменты приливаемые кобальт хромовые «Dental Lab Parts For GeoCCM» с комплектующими, для стоматологических имплантатов

Рисунок 1.115.	Рисунок 1.116.	Рисунок 1.117.
		
Рисунок 1.118.	Рисунок 1.119.	Рисунок 1.120.
		

Абатменты приливаемые кобальт хромовые «Dental Lab Parts For GeoCCM» с комплектующими, для стоматологических имплантатов

Рисунок 1.121.



Рисунок 1.122.



Рисунок 1.123.

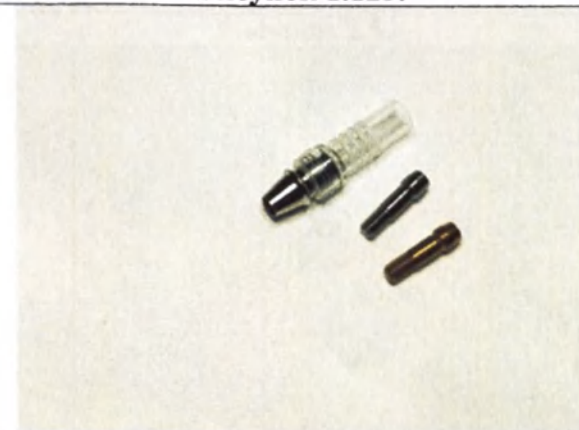


Рисунок 1.124.



Рисунок 2.1.



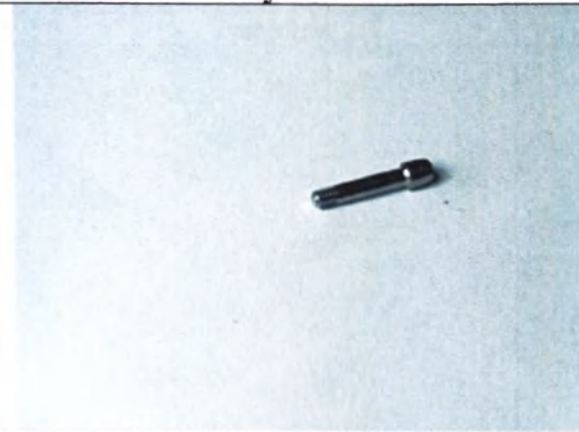


Рисунок 2.2.

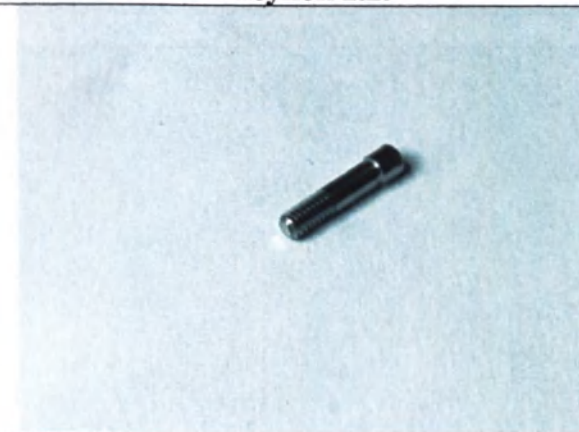

Абатменты приливаемые кобальт хромовые «Dental Lab Parts For GeoCCM» с комплектующими, для стоматологических имплантатов

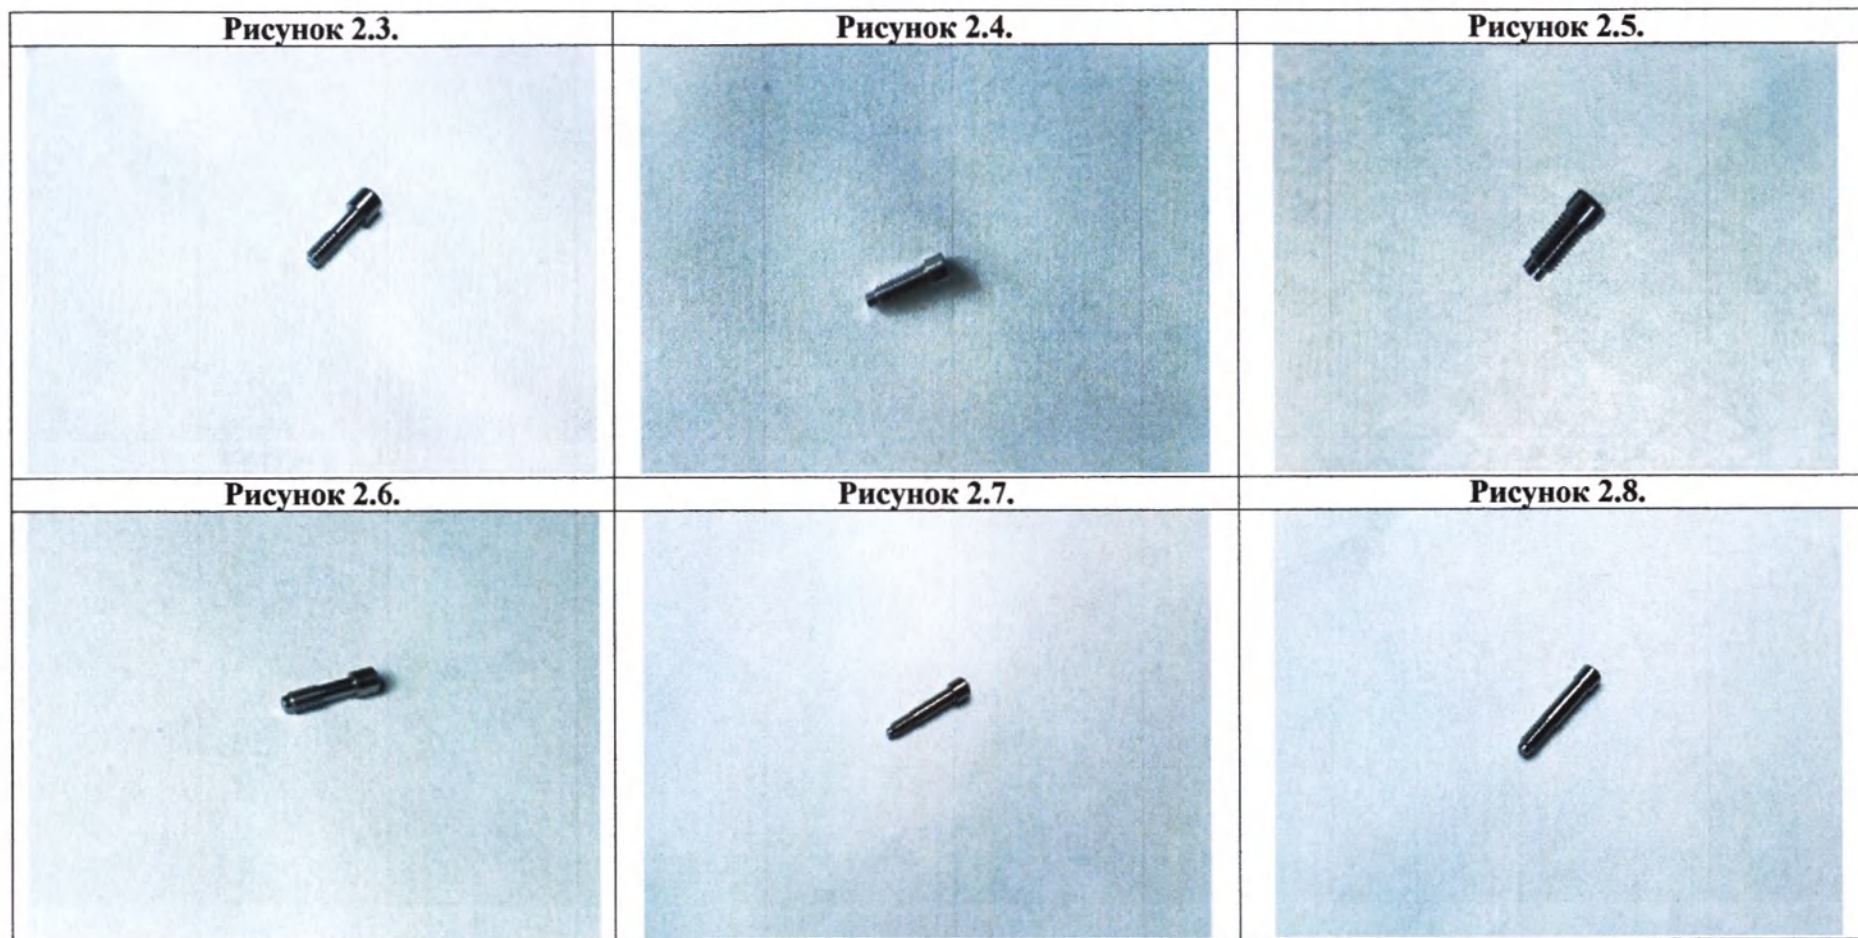

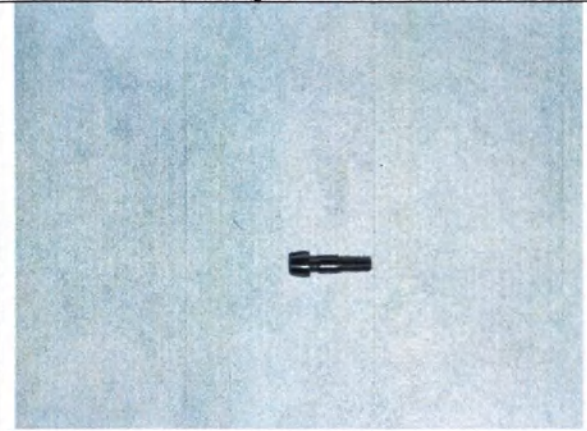
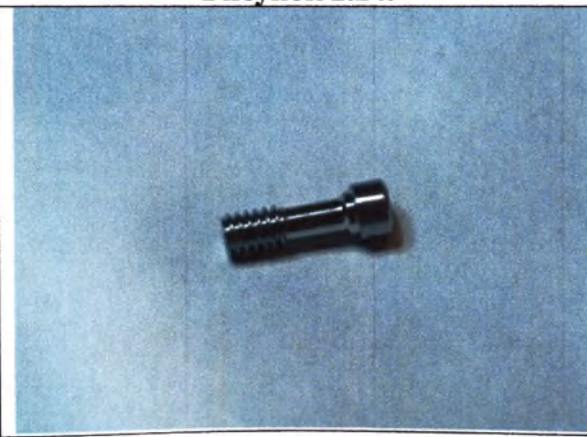
Абатменты приливаемые кобальт хромовые «Dental Lab Parts For GeoCCM» с комплектующими, для стоматологических имплантатов

Рисунок 2.9.	Рисунок 2.10.	Рисунок 2.11.
		
Рисунок 2.12.	Рисунок 2.13.	Рисунок 2.14.
		


Абатменты приливаемые кобальт хромовые «Dental Lab Parts For GeoCCM» с комплектующими, для стоматологических имплантатов

Рисунок 2.15.	Рисунок 2.16.	Рисунок 2.17.
		
Рисунок 2.18.	Рисунок 2.19.	Рисунок 2.20.
		



Абатменты приливаемые кобальт хромовые «Dental Lab Parts For GeoCCM» с комплектующими, для стоматологических имплантатов

Рисунок 2.21.	Рисунок 2.22.	Рисунок 2.23.
		
Рисунок 2.24.	Рисунок 2.25.	Рисунок 2.26.
		


Абатменты приливаемые кобальт хромовые «Dental Lab Parts For GeoCCM» с комплектующими, для стоматологических имплантатов

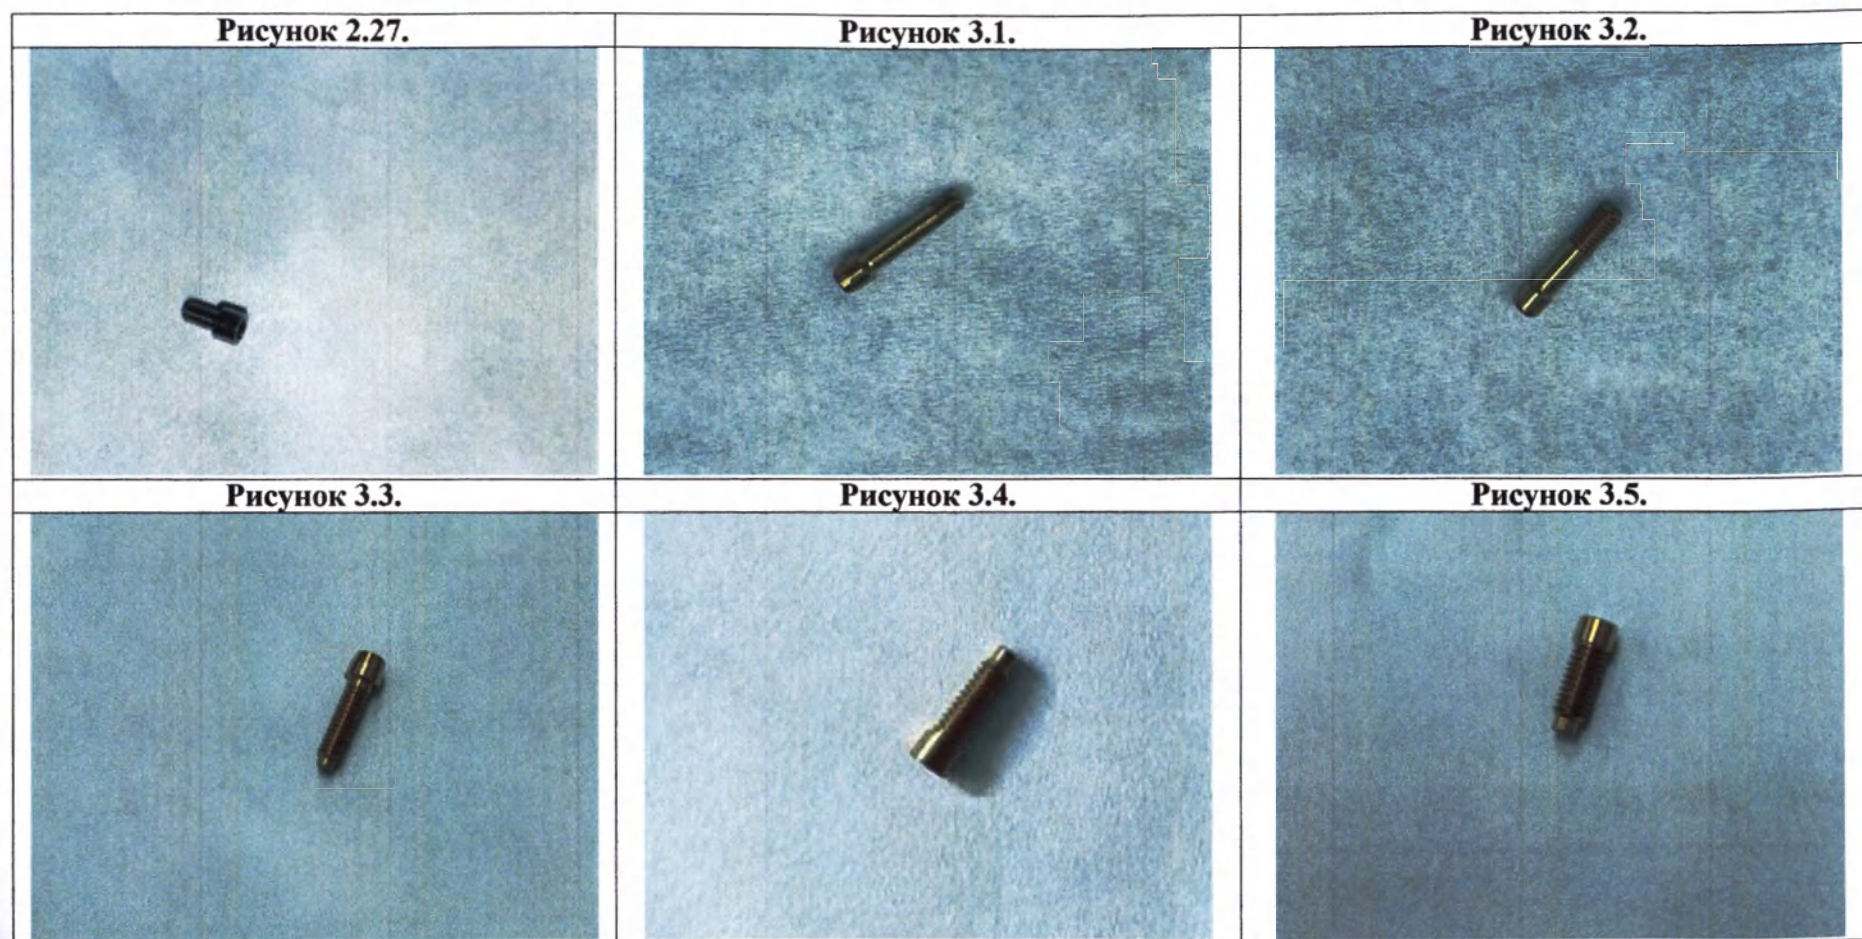


Абатменты приливаемые кобальт хромовые «Dental Lab Parts For GeoCCM» с комплектующими, для стоматологических имплантатов

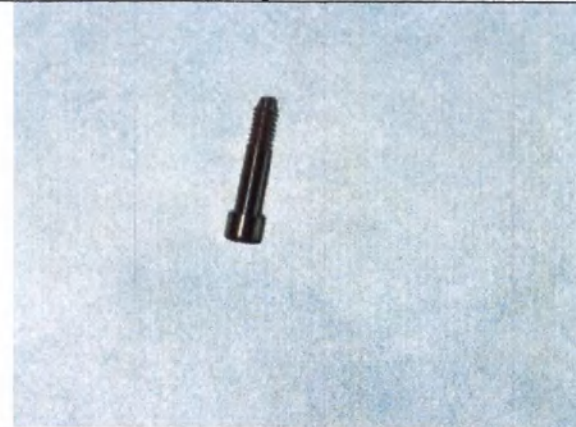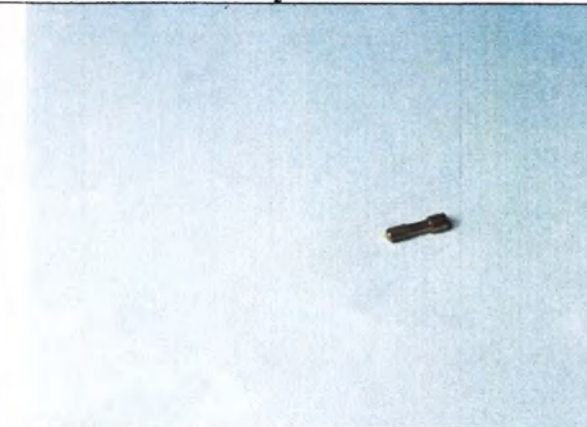Рисунок 3.6.	Рисунок 3.7.	Рисунок 3.8.
		
Рисунок 3.9.	Рисунок 3.10.	Рисунок 3.11.
		

Абатменты приливаемые кобальт хромовые «Dental Lab Parts For GeoCCM» с комплектующими, для стоматологических имплантатов

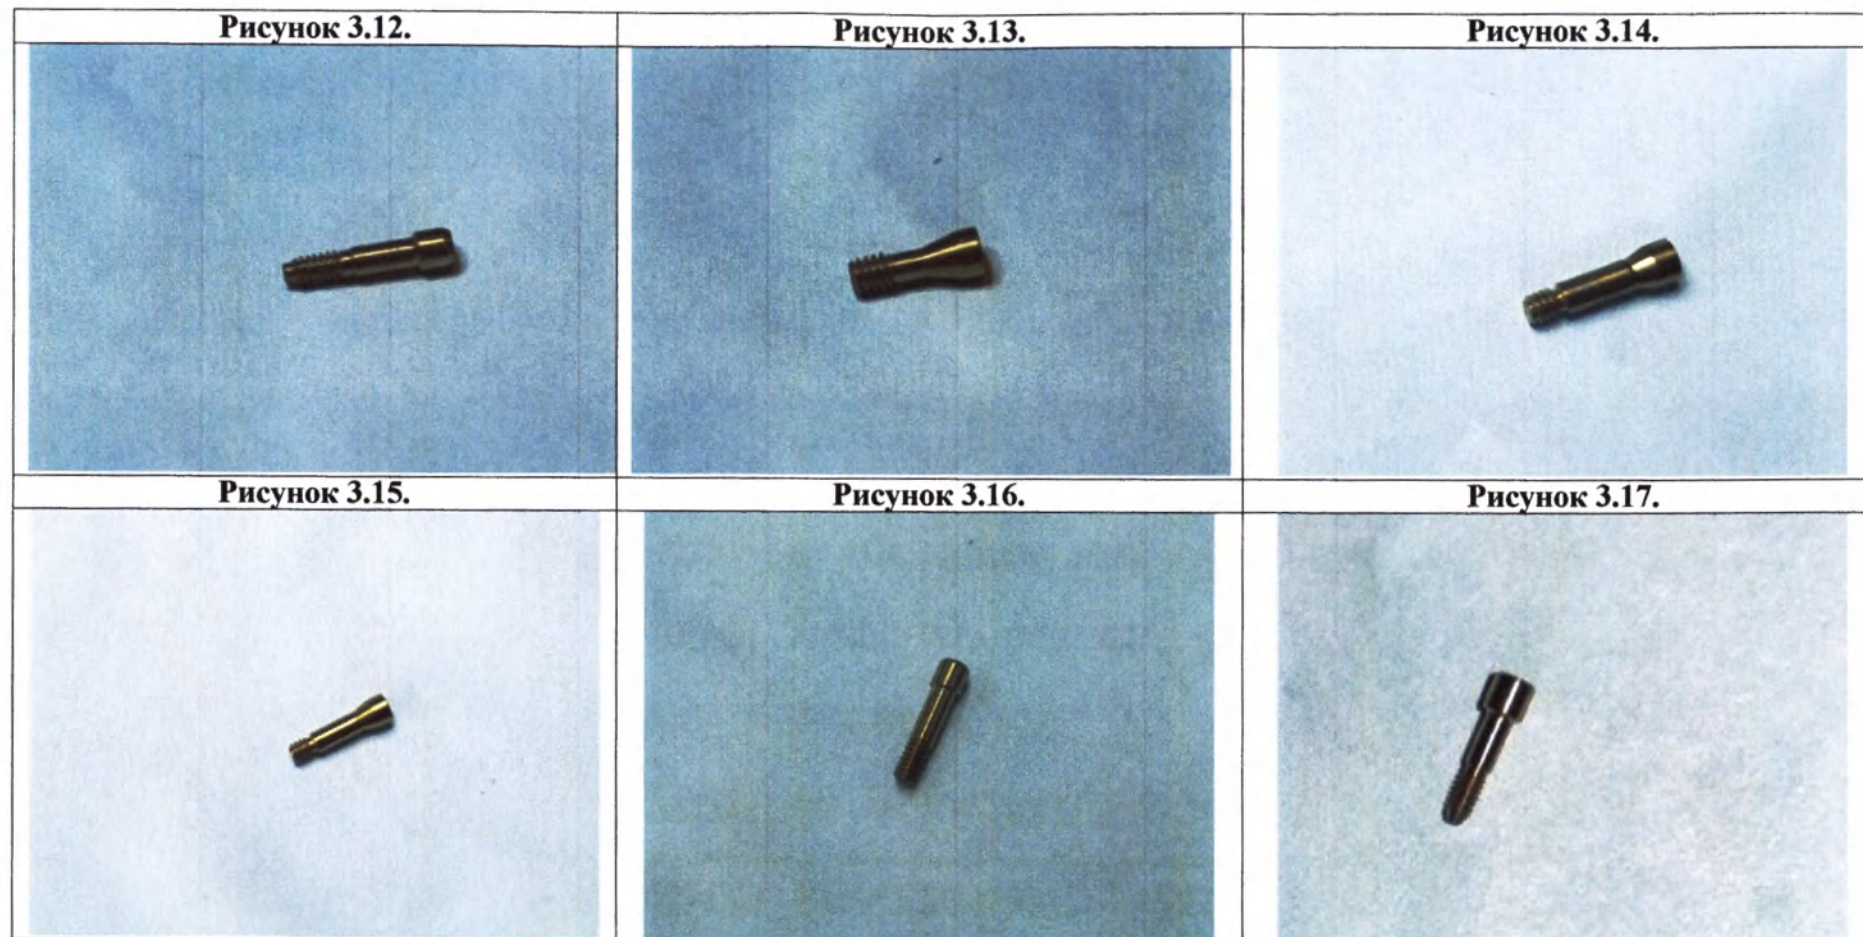

Абатменты приливаемые кобальт хромовые «Dental Lab Parts For GeoCCM» с комплектующими, для стоматологических имплантатов

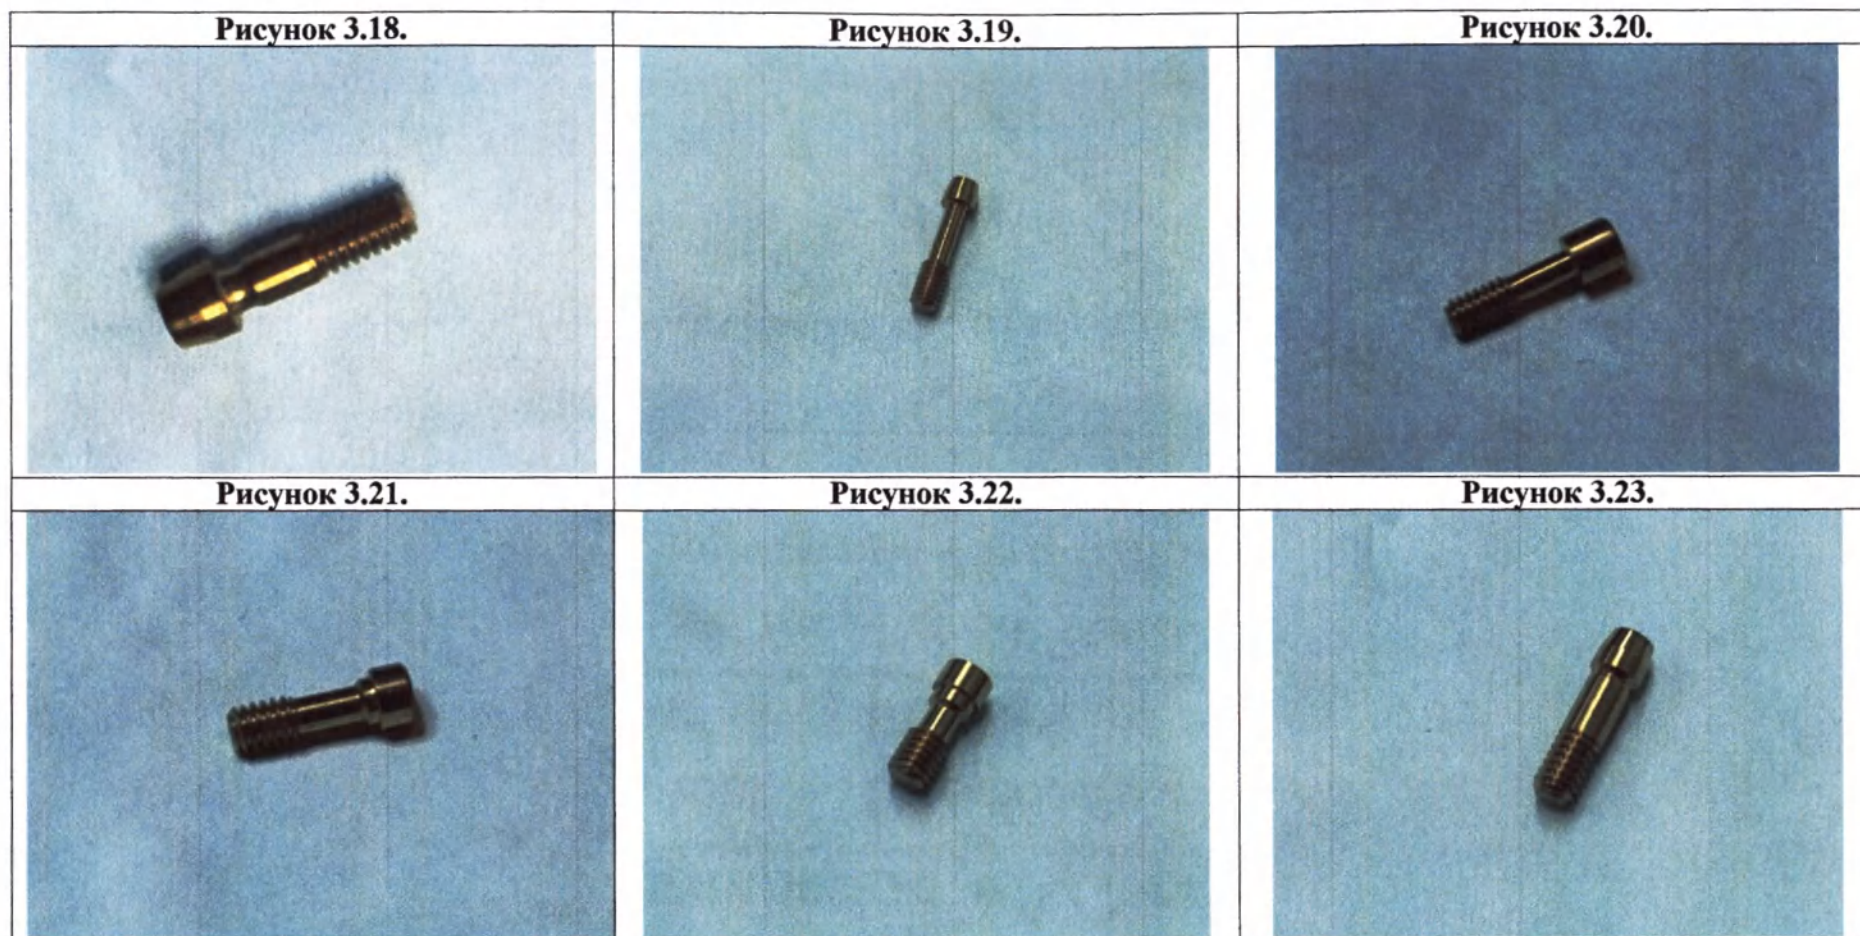

Абатменты приливаемые кобальт хромовые «Dental Lab Parts For GeoCCM» с комплектующими, для стоматологических имплантатов

Рисунок 3.24.	-	-
	-	-

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

36 (тридцать шесть) листов
цифрами прописью

Должность ГЕН. ДИРЕКТОР

Подпись _____

« 22 » ДЕКАБРЯ 2021 г. МТО

