

Фотографические изображения медицинского изделия:
Абатменты «Премил» с комплектующими, для стоматологических имплантатов, в вариантах исполнения: «Dental Lab Parts For GeoCMFit10», «Dental Lab Parts For GeoCMFit14»

Фотографические изображения медицинского изделия:

Абатменты «Премил» с комплектующими, для стоматологических имплантатов, в вариантах исполнения: «Dental Lab Parts For GeoCMFit10», «Dental Lab Parts For GeoCMFit14»

Производство: GeoMedi Co.,Ltd., Korea / ГеоМеди Ко., Лтд., Корея,

#702-703,704, 709-1, Unit D, Indeokwon IT Valley, 40, Imi-ro, Uiwang-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea/ #702-703,704, 709-1, блок Д, Индеовон ИТ Долина, 40, Ими-ро, Юавонг-си, Кенги-до, Республика Корея.

Список фото:

1. «Dental Lab Parts For GeoCMFit10», артикулы:

Рисунок 1.1.	CMFit10-SUM-H
Рисунок 1.2.	CMFit10-SUM-N
Рисунок 1.3.	CMFit10-SURD-H
Рисунок 1.4.	CMFit10-SURD-N
Рисунок 1.5.	CMFit10-DER-H
Рисунок 1.6.	CMFit10-DER-N
Рисунок 1.7.	CMFit10-DERN-H
Рисунок 1.8.	CMFit10-DERN-N
Рисунок 1.9.	CMFit10-MARR-H
Рисунок 1.10.	CMFit10-TSV3-H
Рисунок 1.11.	CMFit10-TSV4-H
Рисунок 1.12.	CMFit10-TSV5-H
Рисунок 1.13.	CMFit10-XVM-H
Рисунок 1.14.	CMFit10-XVR-H
Рисунок 1.15.	CMFit10-XVW-H
Рисунок 1.16.	CMFit10-3ICM-H
Рисунок 1.17.	CMFit10-3ICR-H
Рисунок 1.18.	CMFit10-SURO-H
Рисунок 1.19.	CMFit10-SURO-N
Рисунок 1.20.	CMFit10-SICM-H
Рисунок 1.21.	CMFit10-SICR-H
Рисунок 1.22.	CMFit10-ASR-H
Рисунок 1.23.	CMFit10-ASR-N

Рисунок 1.24.	CMFit10-ASW-H
Рисунок 1.25.	CMFit10-ASW-N
Рисунок 1.26.	CMFit10-DERA-H
Рисунок 1.27.	CMFit10-DERA-N
Рисунок 1.28.	CMFit10-DERT-H
Рисунок 1.29.	CMFit10-BLM-R
Рисунок 1.30.	CMFit10-BLR-R
Рисунок 1.31.	CMFit10-EXM-H
Рисунок 1.32.	CMFit10-EXR-H
Рисунок 1.33.	CMFit10-EXR-N
Рисунок 1.34.	CMFit10-EXW-H
Рисунок 1.35.	CMFit10-EXT-H
Рисунок 1.36.	CMFit10-RPM-E
Рисунок 1.37.	CMFit10-RPR-E
Рисунок 1.38.	CMFit10-RPW-E
Рисунок 1.39.	CMFit10-ISR-O
Рисунок 1.40.	CMFit10-ISW-O
Рисунок 1.41.	CMFit10-ITRK-O
Рисунок 1.42.	CMFit10-ITRK-N
Рисунок 1.43.	CMFit10-ITR-O
Рисунок 1.44.	CMFit10-ITW-O

2. «Dental Lab Parts For GeoCMFit14», артикулы:

Рисунок 2.1.	CMFit14-SUM-H
Рисунок 2.2.	CMFit14-SURD-H
Рисунок 2.3.	CMFit14-SURD-N
Рисунок 2.4.	CMFit14-DER-H
Рисунок 2.5.	CMFit14-DER-N
Рисунок 2.6.	CMFit14-DERN-H
Рисунок 2.7.	CMFit14-DERN-N
Рисунок 2.8.	CMFit14-MARR-H
Рисунок 2.9.	CMFit14-TSV3-H
Рисунок 2.10.	CMFit14-TSV4-H


Рисунок 2.11.	CMFit14-TSV5-H
Рисунок 2.12.	CMFit14-XVM-H
Рисунок 2.13.	CMFit14-XVR-H
Рисунок 2.14.	CMFit14-XVW-H
Рисунок 2.15.	CMFit14-3ICR-H
Рисунок 2.16.	CMFit14-SURO-H
Рисунок 2.17.	CMFit14-SURO-N
Рисунок 2.18.	CMFit14-SICM-H
Рисунок 2.19.	CMFit14-SICR-H
Рисунок 2.20.	CMFit14-ASR-H
Рисунок 2.21.	CMFit14-ASW-H
Рисунок 2.22.	CMFit14-DERA-H
Рисунок 2.23.	CMFit14-DERA-N
Рисунок 2.24.	CMFit14-DERT-H
Рисунок 2.25.	CMFit14-BLM-R
Рисунок 2.26.	CMFit14-BLR-R
Рисунок 2.27.	CMFit14-EXM-H
Рисунок 2.28.	CMFit14-EXR-H
Рисунок 2.29.	CMFit14-EXW-H
Рисунок 2.30.	CMFit14-EXT-H
Рисунок 2.31.	CMFit14-RPM-E
Рисунок 2.32.	CMFit14-RPR-E
Рисунок 2.33.	CMFit14-RPW-E
Рисунок 2.34.	CMFit14-ISR-O
Рисунок 2.35.	CMFit14-ISW-O
Рисунок 2.36.	CMFit14-ITRK-O
Рисунок 2.37.	CMFit14-ITR-O
Рисунок 2.38.	CMFit14-ITW-O

3. Винты без покрытия, (при необходимости) артикулы:

Рисунок 3.1.	SUMC
Рисунок 3.2.	SURDC
Рисунок 3.3.	DERC

Рисунок 3.4.	DERNC
Рисунок 3.5.	MARRC
Рисунок 3.6.	TSVC
Рисунок 3.7.	XVC
Рисунок 3.8.	3ICC
Рисунок 3.9.	SUROC
Рисунок 3.10.	SICC
Рисунок 3.11.	ASRC
Рисунок 3.12.	ASWC
Рисунок 3.13.	MAOC
Рисунок 3.14.	DERTC
Рисунок 3.15.	BLMC
Рисунок 3.16.	BLRC
Рисунок 3.17.	EXMC
Рисунок 3.18.	EXRC
Рисунок 3.19.	EXWC
Рисунок 3.20.	RPMC
Рисунок 3.21.	RPRC
Рисунок 3.22.	ITC







Абатменты «Премил» с комплектующими, для стоматологических имплантатов, в вариантах исполнения: «Dental Lab Parts For GeoCMFit10», «Dental Lab Parts For GeoCMFit14»

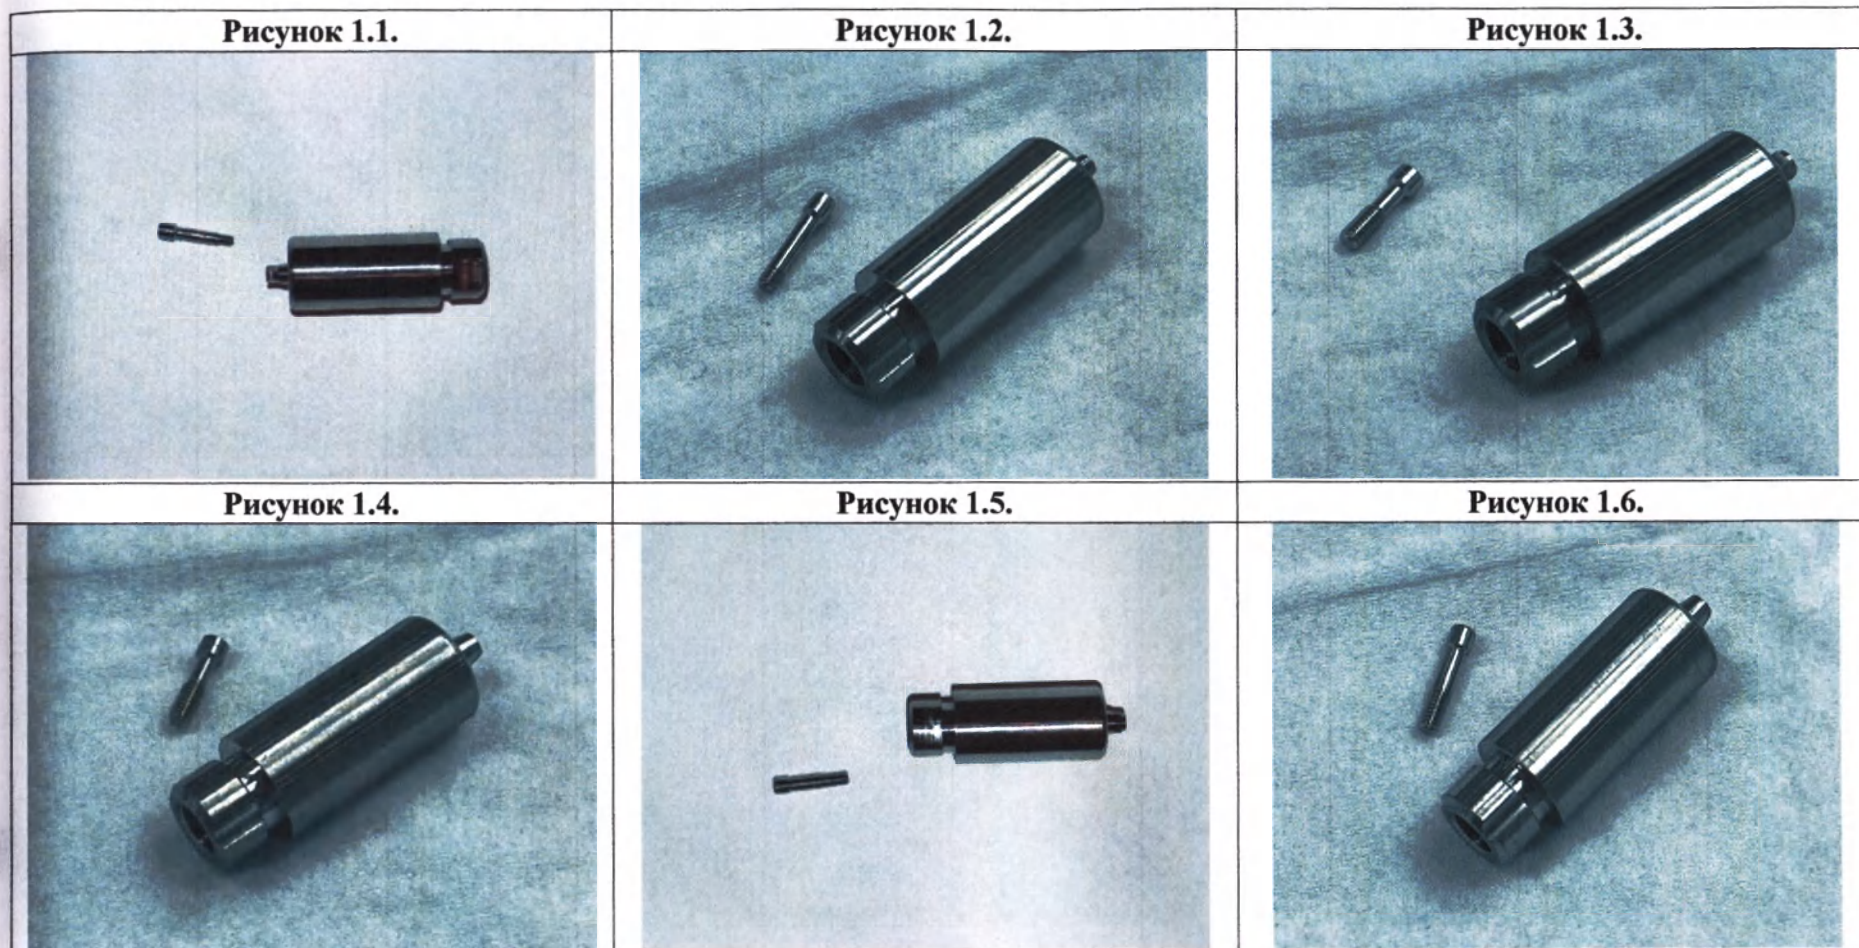






Абатменты «Премил» с комплектующими, для стоматологических имплантатов, в вариантах исполнения: «Dental Lab Parts For GeoCMFit10», «Dental Lab Parts For GeoCMFit14»

Рисунок 1.7. 	Рисунок 1.8. 	Рисунок 1.9. 
Рисунок 1.10. 	Рисунок 1.11. 	Рисунок 1.12. 


Абатменты «Премил» с комплектующими, для стоматологических имплантатов, в вариантах исполнения: «Dental Lab Parts For GeoCMFit10», «Dental Lab Parts For GeoCMFit14»

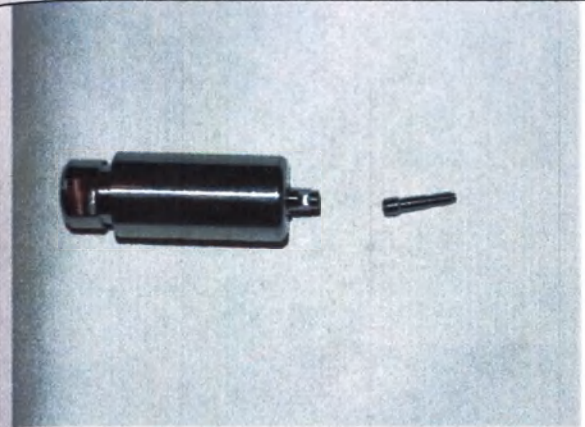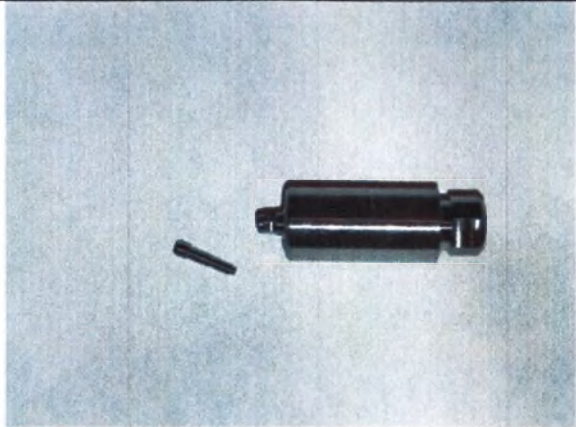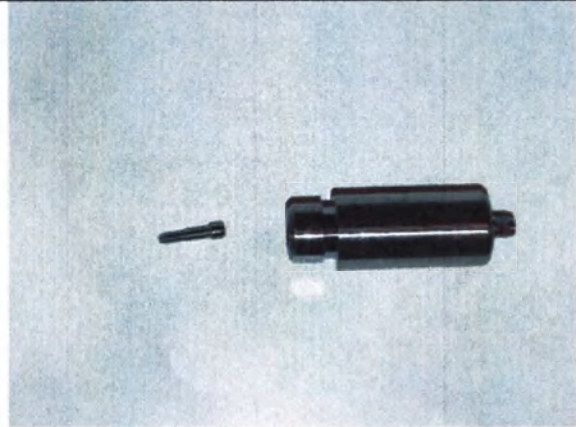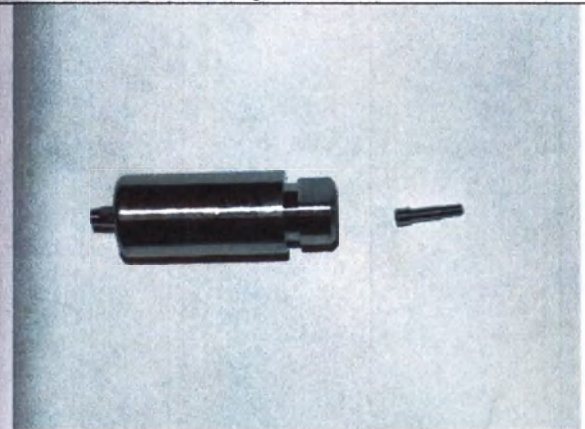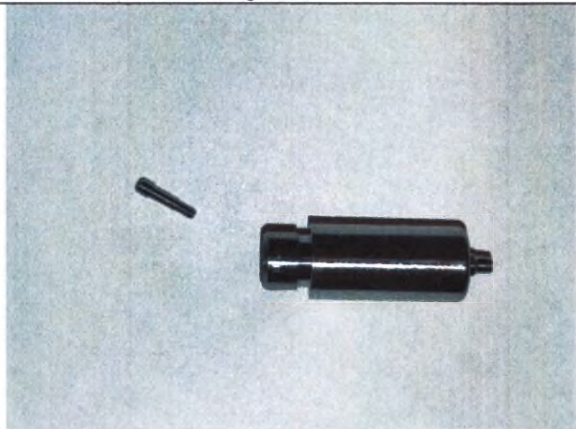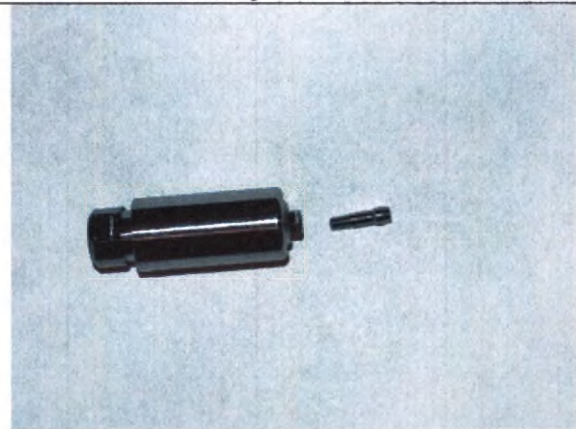Рисунок 1.13.	Рисунок 1.14.	Рисунок 1.15.
		
Рисунок 1.16.	Рисунок 1.17.	Рисунок 1.18.
		

Абатменты «Премил» с комплектующими, для стоматологических имплантатов, в вариантах исполнения: «Dental Lab Parts For GeoCMFit10», «Dental Lab Parts For GeoCMFit14»

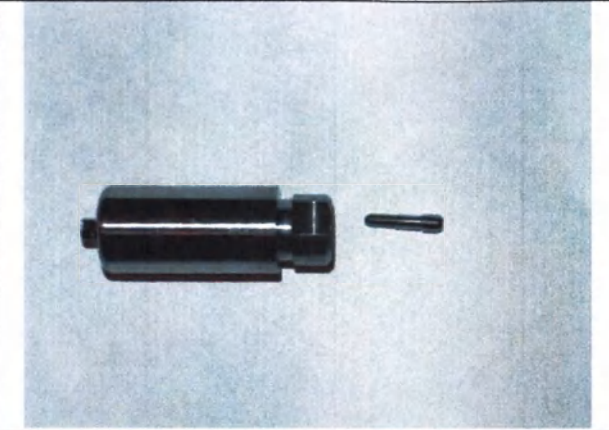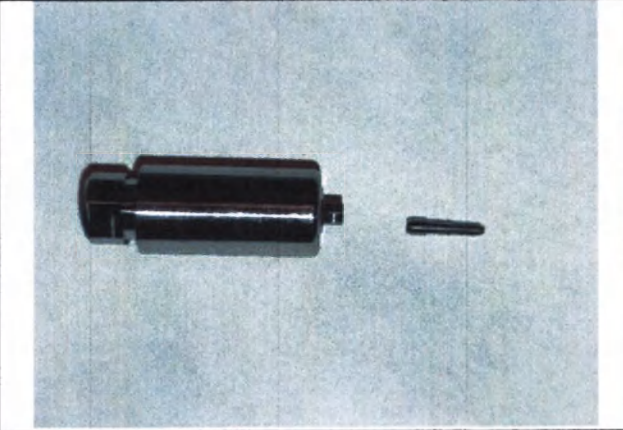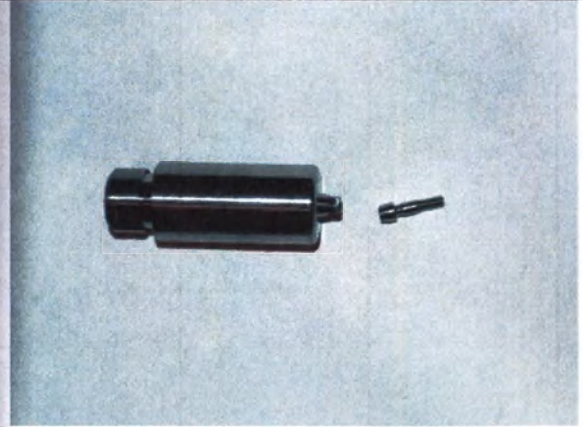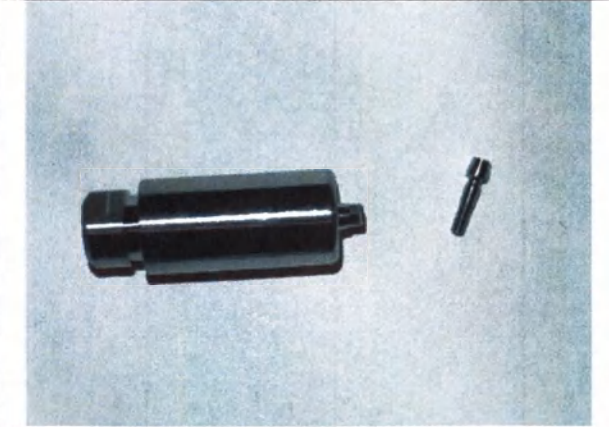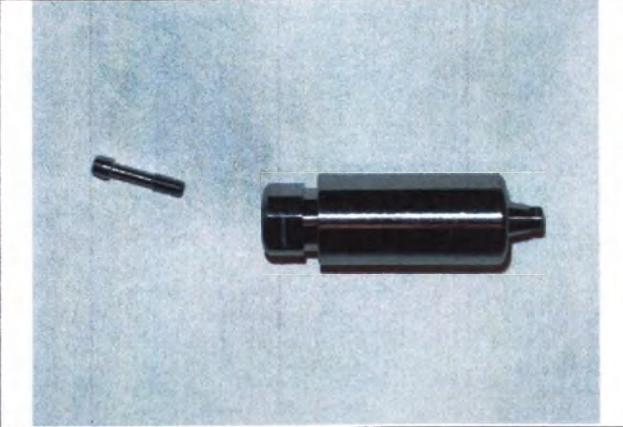Рисунок 1.19.	Рисунок 1.20.	Рисунок 1.21.
		
Рисунок 1.22.	Рисунок 1.23.	Рисунок 1.24.
		

Абатменты «Премил» с комплектующими, для стоматологических имплантатов, в вариантах исполнения: «Dental Lab Parts For GeoCMFit10», «Dental Lab Parts For GeoCMFit14»

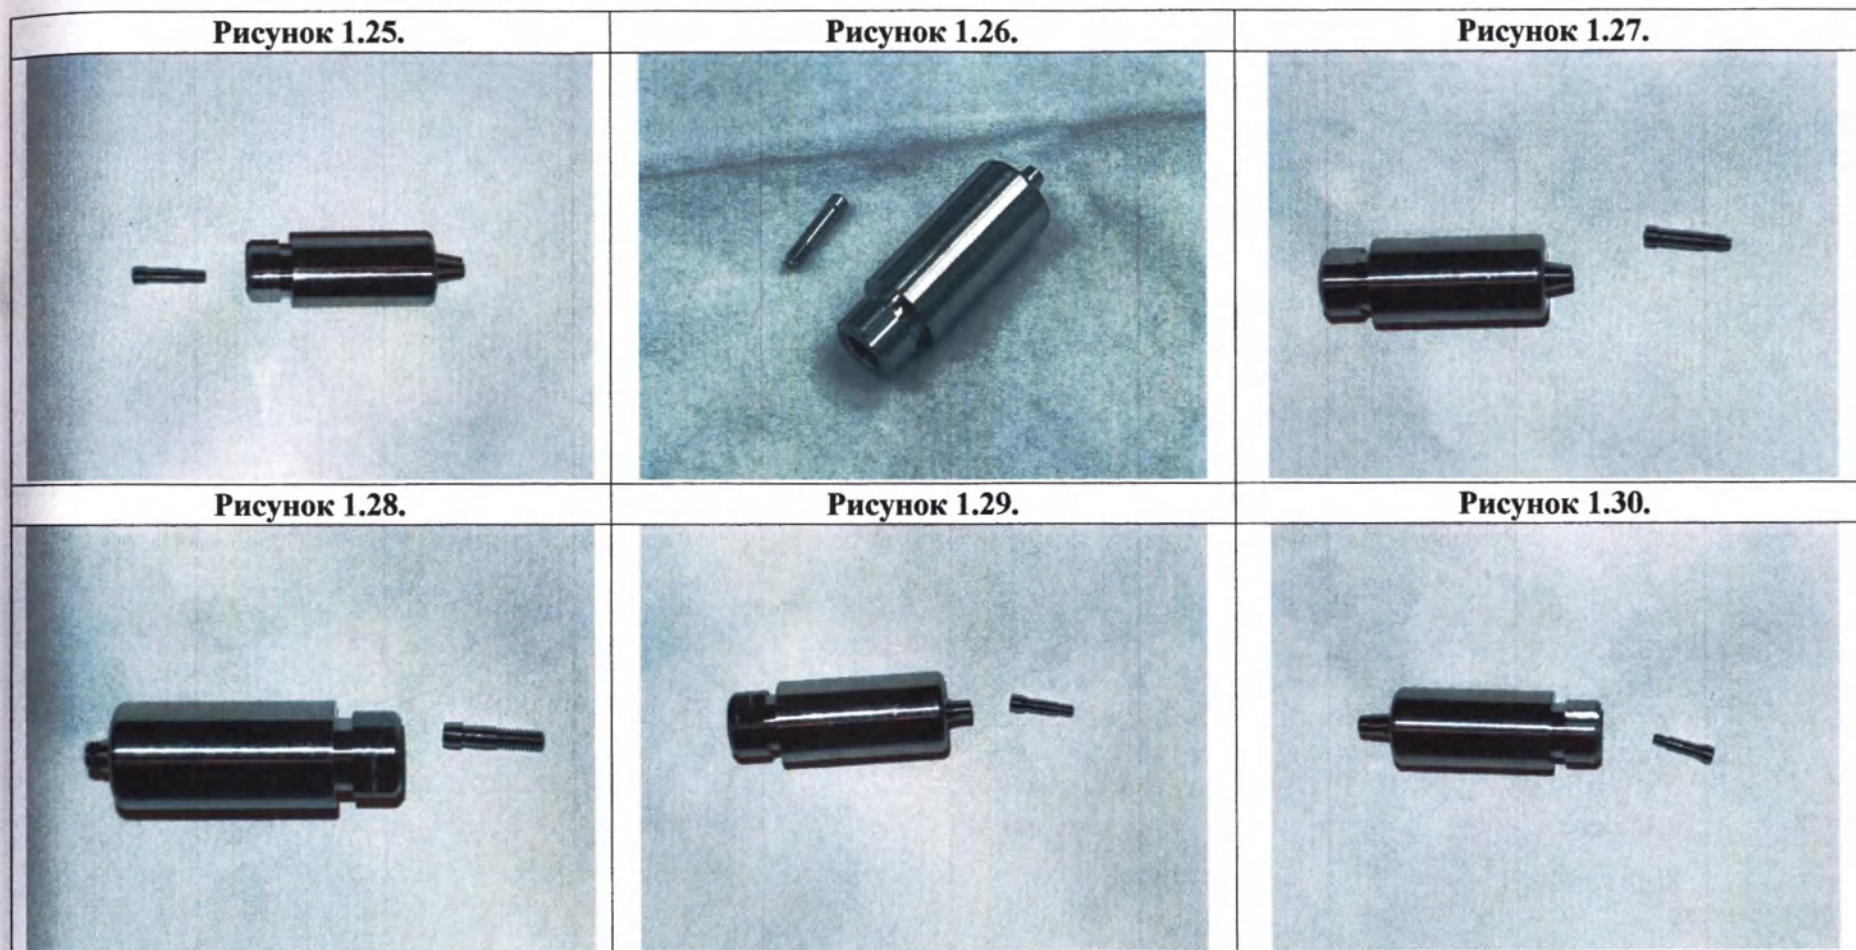

Абатменты «Премил» с комплектующими, для стоматологических имплантатов, в вариантах исполнения: «Dental Lab Parts For GeoCMFit10», «Dental Lab Parts For GeoCMFit14»

Рисунок 1.31.

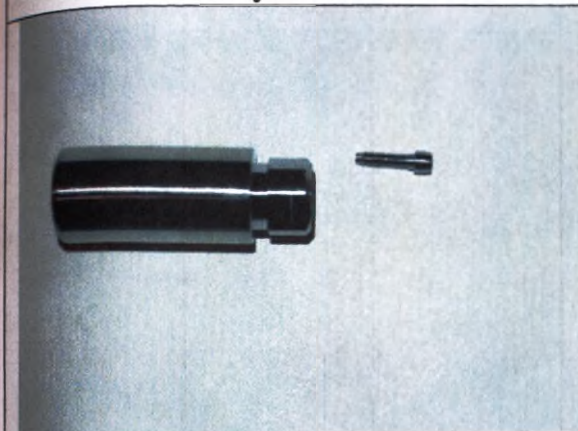


Рисунок 1.32.

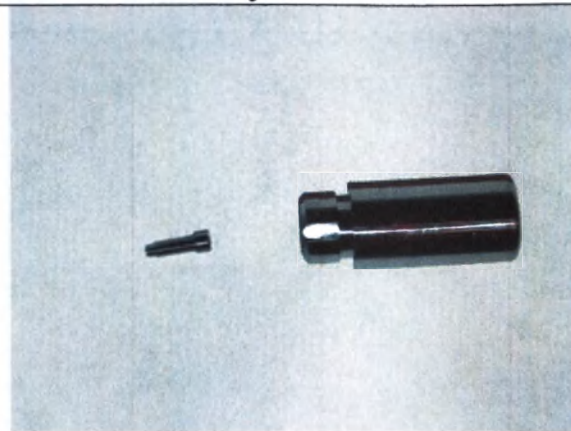


Рисунок 1.33.



Рисунок 1.34.


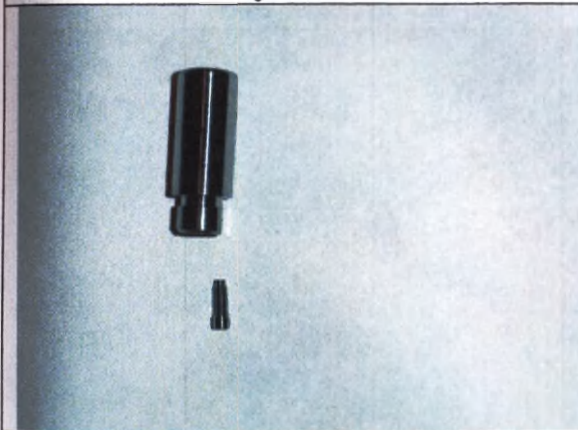


Рисунок 1.35.



Рисунок 1.36.

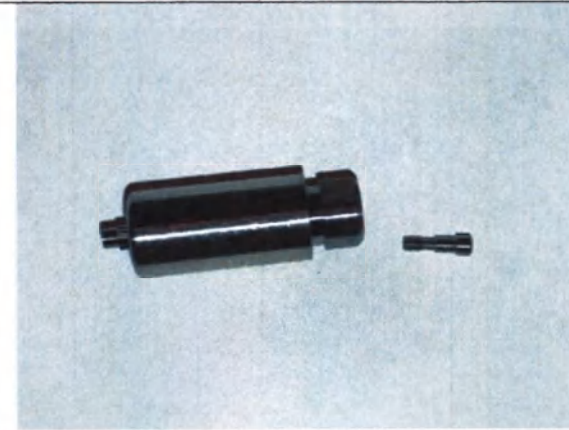

Абатменты «Премил» с комплектующими, для стоматологических имплантатов, в вариантах исполнения: «Dental Lab Parts For GeoCMFit10», «Dental Lab Parts For GeoCMFit14»

Рисунок 1.37.

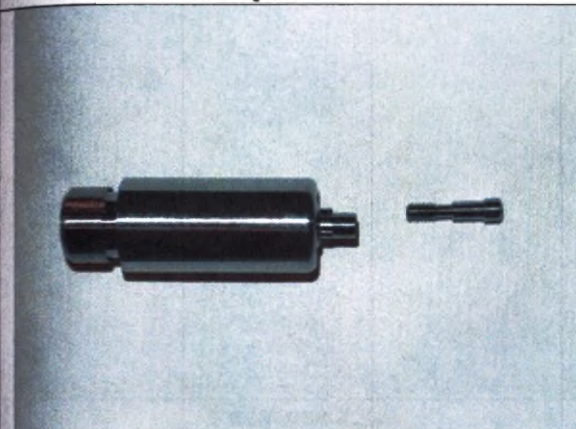


Рисунок 1.38.

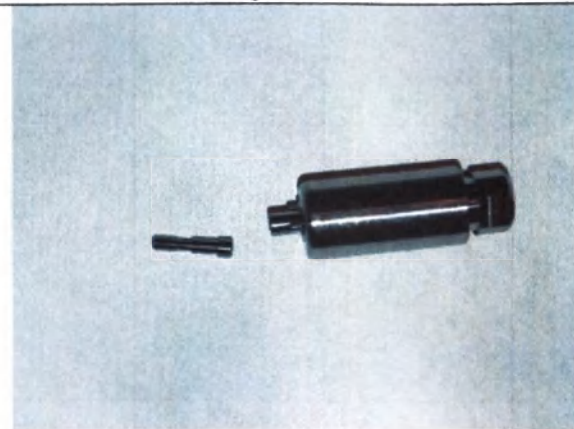


Рисунок 1.39.



Рисунок 1.40.




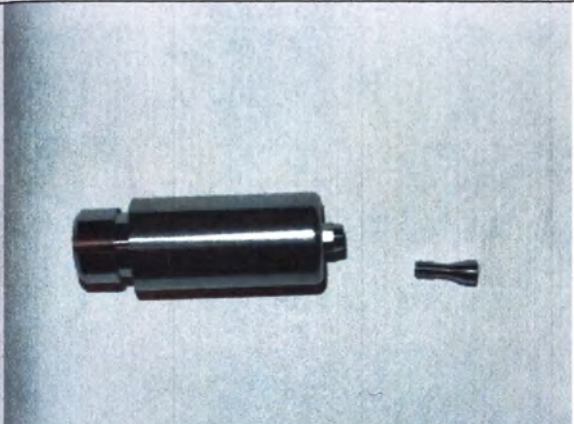
Рисунок 1.41.



Рисунок 1.42.

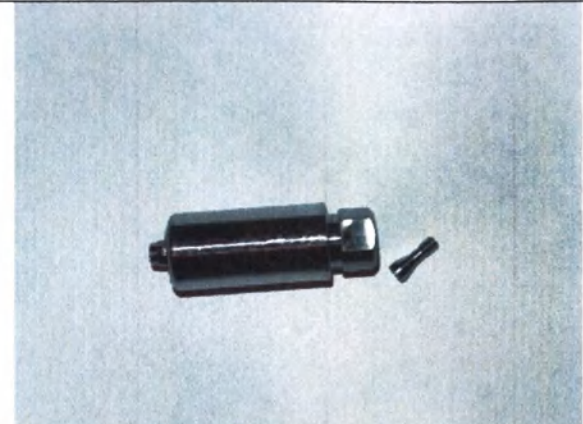

Абатменты «Премил» с комплектующими, для стоматологических имплантатов, в вариантах исполнения: «Dental Lab Parts For GeoCMFit10», «Dental Lab Parts For GeoCMFit14»

Рисунок 1.43. 	Рисунок 1.44. 	- -
Рисунок 2.1. 	Рисунок 2.2. 	Рисунок 2.3. 

Абатменты «Премил» с комплектующими, для стоматологических имплантатов, в вариантах исполнения: «Dental Lab Parts For GeoCMFit10», «Dental Lab Parts For GeoCMFit14»

Рисунок 2.4.



Рисунок 2.5.



Рисунок 2.6.



Рисунок 2.7.



Рисунок 2.8.



Рисунок 2.9.



Абатменты «Премил» с комплектующими, для стоматологических имплантатов, в вариантах исполнения: «Dental Lab Parts For GeoCMFit10», «Dental Lab Parts For GeoCMFit14»

Рисунок 2.10.

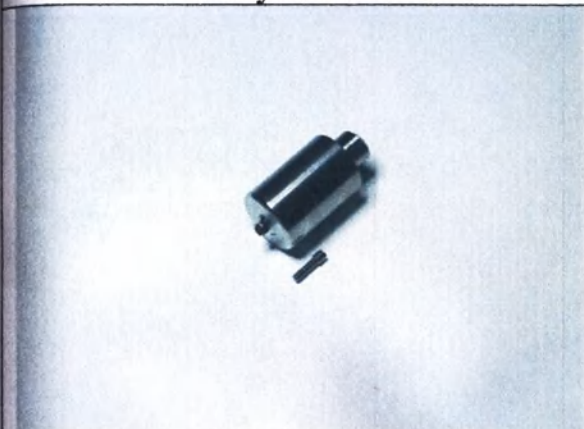


Рисунок 2.11.

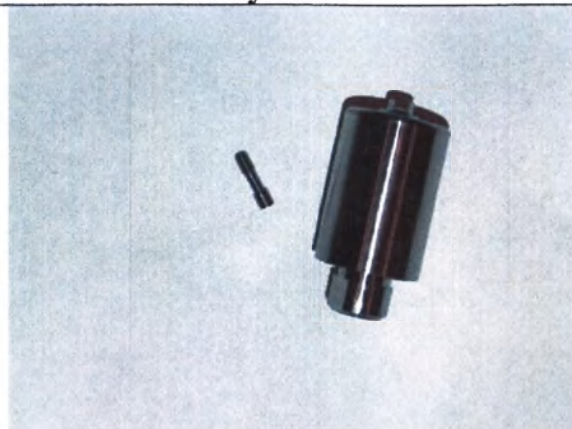


Рисунок 2.12.

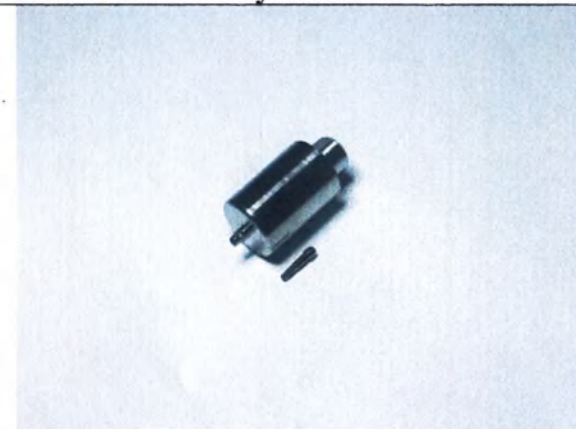


Рисунок 2.13.

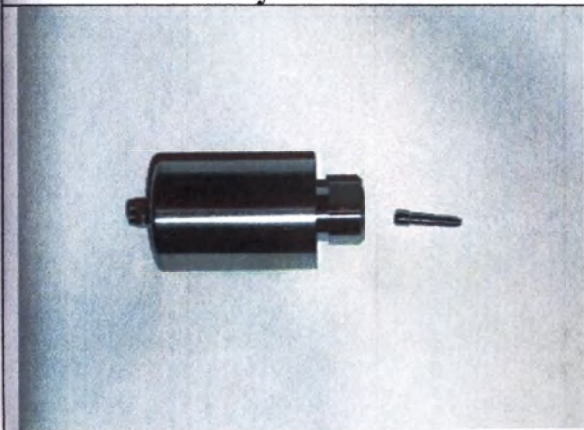


Рисунок 2.14.


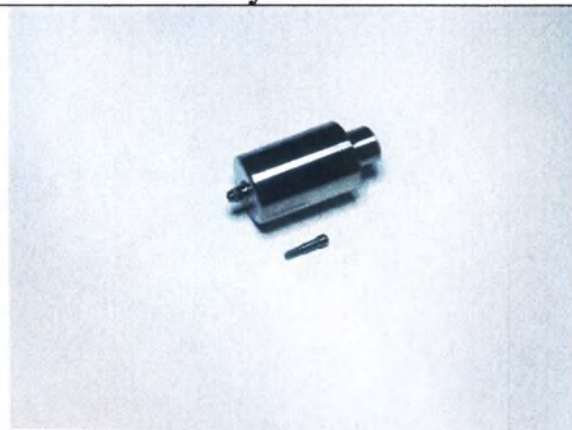


Рисунок 2.15.

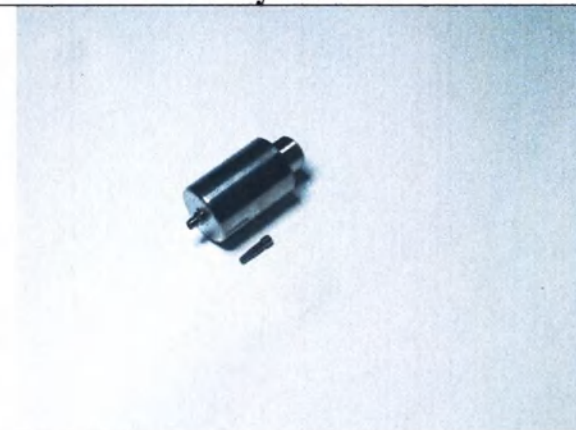

Абатменты «Премил» с комплектующими, для стоматологических имплантатов, в вариантах исполнения: «Dental Lab Parts For GeoCMFit10», «Dental Lab Parts For GeoCMFit14»

Рисунок 2.16.

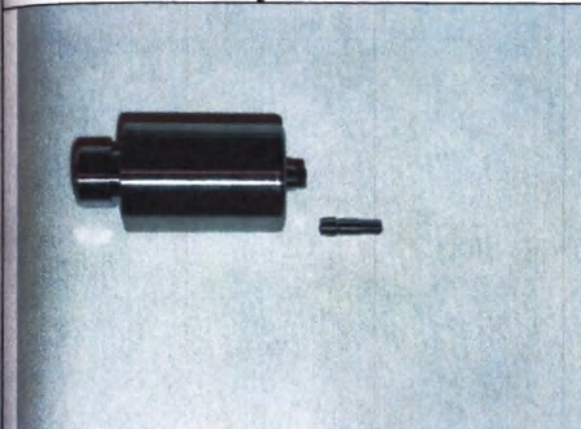


Рисунок 2.17.

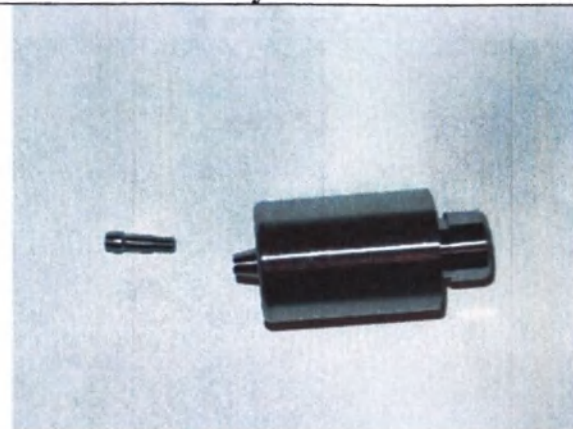


Рисунок 2.18.

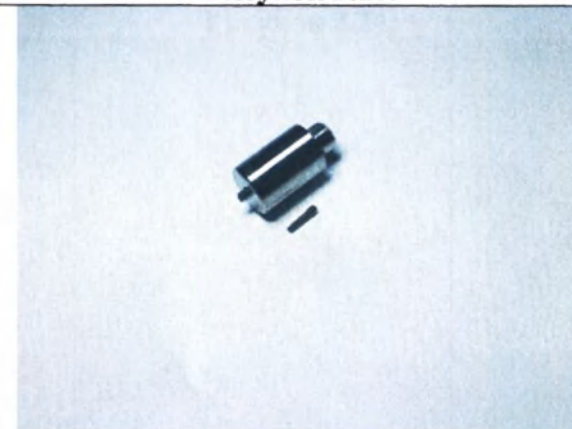


Рисунок 2.19.


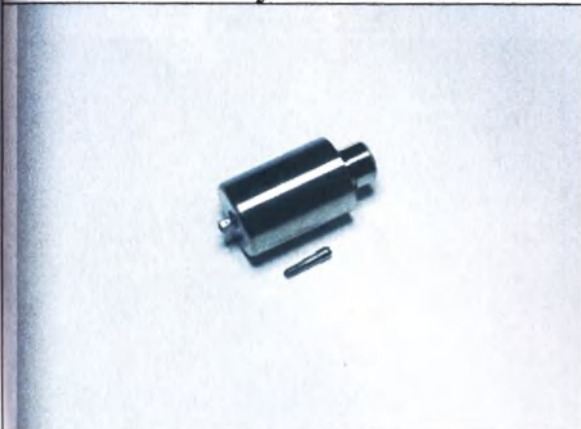


Рисунок 2.20.



Рисунок 2.21.

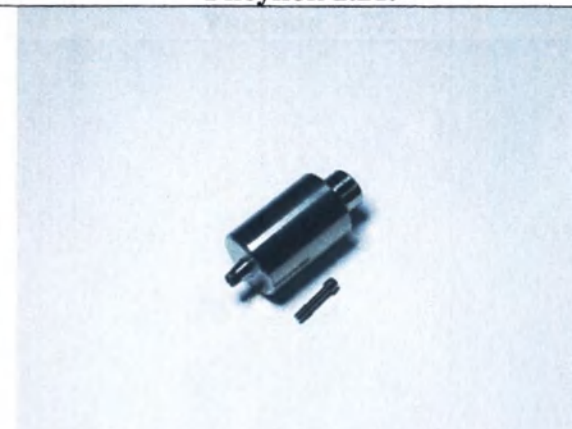

Абатменты «Премил» с комплектующими, для стоматологических имплантатов, в вариантах исполнения: «Dental Lab Parts For GeoCMFit10», «Dental Lab Parts For GeoCMFit14»

Рисунок 2.22.

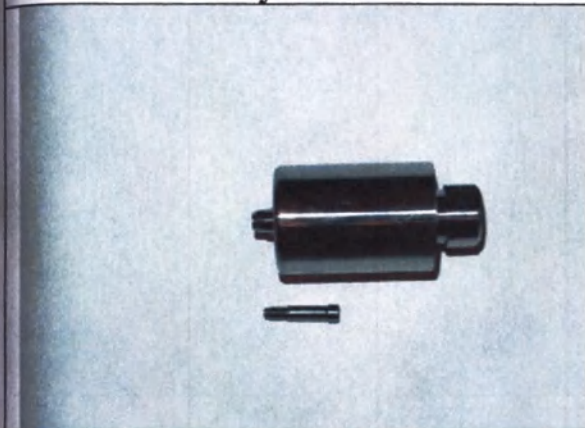


Рисунок 2.23.

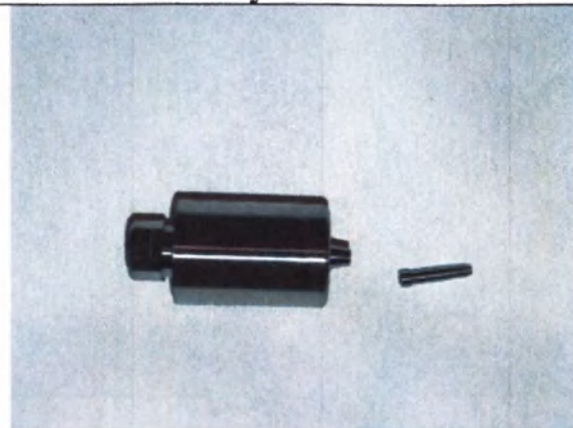


Рисунок 2.24.

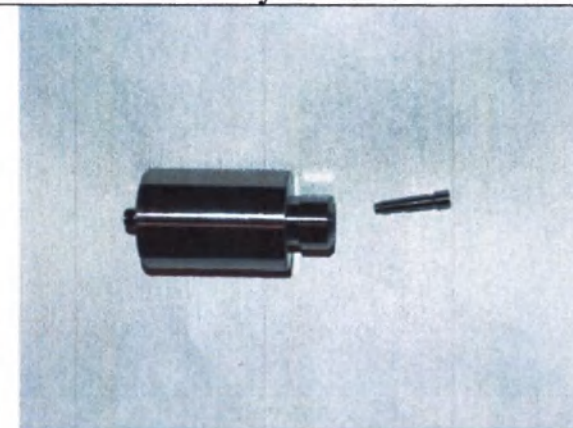


Рисунок 2.25.

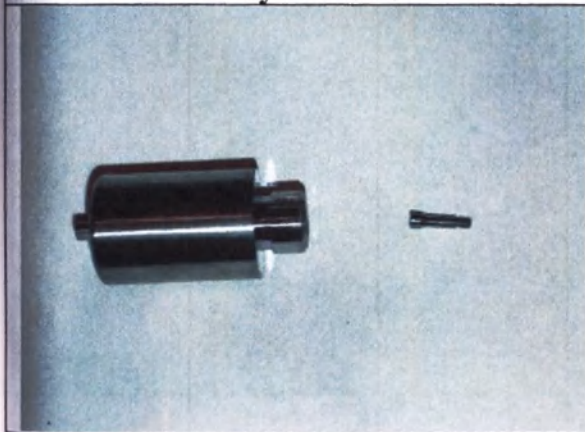


Рисунок 2.26.


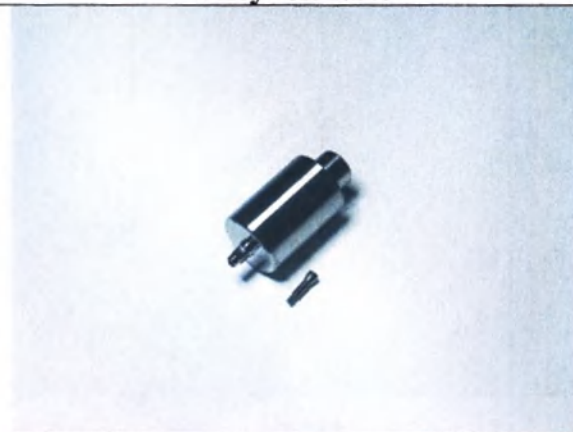


Рисунок 2.27.

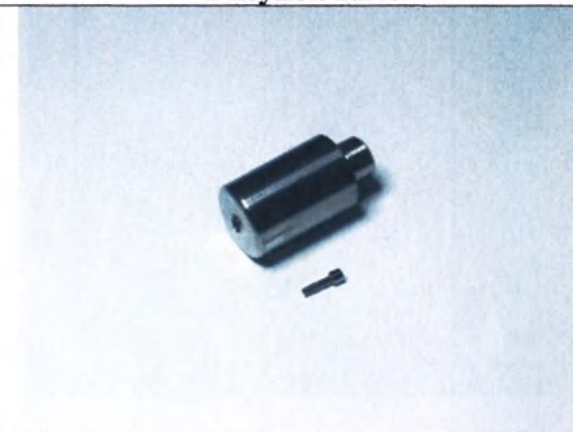

Абатменты «Премил» с комплектующими, для стоматологических имплантатов, в вариантах исполнения: «Dental Lab Parts For GeoCMFit10», «Dental Lab Parts For GeoCMFit14»

Рисунок 2.28.



Рисунок 2.29.



Рисунок 2.30.



Рисунок 2.31.





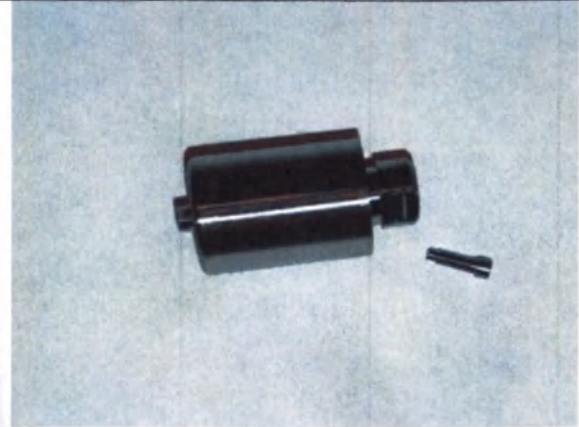
Рисунок 2.32.



Рисунок 2.33.

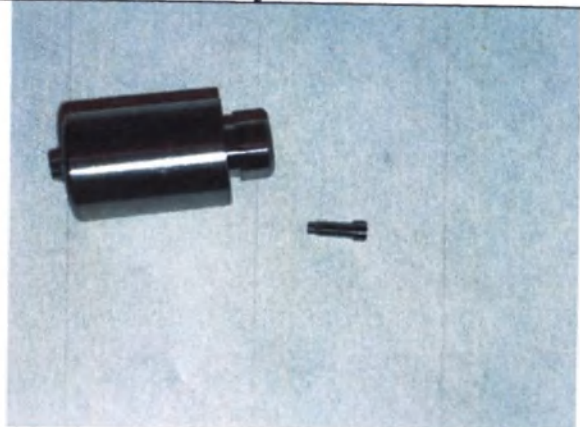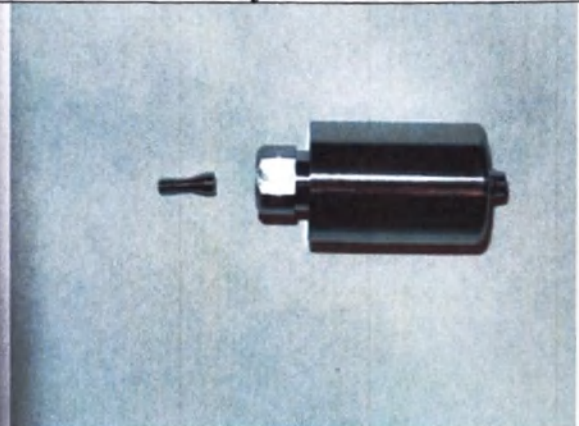

Абатменты «Премил» с комплектующими, для стоматологических имплантатов, в вариантах исполнения: «Dental Lab Parts For GeoCMFit10», «Dental Lab Parts For GeoCMFit14»

Рисунок 2.34.	Рисунок 2.35.	Рисунок 2.36.
		
Рисунок 2.37.	Рисунок 2.38.	-
		-

Абатменты «Премил» с комплектующими, для стоматологических имплантатов, в вариантах исполнения: «Dental Lab Parts For GeoCMFit10», «Dental Lab Parts For GeoCMFit14»

Рисунок 3.1.

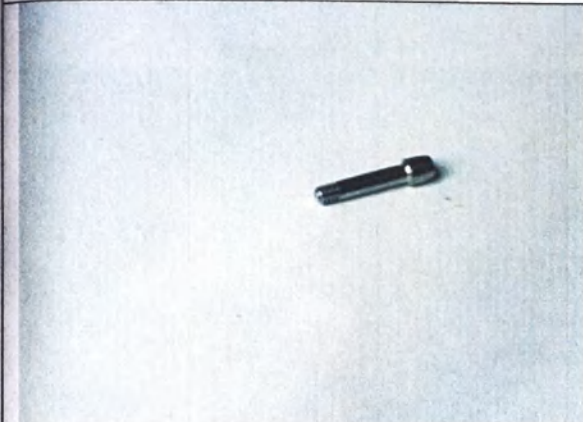


Рисунок 3.2.



Рисунок 3.3.

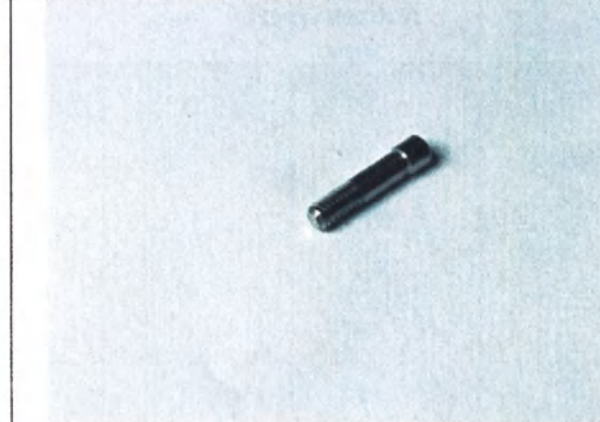


Рисунок 3.4.



Рисунок 3.5.





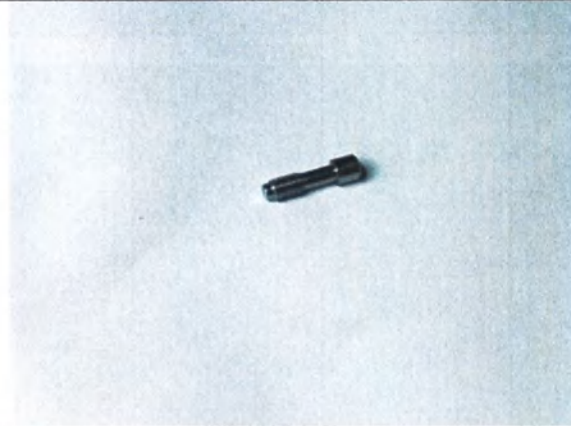


Рисунок 3.6.

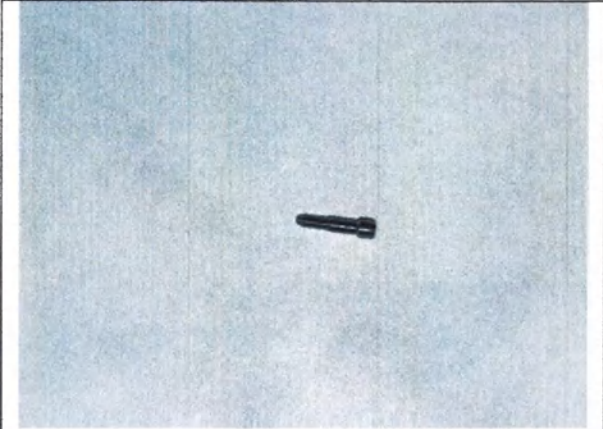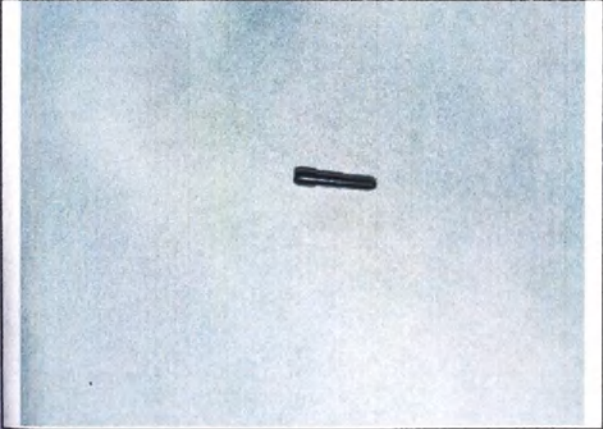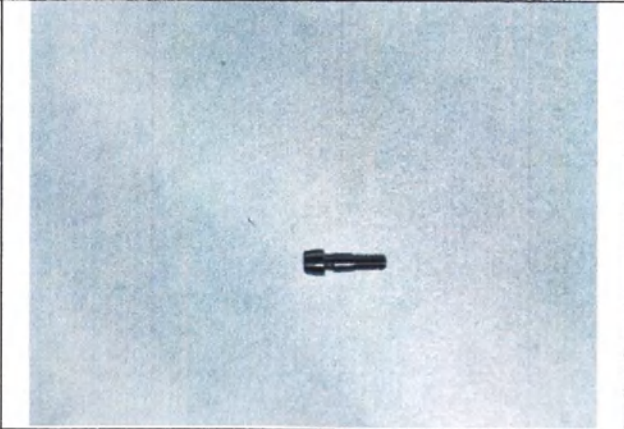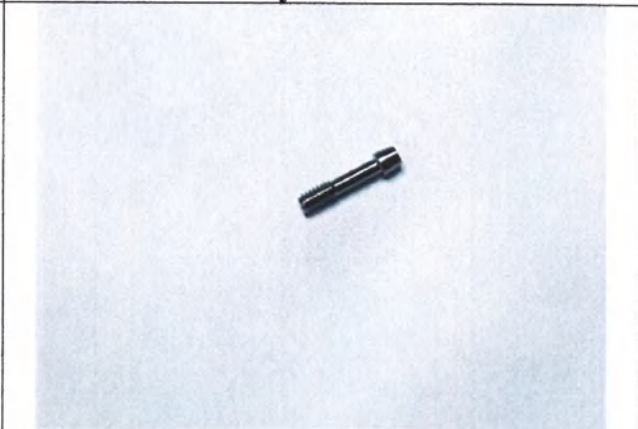

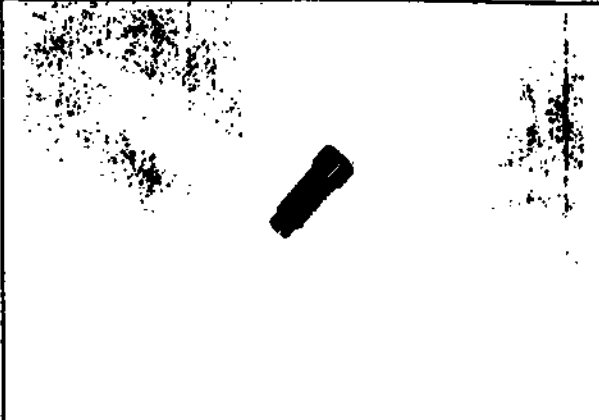


Абатменты «Премил» с комплектующими, для стоматологических имплантатов, в вариантах исполнения: «Dental Lab Parts For GeoCMFit10», «Dental Lab Parts For GeoCMFit14»

Рисунок 3.7.	Рисунок 3.8.	Рисунок 3.9.
		
Рисунок 3.10.	Рисунок 3.11.	Рисунок 3.12.
		

Абатменты «Премил» с комплектующими, для стоматологических имплантатов, в вариантах исполнения: «Dental Lab Parts For GeoCMFit10», «Dental Lab Parts For GeoCMFit14»

Рисунок 3.13.	Рисунок 3.14.	Рисунок 3.15.
		
Рисунок 3.16.	Рисунок 3.17.	Рисунок 3.18.
		

Абатменты «Премил» с комплектующими, для стоматологических имплантатов, в вариантах исполнения: «Dental Lab Parts For GeoCMFit10», «Dental Lab Parts For GeoCMFit14»

Рисунок 3.19.	Рисунок 3.20.	Рисунок 3.21.
		
Рисунок 3.22.	-	-
		

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

23 двадцать три листов
цифрами прописью

Должность ген. директор

Подпись _____

« 22 » декабря 2021 г. МП

