

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Теоксан Рус»



Новосельцев В.В.
2021 г.

Фотографические изображения медицинского изделия
Имплантат вязко-эластичный внутрикожный TEOSYAL® в комплекте

Производство Teoxane S.A. (Теоксан С.А.)



**Общий вид потребительской упаковки на примере (ракурс 1): Имплантат TEOSYAL®
ULTIMATE в формате выпуска 3 мл**

TEOSYAL®

**Имплантат вязкоэластичный внутрикожный
TEOSYAL® Ultimate, полный набор**

Перед использованием ознакомьтесь с инструкцией.
Условия хранения: при температуре от 2°C до +25°C. Не
нагревать, избегать высокой влажности и прямых
солнечных лучей.

Стерильно. Изделие стерилизовано паром.

Произведено в Швейцарии:

"TEOXANE" S.A., Les Charmilles Rue de Lyon, 105, Geneva, CH-
1203, Switzerland.

"Теоксан С.А."; Швейцария.

Уполномоченный представитель производителя на
территории РФ:

ООО «Теоксан Рус», Российская Федерация, 115201, г.
Москва, ул. Котляковская, д. 3, строение 1, помещение
ХХа.

Тел.: 8 800 600 14 94

medical-russia@teoxane.com

Регистрационное удостоверение на медицинское
изделие №ФСЗ 2010/06527 от 25.05.2015

Номер лота и срок годности указаны на стикере
производителя

RU СОСТАВ

Гиалуроновая кислота 22 мг/мл

Фосфатный Буфер pH 7.3

достаточное количество для 3 мл

См. инструкцию по применению
препарата.



TEOXANE

THE EXCELLENCE OF SWISS SCIENCE



TEOXANE SA
Les Charmilles - Rue de Lyon, 105
CH 1203 Geneva - SWITZERLAND

SINGLE
3ml


**Общий вид потребительской упаковки на примере (ракурс 2): Имплантат TEOSYAL®
ULTIMATE в формате выпуска 3 мл**



Маркировка потребительской упаковки (на примере 1-го образца): Имплантат TEOSYAL® ULTIMATE в формате выпуска 3 мл



Комплектность и маркировка стикеров (на примере 1-го образца): Имплантат TEOSYAL® ULTIMATE в формате выпуска 3 мл

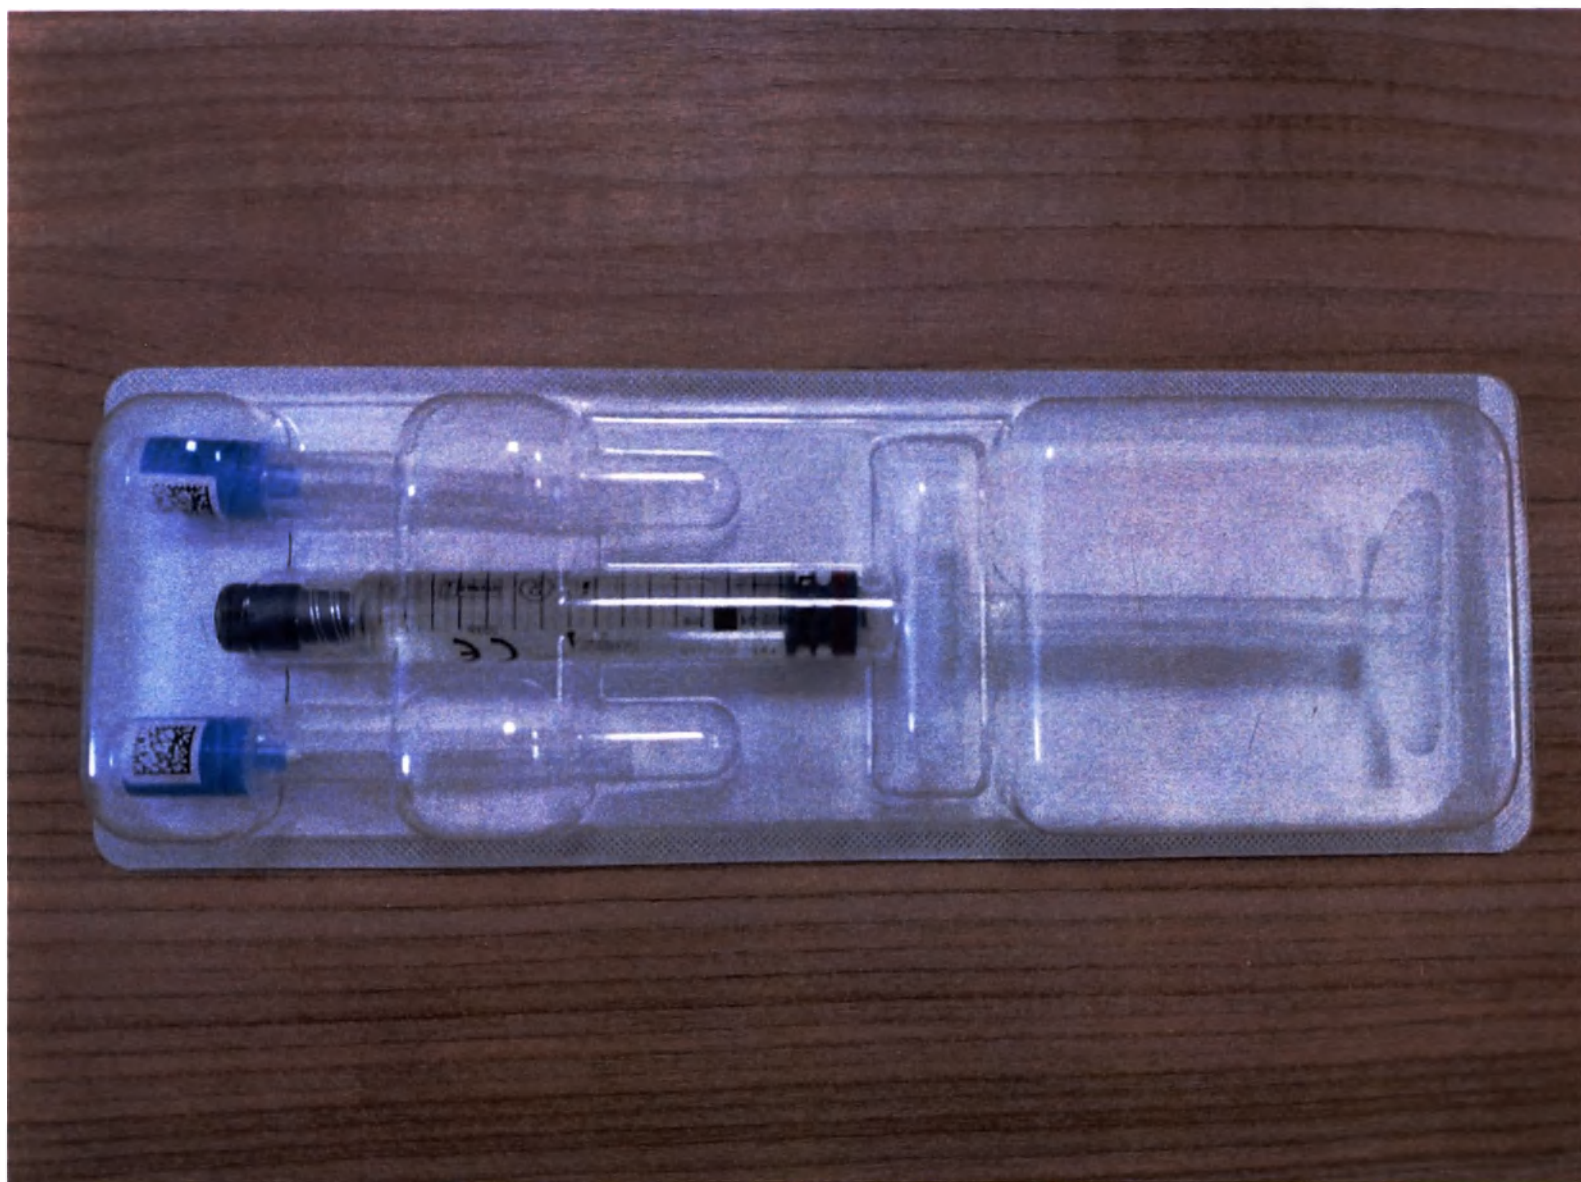

Общий вид первичной стерильной упаковки (на примере 1-го образца): Имплантат *TEOSYAL® ULTIMATE* в формате выпуска 3 мл



**Маркировка шприца на примере 1-го образца (ракурс 1): Имплантат TEOSYAL®
ULTIMATE в формате выпуска 3 мл**



**Маркировка шприца на примере 1-го образца (ракурс 2): Имплантат TEOSYAL®
ULTIMATE в формате выпуска 3 мл**




Маркировка иглы на примере 1-го образца (ракурс 1): Имплантат *TEOSYAL® ULTIMATE* в формате выпуска 3 мл



Маркировка иглы на примере 1-го образца (ракурс 2): Имплантат *TEOSYAL® ULTIMATE* в формате выпуска 3 мл



Маркировка иглы на примере 1-го образца (ракурс 3): Имплантат TEOSYAL® ULTIMATE в формате выпуска 3 мл

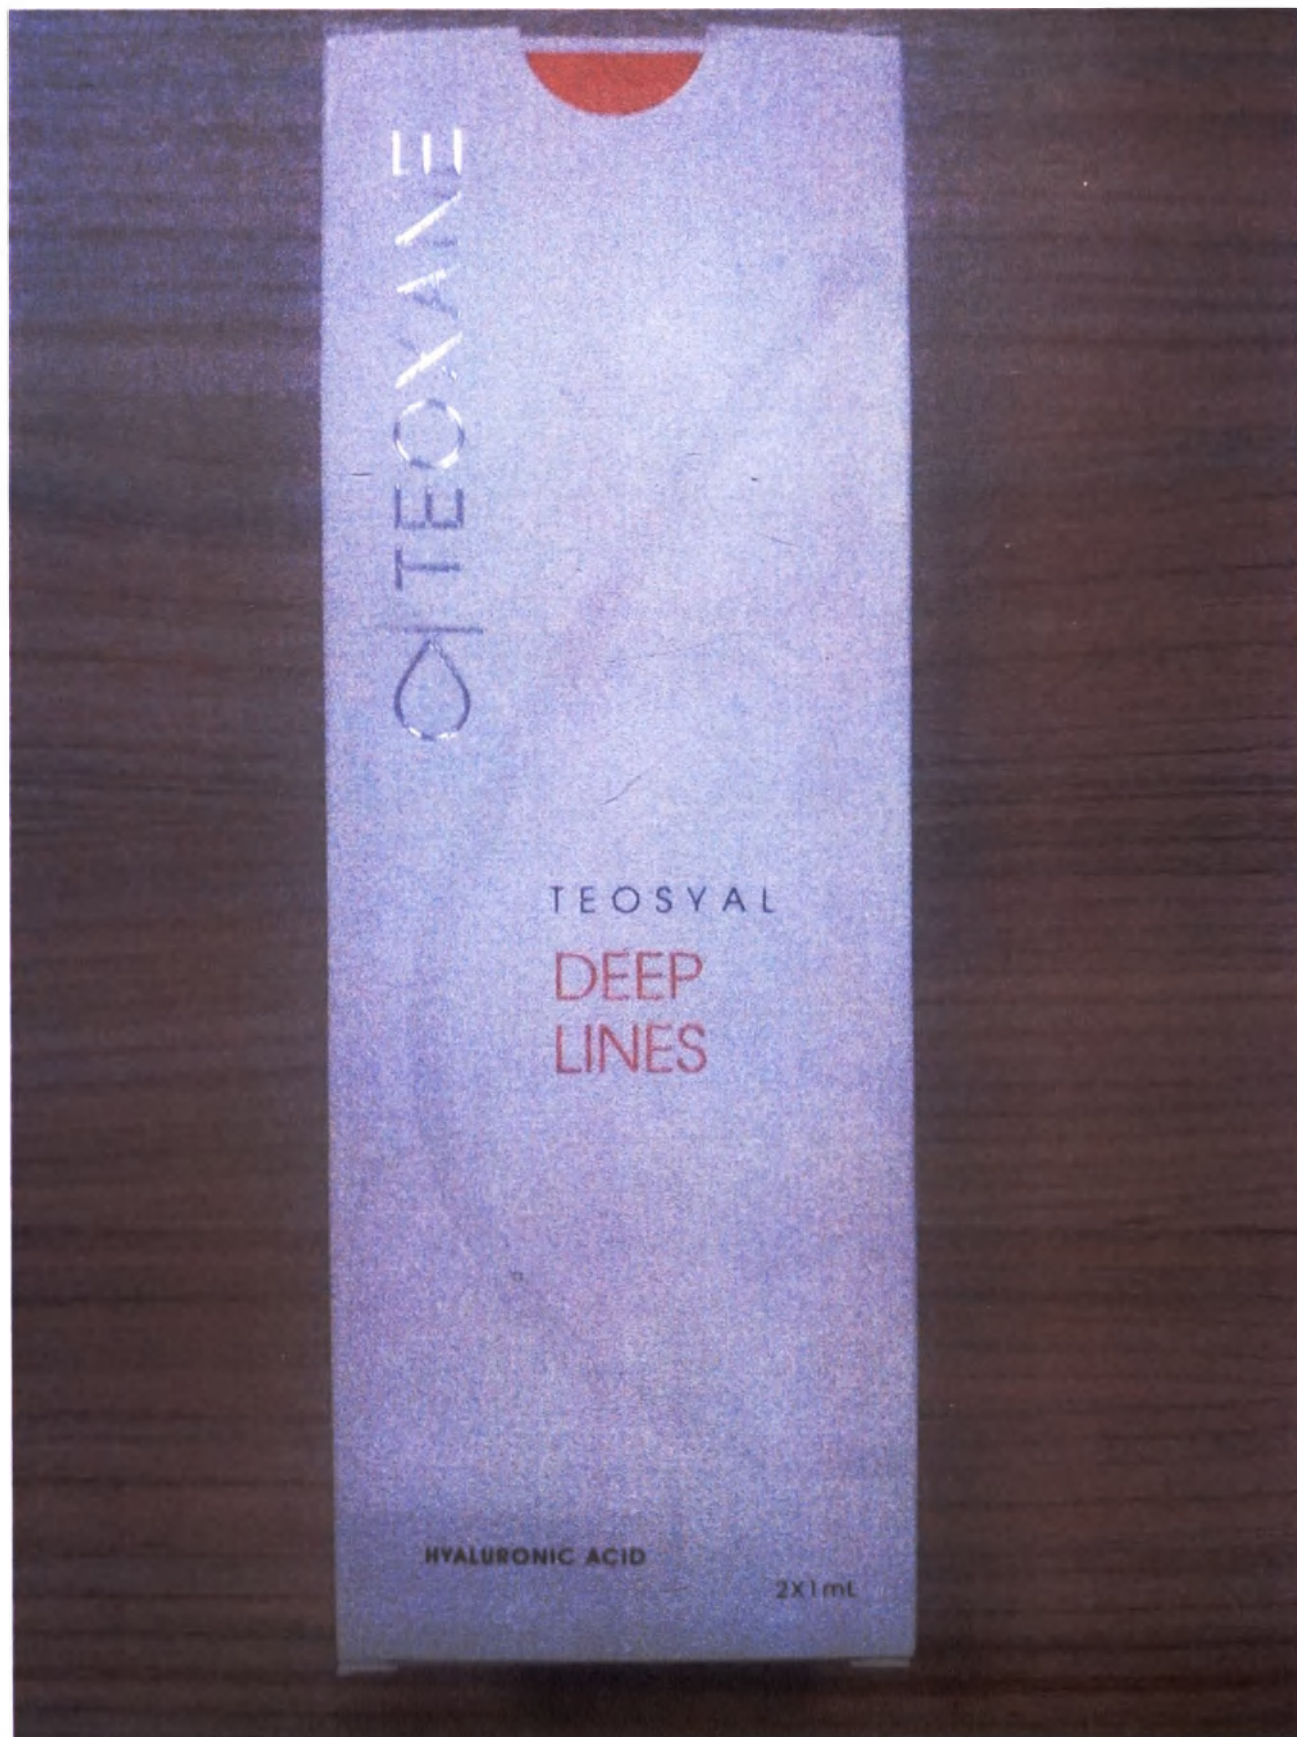

Общий вид потребительской и первичной упаковки на примере 1-го образца (ракурс 1):
Имплантат TEOSYAL® 27G DEEP LINES

TEOSYAL® 27G DEEP LINES

HYALURONIC ACID

FR COMPOSITION

Acide hyaluronique 25 mg/ml
Tampon phosphate
pH 7.3 q.s. ad 1 ml.
Usage intradermique uniquement.
Voir notice d'utilisation.

EN COMPOSITION

Hyaluronic acid 25 mg/ml
Phosphate buffer
pH 7.3 q.s. ad 1 ml.
Intradermal use only.
Refer to instruction for use.

DE INHALT

Hyaluronsäure 25 mg/ml
Phosphatpuffer pH 7.3 q.s. 1 ml.
Nur zur intradermalen Anwendung.
Siehe Gebrauchsanweisung.
Deutsch.

PT COMPOSIÇÃO

Ácido hialurônico 25 mg/ml
Tampon fosfato pH 7.3 q.s. 1 ml.
Unicamente para utilização
intradérmica.
Ver folheto de utilização.

ES COMPOSICIÓN

Ácido hialurónico 25 mg/ml
Tampon fosfato
pH 7.3 q.s. 1 ml.
Solo para uso intradérmico.
Ver las instrucciones de uso.

IT COMPOSIZIONE

Acido ialuronico 25 mg/ml
Tampona fosfato
pH 7.3 q.s. ad 1 ml.
Solo per uso intradermico.
Vedere le istruzioni per l'uso.

TR BİLEŞİM

Hyaluronik asit 25 mg/ml
Fosfat tampon pH 7.3 q.s. 1 ml.
Sadece deri içinde kullanılır.
Kullanma talimatını okuyunuz.

RU СОСТАВ

Гиалуроновая кислота 25 мг/мл
Буферный раствор pH 7.3
достаточно количества для 1 см.
только для внутримышечного
использования.
См. инструкцию по применению
препарата.

CE
0066
syringe

CE
0123
needle

23°C
2°C



TEOXANE
THE EXCELLENCE OF SMILE ARTISTRY





TEOXANE SA
un-Chon-Rol - Route de Joux 105
CH-1203 Geneva - 0462280492

2x 1ml

Общий вид потребительской и первичной упаковки на примере 1-го образца (ракурс 2):
Имплантат TEOSYAL® 27G DEEP LINES



Маркировка потребительской упаковки на примере 1-го образца: Имплантат TEOSYAL® 27G DEEP LINES

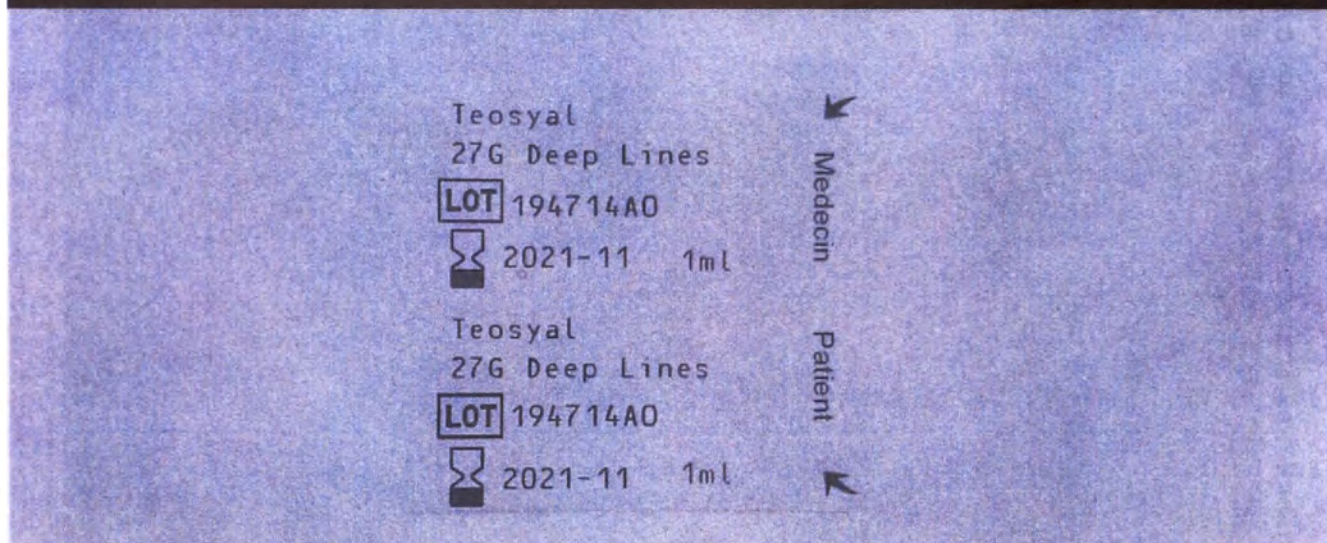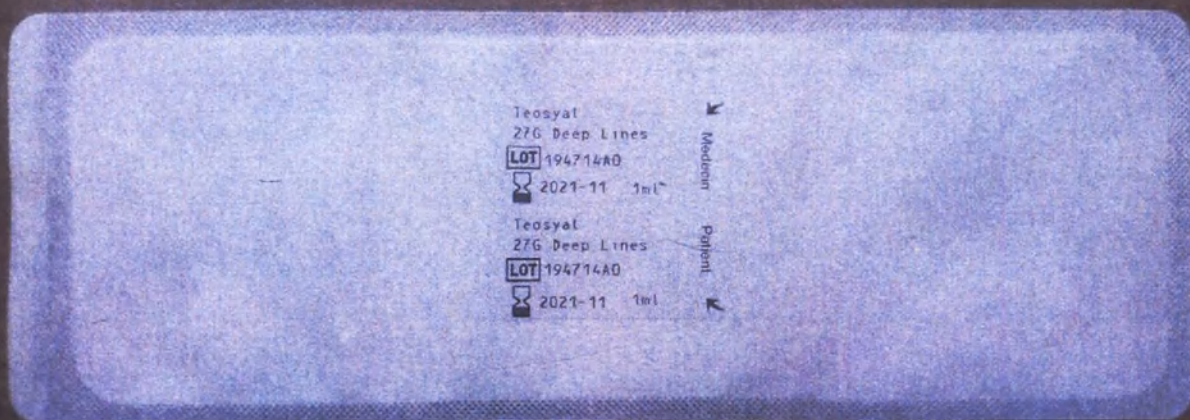

Общий вид и маркировка первичной упаковки на примере 1-го образца: Имплантат
TEOSYAL® 27G DEEP LINES




Общий вид первичной упаковки на примере 1-го образца: Имплантат *TEOSYAL® 27G DEEP LINES*



Маркировка шприца (ракурс 1): Имплантат *TEOSYAL® 27G DEEP LINES*



Маркировка шприца (ракурс 2): Имплантат *TEOSYAL® 27G DEEP LINES*

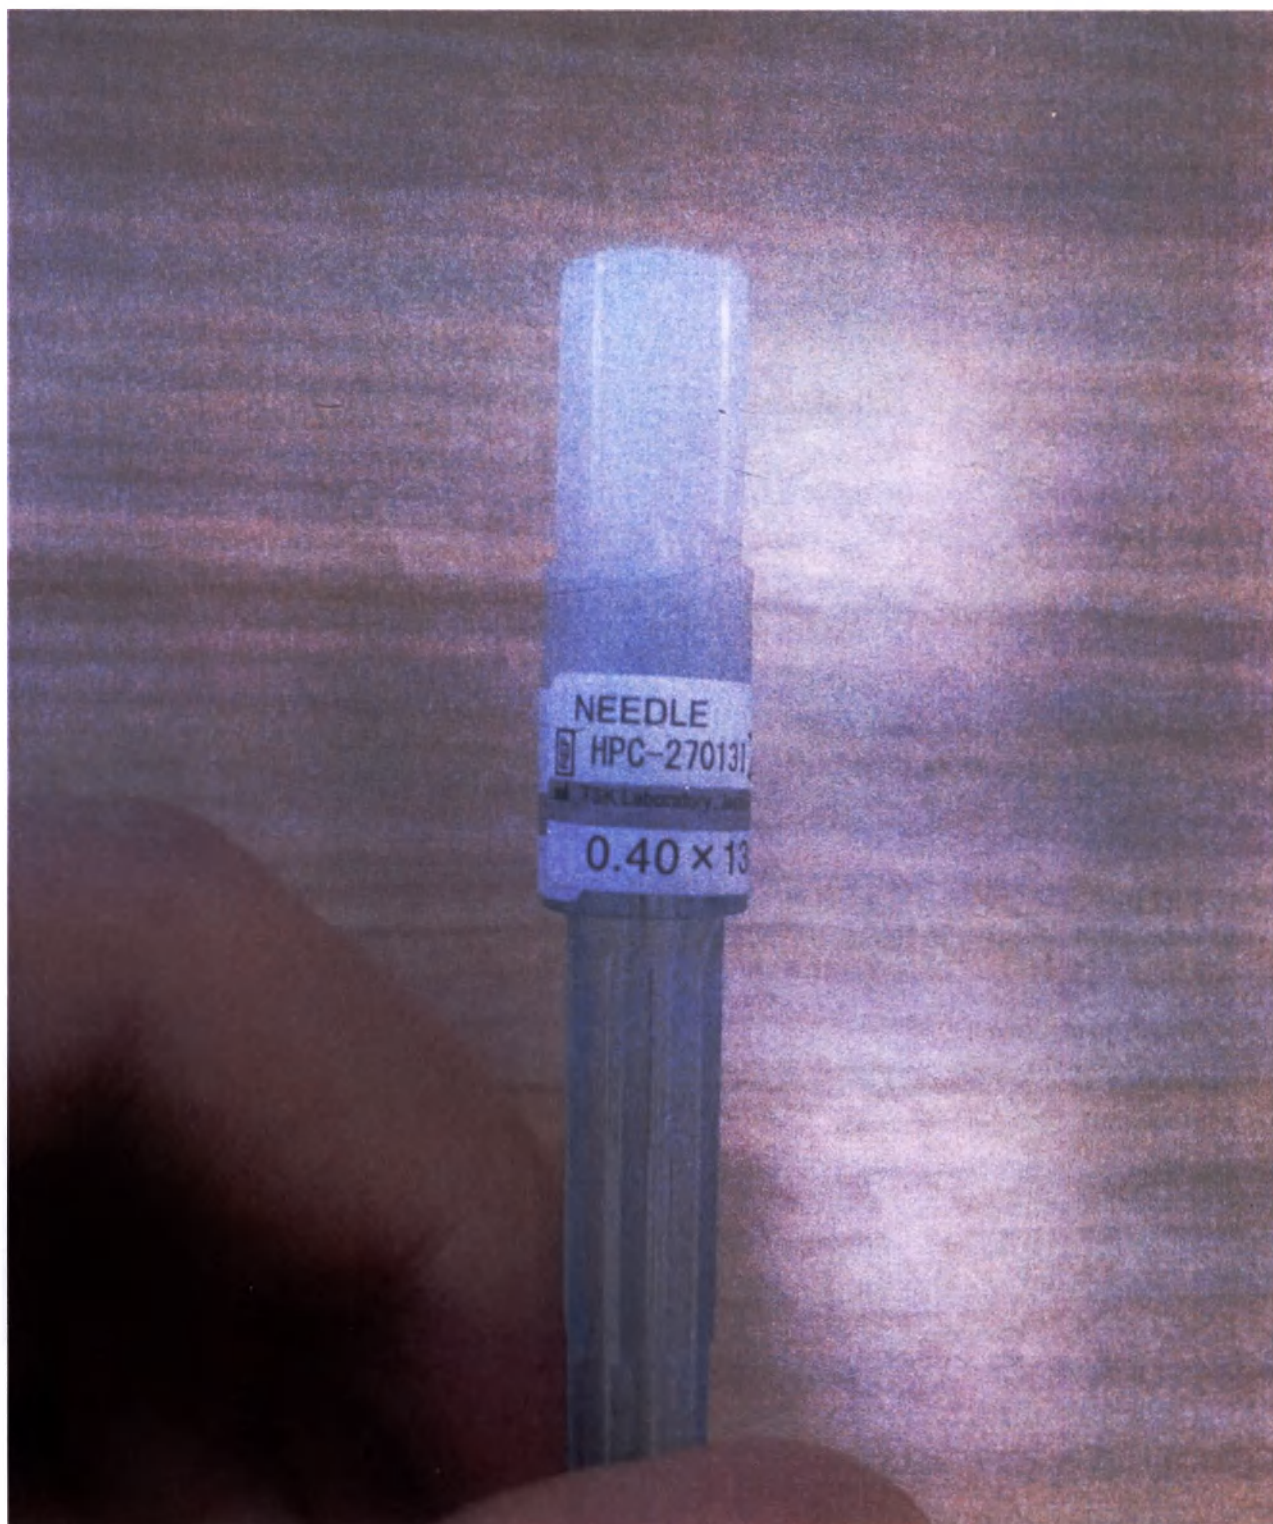

Маркировка игл (ракурс 1): Имплантат TEOSYAL® 27G DEEP LINES



Маркировка игл (ракурс 2): Имплантат TEOSYAL® 27G DEEP LINES




Маркировка игл (ракурс 3): Имплантат TEOSYAL® 27G DEEP LINES



Общий вид потребительской и первичной упаковки на примере 1-ого образца:
Имплантат TEOSYAL® 30G GLOBAL ACTION



Маркировка потребительской упаковки: Имплантат TEOSYAL® 30G GLOBAL ACTION

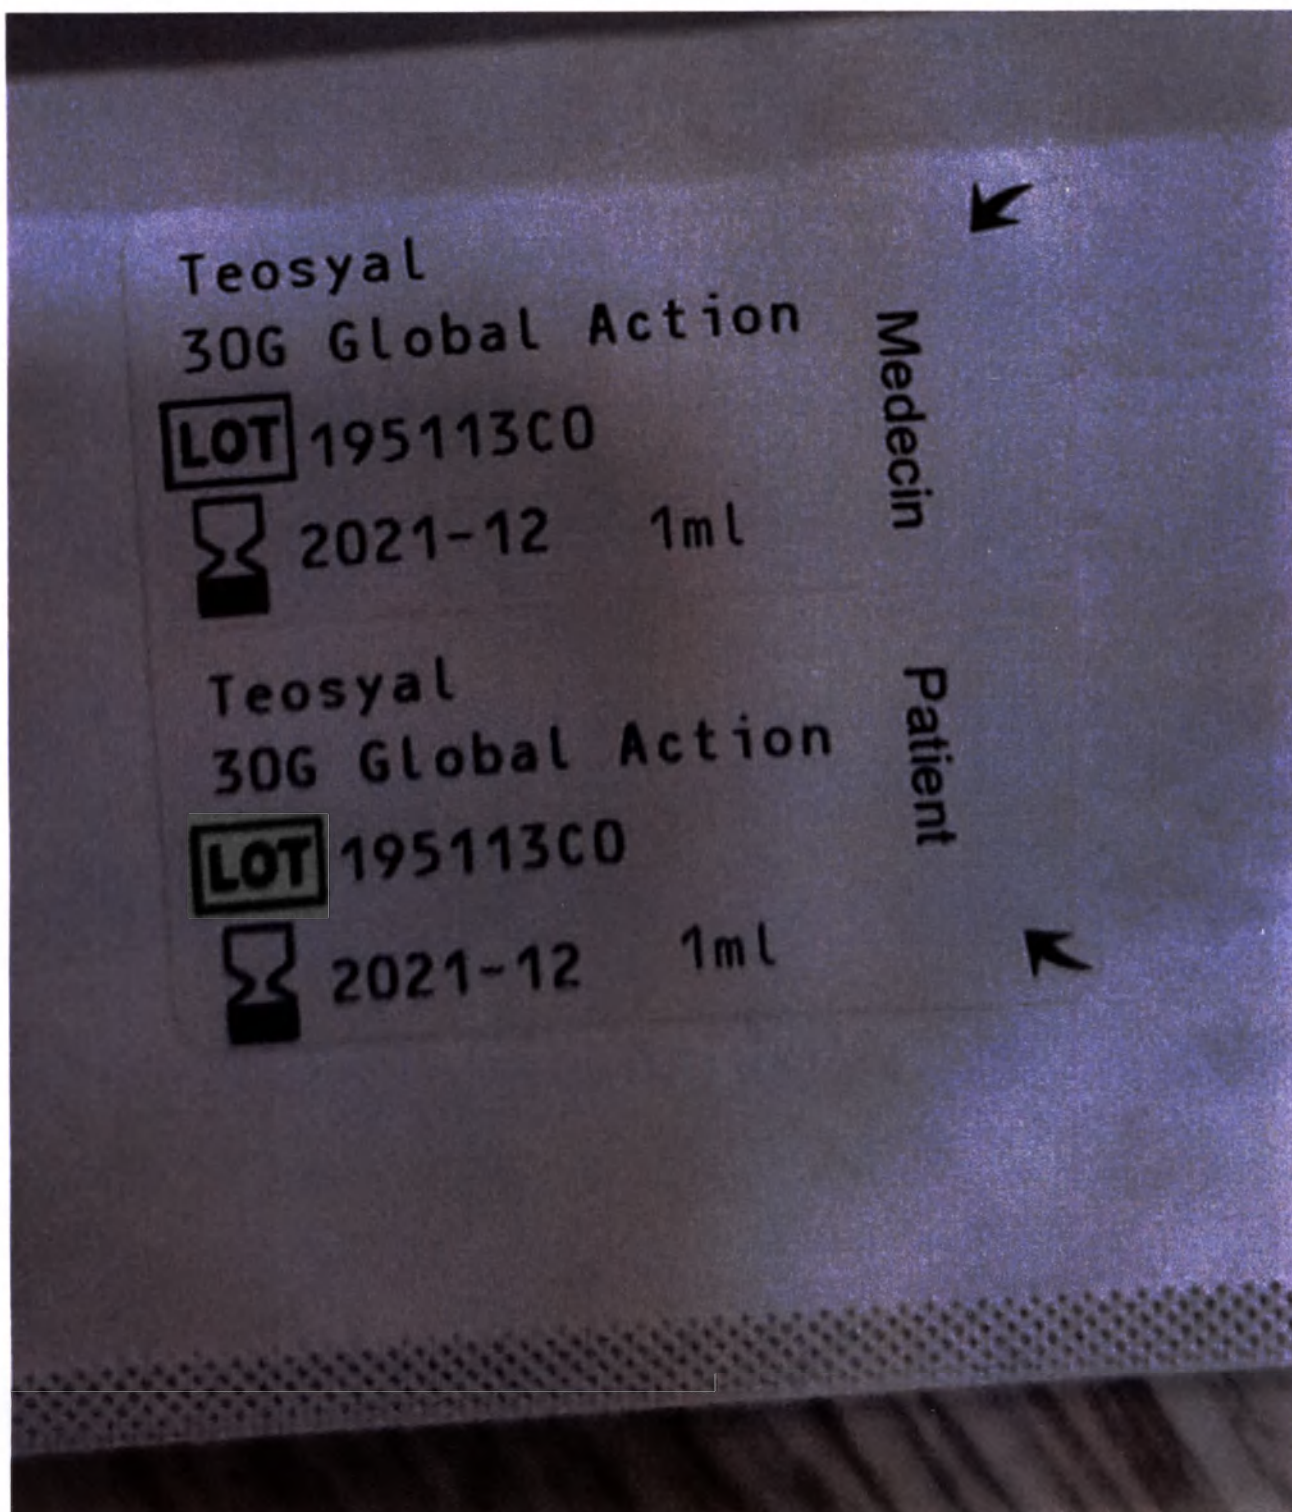

Маркировка стикеров: Имплантат TEOSYAL® 30G GLOBAL ACTION




Общий вид потребительской упаковки на примере 1-го образца (ракурс 1): Имплантат
TEOSYAL® ULTRA DEEP



Общий вид потребительской упаковки на примере 1-го образца (ракурс 2): Имплантат **TEOSYAL® ULTRA DEEP**




Маркировка потребительской упаковки на примере 1-го образца: Имплантат
TEOSYAL® ULTRA DEEP

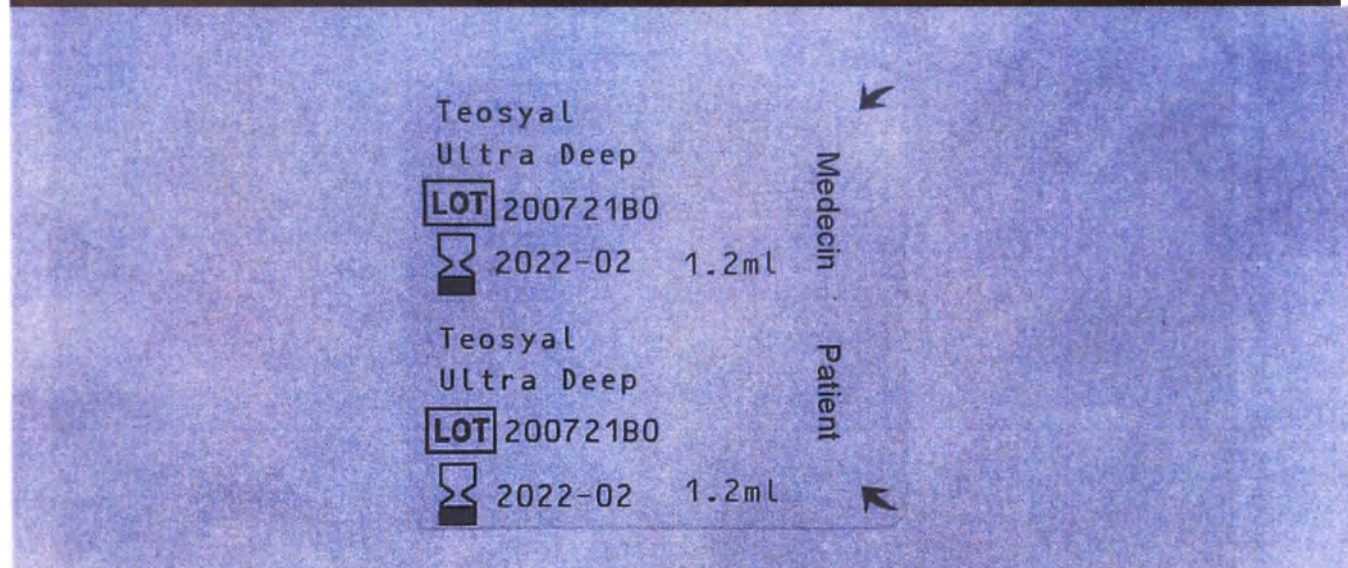


**Комплектность и маркировка стикеров на примере 1-го образца: Имплантат
TEOSYAL® ULTRA DEEP**




Общий вид первичной стерильной упаковки на примере 1-го образца: Имплантат *TEOSYAL® ULTRA DEEP*

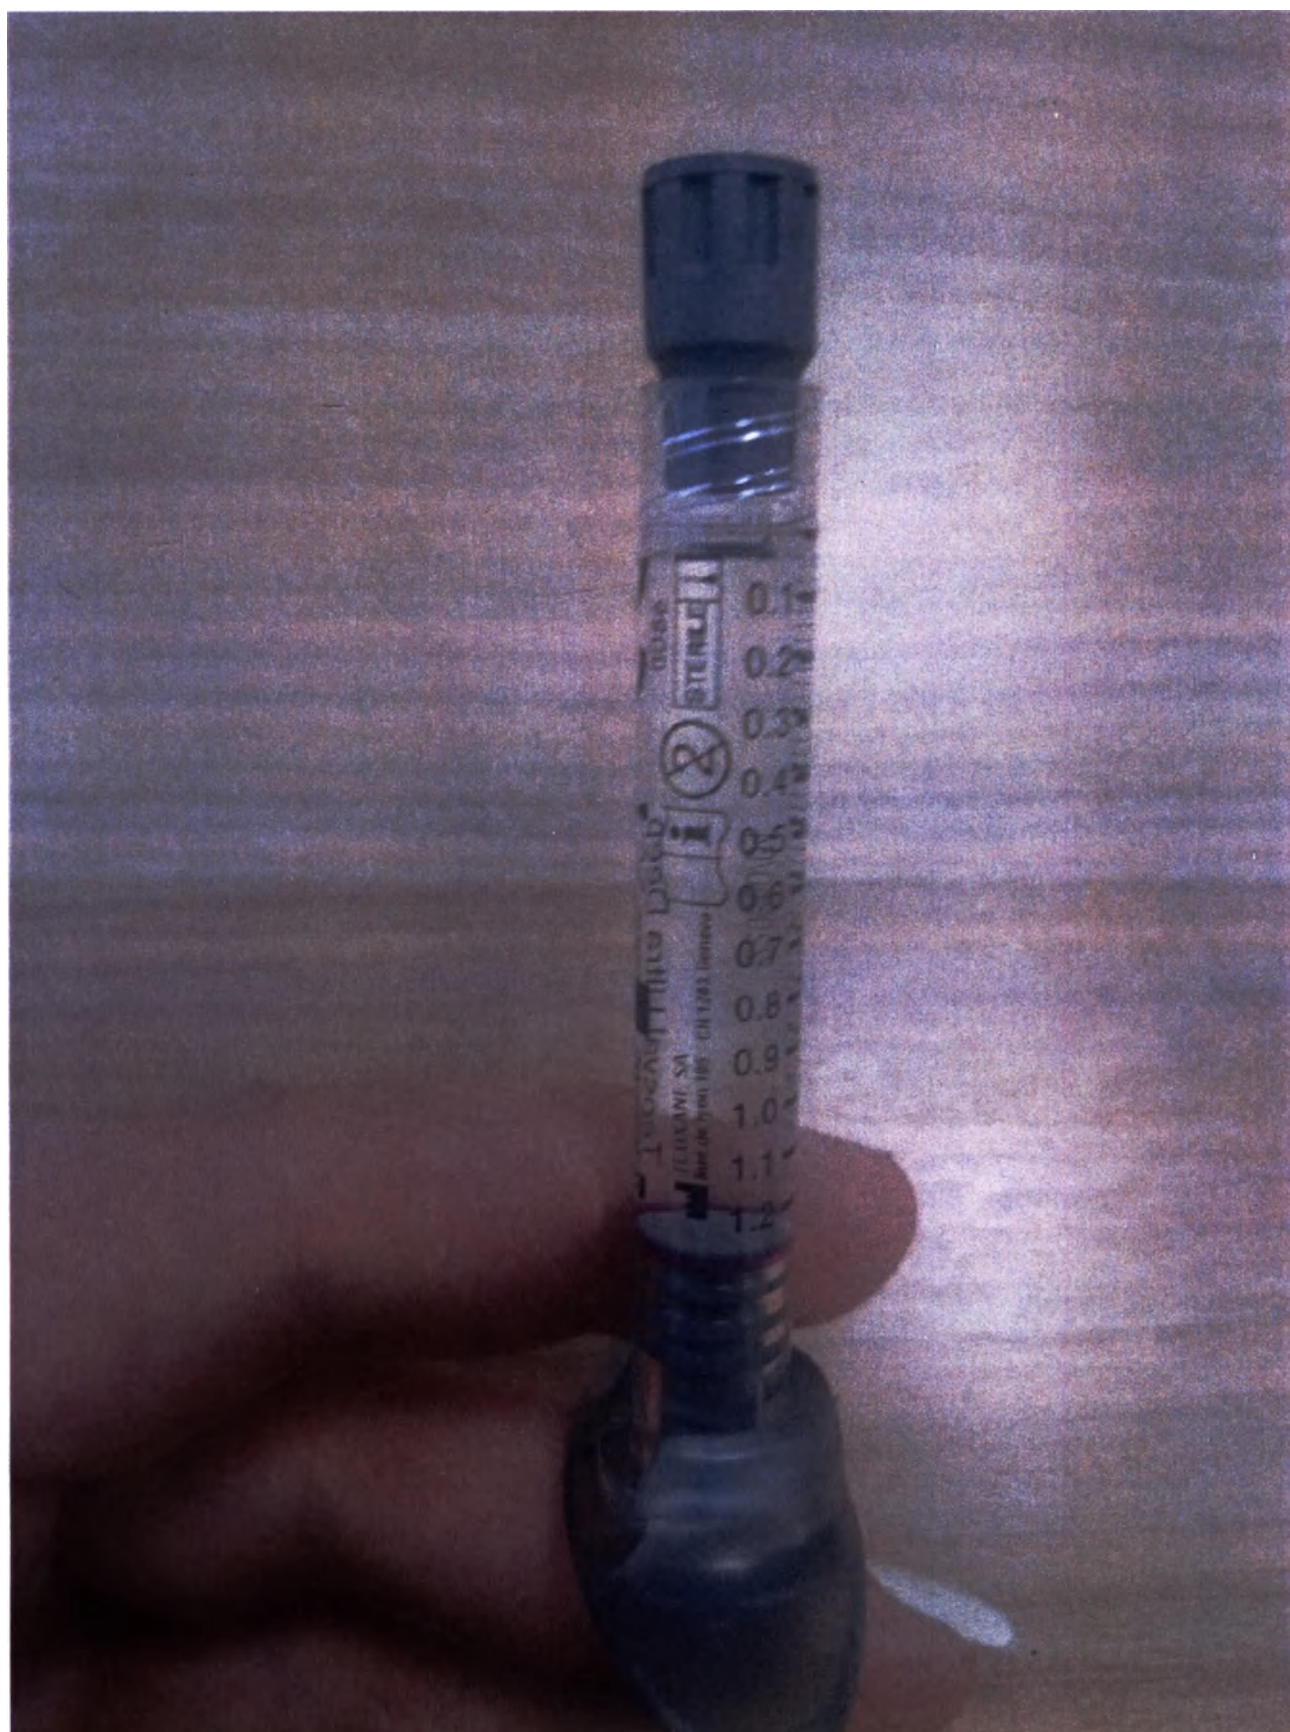

Маркировка шприца на примере 1-го образца (ракурс 1): Имплантат *TEOSYAL® ULTRA DEEP*

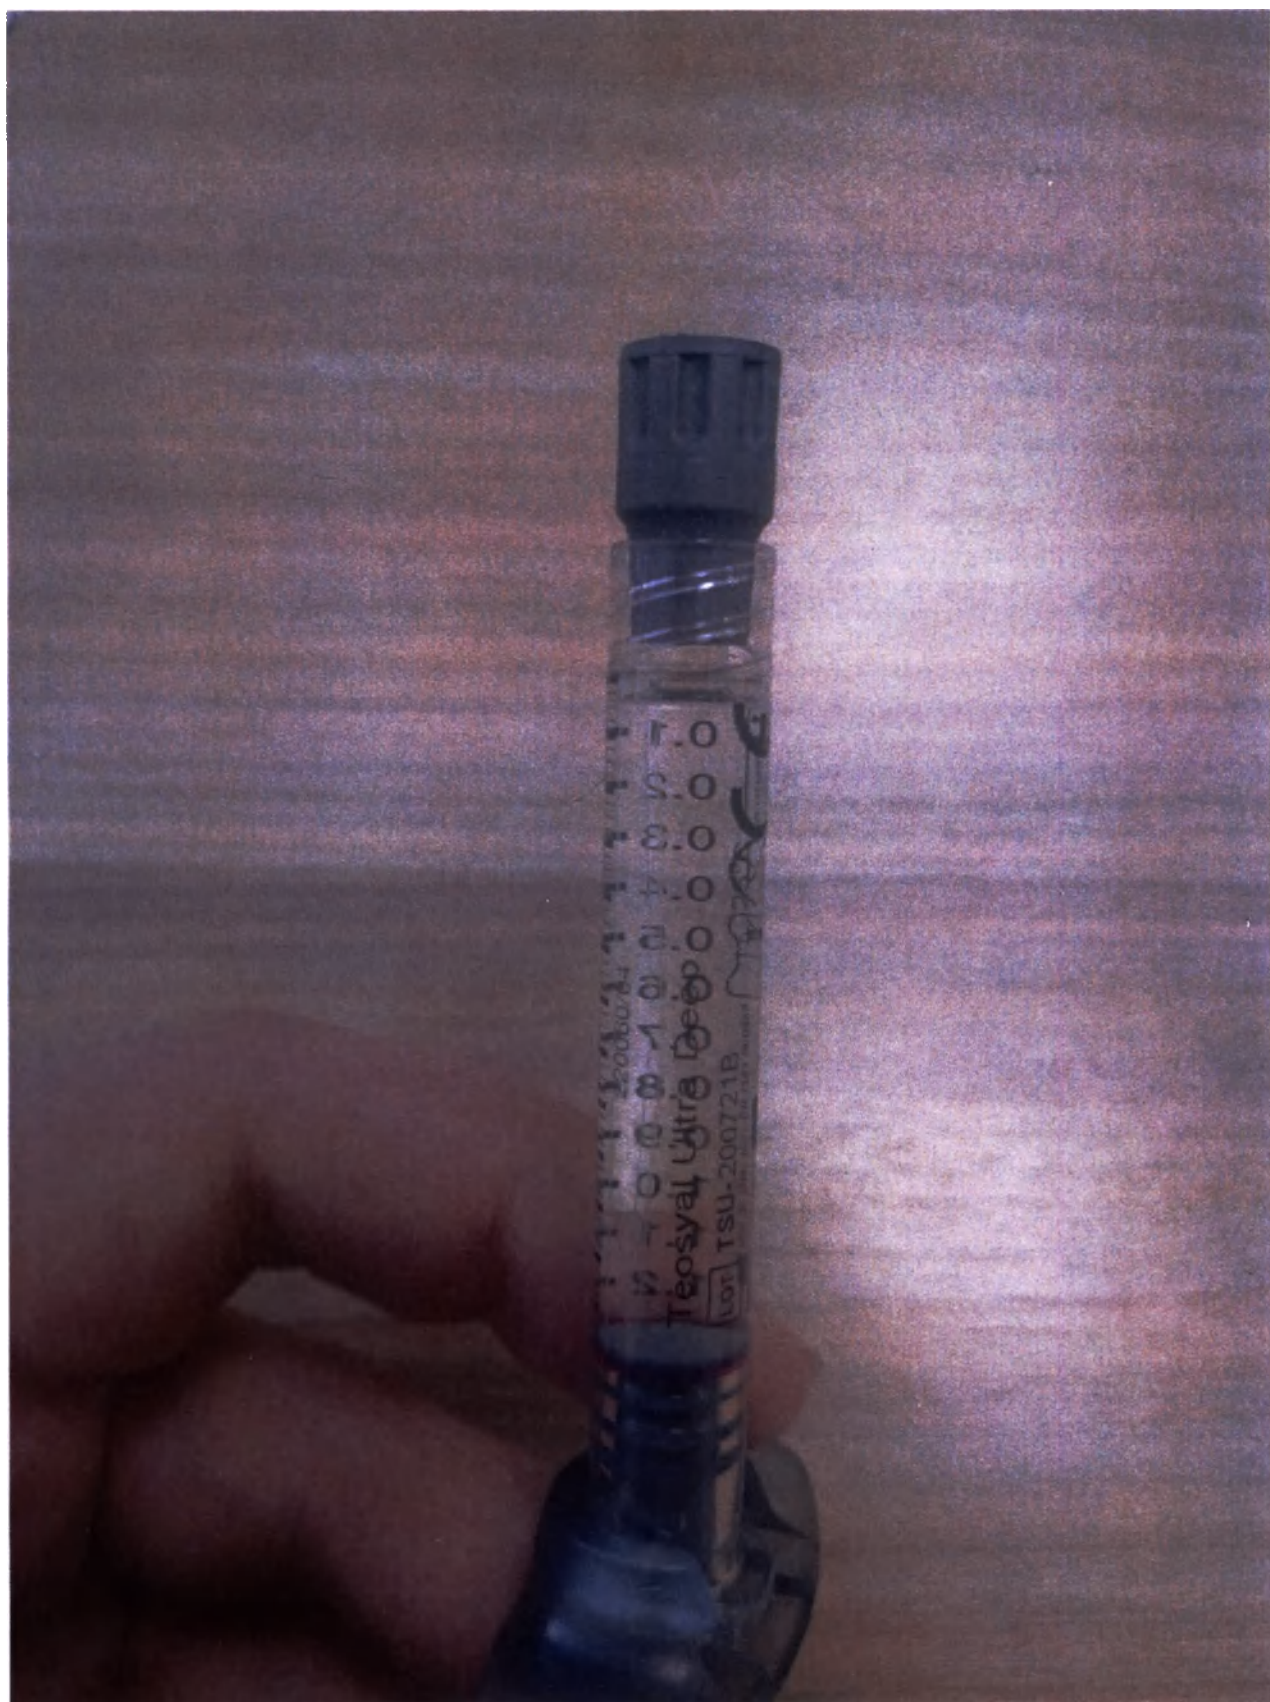

Маркировка шприца на примере 1-го образца (ракурс 2): Имплантат *TEOSYAL® ULTRA DEEP*

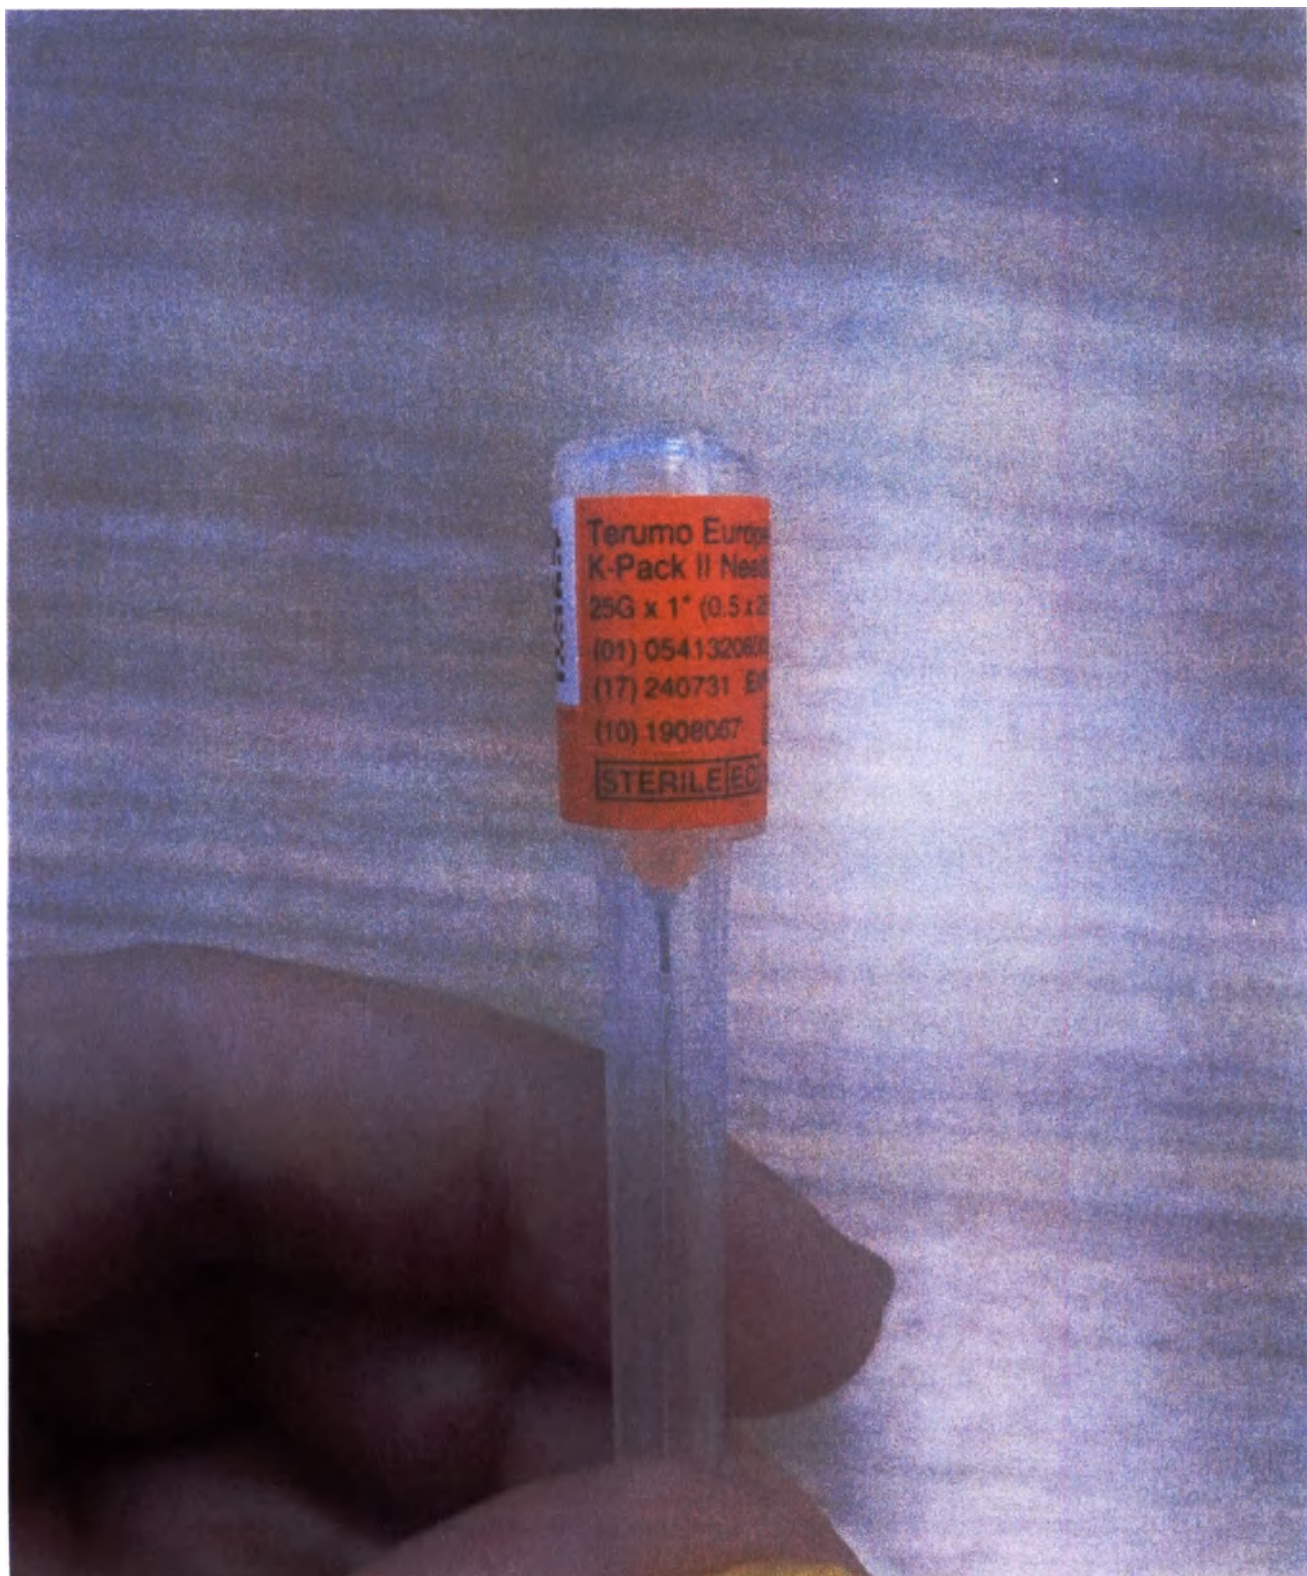

Маркировка игл (ракурс 1): Имплантат *TEOSYAL® ULTRA DEEP*



Маркировка игл (ракурс 2): Имплантат TEOSYAL® ULTRA DEEP

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью 33/Гирсиджия фи лист(ов)
Генеральный директор ООО «Теоксан Рус»

Новосельцев В. В.

