

ПОДТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Штрауманн»
А.Вроблевски



[Signature]
" *июль* 20*20* г.

Фотографические изображения

Метчик стоматологический в вариантах исполнения с принадлежностями

Фото 1. «Адаптер метчика стоматологического Alvim для углового наконечника»



Фото 2. «Адаптер метчика стоматологического Alvim для динамометрического ключа, длинный»

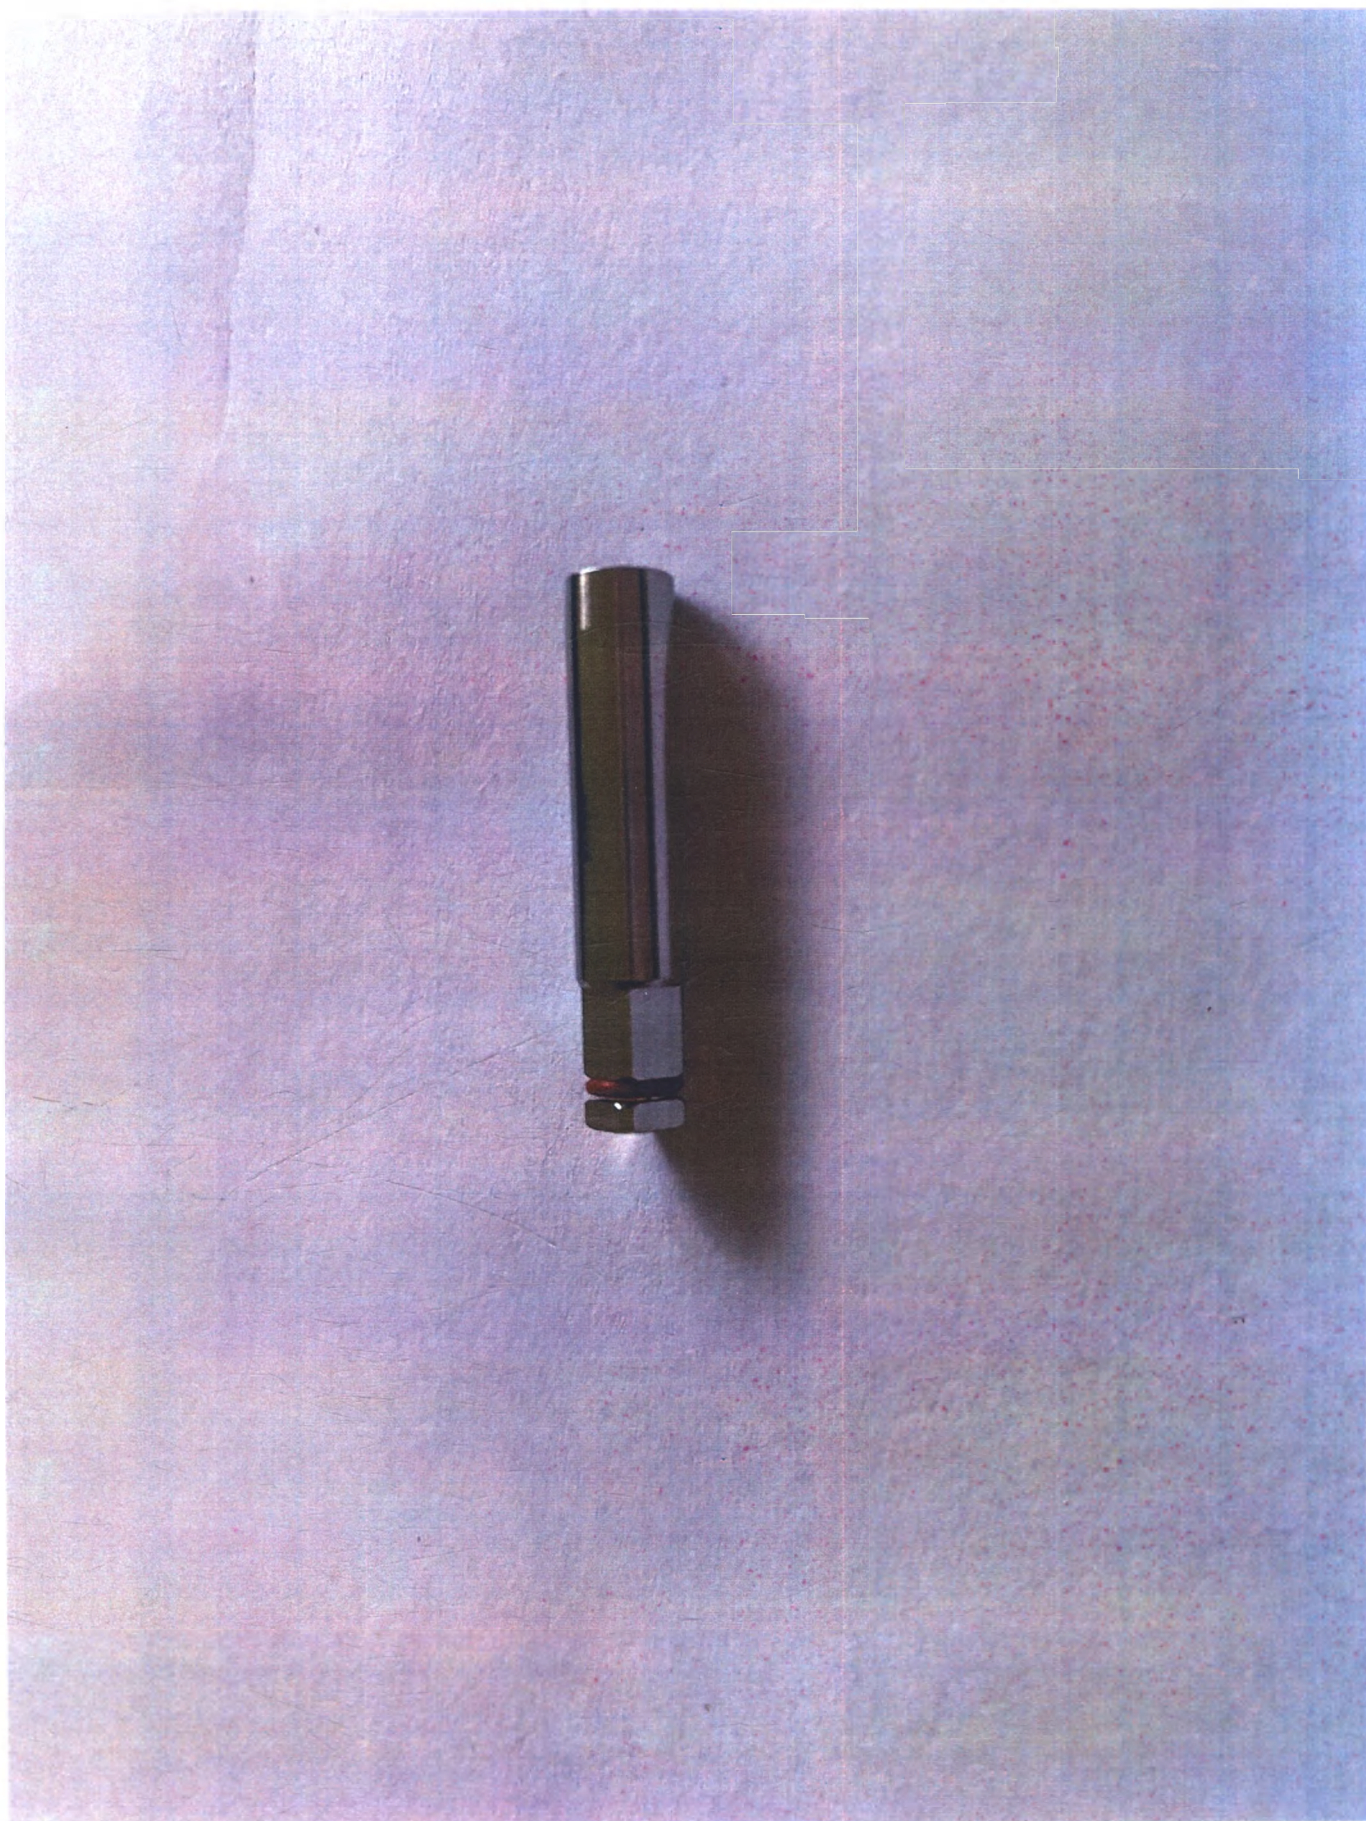


Фото 3. «Метчик стоматологический Facility Ø 3.0 мм»

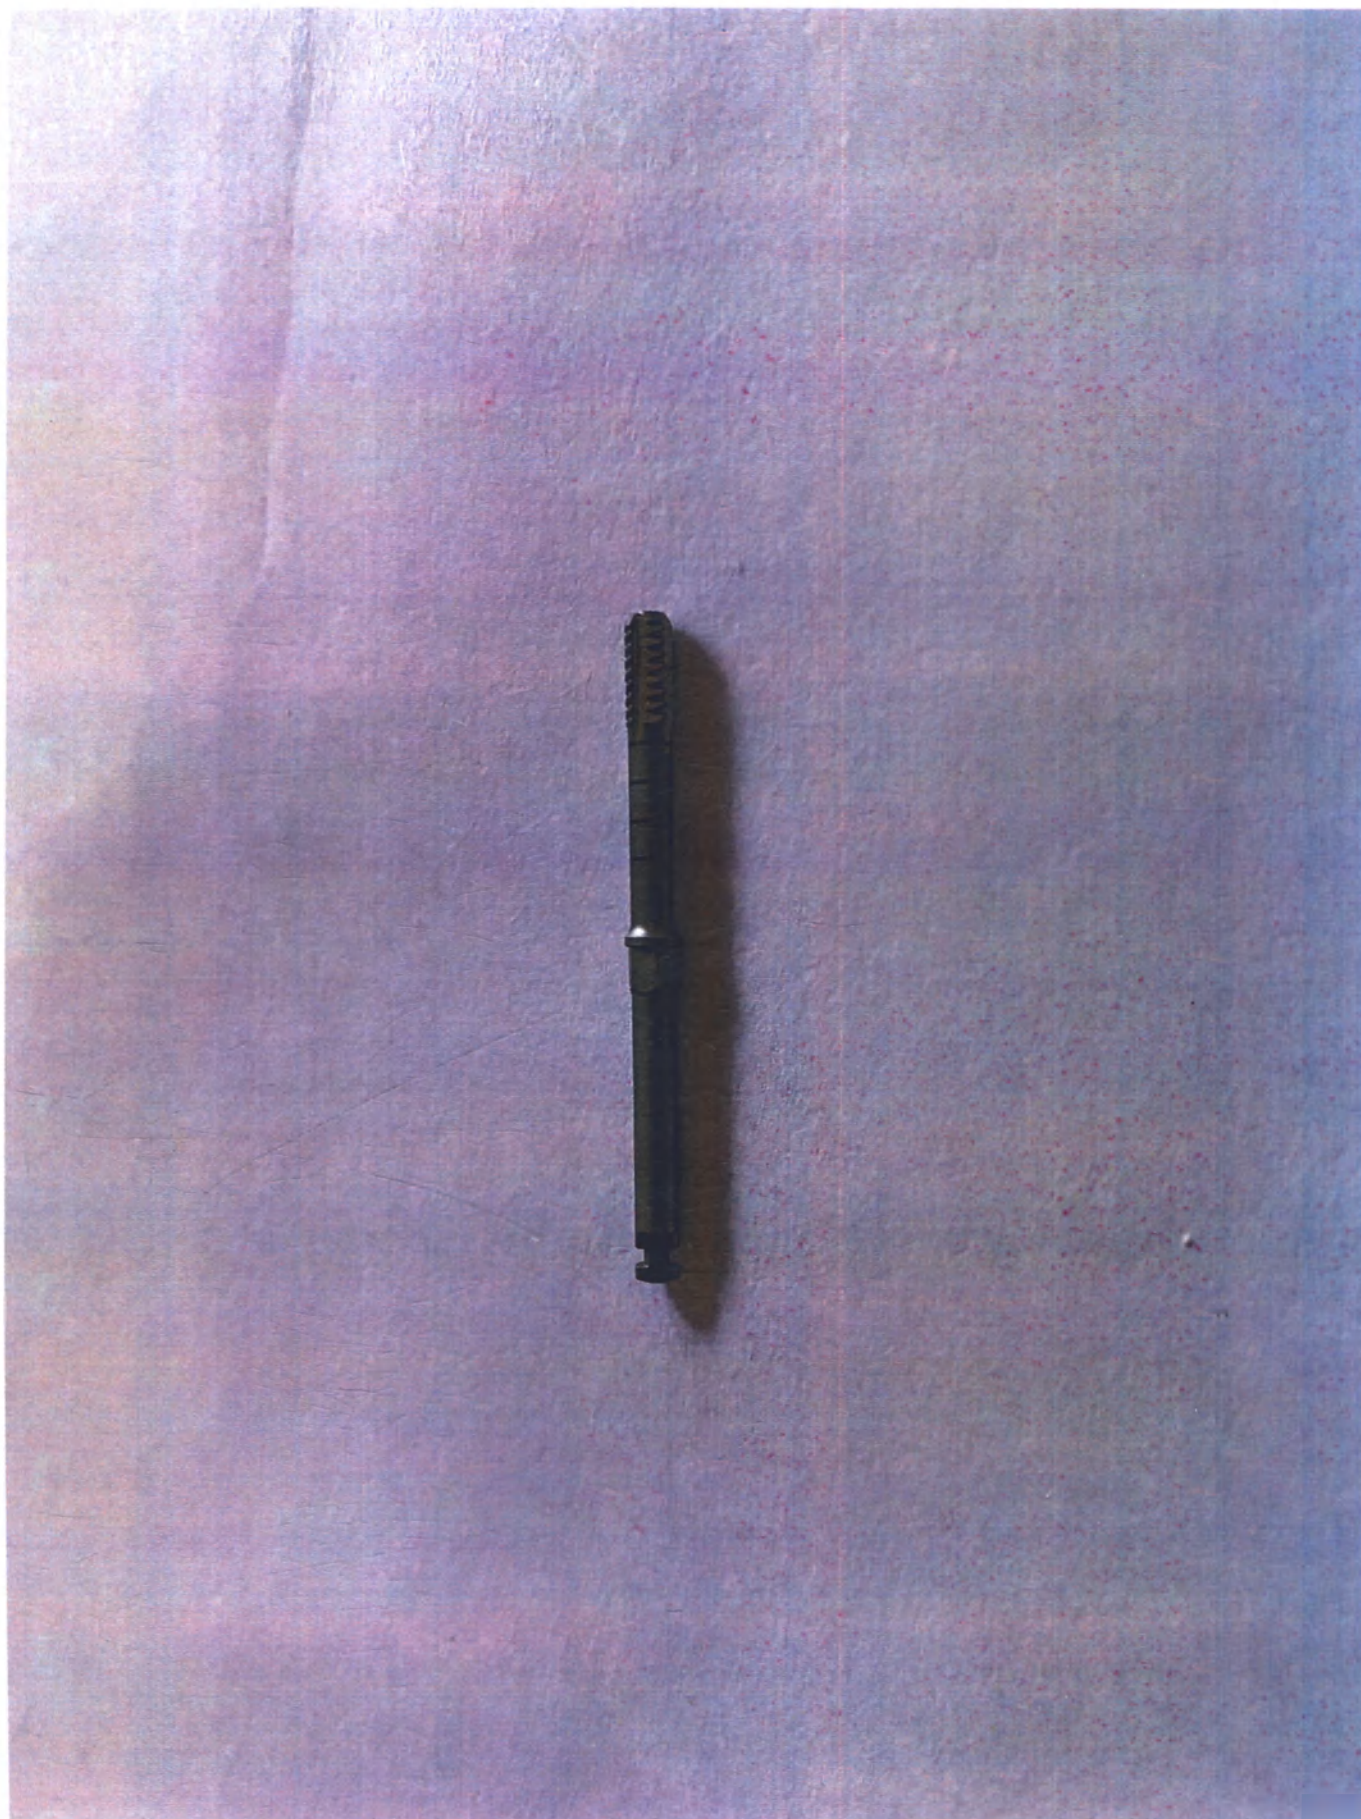


Фото 4. «Метчик стоматологический Alvim Ø 3.5 мм для направленной хирургии, узкий»

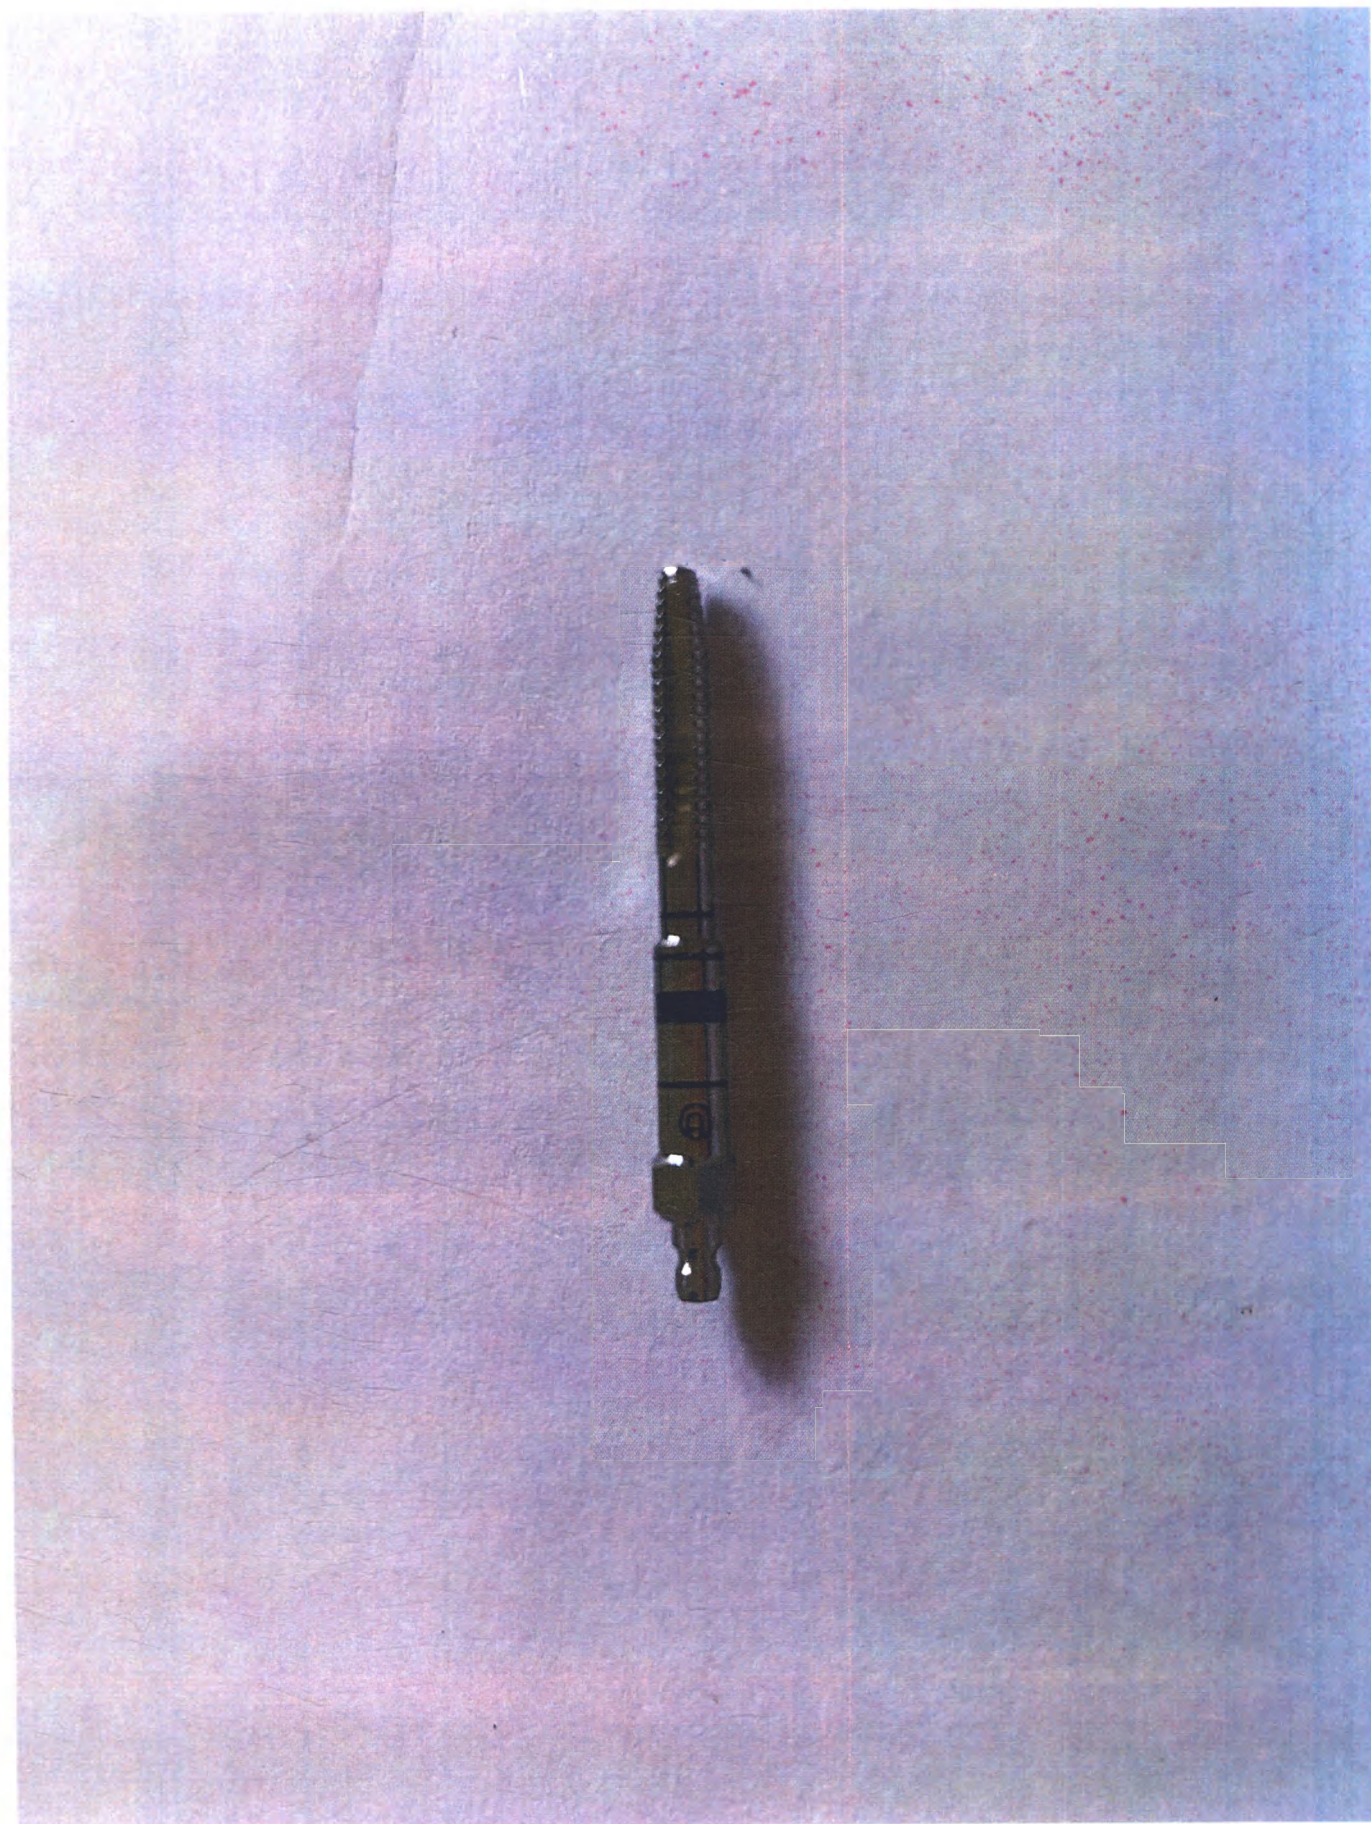


Фото 5. «Метчик стоматологический Alvim Ø 4.3 мм»

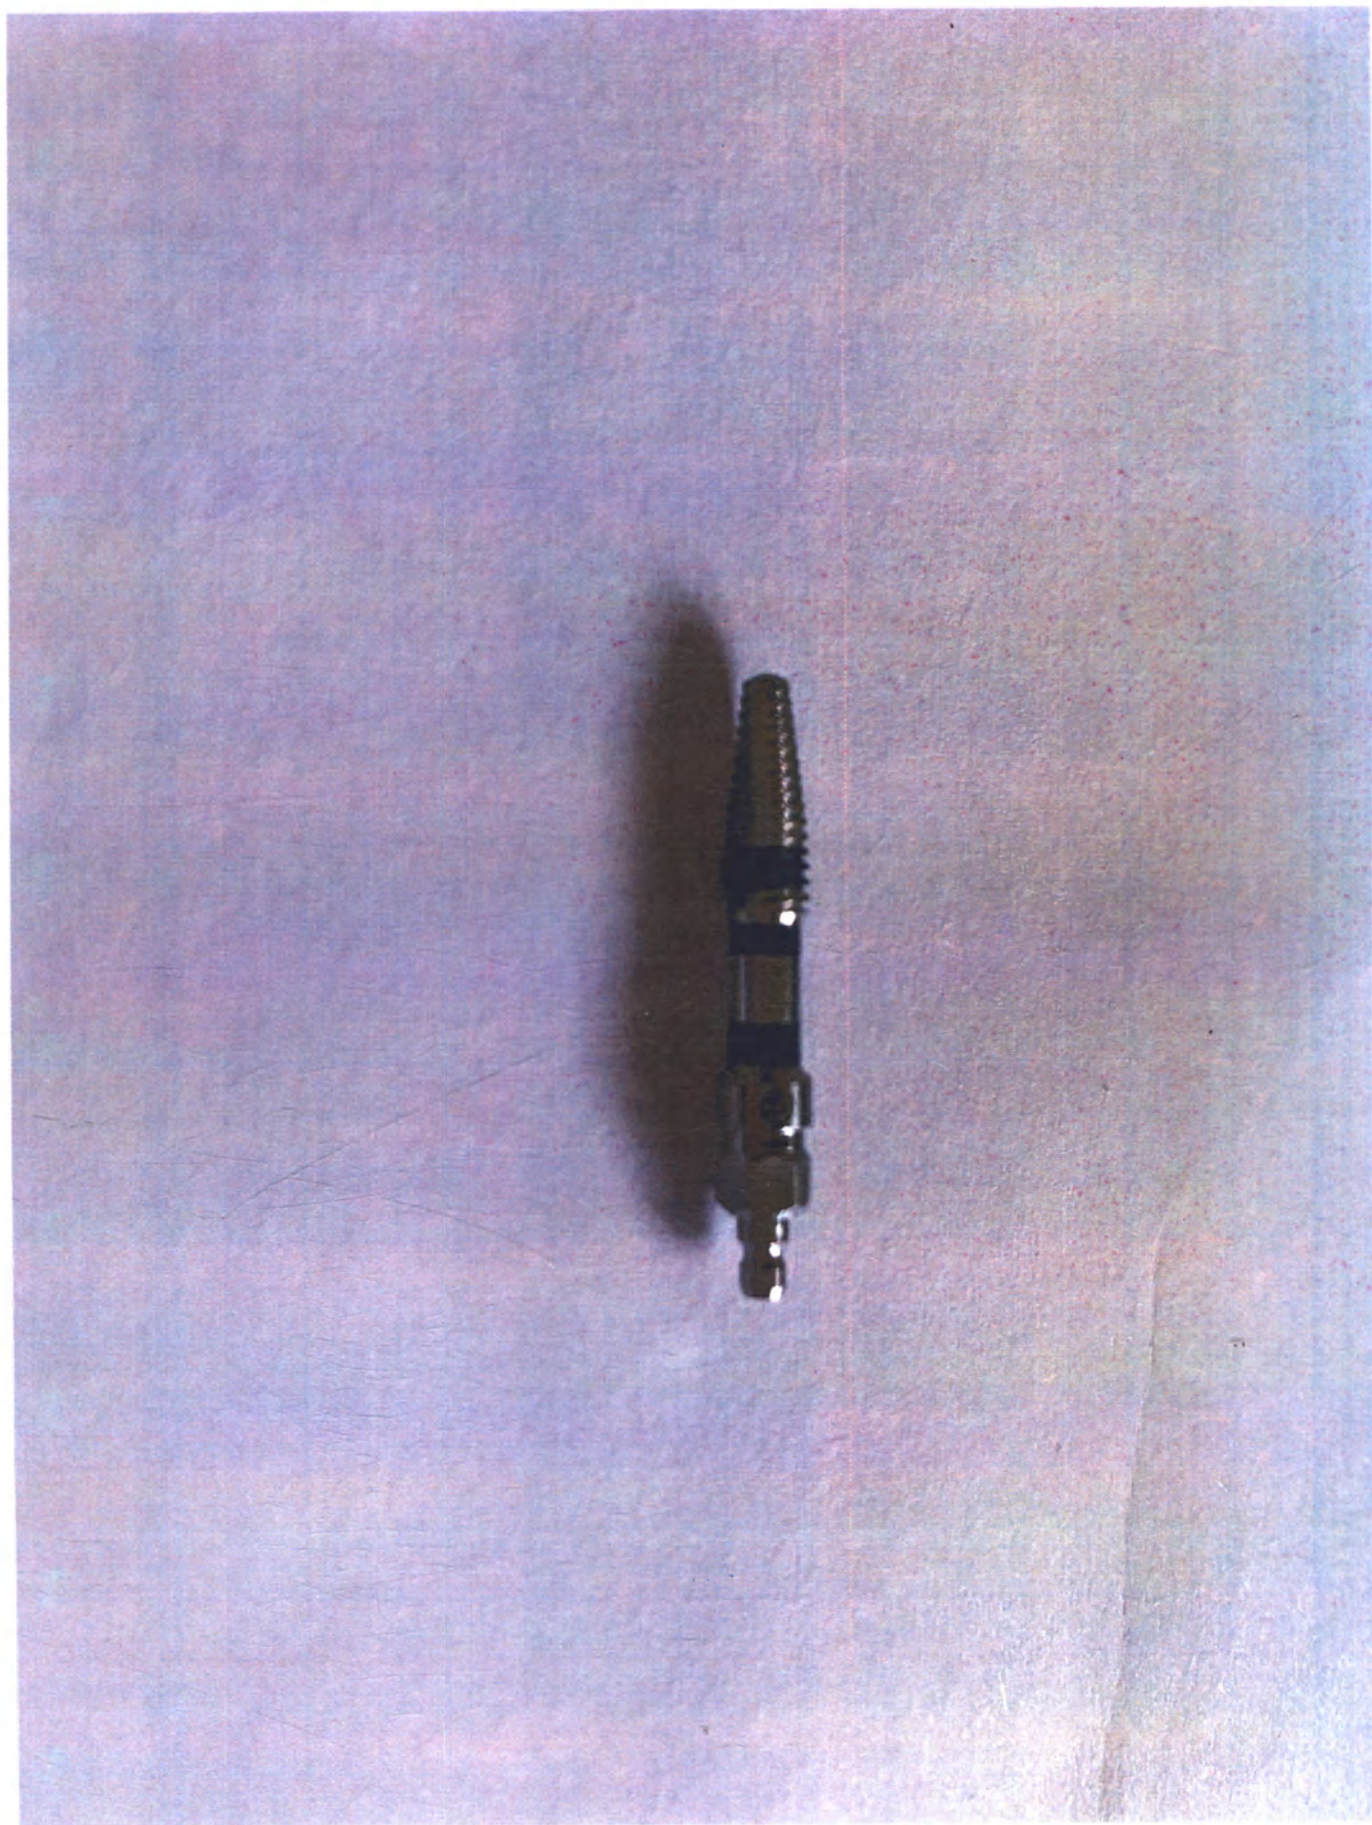


Фото 6. «Метчик стоматологический Alvim Ø 5.0 мм»

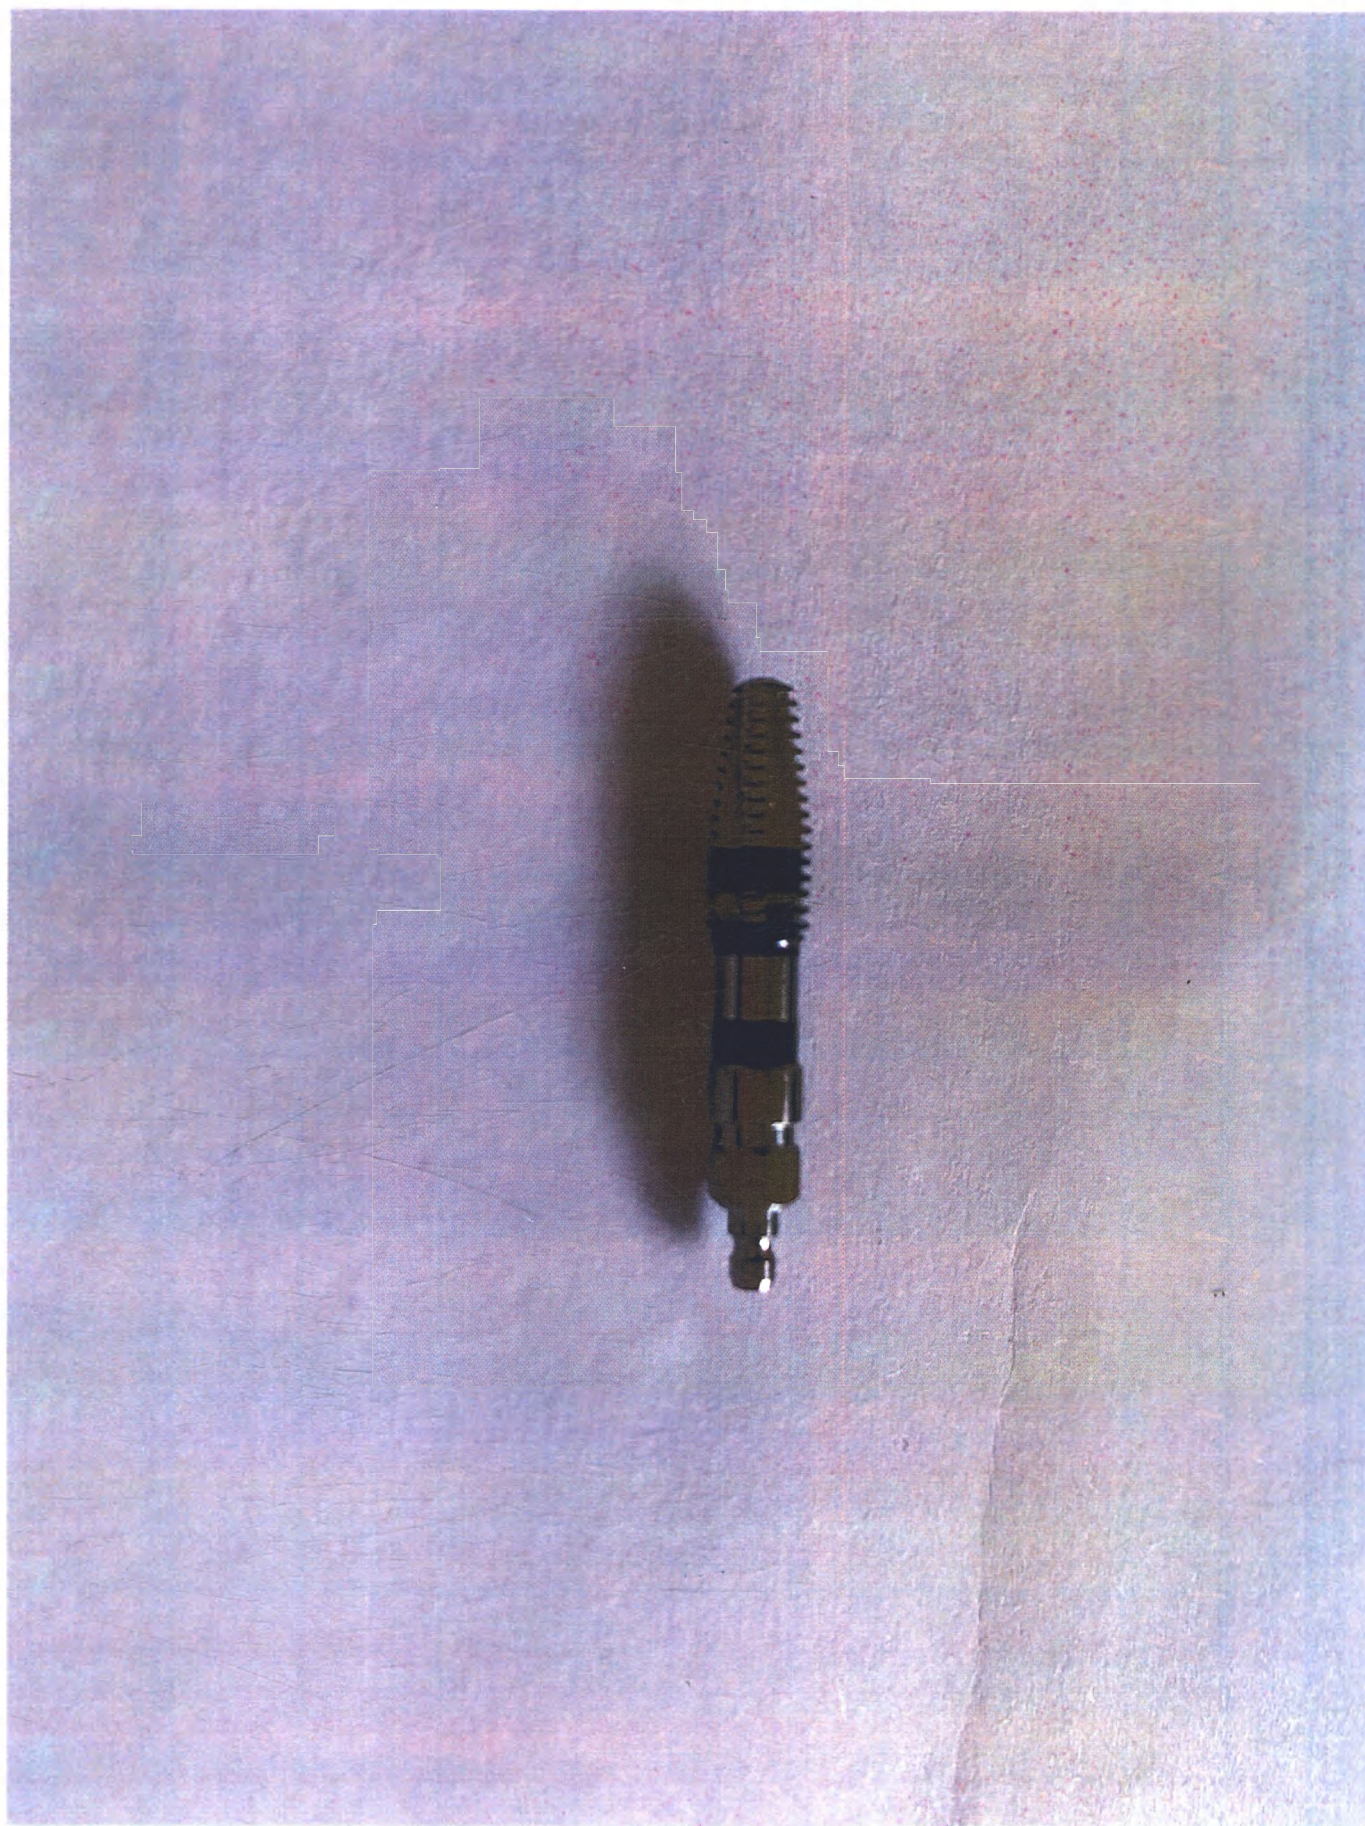


Фото 7. «Метчик стоматологический Facility Ø 2.8 мм для направленной хирургии»

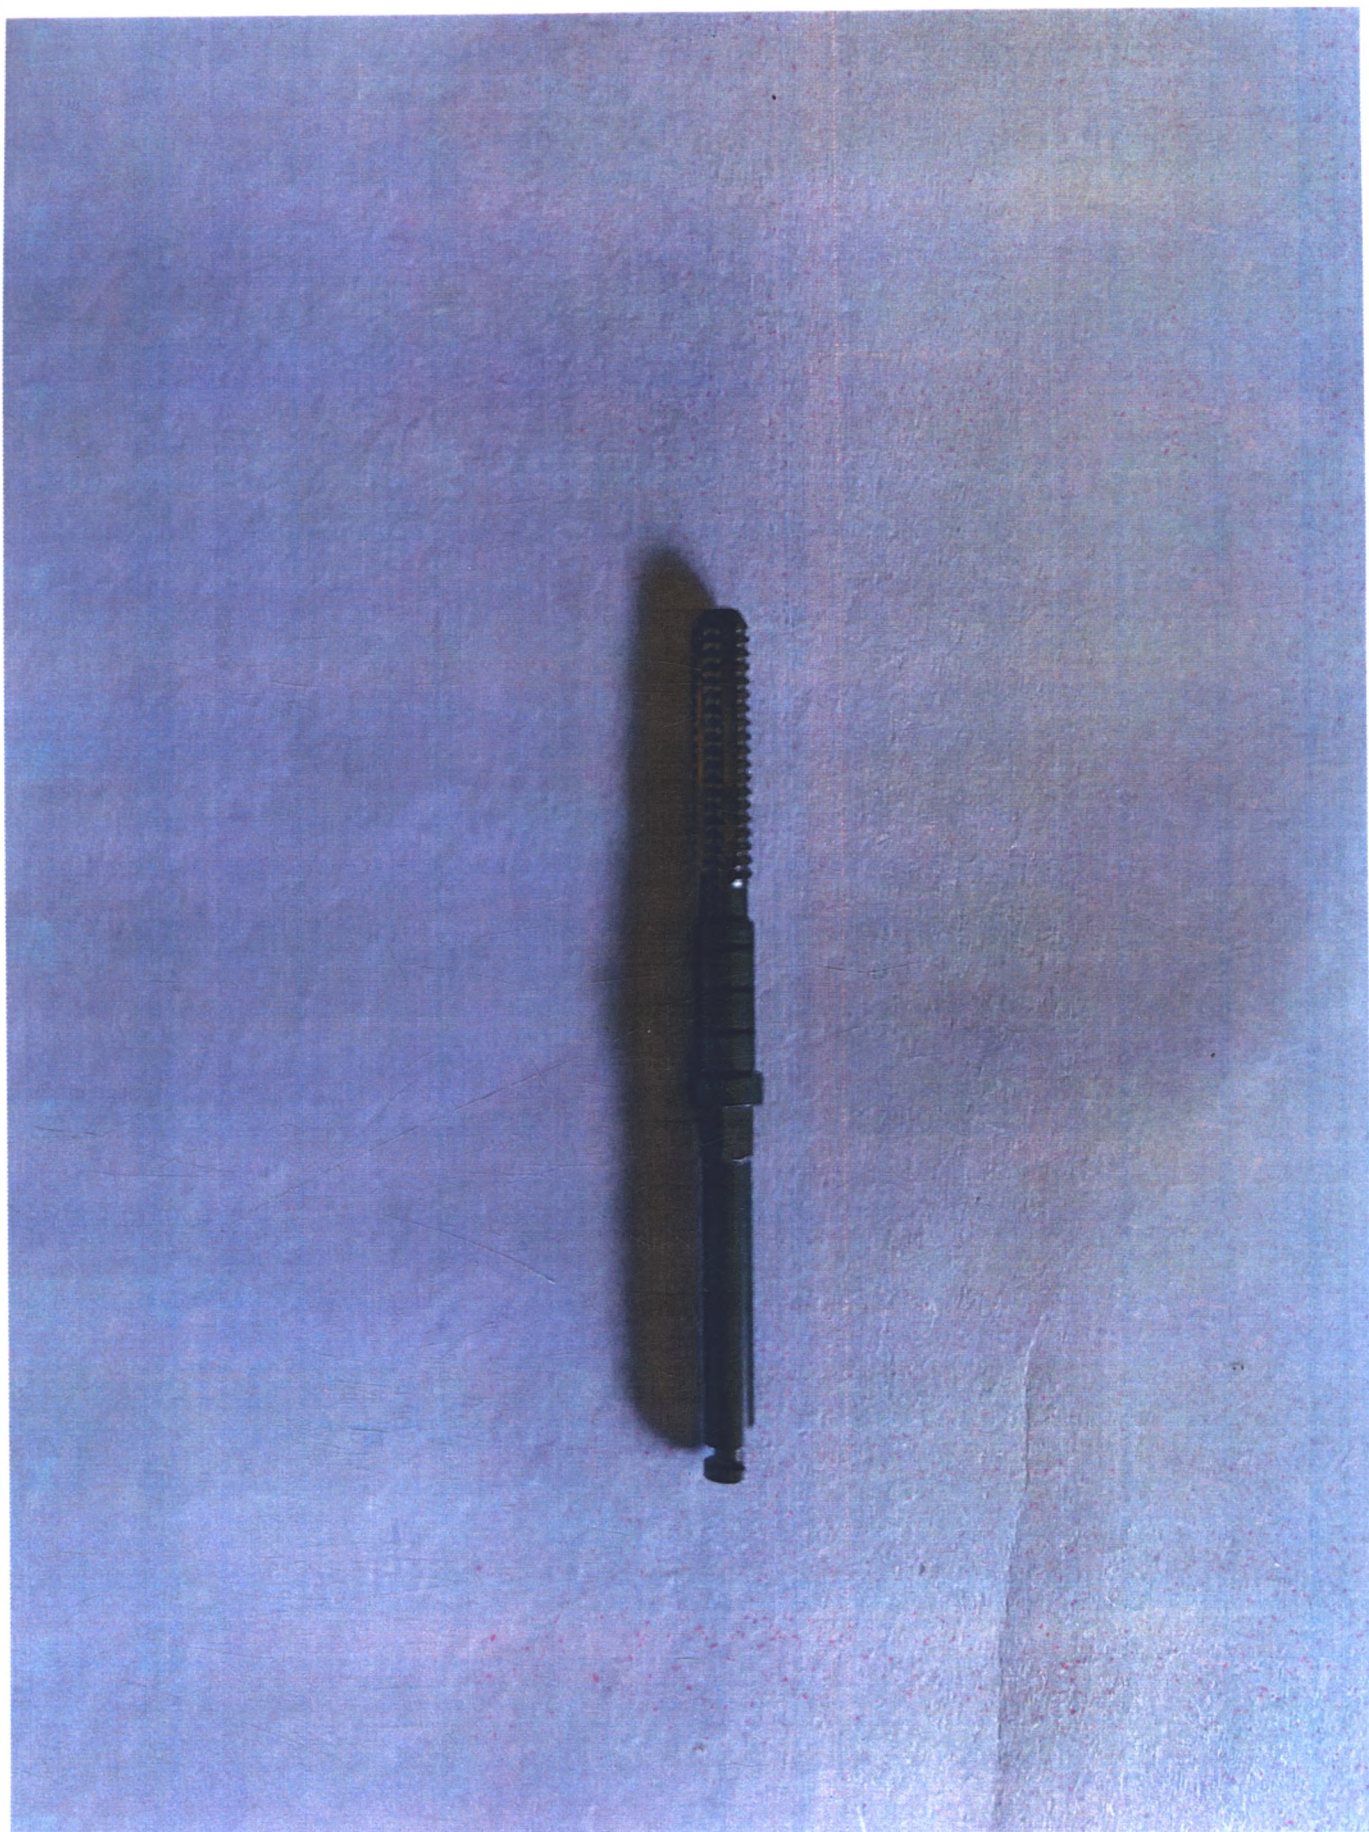


Фото 8. «Адаптер метчика стоматологического Alvim для динамометрического ключа, короткий»

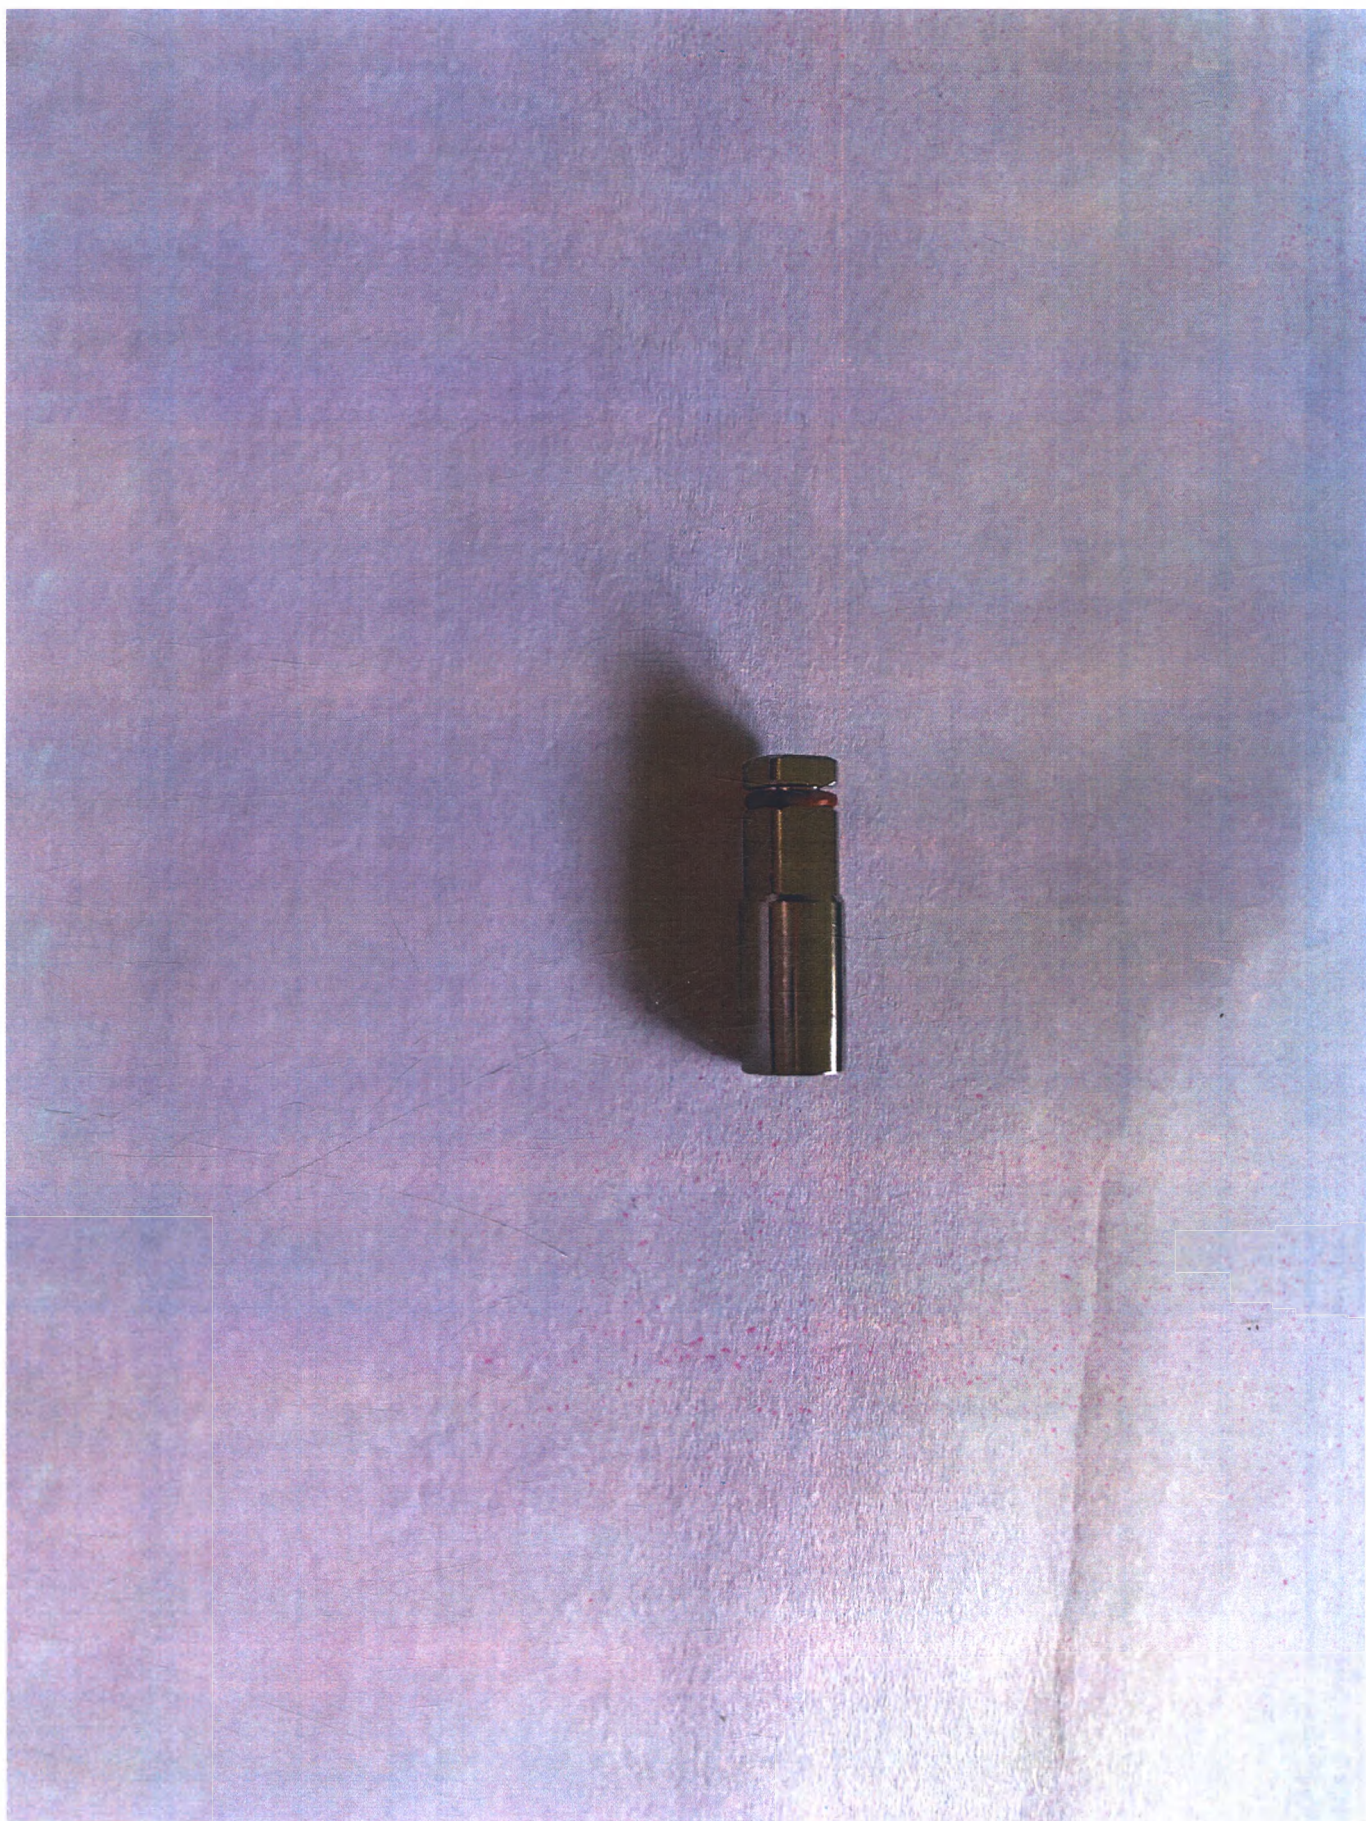


Фото 9. «Метчик стоматологический Alvim Ø 3.5 мм для направленной хирургии, узкий»

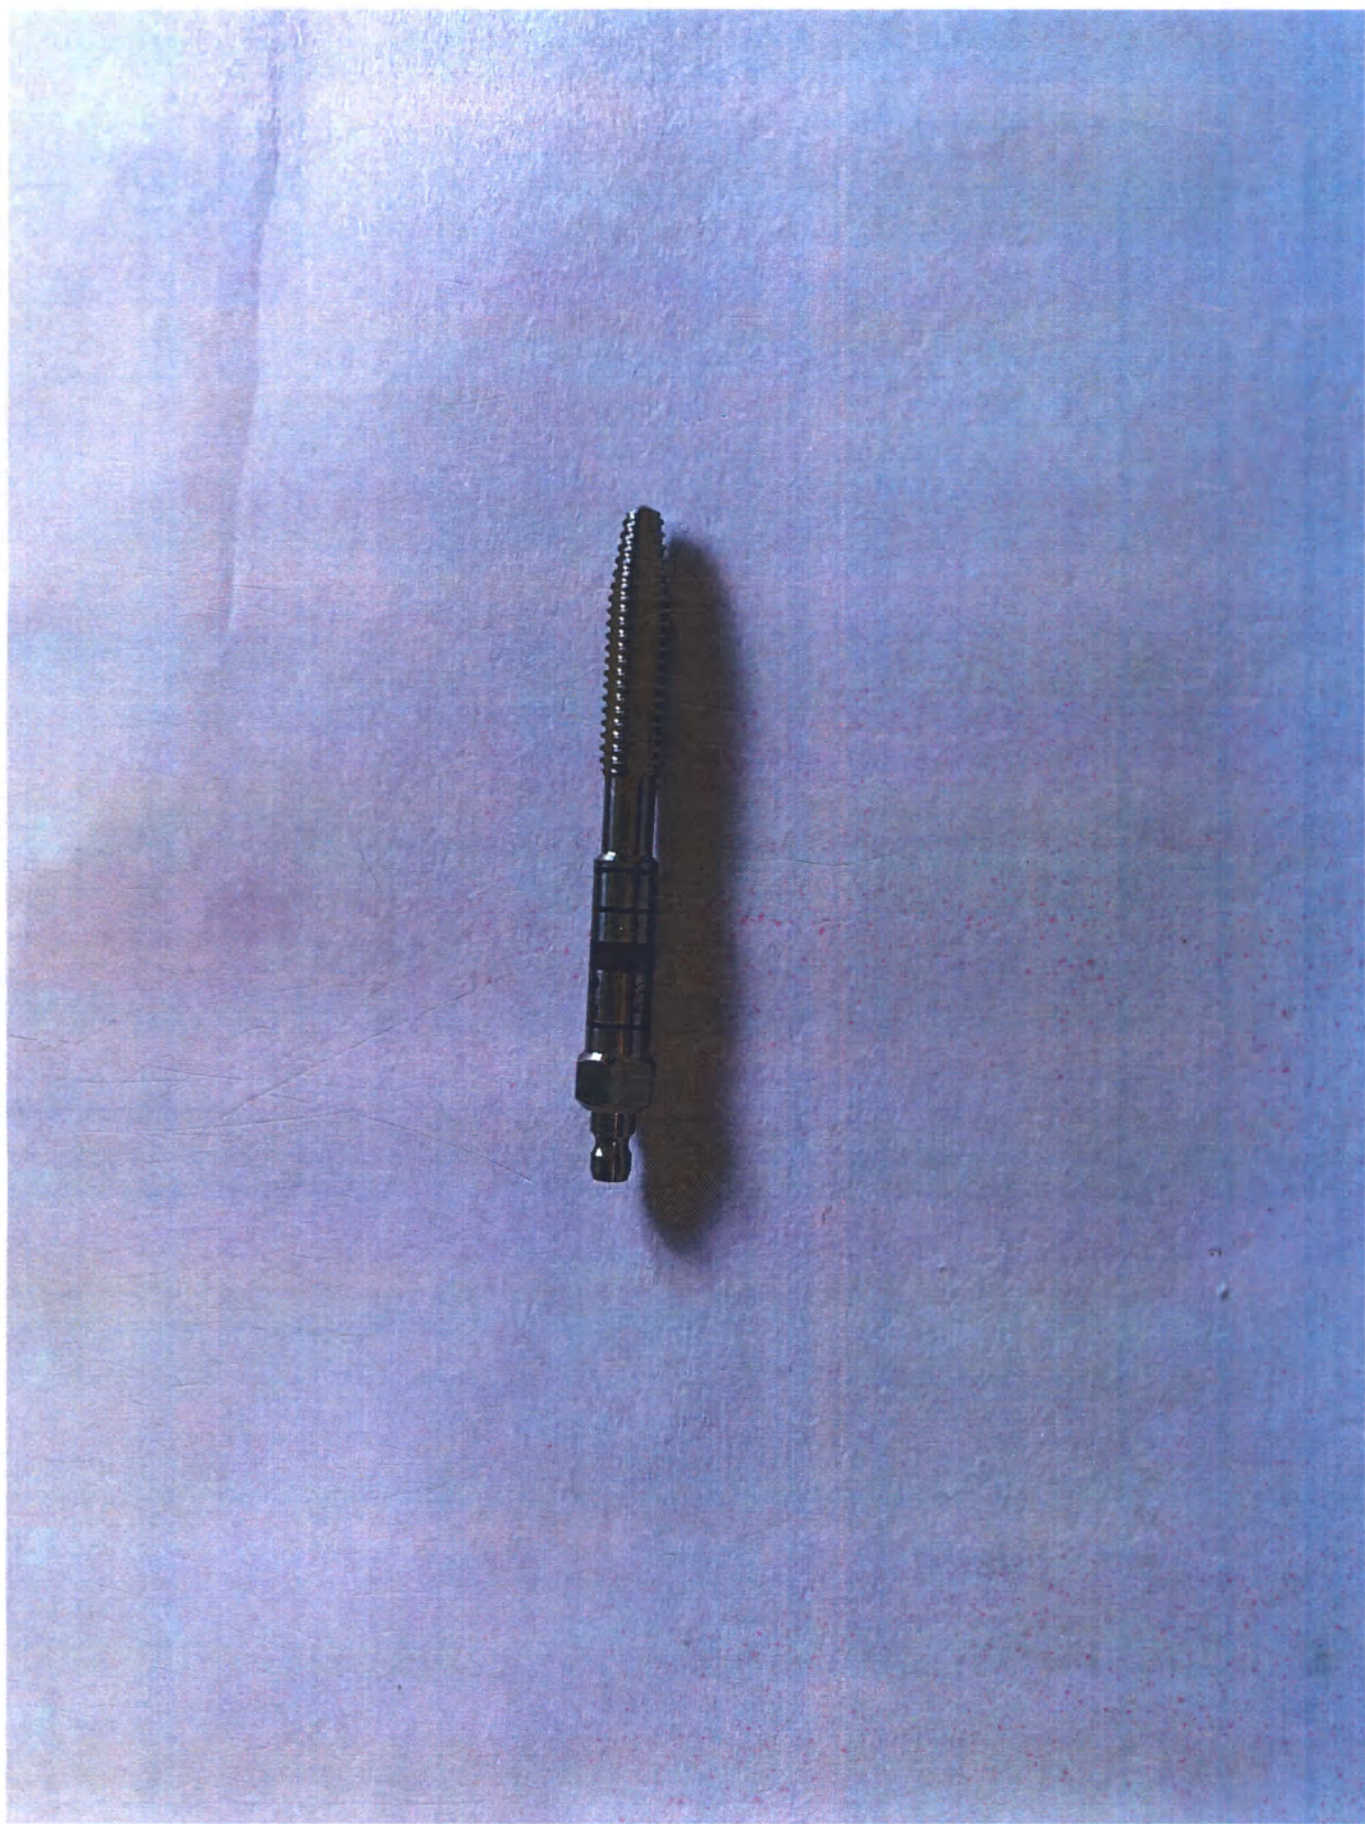


Фото 10. «Адаптер метчика стоматологического Facility для динамометрического ключа»

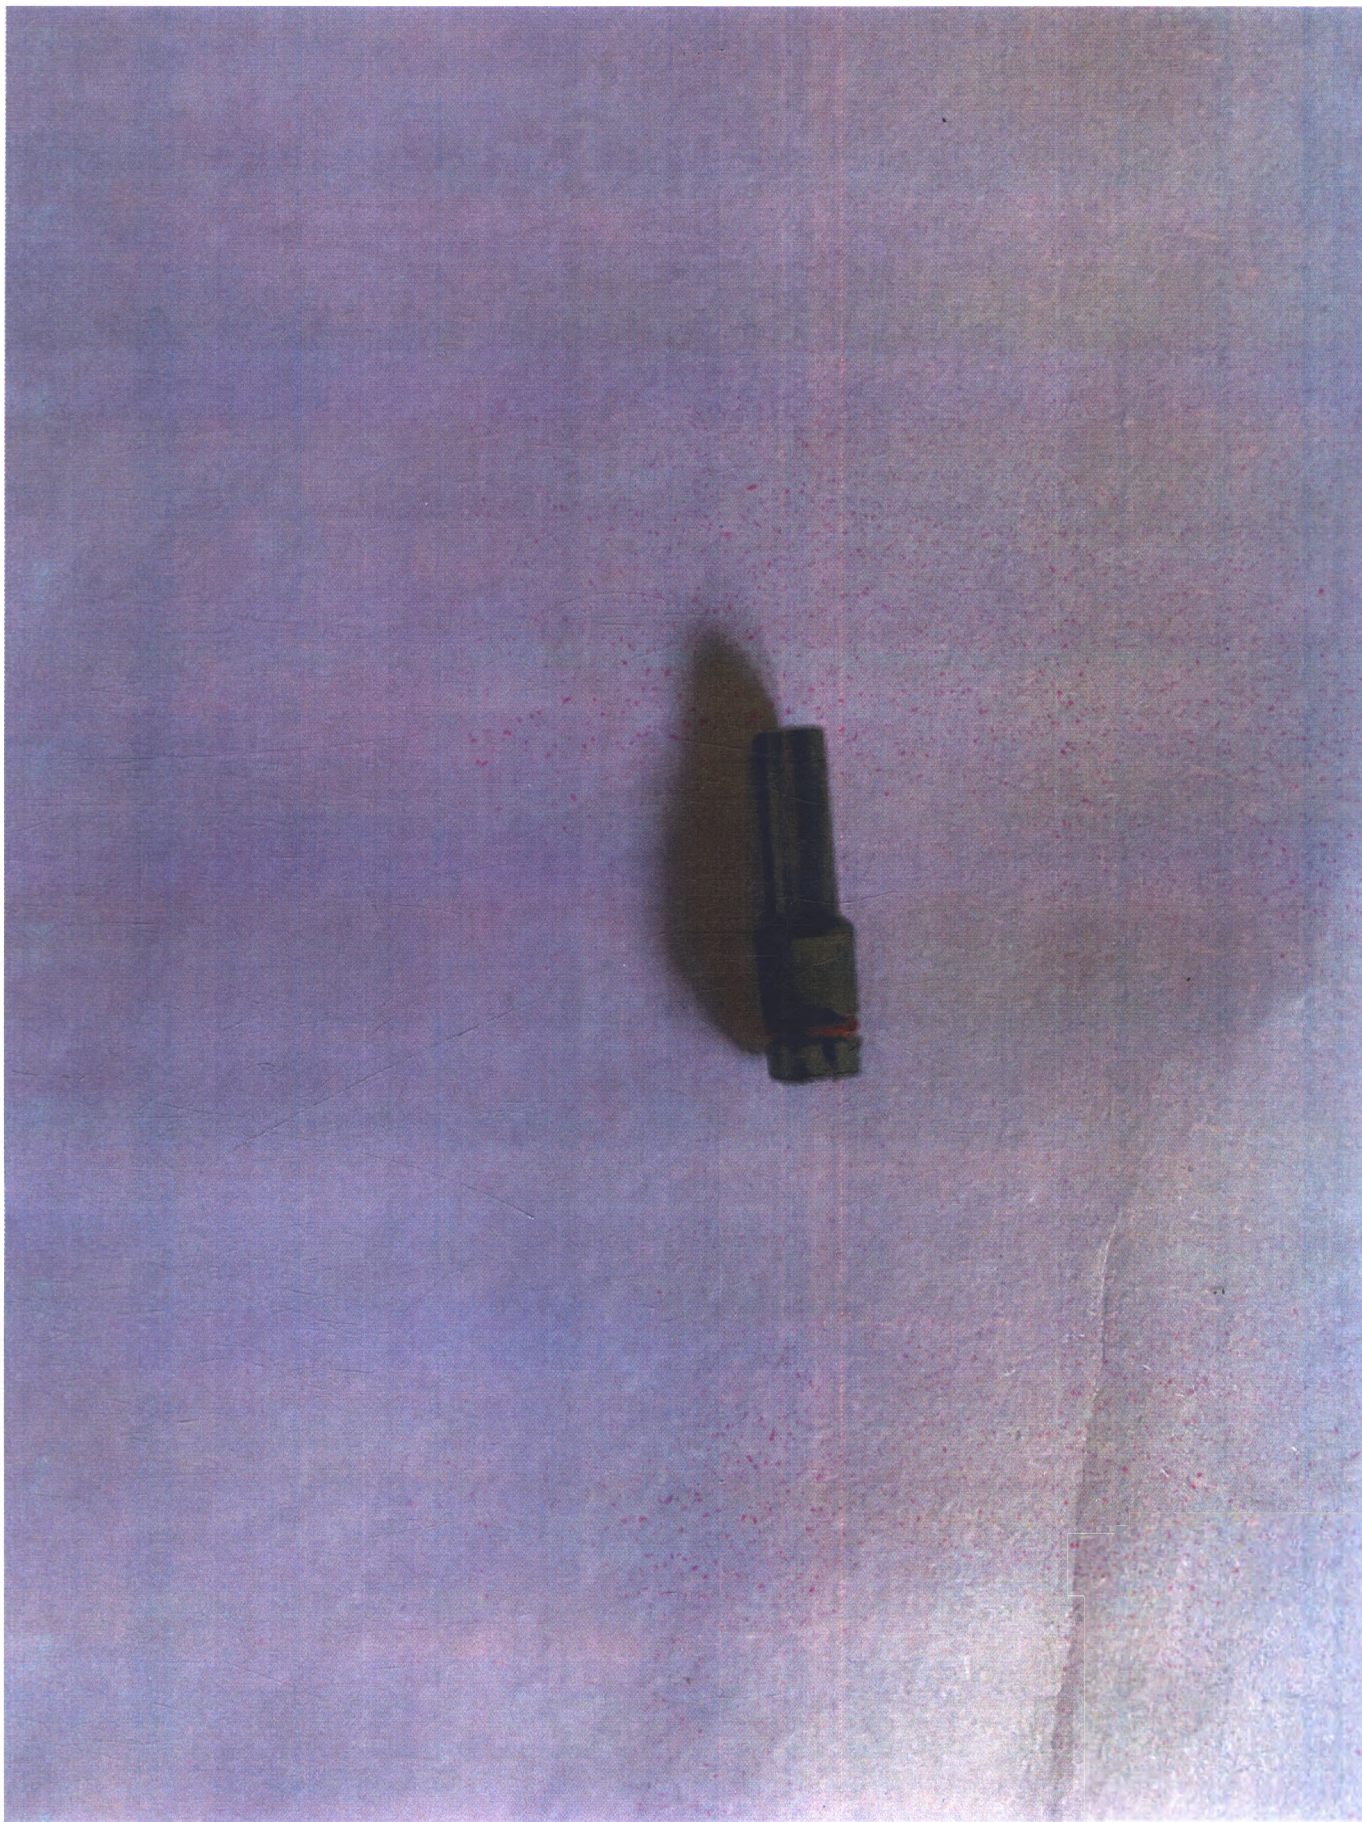


Фото 11. Упаковка с проектом русскоязычной маркировки



Прошито и пронумеровано

2 (Венедукт) (лист 2)



М.П.