

УТВЕРЖДАЮ



Генеральный директор

ЗАО НПО «АСТА»

Спиридонов В. Н.


«20» декабря 2021 г.

М.П.


**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО
ИЗДЕЛИЯ УПАКОВКИ И МАРКИРОВКИ**

**«Раствор разбавителя изотонический I-Mag Diluent низкой
ионной силы»**

Раствор разбавителя изотонический I-Mag Diluent низкой ионной силы
(Общий вид)

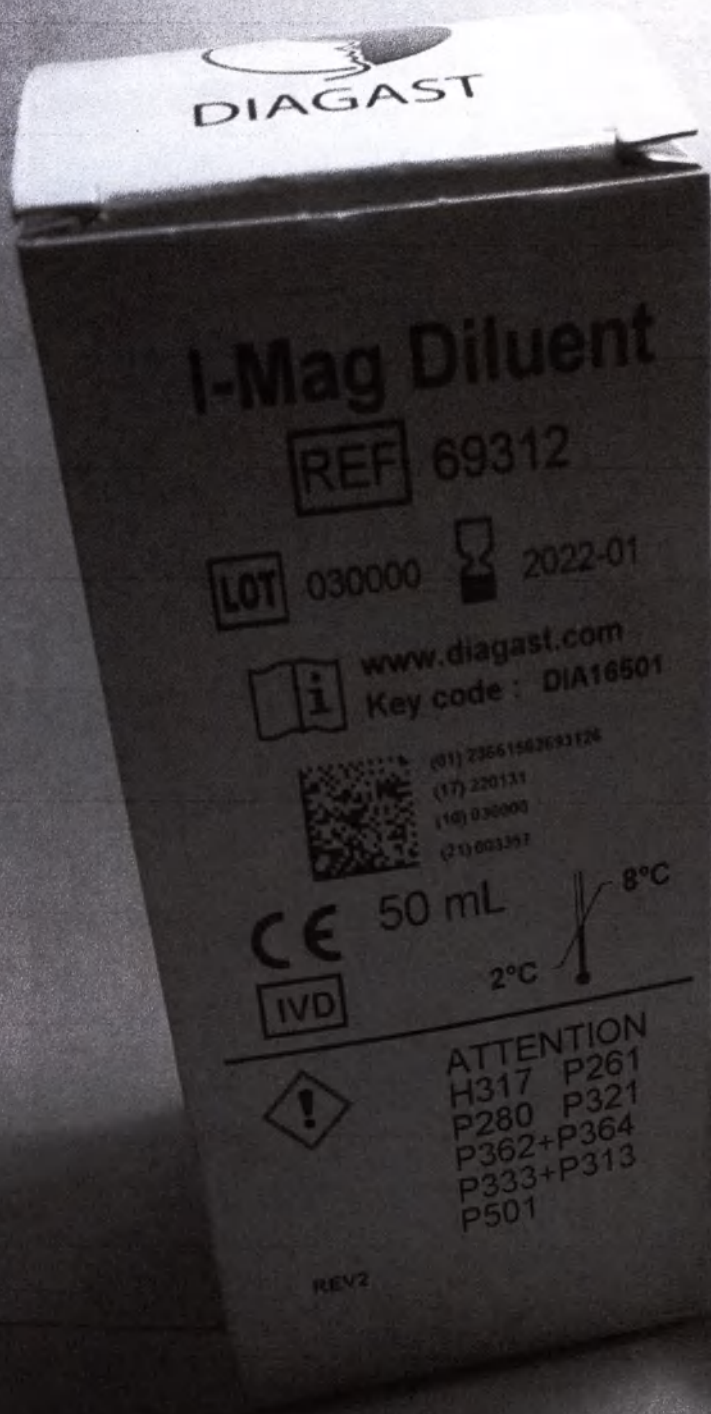

Пробирка I-Mag Diluent (50 мл)

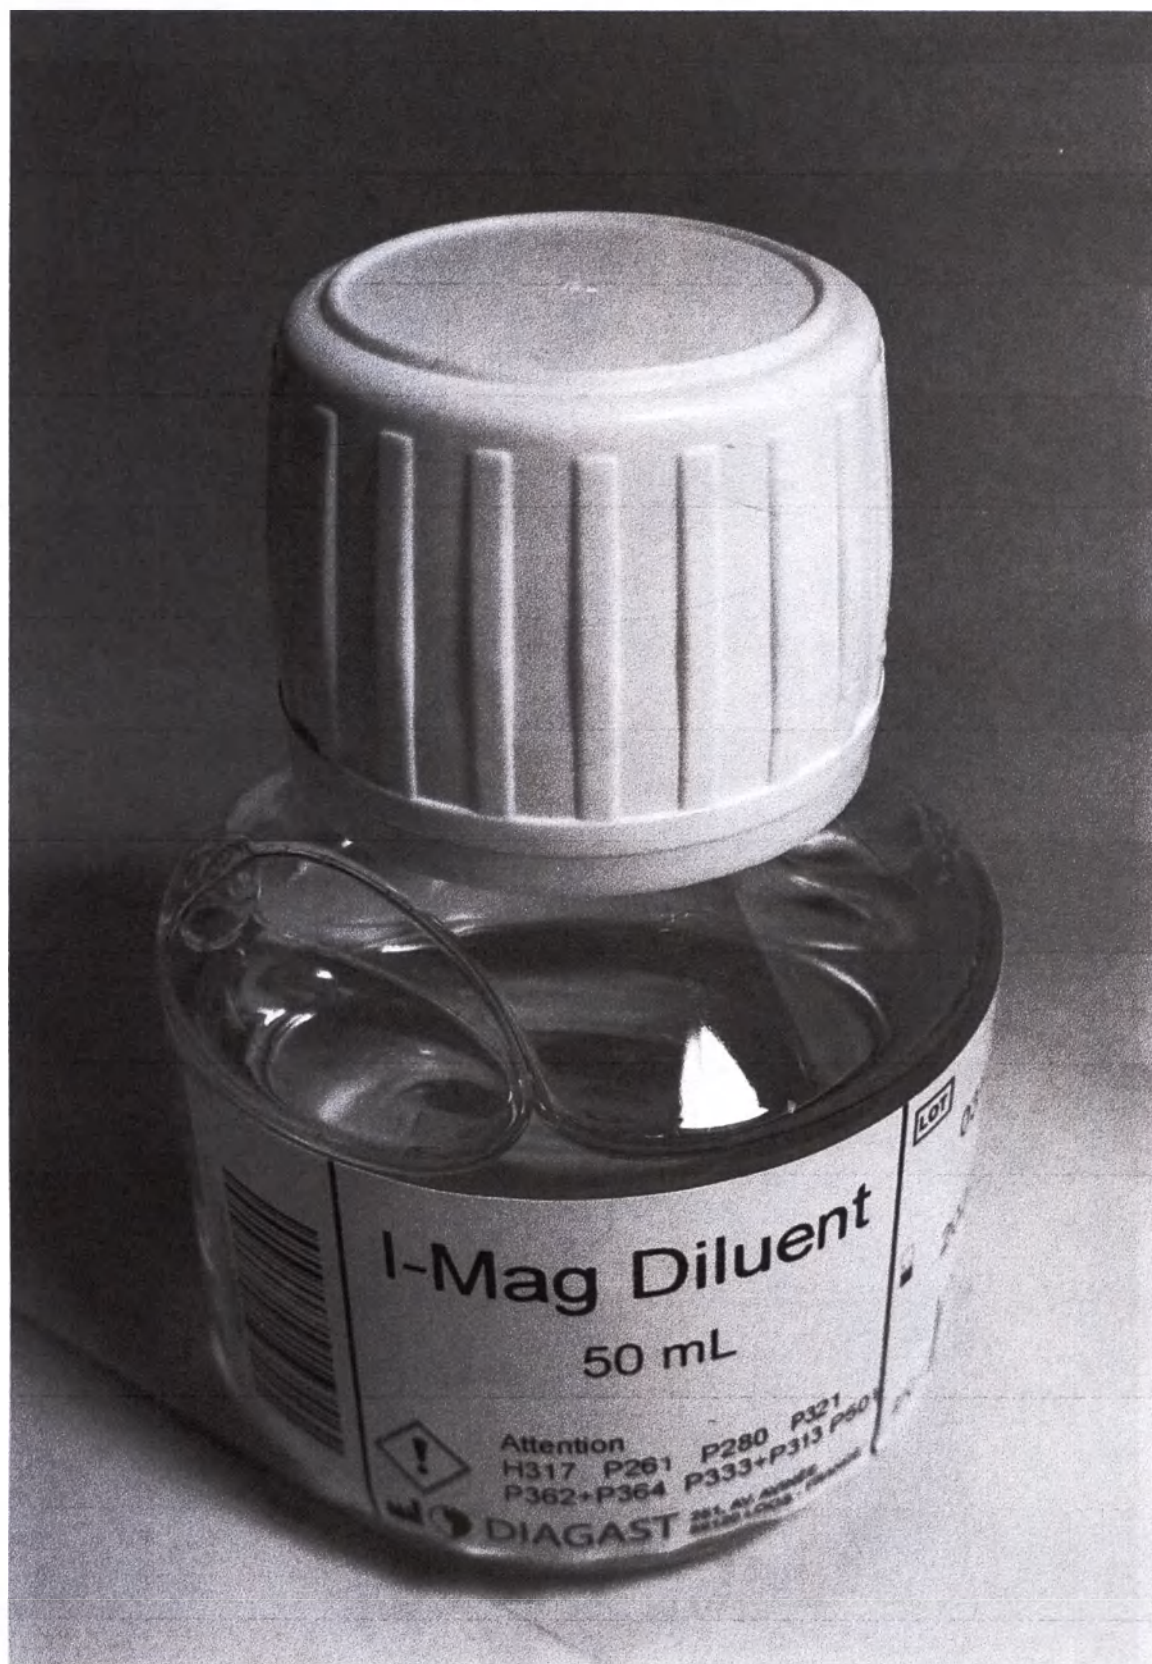

Упаковка

Раствора разбавителя изотонический I-Mag Diluent низкой ионной силы

I-Mag Diluent

REF 69312

LOT 030000



2022-01



www.diagast.com

Key code : DIA16501



(01) 23661562693126


(17) 220131

(10) 030000


(21) 003357



50 mL



2°C



ATTENTION

H317 P261

P280 P321

P362+P364

P333+P313

P501

REV2

I-Mag Diluent

REF 69312

LOT 030000



2022-01



www.diagast.com

Key code : DIA16501



(01) 23661562693126

(17) 220131

(10) 030000



(21) 003357



50 mL




2°C



ATTENTION
H317 P261
P280 P321
P362+P364
P333+P313
P501

REV2

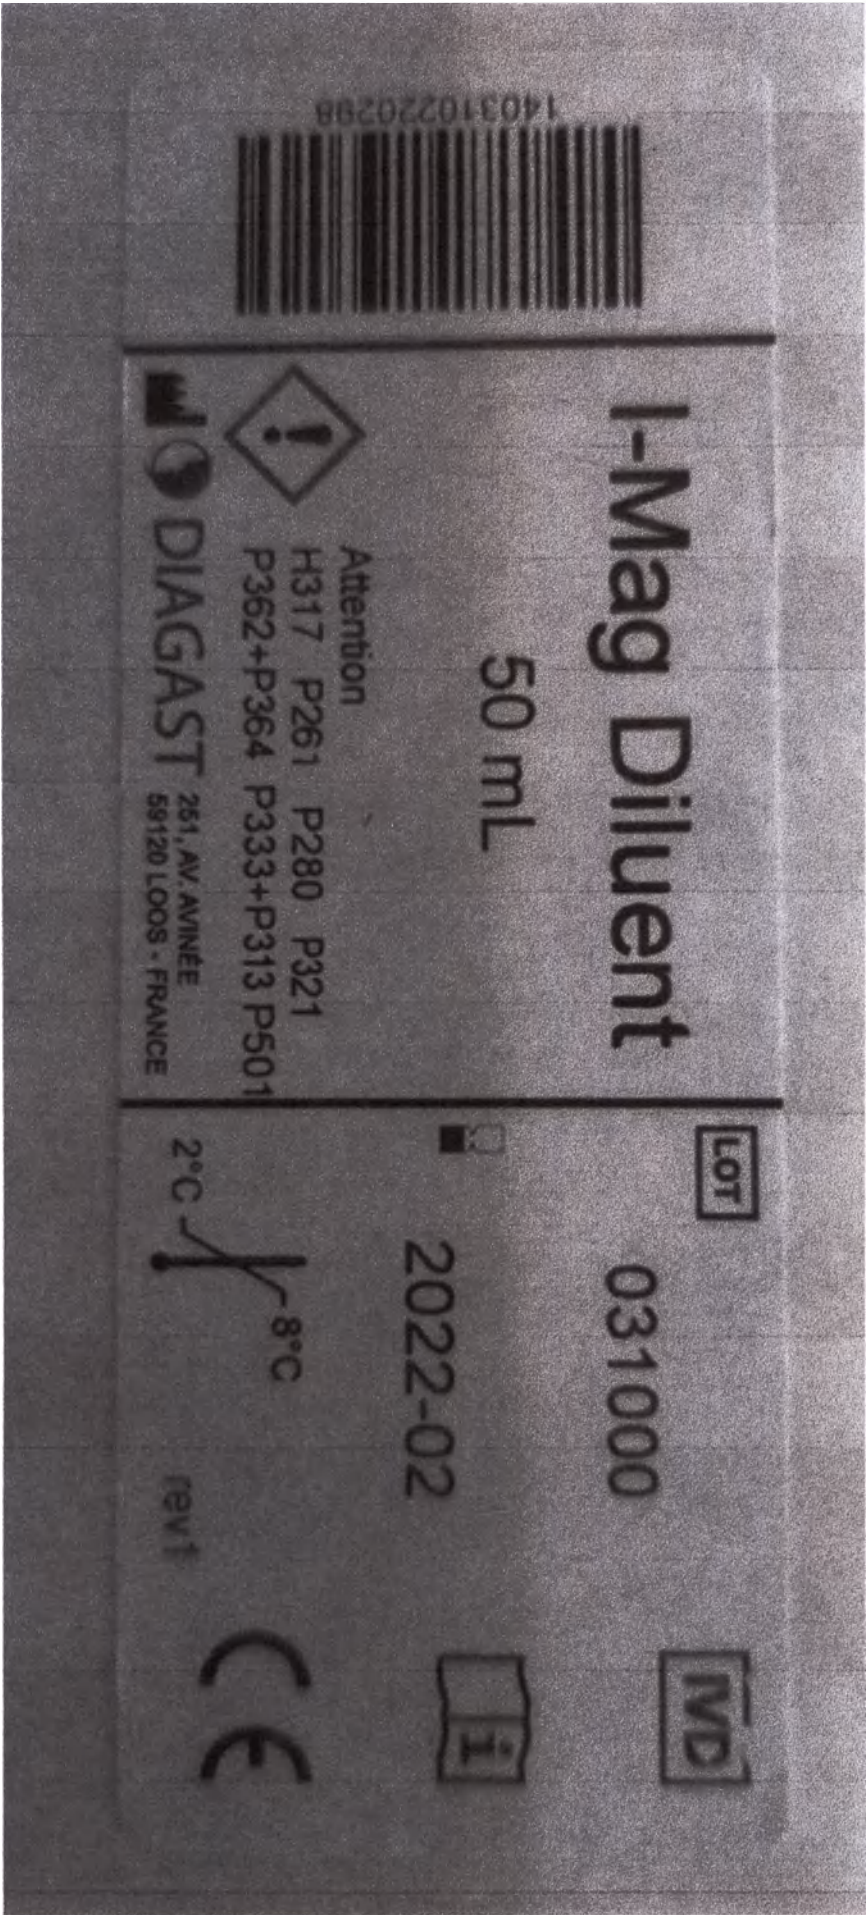

Раствор разбавителя изотонический I-Mag Diluent низкой ионной силы

1. Пробирка I-Mag Diluent (50 мл) – 1 шт.
2. Инструкция по применению – 1 шт.

антитела к ВИЧ 1, 2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют



Регистрационное удостоверение _____

Утилизировать как потенциально опасные отходы (класса Б)

🏭 Произведено во Франции

DIAGAST S.A.S., FRANCE ДИАГАСТ С.А.С., Франция

**Адрес производства: 251, avenue Eugène Avinée, Eurasanté Parc,
59120 LOOS, FRANCE**

**Уполномоченный представитель в РФ: ЗАО «НПО АСТА», адрес:
107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, 6 эт., оф. 1, тел.
+7 495 781 04 08, факс +7 405 781 04 08 доб. 120, эл. почта:
blood@asta.ru, сайт: www.asta.ru.**



См. приложение Б.Н.
"ОТ" - "НО" АСТ