



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

**РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**
от 28 ноября 2022 года № РЗН 2022/18940

На медицинское изделие
Набор ортодонтический IMD®

Настоящее регистрационное удостоверение выдано
Общество с ограниченной ответственностью "ОВК Профи Торг"
(ООО "ОВК Профи Торг"), Россия,
129337, Москва, Ярославское ш., влд. 3, к. 2 стр. 1, ком. 2

Производитель
"Инновейтив Материал энд Девайсес Инк.", Китай,
Innovative Material and Devices Inc., 3rd floor. № 5 plant, № 615 Lane, Fengdeng Rd,
Malu County, Jiading District Shanghai, China

Место производства медицинского изделия
Innovative Material and Devices Inc., 3rd floor. № 5 plant, № 615 Lane, Fengdeng Rd,
Malu County, Jiading District Shanghai, China

Номер регистрационного досье № РД-47523/94765 от 08.02.2022

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 2а

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности 32.50.11.110

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 216 листах

приказом Росздравнадзора от 28 ноября 2022 года № 11205
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0067452

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 28 ноября 2022 года № РЗН 2022/18940

Лист 1

На медицинское изделие

Набор ортодонтический IMD®, в составе:

1. Брекеты, в вариантах исполнения:

1. Брекеты металлические, в вариантах исполнения:

1.1 Брекет металлический Atua Roth Bracket 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, в вариантах исполнения:

- Брекет металлический Atua Roth 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, верхний правый центральный резец - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Atua Roth 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, верхний правый боковой резец - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Atua Roth 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, верхний правый клык без крючка - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Atua Roth 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, верхний правый клык с крючком - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Atua Roth 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, верхний правый первый премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Atua Roth 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, верхний правый первый премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Atua Roth 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, верхний правый второй премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Atua Roth 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, верхний правый второй премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Atua Roth 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, верхний левый центральный резец - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Atua Roth 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, верхний левый боковой резец - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Atua Roth 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, верхний левый клык без крючка - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Atua Roth 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, верхний левый клык с крючком - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Atua Roth 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, верхний левый первый премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Atua Roth 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, верхний левый первый премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Atua Roth 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, верхний левый второй премоляр без крючка - не более 1000 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова



0113147

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 28 ноября 2022 года № РЗН 2022/18940

Лист 2

- Брекет металлический Atua Roth 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, верхний левый второй премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Atua Roth 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, нижний левый центральный резец - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Atua Roth 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, нижний левый боковой резец - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Atua Roth 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, нижний левый клык без крючка - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Atua Roth 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, нижний левый клык с крючком - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Atua Roth 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, нижний левый первый премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Atua Roth 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, нижний левый первый премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Atua Roth 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, нижний левый второй премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Atua Roth 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, нижний левый второй премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Atua Roth 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, нижний правый центральный резец - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Atua Roth 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, нижний правый боковой резец - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Atua Roth 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, нижний правый клык без крючка - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Atua Roth 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, нижний правый клык с крючком - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Atua Roth 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, нижний правый первый премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Atua Roth 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, нижний правый первый премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Atua Roth 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, нижний правый второй премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Atua Roth 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, нижний правый второй премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- 1.2 Брекет металлический Atua Roth Bracket 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, в вариантах исполнения:

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0113148

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 28 ноября 2022 года № РЗН 2022/18940

Лист 3

- Брекет металлический Atua Roth 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, верхний правый центральный резец - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Atua Roth 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, верхний правый боковой резец - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Atua Roth 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, верхний правый клык без крючка - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Atua Roth 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, верхний правый клык с крючком - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Atua Roth 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, верхний правый первый премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Atua Roth 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, верхний правый первый премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Atua Roth 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, верхний правый второй премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Atua Roth 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, верхний правый второй премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Atua Roth 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, верхний левый центральный резец - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Atua Roth 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, верхний левый боковой резец - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Atua Roth 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, верхний левый клык без крючка - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Atua Roth 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, верхний левый клык с крючком - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Atua Roth 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, верхний левый первый премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Atua Roth 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, верхний левый первый премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Atua Roth 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, верхний левый второй премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Atua Roth 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, верхний левый второй премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Atua Roth 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, нижний левый центральный резец - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Atua Roth 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, нижний левый боковой резец - не более 1000 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова



0113149

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 28 ноября 2022 года № РЗН 2022/18940

Лист 4

- Брекет металлический Atua Roth 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, нижний левый клык без крючка - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Atua Roth 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, нижний левый клык с крючком - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Atua Roth 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, нижний левый первый премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Atua Roth 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, нижний левый первый премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Atua Roth 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, нижний левый второй премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Atua Roth 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, нижний левый второй премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Atua Roth 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, нижний правый центральный резец - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Atua Roth 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, нижний правый боковой резец - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Atua Roth 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, нижний правый клык без крючка - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Atua Roth 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, нижний правый клык с крючком - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Atua Roth 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, нижний правый первый премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Atua Roth 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, нижний правый первый премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Atua Roth 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, нижний правый второй премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Atua Roth 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, нижний правый второй премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- 1.3 Брекет металлический Atua McBeTr Bracket 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, в вариантах исполнения:
 - Брекет металлический Atua McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, верхний правый центральный резец - не более 1000 шт.
 - Брекет металлический Atua McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, верхний правый боковой резец - не более 1000 шт.
 - Брекет металлический Atua McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, верхний правый клык без крючка - не более 1000 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0113150

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 28 ноября 2022 года № РЗН 2022/18940

Лист 5

- Брекет металлический Atua McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, верхний правый клык с крючком - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Atua McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, верхний правый первый премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Atua McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, верхний правый первый премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Atua McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, верхний правый второй премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Atua McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, верхний правый второй премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Atua McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, верхний левый центральный резец - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Atua McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, верхний левый боковой резец - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Atua McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, верхний левый клык без крючка - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Atua McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, верхний левый клык с крючком - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Atua McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, верхний левый первый премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Atua McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, верхний левый первый премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Atua McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, верхний левый второй премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Atua McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, верхний левый второй премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Atua McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, нижний левый центральный резец - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Atua McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, нижний левый боковой резец - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Atua McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, нижний левый клык без крючка - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Atua McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, нижний левый клык с крючком - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Atua McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, нижний левый первый премоляр без крючка - не более 1000 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова



0113151

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 28 ноября 2022 года № РЗН 2022/18940

Лист 6

- Брекеты металлические Atua McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, нижний левый первый премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические Atua McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, нижний левый второй премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические Atua McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, нижний левый второй премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические Atua McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, нижний правый центральный резец - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические Atua McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, нижний правый боковой резец - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические Atua McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, нижний правый клык без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические Atua McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, нижний правый клык с крючком - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические Atua McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, нижний правый первый премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические Atua McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, нижний правый первый премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические Atua McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, нижний правый второй премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические Atua McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, нижний правый второй премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- 1.4 Брекеты металлические Atua McBeTr Bracket 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, в вариантах исполнения:
 - Брекеты металлические Atua McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, верхний правый центральный резец - не более 1000 шт.
 - Брекеты металлические Atua McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, верхний правый боковой резец - не более 1000 шт.
 - Брекеты металлические Atua McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, верхний правый клык без крючка - не более 1000 шт.
 - Брекеты металлические Atua McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, верхний правый клык с крючком - не более 1000 шт.
 - Брекеты металлические Atua McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, верхний правый первый премоляр без крючка - не более 1000 шт.
 - Брекеты металлические Atua McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, верхний правый первый премоляр с крючком - не более 1000 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0113152

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 28 ноября 2022 года № РЗН 2022/18940

Лист 7

- Брекет металлический Atua McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, верхний правый второй премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Atua McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, верхний правый второй премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Atua McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, верхний левый центральный резец - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Atua McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, верхний левый боковой резец - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Atua McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, верхний левый клык без крючка - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Atua McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, верхний левый клык с крючком - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Atua McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, верхний левый первый премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Atua McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, верхний левый первый премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Atua McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, верхний левый второй премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Atua McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, верхний левый второй премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Atua McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, нижний левый центральный резец - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Atua McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, нижний левый боковой резец - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Atua McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, нижний левый клык без крючка - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Atua McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, нижний левый клык с крючком - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Atua McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, нижний левый первый премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Atua McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, нижний левый первый премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Atua McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, нижний левый второй премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Atua McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, нижний левый второй премоляр с крючком - не более 1000 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0113153

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 28 ноября 2022 года № РЗН 2022/18940

Лист 8

- Брекеты металлические Atua McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, нижний правый центральный резец - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические Atua McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, нижний правый боковой резец - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические Atua McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, нижний правый клык без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические Atua McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, нижний правый клык с крючком - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические Atua McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, нижний правый первый премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические Atua McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, нижний правый первый премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические Atua McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, нижний правый второй премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические Atua McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, нижний правый второй премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- 1.5 Брекеты металлические Ophro Edgewise Bracket 0,018 дюймов (0,46 мм) Standard, в вариантах исполнения:
 - Брекеты металлические Ophro Edgewise 0,018 дюймов (0,46 мм) Standard, верхний правый центральный резец - не более 1000 шт.
 - Брекеты металлические Ophro Edgewise 0,018 дюймов (0,46 мм) Standard, верхний правый боковой резец - не более 1000 шт.
 - Брекеты металлические Ophro Edgewise 0,018 дюймов (0,46 мм) Standard, верхний правый клык без крючка - не более 1000 шт.
 - Брекеты металлические Ophro Edgewise 0,018 дюймов (0,46 мм) Standard, верхний правый клык с крючком - не более 1000 шт.
 - Брекеты металлические Ophro Edgewise 0,018 дюймов (0,46 мм) Standard, верхний правый первый премоляр без крючка - не более 1000 шт.
 - Брекеты металлические Ophro Edgewise 0,018 дюймов (0,46 мм) Standard, верхний правый первый премоляр с крючком - не более 1000 шт.
 - Брекеты металлические Ophro Edgewise 0,018 дюймов (0,46 мм) Standard, верхний правый второй премоляр без крючка - не более 1000 шт.
 - Брекеты металлические Ophro Edgewise 0,018 дюймов (0,46 мм) Standard, верхний правый второй премоляр с крючком - не более 1000 шт.
 - Брекеты металлические Ophro Edgewise 0,018 дюймов (0,46 мм) Standard, верхний левый центральный резец - не более 1000 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0113154

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 28 ноября 2022 года № РЗН 2022/18940

Лист 9

- Брекеты металлические Ophro Edgewise 0,018 дюймов (0,46 мм) Standard, верхний левый боковой резец - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические Ophro Edgewise 0,018 дюймов (0,46 мм) Standard, верхний левый клык без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические Ophro Edgewise 0,018 дюймов (0,46 мм) Standard, верхний левый клык с крючком - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические Ophro Edgewise 0,018 дюймов (0,46 мм) Standard, верхний левый первый премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические Ophro Edgewise 0,018 дюймов (0,46 мм) Standard, верхний левый первый премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические Ophro Edgewise 0,018 дюймов (0,46 мм) Standard, верхний левый второй премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические Ophro Edgewise 0,018 дюймов (0,46 мм) Standard, верхний левый второй премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические Ophro Edgewise 0,018 дюймов (0,46 мм) Standard, нижний левый центральный резец - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические Ophro Edgewise 0,018 дюймов (0,46 мм) Standard, нижний левый боковой резец - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические Ophro Edgewise 0,018 дюймов (0,46 мм) Standard, нижний левый клык без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические Ophro Edgewise 0,018 дюймов (0,46 мм) Standard, нижний левый клык с крючком - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические Ophro Edgewise 0,018 дюймов (0,46 мм) Standard, нижний левый первый премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические Ophro Edgewise 0,018 дюймов (0,46 мм) Standard, нижний левый первый премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические Ophro Edgewise 0,018 дюймов (0,46 мм) Standard, нижний левый второй премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические Ophro Edgewise 0,018 дюймов (0,46 мм) Standard, нижний левый второй премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические Ophro Edgewise 0,018 дюймов (0,46 мм) Standard, нижний правый центральный резец - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические Ophro Edgewise 0,018 дюймов (0,46 мм) Standard, нижний правый боковой резец - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические Ophro Edgewise 0,018 дюймов (0,46 мм) Standard, нижний правый клык без крючка - не более 1000 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0113155

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 28 ноября 2022 года № РЗН 2022/18940

Лист 10

- Брекеты металлические Ophro Edgewise 0,018 дюймов (0,46 мм) Standard, нижний правый клык с крючком - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические Ophro Edgewise 0,018 дюймов (0,46 мм) Standard, нижний правый первый премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические Ophro Edgewise 0,018 дюймов (0,46 мм) Standard, нижний правый первый премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические Ophro Edgewise 0,018 дюймов (0,46 мм) Standard, нижний правый второй премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические Ophro Edgewise 0,018 дюймов (0,46 мм) Standard, нижний правый второй премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- 1.6 Брекеты металлические Ophro Edgewise Bracket 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, в вариантах исполнения:
 - Брекеты металлические Ophro Edgewise 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, верхний правый центральный резец - не более 1000 шт.
 - Брекеты металлические Ophro Edgewise 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, верхний правый боковой резец - не более 1000 шт.
 - Брекеты металлические Ophro Edgewise 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, верхний правый клык без крючка - не более 1000 шт.
 - Брекеты металлические Ophro Edgewise 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, верхний правый клык с крючком - не более 1000 шт.
 - Брекеты металлические Ophro Edgewise 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, верхний правый первый премоляр без крючка - не более 1000 шт.
 - Брекеты металлические Ophro Edgewise 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, верхний правый первый премоляр с крючком - не более 1000 шт.
 - Брекеты металлические Ophro Edgewise 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, верхний правый второй премоляр без крючка - не более 1000 шт.
 - Брекеты металлические Ophro Edgewise 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, верхний правый второй премоляр с крючком - не более 1000 шт.
 - Брекеты металлические Ophro Edgewise 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, верхний левый центральный резец - не более 1000 шт.
 - Брекеты металлические Ophro Edgewise 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, верхний левый боковой резец - не более 1000 шт.
 - Брекеты металлические Ophro Edgewise 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, верхний левый клык без крючка - не более 1000 шт.
 - Брекеты металлические Ophro Edgewise 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, верхний левый клык с крючком - не более 1000 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0113156

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 28 ноября 2022 года № РЗН 2022/18940

Лист 11

- Брекет металлический Ophro Edgewise 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, верхний левый первый премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Ophro Edgewise 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, верхний левый первый премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Ophro Edgewise 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, верхний левый второй премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Ophro Edgewise 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, верхний левый второй премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Ophro Edgewise 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, нижний левый центральный резец - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Ophro Edgewise 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, нижний левый боковой резец - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Ophro Edgewise 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, нижний левый клык без крючка - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Ophro Edgewise 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, нижний левый клык с крючком - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Ophro Edgewise 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, нижний левый первый премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Ophro Edgewise 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, нижний левый первый премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Ophro Edgewise 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, нижний левый второй премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Ophro Edgewise 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, нижний левый второй премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Ophro Edgewise 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, нижний правый центральный резец - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Ophro Edgewise 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, нижний правый боковой резец - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Ophro Edgewise 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, нижний правый клык без крючка - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Ophro Edgewise 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, нижний правый клык с крючком - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Ophro Edgewise 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, нижний правый первый премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Ophro Edgewise 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, нижний правый первый премоляр с крючком - не более 1000 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0113157

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 28 ноября 2022 года № РЗН 2022/18940

Лист 12

- Брекеты металлические Ophro Edgewise 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, нижний правый второй премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические Ophro Edgewise 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, нижний правый второй премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- 1.7 Брекеты металлические Ophro Edgewise Bracket 0,022 дюйма (0,56 мм) Standard, в вариантах исполнения:
 - Брекеты металлические Ophro Edgewise 0,022 дюйма (0,56 мм) Standard, верхний правый центральный резец - не более 1000 шт.
 - Брекеты металлические Ophro Edgewise 0,022 дюйма (0,56 мм) Standard, верхний правый боковой резец - не более 1000 шт.
 - Брекеты металлические Ophro Edgewise 0,022 дюйма (0,56 мм) Standard, верхний правый клык без крючка - не более 1000 шт.
 - Брекеты металлические Ophro Edgewise 0,022 дюйма (0,56 мм) Standard, верхний правый клык с крючком - не более 1000 шт.
 - Брекеты металлические Ophro Edgewise 0,022 дюйма (0,56 мм) Standard, верхний правый первый премоляр без крючка - не более 1000 шт.
 - Брекеты металлические Ophro Edgewise 0,022 дюйма (0,56 мм) Standard, верхний правый первый премоляр с крючком - не более 1000 шт.
 - Брекеты металлические Ophro Edgewise 0,022 дюйма (0,56 мм) Standard, верхний правый второй премоляр без крючка - не более 1000 шт.
 - Брекеты металлические Ophro Edgewise 0,022 дюйма (0,56 мм) Standard, верхний правый второй премоляр с крючком - не более 1000 шт.
 - Брекеты металлические Ophro Edgewise 0,022 дюйма (0,56 мм) Standard, верхний левый центральный резец - не более 1000 шт.
 - Брекеты металлические Ophro Edgewise 0,022 дюйма (0,56 мм) Standard, верхний левый боковой резец - не более 1000 шт.
 - Брекеты металлические Ophro Edgewise 0,022 дюйма (0,56 мм) Standard, верхний левый клык без крючка - не более 1000 шт.
 - Брекеты металлические Ophro Edgewise 0,022 дюйма (0,56 мм) Standard, верхний левый клык с крючком - не более 1000 шт.
 - Брекеты металлические Ophro Edgewise 0,022 дюйма (0,56 мм) Standard, верхний левый первый премоляр без крючка - не более 1000 шт.
 - Брекеты металлические Ophro Edgewise 0,022 дюйма (0,56 мм) Standard, верхний левый первый премоляр с крючком - не более 1000 шт.
 - Брекеты металлические Ophro Edgewise 0,022 дюйма (0,56 мм) Standard, верхний левый второй премоляр без крючка - не более 1000 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0113158

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 28 ноября 2022 года № РЗН 2022/18940

Лист 13

- Брекет металлический Ophro Edgewise 0,022 дюйма (0,56 мм) Standard, верхний левый второй премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Ophro Edgewise 0,022 дюйма (0,56 мм) Standard, нижний левый центральный резец - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Ophro Edgewise 0,022 дюйма (0,56 мм) Standard, нижний левый боковой резец - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Ophro Edgewise 0,022 дюйма (0,56 мм) Standard, нижний левый клык без крючка - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Ophro Edgewise 0,022 дюйма (0,56 мм) Standard, нижний левый клык с крючком - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Ophro Edgewise 0,022 дюйма (0,56 мм) Standard, нижний левый первый премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Ophro Edgewise 0,022 дюйма (0,56 мм) Standard, нижний левый первый премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Ophro Edgewise 0,022 дюйма (0,56 мм) Standard, нижний левый второй премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Ophro Edgewise 0,022 дюйма (0,56 мм) Standard, нижний левый второй премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Ophro Edgewise 0,022 дюйма (0,56 мм) Standard, нижний правый центральный резец - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Ophro Edgewise 0,022 дюйма (0,56 мм) Standard, нижний правый боковой резец - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Ophro Edgewise 0,022 дюйма (0,56 мм) Standard, нижний правый клык без крючка - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Ophro Edgewise 0,022 дюйма (0,56 мм) Standard, нижний правый клык с крючком - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Ophro Edgewise 0,022 дюйма (0,56 мм) Standard, нижний правый первый премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Ophro Edgewise 0,022 дюйма (0,56 мм) Standard, нижний правый первый премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Ophro Edgewise 0,022 дюйма (0,56 мм) Standard, нижний правый второй премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Ophro Edgewise 0,022 дюйма (0,56 мм) Standard, нижний правый второй премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- 1.8 Брекет металлический Ophro Edgewise Bracket 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, в вариантах исполнения:

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0113159

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ


от 28 ноября 2022 года № РЗН 2022/18940

Лист 14

- Брекеты металлические Ophro Edgewise 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, верхний правый центральный резец - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические Ophro Edgewise 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, верхний правый боковой резец - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические Ophro Edgewise 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, верхний правый клык без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические Ophro Edgewise 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, верхний правый клык с крючком - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические Ophro Edgewise 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, верхний правый первый премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические Ophro Edgewise 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, верхний правый первый премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические Ophro Edgewise 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, верхний правый второй премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические Ophro Edgewise 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, верхний правый второй премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические Ophro Edgewise 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, верхний левый центральный резец - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические Ophro Edgewise 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, верхний левый боковой резец - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические Ophro Edgewise 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, верхний левый клык без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические Ophro Edgewise 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, верхний левый клык с крючком - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические Ophro Edgewise 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, верхний левый первый премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические Ophro Edgewise 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, верхний левый первый премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические Ophro Edgewise 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, верхний левый второй премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические Ophro Edgewise 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, верхний левый второй премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические Ophro Edgewise 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, нижний левый центральный резец - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические Ophro Edgewise 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, нижний левый боковой резец - не более 1000 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

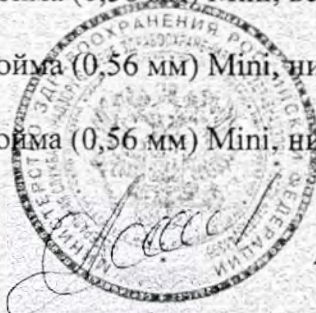

0113160

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 28 ноября 2022 года № РЗН 2022/18940

Лист 15

- Брекеты металлические Ophro Edgewise 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, нижний левый клык без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические Ophro Edgewise 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, нижний левый клык с крючком - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические Ophro Edgewise 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, нижний левый первый премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические Ophro Edgewise 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, нижний левый первый премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические Ophro Edgewise 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, нижний левый второй премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические Ophro Edgewise 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, нижний левый второй премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические Ophro Edgewise 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, нижний правый центральный резец - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические Ophro Edgewise 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, нижний правый боковой резец - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические Ophro Edgewise 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, нижний правый клык без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические Ophro Edgewise 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, нижний правый клык с крючком - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические Ophro Edgewise 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, нижний правый первый премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические Ophro Edgewise 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, нижний правый первый премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические Ophro Edgewise 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, нижний правый второй премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические Ophro Edgewise 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, нижний правый второй премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- 1.9 Брекеты металлические Ophro Roth Bracket 0,018 дюймов (0,46 мм) Standard, в вариантах исполнения:
 - Брекеты металлические Ophro Roth 0,018 дюймов (0,46 мм) Standard, верхний правый центральный резец - не более 1000 шт.
 - Брекеты металлические Ophro Roth 0,018 дюймов (0,46 мм) Standard, верхний правый боковой резец - не более 1000 шт.
 - Брекеты металлические Ophro Roth 0,018 дюймов (0,46 мм) Standard, верхний правый клык без крючка - не более 1000 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0113161

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 28 ноября 2022 года № РЗН 2022/18940

Лист 16

- Брекет металлический Ophro Roth 0,018 дюймов (0,46 мм) Standard, верхний правый клык с крючком - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Ophro Roth 0,018 дюймов (0,46 мм) Standard, верхний правый первый премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Ophro Roth 0,018 дюймов (0,46 мм) Standard, верхний правый первый премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Ophro Roth 0,018 дюймов (0,46 мм) Standard, верхний правый второй премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Ophro Roth 0,018 дюймов (0,46 мм) Standard, верхний правый второй премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Ophro Roth 0,018 дюймов (0,46 мм) Standard, верхний левый центральный резец - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Ophro Roth 0,018 дюймов (0,46 мм) Standard, верхний левый боковой резец - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Ophro Roth 0,018 дюймов (0,46 мм) Standard, верхний левый клык без крючка - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Ophro Roth 0,018 дюймов (0,46 мм) Standard, верхний левый клык с крючком - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Ophro Roth 0,018 дюймов (0,46 мм) Standard, верхний левый первый премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Ophro Roth 0,018 дюймов (0,46 мм) Standard, верхний левый первый премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Ophro Roth 0,018 дюймов (0,46 мм) Standard, верхний левый второй премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Ophro Roth 0,018 дюймов (0,46 мм) Standard, верхний левый второй премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Ophro Roth 0,018 дюймов (0,46 мм) Standard, нижний левый центральный резец - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Ophro Roth 0,018 дюймов (0,46 мм) Standard, нижний левый боковой резец - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Ophro Roth 0,018 дюймов (0,46 мм) Standard, нижний левый клык без крючка - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Ophro Roth 0,018 дюймов (0,46 мм) Standard, нижний левый клык с крючком - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Ophro Roth 0,018 дюймов (0,46 мм) Standard, нижний левый первый премоляр без крючка - не более 1000 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0113162

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 28 ноября 2022 года № РЗН 2022/18940

Лист 17

- Брекет металлический Ophro Roth 0,018 дюймов (0,46 мм) Standard, нижний левый первый премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Ophro Roth 0,018 дюймов (0,46 мм) Standard, нижний левый второй премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Ophro Roth 0,018 дюймов (0,46 мм) Standard, нижний левый второй премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Ophro Roth 0,018 дюймов (0,46 мм) Standard, нижний правый центральный резец - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Ophro Roth 0,018 дюймов (0,46 мм) Standard, нижний правый боковой резец - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Ophro Roth 0,018 дюймов (0,46 мм) Standard, нижний правый клык без крючка - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Ophro Roth 0,018 дюймов (0,46 мм) Standard, нижний правый клык с крючком - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Ophro Roth 0,018 дюймов (0,46 мм) Standard, нижний правый первый премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Ophro Roth 0,018 дюймов (0,46 мм) Standard, нижний правый первый премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Ophro Roth 0,018 дюймов (0,46 мм) Standard, нижний правый второй премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Ophro Roth 0,018 дюймов (0,46 мм) Standard, нижний правый второй премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- 1.10 Брекет металлический Ophro Roth Bracket 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, в вариантах исполнения:
 - Брекет металлический Ophro Roth 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, верхний правый центральный резец - не более 1000 шт.
 - Брекет металлический Ophro Roth 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, верхний правый боковой резец - не более 1000 шт.
 - Брекет металлический Ophro Roth 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, верхний правый клык без крючка - не более 1000 шт.
 - Брекет металлический Ophro Roth 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, верхний правый клык с крючком - не более 1000 шт.
 - Брекет металлический Ophro Roth 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, верхний правый первый премоляр без крючка - не более 1000 шт.
 - Брекет металлический Ophro Roth 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, верхний правый первый премоляр с крючком - не более 1000 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0113163

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 28 ноября 2022 года № РЗН 2022/18940

Лист 18

- Брекет металлический Ophro Roth 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, верхний правый второй премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Ophro Roth 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, верхний правый второй премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Ophro Roth 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, верхний левый центральный резец - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Ophro Roth 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, верхний левый боковой резец - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Ophro Roth 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, верхний левый клык без крючка - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Ophro Roth 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, верхний левый клык с крючком - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Ophro Roth 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, верхний левый первый премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Ophro Roth 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, верхний левый первый премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Ophro Roth 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, верхний левый второй премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Ophro Roth 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, верхний левый второй премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Ophro Roth 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, нижний левый центральный резец - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Ophro Roth 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, нижний левый боковой резец - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Ophro Roth 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, нижний левый клык без крючка - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Ophro Roth 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, нижний левый клык с крючком - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Ophro Roth 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, нижний левый первый премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Ophro Roth 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, нижний левый первый премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Ophro Roth 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, нижний левый второй премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Ophro Roth 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, нижний левый второй премоляр с крючком - не более 1000 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0113164


**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 28 ноября 2022 года № РЗН 2022/18940

Лист 19

- Брекеты металлические Ophro Roth 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, нижний правый центральный резец - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические Ophro Roth 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, нижний правый боковой резец - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические Ophro Roth 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, нижний правый клык без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические Ophro Roth 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, нижний правый клык с крючком - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические Ophro Roth 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, нижний правый первый премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические Ophro Roth 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, нижний правый первый премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические Ophro Roth 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, нижний правый второй премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические Ophro Roth 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, нижний правый второй премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- 1.11 Брекеты металлические Ophro Roth Bracket 0,022 дюйма (0,56 мм) Standard, в вариантах исполнения:
 - Брекеты металлические Ophro Roth 0,022 дюйма (0,56 мм) Standard, верхний правый центральный резец - не более 1000 шт.
 - Брекеты металлические Ophro Roth 0,022 дюйма (0,56 мм) Standard, верхний правый боковой резец - не более 1000 шт.
 - Брекеты металлические Ophro Roth 0,022 дюйма (0,56 мм) Standard, верхний правый клык без крючка - не более 1000 шт.
 - Брекеты металлические Ophro Roth 0,022 дюйма (0,56 мм) Standard, верхний правый клык с крючком - не более 1000 шт.
 - Брекеты металлические Ophro Roth 0,022 дюйма (0,56 мм) Standard, верхний правый первый премоляр без крючка - не более 1000 шт.
 - Брекеты металлические Ophro Roth 0,022 дюйма (0,56 мм) Standard, верхний правый первый премоляр с крючком - не более 1000 шт.
 - Брекеты металлические Ophro Roth 0,022 дюйма (0,56 мм) Standard, верхний правый второй премоляр без крючка - не более 1000 шт.
 - Брекеты металлические Ophro Roth 0,022 дюйма (0,56 мм) Standard, верхний правый второй премоляр с крючком - не более 1000 шт.
 - Брекеты металлические Ophro Roth 0,022 дюйма (0,56 мм) Standard, верхний левый центральный резец - не более 1000 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

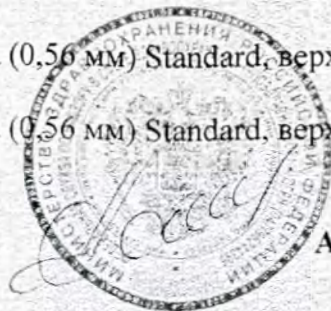

А.В. Самойлова

0113165

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 28 ноября 2022 года № РЗН 2022/18940

Лист 20

- Брекет металлический Ophro Roth 0,022 дюйма (0,56 мм) Standard, верхний левый боковой резец - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Ophro Roth 0,022 дюйма (0,56 мм) Standard, верхний левый клык без крючка - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Ophro Roth 0,022 дюйма (0,56 мм) Standard, верхний левый клык с крючком - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Ophro Roth 0,022 дюйма (0,56 мм) Standard, верхний левый первый премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Ophro Roth 0,022 дюйма (0,56 мм) Standard, верхний левый первый премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Ophro Roth 0,022 дюйма (0,56 мм) Standard, верхний левый второй премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Ophro Roth 0,022 дюйма (0,56 мм) Standard, верхний левый второй премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Ophro Roth 0,022 дюйма (0,56 мм) Standard, нижний левый центральный резец - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Ophro Roth 0,022 дюйма (0,56 мм) Standard, нижний левый боковой резец - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Ophro Roth 0,022 дюйма (0,56 мм) Standard, нижний левый клык без крючка - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Ophro Roth 0,022 дюйма (0,56 мм) Standard, нижний левый клык с крючком - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Ophro Roth 0,022 дюйма (0,56 мм) Standard, нижний левый первый премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Ophro Roth 0,022 дюйма (0,56 мм) Standard, нижний левый первый премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Ophro Roth 0,022 дюйма (0,56 мм) Standard, нижний левый второй премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Ophro Roth 0,022 дюйма (0,56 мм) Standard, нижний левый второй премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Ophro Roth 0,022 дюйма (0,56 мм) Standard, нижний правый центральный резец - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Ophro Roth 0,022 дюйма (0,56 мм) Standard, нижний правый боковой резец - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Ophro Roth 0,022 дюйма (0,56 мм) Standard, нижний правый клык без крючка - не более 1000 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0113166

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 28 ноября 2022 года № РЗН 2022/18940

Лист 21

- Брекеты металлические Ophro Roth 0,022 дюйма (0,56 мм) Standard, нижний правый клык с крючком - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические Ophro Roth 0,022 дюйма (0,56 мм) Standard, нижний правый первый премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические Ophro Roth 0,022 дюйма (0,56 мм) Standard, нижний правый первый премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические Ophro Roth 0,022 дюйма (0,56 мм) Standard, нижний правый второй премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические Ophro Roth 0,022 дюйма (0,56 мм) Standard, нижний правый второй премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- 1.12 Брекеты металлические Ophro Roth Bracket 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, в вариантах исполнения:
 - Брекеты металлические Ophro Roth 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, верхний правый центральный резец - не более 1000 шт.
 - Брекеты металлические Ophro Roth 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, верхний правый боковой резец - не более 1000 шт.
 - Брекеты металлические Ophro Roth 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, верхний правый клык без крючка - не более 1000 шт.
 - Брекеты металлические Ophro Roth 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, верхний правый клык с крючком - не более 1000 шт.
 - Брекеты металлические Ophro Roth 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, верхний правый первый премоляр без крючка - не более 1000 шт.
 - Брекеты металлические Ophro Roth 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, верхний правый первый премоляр с крючком - не более 1000 шт.
 - Брекеты металлические Ophro Roth 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, верхний правый второй премоляр без крючка - не более 1000 шт.
 - Брекеты металлические Ophro Roth 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, верхний правый второй премоляр с крючком - не более 1000 шт.
 - Брекеты металлические Ophro Roth 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, верхний левый центральный резец - не более 1000 шт.
 - Брекеты металлические Ophro Roth 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, верхний левый боковой резец - не более 1000 шт.
 - Брекеты металлические Ophro Roth 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, верхний левый клык без крючка - не более 1000 шт.
 - Брекеты металлические Ophro Roth 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, верхний левый клык с крючком - не более 1000 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0113167

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 28 ноября 2022 года № РЗН 2022/18940

Лист 22

- Брекет металлический Ophro Roth 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, верхний левый первый премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Ophro Roth 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, верхний левый первый премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Ophro Roth 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, верхний левый второй премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Ophro Roth 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, верхний левый второй премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Ophro Roth 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, нижний левый центральный резец - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Ophro Roth 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, нижний левый боковой резец - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Ophro Roth 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, нижний левый клык без крючка - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Ophro Roth 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, нижний левый клык с крючком - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Ophro Roth 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, нижний левый первый премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Ophro Roth 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, нижний левый первый премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Ophro Roth 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, нижний левый второй премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Ophro Roth 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, нижний левый второй премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Ophro Roth 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, нижний правый центральный резец - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Ophro Roth 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, нижний правый боковой резец - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Ophro Roth 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, нижний правый клык без крючка - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Ophro Roth 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, нижний правый клык с крючком - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Ophro Roth 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, нижний правый первый премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Ophro Roth 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, нижний правый первый премоляр с крючком - не более 1000 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0113168

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 28 ноября 2022 года № РЗН 2022/18940

Лист 23

- Брекет металлический Ophro Roth 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, нижний правый второй премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Ophro Roth 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, нижний правый второй премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- 1.13 Брекет металлический Ophro McBeTr Bracket 0,018 дюймов (0,46 мм) Standard, в вариантах исполнения:
 - Брекет металлический Ophro McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм) Standard, верхний правый центральный резец - не более 1000 шт.
 - Брекет металлический Ophro McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм) Standard, верхний правый боковой резец - не более 1000 шт.
 - Брекет металлический Ophro McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм) Standard, верхний правый клык без крючка - не более 1000 шт.
 - Брекет металлический Ophro McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм) Standard, верхний правый клык с крючком - не более 1000 шт.
 - Брекет металлический Ophro McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм) Standard, верхний правый первый премоляр без крючка - не более 1000 шт.
 - Брекет металлический Ophro McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм) Standard, верхний правый первый премоляр с крючком - не более 1000 шт.
 - Брекет металлический Ophro McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм) Standard, верхний правый второй премоляр без крючка - не более 1000 шт.
 - Брекет металлический Ophro McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм) Standard, верхний правый второй премоляр с крючком - не более 1000 шт.
 - Брекет металлический Ophro McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм) Standard, верхний левый центральный резец - не более 1000 шт.
 - Брекет металлический Ophro McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм) Standard, верхний левый боковой резец - не более 1000 шт.
 - Брекет металлический Ophro McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм) Standard, верхний левый клык без крючка - не более 1000 шт.
 - Брекет металлический Ophro McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм) Standard, верхний левый клык с крючком - не более 1000 шт.
 - Брекет металлический Ophro McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм) Standard, верхний левый первый премоляр без крючка - не более 1000 шт.
 - Брекет металлический Ophro McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм) Standard, верхний левый первый премоляр с крючком - не более 1000 шт.
 - Брекет металлический Ophro McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм) Standard, верхний левый второй премоляр без крючка - не более 1000 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0113169

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 28 ноября 2022 года № РЗН 2022/18940

Лист 24

- Брекеты металлические Ophro McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм) Standard, верхний левый второй премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические Ophro McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм) Standard, нижний левый центральный резец - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические Ophro McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм) Standard, нижний левый боковой резец - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические Ophro McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм) Standard, нижний левый клык без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические Ophro McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм) Standard, нижний левый клык с крючком - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические Ophro McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм) Standard, нижний левый первый премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические Ophro McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм) Standard, нижний левый первый премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические Ophro McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм) Standard, нижний левый второй премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические Ophro McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм) Standard, нижний левый второй премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические Ophro McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм) Standard, нижний правый центральный резец - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические Ophro McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм) Standard, нижний правый боковой резец - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические Ophro McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм) Standard, нижний правый клык без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические Ophro McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм) Standard, нижний правый клык с крючком - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические Ophro McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм) Standard, нижний правый первый премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические Ophro McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм) Standard, нижний правый первый премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические Ophro McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм) Standard, нижний правый второй премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические Ophro McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм) Standard, нижний правый второй премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- 1.14 Брекеты металлические Ophro McBeTr Bracket 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, в вариантах исполнения:

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0113170


**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 28 ноября 2022 года № РЗН 2022/18940

Лист 25

- Брекет металлический Ophro McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, верхний правый центральный резец - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Ophro McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, верхний правый боковой резец - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Ophro McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, верхний правый клык без крючка - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Ophro McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, верхний правый клык с крючком - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Ophro McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, верхний правый первый премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Ophro McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, верхний правый первый премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Ophro McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, верхний правый второй премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Ophro McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, верхний правый второй премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Ophro McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, верхний левый центральный резец - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Ophro McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, верхний левый боковой резец - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Ophro McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, верхний левый клык без крючка - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Ophro McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, верхний левый клык с крючком - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Ophro McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, верхний левый первый премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Ophro McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, верхний левый первый премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Ophro McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, верхний левый второй премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Ophro McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, верхний левый второй премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Ophro McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, нижний левый центральный резец - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Ophro McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, нижний левый боковой резец - не более 1000 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

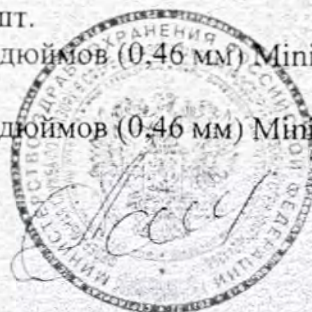

А.В. Самойлова

0113171


**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 28 ноября 2022 года № РЗН 2022/18940

Лист 26

- Брекеты металлические Ophro McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, нижний левый клык без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические Ophro McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, нижний левый клык с крючком - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические Ophro McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, нижний левый первый премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические Ophro McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, нижний левый первый премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические Ophro McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, нижний левый второй премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические Ophro McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, нижний левый второй премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические Ophro McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, нижний правый центральный резец - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические Ophro McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, нижний правый боковой резец - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические Ophro McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, нижний правый клык без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические Ophro McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, нижний правый клык с крючком - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические Ophro McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, нижний правый первый премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические Ophro McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, нижний правый первый премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические Ophro McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, нижний правый второй премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические Ophro McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, нижний правый второй премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- 1.15 Брекеты металлические Ophro McBeTr Bracket 0,022 дюйма (0,56 мм) Standard, в вариантах исполнения:
 - Брекеты металлические Ophro McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм) Standard, верхний правый центральный резец - не более 1000 шт.
 - Брекеты металлические Ophro McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм) Standard, верхний правый боковой резец - не более 1000 шт.
 - Брекеты металлические Ophro McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм) Standard, верхний правый клык без крючка - не более 1000 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

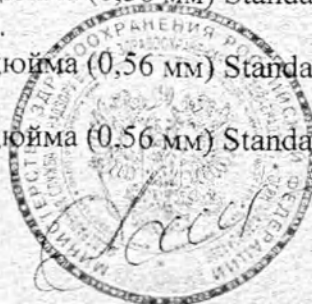

А.В. Самойлова

0113172

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 28 ноября 2022 года № РЗН 2022/18940

Лист 27

- Брекеты металлические Ophro McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм) Standard, верхний правый клык с крючком - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические Ophro McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм) Standard, верхний правый первый премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические Ophro McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм) Standard, верхний правый первый премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические Ophro McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм) Standard, верхний правый второй премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические Ophro McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм) Standard, верхний правый второй премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические Ophro McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм) Standard, верхний левый центральный резец - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические Ophro McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм) Standard, верхний левый боковой резец - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические Ophro McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм) Standard, верхний левый клык без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические Ophro McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм) Standard, верхний левый клык с крючком - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические Ophro McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм) Standard, верхний левый первый премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические Ophro McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм) Standard, верхний левый первый премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические Ophro McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм) Standard, верхний левый второй премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические Ophro McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм) Standard, верхний левый второй премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические Ophro McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм) Standard, нижний левый центральный резец - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические Ophro McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм) Standard, нижний левый боковой резец - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические Ophro McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм) Standard, нижний левый клык без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические Ophro McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм) Standard, нижний левый клык с крючком - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические Ophro McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм) Standard, нижний левый первый премоляр без крючка - не более 1000 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0113173

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 28 ноября 2022 года № РЗН 2022/18940

Лист 28

- Брекеты металлические Ophro McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм) Standard, нижний левый первый премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические Ophro McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм) Standard, нижний левый второй премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические Ophro McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм) Standard, нижний левый второй премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические Ophro McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм) Standard, нижний правый центральный резец - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические Ophro McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм) Standard, нижний правый боковой резец - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические Ophro McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм) Standard, нижний правый клык без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические Ophro McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм) Standard, нижний правый клык с крючком - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические Ophro McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм) Standard, нижний правый первый премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические Ophro McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм) Standard, нижний правый первый премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические Ophro McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм) Standard, нижний правый второй премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические Ophro McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм) Standard, нижний правый второй премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- 1.16 Брекеты металлические Ophro McBeTr Bracket 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, в вариантах исполнения:
 - Брекеты металлические Ophro McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, верхний правый центральный резец - не более 1000 шт.
 - Брекеты металлические Ophro McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, верхний правый боковой резец - не более 1000 шт.
 - Брекеты металлические Ophro McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, верхний правый клык без крючка - не более 1000 шт.
 - Брекеты металлические Ophro McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, верхний правый клык с крючком - не более 1000 шт.
 - Брекеты металлические Ophro McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, верхний правый первый премоляр без крючка - не более 1000 шт.
 - Брекеты металлические Ophro McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, верхний правый первый премоляр с крючком - не более 1000 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0113174

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 28 ноября 2022 года № РЗН 2022/18940

Лист 29

- Брекет металлический Ophro McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, верхний правый второй премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Ophro McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, верхний правый второй премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Ophro McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, верхний левый центральный резец - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Ophro McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, верхний левый боковой резец - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Ophro McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, верхний левый клык без крючка - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Ophro McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, верхний левый клык с крючком - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Ophro McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, верхний левый первый премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Ophro McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, верхний левый первый премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Ophro McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, верхний левый второй премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Ophro McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, верхний левый второй премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Ophro McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, нижний левый центральный резец - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Ophro McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, нижний левый боковой резец - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Ophro McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, нижний левый клык без крючка - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Ophro McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, нижний левый клык с крючком - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Ophro McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, нижний левый первый премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Ophro McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, нижний левый первый премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Ophro McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, нижний левый второй премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Ophro McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, нижний левый второй премоляр с крючком - не более 1000 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0113175

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 28 ноября 2022 года № РЗН 2022/18940

Лист 30

- Брекет металлический Ophro McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, нижний правый центральный резец - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Ophro McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, нижний правый боковой резец - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Ophro McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, нижний правый клык без крючка - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Ophro McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, нижний правый клык с крючком - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Ophro McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, нижний правый первый премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Ophro McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, нижний правый первый премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Ophro McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, нижний правый второй премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Ophro McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, нижний правый второй премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- 1.17 Брекет металлический Mini-Arch Ophro McBeTr Bracket 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, в вариантах исполнения:
 - Брекет металлический Mini-Arch Ophro McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, верхний правый центральный резец - не более 1000 шт.
 - Брекет металлический Mini-Arch Ophro McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, верхний правый боковой резец - не более 1000 шт.
 - Брекет металлический Mini-Arch Ophro McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, верхний правый клык без крючка - не более 1000 шт.
 - Брекет металлический Mini-Arch Ophro McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, верхний правый клык с крючком - не более 1000 шт.
 - Брекет металлический Mini-Arch Ophro McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, верхний правый первый премоляр без крючка - не более 1000 шт.
 - Брекет металлический Mini-Arch Ophro McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, верхний правый первый премоляр с крючком - не более 1000 шт.
 - Брекет металлический Mini-Arch Ophro McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, верхний правый второй премоляр без крючка - не более 1000 шт.
 - Брекет металлический Mini-Arch Ophro McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, верхний правый второй премоляр с крючком - не более 1000 шт.
 - Брекет металлический Mini-Arch Ophro McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, верхний левый центральный резец - не более 1000 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0113176

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 28 ноября 2022 года № РЗН 2022/18940

Лист 31

- Брекеты металлические Mini-Arch Ophro McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, верхний левый боковой резец - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические Mini-Arch Ophro McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, верхний левый клык без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические Mini-Arch Ophro McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, верхний левый клык с крючком - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические Mini-Arch Ophro McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, верхний левый первый премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические Mini-Arch Ophro McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, верхний левый первый премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические Mini-Arch Ophro McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, верхний левый второй премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические Mini-Arch Ophro McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, верхний левый второй премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические Mini-Arch Ophro McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, нижний левый центральный резец - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические Mini-Arch Ophro McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, нижний левый боковой резец - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические Mini-Arch Ophro McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, нижний левый клык без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические Mini-Arch Ophro McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, нижний левый клык с крючком - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические Mini-Arch Ophro McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, нижний левый первый премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические Mini-Arch Ophro McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, нижний левый первый премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические Mini-Arch Ophro McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, нижний левый второй премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические Mini-Arch Ophro McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, нижний левый второй премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические Mini-Arch Ophro McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, нижний правый центральный резец - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические Mini-Arch Ophro McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, нижний правый боковой резец - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические Mini-Arch Ophro McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, нижний правый клык без крючка - не более 1000 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0113177

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 28 ноября 2022 года № РЗН 2022/18940

Лист 32

- Брекет металлический Mini-Arch Ophro McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, нижний правый клык с крючком - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Mini-Arch Ophro McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, нижний правый первый премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Mini-Arch Ophro McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, нижний правый первый премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Mini-Arch Ophro McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, нижний правый второй премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Mini-Arch Ophro McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, нижний правый второй премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- 1.18 Брекет металлический Mini-Arch Ophro McBeTr Bracket 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, в вариантах исполнения:
 - Брекет металлический Mini-Arch Ophro McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, верхний правый центральный резец - не более 1000 шт.
 - Брекет металлический Mini-Arch Ophro McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, верхний правый боковой резец - не более 1000 шт.
 - Брекет металлический Mini-Arch Ophro McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, верхний правый клык без крючка - не более 1000 шт. .
 - Брекет металлический Mini-Arch Ophro McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, верхний правый клык с крючком - не более 1000 шт. .
 - Брекет металлический Mini-Arch Ophro McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, верхний правый первый премоляр без крючка - не более 1000 шт. .
 - Брекет металлический Mini-Arch Ophro McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, верхний правый первый премоляр с крючком - не более 1000 шт. .
 - Брекет металлический Mini-Arch Ophro McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, верхний правый второй премоляр без крючка - не более 1000 шт. .
 - Брекет металлический Mini-Arch Ophro McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, верхний правый второй премоляр с крючком - не более 1000 шт. .
 - Брекет металлический Mini-Arch Ophro McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, верхний левый центральный резец - не более 1000 шт.
 - Брекет металлический Mini-Arch Ophro McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, верхний левый боковой резец - не более 1000 шт. .
 - Брекет металлический Mini-Arch Ophro McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, верхний левый клык без крючка - не более 1000 шт. .
 - Брекет металлический Mini-Arch Ophro McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, верхний левый клык с крючком - не более 1000 шт. .

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0113178

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 28 ноября 2022 года № РЗН 2022/18940

Лист 33

- Брекеты металлические Mini-Arch Ophro McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, верхний левый первый премоляр без крючка - не более 1000 шт. .
- Брекеты металлические Mini-Arch Ophro McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, верхний левый первый премоляр с крючком - не более 1000 шт. .
- Брекеты металлические Mini-Arch Ophro McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, верхний левый второй премоляр без крючка - не более 1000 шт. .
- Брекеты металлические Mini-Arch Ophro McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, верхний левый второй премоляр с крючком - не более 1000 шт. .
- Брекеты металлические Mini-Arch Ophro McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, нижний левый центральный резец - не более 1000 шт. .
- Брекеты металлические Mini-Arch Ophro McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, нижний левый боковой резец - не более 1000 шт. .
- Брекеты металлические Mini-Arch Ophro McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, нижний левый клык без крючка - не более 1000 шт. .
- Брекеты металлические Mini-Arch Ophro McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, нижний левый клык с крючком - не более 1000 шт. .
- Брекеты металлические Mini-Arch Ophro McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, нижний левый первый премоляр без крючка - не более 1000 шт. .
- Брекеты металлические Mini-Arch Ophro McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, нижний левый первый премоляр с крючком - не более 1000 шт. .
- Брекеты металлические Mini-Arch Ophro McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, нижний левый второй премоляр без крючка - не более 1000 шт. .
- Брекеты металлические Mini-Arch Ophro McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, нижний левый второй премоляр с крючком - не более 1000 шт. .
- Брекеты металлические Mini-Arch Ophro McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, нижний правый центральный резец - не более 1000 шт. .
- Брекеты металлические Mini-Arch Ophro McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, нижний правый боковой резец - не более 1000 шт. .
- Брекеты металлические Mini-Arch Ophro McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, нижний правый клык без крючка - не более 1000 шт. .
- Брекеты металлические Mini-Arch Ophro McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, нижний правый клык с крючком - не более 1000 шт. .
- Брекеты металлические Mini-Arch Ophro McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, нижний правый первый премоляр без крючка - не более 1000 шт. .
- Брекеты металлические Mini-Arch Ophro McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, нижний правый первый премоляр с крючком - не более 1000 шт. .

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0113179

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 28 ноября 2022 года № РЗН 2022/18940

Лист 34

- Брекет металлический Mini-Arch Ophro McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, нижний правый второй премоляр без крючка - не более 1000 шт. .
- Брекет металлический Mini-Arch Ophro McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, нижний правый второй премоляр с крючком - не более 1000 шт. .
- 1.19 Брекет металлический Mini-Arch Ophro Roth Bracket 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini , в вариантах исполнения:
- Брекет металлический Mini-Arch Ophro Roth 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, верхний правый центральный резец - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Mini-Arch Ophro Roth 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, верхний правый боковой резец - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Mini-Arch Ophro Roth 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, верхний правый клык без крючка - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Mini-Arch Ophro Roth 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, верхний правый клык с крючком - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Mini-Arch Ophro Roth 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, верхний правый первый премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Mini-Arch Ophro Roth 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, верхний правый первый премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Mini-Arch Ophro Roth 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, верхний правый второй премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Mini-Arch Ophro Roth 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, верхний правый второй премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Mini-Arch Ophro Roth 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, верхний левый центральный резец - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Mini-Arch Ophro Roth 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, верхний левый боковой резец - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Mini-Arch Ophro Roth 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, верхний левый клык без крючка - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Mini-Arch Ophro Roth 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, верхний левый клык с крючком - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Mini-Arch Ophro Roth 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, верхний левый первый премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Mini-Arch Ophro Roth 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, верхний левый первый премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Mini-Arch Ophro Roth 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, верхний левый второй премоляр без крючка - не более 1000 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0113180


ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 28 ноября 2022 года № РЗН 2022/18940

Лист 35

- Брекет металлический Mini-Arch Ophro Roth 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, верхний левый второй премоляр с крючком - не более 1000 шт.
 - Брекет металлический Mini-Arch Ophro Roth 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, нижний левый центральный резец - не более 1000 шт.
 - Брекет металлический Mini-Arch Ophro Roth 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, нижний левый боковой резец - не более 1000 шт.
 - Брекет металлический Mini-Arch Ophro Roth 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, нижний левый клык без крючка - не более 1000 шт.
 - Брекет металлический Mini-Arch Ophro Roth 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, нижний левый клык с крючком - не более 1000 шт.
 - Брекет металлический Mini-Arch Ophro Roth 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, нижний левый первый премоляр без крючка - не более 1000 шт.
 - Брекет металлический Mini-Arch Ophro Roth 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, нижний левый первый премоляр с крючком - не более 1000 шт.
 - Брекет металлический Mini-Arch Ophro Roth 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, нижний левый второй премоляр без крючка - не более 1000 шт.
 - Брекет металлический Mini-Arch Ophro Roth 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, нижний левый второй премоляр с крючком - не более 1000 шт.
 - Брекет металлический Mini-Arch Ophro Roth 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, нижний правый центральный резец - не более 1000 шт.
 - Брекет металлический Mini-Arch Ophro Roth 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, нижний правый боковой резец - не более 1000 шт.
 - Брекет металлический Mini-Arch Ophro Roth 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, нижний правый клык без крючка - не более 1000 шт.
 - Брекет металлический Mini-Arch Ophro Roth 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, нижний правый клык с крючком - не более 1000 шт.
 - Брекет металлический Mini-Arch Ophro Roth 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, нижний правый первый премоляр без крючка - не более 1000 шт.
 - Брекет металлический Mini-Arch Ophro Roth 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, нижний правый первый премоляр с крючком - не более 1000 шт.
 - Брекет металлический Mini-Arch Ophro Roth 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, нижний правый второй премоляр без крючка - не более 1000 шт.
 - Брекет металлический Mini-Arch Ophro Roth 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, нижний правый второй премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- 1.20 Брекет металлический Mini-Arch Ophro Roth Bracket 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, в вариантах исполнения:

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

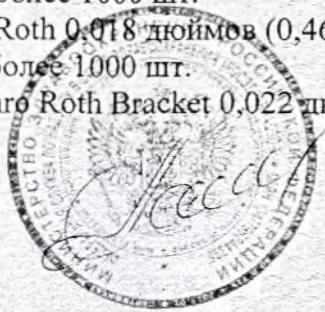

А.В. Самойлова

0113181


ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 28 ноября 2022 года № РЗН 2022/18940

Лист 36

- Брекет металлический Mini-Arch Ophro Roth 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, верхний правый центральный резец - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Mini-Arch Ophro Roth 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, верхний правый боковой резец - не более 1000 шт. .
- Брекет металлический Mini-Arch Ophro Roth 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, верхний правый клык без крючка - не более 1000 шт. .
- Брекет металлический Mini-Arch Ophro Roth 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, верхний правый клык с крючком - не более 1000 шт. .
- Брекет металлический Mini-Arch Ophro Roth 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, верхний правый первый премоляр без крючка - не более 1000 шт. .
- Брекет металлический Mini-Arch Ophro Roth 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, верхний правый первый премоляр с крючком - не более 1000 шт. .
- Брекет металлический Mini-Arch Ophro Roth 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, верхний правый второй премоляр без крючка - не более 1000 шт. .
- Брекет металлический Mini-Arch Ophro Roth 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, верхний правый второй премоляр с крючком - не более 1000 шт. .
- Брекет металлический Mini-Arch Ophro Roth 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, верхний левый центральный резец - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Mini-Arch Ophro Roth 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, верхний левый боковой резец - не более 1000 шт. .
- Брекет металлический Mini-Arch Ophro Roth 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, верхний левый клык без крючка - не более 1000 шт. .
- Брекет металлический Mini-Arch Ophro Roth 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, верхний левый клык с крючком - не более 1000 шт. .
- Брекет металлический Mini-Arch Ophro Roth 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, верхний левый первый премоляр без крючка - не более 1000 шт. .
- Брекет металлический Mini-Arch Ophro Roth 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, верхний левый первый премоляр с крючком - не более 1000 шт. .
- Брекет металлический Mini-Arch Ophro Roth 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, верхний левый второй премоляр без крючка - не более 1000 шт. .
- Брекет металлический Mini-Arch Ophro Roth 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, верхний левый второй премоляр с крючком - не более 1000 шт. .
- Брекет металлический Mini-Arch Ophro Roth 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, нижний левый центральный резец - не более 1000 шт. .
- Брекет металлический Mini-Arch Ophro Roth 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, нижний левый боковой резец - не более 1000 шт. .

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

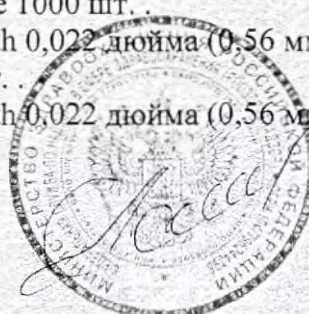

А.В. Самойлова

0113182

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ


от 28 ноября 2022 года № РЗН 2022/18940

Лист 37

- Брекет металлический Mini-Arch Ophro Roth 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, нижний левый клык без крючка - не более 1000 шт. .
- Брекет металлический Mini-Arch Ophro Roth 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, нижний левый клык с крючком - не более 1000 шт. .
- Брекет металлический Mini-Arch Ophro Roth 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, нижний левый первый премоляр без крючка - не более 1000 шт. .
- Брекет металлический Mini-Arch Ophro Roth 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, нижний левый первый премоляр с крючком - не более 1000 шт. .
- Брекет металлический Mini-Arch Ophro Roth 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, нижний левый второй премоляр без крючка - не более 1000 шт. .
- Брекет металлический Mini-Arch Ophro Roth 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, нижний левый второй премоляр с крючком - не более 1000 шт. .
- Брекет металлический Mini-Arch Ophro Roth 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, нижний правый центральный резец - не более 1000 шт. .
- Брекет металлический Mini-Arch Ophro Roth 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, нижний правый боковой резец - не более 1000 шт. .
- Брекет металлический Mini-Arch Ophro Roth 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, нижний правый клык без крючка - не более 1000 шт. .
- Брекет металлический Mini-Arch Ophro Roth 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, нижний правый клык с крючком - не более 1000 шт. .
- Брекет металлический Mini-Arch Ophro Roth 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, нижний правый первый премоляр без крючка - не более 1000 шт. .
- Брекет металлический Mini-Arch Ophro Roth 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, нижний правый первый премоляр с крючком - не более 1000 шт. .
- Брекет металлический Mini-Arch Ophro Roth 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, нижний правый второй премоляр без крючка - не более 1000 шт. .
- Брекет металлический Mini-Arch Ophro Roth 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, нижний правый второй премоляр с крючком - не более 1000 шт. .
- 1.21 Брекет металлический Copolla Edgewise Bracket 0,018 дюймов (0,46 мм) Standard , в вариантах исполнения:
 - Брекет металлический Copolla Edgewise 0,018 дюймов (0,46 мм) Standard, верхний правый центральный резец - не более 1000 шт.
 - Брекет металлический Copolla Edgewise 0,018 дюймов (0,46 мм) Standard, верхний правый боковой резец - не более 1000 шт.
 - Брекет металлический Copolla Edgewise 0,018 дюймов (0,46 мм) Standard, верхний правый клык без крючка - не более 1000 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

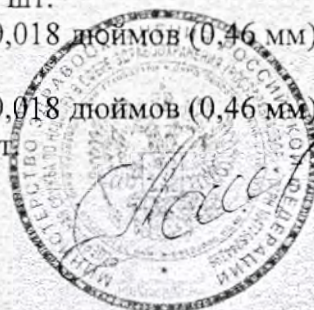

0113183

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 28 ноября 2022 года № РЗН 2022/18940

Лист 38

- Брекеты металлические Copolla Edgewise 0,018 дюймов (0,46 мм) Standard, верхний правый клык с крючком - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические Copolla Edgewise 0,018 дюймов (0,46 мм) Standard, верхний правый первый премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические Copolla Edgewise 0,018 дюймов (0,46 мм) Standard, верхний правый первый премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические Copolla Edgewise 0,018 дюймов (0,46 мм) Standard, верхний правый второй премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические Copolla Edgewise 0,018 дюймов (0,46 мм) Standard, верхний правый второй премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические Copolla Edgewise 0,018 дюймов (0,46 мм) Standard, верхний левый центральный резец - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические Copolla Edgewise 0,018 дюймов (0,46 мм) Standard, верхний левый боковой резец - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические Copolla Edgewise 0,018 дюймов (0,46 мм) Standard, верхний левый клык без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические Copolla Edgewise 0,018 дюймов (0,46 мм) Standard, верхний левый клык с крючком - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические Copolla Edgewise 0,018 дюймов (0,46 мм) Standard, верхний левый первый премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические Copolla Edgewise 0,018 дюймов (0,46 мм) Standard, верхний левый первый премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические Copolla Edgewise 0,018 дюймов (0,46 мм) Standard, верхний левый второй премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические Copolla Edgewise 0,018 дюймов (0,46 мм) Standard, верхний левый второй премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические Copolla Edgewise 0,018 дюймов (0,46 мм) Standard, нижний левый центральный резец - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические Copolla Edgewise 0,018 дюймов (0,46 мм) Standard, нижний левый боковой резец - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические Copolla Edgewise 0,018 дюймов (0,46 мм) Standard, нижний левый клык без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические Copolla Edgewise 0,018 дюймов (0,46 мм) Standard, нижний левый клык с крючком - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические Copolla Edgewise 0,018 дюймов (0,46 мм) Standard, нижний левый первый премоляр без крючка - не более 1000 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0113184

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 28 ноября 2022 года № РЗН 2022/18940

Лист 39

- Брекет металлический Copolla Edgewise 0,018 дюймов (0,46 мм) Standard, нижний левый первый премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Copolla Edgewise 0,018 дюймов (0,46 мм) Standard, нижний левый второй премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Copolla Edgewise 0,018 дюймов (0,46 мм) Standard, нижний левый второй премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Copolla Edgewise 0,018 дюймов (0,46 мм) Standard, нижний правый центральный резец - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Copolla Edgewise 0,018 дюймов (0,46 мм) Standard, нижний правый боковой резец - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Copolla Edgewise 0,018 дюймов (0,46 мм) Standard, нижний правый клык без крючка - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Copolla Edgewise 0,018 дюймов (0,46 мм) Standard, нижний правый клык с крючком - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Copolla Edgewise 0,018 дюймов (0,46 мм) Standard, нижний правый первый премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Copolla Edgewise 0,018 дюймов (0,46 мм) Standard, нижний правый первый премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Copolla Edgewise 0,018 дюймов (0,46 мм) Standard, нижний правый второй премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Copolla Edgewise 0,018 дюймов (0,46 мм) Standard, нижний правый второй премоляр с крючком - не более 1000 шт.

1.22 Брекет металлический Copolla Edgewise Bracket 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, в вариантах исполнения:

- Брекет металлический Copolla Edgewise 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, верхний правый центральный резец - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Copolla Edgewise 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, верхний правый боковой резец - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Copolla Edgewise 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, верхний правый клык без крючка - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Copolla Edgewise 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, верхний правый клык с крючком - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Copolla Edgewise 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, верхний правый первый премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Copolla Edgewise 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, верхний правый первый премоляр с крючком - не более 1000 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0113185

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 28 ноября 2022 года № РЗН 2022/18940

Лист 40

- Брекеты металлические Copolla Edgewise 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, верхний правый второй премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические Copolla Edgewise 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, верхний правый второй премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические Copolla Edgewise 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, верхний левый центральный резец - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические Copolla Edgewise 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, верхний левый боковой резец - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические Copolla Edgewise 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, верхний левый клык без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические Copolla Edgewise 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, верхний левый клык с крючком - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические Copolla Edgewise 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, верхний левый первый премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические Copolla Edgewise 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, верхний левый первый премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические Copolla Edgewise 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, верхний левый второй премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические Copolla Edgewise 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, верхний левый второй премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические Copolla Edgewise 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, нижний левый центральный резец - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические Copolla Edgewise 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, нижний левый боковой резец - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические Copolla Edgewise 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, нижний левый клык без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические Copolla Edgewise 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, нижний левый клык с крючком - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические Copolla Edgewise 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, нижний левый первый премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические Copolla Edgewise 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, нижний левый первый премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические Copolla Edgewise 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, нижний левый второй премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические Copolla Edgewise 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, нижний левый второй премоляр с крючком - не более 1000 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0113186

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 28 ноября 2022 года № РЗН 2022/18940

Лист 41

- Брекет металлический Copolla Edgewise 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, нижний правый центральный резец - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Copolla Edgewise 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, нижний правый боковой резец - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Copolla Edgewise 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, нижний правый клык без крючка - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Copolla Edgewise 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, нижний правый клык с крючком - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Copolla Edgewise 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, нижний правый первый премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Copolla Edgewise 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, нижний правый первый премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Copolla Edgewise 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, нижний правый второй премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Copolla Edgewise 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, нижний правый второй премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- 1.23 Брекет металлический Copolla Edgewise Bracket 0,022 дюйма (0,56 мм) Standard , в вариантах исполнения:
 - Брекет металлический Copolla Edgewise 0,022 дюйма (0,56 мм) Standard, верхний правый центральный резец - не более 1000 шт.
 - Брекет металлический Copolla Edgewise 0,022 дюйма (0,56 мм) Standard, верхний правый боковой резец - не более 1000 шт.
 - Брекет металлический Copolla Edgewise 0,022 дюйма (0,56 мм) Standard, верхний правый клык без крючка - не более 1000 шт.
 - Брекет металлический Copolla Edgewise 0,022 дюйма (0,56 мм) Standard, верхний правый клык с крючком - не более 1000 шт.
 - Брекет металлический Copolla Edgewise 0,022 дюйма (0,56 мм) Standard, верхний правый первый премоляр без крючка - не более 1000 шт.
 - Брекет металлический Copolla Edgewise 0,022 дюйма (0,56 мм) Standard, верхний правый первый премоляр с крючком - не более 1000 шт.
 - Брекет металлический Copolla Edgewise 0,022 дюйма (0,56 мм) Standard, верхний правый второй премоляр без крючка - не более 1000 шт.
 - Брекет металлический Copolla Edgewise 0,022 дюйма (0,56 мм) Standard, верхний правый второй премоляр с крючком - не более 1000 шт.
 - Брекет металлический Copolla Edgewise 0,022 дюйма (0,56 мм) Standard, верхний левый центральный резец - не более 1000 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0113187

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 28 ноября 2022 года № РЗН 2022/18940

Лист 42

- Брекет металлический Copolla Edgewise 0,022 дюйма (0,56 мм) Standard, верхний левый боковой резец - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Copolla Edgewise 0,022 дюйма (0,56 мм) Standard, верхний левый клык без крючка - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Copolla Edgewise 0,022 дюйма (0,56 мм) Standard, верхний левый клык с крючком - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Copolla Edgewise 0,022 дюйма (0,56 мм) Standard, верхний левый первый премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Copolla Edgewise 0,022 дюйма (0,56 мм) Standard, верхний левый первый премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Copolla Edgewise 0,022 дюйма (0,56 мм) Standard, верхний левый второй премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Copolla Edgewise 0,022 дюйма (0,56 мм) Standard, верхний левый второй премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Copolla Edgewise 0,022 дюйма (0,56 мм) Standard, нижний левый центральный резец - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Copolla Edgewise 0,022 дюйма (0,56 мм) Standard, нижний левый боковой резец - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Copolla Edgewise 0,022 дюйма (0,56 мм) Standard, нижний левый клык без крючка - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Copolla Edgewise 0,022 дюйма (0,56 мм) Standard, нижний левый клык с крючком - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Copolla Edgewise 0,022 дюйма (0,56 мм) Standard, нижний левый первый премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Copolla Edgewise 0,022 дюйма (0,56 мм) Standard, нижний левый первый премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Copolla Edgewise 0,022 дюйма (0,56 мм) Standard, нижний левый второй премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Copolla Edgewise 0,022 дюйма (0,56 мм) Standard, нижний левый второй премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Copolla Edgewise 0,022 дюйма (0,56 мм) Standard, нижний правый центральный резец - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Copolla Edgewise 0,022 дюйма (0,56 мм) Standard, нижний правый боковой резец - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Copolla Edgewise 0,022 дюйма (0,56 мм) Standard, нижний правый клык без крючка - не более 1000 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0113188

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 28 ноября 2022 года № РЗН 2022/18940

Лист 43

- Брекет металлический Copolla Edgewise 0,022 дюйма (0,56 мм) Standard, нижний правый клык с крючком - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Copolla Edgewise 0,022 дюйма (0,56 мм) Standard, нижний правый первый премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Copolla Edgewise 0,022 дюйма (0,56 мм) Standard, нижний правый первый премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Copolla Edgewise 0,022 дюйма (0,56 мм) Standard, нижний правый второй премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Copolla Edgewise 0,022 дюйма (0,56 мм) Standard, нижний правый второй премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- 1.24 Брекет металлический Copolla Edgewise Bracket 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, в вариантах исполнения:
- Брекет металлический Copolla Edgewise 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, верхний правый центральный резец - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Copolla Edgewise 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, верхний правый боковой резец - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Copolla Edgewise 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, верхний правый клык без крючка - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Copolla Edgewise 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, верхний правый клык с крючком - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Copolla Edgewise 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, верхний правый первый премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Copolla Edgewise 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, верхний правый первый премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Copolla Edgewise 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, верхний правый второй премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Copolla Edgewise 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, верхний правый второй премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Copolla Edgewise 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, верхний левый центральный резец - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Copolla Edgewise 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, верхний левый боковой резец - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Copolla Edgewise 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, верхний левый клык без крючка - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Copolla Edgewise 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, верхний левый клык с крючком - не более 1000 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0113189

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 28 ноября 2022 года № РЗН 2022/18940

Лист 44

- Брекет металлический Copolla Edgewise 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, верхний левый первый премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Copolla Edgewise 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, верхний левый первый премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Copolla Edgewise 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, верхний левый второй премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Copolla Edgewise 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, верхний левый второй премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Copolla Edgewise 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, нижний левый центральный резец - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Copolla Edgewise 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, нижний левый боковой резец - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Copolla Edgewise 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, нижний левый клык без крючка - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Copolla Edgewise 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, нижний левый клык с крючком - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Copolla Edgewise 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, нижний левый первый премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Copolla Edgewise 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, нижний левый первый премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Copolla Edgewise 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, нижний левый второй премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Copolla Edgewise 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, нижний левый второй премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Copolla Edgewise 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, нижний правый центральный резец - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Copolla Edgewise 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, нижний правый боковой резец - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Copolla Edgewise 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, нижний правый клык без крючка - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Copolla Edgewise 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, нижний правый клык с крючком - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Copolla Edgewise 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, нижний правый первый премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Copolla Edgewise 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, нижний правый первый премоляр с крючком - не более 1000 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0113190


**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 28 ноября 2022 года № РЗН 2022/18940

Лист 45

- Брекеты металлические Copolla Edgewise 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, нижний правый второй премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические Copolla Edgewise 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, нижний правый второй премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- 1.25 Брекеты металлические Copolla Roth Bracket 0,018 дюймов (0,46 мм) Standard, в вариантах исполнения:
 - Брекеты металлические Copolla Roth 0,018 дюймов (0,46 мм) Standard, верхний правый центральный резец - не более 1000 шт.
 - Брекеты металлические Copolla Roth 0,018 дюймов (0,46 мм) Standard, верхний правый боковой резец - не более 1000 шт.
 - Брекеты металлические Copolla Roth 0,018 дюймов (0,46 мм) Standard, верхний правый клык без крючка - не более 1000 шт.
 - Брекеты металлические Copolla Roth 0,018 дюймов (0,46 мм) Standard, верхний правый клык с крючком - не более 1000 шт.
 - Брекеты металлические Copolla Roth 0,018 дюймов (0,46 мм) Standard, верхний правый первый премоляр без крючка - не более 1000 шт.
 - Брекеты металлические Copolla Roth 0,018 дюймов (0,46 мм) Standard, верхний правый первый премоляр с крючком - не более 1000 шт.
 - Брекеты металлические Copolla Roth 0,018 дюймов (0,46 мм) Standard, верхний правый второй премоляр без крючка - не более 1000 шт.
 - Брекеты металлические Copolla Roth 0,018 дюймов (0,46 мм) Standard, верхний правый второй премоляр с крючком - не более 1000 шт.
 - Брекеты металлические Copolla Roth 0,018 дюймов (0,46 мм) Standard, верхний левый центральный резец - не более 1000 шт.
 - Брекеты металлические Copolla Roth 0,018 дюймов (0,46 мм) Standard, верхний левый боковой резец - не более 1000 шт.
 - Брекеты металлические Copolla Roth 0,018 дюймов (0,46 мм) Standard, верхний левый клык без крючка - не более 1000 шт.
 - Брекеты металлические Copolla Roth 0,018 дюймов (0,46 мм) Standard, верхний левый клык с крючком - не более 1000 шт.
 - Брекеты металлические Copolla Roth 0,018 дюймов (0,46 мм) Standard, верхний левый первый премоляр без крючка - не более 1000 шт.
 - Брекеты металлические Copolla Roth 0,018 дюймов (0,46 мм) Standard, верхний левый первый премоляр с крючком - не более 1000 шт.
 - Брекеты металлические Copolla Roth 0,018 дюймов (0,46 мм) Standard, верхний левый второй премоляр без крючка - не более 1000 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

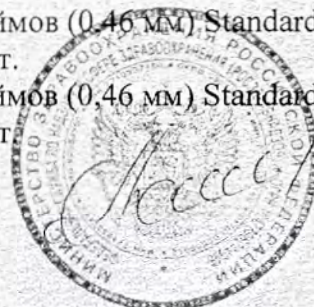

А.В. Самойлова

0113191

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 28 ноября 2022 года № РЗН 2022/18940

Лист 46

- Брекет металлический Copolla Roth 0,018 дюймов (0,46 мм) Standard, верхний левый второй премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Copolla Roth 0,018 дюймов (0,46 мм) Standard, нижний левый центральный резец - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Copolla Roth 0,018 дюймов (0,46 мм) Standard, нижний левый боковой резец - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Copolla Roth 0,018 дюймов (0,46 мм) Standard, нижний левый клык без крючка - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Copolla Roth 0,018 дюймов (0,46 мм) Standard, нижний левый клык с крючком - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Copolla Roth 0,018 дюймов (0,46 мм) Standard, нижний левый первый премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Copolla Roth 0,018 дюймов (0,46 мм) Standard, нижний левый первый премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Copolla Roth 0,018 дюймов (0,46 мм) Standard, нижний левый второй премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Copolla Roth 0,018 дюймов (0,46 мм) Standard, нижний левый второй премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Copolla Roth 0,018 дюймов (0,46 мм) Standard, нижний правый центральный резец - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Copolla Roth 0,018 дюймов (0,46 мм) Standard, нижний правый боковой резец - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Copolla Roth 0,018 дюймов (0,46 мм) Standard, нижний правый клык без крючка - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Copolla Roth 0,018 дюймов (0,46 мм) Standard, нижний правый клык с крючком - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Copolla Roth 0,018 дюймов (0,46 мм) Standard, нижний правый первый премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Copolla Roth 0,018 дюймов (0,46 мм) Standard, нижний правый первый премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Copolla Roth 0,018 дюймов (0,46 мм) Standard, нижний правый второй премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Copolla Roth 0,018 дюймов (0,46 мм) Standard, нижний правый второй премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- 1.26 Брекет металлический Copolla Roth Bracket 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, в вариантах исполнения:

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0113192


**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 28 ноября 2022 года № РЗН 2022/18940

Лист 47

- Брекет металлический Copolla Roth 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, верхний правый центральный резец - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Copolla Roth 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, верхний правый боковой резец - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Copolla Roth 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, верхний правый клык без крючка - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Copolla Roth 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, верхний правый клык с крючком - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Copolla Roth 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, верхний правый первый премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Copolla Roth 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, верхний правый первый премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Copolla Roth 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, верхний правый второй премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Copolla Roth 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, верхний правый второй премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Copolla Roth 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, верхний левый центральный резец - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Copolla Roth 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, верхний левый боковой резец - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Copolla Roth 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, верхний левый клык без крючка - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Copolla Roth 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, верхний левый клык с крючком - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Copolla Roth 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, верхний левый первый премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Copolla Roth 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, верхний левый первый премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Copolla Roth 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, верхний левый второй премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Copolla Roth 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, верхний левый второй премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Copolla Roth 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, нижний левый центральный резец - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Copolla Roth 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, нижний левый боковой резец - не более 1000 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

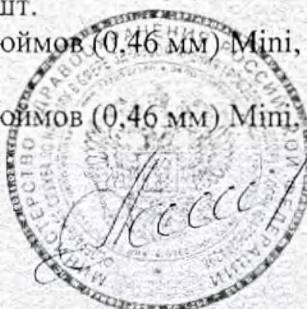

А.В. Самойлова

0113193

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 28 ноября 2022 года № РЗН 2022/18940

Лист 48

- Брекет металлический Copolla Roth 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, нижний левый клык без крючка - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Copolla Roth 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, нижний левый клык с крючком - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Copolla Roth 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, нижний левый первый премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Copolla Roth 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, нижний левый первый премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Copolla Roth 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, нижний левый второй премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Copolla Roth 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, нижний левый второй премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Copolla Roth 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, нижний правый центральный резец - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Copolla Roth 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, нижний правый боковой резец - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Copolla Roth 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, нижний правый клык без крючка - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Copolla Roth 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, нижний правый клык с крючком - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Copolla Roth 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, нижний правый первый премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Copolla Roth 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, нижний правый первый премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Copolla Roth 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, нижний правый второй премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Copolla Roth 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, нижний правый второй премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- 1.27 Брекет металлический Copolla Roth Bracket 0,022 дюйма (0,56 мм) Standard, в вариантах исполнения:
 - Брекет металлический Copolla Roth 0,022 дюйма (0,56 мм) Standard, верхний правый центральный резец - не более 1000 шт.
 - Брекет металлический Copolla Roth 0,022 дюйма (0,56 мм) Standard, верхний правый боковой резец - не более 1000 шт.
 - Брекет металлический Copolla Roth 0,022 дюйма (0,56 мм) Standard, верхний правый клык без крючка - не более 1000 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0113194


**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 28 ноября 2022 года № РЗН 2022/18940

Лист 49

- Брекет металлический Copolla Roth 0,022 дюйма (0,56 мм) Standard, верхний правый клык с крючком - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Copolla Roth 0,022 дюйма (0,56 мм) Standard, верхний правый первый премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Copolla Roth 0,022 дюйма (0,56 мм) Standard, верхний правый первый премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Copolla Roth 0,022 дюйма (0,56 мм) Standard, верхний правый второй премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Copolla Roth 0,022 дюйма (0,56 мм) Standard, верхний правый второй премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Copolla Roth 0,022 дюйма (0,56 мм) Standard, верхний левый центральный резец - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Copolla Roth 0,022 дюйма (0,56 мм) Standard, верхний левый боковой резец - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Copolla Roth 0,022 дюйма (0,56 мм) Standard, верхний левый клык без крючка - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Copolla Roth 0,022 дюйма (0,56 мм) Standard, верхний левый клык с крючком - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Copolla Roth 0,022 дюйма (0,56 мм) Standard, верхний левый первый премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Copolla Roth 0,022 дюйма (0,56 мм) Standard, верхний левый первый премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Copolla Roth 0,022 дюйма (0,56 мм) Standard, верхний левый второй премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Copolla Roth 0,022 дюйма (0,56 мм) Standard, верхний левый второй премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Copolla Roth 0,022 дюйма (0,56 мм) Standard, нижний левый центральный резец - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Copolla Roth 0,022 дюйма (0,56 мм) Standard, нижний левый боковой резец - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Copolla Roth 0,022 дюйма (0,56 мм) Standard, нижний левый клык без крючка - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Copolla Roth 0,022 дюйма (0,56 мм) Standard, нижний левый клык с крючком - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Copolla Roth 0,022 дюйма (0,56 мм) Standard, нижний левый первый премоляр без крючка - не более 1000 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

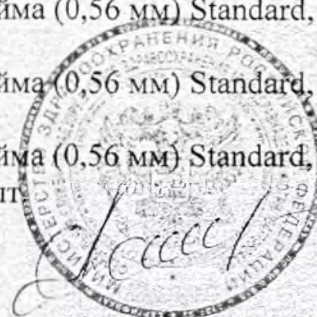

А.В. Самойлова

0113195


ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 28 ноября 2022 года № РЗН 2022/18940

Лист 50

- Брекет металлический Copolla Roth 0,022 дюйма (0,56 мм) Standard, нижний левый первый премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Copolla Roth 0,022 дюйма (0,56 мм) Standard, нижний левый второй премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Copolla Roth 0,022 дюйма (0,56 мм) Standard, нижний левый второй премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Copolla Roth 0,022 дюйма (0,56 мм) Standard, нижний правый центральный резец - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Copolla Roth 0,022 дюйма (0,56 мм) Standard, нижний правый боковой резец - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Copolla Roth 0,022 дюйма (0,56 мм) Standard, нижний правый клык без крючка - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Copolla Roth 0,022 дюйма (0,56 мм) Standard, нижний правый клык с крючком - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Copolla Roth 0,022 дюйма (0,56 мм) Standard, нижний правый первый премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Copolla Roth 0,022 дюйма (0,56 мм) Standard, нижний правый первый премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Copolla Roth 0,022 дюйма (0,56 мм) Standard, нижний правый второй премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Copolla Roth 0,022 дюйма (0,56 мм) Standard, нижний правый второй премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- 1.28 Брекет металлический Copolla Roth Bracket 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini , в вариантах исполнения:
 - Брекет металлический Copolla Roth 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, верхний правый центральный резец - не более 1000 шт.
 - Брекет металлический Copolla Roth 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, верхний правый боковой резец - не более 1000 шт.
 - Брекет металлический Copolla Roth 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, верхний правый клык без крючка - не более 1000 шт.
 - Брекет металлический Copolla Roth 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, верхний правый клык с крючком - не более 1000 шт.
 - Брекет металлический Copolla Roth 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, верхний правый первый премоляр без крючка - не более 1000 шт.
 - Брекет металлический Copolla Roth 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, верхний правый первый премоляр с крючком - не более 1000 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

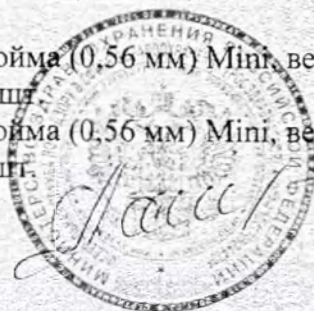

А.В. Самойлова

0113196


**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 28 ноября 2022 года № РЗН 2022/18940

Лист 51

- Брекет металлический Copolla Roth 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, верхний правый второй премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Copolla Roth 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, верхний правый второй премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Copolla Roth 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, верхний левый центральный резец - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Copolla Roth 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, верхний левый боковой резец - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Copolla Roth 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, верхний левый клык без крючка - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Copolla Roth 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, верхний левый клык с крючком - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Copolla Roth 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, верхний левый первый премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Copolla Roth 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, верхний левый первый премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Copolla Roth 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, верхний левый второй премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Copolla Roth 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, верхний левый второй премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Copolla Roth 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, нижний левый центральный резец - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Copolla Roth 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, нижний левый боковой резец - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Copolla Roth 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, нижний левый клык без крючка - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Copolla Roth 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, нижний левый клык с крючком - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Copolla Roth 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, нижний левый первый премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Copolla Roth 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, нижний левый первый премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Copolla Roth 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, нижний левый второй премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Copolla Roth 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, нижний левый второй премоляр с крючком - не более 1000 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

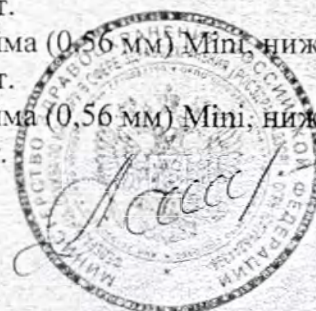

А.В. Самойлова

0113197

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 28 ноября 2022 года № РЗН 2022/18940

Лист 52

- Брекет металлический Copolla Roth 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, нижний правый центральный резец - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Copolla Roth 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, нижний правый боковой резец - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Copolla Roth 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, нижний правый клык без крючка - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Copolla Roth 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, нижний правый клык с крючком - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Copolla Roth 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, нижний правый первый премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Copolla Roth 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, нижний правый первый премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Copolla Roth 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, нижний правый второй премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Copolla Roth 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, нижний правый второй премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- 1.29 Брекет металлический Copolla McBeTr Bracket 0,018 дюймов (0,46 мм) Standard, в вариантах исполнения:
 - Брекет металлический Copolla McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм) Standard, верхний правый центральный резец - не более 1000 шт.
 - Брекет металлический Copolla McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм) Standard, верхний правый боковой резец - не более 1000 шт.
 - Брекет металлический Copolla McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм) Standard, верхний правый клык без крючка - не более 1000 шт.
 - Брекет металлический Copolla McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм) Standard, верхний правый клык с крючком - не более 1000 шт.
 - Брекет металлический Copolla McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм) Standard, верхний правый первый премоляр без крючка - не более 1000 шт.
 - Брекет металлический Copolla McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм) Standard, верхний правый первый премоляр с крючком - не более 1000 шт.
 - Брекет металлический Copolla McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм) Standard, верхний правый второй премоляр без крючка - не более 1000 шт.
 - Брекет металлический Copolla McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм) Standard, верхний правый второй премоляр с крючком - не более 1000 шт.
 - Брекет металлический Copolla McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм) Standard, верхний левый центральный резец - не более 1000 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0113198

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 28 ноября 2022 года № РЗН 2022/18940

Лист 53

- Брекет металлический Corolla McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм) Standard, верхний левый боковой резец - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Corolla McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм) Standard, верхний левый клык без крючка - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Corolla McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм) Standard, верхний левый клык с крючком - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Corolla McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм) Standard, верхний левый первый премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Corolla McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм) Standard, верхний левый первый премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Corolla McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм) Standard, верхний левый второй премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Corolla McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм) Standard, верхний левый второй премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Corolla McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм) Standard, нижний левый центральный резец - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Corolla McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм) Standard, нижний левый боковой резец - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Corolla McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм) Standard, нижний левый клык без крючка - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Corolla McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм) Standard, нижний левый клык с крючком - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Corolla McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм) Standard, нижний левый первый премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Corolla McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм) Standard, нижний левый первый премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Corolla McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм) Standard, нижний левый второй премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Corolla McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм) Standard, нижний левый второй премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Corolla McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм) Standard, нижний правый центральный резец - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Corolla McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм) Standard, нижний правый боковой резец - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Corolla McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм) Standard, нижний правый клык без крючка - не более 1000 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова



0113199


ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 28 ноября 2022 года № РЗН 2022/18940

Лист 54

- Брекеты металлические Corolla McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм) Standard, нижний правый клык с крючком - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические Corolla McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм) Standard, нижний правый первый премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические Corolla McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм) Standard, нижний правый первый премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические Corolla McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм) Standard, нижний правый второй премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические Corolla McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм) Standard, нижний правый второй премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- 1.30 Брекеты металлические Corolla McBeTr Bracket 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, в вариантах исполнения:
 - Брекеты металлические Corolla McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, верхний правый центральный резец - не более 1000 шт.
 - Брекеты металлические Corolla McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, верхний правый боковой резец - не более 1000 шт.
 - Брекеты металлические Corolla McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, верхний правый клык без крючка - не более 1000 шт.
 - Брекеты металлические Corolla McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, верхний правый клык с крючком - не более 1000 шт.
 - Брекеты металлические Corolla McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, верхний правый первый премоляр без крючка - не более 1000 шт.
 - Брекеты металлические Corolla McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, верхний правый первый премоляр с крючком - не более 1000 шт.
 - Брекеты металлические Corolla McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, верхний правый второй премоляр без крючка - не более 1000 шт.
 - Брекеты металлические Corolla McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, верхний правый второй премоляр с крючком - не более 1000 шт.
 - Брекеты металлические Corolla McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, верхний левый центральный резец - не более 1000 шт.
 - Брекеты металлические Corolla McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, верхний левый боковой резец - не более 1000 шт.
 - Брекеты металлические Corolla McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, верхний левый клык без крючка - не более 1000 шт.
 - Брекеты металлические Corolla McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, верхний левый клык с крючком - не более 1000 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

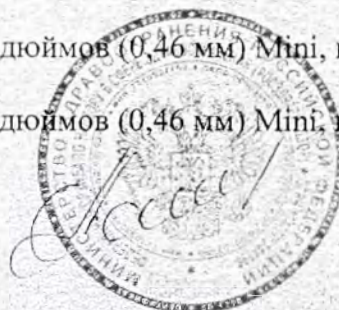

А.В. Самойлова

0113200

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 28 ноября 2022 года № РЗН 2022/18940

Лист 55

- Брекет металлический Corolla McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, верхний левый первый премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Corolla McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, верхний левый первый премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Corolla McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, верхний левый второй премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Corolla McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, верхний левый второй премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Corolla McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, нижний левый центральный резец - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Corolla McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, нижний левый боковой резец - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Corolla McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, нижний левый клык без крючка - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Corolla McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, нижний левый клык с крючком - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Corolla McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, нижний левый первый премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Corolla McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, нижний левый первый премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Corolla McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, нижний левый второй премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Corolla McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, нижний левый второй премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Corolla McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, нижний правый центральный резец - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Corolla McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, нижний правый боковой резец - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Corolla McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, нижний правый клык без крючка - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Corolla McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, нижний правый клык с крючком - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Corolla McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, нижний правый первый премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекет металлический Corolla McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, нижний правый первый премоляр с крючком - не более 1000 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0113401

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 28 ноября 2022 года № РЗН 2022/18940

Лист 56

- Брекеты металлические Copolla McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, нижний правый второй премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические Copolla McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм) Mini, нижний правый второй премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- 1.31 Брекеты металлические Copolla McBeTr Bracket 0,022 дюйма (0,56 мм) Standard, в вариантах исполнения:
- Брекеты металлические Copolla McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм) Standard, верхний правый центральный резец - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические Copolla McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм) Standard, верхний правый боковой резец - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические Copolla McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм) Standard, верхний правый клык без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические Copolla McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм) Standard, верхний правый клык с крючком - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические Copolla McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм) Standard, верхний правый первый премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические Copolla McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм) Standard, верхний правый первый премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические Copolla McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм) Standard, верхний правый второй премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические Copolla McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм) Standard, верхний правый второй премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические Copolla McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм) Standard, верхний левый центральный резец - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические Copolla McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм) Standard, верхний левый боковой резец - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические Copolla McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм) Standard, верхний левый клык без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические Copolla McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм) Standard, верхний левый клык с крючком - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические Copolla McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм) Standard, верхний левый первый премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические Copolla McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм) Standard, верхний левый первый премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические Copolla McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм) Standard, верхний левый второй премоляр без крючка - не более 1000 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0113402

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 28 ноября 2022 года № РЗН 2022/18940

Лист 57

- Брекеты металлические Copolla McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм) Standard, верхний левый второй премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические Copolla McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм) Standard, нижний левый центральный резец - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические Copolla McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм) Standard, нижний левый боковой резец - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические Copolla McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм) Standard, нижний левый клык без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические Copolla McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм) Standard, нижний левый клык с крючком - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические Copolla McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм) Standard, нижний левый первый премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические Copolla McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм) Standard, нижний левый первый премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические Copolla McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм) Standard, нижний левый второй премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические Copolla McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм) Standard, нижний левый второй премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические Copolla McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм) Standard, нижний правый центральный резец - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические Copolla McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм) Standard, нижний правый боковой резец - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические Copolla McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм) Standard, нижний правый клык без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические Copolla McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм) Standard, нижний правый клык с крючком - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические Copolla McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм) Standard, нижний правый первый премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические Copolla McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм) Standard, нижний правый первый премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические Copolla McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм) Standard, нижний правый второй премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические Copolla McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм) Standard, нижний правый второй премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- 1.32 Брекеты металлические Copolla McBeTr Bracket 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, в вариантах исполнения:

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0113403

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 28 ноября 2022 года № РЗН 2022/18940

Лист 58

- Брекеты металлические Sorolla McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, верхний правый центральный резец - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические Sorolla McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, верхний правый боковой резец - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические Sorolla McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, верхний правый клык без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические Sorolla McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, верхний правый клык с крючком - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические Sorolla McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, верхний правый первый премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические Sorolla McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, верхний правый первый премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические Sorolla McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, верхний правый второй премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические Sorolla McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, верхний правый второй премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические Sorolla McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, верхний левый центральный резец - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические Sorolla McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, верхний левый боковой резец - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические Sorolla McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, верхний левый клык без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические Sorolla McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, верхний левый клык с крючком - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические Sorolla McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, верхний левый первый премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические Sorolla McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, верхний левый первый премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические Sorolla McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, верхний левый второй премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические Sorolla McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, верхний левый второй премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические Sorolla McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, нижний левый центральный резец - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические Sorolla McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, нижний левый боковой резец - не более 1000 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0113404

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 28 ноября 2022 года

№ РЗН 2022/18940

Лист 59

- Брекеты металлические Sorolla McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, нижний левый клык без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические Sorolla McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, нижний левый клык с крючком - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические Sorolla McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, нижний левый первый премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические Sorolla McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, нижний левый первый премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические Sorolla McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, нижний левый второй премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические Sorolla McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, нижний левый второй премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические Sorolla McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, нижний правый центральный резец - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические Sorolla McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, нижний правый боковой резец - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические Sorolla McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, нижний правый клык без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические Sorolla McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, нижний правый клык с крючком - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические Sorolla McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, нижний правый первый премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические Sorolla McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, нижний правый первый премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические Sorolla McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, нижний правый второй премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические Sorolla McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм) Mini, нижний правый второй премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- 1.33 Брекеты металлические самолигирующие ProMIM Self-Ligating Roth Bracket 0,018 дюймов (0,46 мм), в вариантах исполнения:
 - Брекеты металлические самолигирующие ProMIM Roth 0,018 дюймов (0,46 мм), верхний правый центральный резец - не более 1000 шт.
 - Брекеты металлические самолигирующие ProMIM Roth 0,018 дюймов (0,46 мм), верхний правый боковой резец - не более 1000 шт.
 - Брекеты металлические самолигирующие ProMIM Roth 0,018 дюймов (0,46 мм), верхний правый клык без крючка - не более 1000 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова



0113405

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 28 ноября 2022 года

№ РЗН 2022/18940

Лист 60

- Брекеты металлические самолигирующие ProMIM Roth 0,018 дюймов (0,46 мм), верхний правый клык с крючком - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические самолигирующие ProMIM Roth 0,018 дюймов (0,46 мм), верхний правый первый премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические самолигирующие ProMIM Roth 0,018 дюймов (0,46 мм), верхний правый первый премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические самолигирующие ProMIM Roth 0,018 дюймов (0,46 мм), верхний правый второй премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические самолигирующие ProMIM Roth 0,018 дюймов (0,46 мм), верхний правый второй премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические самолигирующие ProMIM Roth 0,018 дюймов (0,46 мм), верхний левый центральный резец - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические самолигирующие ProMIM Roth 0,018 дюймов (0,46 мм), верхний левый боковой резец - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические самолигирующие ProMIM Roth 0,018 дюймов (0,46 мм), верхний левый клык без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические самолигирующие ProMIM Roth 0,018 дюймов (0,46 мм), верхний левый клык с крючком - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические самолигирующие ProMIM Roth 0,018 дюймов (0,46 мм), верхний левый первый премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические самолигирующие ProMIM Roth 0,018 дюймов (0,46 мм), верхний левый первый премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические самолигирующие ProMIM Roth 0,018 дюймов (0,46 мм), верхний левый второй премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические самолигирующие ProMIM Roth 0,018 дюймов (0,46 мм), верхний левый второй премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические самолигирующие ProMIM Roth 0,018 дюймов (0,46 мм), нижний левый центральный резец - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические самолигирующие ProMIM Roth 0,018 дюймов (0,46 мм), нижний левый боковой резец - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические самолигирующие ProMIM Roth 0,018 дюймов (0,46 мм), нижний левый клык без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические самолигирующие ProMIM Roth 0,018 дюймов (0,46 мм), нижний левый клык с крючком - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические самолигирующие ProMIM Roth 0,018 дюймов (0,46 мм), нижний левый первый премоляр без крючка - не более 1000 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова



0113406

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 28 ноября 2022 года № РЗН 2022/18940

Лист 61

- Брекеты металлические самолигирующие ProMIM Roth 0,018 дюймов (0,46 мм), нижний левый первый премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические самолигирующие ProMIM Roth 0,018 дюймов (0,46 мм), нижний левый второй премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические самолигирующие ProMIM Roth 0,018 дюймов (0,46 мм), нижний левый второй премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические самолигирующие ProMIM Roth 0,018 дюймов (0,46 мм), нижний правый центральный резец - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические самолигирующие ProMIM Roth 0,018 дюймов (0,46 мм), нижний правый боковой резец - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические самолигирующие ProMIM Roth 0,018 дюймов (0,46 мм), нижний правый клык без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические самолигирующие ProMIM Roth 0,018 дюймов (0,46 мм), нижний правый клык с крючком - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические самолигирующие ProMIM Roth 0,018 дюймов (0,46 мм), нижний правый первый премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические самолигирующие ProMIM Roth 0,018 дюймов (0,46 мм), нижний правый первый премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические самолигирующие ProMIM Roth 0,018 дюймов (0,46 мм), нижний правый второй премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические самолигирующие ProMIM Roth 0,018 дюймов (0,46 мм), нижний правый второй премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- 1.34 Брекеты металлические самолигирующие ProMIM Self-Ligating Roth Bracket 0,022 дюйма (0,56 мм), в вариантах исполнения:
 - Брекеты металлические самолигирующие ProMIM Roth 0,022 дюйма (0,56 мм), верхний правый центральный резец - не более 1000 шт.
 - Брекеты металлические самолигирующие ProMIM Roth 0,022 дюйма (0,56 мм), верхний правый боковой резец - не более 1000 шт.
 - Брекеты металлические самолигирующие ProMIM Roth 0,022 дюйма (0,56 мм), верхний правый клык без крючка - не более 1000 шт.
 - Брекеты металлические самолигирующие ProMIM Roth 0,022 дюйма (0,56 мм), верхний правый клык с крючком - не более 1000 шт.
 - Брекеты металлические самолигирующие ProMIM Roth 0,022 дюйма (0,56 мм), верхний правый первый премоляр без крючка - не более 1000 шт.
 - Брекеты металлические самолигирующие ProMIM Roth 0,022 дюйма (0,56 мм), верхний правый первый премоляр с крючком - не более 1000 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0113407

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 28 ноября 2022 года № РЗН 2022/18940

Лист 62

- Брекеты металлические самолигирующие ProMIM Roth 0,022 дюйма (0,56 мм), верхний правый второй премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические самолигирующие ProMIM Roth 0,022 дюйма (0,56 мм), верхний правый второй премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические самолигирующие ProMIM Roth 0,022 дюйма (0,56 мм), верхний левый центральный резец - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические самолигирующие ProMIM Roth 0,022 дюйма (0,56 мм), верхний левый боковой резец - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические самолигирующие ProMIM Roth 0,022 дюйма (0,56 мм), верхний левый клык без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические самолигирующие ProMIM Roth 0,022 дюйма (0,56 мм), верхний левый клык с крючком - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические самолигирующие ProMIM Roth 0,022 дюйма (0,56 мм), верхний левый первый премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические самолигирующие ProMIM Roth 0,022 дюйма (0,56 мм), верхний левый первый премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические самолигирующие ProMIM Roth 0,022 дюйма (0,56 мм), верхний левый второй премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические самолигирующие ProMIM Roth 0,022 дюйма (0,56 мм), верхний левый второй премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические самолигирующие ProMIM Roth 0,022 дюйма (0,56 мм), нижний левый центральный резец - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические самолигирующие ProMIM Roth 0,022 дюйма (0,56 мм), нижний левый боковой резец - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические самолигирующие ProMIM Roth 0,022 дюйма (0,56 мм), нижний левый клык без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические самолигирующие ProMIM Roth 0,022 дюйма (0,56 мм), нижний левый клык с крючком - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические самолигирующие ProMIM Roth 0,022 дюйма (0,56 мм), нижний левый первый премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические самолигирующие ProMIM Roth 0,022 дюйма (0,56 мм), нижний левый первый премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические самолигирующие ProMIM Roth 0,022 дюйма (0,56 мм), нижний левый второй премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические самолигирующие ProMIM Roth 0,022 дюйма (0,56 мм), нижний левый второй премоляр с крючком - не более 1000 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0113408

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 28 ноября 2022 года № РЗН 2022/18940

Лист 63

- Брекеты металлические самолигирующие ProMIM Roth 0,022 дюйма (0,56 мм), нижний правый центральный резец - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические самолигирующие ProMIM Roth 0,022 дюйма (0,56 мм), нижний правый боковой резец - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические самолигирующие ProMIM Roth 0,022 дюйма (0,56 мм), нижний правый клык без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические самолигирующие ProMIM Roth 0,022 дюйма (0,56 мм), нижний правый клык с крючком - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические самолигирующие ProMIM Roth 0,022 дюйма (0,56 мм), нижний правый первый премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические самолигирующие ProMIM Roth 0,022 дюйма (0,56 мм), нижний правый первый премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические самолигирующие ProMIM Roth 0,022 дюйма (0,56 мм), нижний правый второй премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические самолигирующие ProMIM Roth 0,022 дюйма (0,56 мм), нижний правый второй премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- 1.35 Брекеты металлические самолигирующие ProMIM Self-Ligating McBeTr Bracket 0,018 дюймов (0,46 мм), в вариантах исполнения:
 - Брекеты металлические самолигирующие ProMIM McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм), верхний правый центральный резец - не более 1000 шт.
 - Брекеты металлические самолигирующие ProMIM McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм), верхний правый боковой резец - не более 1000 шт.
 - Брекеты металлические самолигирующие ProMIM McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм), верхний правый клык без крючка - не более 1000 шт.
 - Брекеты металлические самолигирующие ProMIM McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм), верхний правый клык с крючком - не более 1000 шт.
 - Брекеты металлические самолигирующие ProMIM McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм), верхний правый первый премоляр без крючка - не более 1000 шт.
 - Брекеты металлические самолигирующие ProMIM McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм), верхний правый первый премоляр с крючком - не более 1000 шт.
 - Брекеты металлические самолигирующие ProMIM McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм), верхний правый второй премоляр без крючка - не более 1000 шт.
 - Брекеты металлические самолигирующие ProMIM McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм), верхний правый второй премоляр с крючком - не более 1000 шт.
 - Брекеты металлические самолигирующие ProMIM McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм), верхний левый центральный резец - не более 1000 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0113409

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 28 ноября 2022 года № РЗН 2022/18940

Лист 64

- Брекеты металлические самолигирующие ProMIM McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм), верхний левый боковой резец - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические самолигирующие ProMIM McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм), верхний левый клык без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические самолигирующие ProMIM McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм), верхний левый клык с крючком - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические самолигирующие ProMIM McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм), верхний левый первый премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические самолигирующие ProMIM McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм), верхний левый первый премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические самолигирующие ProMIM McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм), верхний левый второй премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические самолигирующие ProMIM McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм), верхний левый второй премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические самолигирующие ProMIM McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм), нижний левый центральный резец - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические самолигирующие ProMIM McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм), нижний левый боковой резец - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические самолигирующие ProMIM McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм), нижний левый клык без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические самолигирующие ProMIM McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм), нижний левый клык с крючком - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические самолигирующие ProMIM McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм), нижний левый первый премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические самолигирующие ProMIM McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм), нижний левый первый премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические самолигирующие ProMIM McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм), нижний левый второй премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические самолигирующие ProMIM McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм), нижний левый второй премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические самолигирующие ProMIM McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм), нижний правый центральный резец - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические самолигирующие ProMIM McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм), нижний правый боковой резец - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические самолигирующие ProMIM McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм), нижний правый клык без крючка - не более 1000 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0113410

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 28 ноября 2022 года

№ РЗН 2022/18940

Лист 65

- Брекеты металлические самолигирующие ProMIM McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм), нижний правый клык с крючком - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические самолигирующие ProMIM McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм), нижний правый первый премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические самолигирующие ProMIM McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм), нижний правый первый премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические самолигирующие ProMIM McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм), нижний правый второй премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические самолигирующие ProMIM McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм), нижний правый второй премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- 1.36 Брекеты металлические самолигирующие ProMIM Self-Ligating McBeTr Bracket 0,022 дюйма (0,56 мм), в вариантах исполнения:
 - Брекеты металлические самолигирующие ProMIM McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм), верхний правый центральный резец - не более 1000 шт.
 - Брекеты металлические самолигирующие ProMIM McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм), верхний правый боковой резец - не более 1000 шт.
 - Брекеты металлические самолигирующие ProMIM McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм), верхний правый клык без крючка - не более 1000 шт.
 - Брекеты металлические самолигирующие ProMIM McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм), верхний правый клык с крючком - не более 1000 шт.
 - Брекеты металлические самолигирующие ProMIM McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм), верхний правый первый премоляр без крючка - не более 1000 шт.
 - Брекеты металлические самолигирующие ProMIM McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм), верхний правый первый премоляр с крючком - не более 1000 шт.
 - Брекеты металлические самолигирующие ProMIM McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм), верхний правый второй премоляр без крючка - не более 1000 шт.
 - Брекеты металлические самолигирующие ProMIM McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм), верхний правый второй премоляр с крючком - не более 1000 шт.
 - Брекеты металлические самолигирующие ProMIM McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм), верхний левый центральный резец - не более 1000 шт.
 - Брекеты металлические самолигирующие ProMIM McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм), верхний левый боковой резец - не более 1000 шт.
 - Брекеты металлические самолигирующие ProMIM McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм), верхний левый клык без крючка - не более 1000 шт.
 - Брекеты металлические самолигирующие ProMIM McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм), верхний левый клык с крючком - не более 1000 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0113411

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 28 ноября 2022 года № РЗН 2022/18940

Лист 66

- Брекеты металлические самолигирующие ProMIM McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм), верхний левый первый премоляр без крючка - не более 1000 шт. .
- Брекеты металлические самолигирующие ProMIM McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм), верхний левый первый премоляр с крючком - не более 1000 шт. .
- Брекеты металлические самолигирующие ProMIM McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм), верхний левый второй премоляр без крючка - не более 1000 шт. .
- Брекеты металлические самолигирующие ProMIM McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм), верхний левый второй премоляр с крючком - не более 1000 шт. .
- Брекеты металлические самолигирующие ProMIM McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм), нижний левый центральный резец - не более 1000 шт. .
- Брекеты металлические самолигирующие ProMIM McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм), нижний левый боковой резец - не более 1000 шт. .
- Брекеты металлические самолигирующие ProMIM McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм), нижний левый клык без крючка - не более 1000 шт. .
- Брекеты металлические самолигирующие ProMIM McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм), нижний левый клык с крючком - не более 1000 шт. .
- Брекеты металлические самолигирующие ProMIM McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм), нижний левый первый премоляр без крючка - не более 1000 шт. .
- Брекеты металлические самолигирующие ProMIM McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм), нижний левый первый премоляр с крючком - не более 1000 шт. .
- Брекеты металлические самолигирующие ProMIM McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм), нижний левый второй премоляр без крючка - не более 1000 шт. .
- Брекеты металлические самолигирующие ProMIM McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм), нижний левый второй премоляр с крючком - не более 1000 шт. .
- Брекеты металлические самолигирующие ProMIM McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм), нижний правый центральный резец - не более 1000 шт. .
- Брекеты металлические самолигирующие ProMIM McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм), нижний правый боковой резец - не более 1000 шт. .
- Брекеты металлические самолигирующие ProMIM McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм), нижний правый клык без крючка - не более 1000 шт. .
- Брекеты металлические самолигирующие ProMIM McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм), нижний правый клык с крючком - не более 1000 шт. .
- Брекеты металлические самолигирующие ProMIM McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм), нижний правый первый премоляр без крючка - не более 1000 шт. .
- Брекеты металлические самолигирующие ProMIM McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм), нижний правый первый премоляр с крючком - не более 1000 шт. .

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0113412

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 28 ноября 2022 года

№ РЗН 2022/18940

Лист 67

- Брекеты металлические самолигирующие ProMIM McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм), нижний правый второй премоляр без крючка - не более 1000 шт. .
- Брекеты металлические самолигирующие ProMIM McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм), нижний правый второй премоляр с крючком - не более 1000 шт. .
- 1.37 Брекеты металлические самолигирующие ActMIM Self-Ligating Roth Bracket 0,018 дюймов (0,46 мм) , в вариантах исполнения:
- Брекеты металлические самолигирующие ActMIM Roth 0,018 дюймов (0,46 мм), верхний правый центральный резец - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические самолигирующие ActMIM Roth 0,018 дюймов (0,46 мм), верхний правый боковой резец - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические самолигирующие ActMIM Roth 0,018 дюймов (0,46 мм), верхний правый клык без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические самолигирующие ActMIM Roth 0,018 дюймов (0,46 мм), верхний правый клык с крючком - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические самолигирующие ActMIM Roth 0,018 дюймов (0,46 мм), верхний правый первый премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические самолигирующие ActMIM Roth 0,018 дюймов (0,46 мм), верхний правый первый премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические самолигирующие ActMIM Roth 0,018 дюймов (0,46 мм), верхний правый второй премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические самолигирующие ActMIM Roth 0,018 дюймов (0,46 мм), верхний правый второй премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические самолигирующие ActMIM Roth 0,018 дюймов (0,46 мм), верхний левый центральный резец - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические самолигирующие ActMIM Roth 0,018 дюймов (0,46 мм), верхний левый боковой резец - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические самолигирующие ActMIM Roth 0,018 дюймов (0,46 мм), верхний левый клык без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические самолигирующие ActMIM Roth 0,018 дюймов (0,46 мм), верхний левый клык с крючком - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические самолигирующие ActMIM Roth 0,018 дюймов (0,46 мм), верхний левый первый премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические самолигирующие ActMIM Roth 0,018 дюймов (0,46 мм), верхний левый первый премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические самолигирующие ActMIM Roth 0,018 дюймов (0,46 мм), верхний левый второй премоляр без крючка - не более 1000 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0113413

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 28 ноября 2022 года № РЗН 2022/18940

Лист 68

- Брекеты металлические самолигирующие ActMIM Roth 0,018 дюймов (0,46 мм), верхний левый второй премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические самолигирующие ActMIM Roth 0,018 дюймов (0,46 мм), нижний левый центральный резец - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические самолигирующие ActMIM Roth 0,018 дюймов (0,46 мм), нижний левый боковой резец - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические самолигирующие ActMIM Roth 0,018 дюймов (0,46 мм), нижний левый клык без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические самолигирующие ActMIM Roth 0,018 дюймов (0,46 мм), нижний левый клык с крючком - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические самолигирующие ActMIM Roth 0,018 дюймов (0,46 мм), нижний левый первый премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические самолигирующие ActMIM Roth 0,018 дюймов (0,46 мм), нижний левый первый премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические самолигирующие ActMIM Roth 0,018 дюймов (0,46 мм), нижний левый второй премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические самолигирующие ActMIM Roth 0,018 дюймов (0,46 мм), нижний левый второй премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические самолигирующие ActMIM Roth 0,018 дюймов (0,46 мм), нижний правый центральный резец - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические самолигирующие ActMIM Roth 0,018 дюймов (0,46 мм), нижний правый боковой резец - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические самолигирующие ActMIM Roth 0,018 дюймов (0,46 мм), нижний правый клык без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические самолигирующие ActMIM Roth 0,018 дюймов (0,46 мм), нижний правый клык с крючком - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические самолигирующие ActMIM Roth 0,018 дюймов (0,46 мм), нижний правый первый премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические самолигирующие ActMIM Roth 0,018 дюймов (0,46 мм), нижний правый первый премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические самолигирующие ActMIM Roth 0,018 дюймов (0,46 мм), нижний правый второй премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические самолигирующие ActMIM Roth 0,018 дюймов (0,46 мм), нижний правый второй премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- 1.38 Брекеты металлические самолигирующие ActMIM Self-Ligating Roth Bracket 0,022 дюйма (0,56 мм), в вариантах исполнения:

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0113414


ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 28 ноября 2022 года № РЗН 2022/18940

Лист 69

- Брекеты металлические самолигирующие ActMIM Roth 0,022 дюйма (0,56 мм), верхний правый центральный резец - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические самолигирующие ActMIM Roth 0,022 дюйма (0,56 мм), верхний правый боковой резец - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические самолигирующие ActMIM Roth 0,022 дюйма (0,56 мм), верхний правый клык без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические самолигирующие ActMIM Roth 0,022 дюйма (0,56 мм), верхний правый клык с крючком - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические самолигирующие ActMIM Roth 0,022 дюйма (0,56 мм), верхний правый первый премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические самолигирующие ActMIM Roth 0,022 дюйма (0,56 мм), верхний правый первый премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические самолигирующие ActMIM Roth 0,022 дюйма (0,56 мм), верхний правый второй премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические самолигирующие ActMIM Roth 0,022 дюйма (0,56 мм), верхний правый второй премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические самолигирующие ActMIM Roth 0,022 дюйма (0,56 мм), верхний левый центральный резец - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические самолигирующие ActMIM Roth 0,022 дюйма (0,56 мм), верхний левый боковой резец - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические самолигирующие ActMIM Roth 0,022 дюйма (0,56 мм), верхний левый клык без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические самолигирующие ActMIM Roth 0,022 дюйма (0,56 мм), верхний левый клык с крючком - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические самолигирующие ActMIM Roth 0,022 дюйма (0,56 мм), верхний левый первый премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические самолигирующие ActMIM Roth 0,022 дюйма (0,56 мм), верхний левый первый премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические самолигирующие ActMIM Roth 0,022 дюйма (0,56 мм), верхний левый второй премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические самолигирующие ActMIM Roth 0,022 дюйма (0,56 мм), верхний левый второй премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические самолигирующие ActMIM Roth 0,022 дюйма (0,56 мм), нижний левый центральный резец - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические самолигирующие ActMIM Roth 0,022 дюйма (0,56 мм), нижний левый боковой резец - не более 1000 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

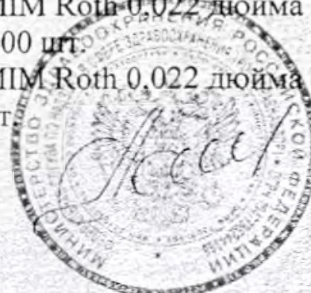

А.В. Самойлова

0113415

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 28 ноября 2022 года № РЗН 2022/18940

Лист 70

- Брекеты металлические самолигирующие ActMIM Roth 0,022 дюйма (0,56 мм), нижний левый клык без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические самолигирующие ActMIM Roth 0,022 дюйма (0,56 мм), нижний левый клык с крючком - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические самолигирующие ActMIM Roth 0,022 дюйма (0,56 мм), нижний левый первый премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические самолигирующие ActMIM Roth 0,022 дюйма (0,56 мм), нижний левый первый премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические самолигирующие ActMIM Roth 0,022 дюйма (0,56 мм), нижний левый второй премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические самолигирующие ActMIM Roth 0,022 дюйма (0,56 мм), нижний левый второй премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические самолигирующие ActMIM Roth 0,022 дюйма (0,56 мм), нижний правый центральный резец - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические самолигирующие ActMIM Roth 0,022 дюйма (0,56 мм), нижний правый боковой резец - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические самолигирующие ActMIM Roth 0,022 дюйма (0,56 мм), нижний правый клык без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические самолигирующие ActMIM Roth 0,022 дюйма (0,56 мм), нижний правый клык с крючком - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические самолигирующие ActMIM Roth 0,022 дюйма (0,56 мм), нижний правый первый премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические самолигирующие ActMIM Roth 0,022 дюйма (0,56 мм), нижний правый первый премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические самолигирующие ActMIM Roth 0,022 дюйма (0,56 мм), нижний правый второй премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические самолигирующие ActMIM Roth 0,022 дюйма (0,56 мм), нижний правый второй премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- 1.39 Брекеты металлические самолигирующие ActMIM Self-Ligating Roth+ Bracket 0,018 дюймов (0,46 мм), в вариантах исполнения:
 - Брекеты металлические самолигирующие ActMIM Self-Ligating Roth+ 0,018 дюймов (0,46 мм), верхний правый центральный резец - не более 1000 шт.
 - Брекеты металлические самолигирующие ActMIM Self-Ligating Roth+ 0,018 дюймов (0,46 мм), с низким торком, верхний правый центральный резец - не более 1000 шт.
 - Брекеты металлические самолигирующие ActMIM Self-Ligating Roth+ 0,018 дюймов (0,46 мм), верхний правый боковой резец - не более 1000 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова



0113416

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 28 ноября 2022 года № РЗН 2022/18940

Лист 71

- Брекеты металлические самолигирующие ActMIM Self-Ligating Roth+ 0,018 дюймов (0,46 мм), с низким торком, верхний правый боковой резец - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические самолигирующие ActMIM Self-Ligating Roth+ 0,018 дюймов (0,46 мм), верхний правый клык без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические самолигирующие ActMIM Self-Ligating Roth+ 0,018 дюймов (0,46 мм), верхний правый клык с крючком - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические самолигирующие ActMIM Self-Ligating Roth+ 0,018 дюймов (0,46 мм), с низким торком, верхний правый клык с крючком - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические самолигирующие ActMIM Self-Ligating Roth+ 0,018 дюймов (0,46 мм), верхний правый первый премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические самолигирующие ActMIM Self-Ligating Roth+ 0,018 дюймов (0,46 мм), верхний правый первый премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические самолигирующие ActMIM Self-Ligating Roth+ 0,018 дюймов (0,46 мм), верхний правый второй премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические самолигирующие ActMIM Self-Ligating Roth+ 0,018 дюймов (0,46 мм), верхний правый второй премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические самолигирующие ActMIM Self-Ligating Roth+ 0,018 дюймов (0,46 мм), верхний левый центральный резец - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические самолигирующие ActMIM Self-Ligating Roth+ 0,018 дюймов (0,46 мм), с низким торком, верхний левый центральный резец - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические самолигирующие ActMIM Self-Ligating Roth+ 0,018 дюймов (0,46 мм), верхний левый боковой резец - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические самолигирующие ActMIM Self-Ligating Roth+ 0,018 дюймов (0,46 мм), с низким торком, верхний левый боковой резец - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические самолигирующие ActMIM Self-Ligating Roth+ 0,018 дюймов (0,46 мм), верхний левый клык без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические самолигирующие ActMIM Self-Ligating Roth+ 0,018 дюймов (0,46 мм), верхний левый клык с крючком - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические самолигирующие ActMIM Self-Ligating Roth+ 0,018 дюймов (0,46 мм), с низким торком, верхний левый клык с крючком - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические самолигирующие ActMIM Self-Ligating Roth+ 0,018 дюймов (0,46 мм), верхний левый первый премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические самолигирующие ActMIM Self-Ligating Roth+ 0,018 дюймов (0,46 мм), верхний левый первый премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические самолигирующие ActMIM Self-Ligating Roth+ 0,018 дюймов (0,46 мм), верхний левый второй премоляр без крючка - не более 1000 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0113417

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 28 ноября 2022 года № РЗН 2022/18940

Лист 72

- Брекет металлический самолигирующий ActMIM Self-Ligating Roth+ 0,018 дюймов (0,46 мм), верхний левый второй премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекет металлический самолигирующий ActMIM Self-Ligating Roth+ 0,018 дюймов (0,46 мм), нижний левый центральный резец - не более 1000 шт.
- Брекет металлический самолигирующий ActMIM Self-Ligating Roth+ 0,018 дюймов (0,46 мм), с высоким торком, нижний левый центральный резец - не более 1000 шт.
- Брекет металлический самолигирующий ActMIM Self-Ligating Roth+ 0,018 дюймов (0,46 мм), нижний левый боковой резец - не более 1000 шт.
- Брекет металлический самолигирующий ActMIM Self-Ligating Roth+ 0,018 дюймов (0,46 мм), с высоким торком, нижний левый боковой резец - не более 1000 шт.
- Брекет металлический самолигирующий ActMIM Self-Ligating Roth+ 0,018 дюймов (0,46 мм), нижний левый клык без крючка - не более 1000 шт.
- Брекет металлический самолигирующий ActMIM Self-Ligating Roth+ 0,018 дюймов (0,46 мм), нижний левый клык с крючком - не более 1000 шт.
- Брекет металлический самолигирующий ActMIM Self-Ligating Roth+ 0,018 дюймов (0,46 мм), нижний левый первый премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекет металлический самолигирующий ActMIM Self-Ligating Roth+ 0,018 дюймов (0,46 мм), нижний левый первый премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекет металлический самолигирующий ActMIM Self-Ligating Roth+ 0,018 дюймов (0,46 мм), нижний левый второй премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекет металлический самолигирующий ActMIM Self-Ligating Roth+ 0,018 дюймов (0,46 мм), нижний левый второй премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекет металлический самолигирующий ActMIM Self-Ligating Roth+ 0,018 дюймов (0,46 мм), нижний правый центральный резец - не более 1000 шт.
- Брекет металлический самолигирующий ActMIM Self-Ligating Roth+ 0,018 дюймов (0,46 мм), с высоким торком, нижний правый центральный резец - не более 1000 шт.
- Брекет металлический самолигирующий ActMIM Self-Ligating Roth+ 0,018 дюймов (0,46 мм), нижний правый боковой резец - не более 1000 шт.
- Брекет металлический самолигирующий ActMIM Self-Ligating Roth+ 0,018 дюймов (0,46 мм), с высоким торком, нижний правый боковой резец - не более 1000 шт.
- Брекет металлический самолигирующий ActMIM Self-Ligating Roth+ 0,018 дюймов (0,46 мм), нижний правый клык без крючка - не более 1000 шт.
- Брекет металлический самолигирующий ActMIM Self-Ligating Roth+ 0,018 дюймов (0,46 мм), нижний правый клык с крючком - не более 1000 шт.
- Брекет металлический самолигирующий ActMIM Self-Ligating Roth+ 0,018 дюймов (0,46 мм), нижний правый первый премоляр без крючка - не более 1000 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0113418

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 28 ноября 2022 года № РЗН 2022/18940

Лист 73

- Брекеты металлические самолигирующие ActMIM Self-Ligating Roth+ 0,018 дюймов (0,46 мм), нижний правый первый премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические самолигирующие ActMIM Self-Ligating Roth+ 0,018 дюймов (0,46 мм), нижний правый второй премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические самолигирующие ActMIM Self-Ligating Roth+ 0,018 дюймов (0,46 мм), нижний правый второй премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- 1.40 Брекеты металлические самолигирующие ActMIM Self-Ligating Roth+ Bracket 0,022 дюйма (0,56 мм), в вариантах исполнения:
 - Брекеты металлические самолигирующие ActMIM Self-Ligating Roth+ 0,022 дюйма (0,56 мм), верхний правый центральный резец - не более 1000 шт.
 - Брекеты металлические самолигирующие ActMIM Self-Ligating Roth+ 0,022 дюйма (0,56 мм), с низким торком, верхний правый центральный резец - не более 1000 шт.
 - Брекеты металлические самолигирующие ActMIM Self-Ligating Roth+ 0,022 дюйма (0,56 мм), верхний правый боковой резец - не более 1000 шт.
 - Брекеты металлические самолигирующие ActMIM Self-Ligating Roth+ 0,022 дюйма (0,56 мм), с низким торком, верхний правый боковой резец - не более 1000 шт.
 - Брекеты металлические самолигирующие ActMIM Self-Ligating Roth+ 0,022 дюйма (0,56 мм), верхний правый клык без крючка - не более 1000 шт.
 - Брекеты металлические самолигирующие ActMIM Self-Ligating Roth+ 0,022 дюйма (0,56 мм), верхний правый клык с крючком - не более 1000 шт.
 - Брекеты металлические самолигирующие ActMIM Self-Ligating Roth+ 0,022 дюйма (0,56 мм), с низким торком, верхний правый клык с крючком - не более 1000 шт.
 - Брекеты металлические самолигирующие ActMIM Self-Ligating Roth+ 0,022 дюйма (0,56 мм), верхний правый первый премоляр без крючка - не более 1000 шт.
 - Брекеты металлические самолигирующие ActMIM Self-Ligating Roth+ 0,022 дюйма (0,56 мм), верхний правый первый премоляр с крючком - не более 1000 шт.
 - Брекеты металлические самолигирующие ActMIM Self-Ligating Roth+ 0,022 дюйма (0,56 мм), верхний правый второй премоляр без крючка - не более 1000 шт.
 - Брекеты металлические самолигирующие ActMIM Self-Ligating Roth+ 0,022 дюйма (0,56 мм), верхний правый второй премоляр с крючком - не более 1000 шт.
 - Брекеты металлические самолигирующие ActMIM Self-Ligating Roth+ 0,022 дюйма (0,56 мм), верхний левый центральный резец - не более 1000 шт.
 - Брекеты металлические самолигирующие ActMIM Self-Ligating Roth+ 0,022 дюйма (0,56 мм), с низким торком, верхний левый центральный резец - не более 1000 шт.
 - Брекеты металлические самолигирующие ActMIM Self-Ligating Roth+ 0,022 дюйма (0,56 мм), верхний левый боковой резец - не более 1000 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0113419

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 28 ноября 2022 года № РЗН 2022/18940

Лист 74

- Брекеты металлические самолигирующие ActMIM Self-Ligating Roth+ 0,022 дюйма (0,56 мм), с низким торком, верхний левый боковой резец - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические самолигирующие ActMIM Self-Ligating Roth+ 0,022 дюйма (0,56 мм), верхний левый клык без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические самолигирующие ActMIM Self-Ligating Roth+ 0,022 дюйма (0,56 мм), верхний левый клык с крючком - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические самолигирующие ActMIM Self-Ligating Roth+ 0,022 дюйма (0,56 мм), с низким торком, верхний левый клык с крючком - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические самолигирующие ActMIM Self-Ligating Roth+ 0,022 дюйма (0,56 мм), верхний левый первый премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические самолигирующие ActMIM Self-Ligating Roth+ 0,022 дюйма (0,56 мм), верхний левый первый премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические самолигирующие ActMIM Self-Ligating Roth+ 0,022 дюйма (0,56 мм), верхний левый второй премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические самолигирующие ActMIM Self-Ligating Roth+ 0,022 дюйма (0,56 мм), верхний левый второй премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические самолигирующие ActMIM Self-Ligating Roth+ 0,022 дюйма (0,56 мм), нижний левый центральный резец - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические самолигирующие ActMIM Self-Ligating Roth+ 0,022 дюйма (0,56 мм), с высоким торком, нижний левый центральный резец - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические самолигирующие ActMIM Self-Ligating Roth+ 0,022 дюйма (0,56 мм), нижний левый боковой резец - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические самолигирующие ActMIM Self-Ligating Roth+ 0,022 дюйма (0,56 мм), с высоким торком, нижний левый боковой резец - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические самолигирующие ActMIM Self-Ligating Roth+ 0,022 дюйма (0,56 мм), нижний левый клык без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические самолигирующие ActMIM Self-Ligating Roth+ 0,022 дюйма (0,56 мм), нижний левый клык с крючком - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические самолигирующие ActMIM Self-Ligating Roth+ 0,022 дюйма (0,56 мм), нижний левый первый премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические самолигирующие ActMIM Self-Ligating Roth+ 0,022 дюйма (0,56 мм), нижний левый первый премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические самолигирующие ActMIM Self-Ligating Roth+ 0,022 дюйма (0,56 мм), нижний левый второй премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические самолигирующие ActMIM Self-Ligating Roth+ 0,022 дюйма (0,56 мм), нижний левый второй премоляр с крючком - не более 1000 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0113420

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 28 ноября 2022 года № РЗН 2022/18940

Лист 75

- Брекет металлический самолигирующий ActMIM Self-Ligating Roth+ 0,022 дюйма (0,56 мм), нижний правый центральный резец - не более 1000 шт.
- Брекет металлический самолигирующий ActMIM Self-Ligating Roth+ 0,022 дюйма (0,56 мм), с высоким торком, нижний правый центральный резец - не более 1000 шт.
- Брекет металлический самолигирующий ActMIM Self-Ligating Roth+ 0,022 дюйма (0,56 мм), нижний правый боковой резец - не более 1000 шт.
- Брекет металлический самолигирующий ActMIM Self-Ligating Roth+ 0,022 дюйма (0,56 мм), с высоким торком, нижний правый боковой резец - не более 1000 шт.
- Брекет металлический самолигирующий ActMIM Self-Ligating Roth+ 0,022 дюйма (0,56 мм), нижний правый клык без крючка - не более 1000 шт.
- Брекет металлический самолигирующий ActMIM Self-Ligating Roth+ 0,022 дюйма (0,56 мм), нижний правый клык с крючком - не более 1000 шт.
- Брекет металлический самолигирующий ActMIM Self-Ligating Roth+ 0,022 дюйма (0,56 мм), нижний правый первый премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекет металлический самолигирующий ActMIM Self-Ligating Roth+ 0,022 дюйма (0,56 мм), нижний правый первый премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекет металлический самолигирующий ActMIM Self-Ligating Roth+ 0,022 дюйма (0,56 мм), нижний правый второй премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекет металлический самолигирующий ActMIM Self-Ligating Roth+ 0,022 дюйма (0,56 мм), нижний правый второй премоляр с крючком - не более 1000 шт.

1.41 Брекет металлический самолигирующий ActMIM Self-Ligating McBeTr Bracket 0,018 дюймов (0,46 мм), в вариантах исполнения:

- Брекет металлический самолигирующий ActMIM McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм), верхний правый центральный резец - не более 1000 шт.
- Брекет металлический самолигирующий ActMIM McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм), верхний правый боковой резец - не более 1000 шт.
- Брекет металлический самолигирующий ActMIM McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм), верхний правый клык без крючка - не более 1000 шт.
- Брекет металлический самолигирующий ActMIM McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм), верхний правый клык с крючком - не более 1000 шт.
- Брекет металлический самолигирующий ActMIM McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм), верхний правый первый премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекет металлический самолигирующий ActMIM McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм), верхний правый первый премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекет металлический самолигирующий ActMIM McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм),

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0113421

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 28 ноября 2022 года № РЗН 2022/18940

Лист 76

- верхний правый второй премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекет металлический самолигирующий ActMIM McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм), верхний правый второй премоляр с крючком - не более 1000 шт.
 - Брекет металлический самолигирующий ActMIM McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм), верхний левый центральный резец - не более 1000 шт.
 - Брекет металлический самолигирующий ActMIM McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм), верхний левый боковой резец - не более 1000 шт.
 - Брекет металлический самолигирующий ActMIM McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм), верхний левый клык без крючка - не более 1000 шт.
 - Брекет металлический самолигирующий ActMIM McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм), верхний левый клык с крючком - не более 1000 шт.
 - Брекет металлический самолигирующий ActMIM McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм), верхний левый первый премоляр без крючка - не более 1000 шт.
 - Брекет металлический самолигирующий ActMIM McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм), верхний левый первый премоляр с крючком - не более 1000 шт.
 - Брекет металлический самолигирующий ActMIM McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм), верхний левый второй премоляр без крючка - не более 1000 шт.
 - Брекет металлический самолигирующий ActMIM McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм), верхний левый второй премоляр с крючком - не более 1000 шт.
 - Брекет металлический самолигирующий ActMIM McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм), нижний левый центральный резец - не более 1000 шт.
 - Брекет металлический самолигирующий ActMIM McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм), нижний левый боковой резец - не более 1000 шт.
 - Брекет металлический самолигирующий ActMIM McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм), нижний левый клык без крючка - не более 1000 шт.
 - Брекет металлический самолигирующий ActMIM McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм), нижний левый клык с крючком - не более 1000 шт.
 - Брекет металлический самолигирующий ActMIM McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм), нижний левый первый премоляр без крючка - не более 1000 шт.
 - Брекет металлический самолигирующий ActMIM McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм), нижний левый первый премоляр с крючком - не более 1000 шт.
 - Брекет металлический самолигирующий ActMIM McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм), нижний левый второй премоляр без крючка - не более 1000 шт.
 - Брекет металлический самолигирующий ActMIM McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм), нижний левый второй премоляр с крючком - не более 1000 шт.
 - Брекет металлический самолигирующий ActMIM McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм),

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова



0113422

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 28 ноября 2022 года № РЗН 2022/18940

Лист 77

- нижний правый центральный резец - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические самолигирующие ActMIM McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм), нижний правый боковой резец - не более 1000 шт.
 - Брекеты металлические самолигирующие ActMIM McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм), нижний правый клык без крючка - не более 1000 шт.
 - Брекеты металлические самолигирующие ActMIM McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм), нижний правый клык с крючком - не более 1000 шт.
 - Брекеты металлические самолигирующие ActMIM McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм), нижний правый первый премоляр без крючка - не более 1000 шт.
 - Брекеты металлические самолигирующие ActMIM McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм), нижний правый первый премоляр с крючком - не более 1000 шт.
 - Брекеты металлические самолигирующие ActMIM McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм), нижний правый второй премоляр без крючка - не более 1000 шт.
 - Брекеты металлические самолигирующие ActMIM McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм), нижний правый второй премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- 1.42 Брекеты металлические самолигирующие ActMIM Self-Ligating McBeTr Bracket 0,022 дюйма (0,56 мм), в вариантах исполнения:
- Брекеты металлические самолигирующие ActMIM McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм), верхний правый центральный резец - не более 1000 шт.
 - Брекеты металлические самолигирующие ActMIM McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм), верхний правый боковой резец - не более 1000 шт.
 - Брекеты металлические самолигирующие ActMIM McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм), верхний правый клык без крючка - не более 1000 шт.
 - Брекеты металлические самолигирующие ActMIM McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм), верхний правый клык с крючком - не более 1000 шт.
 - Брекеты металлические самолигирующие ActMIM McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм), верхний правый первый премоляр без крючка - не более 1000 шт.
 - Брекеты металлические самолигирующие ActMIM McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм), верхний правый первый премоляр с крючком - не более 1000 шт.
 - Брекеты металлические самолигирующие ActMIM McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм), верхний правый второй премоляр без крючка - не более 1000 шт.
 - Брекеты металлические самолигирующие ActMIM McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм), верхний правый второй премоляр с крючком - не более 1000 шт.
 - Брекеты металлические самолигирующие ActMIM McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм), верхний левый центральный резец - не более 1000 шт.
 - Брекеты металлические самолигирующие ActMIM McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм),

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0113423

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 28 ноября 2022 года № РЗН 2022/18940

Лист 78

- верхний левый боковой резец - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические самолигирующие ActMIM McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм), верхний левый клык без крючка - не более 1000 шт.
 - Брекеты металлические самолигирующие ActMIM McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм), верхний левый клык с крючком - не более 1000 шт.
 - Брекеты металлические самолигирующие ActMIM McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм), верхний левый первый премоляр без крючка - не более 1000 шт.
 - Брекеты металлические самолигирующие ActMIM McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм), верхний левый первый премоляр с крючком - не более 1000 шт.
 - Брекеты металлические самолигирующие ActMIM McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм), верхний левый второй премоляр без крючка - не более 1000 шт.
 - Брекеты металлические самолигирующие ActMIM McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм), верхний левый второй премоляр с крючком - не более 1000 шт.
 - Брекеты металлические самолигирующие ActMIM McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм), нижний левый центральный резец - не более 1000 шт.
 - Брекеты металлические самолигирующие ActMIM McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм), нижний левый боковой резец - не более 1000 шт.
 - Брекеты металлические самолигирующие ActMIM McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм), нижний левый клык без крючка - не более 1000 шт.
 - Брекеты металлические самолигирующие ActMIM McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм), нижний левый клык с крючком - не более 1000 шт.
 - Брекеты металлические самолигирующие ActMIM McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм), нижний левый первый премоляр без крючка - не более 1000 шт.
 - Брекеты металлические самолигирующие ActMIM McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм), нижний левый первый премоляр с крючком - не более 1000 шт.
 - Брекеты металлические самолигирующие ActMIM McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм), нижний левый второй премоляр без крючка - не более 1000 шт.
 - Брекеты металлические самолигирующие ActMIM McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм), нижний левый второй премоляр с крючком - не более 1000 шт.
 - Брекеты металлические самолигирующие ActMIM McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм), нижний правый центральный резец - не более 1000 шт.
 - Брекеты металлические самолигирующие ActMIM McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм), нижний правый боковой резец - не более 1000 шт.
 - Брекеты металлические самолигирующие ActMIM McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм), нижний правый клык без крючка - не более 1000 шт.
 - Брекеты металлические самолигирующие ActMIM McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм),

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0113424

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 28 ноября 2022 года № РЗН 2022/18940

Лист 79

нижний правый клык с крючком - не более 1000 шт.

- Брекет металлический самолигирующий ActMIM McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм),

нижний правый первый премоляр без крючка - не более 1000 шт.

- Брекет металлический самолигирующий ActMIM McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм),

нижний правый первый премоляр с крючком - не более 1000 шт.

- Брекет металлический самолигирующий ActMIM McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм),

нижний правый второй премоляр без крючка - не более 1000 шт.

- Брекет металлический самолигирующий ActMIM McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм),

нижний правый второй премоляр с крючком - не более 1000 шт.

2. Брекетты керамические, в вариантах исполнения:

2.1 Брекет керамический Amora Edgewise Esthetic Bracket 0,018 дюймов (0,46 мм), в вариантах исполнения:

- Брекет керамический Amora Edgewise 0,018 дюймов (0,46 мм), верхний правый центральный резец - не более 1000 шт.

- Брекет керамический Amora Edgewise 0,018 дюймов (0,46 мм), верхний правый боковой резец - не более 1000 шт.

- Брекет керамический Amora Edgewise 0,018 дюймов (0,46 мм), верхний правый клык без крючка - не более 1000 шт.

- Брекет керамический Amora Edgewise 0,018 дюймов (0,46 мм), верхний правый клык с крючком - не более 1000 шт.

- Брекет керамический Amora Edgewise 0,018 дюймов (0,46 мм), верхний правый первый премоляр без крючка - не более 1000 шт.

- Брекет керамический Amora Edgewise 0,018 дюймов (0,46 мм), верхний правый первый премоляр с крючком - не более 1000 шт.

- Брекет керамический Amora Edgewise 0,018 дюймов (0,46 мм), верхний правый второй премоляр без крючка - не более 1000 шт.

- Брекет керамический Amora Edgewise 0,018 дюймов (0,46 мм), верхний правый второй премоляр с крючком - не более 1000 шт.


- Брекет керамический Amora Edgewise 0,018 дюймов (0,46 мм), верхний левый центральный резец - не более 1000 шт.

- Брекет керамический Amora Edgewise 0,018 дюймов (0,46 мм), верхний левый боковой резец - не более 1000 шт.

- Брекет керамический Amora Edgewise 0,018 дюймов (0,46 мм), верхний левый клык без крючка - не более 1000 шт.

- Брекет керамический Amora Edgewise 0,018 дюймов (0,46 мм), верхний левый клык с крючком - не более 1000 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

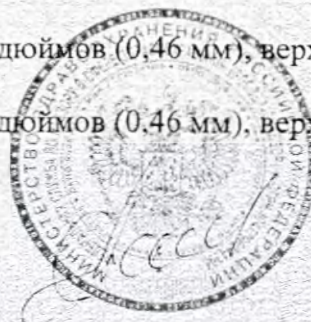

А.В. Самойлова

0113425

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 28 ноября 2022 года № РЗН 2022/18940

Лист 80

- Брекеты керамические Amora Edgewise 0,018 дюймов (0,46 мм), верхний левый первый премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические Amora Edgewise 0,018 дюймов (0,46 мм), верхний левый первый премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические Amora Edgewise 0,018 дюймов (0,46 мм), верхний левый второй премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические Amora Edgewise 0,018 дюймов (0,46 мм), верхний левый второй премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические Amora Edgewise 0,018 дюймов (0,46 мм), нижний левый центральный резец - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические Amora Edgewise 0,018 дюймов (0,46 мм), нижний левый боковой резец - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические Amora Edgewise 0,018 дюймов (0,46 мм), нижний левый клык без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические Amora Edgewise 0,018 дюймов (0,46 мм), нижний левый клык с крючком - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические Amora Edgewise 0,018 дюймов (0,46 мм), нижний левый первый премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические Amora Edgewise 0,018 дюймов (0,46 мм), нижний левый первый премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические Amora Edgewise 0,018 дюймов (0,46 мм), нижний левый второй премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические Amora Edgewise 0,018 дюймов (0,46 мм), нижний левый второй премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические Amora Edgewise 0,018 дюймов (0,46 мм), нижний правый центральный резец - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические Amora Edgewise 0,018 дюймов (0,46 мм), нижний правый боковой резец - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические Amora Edgewise 0,018 дюймов (0,46 мм), нижний правый клык без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические Amora Edgewise 0,018 дюймов (0,46 мм), нижний правый клык с крючком - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические Amora Edgewise 0,018 дюймов (0,46 мм), нижний правый первый премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические Amora Edgewise 0,018 дюймов (0,46 мм), нижний правый первый премоляр с крючком - не более 1000 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0113426

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 28 ноября 2022 года № РЗН 2022/18940

Лист 81

- Брекеты керамические Amora Edgewise 0,018 дюймов (0,46 мм), нижний правый второй премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические Amora Edgewise 0,018 дюймов (0,46 мм), нижний правый второй премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- 2.2 Брекеты керамические Amora Edgewise Esthetic Bracket 0,022 дюйма (0,56 мм), в вариантах исполнения:
- Брекеты керамические Amora Edgewise 0,022 дюйма (0,56 мм), верхний правый центральный резец - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические Amora Edgewise 0,022 дюйма (0,56 мм), верхний правый боковой резец - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические Amora Edgewise 0,022 дюйма (0,56 мм), верхний правый клык без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические Amora Edgewise 0,022 дюйма (0,56 мм), верхний правый клык с крючком - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические Amora Edgewise 0,022 дюйма (0,56 мм), верхний правый первый премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические Amora Edgewise 0,022 дюйма (0,56 мм), верхний правый первый премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические Amora Edgewise 0,022 дюйма (0,56 мм), верхний правый второй премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические Amora Edgewise 0,022 дюйма (0,56 мм), верхний правый второй премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические Amora Edgewise 0,022 дюйма (0,56 мм), верхний левый центральный резец - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические Amora Edgewise 0,022 дюйма (0,56 мм), верхний левый боковой резец - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические Amora Edgewise 0,022 дюйма (0,56 мм), верхний левый клык без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические Amora Edgewise 0,022 дюйма (0,56 мм), верхний левый клык с крючком - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические Amora Edgewise 0,022 дюйма (0,56 мм), верхний левый первый премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические Amora Edgewise 0,022 дюйма (0,56 мм), верхний левый первый премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические Amora Edgewise 0,022 дюйма (0,56 мм), верхний левый второй премоляр без крючка - не более 1000 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова



0113427

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 28 ноября 2022 года № РЗН 2022/18940

Лист 82

- Брекеты керамические Amora Edgewise 0,022 дюйма (0,56 мм), верхний левый второй премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические Amora Edgewise 0,022 дюйма (0,56 мм), нижний левый центральный резец - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические Amora Edgewise 0,022 дюйма (0,56 мм), нижний левый боковой резец - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические Amora Edgewise 0,022 дюйма (0,56 мм), нижний левый клык без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические Amora Edgewise 0,022 дюйма (0,56 мм), нижний левый клык с крючком - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические Amora Edgewise 0,022 дюйма (0,56 мм), нижний левый первый премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические Amora Edgewise 0,022 дюйма (0,56 мм), нижний левый первый премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические Amora Edgewise 0,022 дюйма (0,56 мм), нижний левый второй премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические Amora Edgewise 0,022 дюйма (0,56 мм), нижний левый второй премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические Amora Edgewise 0,022 дюйма (0,56 мм), нижний правый центральный резец - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические Amora Edgewise 0,022 дюйма (0,56 мм), нижний правый боковой резец - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические Amora Edgewise 0,022 дюйма (0,56 мм), нижний правый клык без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические Amora Edgewise 0,022 дюйма (0,56 мм), нижний правый клык с крючком - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические Amora Edgewise 0,022 дюйма (0,56 мм), нижний правый первый премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические Amora Edgewise 0,022 дюйма (0,56 мм), нижний правый первый премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические Amora Edgewise 0,022 дюйма (0,56 мм), нижний правый второй премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические Amora Edgewise 0,022 дюйма (0,56 мм), нижний правый второй премоляр с крючком - не более 1000 шт.

2.3 Брекеты керамические Amora Roth Esthetic Bracket 0,018 дюймов (0,46 мм), в вариантах исполнения:

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0113428

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 28 ноября 2022 года № РЗН 2022/18940

Лист 83

- Брекеты керамические Amora Roth 0,018 дюймов (0,46 мм), верхний правый центральный резец - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические Amora Roth 0,018 дюймов (0,46 мм), верхний правый боковой резец - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические Amora Roth 0,018 дюймов (0,46 мм), верхний правый клык без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические Amora Roth 0,018 дюймов (0,46 мм), верхний правый клык с крючком - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические Amora Roth 0,018 дюймов (0,46 мм), верхний правый первый премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические Amora Roth 0,018 дюймов (0,46 мм), верхний правый первый премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические Amora Roth 0,018 дюймов (0,46 мм), верхний правый второй премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические Amora Roth 0,018 дюймов (0,46 мм), верхний правый второй премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические Amora Roth 0,018 дюймов (0,46 мм), верхний левый центральный резец - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические Amora Roth 0,018 дюймов (0,46 мм), верхний левый боковой резец - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические Amora Roth 0,018 дюймов (0,46 мм), верхний левый клык без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические Amora Roth 0,018 дюймов (0,46 мм), верхний левый клык с крючком - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические Amora Roth 0,018 дюймов (0,46 мм), верхний левый первый премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические Amora Roth 0,018 дюймов (0,46 мм), верхний левый первый премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические Amora Roth 0,018 дюймов (0,46 мм), верхний левый второй премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические Amora Roth 0,018 дюймов (0,46 мм), верхний левый второй премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические Amora Roth 0,018 дюймов (0,46 мм), нижний левый центральный резец - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические Amora Roth 0,018 дюймов (0,46 мм), нижний левый боковой резец - не более 1000 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова



0113429

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ


от 28 ноября 2022 года № РЗН 2022/18940

Лист 84

- Брекеты керамические Amora Roth 0,018 дюймов (0,46 мм), нижний левый клык без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические Amora Roth 0,018 дюймов (0,46 мм), нижний левый клык с крючком - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические Amora Roth 0,018 дюймов (0,46 мм), нижний левый первый премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические Amora Roth 0,018 дюймов (0,46 мм), нижний левый первый премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические Amora Roth 0,018 дюймов (0,46 мм), нижний левый второй премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические Amora Roth 0,018 дюймов (0,46 мм), нижний левый второй премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические Amora Roth 0,018 дюймов (0,46 мм), нижний правый центральный резец - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические Amora Roth 0,018 дюймов (0,46 мм), нижний правый боковой резец - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические Amora Roth 0,018 дюймов (0,46 мм), нижний правый клык без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические Amora Roth 0,018 дюймов (0,46 мм), нижний правый клык с крючком - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические Amora Roth 0,018 дюймов (0,46 мм), нижний правый первый премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические Amora Roth 0,018 дюймов (0,46 мм), нижний правый первый премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические Amora Roth 0,018 дюймов (0,46 мм), нижний правый второй премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические Amora Roth 0,018 дюймов (0,46 мм), нижний правый второй премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- 2.4 Брекеты керамические Amora Roth Esthetic Bracket 0,022 дюйма (0,56 мм), в вариантах исполнения:
 - Брекеты керамические Amora Roth 0,022 дюйма (0,56 мм), верхний правый центральный резец - не более 1000 шт.
 - Брекеты керамические Amora Roth 0,022 дюйма (0,56 мм), верхний правый боковой резец - не более 1000 шт.
 - Брекеты керамические Amora Roth 0,022 дюйма (0,56 мм), верхний правый клык без крючка - не более 1000 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

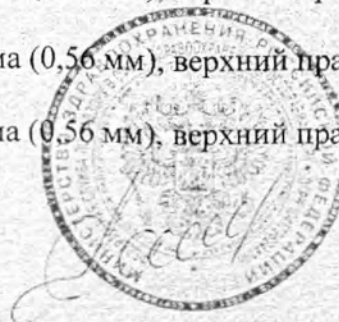

0113430

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 28 ноября 2022 года № РЗН 2022/18940

Лист 85

- Брекеты керамические Amora Roth 0,022 дюйма (0,56 мм), верхний правый клык с крючком - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические Amora Roth 0,022 дюйма (0,56 мм), верхний правый первый премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические Amora Roth 0,022 дюйма (0,56 мм), верхний правый первый премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические Amora Roth 0,022 дюйма (0,56 мм), верхний правый второй премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические Amora Roth 0,022 дюйма (0,56 мм), верхний правый второй премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические Amora Roth 0,022 дюйма (0,56 мм), верхний левый центральный резец - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические Amora Roth 0,022 дюйма (0,56 мм), верхний левый боковой резец - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические Amora Roth 0,022 дюйма (0,56 мм), верхний левый клык без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические Amora Roth 0,022 дюйма (0,56 мм), верхний левый клык с крючком - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические Amora Roth 0,022 дюйма (0,56 мм), верхний левый первый премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические Amora Roth 0,022 дюйма (0,56 мм), верхний левый первый премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические Amora Roth 0,022 дюйма (0,56 мм), верхний левый второй премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические Amora Roth 0,022 дюйма (0,56 мм), верхний левый второй премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические Amora Roth 0,022 дюйма (0,56 мм), нижний левый центральный резец - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические Amora Roth 0,022 дюйма (0,56 мм), нижний левый боковой резец - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические Amora Roth 0,022 дюйма (0,56 мм), нижний левый клык без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические Amora Roth 0,022 дюйма (0,56 мм), нижний левый клык с крючком - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические Amora Roth 0,022 дюйма (0,56 мм), нижний левый первый премоляр без крючка - не более 1000 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0113431

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 28 ноября 2022 года № РЗН 2022/18940

Лист 86

- Брекеты керамические Amora Roth 0,022 дюйма (0,56 мм), нижний левый первый премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические Amora Roth 0,022 дюйма (0,56 мм), нижний левый второй премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические Amora Roth 0,022 дюйма (0,56 мм), нижний левый второй премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические Amora Roth 0,022 дюйма (0,56 мм), нижний правый центральный резец - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические Amora Roth 0,022 дюйма (0,56 мм), нижний правый боковой резец - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические Amora Roth 0,022 дюйма (0,56 мм), нижний правый клык без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические Amora Roth 0,022 дюйма (0,56 мм), нижний правый клык с крючком - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические Amora Roth 0,022 дюйма (0,56 мм), нижний правый первый премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические Amora Roth 0,022 дюйма (0,56 мм), нижний правый первый премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические Amora Roth 0,022 дюйма (0,56 мм), нижний правый второй премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические Amora Roth 0,022 дюйма (0,56 мм), нижний правый второй премоляр с крючком - не более 1000 шт.

2.5 Брекеты керамические Amora McBeTr Esthetic Bracket 0,018 дюймов (0,46 мм), в вариантах исполнения:

- Брекеты керамические Amora McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм), верхний правый центральный резец - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические Amora McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм), верхний правый боковой резец - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические Amora McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм), верхний правый клык без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические Amora McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм), верхний правый клык с крючком - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические Amora McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм), верхний правый первый премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические Amora McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм), верхний правый первый премоляр с крючком - не более 1000 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова



0113432

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 28 ноября 2022 года № РЗН 2022/18940

Лист 87

- Брекеты керамические Amora McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм), верхний правый второй премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические Amora McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм), верхний правый второй премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические Amora McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм), верхний левый центральный резец - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические Amora McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм), верхний левый боковой резец - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические Amora McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм), верхний левый клык без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические Amora McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм), верхний левый клык с крючком - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические Amora McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм), верхний левый первый премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические Amora McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм), верхний левый первый премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические Amora McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм), верхний левый второй премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические Amora McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм), верхний левый второй премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические Amora McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм), нижний левый центральный резец - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические Amora McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм), нижний левый боковой резец - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические Amora McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм), нижний левый клык без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические Amora McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм), нижний левый клык с крючком - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические Amora McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм), нижний левый первый премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические Amora McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм), нижний левый первый премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические Amora McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм), нижний левый второй премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические Amora McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм), нижний левый второй премоляр с крючком - не более 1000 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0113433

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 28 ноября 2022 года № РЗН 2022/18940

Лист 88

- Брекеты керамические Amora McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм), нижний правый центральный резец - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические Amora McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм), нижний правый боковой резец - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические Amora McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм), нижний правый клык без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические Amora McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм), нижний правый клык с крючком - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические Amora McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм), нижний правый первый премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические Amora McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм), нижний правый первый премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические Amora McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм), нижний правый второй премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические Amora McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм), нижний правый второй премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- 2.6 Брекеты керамические Amora McBeTr Esthetic Bracket 0,022 дюйма (0,56 мм), в вариантах исполнения:
- Брекеты керамические Amora McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм), верхний правый центральный резец - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические Amora McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм), верхний правый боковой резец - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические Amora McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм), верхний правый клык без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические Amora McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм), верхний правый клык с крючком - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические Amora McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм), верхний правый первый премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические Amora McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм), верхний правый первый премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические Amora McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм), верхний правый второй премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические Amora McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм), верхний правый второй премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические Amora McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм), верхний левый центральный резец - не более 1000 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0113434

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ


от 28 ноября 2022 года № РЗН 2022/18940

Лист 89

- Брекеты керамические Amora McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм), верхний левый боковой резец - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические Amora McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм), верхний левый клык без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические Amora McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм), верхний левый клык с крючком - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические Amora McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм), верхний левый первый премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические Amora McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм), верхний левый первый премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические Amora McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм), верхний левый второй премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические Amora McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм), верхний левый второй премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические Amora McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм), нижний левый центральный резец - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические Amora McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм), нижний левый боковой резец - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические Amora McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм), нижний левый клык без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические Amora McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм), нижний левый клык с крючком - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические Amora McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм), нижний левый первый премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические Amora McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм), нижний левый первый премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические Amora McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм), нижний левый второй премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические Amora McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм), нижний левый второй премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические Amora McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм), нижний правый центральный резец - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические Amora McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм), нижний правый боковой резец - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические Amora McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм), нижний правый клык без крючка - не более 1000 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

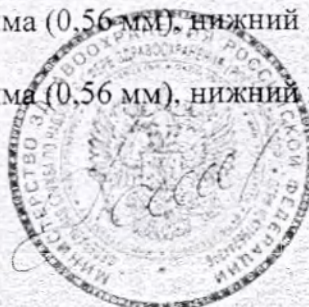

0113435

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 28 ноября 2022 года № РЗН 2022/18940

Лист 90

- Брекеты керамические Amora McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм), нижний правый клык с крючком - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические Amora McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм), нижний правый первый премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические Amora McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм), нижний правый первый премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические Amora McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм), нижний правый второй премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические Amora McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм), нижний правый второй премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- 2.7 Брекеты керамические Hera Sapphire Roth Esthetic Bracket 0,018 дюймов (0,46 мм), в вариантах исполнения:
 - Брекеты керамические Hera Sapphire Roth 0,018 дюймов (0,46 мм), верхний правый центральный резец - не более 1000 шт.
 - Брекеты керамические Hera Sapphire Roth 0,018 дюймов (0,46 мм), верхний правый боковой резец - не более 1000 шт.
 - Брекеты керамические Hera Sapphire Roth 0,018 дюймов (0,46 мм), верхний правый клык без крючка - не более 1000 шт.
 - Брекеты керамические Hera Sapphire Roth 0,018 дюймов (0,46 мм), верхний правый клык с крючком - не более 1000 шт.
 - Брекеты керамические Hera Sapphire Roth 0,018 дюймов (0,46 мм), верхний правый первый премоляр без крючка - не более 1000 шт.
 - Брекеты керамические Hera Sapphire Roth 0,018 дюймов (0,46 мм), верхний правый первый премоляр с крючком - не более 1000 шт.
 - Брекеты керамические Hera Sapphire Roth 0,018 дюймов (0,46 мм), верхний правый второй премоляр без крючка - не более 1000 шт.
 - Брекеты керамические Hera Sapphire Roth 0,018 дюймов (0,46 мм), верхний правый второй премоляр с крючком - не более 1000 шт.
 - Брекеты керамические Hera Sapphire Roth 0,018 дюймов (0,46 мм), верхний левый центральный резец - не более 1000 шт.
 - Брекеты керамические Hera Sapphire Roth 0,018 дюймов (0,46 мм), верхний левый боковой резец - не более 1000 шт.
 - Брекеты керамические Hera Sapphire Roth 0,018 дюймов (0,46 мм), верхний левый клык без крючка - не более 1000 шт.
 - Брекеты керамические Hera Sapphire Roth 0,018 дюймов (0,46 мм), верхний левый клык с крючком - не более 1000 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова



0113436

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 28 ноября 2022 года № РЗН 2022/18940

Лист 91

- Брекеты керамические Hera Sapphire Roth 0,018 дюймов (0,46 мм), верхний левый первый премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические Hera Sapphire Roth 0,018 дюймов (0,46 мм), верхний левый первый премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические Hera Sapphire Roth 0,018 дюймов (0,46 мм), верхний левый второй премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические Hera Sapphire Roth 0,018 дюймов (0,46 мм), верхний левый второй премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические Hera Sapphire Roth 0,018 дюймов (0,46 мм), нижний левый центральный резец - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические Hera Sapphire Roth 0,018 дюймов (0,46 мм), нижний левый боковой резец - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические Hera Sapphire Roth 0,018 дюймов (0,46 мм), нижний левый клык без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические Hera Sapphire Roth 0,018 дюймов (0,46 мм), нижний левый клык с крючком - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические Hera Sapphire Roth 0,018 дюймов (0,46 мм), нижний левый первый премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические Hera Sapphire Roth 0,018 дюймов (0,46 мм), нижний левый первый премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические Hera Sapphire Roth 0,018 дюймов (0,46 мм), нижний левый второй премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические Hera Sapphire Roth 0,018 дюймов (0,46 мм), нижний левый второй премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические Hera Sapphire Roth 0,018 дюймов (0,46 мм), нижний правый центральный резец - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические Hera Sapphire Roth 0,018 дюймов (0,46 мм), нижний правый боковой резец - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические Hera Sapphire Roth 0,018 дюймов (0,46 мм), нижний правый клык без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические Hera Sapphire Roth 0,018 дюймов (0,46 мм), нижний правый клык с крючком - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические Hera Sapphire Roth 0,018 дюймов (0,46 мм), нижний правый первый премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические Hera Sapphire Roth 0,018 дюймов (0,46 мм), нижний правый первый премоляр с крючком - не более 1000 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0113437

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 28 ноября 2022 года № РЗН 2022/18940

Лист 92

- Брекеты керамические Hera Sapphire Roth 0,018 дюймов (0,46 мм), нижний правый второй премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические Hera Sapphire Roth 0,018 дюймов (0,46 мм), нижний правый второй премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- 2.8 Брекеты керамические Hera Sapphire Roth Esthetic Bracket 0,022 дюйма (0,56 мм), в вариантах исполнения:
- Брекеты керамические Hera Sapphire Roth 0,022 дюйма (0,56 мм), верхний правый центральный резец - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические Hera Sapphire Roth 0,022 дюйма (0,56 мм), верхний правый боковой резец - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические Hera Sapphire Roth 0,022 дюйма (0,56 мм), верхний правый клык без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические Hera Sapphire Roth 0,022 дюйма (0,56 мм), верхний правый клык с крючком - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические Hera Sapphire Roth 0,022 дюйма (0,56 мм), верхний правый первый премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические Hera Sapphire Roth 0,022 дюйма (0,56 мм), верхний правый первый премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические Hera Sapphire Roth 0,022 дюйма (0,56 мм), верхний правый второй премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические Hera Sapphire Roth 0,022 дюйма (0,56 мм), верхний правый второй премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические Hera Sapphire Roth 0,022 дюйма (0,56 мм), верхний левый центральный резец - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические Hera Sapphire Roth 0,022 дюйма (0,56 мм), верхний левый боковой резец - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические Hera Sapphire Roth 0,022 дюйма (0,56 мм), верхний левый клык без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические Hera Sapphire Roth 0,022 дюйма (0,56 мм), верхний левый клык с крючком - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические Hera Sapphire Roth 0,022 дюйма (0,56 мм), верхний левый первый премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические Hera Sapphire Roth 0,022 дюйма (0,56 мм), верхний левый первый премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические Hera Sapphire Roth 0,022 дюйма (0,56 мм), верхний левый второй премоляр без крючка - не более 1000 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0113438

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 28 ноября 2022 года № РЗН 2022/18940

Лист 93

- Брекеты керамические Hera Sapphire Roth 0,022 дюйма (0,56 мм), верхний левый второй премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические Hera Sapphire Roth 0,022 дюйма (0,56 мм), нижний левый центральный резец - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические Hera Sapphire Roth 0,022 дюйма (0,56 мм), нижний левый боковой резец - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические Hera Sapphire Roth 0,022 дюйма (0,56 мм), нижний левый клык без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические Hera Sapphire Roth 0,022 дюйма (0,56 мм), нижний левый клык с крючком - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические Hera Sapphire Roth 0,022 дюйма (0,56 мм), нижний левый первый премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические Hera Sapphire Roth 0,022 дюйма (0,56 мм), нижний левый первый премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические Hera Sapphire Roth 0,022 дюйма (0,56 мм), нижний левый второй премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические Hera Sapphire Roth 0,022 дюйма (0,56 мм), нижний левый второй премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические Hera Sapphire Roth 0,022 дюйма (0,56 мм), нижний правый центральный резец - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические Hera Sapphire Roth 0,022 дюйма (0,56 мм), нижний правый боковой резец - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические Hera Sapphire Roth 0,022 дюйма (0,56 мм), нижний правый клык без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические Hera Sapphire Roth 0,022 дюйма (0,56 мм), нижний правый клык с крючком - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические Hera Sapphire Roth 0,022 дюйма (0,56 мм), нижний правый первый премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические Hera Sapphire Roth 0,022 дюйма (0,56 мм), нижний правый первый премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические Hera Sapphire Roth 0,022 дюйма (0,56 мм), нижний правый второй премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические Hera Sapphire Roth 0,022 дюйма (0,56 мм), нижний правый второй премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- 2.9 Брекеты керамические Hera Sapphire McBeTr Esthetic Bracket 0,018 дюймов (0,46 мм), в вариантах исполнения:

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова



0113439

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 28 ноября 2022 года № РЗН 2022/18940

Лист 94

- Брекеты керамические Hera Sapphire McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм), верхний правый центральный резец - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические Hera Sapphire McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм), верхний правый боковой резец - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические Hera Sapphire McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм), верхний правый клык без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические Hera Sapphire McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм), верхний правый клык с крючком - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические Hera Sapphire McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм), верхний правый первый премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические Hera Sapphire McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм), верхний правый первый премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические Hera Sapphire McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм), верхний правый второй премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические Hera Sapphire McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм), верхний правый второй премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические Hera Sapphire McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм), верхний левый центральный резец - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические Hera Sapphire McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм), верхний левый боковой резец - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические Hera Sapphire McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм), верхний левый клык без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические Hera Sapphire McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм), верхний левый клык с крючком - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические Hera Sapphire McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм), верхний левый первый премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические Hera Sapphire McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм), верхний левый первый премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические Hera Sapphire McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм), верхний левый второй премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические Hera Sapphire McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм), верхний левый второй премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические Hera Sapphire McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм), нижний левый центральный резец - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические Hera Sapphire McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм), нижний левый боковой резец - не более 1000 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова



0113440

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 28 ноября 2022 года № РЗН 2022/18940

Лист 95

- Брекеты керамические Hera Sapphire McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм), нижний левый клык без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические Hera Sapphire McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм), нижний левый клык с крючком - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические Hera Sapphire McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм), нижний левый первый премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические Hera Sapphire McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм), нижний левый первый премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические Hera Sapphire McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм), нижний левый второй премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические Hera Sapphire McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм), нижний левый второй премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические Hera Sapphire McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм), нижний правый центральный резец - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические Hera Sapphire McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм), нижний правый боковой резец - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические Hera Sapphire McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм), нижний правый клык без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические Hera Sapphire McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм), нижний правый клык с крючком - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические Hera Sapphire McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм), нижний правый первый премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические Hera Sapphire McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм), нижний правый первый премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические Hera Sapphire McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм), нижний правый второй премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические Hera Sapphire McBeTr 0,018 дюймов (0,46 мм), нижний правый второй премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- 2.10 Брекеты керамические Hera Sapphire McBeTr Esthetic Bracket 0,022 дюйма (0,56 мм), в вариантах исполнения:
 - Брекеты керамические Hera Sapphire McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм), верхний правый центральный резец - не более 1000 шт.
 - Брекеты керамические Hera Sapphire McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм), верхний правый боковой резец - не более 1000 шт.
 - Брекеты керамические Hera Sapphire McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм), верхний правый клык без крючка - не более 1000 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0113441


**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 28 ноября 2022 года № РЗН 2022/18940

Лист 96

- Брекет керамический Hera Sapphire McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм), верхний правый клык с крючком - не более 1000 шт.
- Брекет керамический Hera Sapphire McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм), верхний правый первый премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекет керамический Hera Sapphire McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм), верхний правый первый премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекет керамический Hera Sapphire McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм), верхний правый второй премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекет керамический Hera Sapphire McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм), верхний правый второй премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекет керамический Hera Sapphire McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм), верхний левый центральный резец - не более 1000 шт.
- Брекет керамический Hera Sapphire McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм), верхний левый боковой резец - не более 1000 шт.
- Брекет керамический Hera Sapphire McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм), верхний левый клык без крючка - не более 1000 шт.
- Брекет керамический Hera Sapphire McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм), верхний левый клык с крючком - не более 1000 шт.
- Брекет керамический Hera Sapphire McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм), верхний левый первый премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекет керамический Hera Sapphire McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм), верхний левый первый премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекет керамический Hera Sapphire McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм), верхний левый второй премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекет керамический Hera Sapphire McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм), верхний левый второй премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекет керамический Hera Sapphire McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм), нижний левый центральный резец - не более 1000 шт.
- Брекет керамический Hera Sapphire McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм), нижний левый боковой резец - не более 1000 шт.
- Брекет керамический Hera Sapphire McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм), нижний левый клык без крючка - не более 1000 шт.
- Брекет керамический Hera Sapphire McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм), нижний левый клык с крючком - не более 1000 шт.
- Брекет керамический Hera Sapphire McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм), нижний левый первый премоляр без крючка - не более 1000 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

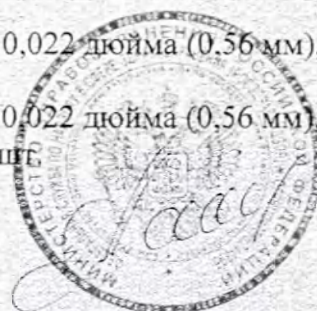

А.В. Самойлова

0113442

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 28 ноября 2022 года № РЗН 2022/18940

Лист 97

- Брекеты керамические Hera Sapphire McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм), нижний левый первый премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические Hera Sapphire McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм), нижний левый второй премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические Hera Sapphire McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм), нижний левый второй премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические Hera Sapphire McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм), нижний правый центральный резец - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические Hera Sapphire McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм), нижний правый боковой резец - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические Hera Sapphire McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм), нижний правый клык без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические Hera Sapphire McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм), нижний правый клык с крючком - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические Hera Sapphire McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм), нижний правый первый премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические Hera Sapphire McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм), нижний правый первый премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические Hera Sapphire McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм), нижний правый второй премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические Hera Sapphire McBeTr 0,022 дюйма (0,56 мм), нижний правый второй премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- 3. Брекеты керамические и металлические самолигирующие, в вариантах исполнения:
 - 3.1 Брекеты керамические и металлические самолигирующие Glacier II Roth Esthetic Bracket 0,022 дюйма (0,56 мм), в вариантах исполнения:
 - Брекеты керамические самолигирующие Glacier II Roth Esthetic Bracket 0,022 дюйма (0,56 мм), верхний правый центральный резец - не более 1000 шт.
 - Брекеты керамические самолигирующие Glacier II Roth Esthetic Bracket 0,022 дюйма (0,56 мм), верхний правый боковой резец - не более 1000 шт.
 - Брекеты керамические самолигирующие Glacier II Roth Esthetic Bracket 0,022 дюйма (0,56 мм), верхний правый клык без крючка - не более 1000 шт.
 - Брекеты керамические самолигирующие Glacier II Roth Esthetic Bracket 0,022 дюйма (0,56 мм), верхний правый клык с крючком - не более 1000 шт.
 - Брекеты керамические самолигирующие Glacier II Roth Esthetic Bracket 0,022 дюйма (0,56 мм), верхний правый первый премоляр без крючка - не более 1000 шт.
 - Брекеты керамические самолигирующие Glacier II Roth Esthetic Bracket 0,022 дюйма (0,56 мм), верхний правый первый премоляр с крючком - не более 1000 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0113443

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 28 ноября 2022 года № РЗН 2022/18940

Лист 98

- (0,56 мм), верхний правый первый премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические самолигирующие Glacier II Roth Esthetic Bracket 0,022 дюйма (0,56 мм), верхний правый второй премоляр без крючка - не более 1000 шт.
 - Брекеты керамические самолигирующие Glacier II Roth Esthetic Bracket 0,022 дюйма (0,56 мм), верхний правый второй премоляр с крючком - не более 1000 шт.
 - Брекеты керамические самолигирующие Glacier II Roth Esthetic Bracket 0,022 дюйма (0,56 мм), верхний левый центральный резец - не более 1000 шт.
 - Брекеты керамические самолигирующие Glacier II Roth Esthetic Bracket 0,022 дюйма (0,56 мм), верхний левый боковой резец - не более 1000 шт.
 - Брекеты керамические самолигирующие Glacier II Roth Esthetic Bracket 0,022 дюйма (0,56 мм), верхний левый клык без крючка - не более 1000 шт.
 - Брекеты керамические самолигирующие Glacier II Roth Esthetic Bracket 0,022 дюйма (0,56 мм), верхний левый клык с крючком - не более 1000 шт.
 - Брекеты керамические самолигирующие Glacier II Roth Esthetic Bracket 0,022 дюйма (0,56 мм), верхний левый первый премоляр без крючка - не более 1000 шт.
 - Брекеты керамические самолигирующие Glacier II Roth Esthetic Bracket 0,022 дюйма (0,56 мм), верхний левый первый премоляр с крючком - не более 1000 шт.
 - Брекеты керамические самолигирующие Glacier II Roth Esthetic Bracket 0,022 дюйма (0,56 мм), верхний левый второй премоляр без крючка - не более 1000 шт.
 - Брекеты керамические самолигирующие Glacier II Roth Esthetic Bracket 0,022 дюйма (0,56 мм), верхний левый второй премоляр с крючком - не более 1000 шт.
 - Брекеты керамические самолигирующие Glacier II Roth Esthetic Bracket 0,022 дюйма (0,56 мм), нижний левый центральный резец - не более 1000 шт.
 - Брекеты керамические самолигирующие Glacier II Roth Esthetic Bracket 0,022 дюйма (0,56 мм), нижний левый боковой резец - не более 1000 шт.
 - Брекеты керамические самолигирующие Glacier II Roth Esthetic Bracket 0,022 дюйма (0,56 мм), нижний левый клык без крючка - не более 1000 шт.
 - Брекеты керамические самолигирующие Glacier II Roth Esthetic Bracket 0,022 дюйма (0,56 мм), нижний левый клык с крючком - не более 1000 шт.
 - Брекеты металлические самолигирующие Glacier II Roth Esthetic Bracket 0,022 дюйма (0,56 мм), нижний левый первый премоляр без крючка - не более 1000 шт.
 - Брекеты металлические самолигирующие Glacier II Roth Esthetic Bracket 0,022 дюйма (0,56 мм), нижний левый первый премоляр с крючком - не более 1000 шт.
 - Брекеты металлические самолигирующие Glacier II Roth Esthetic Bracket 0,022 дюйма (0,56 мм), нижний левый второй премоляр без крючка - не более 1000 шт.
 - Брекеты металлические самолигирующие Glacier II Roth Esthetic Bracket 0,022 дюйма

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0113444

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 28 ноября 2022 года

№ РЗН 2022/18940

Лист 99

- (0,56 мм), нижний левый второй премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекет керамический самолигирующий Glacier II Roth Esthetic Bracket 0,022 дюйма (0,56 мм), нижний правый центральный резец - не более 1000 шт.
 - Брекет керамический самолигирующий Glacier II Roth Esthetic Bracket 0,022 дюйма (0,56 мм), нижний правый боковой резец - не более 1000 шт.
 - Брекет керамический самолигирующий Glacier II Roth Esthetic Bracket 0,022 дюйма (0,56 мм), нижний правый клык без крючка - не более 1000 шт.
 - Брекет керамический самолигирующий Glacier II Roth Esthetic Bracket 0,022 дюйма (0,56 мм), нижний правый клык с крючком - не более 1000 шт.
 - Брекет металлический самолигирующий Glacier II Roth Esthetic Bracket 0,022 дюйма (0,56 мм), нижний правый первый премоляр без крючка - не более 1000 шт.
 - Брекет металлический самолигирующий Glacier II Roth Esthetic Bracket 0,022 дюйма (0,56 мм), нижний правый первый премоляр с крючком - не более 1000 шт.
 - Брекет металлический самолигирующий Glacier II Roth Esthetic Bracket 0,022 дюйма (0,56 мм), нижний правый второй премоляр без крючка - не более 1000 шт.
 - Брекет металлический самолигирующий Glacier II Roth Esthetic Bracket 0,022 дюйма (0,56 мм), нижний правый второй премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- 3.2 Брекет керамический и металлический самолигирующий Glacier II Roth Esthetic Bracket 0,018 дюймов (0,46 мм), в вариантах исполнения:
- Брекет керамический самолигирующий Glacier II Roth Esthetic Bracket 0,018 дюймов (0,46 мм), верхний правый центральный резец - не более 1000 шт.
 - Брекет керамический самолигирующий Glacier II Roth Esthetic Bracket 0,018 дюймов (0,46 мм), верхний правый боковой резец - не более 1000 шт.
 - Брекет керамический самолигирующий Glacier II Roth Esthetic Bracket 0,018 дюймов (0,46 мм), верхний правый клык без крючка - не более 1000 шт.
 - Брекет керамический самолигирующий Glacier II Roth Esthetic Bracket 0,018 дюймов (0,46 мм), верхний правый клык с крючком - не более 1000 шт.
 - Брекет керамический самолигирующий Glacier II Roth Esthetic Bracket 0,018 дюймов (0,46 мм), верхний правый первый премоляр без крючка - не более 1000 шт.
 - Брекет керамический самолигирующий Glacier II Roth Esthetic Bracket 0,018 дюймов (0,46 мм), верхний правый первый премоляр с крючком - не более 1000 шт.
 - Брекет керамический самолигирующий Glacier II Roth Esthetic Bracket 0,018 дюймов (0,46 мм), верхний правый второй премоляр без крючка - не более 1000 шт.
 - Брекет керамический самолигирующий Glacier II Roth Esthetic Bracket 0,018 дюймов (0,46 мм), верхний правый второй премоляр с крючком - не более 1000 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0113445

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 28 ноября 2022 года № РЗН 2022/18940

Лист 100

- (0,46 мм), верхний левый центральный резец - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические самолигирующие Glacier II Roth Esthetic Bracket 0,018 дюймов (0,46 мм), верхний левый боковой резец - не более 1000 шт.
 - Брекеты керамические самолигирующие Glacier II Roth Esthetic Bracket 0,018 дюймов (0,46 мм), верхний левый клык без крючка - не более 1000 шт.
 - Брекеты керамические самолигирующие Glacier II Roth Esthetic Bracket 0,018 дюймов (0,46 мм), верхний левый клык с крючком - не более 1000 шт.
 - Брекеты керамические самолигирующие Glacier II Roth Esthetic Bracket 0,018 дюймов (0,46 мм), верхний левый первый премоляр без крючка - не более 1000 шт.
 - Брекеты керамические самолигирующие Glacier II Roth Esthetic Bracket 0,018 дюймов (0,46 мм), верхний левый первый премоляр с крючком - не более 1000 шт.
 - Брекеты керамические самолигирующие Glacier II Roth Esthetic Bracket 0,018 дюймов (0,46 мм), верхний левый второй премоляр без крючка - не более 1000 шт.
 - Брекеты керамические самолигирующие Glacier II Roth Esthetic Bracket 0,018 дюймов (0,46 мм), верхний левый второй премоляр с крючком - не более 1000 шт.
 - Брекеты керамические самолигирующие Glacier II Roth Esthetic Bracket 0,018 дюймов (0,46 мм), нижний левый центральный резец - не более 1000 шт.
 - Брекеты керамические самолигирующие Glacier II Roth Esthetic Bracket 0,018 дюймов (0,46 мм), нижний левый боковой резец - не более 1000 шт.
 - Брекеты керамические самолигирующие Glacier II Roth Esthetic Bracket 0,018 дюймов (0,46 мм), нижний левый клык без крючка - не более 1000 шт.
 - Брекеты керамические самолигирующие Glacier II Roth Esthetic Bracket 0,018 дюймов (0,46 мм), нижний левый клык с крючком - не более 1000 шт.
 - Брекеты металлические самолигирующие Glacier II Roth Esthetic Bracket 0,018 дюймов (0,46 мм), нижний левый первый премоляр без крючка - не более 1000 шт.
 - Брекеты металлические самолигирующие Glacier II Roth Esthetic Bracket 0,018 дюймов (0,46 мм), нижний левый первый премоляр с крючком - не более 1000 шт.
 - Брекеты металлические самолигирующие Glacier II Roth Esthetic Bracket 0,018 дюймов (0,46 мм), нижний левый второй премоляр без крючка - не более 1000 шт.
 - Брекеты металлические самолигирующие Glacier II Roth Esthetic Bracket 0,018 дюймов (0,46 мм), нижний левый второй премоляр с крючком - не более 1000 шт.
 - Брекеты керамические самолигирующие Glacier II Roth Esthetic Bracket 0,018 дюймов (0,46 мм), нижний правый центральный резец - не более 1000 шт.
 - Брекеты керамические самолигирующие Glacier II Roth Esthetic Bracket 0,018 дюймов (0,46 мм), нижний правый боковой резец - не более 1000 шт.
 - Брекеты керамические самолигирующие Glacier II Roth Esthetic Bracket 0,018 дюймов

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0113446

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 28 ноября 2022 года № РЗН 2022/18940

Лист 101

(0,46 мм), нижний правый клык без крючка - не более 1000 шт.
- Брекет керамический самолигирующий Glacier II Roth Esthetic Bracket 0,018 дюймов (0,46 мм), нижний правый клык с крючком - не более 1000 шт.
- Брекет металлический самолигирующий Glacier II Roth Esthetic Bracket 0,018 дюймов (0,46 мм), нижний правый первый премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекет металлический самолигирующий Glacier II Roth Esthetic Bracket 0,018 дюймов (0,46 мм), нижний правый первый премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекет металлический самолигирующий Glacier II Roth Esthetic Bracket 0,018 дюймов (0,46 мм), нижний правый второй премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекет металлический самолигирующий Glacier II Roth Esthetic Bracket 0,018 дюймов (0,46 мм), нижний правый второй премоляр с крючком - не более 1000 шт. (без необходимости)

3.3 Брекет керамический и металлический самолигирующий Glacier II McBeTr Esthetic Bracket 0,018 дюймов (0,46 мм), в вариантах исполнения:

- Брекет керамический самолигирующий Glacier II McBeTr Esthetic Bracket 0,018 дюймов (0,46 мм), верхний правый центральный резец - не более 1000 шт.
- Брекет керамический самолигирующий Glacier II McBeTr Esthetic Bracket 0,018 дюймов (0,46 мм), верхний правый боковой резец - не более 1000 шт.
- Брекет керамический самолигирующий Glacier II McBeTr Esthetic Bracket 0,018 дюймов (0,46 мм), верхний правый клык без крючка - не более 1000 шт.
- Брекет керамический самолигирующий Glacier II McBeTr Esthetic Bracket 0,018 дюймов (0,46 мм), верхний правый клык с крючком - не более 1000 шт.
- Брекет керамический самолигирующий Glacier II McBeTr Esthetic Bracket 0,018 дюймов (0,46 мм), верхний правый первый премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекет керамический самолигирующий Glacier II McBeTr Esthetic Bracket 0,018 дюймов (0,46 мм), верхний правый первый премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекет керамический самолигирующий Glacier II McBeTr Esthetic Bracket 0,018 дюймов (0,46 мм), верхний правый второй премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекет керамический самолигирующий Glacier II McBeTr Esthetic Bracket 0,018 дюймов (0,46 мм), верхний правый второй премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекет керамический самолигирующий Glacier II McBeTr Esthetic Bracket 0,018 дюймов (0,46 мм), верхний левый центральный резец - не более 1000 шт.
- Брекет керамический самолигирующий Glacier II McBeTr Esthetic Bracket 0,018 дюймов (0,46 мм), верхний левый боковой резец - не более 1000 шт.
- Брекет керамический самолигирующий Glacier II McBeTr Esthetic Bracket 0,018 дюймов (0,46 мм), верхний левый клык без крючка - не более 1000 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0113447

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 28 ноября 2022 года

№ РЗН 2022/18940

Лист 102

- Брекеты керамические самолигирующие Glacier II McBeTr Esthetic Bracket 0,018 дюймов (0,46 мм), верхний левый клык с крючком - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические самолигирующие Glacier II McBeTr Esthetic Bracket 0,018 дюймов (0,46 мм), верхний левый первый премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические самолигирующие Glacier II McBeTr Esthetic Bracket 0,018 дюймов (0,46 мм), верхний левый первый премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические самолигирующие Glacier II McBeTr Esthetic Bracket 0,018 дюймов (0,46 мм), верхний левый второй премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические самолигирующие Glacier II McBeTr Esthetic Bracket 0,018 дюймов (0,46 мм), верхний левый второй премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические самолигирующие Glacier II McBeTr Esthetic Bracket 0,018 дюймов (0,46 мм), нижний левый центральный резец - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические самолигирующие Glacier II McBeTr Esthetic Bracket 0,018 дюймов (0,46 мм), нижний левый боковой резец - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические самолигирующие Glacier II McBeTr Esthetic Bracket 0,018 дюймов (0,46 мм), нижний левый клык без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические самолигирующие Glacier II McBeTr Esthetic Bracket 0,018 дюймов (0,46 мм), нижний левый клык с крючком - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические самолигирующие Glacier II McBeTr Esthetic Bracket 0,018 дюймов (0,46 мм), нижний левый первый премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические самолигирующие Glacier II McBeTr Esthetic Bracket 0,018 дюймов (0,46 мм), нижний левый первый премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические самолигирующие Glacier II McBeTr Esthetic Bracket 0,018 дюймов (0,46 мм), нижний левый второй премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические самолигирующие Glacier II McBeTr Esthetic Bracket 0,018 дюймов (0,46 мм), нижний левый второй премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические самолигирующие Glacier II McBeTr Esthetic Bracket 0,018 дюймов (0,46 мм), нижний правый центральный резец - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические самолигирующие Glacier II McBeTr Esthetic Bracket 0,018 дюймов (0,46 мм), нижний правый боковой резец - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические самолигирующие Glacier II McBeTr Esthetic Bracket 0,018 дюймов (0,46 мм), нижний правый клык без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические самолигирующие Glacier II McBeTr Esthetic Bracket 0,018 дюймов (0,46 мм), нижний правый клык с крючком - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические самолигирующие Glacier II McBeTr Esthetic Bracket 0,018 дюймов (0,46 мм), нижний правый первый премоляр без крючка - не более 1000 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова



0113448

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 28 ноября 2022 года

№ РЗН 2022/18940

Лист 103

- Брекеты металлические самолигирующие Glacier II McBeTr Esthetic Bracket 0,018 дюймов (0,46 мм), нижний правый первый премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические самолигирующие Glacier II McBeTr Esthetic Bracket 0,018 дюймов (0,46 мм), нижний правый второй премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты металлические самолигирующие Glacier II McBeTr Esthetic Bracket 0,018 дюймов (0,46 мм), нижний правый второй премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- 3.4 Брекеты керамические и металлические самолигирующие Glacier II McBeTr Esthetic Bracket 0,022 дюйма (0,56 мм), в вариантах исполнения:
- Брекеты керамические самолигирующие Glacier II McBeTr Esthetic Bracket 0,022 дюйма (0,56 мм), верхний правый центральный резец - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические самолигирующие Glacier II McBeTr Esthetic Bracket 0,022 дюйма (0,56 мм), верхний правый боковой резец - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические самолигирующие Glacier II McBeTr Esthetic Bracket 0,022 дюйма (0,56 мм), верхний правый клык без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические самолигирующие Glacier II McBeTr Esthetic Bracket 0,022 дюйма (0,56 мм), верхний правый клык с крючком - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические самолигирующие Glacier II McBeTr Esthetic Bracket 0,022 дюйма (0,56 мм), верхний правый первый премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические самолигирующие Glacier II McBeTr Esthetic Bracket 0,022 дюйма (0,56 мм), верхний правый первый премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические самолигирующие Glacier II McBeTr Esthetic Bracket 0,022 дюйма (0,56 мм), верхний правый второй премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические самолигирующие Glacier II McBeTr Esthetic Bracket 0,022 дюйма (0,56 мм), верхний правый второй премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические самолигирующие Glacier II McBeTr Esthetic Bracket 0,022 дюйма (0,56 мм), верхний левый центральный резец - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические самолигирующие Glacier II McBeTr Esthetic Bracket 0,022 дюйма (0,56 мм), верхний левый боковой резец - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические самолигирующие Glacier II McBeTr Esthetic Bracket 0,022 дюйма (0,56 мм), верхний левый клык без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические самолигирующие Glacier II McBeTr Esthetic Bracket 0,022 дюйма (0,56 мм), верхний левый клык с крючком - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические самолигирующие Glacier II McBeTr Esthetic Bracket 0,022 дюйма (0,56 мм), верхний левый первый премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекеты керамические самолигирующие Glacier II McBeTr Esthetic Bracket 0,022 дюйма (0,56 мм), верхний левый первый премоляр с крючком - не более 1000 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0113449

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 28 ноября 2022 года № РЗН 2022/18940

Лист 104

- Брекет керамический самолигирующий Glacier II McBeTr Esthetic Bracket 0,022 дюйма (0,56 мм), верхний левый второй премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекет керамический самолигирующий Glacier II McBeTr Esthetic Bracket 0,022 дюйма (0,56 мм), верхний левый второй премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекет керамический самолигирующий Glacier II McBeTr Esthetic Bracket 0,022 дюйма (0,56 мм), нижний левый центральный резец - не более 1000 шт.
- Брекет керамический самолигирующий Glacier II McBeTr Esthetic Bracket 0,022 дюйма (0,56 мм), нижний левый боковой резец - не более 1000 шт.
- Брекет керамический самолигирующий Glacier II McBeTr Esthetic Bracket 0,022 дюйма (0,56 мм), нижний левый клык без крючка - не более 1000 шт.
- Брекет керамический самолигирующий Glacier II McBeTr Esthetic Bracket 0,022 дюйма (0,56 мм), нижний левый клык с крючком - не более 1000 шт.
- Брекет металлический самолигирующий Glacier II McBeTr Esthetic Bracket 0,022 дюйма (0,56 мм), нижний левый первый премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекет металлический самолигирующий Glacier II McBeTr Esthetic Bracket 0,022 дюйма (0,56 мм), нижний левый первый премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекет металлический самолигирующий Glacier II McBeTr Esthetic Bracket 0,022 дюйма (0,56 мм), нижний левый второй премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекет металлический самолигирующий Glacier II McBeTr Esthetic Bracket 0,022 дюйма (0,56 мм), нижний левый второй премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекет керамический самолигирующий Glacier II McBeTr Esthetic Bracket 0,022 дюйма (0,56 мм), нижний правый центральный резец - не более 1000 шт.
- Брекет керамический самолигирующий Glacier II McBeTr Esthetic Bracket 0,022 дюйма (0,56 мм), нижний правый боковой резец - не более 1000 шт.
- Брекет керамический самолигирующий Glacier II McBeTr Esthetic Bracket 0,022 дюйма (0,56 мм), нижний правый клык без крючка - не более 1000 шт.
- Брекет керамический самолигирующий Glacier II McBeTr Esthetic Bracket 0,022 дюйма (0,56 мм), нижний правый клык с крючком - не более 1000 шт.
- Брекет металлический самолигирующий Glacier II McBeTr Esthetic Bracket 0,022 дюйма (0,56 мм), нижний правый первый премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекет металлический самолигирующий Glacier II McBeTr Esthetic Bracket 0,022 дюйма (0,56 мм), нижний правый первый премоляр с крючком - не более 1000 шт.
- Брекет металлический самолигирующий Glacier II McBeTr Esthetic Bracket 0,022 дюйма (0,56 мм), нижний правый второй премоляр без крючка - не более 1000 шт.
- Брекет металлический самолигирующий Glacier II McBeTr Esthetic Bracket 0,022 дюйма (0,56 мм), нижний правый второй премоляр с крючком - не более 1000 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0113450

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 28 ноября 2022 года № РЗН 2022/18940

Лист 105

II. Эластичная лигатура на модуле, в вариантах исполнения:

1. Эластичная лигатура на модуле Round, в вариантах исполнения:

- Эластичная лигатура на модуле Round, цвет серебристый - не более 1000 шт.
- Эластичная лигатура на модуле Round, цвет чёрный - не более 1000 шт.
- Эластичная лигатура на модуле Round, цвет зелёный - не более 1000 шт.
- Эластичная лигатура на модуле Round, цвет красный - не более 1000 шт.
- Эластичная лигатура на модуле Round, цвет прозрачный - не более 1000 шт.
- Эластичная лигатура на модуле Round, цвет оранжевый - не более 1000 шт.
- Эластичная лигатура на модуле Round, цвет розовый - не более 1000 шт.
- Эластичная лигатура на модуле Round, цвет синий - не более 1000 шт.
- Эластичная лигатура на модуле Round, цвет жёлтый - не более 1000 шт.
- Эластичная лигатура на модуле Round, цвет натуральный - не более 1000 шт.

2. Эластичная лигатура на модуле Flower, в вариантах исполнения:

- Эластичная лигатура на модуле Flower, цвет серебристый - не более 1000 шт.
- Эластичная лигатура на модуле Flower, цвет чёрный - не более 1000 шт.
- Эластичная лигатура на модуле Flower, цвет зелёный - не более 1000 шт.
- Эластичная лигатура на модуле Flower, цвет красный - не более 1000 шт.
- Эластичная лигатура на модуле Flower, цвет прозрачный - не более 1000 шт.
- Эластичная лигатура на модуле Flower, цвет оранжевый - не более 1000 шт.
- Эластичная лигатура на модуле Flower, цвет розовый - не более 1000 шт.
- Эластичная лигатура на модуле Flower, цвет синий - не более 1000 шт.
- Эластичная лигатура на модуле Flower, цвет жёлтый - не более 1000 шт.
- Эластичная лигатура на модуле Flower, цвет натуральный - не более 1000 шт.

3. Эластичная лигатура на модуле Mickey Mouse, в вариантах исполнения:

- Эластичная лигатура на модуле Mickey Mouse, цвет серебристый - не более 1000 шт.
- Эластичная лигатура на модуле Mickey Mouse, цвет чёрный - не более 1000 шт.
- Эластичная лигатура на модуле Mickey Mouse, цвет зелёный - не более 1000 шт.
- Эластичная лигатура на модуле Mickey Mouse, цвет красный - не более 1000 шт.
- Эластичная лигатура на модуле Mickey Mouse, цвет прозрачный - не более 1000 шт.
- Эластичная лигатура на модуле Mickey Mouse, цвет оранжевый - не более 1000 шт.
- Эластичная лигатура на модуле Mickey Mouse, цвет розовый - не более 1000 шт.
- Эластичная лигатура на модуле Mickey Mouse, цвет синий - не более 1000 шт.
- Эластичная лигатура на модуле Mickey Mouse, цвет жёлтый - не более 1000 шт.
- Эластичная лигатура на модуле Mickey Mouse, цвет натуральный - не более 1000 шт.

4. Эластичная лигатура на модуле Cat, в вариантах исполнения:

- Эластичная лигатура на модуле Cat, цвет серебристый - не более 1000 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0113451

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 28 ноября 2022 года № РЗН 2022/18940

Лист 106

- Эластичная лигатура на модуле Cat, цвет чёрный - не более 1000 шт.
- Эластичная лигатура на модуле Cat, цвет зелёный - не более 1000 шт.
- Эластичная лигатура на модуле Cat, цвет красный - не более 1000 шт.
- Эластичная лигатура на модуле Cat, цвет прозрачный - не более 1000 шт.
- Эластичная лигатура на модуле Cat, цвет оранжевый - не более 1000 шт.
- Эластичная лигатура на модуле Cat, цвет розовый - не более 1000 шт.
- Эластичная лигатура на модуле Cat, цвет синий - не более 1000 шт.
- Эластичная лигатура на модуле Cat, цвет жёлтый - не более 1000 шт.
- Эластичная лигатура на модуле Cat, цвет натуральный - не более 1000 шт.

III. Лигатура металлическая, в вариантах исполнения:

1. Лигатура металлическая Ligature Wires, диаметр 0,20 мм, не более 1000 шт.
2. Лигатура металлическая Ligature Wires, диаметр 0,25 мм, не более 1000 шт.
3. Лигатура металлическая Ligature Wires, диаметр 0,30 мм, не более 1000 шт.
4. Лигатура металлическая Кобаяши, Длинная, диаметр 0,30 мм, не более 1000 шт.
5. Лигатура металлическая Кобаяши, Длинная, диаметр 0,35 мм, не более 1000 шт.
6. Лигатура металлическая Кобаяши, Короткая, диаметр 0,30 мм, не более 1000 шт.
7. Лигатура металлическая Кобаяши, Короткая, диаметр 0,35 мм, не более 1000 шт.

IV. Эластичная цепочка, в вариантах исполнения:

1. Эластичная цепочка Power Chain Short, в вариантах исполнения:
 - Эластичная цепочка Short, длина 4,6 м, цвет Серебристый, не более 100 шт.
 - Эластичная цепочка Short, длина 4,6 м, цвет Чёрный, не более 100 шт.
 - Эластичная цепочка Short, длина 4,6 м, цвет Зелёный, не более 100 шт.
 - Эластичная цепочка Short, длина 4,6 м, цвет Красный, не более 100 шт.
 - Эластичная цепочка Short, длина 4,6 м, цвет Прозрачный, не более 100 шт.
 - Эластичная цепочка Short, длина 4,6 м, цвет Оранжевый, не более 100 шт.
 - Эластичная цепочка Short, длина 4,6 м, цвет Розовый, не более 100 шт.
 - Эластичная цепочка Short, длина 4,6 м, цвет Синий, не более 100 шт.
 - Эластичная цепочка Short, длина 4,6 м, цвет Жёлтый, не более 100 шт.
 - Эластичная цепочка Short, длина 4,6 м, цвет Натуральный, не более 100 шт.
2. Эластичная цепочка Power Chain Closed, в вариантах исполнения:
 - Эластичная цепочка Closed, длина 4,6 м, цвет Серебристый, не более 100 шт.
 - Эластичная цепочка Closed, длина 4,6 м, цвет Чёрный, не более 100 шт.
 - Эластичная цепочка Closed, длина 4,6 м, цвет Зелёный, не более 100 шт.
 - Эластичная цепочка Closed, длина 4,6 м, цвет Красный, не более 100 шт.
 - Эластичная цепочка Closed, длина 4,6 м, цвет Прозрачный, не более 100 шт.
 - Эластичная цепочка Closed, длина 4,6 м, цвет Оранжевый, не более 100 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0113452

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 28 ноября 2022 года

№ РЗН 2022/18940

Лист 107

- Эластичная цепочка Closed, длина 4,6 м, цвет Розовый, не более 100 шт.
- Эластичная цепочка Closed, длина 4,6 м, цвет Синий, не более 100 шт.
- Эластичная цепочка Closed, длина 4,6 м, цвет Жёлтый, не более 100 шт.
- Эластичная цепочка Closed, длина 4,6 м, цвет Натуральный, не более 100 шт.
- 3. Эластичная цепочка Power Chain Long, в вариантах исполнения:
 - Эластичная цепочка Long, длина 4,6 м, цвет Серебристый, не более 100 шт.
 - Эластичная цепочка Long, длина 4,6 м, цвет Чёрный, не более 100 шт.
 - Эластичная цепочка Long, длина 4,6 м, цвет Зелёный, не более 100 шт.
 - Эластичная цепочка Long, длина 4,6 м, цвет Красный, не более 100 шт.
 - Эластичная цепочка Long, длина 4,6 м, цвет Прозрачный, не более 100 шт.
 - Эластичная цепочка Long, длина 4,6 м, цвет Оранжевый, не более 100 шт.
 - Эластичная цепочка Long, длина 4,6 м, цвет Розовый, не более 100 шт.
 - Эластичная цепочка Long, длина 4,6 м, цвет Синий, не более 100 шт.
 - Эластичная цепочка Long, длина 4,6 м, цвет Жёлтый, не более 100 шт.
 - Эластичная цепочка Long, длина 4,6 м, цвет Натуральный, не более 100 шт.
- V. Эластичные тяги O-ring, в вариантах исполнения:
 - 1. Эластичные тяги O-ring light, в вариантах исполнения:
 - Эластичные тяги O-ring light, диаметр 1/8 дюйма (3,2 мм), не более 1000 шт.
 - Эластичные тяги O-ring light, диаметр 3/16 дюйма (4,8 мм), не более 1000 шт.
 - Эластичные тяги O-ring light, диаметр 1/4 дюйма (6,4 мм), не более 1000 шт.
 - Эластичные тяги O-ring light, диаметр 5/16 дюйма (8,0 мм), не более 1000 шт.
 - Эластичные тяги O-ring light, диаметр 3/8 дюйма (9,5 мм), не более 1000 шт.
 - 2. Эластичные тяги O-ring medium, в вариантах исполнения:
 - Эластичные тяги O-ring medium, диаметр 1/8 дюйма (3,2 мм), не более 1000 шт.
 - Эластичные тяги O-ring medium, диаметр 3/16 дюйма (4,8 мм), не более 1000 шт.
 - Эластичные тяги O-ring medium, диаметр 1/4 дюйма (6,4 мм), не более 1000 шт.
 - Эластичные тяги O-ring medium, диаметр 5/16 дюйма (8,0 мм), не более 1000 шт.
 - Эластичные тяги O-ring medium, диаметр 3/8 дюйма (9,5 мм), не более 1000 шт.
 - 3. Эластичные тяги O-ring heavy, в вариантах исполнения:
 - Эластичные тяги O-ring heavy, диаметр 1/8 дюйма (3,2 мм), не более 1000 шт.
 - Эластичные тяги O-ring heavy, диаметр 3/16 дюйма (4,8 мм), не более 1000 шт.
 - Эластичные тяги O-ring heavy, диаметр 1/4 дюйма (6,4 мм), не более 1000 шт.
 - Эластичные тяги O-ring heavy, диаметр 5/16 дюйма (8,0 мм), не более 1000 шт.
 - Эластичные тяги O-ring heavy, диаметр 3/8 дюйма (9,5 мм), не более 1000 шт.
 - 4. Эластичные тяги O-ring extra heavy, в вариантах исполнения:
 - Эластичные тяги O-ring extra heavy, диаметр 1/8 дюйма (3,2 мм), не более 1000 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0113453

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 28 ноября 2022 года № РЗН 2022/18940

Лист 108

- Эластичные тяги O-ring extra heavy, диаметр 3/16 дюйма (4,8 мм), не более 1000 шт.
- Эластичные тяги O-ring extra heavy, диаметр 1/4 дюйма (6,4 мм), не более 1000 шт.
- Эластичные тяги O-ring extra heavy, диаметр 5/16 дюйма (8,0 мм), не более 1000 шт.
- Эластичные тяги O-ring extra heavy, диаметр 3/8 дюйма (9,5 мм), не более 1000 шт.

VI. Кольцо бандажное ортодонтическое, в вариантах исполнения:

- Кольцо бандажное ортодонтическое, на первый моляр, верхняя челюсть, право, размер 29 мм, не более 100 шт.
- Кольцо бандажное ортодонтическое, на первый моляр, верхняя челюсть, право, размер 29,5 мм, не более 100 шт.
- Кольцо бандажное ортодонтическое, на первый моляр, верхняя челюсть, право, размер 30 мм, не более 100 шт.
- Кольцо бандажное ортодонтическое, на первый моляр, верхняя челюсть, право, размер 30,5 мм, не более 100 шт.
- Кольцо бандажное ортодонтическое, на первый моляр, верхняя челюсть, право, размер 31 мм, не более 100 шт.
- Кольцо бандажное ортодонтическое, на первый моляр, верхняя челюсть, право, размер 31,5 мм, не более 100 шт.
- Кольцо бандажное ортодонтическое, на первый моляр, верхняя челюсть, право, размер 32 мм, не более 100 шт.
- Кольцо бандажное ортодонтическое, на первый моляр, верхняя челюсть, право, размер 32,5 мм, не более 100 шт.
- Кольцо бандажное ортодонтическое, на первый моляр, верхняя челюсть, право, размер 33 мм, не более 100 шт.
- Кольцо бандажное ортодонтическое, на первый моляр, верхняя челюсть, право, размер 33,5 мм, не более 100 шт.
- Кольцо бандажное ортодонтическое, на первый моляр, верхняя челюсть, право, размер 34 мм, не более 100 шт.
- Кольцо бандажное ортодонтическое, на первый моляр, верхняя челюсть, право, размер 34,5 мм, не более 100 шт.
- Кольцо бандажное ортодонтическое, на первый моляр, верхняя челюсть, право, размер 35 мм, не более 100 шт.
- Кольцо бандажное ортодонтическое, на первый моляр, верхняя челюсть, право, размер 35,5 мм, не более 100 шт.
- Кольцо бандажное ортодонтическое, на первый моляр, верхняя челюсть, право, размер 36 мм, не более 100 шт.
- Кольцо бандажное ортодонтическое, на первый моляр, верхняя челюсть, право,

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0113454

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 28 ноября 2022 года № РЗН 2022/18940

Лист 109

размер 36,5 мм, не более 100 шт.

- Кольцо бандажное ортодонтическое, на первый моляр, верхняя челюсть, право, размер 37 мм, не более 100 шт.

- Кольцо бандажное ортодонтическое, на первый моляр, верхняя челюсть, право, размер 37,5 мм, не более 100 шт.

- Кольцо бандажное ортодонтическое, на первый моляр, верхняя челюсть, право, размер 38 мм, не более 100 шт.

- Кольцо бандажное ортодонтическое, на первый моляр, верхняя челюсть, право, размер 38,5 мм, не более 100 шт.

- Кольцо бандажное ортодонтическое, на первый моляр, верхняя челюсть, право, размер 39 мм, не более 100 шт.

- Кольцо бандажное ортодонтическое, на первый моляр, верхняя челюсть, право, размер 39,5 мм, не более 100 шт.

- Кольцо бандажное ортодонтическое, на первый моляр, верхняя челюсть, право, размер 40 мм, не более 100 шт.

- Кольцо бандажное ортодонтическое, на первый моляр, верхняя челюсть, право, размер 40,5 мм, не более 100 шт.

- Кольцо бандажное ортодонтическое, на первый моляр, верхняя челюсть, право, размер 41 мм, не более 100 шт.

- Кольцо бандажное ортодонтическое, на первый моляр, верхняя челюсть, право, размер 41,5 мм, не более 100 шт.

- Кольцо бандажное ортодонтическое, на первый моляр, верхняя челюсть, право, размер 42 мм, не более 100 шт.

- Кольцо бандажное ортодонтическое, на первый моляр, верхняя челюсть, право, размер 42,5 мм, не более 100 шт.

- Кольцо бандажное ортодонтическое, на первый моляр, верхняя челюсть, право, размер 43 мм, не более 100 шт.

- Кольцо бандажное ортодонтическое, на первый моляр, верхняя челюсть, право, размер 43,5 мм, не более 100 шт.

- Кольцо бандажное ортодонтическое, на первый моляр, верхняя челюсть, право, размер 44 мм, не более 100 шт.

- Кольцо бандажное ортодонтическое, на первый моляр, верхняя челюсть, право, размер 44,5 мм, не более 100 шт.

- Кольцо бандажное ортодонтическое, на первый моляр, верхняя челюсть, лево, размер 29 мм, не более 100 шт.

- Кольцо бандажное ортодонтическое, на первый моляр, верхняя челюсть, лево, размер

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0113455

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 28 ноября 2022 года № РЗН 2022/18940

Лист 110

29,5 мм, не более 100 шт.

- Кольцо бандажное ортодонтическое, на первый моляр, верхняя челюсть, лево, размер 30 мм, не более 100 шт.

- Кольцо бандажное ортодонтическое, на первый моляр, верхняя челюсть, лево, размер 30,5 мм, не более 100 шт.

- Кольцо бандажное ортодонтическое, на первый моляр, верхняя челюсть, лево, размер 31 мм, не более 100 шт.

- Кольцо бандажное ортодонтическое, на первый моляр, верхняя челюсть, лево, размер 31,5 мм, не более 100 шт.

- Кольцо бандажное ортодонтическое, на первый моляр, верхняя челюсть, лево, размер 32 мм, не более 100 шт.

- Кольцо бандажное ортодонтическое, на первый моляр, верхняя челюсть, лево, размер 32,5 мм, не более 100 шт.

- Кольцо бандажное ортодонтическое, на первый моляр, верхняя челюсть, лево, размер 33 мм, не более 100 шт.

- Кольцо бандажное ортодонтическое, на первый моляр, верхняя челюсть, лево, размер 33,5 мм, не более 100 шт.

- Кольцо бандажное ортодонтическое, на первый моляр, верхняя челюсть, лево, размер 34 мм, не более 100 шт.

- Кольцо бандажное ортодонтическое, на первый моляр, верхняя челюсть, лево, размер 34,5 мм, не более 100 шт.

- Кольцо бандажное ортодонтическое, на первый моляр, верхняя челюсть, лево, размер 35 мм, не более 100 шт.

- Кольцо бандажное ортодонтическое, на первый моляр, верхняя челюсть, лево, размер 35,5 мм, не более 100 шт.

- Кольцо бандажное ортодонтическое, на первый моляр, верхняя челюсть, лево, размер 36 мм, не более 100 шт.

- Кольцо бандажное ортодонтическое, на первый моляр, верхняя челюсть, лево, размер 36,5 мм, не более 100 шт.

- Кольцо бандажное ортодонтическое, на первый моляр, верхняя челюсть, лево, размер 37 мм, не более 100 шт.

- Кольцо бандажное ортодонтическое, на первый моляр, верхняя челюсть, лево, размер 37,5 мм, не более 100 шт.

- Кольцо бандажное ортодонтическое, на первый моляр, верхняя челюсть, лево, размер 38 мм, не более 100 шт.

- Кольцо бандажное ортодонтическое, на первый моляр, верхняя челюсть, лево, размер

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0113456

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 28 ноября 2022 года № РЗН 2022/18940

Лист 111

38,5 мм, не более 100 шт.

- Кольцо бандажное ортодонтическое, на первый моляр, верхняя челюсть, размер 39 мм, не более 100 шт.

- Кольцо бандажное ортодонтическое, на первый моляр, верхняя челюсть, лево, размер 39,5 мм, не более 100 шт.

- Кольцо бандажное ортодонтическое, на первый моляр, верхняя челюсть, лево, размер 40 мм, не более 100 шт.

- Кольцо бандажное ортодонтическое, на первый моляр, верхняя челюсть, лево, размер 40,5 мм, не более 100 шт.

- Кольцо бандажное ортодонтическое, на первый моляр, верхняя челюсть, лево, размер 41 мм, не более 100 шт.

- Кольцо бандажное ортодонтическое, на первый моляр, верхняя челюсть, лево, размер 41,5 мм, не более 100 шт.

- Кольцо бандажное ортодонтическое, на первый моляр, верхняя челюсть, лево, размер 42 мм, не более 100 шт.

- Кольцо бандажное ортодонтическое, на первый моляр, верхняя челюсть, лево, размер 42,5 мм, не более 100 шт.

- Кольцо бандажное ортодонтическое, на первый моляр, верхняя челюсть, лево, размер 43 мм, не более 100 шт.

- Кольцо бандажное ортодонтическое, на первый моляр, верхняя челюсть, лево, размер 43,5 мм, не более 100 шт.

- Кольцо бандажное ортодонтическое, на первый моляр, верхняя челюсть, лево, размер 44 мм, не более 100 шт.

- Кольцо бандажное ортодонтическое, на первый моляр, верхняя челюсть, лево, размер 44,5 мм, не более 100 шт.

- Кольцо бандажное ортодонтическое, на первый моляр, нижняя челюсть, лево, размер 29 мм, не более 100 шт.

- Кольцо бандажное ортодонтическое, на первый моляр, нижняя челюсть, лево, размер 29,5 мм, не более 100 шт.

- Кольцо бандажное ортодонтическое, на первый моляр, нижняя челюсть, лево, размер 30 мм, не более 100 шт.

- Кольцо бандажное ортодонтическое, на первый моляр, нижняя челюсть, лево, размер 30,5 мм, не более 100 шт.

- Кольцо бандажное ортодонтическое, на первый моляр, нижняя челюсть, лево, размер 31 мм, не более 100 шт.

- Кольцо бандажное ортодонтическое, на первый моляр, нижняя челюсть, лево, размер

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0113457

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 28 ноября 2022 года № РЗН 2022/18940

Лист 112

31,5 мм, не более 100 шт.

- Кольцо бандажное ортодонтическое, на первый моляр, нижняя челюсть, лево, размер 32 мм, не более 100 шт.

- Кольцо бандажное ортодонтическое, на первый моляр, нижняя челюсть, лево, размер 32,5 мм, не более 100 шт.

- Кольцо бандажное ортодонтическое, на первый моляр, нижняя челюсть, лево, размер 33 мм, не более 100 шт.

- Кольцо бандажное ортодонтическое, на первый моляр, нижняя челюсть, лево, размер 33,5 мм, не более 100 шт.

- Кольцо бандажное ортодонтическое, на первый моляр, нижняя челюсть, лево, размер 34 мм, не более 100 шт.

- Кольцо бандажное ортодонтическое, на первый моляр, нижняя челюсть, лево, размер 34,5 мм, не более 100 шт.

- Кольцо бандажное ортодонтическое, на первый моляр, нижняя челюсть, лево, размер 35 мм, не более 100 шт.

- Кольцо бандажное ортодонтическое, на первый моляр, нижняя челюсть, лево, размер 35,5 мм, не более 100 шт.

- Кольцо бандажное ортодонтическое, на первый моляр, нижняя челюсть, лево, размер 36 мм, не более 100 шт.

- Кольцо бандажное ортодонтическое, на первый моляр, нижняя челюсть, лево, размер 36,5 мм, не более 100 шт.

- Кольцо бандажное ортодонтическое, на первый моляр, нижняя челюсть, лево, размер 37 мм, не более 100 шт.

- Кольцо бандажное ортодонтическое, на первый моляр, нижняя челюсть, лево, размер 37,5 мм, не более 100 шт.

- Кольцо бандажное ортодонтическое, на первый моляр, нижняя челюсть, лево, размер 38 мм, не более 100 шт.

- Кольцо бандажное ортодонтическое, на первый моляр, нижняя челюсть, лево, размер 38,5 мм, не более 100 шт.

- Кольцо бандажное ортодонтическое, на первый моляр, нижняя челюсть, лево, размер 39 мм, не более 100 шт.

- Кольцо бандажное ортодонтическое, на первый моляр, нижняя челюсть, лево, размер 39,5 мм, не более 100 шт.

- Кольцо бандажное ортодонтическое, на первый моляр, нижняя челюсть, лево, размер 40 мм, не более 100 шт.

- Кольцо бандажное ортодонтическое, на первый моляр, нижняя челюсть, лево, размер

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0113458

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 28 ноября 2022 года № РЗН 2022/18940

Лист 113

40,5 мм, не более 100 шт.

- Кольцо бандажное ортодонтическое, на первый моляр, нижняя челюсть, лево, размер 41 мм, не более 100 шт.
- Кольцо бандажное ортодонтическое, на первый моляр, нижняя челюсть, лево, размер 41,5 мм, не более 100 шт.
- Кольцо бандажное ортодонтическое, на первый моляр, нижняя челюсть, лево, размер 42 мм, не более 100 шт.
- Кольцо бандажное ортодонтическое, на первый моляр, нижняя челюсть, лево, размер 42,5 мм, не более 100 шт.
- Кольцо бандажное ортодонтическое, на первый моляр, нижняя челюсть, лево, размер 43 мм, не более 100 шт.
- Кольцо бандажное ортодонтическое, на первый моляр, нижняя челюсть, лево, размер 43,5 мм, не более 100 шт.
- Кольцо бандажное ортодонтическое, на первый моляр, нижняя челюсть, лево, размер 44 мм, не более 100 шт.
- Кольцо бандажное ортодонтическое, на первый моляр, нижняя челюсть, лево, размер 44,5 мм, не более 100 шт.
- Кольцо бандажное ортодонтическое, на первый моляр, нижняя челюсть, право, размер 29 мм, не более 100 шт.
- Кольцо бандажное ортодонтическое, на первый моляр, нижняя челюсть, право, размер 29,5 мм, не более 100 шт.
- Кольцо бандажное ортодонтическое, на первый моляр, нижняя челюсть, право, размер 30 мм, не более 100 шт.
- Кольцо бандажное ортодонтическое, на первый моляр, нижняя челюсть, право, размер 30,5 мм, не более 100 шт.
- Кольцо бандажное ортодонтическое, на первый моляр, нижняя челюсть, право, размер 31 мм, не более 100 шт.
- Кольцо бандажное ортодонтическое, на первый моляр, нижняя челюсть, право, размер 31,5 мм, не более 100 шт.
- Кольцо бандажное ортодонтическое, на первый моляр, нижняя челюсть, право, размер 32 мм, не более 100 шт.
- Кольцо бандажное ортодонтическое, на первый моляр, нижняя челюсть, право, размер 32,5 мм, не более 100 шт.
- Кольцо бандажное ортодонтическое, на первый моляр, нижняя челюсть, право, размер 33 мм, не более 100 шт.
- Кольцо бандажное ортодонтическое, на первый моляр, нижняя челюсть, право,

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0113459

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 28 ноября 2022 года № РЗН 2022/18940

Лист 114

размер 33,5 мм, не более 100 шт.

- Кольцо бандажное ортодонтическое, на первый моляр, нижняя челюсть, право, размер 34 мм, не более 100 шт.

- Кольцо бандажное ортодонтическое, на первый моляр, нижняя челюсть, право, размер 34,5 мм, не более 100 шт.

- Кольцо бандажное ортодонтическое, на первый моляр, нижняя челюсть, право, размер 35 мм, не более 100 шт.

- Кольцо бандажное ортодонтическое, на первый моляр, нижняя челюсть, право, размер 35,5 мм, не более 100 шт.

- Кольцо бандажное ортодонтическое, на первый моляр, нижняя челюсть, право, размер 36 мм, не более 100 шт.

- Кольцо бандажное ортодонтическое, на первый моляр, нижняя челюсть, право, размер 36,5 мм, не более 100 шт.

- Кольцо бандажное ортодонтическое, на первый моляр, нижняя челюсть, право, размер 37 мм, не более 100 шт.

- Кольцо бандажное ортодонтическое, на первый моляр, нижняя челюсть, право, размер 37,5 мм, не более 100 шт.

- Кольцо бандажное ортодонтическое, на первый моляр, нижняя челюсть, право, размер 38 мм, не более 100 шт.

- Кольцо бандажное ортодонтическое, на первый моляр, нижняя челюсть, право, размер 38,5 мм, не более 100 шт.

- Кольцо бандажное ортодонтическое, на первый моляр, нижняя челюсть, право, размер 39 мм, не более 100 шт.

- Кольцо бандажное ортодонтическое, на первый моляр, нижняя челюсть, право, размер 39,5 мм, не более 100 шт.

- Кольцо бандажное ортодонтическое, на первый моляр, нижняя челюсть, право, размер 40 мм, не более 100 шт.

- Кольцо бандажное ортодонтическое, на первый моляр, нижняя челюсть, право, размер 40,5 мм, не более 100 шт.

- Кольцо бандажное ортодонтическое, на первый моляр, нижняя челюсть, право, размер 41 мм, не более 100 шт.

- Кольцо бандажное ортодонтическое, на первый моляр, нижняя челюсть, право, размер 41,5 мм, не более 100 шт.

- Кольцо бандажное ортодонтическое, на первый моляр, нижняя челюсть, право, размер 42 мм, не более 100 шт.

- Кольцо бандажное ортодонтическое, на первый моляр, нижняя челюсть, право,

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0113460

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 28 ноября 2022 года № РЗН 2022/18940

Лист 115

- размер 42,5 мм, не более 100 шт.
- Кольцо бандажное ортодонтическое, на первый моляр, нижняя челюсть, право, размер 43 мм, не более 100 шт.
 - Кольцо бандажное ортодонтическое, на первый моляр, нижняя челюсть, право, размер 43,5 мм, не более 100 шт.
 - Кольцо бандажное ортодонтическое, на первый моляр, нижняя челюсть, право, размер 44 мм, не более 100 шт.
 - Кольцо бандажное ортодонтическое, на первый моляр, нижняя челюсть, право, размер 44,5 мм, не более 100 шт.
 - Кольцо бандажное ортодонтическое, на второй моляр, верхняя челюсть, право, размер 29 мм, не более 100 шт.
 - Кольцо бандажное ортодонтическое, на второй моляр, верхняя челюсть, право, размер 29,5 мм, не более 100 шт.
 - Кольцо бандажное ортодонтическое, на второй моляр, верхняя челюсть, право, размер 30 мм, не более 100 шт.
 - Кольцо бандажное ортодонтическое, на второй моляр, верхняя челюсть, право, размер 30,5 мм, не более 100 шт.
 - Кольцо бандажное ортодонтическое, на второй моляр, верхняя челюсть, право, размер 31 мм, не более 100 шт.
 - Кольцо бандажное ортодонтическое, на второй моляр, верхняя челюсть, право, размер 31,5 мм, не более 100 шт.
 - Кольцо бандажное ортодонтическое, на второй моляр, верхняя челюсть, право, размер 32 мм, не более 100 шт.
 - Кольцо бандажное ортодонтическое, на второй моляр, верхняя челюсть, право, размер 32,5 мм, не более 100 шт.
 - Кольцо бандажное ортодонтическое, на второй моляр, верхняя челюсть, право, размер 33 мм, не более 100 шт.
 - Кольцо бандажное ортодонтическое, на второй моляр, верхняя челюсть, право, размер 33,5 мм, не более 100 шт.
 - Кольцо бандажное ортодонтическое, на второй моляр, верхняя челюсть, право, размер 34 мм, не более 100 шт.
 - Кольцо бандажное ортодонтическое, на второй моляр, верхняя челюсть, право, размер 34,5 мм, не более 100 шт.
 - Кольцо бандажное ортодонтическое, на второй моляр, верхняя челюсть, право, размер 35 мм, не более 100 шт.
 - Кольцо бандажное ортодонтическое, на второй моляр, верхняя челюсть, право, размер 35,5 мм, не более 100 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0113461

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 28 ноября 2022 года № РЗН 2022/18940

Лист 116

размер 35,5 мм, не более 100 шт.

- Кольцо бандажное ортодонтическое, на второй моляр, верхняя челюсть, право, размер 36 мм, не более 100 шт.

- Кольцо бандажное ортодонтическое, на второй моляр, верхняя челюсть, право, размер 36,5 мм, не более 100 шт.

- Кольцо бандажное ортодонтическое, на второй моляр, верхняя челюсть, право, размер 37 мм, не более 100 шт.

- Кольцо бандажное ортодонтическое, на второй моляр, верхняя челюсть, право, размер 37,5 мм, не более 100 шт.

- Кольцо бандажное ортодонтическое, на второй моляр, верхняя челюсть, право, размер 38 мм, не более 100 шт.

- Кольцо бандажное ортодонтическое, на второй моляр, верхняя челюсть, право, размер 38,5 мм, не более 100 шт.

- Кольцо бандажное ортодонтическое, на второй моляр, верхняя челюсть, право, размер 39 мм, не более 100 шт.

- Кольцо бандажное ортодонтическое, на второй моляр, верхняя челюсть, право, размер 39,5 мм, не более 100 шт.

- Кольцо бандажное ортодонтическое, на второй моляр, верхняя челюсть, право, размер 40 мм, не более 100 шт.

- Кольцо бандажное ортодонтическое, на второй моляр, верхняя челюсть, право, размер 40,5 мм, не более 100 шт.

- Кольцо бандажное ортодонтическое, на второй моляр, верхняя челюсть, право, размер 41 мм, не более 100 шт.

- Кольцо бандажное ортодонтическое, на второй моляр, верхняя челюсть, право, размер 41,5 мм, не более 100 шт.

- Кольцо бандажное ортодонтическое, на второй моляр, верхняя челюсть, право, размер 42 мм, не более 100 шт.

- Кольцо бандажное ортодонтическое, на второй моляр, верхняя челюсть, право, размер 42,5 мм, не более 100 шт.

- Кольцо бандажное ортодонтическое, на второй моляр, верхняя челюсть, право, размер 43 мм, не более 100 шт.

- Кольцо бандажное ортодонтическое, на второй моляр, верхняя челюсть, право, размер 43,5 мм, не более 100 шт.

- Кольцо бандажное ортодонтическое, на второй моляр, верхняя челюсть, право, размер 44 мм, не более 100 шт.

- Кольцо бандажное ортодонтическое, на второй моляр, верхняя челюсть, право,

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0113462

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 28 ноября 2022 года № РЗН 2022/18940

Лист 117

размер 44,5 мм, не более 100 шт.

- Кольцо бандажное ортодонтическое, на второй моляр, верхняя челюсть, лево, размер 29 мм, не более 100 шт.

- Кольцо бандажное ортодонтическое, на второй моляр, верхняя челюсть, лево, размер 29,5 мм, не более 100 шт.

- Кольцо бандажное ортодонтическое, на второй моляр, верхняя челюсть, лево, размер 30 мм, не более 100 шт.

- Кольцо бандажное ортодонтическое, на второй моляр, верхняя челюсть, лево, размер 30,5 мм, не более 100 шт.

- Кольцо бандажное ортодонтическое, на второй моляр, верхняя челюсть, лево, размер 31 мм, не более 100 шт.

- Кольцо бандажное ортодонтическое, на второй моляр, верхняя челюсть, лево, размер 31,5 мм, не более 100 шт.

- Кольцо бандажное ортодонтическое, на второй моляр, верхняя челюсть, лево, размер 32 мм, не более 100 шт.

- Кольцо бандажное ортодонтическое, на второй моляр, верхняя челюсть, лево, размер 32,5 мм, не более 100 шт.

- Кольцо бандажное ортодонтическое, на второй моляр, верхняя челюсть, лево, размер 33 мм, не более 100 шт.

- Кольцо бандажное ортодонтическое, на второй моляр, верхняя челюсть, лево, размер 33,5 мм, не более 100 шт.

- Кольцо бандажное ортодонтическое, на второй моляр, верхняя челюсть, лево, размер 34 мм, не более 100 шт.

- Кольцо бандажное ортодонтическое, на второй моляр, верхняя челюсть, лево, размер 34,5 мм, не более 100 шт.

- Кольцо бандажное ортодонтическое, на второй моляр, верхняя челюсть, лево, размер 35 мм, не более 100 шт.

- Кольцо бандажное ортодонтическое, на второй моляр, верхняя челюсть, лево, размер 35,5 мм, не более 100 шт.

- Кольцо бандажное ортодонтическое, на второй моляр, верхняя челюсть, лево, размер 36 мм, не более 100 шт.

- Кольцо бандажное ортодонтическое, на второй моляр, верхняя челюсть, лево, размер 36,5 мм, не более 100 шт.

- Кольцо бандажное ортодонтическое, на второй моляр, верхняя челюсть, лево, размер 37 мм, не более 100 шт.

- Кольцо бандажное ортодонтическое, на второй моляр, верхняя челюсть, лево, размер

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0113463

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 28 ноября 2022 года № РЗН 2022/18940

Лист 118

37,5 мм, не более 100 шт.

- Кольцо бандажное ортодонтическое, на второй моляр, верхняя челюсть, лево, размер 38 мм, не более 100 шт.

- Кольцо бандажное ортодонтическое, на второй моляр, верхняя челюсть, лево, размер 38,5 мм, не более 100 шт.

- Кольцо бандажное ортодонтическое, на второй моляр, верхняя челюсть, лево, размер 39 мм, не более 100 шт.

- Кольцо бандажное ортодонтическое, на второй моляр, верхняя челюсть, лево, размер 39,5 мм, не более 100 шт.

- Кольцо бандажное ортодонтическое, на второй моляр, верхняя челюсть, лево, размер 40 мм, не более 100 шт.

- Кольцо бандажное ортодонтическое, на второй моляр, верхняя челюсть, лево, размер 40,5 мм, не более 100 шт.

- Кольцо бандажное ортодонтическое, на второй моляр, верхняя челюсть, лево, размер 41 мм, не более 100 шт.

- Кольцо бандажное ортодонтическое, на второй моляр, верхняя челюсть, лево, размер 41,5 мм, не более 100 шт.

- Кольцо бандажное ортодонтическое, на второй моляр, верхняя челюсть, лево, размер 42 мм, не более 100 шт.

- Кольцо бандажное ортодонтическое, на второй моляр, верхняя челюсть, лево, размер 42,5 мм, не более 100 шт.

- Кольцо бандажное ортодонтическое, на второй моляр, верхняя челюсть, лево, размер 43 мм, не более 100 шт.

- Кольцо бандажное ортодонтическое, на второй моляр, верхняя челюсть, лево, размер 43,5 мм, не более 100 шт.

- Кольцо бандажное ортодонтическое, на второй моляр, верхняя челюсть, лево, размер 44 мм, не более 100 шт.

- Кольцо бандажное ортодонтическое, на второй моляр, верхняя челюсть, лево, размер 44,5 мм, не более 100 шт.

- Кольцо бандажное ортодонтическое, на второй моляр, нижняя челюсть, лево, размер 29 мм, не более 100 шт.

- Кольцо бандажное ортодонтическое, на второй моляр, нижняя челюсть, лево, размер 29,5 мм, не более 100 шт.

- Кольцо бандажное ортодонтическое, на второй моляр, нижняя челюсть, лево, размер 30 мм, не более 100 шт.

- Кольцо бандажное ортодонтическое, на второй моляр, нижняя челюсть, лево, размер

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0113464

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 28 ноября 2022 года № РЗН 2022/18940

Лист 119

30,5 мм, не более 100 шт.

- Кольцо бандажное ортодонтическое, на второй моляр, нижняя челюсть, лево, размер 31 мм, не более 100 шт.
- Кольцо бандажное ортодонтическое, на второй моляр, нижняя челюсть, лево, размер 31,5 мм, не более 100 шт.
- Кольцо бандажное ортодонтическое, на второй моляр, нижняя челюсть, лево, размер 32 мм, не более 100 шт.
- Кольцо бандажное ортодонтическое, на второй моляр, нижняя челюсть, лево, размер 32,5 мм, не более 100 шт.
- Кольцо бандажное ортодонтическое, на второй моляр, нижняя челюсть, лево, размер 33 мм, не более 100 шт.
- Кольцо бандажное ортодонтическое, на второй моляр, нижняя челюсть, лево, размер 33,5 мм, не более 100 шт.
- Кольцо бандажное ортодонтическое, на второй моляр, нижняя челюсть, лево, размер 34 мм, не более 100 шт.
- Кольцо бандажное ортодонтическое, на второй моляр, нижняя челюсть, лево, размер 34,5 мм, не более 100 шт.
- Кольцо бандажное ортодонтическое, на второй моляр, нижняя челюсть, лево, размер 35 мм, не более 100 шт.
- Кольцо бандажное ортодонтическое, на второй моляр, нижняя челюсть, лево, размер 35,5 мм, не более 100 шт.
- Кольцо бандажное ортодонтическое, на второй моляр, нижняя челюсть, лево, размер 36 мм, не более 100 шт.
- Кольцо бандажное ортодонтическое, на второй моляр, нижняя челюсть, лево, размер 36,5 мм, не более 100 шт.
- Кольцо бандажное ортодонтическое, на второй моляр, нижняя челюсть, лево, размер 37 мм, не более 100 шт.
- Кольцо бандажное ортодонтическое, на второй моляр, нижняя челюсть, лево, размер 37,5 мм, не более 100 шт.
- Кольцо бандажное ортодонтическое, на второй моляр, нижняя челюсть, лево, размер 38 мм, не более 100 шт.
- Кольцо бандажное ортодонтическое, на второй моляр, нижняя челюсть, лево, размер 38,5 мм, не более 100 шт.
- Кольцо бандажное ортодонтическое, на второй моляр, нижняя челюсть, лево, размер 39 мм, не более 100 шт.
- Кольцо бандажное ортодонтическое, на второй моляр, нижняя челюсть, лево, размер

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0113465

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 28 ноября 2022 года

№ РЗН 2022/18940

Лист 120

39,5 мм, не более 100 шт.

- Кольцо бандажное ортодонтическое, на второй моляр, нижняя челюсть, лево, размер 40 мм, не более 100 шт.

- Кольцо бандажное ортодонтическое, на второй моляр, нижняя челюсть, лево, размер 40,5 мм, не более 100 шт.

- Кольцо бандажное ортодонтическое, на второй моляр, нижняя челюсть, лево, размер 41 мм, не более 100 шт.

- Кольцо бандажное ортодонтическое, на второй моляр, нижняя челюсть, лево, размер 41,5 мм, не более 100 шт.

- Кольцо бандажное ортодонтическое, на второй моляр, нижняя челюсть, лево, размер 42 мм, не более 100 шт.

- Кольцо бандажное ортодонтическое, на второй моляр, нижняя челюсть, лево, размер 42,5 мм, не более 100 шт.

- Кольцо бандажное ортодонтическое, на второй моляр, нижняя челюсть, лево, размер 43 мм, не более 100 шт.

- Кольцо бандажное ортодонтическое, на второй моляр, нижняя челюсть, лево, размер 43,5 мм, не более 100 шт.

- Кольцо бандажное ортодонтическое, на второй моляр, нижняя челюсть, лево, размер 44 мм, не более 100 шт.

- Кольцо бандажное ортодонтическое, на второй моляр, нижняя челюсть, лево, размер 44,5 мм, не более 100 шт.

- Кольцо бандажное ортодонтическое, на второй моляр, нижняя челюсть, право, размер 29 мм, не более 100 шт.

- Кольцо бандажное ортодонтическое, на второй моляр, нижняя челюсть, право, размер 29,5 мм, не более 100 шт.

- Кольцо бандажное ортодонтическое, на второй моляр, нижняя челюсть, право, размер 30 мм, не более 100 шт.

- Кольцо бандажное ортодонтическое, на второй моляр, нижняя челюсть, право, размер 30,5 мм, не более 100 шт.

- Кольцо бандажное ортодонтическое, на второй моляр, нижняя челюсть, право, размер 31 мм, не более 100 шт.

- Кольцо бандажное ортодонтическое, на второй моляр, нижняя челюсть, право, размер 31,5 мм, не более 100 шт.

- Кольцо бандажное ортодонтическое, на второй моляр, нижняя челюсть, право, размер 32 мм, не более 100 шт.

- Кольцо бандажное ортодонтическое, на второй моляр, нижняя челюсть, право, размер

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0113466

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 28 ноября 2022 года № РЗН 2022/18940

Лист 121

32,5 мм, не более 100 шт.

- Кольцо бандажное ортодонтическое, на второй моляр, нижняя челюсть, право, размер 33 мм, не более 100 шт.

- Кольцо бандажное ортодонтическое, на второй моляр, нижняя челюсть, право, размер 33,5 мм, не более 100 шт.

- Кольцо бандажное ортодонтическое, на второй моляр, нижняя челюсть, право, размер 34 мм, не более 100 шт.

- Кольцо бандажное ортодонтическое, на второй моляр, нижняя челюсть, право, размер 34,5 мм, не более 100 шт.

- Кольцо бандажное ортодонтическое, на второй моляр, нижняя челюсть, право, размер 35 мм, не более 100 шт.

- Кольцо бандажное ортодонтическое, на второй моляр, нижняя челюсть, право, размер 35,5 мм, не более 100 шт.

- Кольцо бандажное ортодонтическое, на второй моляр, нижняя челюсть, право, размер 36 мм, не более 100 шт.

- Кольцо бандажное ортодонтическое, на второй моляр, нижняя челюсть, право, размер 36,5 мм, не более 100 шт.

- Кольцо бандажное ортодонтическое, на второй моляр, нижняя челюсть, право, размер 37 мм, не более 100 шт.

- Кольцо бандажное ортодонтическое, на второй моляр, нижняя челюсть, право, размер 37,5 мм, не более 100 шт.

- Кольцо бандажное ортодонтическое, на второй моляр, нижняя челюсть, право, размер 38 мм, не более 100 шт.

- Кольцо бандажное ортодонтическое, на второй моляр, нижняя челюсть, право, размер 38,5 мм, не более 100 шт.

- Кольцо бандажное ортодонтическое, на второй моляр, нижняя челюсть, право, размер 39 мм, не более 100 шт.

- Кольцо бандажное ортодонтическое, на второй моляр, нижняя челюсть, право, размер 39,5 мм, не более 100 шт.

- Кольцо бандажное ортодонтическое, на второй моляр, нижняя челюсть, право, размер 40 мм, не более 100 шт.

- Кольцо бандажное ортодонтическое, на второй моляр, нижняя челюсть, право, размер 40,5 мм, не более 100 шт.

- Кольцо бандажное ортодонтическое, на второй моляр, нижняя челюсть, право, размер 41 мм, не более 100 шт.

- Кольцо бандажное ортодонтическое, на второй моляр, нижняя челюсть, право, размер

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0113467

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 28 ноября 2022 года № РЗН 2022/18940

Лист 122

41,5 мм, не более 100 шт.

- Кольцо бандажное ортодонтическое, на второй моляр, нижняя челюсть, право, размер 42 мм, не более 100 шт.

- Кольцо бандажное ортодонтическое, на второй моляр, нижняя челюсть, право, размер 42,5 мм, не более 100 шт.

- Кольцо бандажное ортодонтическое, на второй моляр, нижняя челюсть, право, размер 43 мм, не более 100 шт.

- Кольцо бандажное ортодонтическое, на второй моляр, нижняя челюсть, право, размер 43,5 мм, не более 100 шт.

- Кольцо бандажное ортодонтическое, на второй моляр, нижняя челюсть, право, размер 44 мм, не более 100 шт.

- Кольцо бандажное ортодонтическое, на второй моляр, нижняя челюсть, право, размер 44,5 мм, не более 100 шт.

VII. Щечные трубки, в вариантах исполнения:

1. Щечные трубки для приклеивания Nepto, в вариантах исполнения:

- Щечные трубки для приклеивания Nepto на первый моляр, Edgewise неконвертируемые, 0,018 дюймов (0,46 мм), верхняя челюсть, право - не более 1000 шт.

- Щечные трубки для приклеивания Nepto на первый моляр, Edgewise неконвертируемые, 0,018 дюймов (0,46 мм), верхняя челюсть, лево - не более 1000 шт.

- Щечные трубки для приклеивания Nepto на первый моляр, Edgewise неконвертируемые, 0,018 дюймов (0,46 мм), нижняя челюсть, лево - не более 1000 шт.

- Щечные трубки для приклеивания Nepto на первый моляр, Edgewise неконвертируемые, 0,018 дюймов (0,46 мм), нижняя челюсть, право - не более 1000 шт.

- Щечные трубки для приклеивания Nepto на первый моляр, Edgewise неконвертируемые, 0,022 дюйма (0,56 мм), верхняя челюсть, право - не более 1000 шт.

- Щечные трубки для приклеивания Nepto на первый моляр, Edgewise неконвертируемые, 0,022 дюйма (0,56 мм), верхняя челюсть, лево - не более 1000 шт.

- Щечные трубки для приклеивания Nepto на первый моляр, Edgewise неконвертируемые, 0,022 дюйма (0,56 мм), нижняя челюсть, лево - не более 1000 шт.

- Щечные трубки для приклеивания Nepto на первый моляр, Edgewise неконвертируемые, 0,022 дюйма (0,56 мм), нижняя челюсть, право - не более 1000 шт.

- Щечные трубки для приклеивания Nepto на первый моляр, Roth неконвертируемые, 0,018 дюймов (0,46 мм), верхняя челюсть, право - не более 1000 шт.

- Щечные трубки для приклеивания Nepto на первый моляр, Roth неконвертируемые двойные, 0,018 дюймов (0,46 мм), верхняя челюсть, право - не более 1000 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0113468

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 28 ноября 2022 года № РЗН 2022/18940

Лист 123

- Щечные трубки для приклеивания Nepto на первый моляр, Roth неконвертируемые тройные, 0,018 дюймов (0,46 мм), верхняя челюсть, право - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приклеивания Nepto на первый моляр, Roth неконвертируемые, 0,018 дюймов (0,46 мм), верхняя челюсть, лево - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приклеивания Nepto на первый моляр, Roth неконвертируемые двойные, 0,018 дюймов (0,46 мм), верхняя челюсть, лево - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приклеивания Nepto на первый моляр, Roth неконвертируемые тройные, 0,018 дюймов (0,46 мм), верхняя челюсть, лево - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приклеивания Nepto на первый моляр, Roth неконвертируемые, 0,018 дюймов (0,46 мм), нижняя челюсть, лево - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приклеивания Nepto на первый моляр, Roth неконвертируемые двойные, 0,018 дюймов (0,46 мм), нижняя челюсть, лево - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приклеивания Nepto на первый моляр, Roth неконвертируемые, 0,018 дюймов (0,46 мм), нижняя челюсть, право - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приклеивания Nepto на первый моляр, Roth неконвертируемые двойные, 0,018 дюймов (0,46 мм), нижняя челюсть, право - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приклеивания Nepto на первый моляр, Roth неконвертируемые, 0,022 дюйма (0,56 мм), верхняя челюсть, право - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приклеивания Nepto на первый моляр, Roth неконвертируемые двойные, 0,022 дюйма (0,56 мм), верхняя челюсть, право - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приклеивания Nepto на первый моляр, Roth неконвертируемые тройные, 0,022 дюйма (0,56 мм), верхняя челюсть, право - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приклеивания Nepto на первый моляр, Roth неконвертируемые, 0,022 дюйма (0,56 мм), верхняя челюсть, лево - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приклеивания Nepto на первый моляр, Roth неконвертируемые двойные, 0,022 дюйма (0,56 мм), верхняя челюсть, лево - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приклеивания Nepto на первый моляр, Roth неконвертируемые тройные, 0,022 дюйма (0,56 мм), верхняя челюсть, лево - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приклеивания Nepto на первый моляр, Roth неконвертируемые, 0,022 дюйма (0,56 мм), нижняя челюсть, лево - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приклеивания Nepto на первый моляр, Roth неконвертируемые двойные, 0,022 дюйма (0,56 мм), нижняя челюсть, лево - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приклеивания Nepto на первый моляр, Roth неконвертируемые, 0,022 дюйма (0,56 мм), нижняя челюсть, право - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приклеивания Nepto на первый моляр, Roth неконвертируемые двойные, 0,022 дюйма (0,56 мм), нижняя челюсть, право - не более 1000 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0113469

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 28 ноября 2022 года № РЗН 2022/18940

Лист 124

- Щечные трубки для приклеивания Nepto на первый моляр, McBeTr неконвертируемые, 0,018 дюймов (0,46 мм), верхняя челюсть, право - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приклеивания Nepto на первый моляр, McBeTr неконвертируемые двойные, 0,018 дюймов (0,46 мм), верхняя челюсть, право - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приклеивания Nepto на первый моляр, McBeTr неконвертируемые тройные, 0,018 дюймов (0,46 мм), верхняя челюсть, право - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приклеивания Nepto на первый моляр, McBeTr неконвертируемые, 0,018 дюймов (0,46 мм), верхняя челюсть, лево - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приклеивания Nepto на первый моляр, McBeTr неконвертируемые двойные, 0,018 дюймов (0,46 мм), верхняя челюсть, лево - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приклеивания Nepto на первый моляр, McBeTr неконвертируемые тройные, 0,018 дюймов (0,46 мм), верхняя челюсть, лево - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приклеивания Nepto на первый моляр, McBeTr неконвертируемые, 0,018 дюймов (0,46 мм), нижняя челюсть, лево - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приклеивания Nepto на первый моляр, McBeTr неконвертируемые двойные, 0,018 дюймов (0,46 мм), нижняя челюсть, лево - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приклеивания Nepto на первый моляр, McBeTr неконвертируемые, 0,018 дюймов (0,46 мм), нижняя челюсть, право - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приклеивания Nepto на первый моляр, McBeTr неконвертируемые двойные, 0,018 дюймов (0,46 мм), нижняя челюсть, право - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приклеивания Nepto на первый моляр, McBeTr неконвертируемые, 0,022 дюйма (0,56 мм), верхняя челюсть, право - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приклеивания Nepto на первый моляр, McBeTr неконвертируемые двойные, 0,022 дюйма (0,56 мм), верхняя челюсть, право - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приклеивания Nepto на первый моляр, McBeTr неконвертируемые тройные, 0,022 дюйма (0,56 мм), верхняя челюсть, право - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приклеивания Nepto на первый моляр, McBeTr

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0113470

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 28 ноября 2022 года № РЗН 2022/18940

Лист 125

- неконвертируемые, 0,022 дюйма (0,56 мм), верхняя челюсть, лево - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приклеивания Nepto на первый моляр, McBeTr неконвертируемые двойные, 0,022 дюйма (0,56 мм), верхняя челюсть, лево - не более 1000 шт.
 - Щечные трубки для приклеивания Nepto на первый моляр, McBeTr неконвертируемые тройные, 0,022 дюйма (0,56 мм), верхняя челюсть, лево - не более 1000 шт.
 - Щечные трубки для приклеивания Nepto на первый моляр, McBeTr неконвертируемые, 0,022 дюйма (0,56 мм), нижняя челюсть, лево - не более 1000 шт.
 - Щечные трубки для приклеивания Nepto на первый моляр, McBeTr неконвертируемые двойные, 0,022 дюйма (0,56 мм), нижняя челюсть, лево - не более 1000 шт.
 - Щечные трубки для приклеивания Nepto на первый моляр, McBeTr неконвертируемые, 0,022 дюйма (0,56 мм), нижняя челюсть, право - не более 1000 шт.
 - Щечные трубки для приклеивания Nepto на первый моляр, McBeTr неконвертируемые двойные, 0,022 дюйма (0,56 мм), нижняя челюсть, право - не более 1000 шт.
 - Щечные трубки для приклеивания Nepto на второй моляр, Edgewise неконвертируемые, 0,018 дюймов (0,46 мм), верхняя челюсть, право - не более 1000 шт.
 - Щечные трубки для приклеивания Nepto на второй моляр, Edgewise неконвертируемые, 0,018 дюймов (0,46 мм), верхняя челюсть, лево - не более 1000 шт.
 - Щечные трубки для приклеивания Nepto на второй моляр, Edgewise неконвертируемые, 0,018 дюймов (0,46 мм), нижняя челюсть, лево - не более 1000 шт.
 - Щечные трубки для приклеивания Nepto на второй моляр, Edgewise неконвертируемые, 0,018 дюймов (0,46 мм), нижняя челюсть, право - не более 1000 шт.
 - Щечные трубки для приклеивания Nepto на второй моляр, Edgewise неконвертируемые, 0,022 дюйма (0,56 мм), верхняя челюсть, право - не более 1000 шт.
 - Щечные трубки для приклеивания Nepto на второй моляр, Edgewise неконвертируемые, 0,022 дюйма (0,56 мм), верхняя челюсть, лево - не более 1000 шт.
 - Щечные трубки для приклеивания Nepto на второй моляр, Edgewise неконвертируемые, 0,022 дюйма (0,56 мм), нижняя челюсть, лево - не более 1000 шт.
 - Щечные трубки для приклеивания Nepto на второй моляр, Edgewise неконвертируемые, 0,022 дюйма (0,56 мм), нижняя челюсть, право - не более 1000 шт.
 - Щечные трубки для приклеивания Nepto на второй моляр, Roth неконвертируемые, 0,018 дюймов (0,46 мм), верхняя челюсть, право - не более 1000 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0113471

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 28 ноября 2022 года № РЗН 2022/18940

Лист 126

- Щечные трубки для приклеивания Nepto на второй моляр, Roth неконвертируемые, 0,018 дюймов (0,46 мм), верхняя челюсть, лево - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приклеивания Nepto на второй моляр, Roth неконвертируемые, 0,018 дюймов (0,46 мм), нижняя челюсть, лево - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приклеивания Nepto на второй моляр, Roth неконвертируемые, 0,018 дюймов (0,46 мм), нижняя челюсть, право - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приклеивания Nepto на второй моляр, Roth неконвертируемые, 0,022 дюйма (0,56 мм), верхняя челюсть, право - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приклеивания Nepto на второй моляр, Roth неконвертируемые, 0,022 дюйма (0,56 мм), верхняя челюсть, лево - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приклеивания Nepto на второй моляр, Roth неконвертируемые, 0,022 дюйма (0,56 мм), нижняя челюсть, лево - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приклеивания Nepto на второй моляр, Roth неконвертируемые, 0,022 дюйма (0,56 мм), нижняя челюсть, право - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приклеивания Nepto на второй моляр, McBeTr неконвертируемые, 0,018 дюймов (0,46 мм), верхняя челюсть, право - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приклеивания Nepto на второй моляр, McBeTr неконвертируемые двойные, 0,018 дюймов (0,46 мм), верхняя челюсть, право - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приклеивания Nepto на второй моляр, McBeTr неконвертируемые, 0,018 дюймов (0,46 мм), верхняя челюсть, лево - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приклеивания Nepto на второй моляр, McBeTr неконвертируемые двойные, 0,018 дюймов (0,46 мм), верхняя челюсть, лево - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приклеивания Nepto на второй моляр, McBeTr неконвертируемые, 0,018 дюймов (0,46 мм), нижняя челюсть, лево - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приклеивания Nepto на второй моляр, McBeTr неконвертируемые, 0,018 дюймов (0,46 мм), нижняя челюсть, право - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приклеивания Nepto на второй моляр, McBeTr неконвертируемые, 0,022 дюйма (0,56 мм), верхняя челюсть, право - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приклеивания Nepto на второй моляр, McBeTr неконвертируемые двойные, 0,022 дюйма (0,56 мм), верхняя челюсть, право - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приклеивания Nepto на второй моляр, McBeTr неконвертируемые, 0,022 дюйма (0,56 мм), верхняя челюсть, лево - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приклеивания Nepto на второй моляр, McBeTr неконвертируемые двойные, 0,022 дюйма (0,56 мм), верхняя челюсть, лево - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приклеивания Nepto на второй моляр, McBeTr неконвертируемые, 0,022 дюйма (0,56 мм), нижняя челюсть, лево - не более 1000 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0113472

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 28 ноября 2022 года № РЗН 2022/18940

Лист 127

- неконвертируемые, 0,022 дюйма (0,56 мм), нижняя челюсть, лево - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приклеивания Nepto на второй моляр, McBeTr неконвертируемые, 0,022 дюйма (0,56 мм), нижняя челюсть, право - не более 1000 шт.
 - Щечные трубки для приклеивания Nepto на первый моляр, Edgewise конвертируемые, 0,018 дюймов (0,46 мм), верхняя челюсть, право - не более 1000 шт.
 - Щечные трубки для приклеивания Nepto на первый моляр, Edgewise конвертируемые, 0,018 дюймов (0,46 мм), верхняя челюсть, лево - не более 1000 шт.
 - Щечные трубки для приклеивания Nepto на первый моляр, Edgewise конвертируемые, 0,018 дюймов (0,46 мм), нижняя челюсть, лево - не более 1000 шт.
 - Щечные трубки для приклеивания Nepto на первый моляр, Edgewise конвертируемые, 0,018 дюймов (0,46 мм), нижняя челюсть, право - не более 1000 шт.
 - Щечные трубки для приклеивания Nepto на первый моляр, Edgewise конвертируемые, 0,022 дюйма (0,56 мм), верхняя челюсть, право - не более 1000 шт.
 - Щечные трубки для приклеивания Nepto на первый моляр, Edgewise конвертируемые, 0,022 дюйма (0,56 мм), верхняя челюсть, лево - не более 1000 шт.
 - Щечные трубки для приклеивания Nepto на первый моляр, Edgewise конвертируемые, 0,022 дюйма (0,56 мм), нижняя челюсть, лево - не более 1000 шт.
 - Щечные трубки для приклеивания Nepto на первый моляр, Edgewise конвертируемые, 0,022 дюйма (0,56 мм), нижняя челюсть, право - не более 1000 шт.
 - Щечные трубки для приклеивания Nepto на первый моляр, Roth конвертируемые, 0,018 дюймов (0,46 мм), верхняя челюсть, право - не более 1000 шт.
 - Щечные трубки для приклеивания Nepto на первый моляр, Roth конвертируемые двойные, 0,018 дюймов (0,46 мм), верхняя челюсть, право - не более 1000 шт.
 - Щечные трубки для приклеивания Nepto на первый моляр, Roth конвертируемые тройные, 0,018 дюймов (0,46 мм), верхняя челюсть, право - не более 1000 шт.
 - Щечные трубки для приклеивания Nepto на первый моляр, Roth конвертируемые, 0,018 дюймов (0,46 мм), верхняя челюсть, лево - не более 1000 шт.
 - Щечные трубки для приклеивания Nepto на первый моляр, Roth конвертируемые двойные, 0,018 дюймов (0,46 мм), верхняя челюсть, лево - не более 1000 шт.
 - Щечные трубки для приклеивания Nepto на первый моляр, Roth конвертируемые тройные, 0,018 дюймов (0,46 мм), верхняя челюсть, лево - не более 1000 шт.
 - Щечные трубки для приклеивания Nepto на первый моляр, Roth конвертируемые, 0,018 дюймов (0,46 мм), нижняя челюсть, лево - не более 1000 шт.
 - Щечные трубки для приклеивания Nepto на первый моляр, Roth конвертируемые двойные, 0,018 дюймов (0,46 мм), нижняя челюсть, лево - не более 1000 шт.
 - Щечные трубки для приклеивания Nepto на первый моляр, Roth конвертируемые, 0,018 дюймов (0,46 мм), нижняя челюсть, право - не более 1000 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0113473

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 28 ноября 2022 года № РЗН 2022/18940

Лист 128

- 0,018 дюймов (0,46 мм), нижняя челюсть, право - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приклеивания Nepto на первый моляр, Roth конвертируемые двойные, 0,018 дюймов (0,46 мм), нижняя челюсть, право - не более 1000 шт.
 - Щечные трубки для приклеивания Nepto на первый моляр, Roth конвертируемые, 0,022 дюйма (0,56 мм), верхняя челюсть, право - не более 1000 шт.
 - Щечные трубки для приклеивания Nepto на первый моляр, Roth конвертируемые двойные, 0,022 дюйма (0,56 мм), верхняя челюсть, право - не более 1000 шт.
 - Щечные трубки для приклеивания Nepto на первый моляр, Roth конвертируемые тройные, 0,022 дюйма (0,56 мм), верхняя челюсть, право - не более 1000 шт.
 - Щечные трубки для приклеивания Nepto на первый моляр, Roth конвертируемые, 0,022 дюйма (0,56 мм), верхняя челюсть, лево - не более 1000 шт.
 - Щечные трубки для приклеивания Nepto на первый моляр, Roth конвертируемые двойные, 0,022 дюйма (0,56 мм), верхняя челюсть, лево - не более 1000 шт.
 - Щечные трубки для приклеивания Nepto на первый моляр, Roth конвертируемые тройные, 0,022 дюйма (0,56 мм), верхняя челюсть, лево - не более 1000 шт.
 - Щечные трубки для приклеивания Nepto на первый моляр, Roth конвертируемые, 0,022 дюйма (0,56 мм), нижняя челюсть, лево - не более 1000 шт.
 - Щечные трубки для приклеивания Nepto на первый моляр, Roth конвертируемые двойные, 0,022 дюйма (0,56 мм), нижняя челюсть, лево - не более 1000 шт.
 - Щечные трубки для приклеивания Nepto на первый моляр, Roth конвертируемые, 0,022 дюйма (0,56 мм), нижняя челюсть, право - не более 1000 шт.
 - Щечные трубки для приклеивания Nepto на первый моляр, Roth конвертируемые двойные, 0,022 дюйма (0,56 мм), нижняя челюсть, право - не более 1000 шт.
 - Щечные трубки для приклеивания Nepto на первый моляр, McBeTr конвертируемые, 0,018 дюймов (0,46 мм), верхняя челюсть, право - не более 1000 шт.
 - Щечные трубки для приклеивания Nepto на первый моляр, McBeTr конвертируемые двойные, 0,018 дюймов (0,46 мм), верхняя челюсть, право - не более 1000 шт.
 - Щечные трубки для приклеивания Nepto на первый моляр, McBeTr конвертируемые тройные, 0,018 дюймов (0,46 мм), верхняя челюсть, право - не более 1000 шт.
 - Щечные трубки для приклеивания Nepto на первый моляр, McBeTr конвертируемые, 0,018 дюймов (0,46 мм), верхняя челюсть, лево - не более 1000 шт.
 - Щечные трубки для приклеивания Nepto на первый моляр, McBeTr конвертируемые двойные, 0,018 дюймов (0,46 мм), верхняя челюсть, лево - не более 1000 шт.
 - Щечные трубки для приклеивания Nepto на первый моляр, McBeTr конвертируемые тройные, 0,018 дюймов (0,46 мм), верхняя челюсть, лево - не более 1000 шт.
 - Щечные трубки для приклеивания Nepto на первый моляр, McBeTr конвертируемые, 0,018 дюймов (0,46 мм), верхняя челюсть, лево - не более 1000 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0113474

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 28 ноября 2022 года № РЗН 2022/18940

Лист 129

- 0,018 дюймов (0,46 мм), нижняя челюсть, лево - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приклеивания Nepto на первый моляр, McBeTr конвертируемые двойные, 0,018 дюймов (0,46 мм), нижняя челюсть, лево - не более 1000 шт.
 - Щечные трубки для приклеивания Nepto на первый моляр, McBeTr конвертируемые, 0,018 дюймов (0,46 мм), нижняя челюсть, право - не более 1000 шт.
 - Щечные трубки для приклеивания Nepto на первый моляр, McBeTr конвертируемые двойные, 0,018 дюймов (0,46 мм), нижняя челюсть, право - не более 1000 шт.
 - Щечные трубки для приклеивания Nepto на первый моляр, McBeTr конвертируемые, 0,022 дюйма (0,56 мм), верхняя челюсть, право - не более 1000 шт.
 - Щечные трубки для приклеивания Nepto на первый моляр, McBeTr конвертируемые двойные, 0,022 дюйма (0,56 мм), верхняя челюсть, право - не более 1000 шт.
 - Щечные трубки для приклеивания Nepto на первый моляр, McBeTr конвертируемые тройные, 0,022 дюйма (0,56 мм), верхняя челюсть, право - не более 1000 шт.
 - Щечные трубки для приклеивания Nepto на первый моляр, McBeTr конвертируемые, 0,022 дюйма (0,56 мм), верхняя челюсть, лево - не более 1000 шт.
 - Щечные трубки для приклеивания Nepto на первый моляр, McBeTr конвертируемые двойные, 0,022 дюйма (0,56 мм), верхняя челюсть, лево - не более 1000 шт.
 - Щечные трубки для приклеивания Nepto на первый моляр, McBeTr конвертируемые тройные, 0,022 дюйма (0,56 мм), верхняя челюсть, лево - не более 1000 шт.
 - Щечные трубки для приклеивания Nepto на первый моляр, McBeTr конвертируемые, 0,022 дюйма (0,56 мм), нижняя челюсть, лево - не более 1000 шт.
 - Щечные трубки для приклеивания Nepto на первый моляр, McBeTr конвертируемые двойные, 0,022 дюйма (0,56 мм), нижняя челюсть, лево - не более 1000 шт.
 - Щечные трубки для приклеивания Nepto на первый моляр, McBeTr конвертируемые, 0,022 дюйма (0,56 мм), нижняя челюсть, право - не более 1000 шт.
 - Щечные трубки для приклеивания Nepto на первый моляр, McBeTr конвертируемые двойные, 0,022 дюйма (0,56 мм), нижняя челюсть, право - не более 1000 шт.
2. Щечные трубки для приваривания Nepto, в вариантах исполнения:
- Щечные трубки для приваривания Nepto на первый моляр, Edgewise неконвертируемые, 0,018 дюймов (0,46 мм), верхняя челюсть, право - не более 1000 шт.
 - Щечные трубки для приваривания Nepto на первый моляр, Edgewise неконвертируемые, 0,018 дюймов (0,46 мм), верхняя челюсть, лево - не более 1000 шт.
 - Щечные трубки для приваривания Nepto на первый моляр, Edgewise неконвертируемые, 0,018 дюймов (0,46 мм), нижняя челюсть, лево - не более 1000 шт.
 - Щечные трубки для приваривания Nepto на первый моляр, Edgewise неконвертируемые, 0,018 дюймов (0,46 мм), нижняя челюсть, право - не более 1000 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0113475

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 28 ноября 2022 года № РЗН 2022/18940

Лист 130

- неконвертируемые, 0,018 дюймов (0,46 мм), нижняя челюсть, право - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приваривания Nepto на первый моляр, Edgewise неконвертируемые, 0,022 дюйма (0,56 мм), верхняя челюсть, право - не более 1000 шт.
 - Щечные трубки для приваривания Nepto на первый моляр, Edgewise неконвертируемые, 0,022 дюйма (0,56 мм), верхняя челюсть, лево - не более 1000 шт.
 - Щечные трубки для приваривания Nepto на первый моляр, Edgewise неконвертируемые, 0,022 дюйма (0,56 мм), нижняя челюсть, лево - не более 1000 шт.
 - Щечные трубки для приваривания Nepto на первый моляр, Edgewise неконвертируемые, 0,022 дюйма (0,56 мм), нижняя челюсть, право - не более 1000 шт.
 - Щечные трубки для приваривания Nepto на первый моляр, Roth неконвертируемые, 0,018 дюймов (0,46 мм), верхняя челюсть, право - не более 1000 шт.
 - Щечные трубки для приваривания Nepto на первый моляр, Roth неконвертируемые двойные, 0,018 дюймов (0,46 мм), верхняя челюсть, право - не более 1000 шт.
 - Щечные трубки для приваривания Nepto на первый моляр, Roth неконвертируемые тройные, 0,018 дюймов (0,46 мм), верхняя челюсть, право - не более 1000 шт.
 - Щечные трубки для приваривания Nepto на первый моляр, Roth неконвертируемые, 0,018 дюймов (0,46 мм), верхняя челюсть, лево - не более 1000 шт.
 - Щечные трубки для приваривания Nepto на первый моляр, Roth неконвертируемые двойные, 0,018 дюймов (0,46 мм), верхняя челюсть, лево - не более 1000 шт.
 - Щечные трубки для приваривания Nepto на первый моляр, Roth неконвертируемые тройные, 0,018 дюймов (0,46 мм), верхняя челюсть, лево - не более 1000 шт.
 - Щечные трубки для приваривания Nepto на первый моляр, Roth неконвертируемые, 0,018 дюймов (0,46 мм), нижняя челюсть, лево - не более 1000 шт.
 - Щечные трубки для приваривания Nepto на первый моляр, Roth неконвертируемые двойные, 0,018 дюймов (0,46 мм), нижняя челюсть, лево - не более 1000 шт.
 - Щечные трубки для приваривания Nepto на первый моляр, Roth неконвертируемые, 0,018 дюймов (0,46 мм), нижняя челюсть, право - не более 1000 шт.
 - Щечные трубки для приваривания Nepto на первый моляр, Roth неконвертируемые двойные, 0,018 дюймов (0,46 мм), нижняя челюсть, право - не более 1000 шт.
 - Щечные трубки для приваривания Nepto на первый моляр, Roth неконвертируемые, 0,022 дюйма (0,56 мм), верхняя челюсть, право - не более 1000 шт.
 - Щечные трубки для приваривания Nepto на первый моляр, Roth неконвертируемые двойные, 0,022 дюйма (0,56 мм), верхняя челюсть, право - не более 1000 шт.
 - Щечные трубки для приваривания Nepto на первый моляр, Roth неконвертируемые тройные, 0,022 дюйма (0,56 мм), верхняя челюсть, право - не более 1000 шт.
 - Щечные трубки для приваривания Nepto на первый моляр, Roth неконвертируемые,

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0113476

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 28 ноября 2022 года № РЗН 2022/18940

Лист 131

- 0,022 дюйма (0,56 мм), верхняя челюсть, лево - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приваривания Nepto на первый моляр, Roth неконвертируемые двойные, 0,022 дюйма (0,56 мм), верхняя челюсть, лево - не более 1000 шт.
 - Щечные трубки для приваривания Nepto на первый моляр, Roth неконвертируемые тройные, 0,022 дюйма (0,56 мм), верхняя челюсть, лево - не более 1000 шт.
 - Щечные трубки для приваривания Nepto на первый моляр, Roth неконвертируемые, 0,022 дюйма (0,56 мм), нижняя челюсть, лево - не более 1000 шт.
 - Щечные трубки для приваривания Nepto на первый моляр, Roth неконвертируемые двойные, 0,022 дюйма (0,56 мм), нижняя челюсть, лево - не более 1000 шт.
 - Щечные трубки для приваривания Nepto на первый моляр, Roth неконвертируемые, 0,022 дюйма (0,56 мм), нижняя челюсть, право - не более 1000 шт.
 - Щечные трубки для приваривания Nepto на первый моляр, Roth неконвертируемые двойные, 0,022 дюйма (0,56 мм), нижняя челюсть, право - не более 1000 шт.
 - Щечные трубки для приваривания Nepto на первый моляр, McBeTr неконвертируемые, 0,018 дюймов (0,46 мм), верхняя челюсть, право - не более 1000 шт.
 - Щечные трубки для приваривания Nepto на первый моляр, McBeTr неконвертируемые двойные, 0,018 дюймов (0,46 мм), верхняя челюсть, право - не более 1000 шт.
 - Щечные трубки для приваривания Nepto на первый моляр, McBeTr неконвертируемые тройные, 0,018 дюймов (0,46 мм), верхняя челюсть, право - не более 1000 шт.
 - Щечные трубки для приваривания Nepto на первый моляр, McBeTr неконвертируемые, 0,018 дюймов (0,46 мм), верхняя челюсть, лево - не более 1000 шт.
 - Щечные трубки для приваривания Nepto на первый моляр, McBeTr неконвертируемые двойные, 0,018 дюймов (0,46 мм), верхняя челюсть, лево - не более 1000 шт.
 - Щечные трубки для приваривания Nepto на первый моляр, McBeTr неконвертируемые тройные, 0,018 дюймов (0,46 мм), верхняя челюсть, лево - не более 1000 шт.
 - Щечные трубки для приваривания Nepto на первый моляр, McBeTr неконвертируемые, 0,018 дюймов (0,46 мм), нижняя челюсть, лево - не более 1000 шт.
 - Щечные трубки для приваривания Nepto на первый моляр, McBeTr неконвертируемые двойные, 0,018 дюймов (0,46 мм), нижняя челюсть, лево - не более 1000 шт.
 - Щечные трубки для приваривания Nepto на первый моляр, McBeTr

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0113477

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 28 ноября 2022 года

№ РЗН 2022/18940

Лист 132

- неконвертируемые, 0,018 дюймов (0,46 мм), нижняя челюсть, право - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приваривания Nepto на первый моляр, McBeTr неконвертируемые двойные, 0,018 дюймов (0,46 мм), нижняя челюсть, право - не более 1000 шт.
 - Щечные трубки для приваривания Nepto на первый моляр, McBeTr неконвертируемые, 0,022 дюйма (0,56 мм), верхняя челюсть, право - не более 1000 шт.
 - Щечные трубки для приваривания Nepto на первый моляр, McBeTr неконвертируемые двойные, 0,022 дюйма (0,56 мм), верхняя челюсть, право - не более 1000 шт.
 - Щечные трубки для приваривания Nepto на первый моляр, McBeTr неконвертируемые тройные, 0,022 дюйма (0,56 мм), верхняя челюсть, право - не более 1000 шт.
 - Щечные трубки для приваривания Nepto на первый моляр, McBeTr неконвертируемые, 0,022 дюйма (0,56 мм), верхняя челюсть, лево - не более 1000 шт.
 - Щечные трубки для приваривания Nepto на первый моляр, McBeTr неконвертируемые двойные, 0,022 дюйма (0,56 мм), верхняя челюсть, лево - не более 1000 шт.
 - Щечные трубки для приваривания Nepto на первый моляр, McBeTr неконвертируемые тройные, 0,022 дюйма (0,56 мм), верхняя челюсть, лево - не более 1000 шт.
 - Щечные трубки для приваривания Nepto на первый моляр, McBeTr неконвертируемые, 0,022 дюйма (0,56 мм), нижняя челюсть, лево - не более 1000 шт.
 - Щечные трубки для приваривания Nepto на первый моляр, McBeTr неконвертируемые двойные, 0,022 дюйма (0,56 мм), нижняя челюсть, лево - не более 1000 шт.
 - Щечные трубки для приваривания Nepto на первый моляр, McBeTr неконвертируемые, 0,022 дюйма (0,56 мм), нижняя челюсть, право - не более 1000 шт.
 - Щечные трубки для приваривания Nepto на первый моляр, McBeTr неконвертируемые двойные, 0,022 дюйма (0,56 мм), нижняя челюсть, право - не более 1000 шт.
 - Щечные трубки для приваривания Nepto на второй моляр, Edgewise неконвертируемые, 0,018 дюймов (0,46 мм), верхняя челюсть, право - не более 1000 шт.
 - Щечные трубки для приваривания Nepto на второй моляр, Edgewise неконвертируемые, 0,018 дюймов (0,46 мм), верхняя челюсть, лево - не более 1000 шт.
 - Щечные трубки для приваривания Nepto на второй моляр, Edgewise

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0113478

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 28 ноября 2022 года № РЗН 2022/18940

Лист 133

- неконвертируемые, 0,018 дюймов (0,46 мм), нижняя челюсть, лево - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приваривания Nepto на второй моляр, Edgewise неконвертируемые, 0,018 дюймов (0,46 мм), нижняя челюсть, право - не более 1000 шт.
 - Щечные трубки для приваривания Nepto на второй моляр, Edgewise неконвертируемые, 0,022 дюйма (0,56 мм), верхняя челюсть, право - не более 1000 шт.
 - Щечные трубки для приваривания Nepto на второй моляр, Edgewise неконвертируемые, 0,022 дюйма (0,56 мм), верхняя челюсть, лево - не более 1000 шт.
 - Щечные трубки для приваривания Nepto на второй моляр, Edgewise неконвертируемые, 0,022 дюйма (0,56 мм), нижняя челюсть, лево - не более 1000 шт.
 - Щечные трубки для приваривания Nepto на второй моляр, Edgewise неконвертируемые, 0,022 дюйма (0,56 мм), нижняя челюсть, право - не более 1000 шт.
 - Щечные трубки для приваривания Nepto на второй моляр, Roth неконвертируемые, 0,018 дюймов (0,46 мм), верхняя челюсть, право - не более 1000 шт.
 - Щечные трубки для приваривания Nepto на второй моляр, Roth неконвертируемые, 0,018 дюймов (0,46 мм), верхняя челюсть, лево - не более 1000 шт.
 - Щечные трубки для приваривания Nepto на второй моляр, Roth неконвертируемые, 0,018 дюймов (0,46 мм), нижняя челюсть, лево - не более 1000 шт.
 - Щечные трубки для приваривания Nepto на второй моляр, Roth неконвертируемые, 0,018 дюймов (0,46 мм), нижняя челюсть, право - не более 1000 шт.
 - Щечные трубки для приваривания Nepto на второй моляр, Roth неконвертируемые, 0,022 дюйма (0,56 мм), верхняя челюсть, право - не более 1000 шт.
 - Щечные трубки для приваривания Nepto на второй моляр, Roth неконвертируемые, 0,022 дюйма (0,56 мм), верхняя челюсть, лево - не более 1000 шт.
 - Щечные трубки для приваривания Nepto на второй моляр, Roth неконвертируемые, 0,022 дюйма (0,56 мм), нижняя челюсть, лево - не более 1000 шт.
 - Щечные трубки для приваривания Nepto на второй моляр, Roth неконвертируемые, 0,022 дюйма (0,56 мм), нижняя челюсть, право - не более 1000 шт.
 - Щечные трубки для приваривания Nepto на второй моляр, McBeTr неконвертируемые, 0,018 дюймов (0,46 мм), верхняя челюсть, право - не более 1000 шт.
 - Щечные трубки для приваривания Nepto на второй моляр, McBeTr неконвертируемые двойные, 0,018 дюймов (0,46 мм), верхняя челюсть, право - не более 1000 шт.
 - Щечные трубки для приваривания Nepto на второй моляр, McBeTr неконвертируемые, 0,018 дюймов (0,46 мм), верхняя челюсть, лево - не более 1000 шт.
 - Щечные трубки для приваривания Nepto на второй моляр, McBeTr неконвертируемые двойные, 0,018 дюймов (0,46 мм), верхняя челюсть, лево - не более 1000 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0113479

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 28 ноября 2022 года

№ РЗН 2022/18940

Лист 134

- Щечные трубки для приваривания Nepto на второй моляр, McBeTr неконвертируемые, 0,018 дюймов (0,46 мм), нижняя челюсть, лево - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приваривания Nepto на второй моляр, McBeTr неконвертируемые, 0,018 дюймов (0,46 мм), нижняя челюсть, право - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приваривания Nepto на второй моляр, McBeTr неконвертируемые, 0,022 дюйма (0,56 мм), верхняя челюсть, право - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приваривания Nepto на второй моляр, McBeTr неконвертируемые двойные, 0,022 дюйма (0,56 мм), верхняя челюсть, право - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приваривания Nepto на второй моляр, McBeTr неконвертируемые, 0,022 дюйма (0,56 мм), верхняя челюсть, лево - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приваривания Nepto на второй моляр, McBeTr неконвертируемые двойные, 0,022 дюйма (0,56 мм), верхняя челюсть, лево - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приваривания Nepto на второй моляр, McBeTr неконвертируемые, 0,022 дюйма (0,56 мм), нижняя челюсть, лево - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приваривания Nepto на второй моляр, McBeTr неконвертируемые, 0,022 дюйма (0,56 мм), нижняя челюсть, право - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приваривания Nepto на первый моляр, Edgewise конвертируемые, 0,018 дюймов (0,46 мм), верхняя челюсть, право - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приваривания Nepto на первый моляр, Edgewise конвертируемые, 0,018 дюймов (0,46 мм), верхняя челюсть, лево - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приваривания Nepto на первый моляр, Edgewise конвертируемые, 0,018 дюймов (0,46 мм), нижняя челюсть, лево - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приваривания Nepto на первый моляр, Edgewise конвертируемые, 0,018 дюймов (0,46 мм), нижняя челюсть, право - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приваривания Nepto на первый моляр, Edgewise конвертируемые, 0,022 дюйма (0,56 мм), верхняя челюсть, право - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приваривания Nepto на первый моляр, Edgewise конвертируемые, 0,022 дюйма (0,56 мм), верхняя челюсть, лево - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приваривания Nepto на первый моляр, Edgewise конвертируемые, 0,022 дюйма (0,56 мм), нижняя челюсть, лево - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приваривания Nepto на первый моляр, Edgewise конвертируемые, 0,022 дюйма (0,56 мм), нижняя челюсть, право - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приваривания Nepto на первый моляр, Roth конвертируемые, 0,018 дюймов (0,46 мм), верхняя челюсть, право - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приваривания Nepto на первый моляр, Roth конвертируемые двойные, 0,018 дюймов (0,46 мм), верхняя челюсть, право - не более 1000 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0113480

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 28 ноября 2022 года

№ РЗН 2022/18940

Лист 135

- Щечные трубки для приваривания Nepto на первый моляр, Roth конвертируемые тройные, 0,018 дюймов (0,46 мм), верхняя челюсть, право - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приваривания Nepto на первый моляр, Roth конвертируемые, 0,018 дюймов (0,46 мм), верхняя челюсть, лево - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приваривания Nepto на первый моляр, Roth конвертируемые двойные, 0,018 дюймов (0,46 мм), верхняя челюсть, лево - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приваривания Nepto на первый моляр, Roth конвертируемые тройные, 0,018 дюймов (0,46 мм), верхняя челюсть, лево - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приваривания Nepto на первый моляр, Roth конвертируемые, 0,018 дюймов (0,46 мм), нижняя челюсть, лево - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приваривания Nepto на первый моляр, Roth конвертируемые двойные, 0,018 дюймов (0,46 мм), нижняя челюсть, лево - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приваривания Nepto на первый моляр, Roth конвертируемые, 0,018 дюймов (0,46 мм), нижняя челюсть, право - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приваривания Nepto на первый моляр, Roth конвертируемые двойные, 0,018 дюймов (0,46 мм), нижняя челюсть, право - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приваривания Nepto на первый моляр, Roth конвертируемые, 0,022 дюйма (0,56 мм), верхняя челюсть, право - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приваривания Nepto на первый моляр, Roth конвертируемые двойные, 0,022 дюйма (0,56 мм), верхняя челюсть, право - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приваривания Nepto на первый моляр, Roth конвертируемые тройные, 0,022 дюйма (0,56 мм), верхняя челюсть, право - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приваривания Nepto на первый моляр, Roth конвертируемая, 0,022 дюйма (0,56 мм), верхняя челюсть, лево - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приваривания Nepto на первый моляр, Roth конвертируемые двойные, 0,022 дюйма (0,56 мм), верхняя челюсть, лево - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приваривания Nepto на первый моляр, Roth конвертируемые тройные, 0,022 дюйма (0,56 мм), верхняя челюсть, лево - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приваривания Nepto на первый моляр, Roth конвертируемая, 0,022 дюйма (0,56 мм), нижняя челюсть, лево - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приваривания Nepto на первый моляр, Roth конвертируемые двойные, 0,022 дюйма (0,56 мм), нижняя челюсть, лево - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приваривания Nepto на первый моляр, Roth конвертируемые, 0,022 дюйма (0,56 мм), нижняя челюсть, право - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приваривания Nepto на первый моляр, Roth конвертируемые двойные, 0,022 дюйма (0,56 мм), нижняя челюсть, право - не более 1000 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0113481

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 28 ноября 2022 года № РЗН 2022/18940

Лист 136

- Щечные трубки для приваривания Nepto на первый моляр, McBeTg конвертируемые, 0,018 дюймов (0,46 мм), верхняя челюсть, право - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приваривания Nepto на первый моляр, McBeTg конвертируемые двойные, 0,018 дюймов (0,46 мм), верхняя челюсть, право - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приваривания Nepto на первый моляр, McBeTg конвертируемые тройные, 0,018 дюймов (0,46 мм), верхняя челюсть, право - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приваривания Nepto на первый моляр, McBeTg конвертируемые, 0,018 дюймов (0,46 мм), верхняя челюсть, лево - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приваривания Nepto на первый моляр, McBeTg конвертируемые двойные, 0,018 дюймов (0,46 мм), верхняя челюсть, лево - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приваривания Nepto на первый моляр, McBeTg конвертируемые тройные, 0,018 дюймов (0,46 мм), верхняя челюсть, лево - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приваривания Nepto на первый моляр, McBeTg конвертируемые, 0,018 дюймов (0,46 мм), нижняя челюсть, лево - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приваривания Nepto на первый моляр, McBeTg конвертируемые двойные, 0,018 дюймов (0,46 мм), нижняя челюсть, лево - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приваривания Nepto на первый моляр, McBeTg конвертируемые, 0,018 дюймов (0,46 мм), нижняя челюсть, право - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приваривания Nepto на первый моляр, McBeTg конвертируемые двойные, 0,018 дюймов (0,46 мм), нижняя челюсть, право - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приваривания Nepto на первый моляр, McBeTg конвертируемые, 0,022 дюйма (0,56 мм), верхняя челюсть, право - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приваривания Nepto на первый моляр, McBeTg конвертируемые двойные, 0,022 дюйма (0,56 мм), верхняя челюсть, право - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приваривания Nepto на первый моляр, McBeTg конвертируемые тройные, 0,022 дюйма (0,56 мм), верхняя челюсть, право - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приваривания Nepto на первый моляр, McBeTg конвертируемые, 0,022 дюйма (0,56 мм), верхняя челюсть, лево - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приваривания Nepto на первый моляр, McBeTg конвертируемые двойные, 0,022 дюйма (0,56 мм), верхняя челюсть, лево - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приваривания Nepto на первый моляр, McBeTg конвертируемые тройные, 0,022 дюйма (0,56 мм), верхняя челюсть, лево - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приваривания Nepto на первый моляр, McBeTg конвертируемые, 0,022 дюйма (0,56 мм), нижняя челюсть, лево - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приваривания Nepto на первый моляр, McBeTg конвертируемые двойные, 0,022 дюйма (0,56 мм), нижняя челюсть, лево - не более 1000 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0113482

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 28 ноября 2022 года № РЗН 2022/18940

Лист 137

- Щечные трубки для приваривания Nepto на первый моляр, McBeTr конвертируемые, 0,022 дюйма (0,56 мм), нижняя челюсть, право - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приваривания Nepto на первый моляр, McBeTr конвертируемые двойные, 0,022 дюйма (0,56 мм), нижняя челюсть, право - не более 1000 шт.
- 3. Щечные трубки для приклеивания Pluto, в вариантах исполнения:
- Щечные трубки для приклеивания Pluto на первый моляр, Edgewise неконвертируемые, 0,018 дюймов (0,46 мм), верхняя челюсть, право - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приклеивания Pluto на первый моляр, Edgewise неконвертируемые, 0,018 дюймов (0,46 мм), верхняя челюсть, лево - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приклеивания Pluto на первый моляр, Edgewise неконвертируемые, 0,018 дюймов (0,46 мм), нижняя челюсть, лево - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приклеивания Pluto на первый моляр, Edgewise неконвертируемые, 0,018 дюймов (0,46 мм), нижняя челюсть, право - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приклеивания Pluto на первый моляр, Edgewise неконвертируемые, 0,022 дюйма (0,56 мм), верхняя челюсть, право - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приклеивания Pluto на первый моляр, Edgewise неконвертируемые, 0,022 дюйма (0,56 мм), верхняя челюсть, лево - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приклеивания Pluto на первый моляр, Edgewise неконвертируемые, 0,022 дюйма (0,56 мм), нижняя челюсть, лево - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приклеивания Pluto на первый моляр, Edgewise неконвертируемые, 0,022 дюйма (0,56 мм), нижняя челюсть, право - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приклеивания Pluto на первый моляр, Roth неконвертируемые, 0,018 дюймов (0,46 мм), верхняя челюсть, право - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приклеивания Pluto Plus на первый моляр, Roth неконвертируемые, 0,018 дюймов (0,46 мм), верхняя челюсть, право - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приклеивания Pluto на первый моляр, Roth неконвертируемые двойные комбинированные, 0,018 дюймов (0,46 мм), верхняя челюсть, право - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приклеивания Pluto на первый моляр, Roth неконвертируемые тройные, 0,018 дюймов (0,46 мм), верхняя челюсть, право - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приклеивания Pluto на первый моляр, Roth неконвертируемые, 0,018 дюймов (0,46 мм), верхняя челюсть, лево - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приклеивания Pluto Plus на первый моляр, Roth неконвертируемые, 0,018 дюймов (0,46 мм), верхняя челюсть, лево - не более 1000 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0113483

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 28 ноября 2022 года № РЗН 2022/18940

Лист 138

- Щечные трубки для приклеивания Pluto на первый моляр, Roth неконвертируемые двойные комбинированные, 0,018 дюймов (0,46 мм), верхняя челюсть, лево - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приклеивания Pluto на первый моляр, Roth неконвертируемые тройные, 0,018 дюймов (0,46 мм), верхняя челюсть, лево - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приклеивания Pluto на первый моляр, Roth неконвертируемые, 0,018 дюймов (0,46 мм), нижняя челюсть, лево - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приклеивания Pluto Plus на первый моляр, Roth неконвертируемые, 0,018 дюймов (0,46 мм), нижняя челюсть, лево - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приклеивания Pluto на первый моляр, Roth неконвертируемые двойные, 0,018 дюймов (0,46 мм), нижняя челюсть, лево - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приклеивания Pluto на первый моляр, Roth неконвертируемые, 0,018 дюймов (0,46 мм), нижняя челюсть, право - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приклеивания Pluto Plus на первый моляр, Roth неконвертируемые, 0,018 дюймов (0,46 мм), нижняя челюсть, право - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приклеивания Pluto на первый моляр, Roth неконвертируемые двойные, 0,018 дюймов (0,46 мм), нижняя челюсть, право - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приклеивания Pluto на первый моляр, Roth неконвертируемые, 0,022 дюйма (0,56 мм), верхняя челюсть, право - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приклеивания Pluto Plus на первый моляр, Roth неконвертируемые, 0,022 дюйма (0,56 мм), верхняя челюсть, право - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приклеивания Pluto на первый моляр, Roth неконвертируемые двойные комбинированные, 0,022 дюйма (0,56 мм), верхняя челюсть, право - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приклеивания Pluto на первый моляр, Roth неконвертируемые тройные, 0,022 дюйма (0,56 мм), верхняя челюсть, право - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приклеивания Pluto на первый моляр, Roth неконвертируемые, 0,022 дюйма (0,56 мм), верхняя челюсть, лево - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приклеивания Pluto Plus на первый моляр, Roth неконвертируемые, 0,022 дюйма (0,56 мм), верхняя челюсть, лево - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приклеивания Pluto на первый моляр, Roth неконвертируемые двойные комбинированные, 0,022 дюйма (0,56 мм), верхняя челюсть, лево - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приклеивания Pluto на первый моляр, Roth неконвертируемые тройные, 0,022 дюйма (0,56 мм), верхняя челюсть, лево - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приклеивания Pluto на первый моляр, Roth неконвертируемые,

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0113484

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 28 ноября 2022 года № РЗН 2022/18940

Лист 139

- 0,022 дюйма (0,56 мм), нижняя челюсть, лево - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приклеивания Pluto Plus на первый моляр, Roth неконвертируемые, 0,022 дюйма (0,56 мм), нижняя челюсть, лево - не более 1000 шт.
 - Щечные трубки для приклеивания Pluto на первый моляр, Roth неконвертируемые двойные, 0,022 дюйма (0,56 мм), нижняя челюсть, лево - не более 1000 шт.
 - Щечные трубки для приклеивания Pluto на первый моляр, Roth неконвертируемые, 0,022 дюйма (0,56 мм), нижняя челюсть, право - не более 1000 шт.
 - Щечные трубки для приклеивания Pluto Plus на первый моляр, Roth неконвертируемые, 0,022 дюйма (0,56 мм), нижняя челюсть, право - не более 1000 шт.
 - Щечные трубки для приклеивания Pluto на первый моляр, Roth неконвертируемые двойные, 0,022 дюйма (0,56 мм), нижняя челюсть, право - не более 1000 шт.
 - Щечные трубки для приклеивания Pluto на первый моляр, McBeTr неконвертируемые, 0,018 дюймов (0,46 мм), верхняя челюсть, право - не более 1000 шт.
 - Щечные трубки для приклеивания Pluto Plus на первый моляр, McBeTr неконвертируемые, 0,018 дюймов (0,46 мм), верхняя челюсть, право - не более 1000 шт.
 - Щечные трубки для приклеивания Pluto на первый моляр, McBeTr неконвертируемые двойные комбинированные, 0,018 дюймов (0,46 мм), верхняя челюсть, право - не более 1000 шт.
 - Щечные трубки для приклеивания Pluto на первый моляр, McBeTr неконвертируемые тройные, 0,018 дюймов (0,46 мм), верхняя челюсть, право - не более 1000 шт.
 - Щечные трубки для приклеивания Pluto на первый моляр, McBeTr неконвертируемые, 0,018 дюймов (0,46 мм), верхняя челюсть, лево - не более 1000 шт.
 - Щечные трубки для приклеивания Pluto Plus на первый моляр, McBeTr неконвертируемые, 0,018 дюймов (0,46 мм), верхняя челюсть, лево - не более 1000 шт.
 - Щечные трубки для приклеивания Pluto на первый моляр, McBeTr неконвертируемые двойные комбинированные, 0,018 дюймов (0,46 мм), верхняя челюсть, лево - не более 1000 шт.
 - Щечные трубки для приклеивания Pluto на первый моляр, McBeTr неконвертируемые тройные, 0,018 дюймов (0,46 мм), верхняя челюсть, лево - не более 1000 шт.
 - Щечные трубки для приклеивания Pluto на первый моляр, McBeTr неконвертируемые, 0,018 дюймов (0,46 мм), нижняя челюсть, лево - не более 1000 шт.
 - Щечные трубки для приклеивания Pluto Plus на первый моляр, McBeTr неконвертируемые, 0,018 дюймов (0,46 мм), нижняя челюсть, лево - не более 1000 шт.
 - Щечные трубки для приклеивания Pluto на первый моляр, McBeTr неконвертируемые

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0113485

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 28 ноября 2022 года № РЗН 2022/18940

Лист 140

- двойные, 0,018 дюймов (0,46 мм), нижняя челюсть, лево - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приклеивания Pluto на первый моляр, McBeTr неконвертируемые, 0,018 дюймов (0,46 мм), нижняя челюсть, право - не более 1000 шт.
 - Щечные трубки для приклеивания Pluto Plus на первый моляр, McBeTr неконвертируемые, 0,018 дюймов (0,46 мм), нижняя челюсть, право - не более 1000 шт.
 - Щечные трубки для приклеивания Pluto на первый моляр, McBeTr неконвертируемые двойные, 0,018 дюймов (0,46 мм), нижняя челюсть, право - не более 1000 шт.
 - Щечные трубки для приклеивания Pluto на первый моляр, McBeTr неконвертируемые, 0,022 дюйма (0,56 мм), верхняя челюсть, право - не более 1000 шт.
 - Щечные трубки для приклеивания Pluto Plus на первый моляр, McBeTr неконвертируемые, 0,022 дюйма (0,56 мм), верхняя челюсть, право - не более 1000 шт.
 - Щечные трубки для приклеивания Pluto на первый моляр, McBeTr неконвертируемые двойные комбинированные, 0,022 дюйма (0,56 мм), верхняя челюсть, право - не более 1000 шт.
 - Щечные трубки для приклеивания Pluto на первый моляр, McBeTr неконвертируемые тройные, 0,022 дюйма (0,56 мм), верхняя челюсть, право - не более 1000 шт.
 - Щечные трубки для приклеивания Pluto на первый моляр, McBeTr неконвертируемые, 0,022 дюйма (0,56 мм), верхняя челюсть, лево - не более 1000 шт.
 - Щечные трубки для приклеивания Pluto Plus на первый моляр, McBeTr неконвертируемые, 0,022 дюйма (0,56 мм), верхняя челюсть, лево - не более 1000 шт.
 - Щечные трубки для приклеивания Pluto на первый моляр, McBeTr неконвертируемые двойные комбинированные, 0,022 дюйма (0,56 мм), верхняя челюсть, лево - не более 1000 шт.
 - Щечные трубки для приклеивания Pluto на первый моляр, McBeTr неконвертируемые тройные, 0,022 дюйма (0,56 мм), верхняя челюсть, лево - не более 1000 шт.
 - Щечные трубки для приклеивания Pluto на первый моляр, McBeTr неконвертируемые, 0,022 дюйма (0,56 мм), нижняя челюсть, лево - не более 1000 шт.
 - Щечные трубки для приклеивания Pluto Plus на первый моляр, McBeTr неконвертируемые, 0,022 дюйма (0,56 мм), нижняя челюсть, лево - не более 1000 шт.
 - Щечные трубки для приклеивания Pluto на первый моляр, McBeTr неконвертируемые двойные, 0,022 дюйма (0,56 мм), нижняя челюсть, лево - не более 1000 шт.
 - Щечные трубки для приклеивания Pluto на первый моляр, McBeTr неконвертируемые, 0,022 дюйма (0,56 мм), нижняя челюсть, право - не более 1000 шт.
 - Щечные трубки для приклеивания Pluto Plus на первый моляр, McBeTr неконвертируемые, 0,022 дюйма (0,56 мм), нижняя челюсть, право - не более 1000 шт.
 - Щечные трубки для приклеивания Pluto на первый моляр, McBeTr неконвертируемые

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0113486

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 28 ноября 2022 года № РЗН 2022/18940

Лист 141

- двойные, 0,022 дюйма (0,56 мм), нижняя челюсть, право - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приклеивания Pluto на второй моляр, Edgewise неконвертируемые, 0,018 дюймов (0,46 мм), верхняя челюсть, право - не более 1000 шт.
 - Щечные трубки для приклеивания Pluto на второй моляр, Edgewise неконвертируемые, 0,018 дюймов (0,46 мм), верхняя челюсть, лево - не более 1000 шт.
 - Щечные трубки для приклеивания Pluto на второй моляр, Edgewise неконвертируемые, 0,018 дюймов (0,46 мм), нижняя челюсть, лево - не более 1000 шт.
 - Щечные трубки для приклеивания Pluto на второй моляр, Edgewise неконвертируемые, 0,018 дюймов (0,46 мм), нижняя челюсть, право - не более 1000 шт.
 - Щечные трубки для приклеивания Pluto на второй моляр, Edgewise неконвертируемые, 0,022 дюйма (0,56 мм), верхняя челюсть, право - не более 1000 шт.
 - Щечные трубки для приклеивания Pluto на второй моляр, Edgewise неконвертируемые, 0,022 дюйма (0,56 мм), верхняя челюсть, лево - не более 1000 шт.
 - Щечные трубки для приклеивания Pluto на второй моляр, Edgewise неконвертируемые, 0,022 дюйма (0,56 мм), нижняя челюсть, лево - не более 1000 шт.
 - Щечные трубки для приклеивания Pluto на второй моляр, Edgewise неконвертируемые, 0,022 дюйма (0,56 мм), нижняя челюсть, право - не более 1000 шт.
 - Щечные трубки для приклеивания Pluto на второй моляр, Roth неконвертируемые, 0,018 дюймов (0,46 мм), верхняя челюсть, право - не более 1000 шт.
 - Щечные трубки для приклеивания Pluto Plus на второй моляр, Roth неконвертируемые, 0,018 дюймов (0,46 мм), верхняя челюсть, право - не более 1000 шт.
 - Щечные трубки для приклеивания Pluto на второй моляр, Roth неконвертируемые, 0,018 дюймов (0,46 мм), верхняя челюсть, лево - не более 1000 шт.
 - Щечные трубки для приклеивания Pluto Plus на второй моляр, Roth неконвертируемые, 0,018 дюймов (0,46 мм), верхняя челюсть, лево - не более 1000 шт.
 - Щечные трубки для приклеивания Pluto на второй моляр, Roth неконвертируемые, 0,018 дюймов (0,46 мм), нижняя челюсть, лево - не более 1000 шт.
 - Щечные трубки для приклеивания Pluto Plus на второй моляр, Roth неконвертируемые, 0,018 дюймов (0,46 мм), нижняя челюсть, лево - не более 1000 шт.
 - Щечные трубки для приклеивания Pluto на второй моляр, Roth неконвертируемые, 0,018 дюймов (0,46 мм), нижняя челюсть, право - не более 1000 шт.
 - Щечные трубки для приклеивания Pluto Plus на второй моляр, Roth неконвертируемые, 0,018 дюймов (0,46 мм), нижняя челюсть, право - не более 1000 шт.
 - Щечные трубки для приклеивания Pluto на второй моляр, Roth неконвертируемые,

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0113487

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 28 ноября 2022 года № РЗН 2022/18940

Лист 142

- 0,022 дюйма (0,56 мм), верхняя челюсть, право - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приклеивания Pluto Plus на второй моляр, Roth неконвертируемые, 0,022 дюйма (0,56 мм), верхняя челюсть, право - не более 1000 шт.
 - Щечные трубки для приклеивания Pluto на второй моляр, Roth неконвертируемые, 0,022 дюйма (0,56 мм), верхняя челюсть, лево - не более 1000 шт.
 - Щечные трубки для приклеивания Pluto Plus на второй моляр, Roth неконвертируемые, 0,022 дюйма (0,56 мм), верхняя челюсть, лево - не более 1000 шт.
 - Щечные трубки для приклеивания Pluto на второй моляр, Roth неконвертируемые, 0,022 дюйма (0,56 мм), нижняя челюсть, лево - не более 1000 шт.
 - Щечные трубки для приклеивания Pluto Plus на второй моляр, Roth неконвертируемые, 0,022 дюйма (0,56 мм), нижняя челюсть, лево - не более 1000 шт.
 - Щечные трубки для приклеивания Pluto на второй моляр, Roth неконвертируемые, 0,022 дюйма (0,56 мм), нижняя челюсть, право - не более 1000 шт.
 - Щечные трубки для приклеивания Pluto Plus на второй моляр, Roth неконвертируемые, 0,022 дюйма (0,56 мм), нижняя челюсть, право - не более 1000 шт.
 - Щечные трубки для приклеивания Pluto на второй моляр, McBeTr неконвертируемые, 0,018 дюймов (0,46 мм), верхняя челюсть, право - не более 1000 шт.
 - Щечные трубки для приклеивания Pluto Plus на второй моляр, McBeTr неконвертируемые, 0,018 дюймов (0,46 мм), верхняя челюсть, право - не более 1000 шт.
 - Щечные трубки для приклеивания Pluto на второй моляр, McBeTr неконвертируемые двойные, 0,018 дюймов (0,46 мм), верхняя челюсть, право - не более 1000 шт.
 - Щечные трубки для приклеивания Pluto на второй моляр, McBeTr неконвертируемые, 0,018 дюймов (0,46 мм), верхняя челюсть, лево - не более 1000 шт.
 - Щечные трубки для приклеивания Pluto Plus на второй моляр, McBeTr неконвертируемые, 0,018 дюймов (0,46 мм), верхняя челюсть, лево - не более 1000 шт.
 - Щечные трубки для приклеивания Pluto на второй моляр, McBeTr неконвертируемые двойные, 0,018 дюймов (0,46 мм), верхняя челюсть, лево - не более 1000 шт.
 - Щечные трубки для приклеивания Pluto на второй моляр, McBeTr неконвертируемые, 0,018 дюймов (0,46 мм), нижняя челюсть, лево - не более 1000 шт.
 - Щечные трубки для приклеивания Pluto Plus на второй моляр, McBeTr неконвертируемые, 0,018 дюймов (0,46 мм), нижняя челюсть, лево - не более 1000 шт.
 - Щечные трубки для приклеивания Pluto на второй моляр, McBeTr неконвертируемые, 0,018 дюймов (0,46 мм), нижняя челюсть, право - не более 1000 шт.
 - Щечные трубки для приклеивания Pluto Plus на второй моляр, McBeTr неконвертируемые, 0,018 дюймов (0,46 мм), нижняя челюсть, право - не более 1000 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0113488

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 28 ноября 2022 года № РЗН 2022/18940

Лист 143

- Щечные трубки для приклеивания Pluto на второй моляр, McBeTr неконвертируемые, 0,022 дюйма (0,56 мм), верхняя челюсть, право - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приклеивания Pluto Plus на второй моляр, McBeTr неконвертируемые, 0,022 дюйма (0,56 мм), верхняя челюсть, право - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приклеивания Pluto на второй моляр, McBeTr неконвертируемые двойные, 0,022 дюйма (0,56 мм), верхняя челюсть, право - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приклеивания Pluto на второй моляр, McBeTr неконвертируемые, 0,022 дюйма (0,56 мм), верхняя челюсть, лево - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приклеивания Pluto Plus на второй моляр, McBeTr неконвертируемые, 0,022 дюйма (0,56 мм), верхняя челюсть, лево - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приклеивания Pluto на второй моляр, McBeTr неконвертируемые двойные, 0,022 дюйма (0,56 мм), верхняя челюсть, лево - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приклеивания Pluto на второй моляр, McBeTr неконвертируемые, 0,022 дюйма (0,56 мм), нижняя челюсть, лево - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приклеивания Pluto Plus на второй моляр, McBeTr неконвертируемые, 0,022 дюйма (0,56 мм), нижняя челюсть, лево - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приклеивания Pluto на второй моляр, McBeTr неконвертируемые, 0,022 дюйма (0,56 мм), нижняя челюсть, право - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приклеивания Pluto Plus на второй моляр, McBeTr неконвертируемые, 0,022 дюйма (0,56 мм), нижняя челюсть, право - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приклеивания Pluto на первый моляр, Edgewise конвертируемая, 0,018 дюймов (0,46 мм), верхняя челюсть, право - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приклеивания Pluto на первый моляр, Edgewise конвертируемая, 0,018 дюймов (0,46 мм), верхняя челюсть, лево - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приклеивания Pluto на первый моляр, Edgewise конвертируемая, 0,018 дюймов (0,46 мм), нижняя челюсть, лево - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приклеивания Pluto на первый моляр, Edgewise конвертируемая, 0,018 дюймов (0,46 мм), нижняя челюсть, право - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приклеивания Pluto на первый моляр, Edgewise конвертируемая, 0,022 дюйма (0,56 мм), верхняя челюсть, право - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приклеивания Pluto на первый моляр, Edgewise конвертируемая, 0,022 дюйма (0,56 мм), верхняя челюсть, лево - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приклеивания Pluto на первый моляр, Edgewise конвертируемая, 0,022 дюйма (0,56 мм), нижняя челюсть, лево - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приклеивания Pluto на первый моляр, Edgewise конвертируемая, 0,022 дюйма (0,56 мм), нижняя челюсть, право - не более 1000 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0113489

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 28 ноября 2022 года № РЗН 2022/18940

Лист 144

- Щечные трубки для приклеивания Pluto на первый моляр, Roth конвертируемая, 0,018 дюймов (0,46 мм), верхняя челюсть, право - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приклеивания Pluto на первый моляр, Roth конвертируемая двойные комбинированные, 0,018 дюймов (0,46 мм), верхняя челюсть, право - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приклеивания Pluto на первый моляр, Roth конвертируемая тройные, 0,018 дюймов (0,46 мм), верхняя челюсть, право - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приклеивания Pluto на первый моляр, Roth конвертируемая, 0,018 дюймов (0,46 мм), верхняя челюсть, лево - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приклеивания Pluto на первый моляр, Roth конвертируемая двойные комбинированные, 0,018 дюймов (0,46 мм), верхняя челюсть, лево - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приклеивания Pluto на первый моляр, Roth конвертируемая тройные, 0,018 дюймов (0,46 мм), верхняя челюсть, лево - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приклеивания Pluto на первый моляр, Roth конвертируемая, 0,018 дюймов (0,46 мм), нижняя челюсть, лево - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приклеивания Pluto на первый моляр, Roth конвертируемая двойные комбинированные, 0,018 дюймов (0,46 мм), нижняя челюсть, лево - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приклеивания Pluto на первый моляр, Roth конвертируемая, 0,018 дюймов (0,46 мм), нижняя челюсть, право - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приклеивания Pluto на первый моляр, Roth конвертируемая двойные комбинированные, 0,018 дюймов (0,46 мм), нижняя челюсть, право - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приклеивания Pluto на первый моляр, Roth конвертируемая, 0,022 дюйма (0,56 мм), верхняя челюсть, право - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приклеивания Pluto на первый моляр, Roth конвертируемая двойные комбинированные, 0,022 дюйма (0,56 мм), верхняя челюсть, право - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приклеивания Pluto на первый моляр, Roth конвертируемая тройные, 0,022 дюйма (0,56 мм), верхняя челюсть, право - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приклеивания Pluto на первый моляр, Roth конвертируемая, 0,022 дюйма (0,56 мм), верхняя челюсть, лево - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приклеивания Pluto на первый моляр, Roth конвертируемая двойные комбинированные, 0,022 дюйма (0,56 мм), верхняя челюсть, лево - не более 1000 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова



0113490

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 28 ноября 2022 года № РЗН 2022/18940

Лист 145

- Щечные трубки для приклеивания Pluto на первый моляр, Roth конвертируемая тройные, 0,022 дюйма (0,56 мм), верхняя челюсть, лево - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приклеивания Pluto на первый моляр, Roth конвертируемая, 0,022 дюйма (0,56 мм), нижняя челюсть, лево - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приклеивания Pluto на первый моляр, Roth конвертируемая двойные комбинированные, 0,022 дюйма (0,56 мм), нижняя челюсть, лево - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приклеивания Pluto на первый моляр, Roth конвертируемая, 0,022 дюйма (0,56 мм), нижняя челюсть, право - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приклеивания Pluto на первый моляр, Roth конвертируемая двойные комбинированные, 0,022 дюйма (0,56 мм), нижняя челюсть, право - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приклеивания Pluto на первый моляр, McBeTr конвертируемая, 0,018 дюймов (0,46 мм), верхняя челюсть, право - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приклеивания Pluto на первый моляр, McBeTr конвертируемая двойные комбинированные, 0,018 дюймов (0,46 мм), верхняя челюсть, право - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приклеивания Pluto на первый моляр, McBeTr конвертируемая тройные, 0,018 дюймов (0,46 мм), верхняя челюсть, право - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приклеивания Pluto на первый моляр, McBeTr конвертируемая, 0,018 дюймов (0,46 мм), верхняя челюсть, лево - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приклеивания Pluto на первый моляр, McBeTr конвертируемая двойные комбинированные, 0,018 дюймов (0,46 мм), верхняя челюсть, лево - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приклеивания Pluto на первый моляр, McBeTr конвертируемая тройные, 0,018 дюймов (0,46 мм), верхняя челюсть, лево - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приклеивания Pluto на первый моляр, McBeTr конвертируемая, 0,018 дюймов (0,46 мм), нижняя челюсть, лево - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приклеивания Pluto на первый моляр, McBeTr конвертируемая двойные комбинированные, 0,018 дюймов (0,46 мм), нижняя челюсть, лево - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приклеивания Pluto на первый моляр, McBeTr конвертируемая, 0,018 дюймов (0,46 мм), нижняя челюсть, право - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приклеивания Pluto на первый моляр, McBeTr конвертируемая двойные комбинированные, 0,018 дюймов (0,46 мм), нижняя челюсть, право - не более 1000 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0113491

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 28 ноября 2022 года № РЗН 2022/18940

Лист 146

- Щечные трубки для приклеивания Pluto на первый моляр, McBeTr конвертируемая, 0,022 дюйма (0,56 мм), верхняя челюсть, право - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приклеивания Pluto на первый моляр, McBeTr конвертируемая двойные комбинированные, 0,022 дюйма (0,56 мм), верхняя челюсть, право - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приклеивания Pluto на первый моляр, McBeTr конвертируемая тройные, 0,022 дюйма (0,56 мм), верхняя челюсть, право - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приклеивания Pluto на первый моляр, McBeTr конвертируемая, 0,022 дюйма (0,56 мм), верхняя челюсть, лево - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приклеивания Pluto на первый моляр, McBeTr конвертируемая двойные комбинированные, 0,022 дюйма (0,56 мм), верхняя челюсть, лево - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приклеивания Pluto на первый моляр, McBeTr конвертируемая тройные, 0,022 дюйма (0,56 мм), верхняя челюсть, лево - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приклеивания Pluto на первый моляр, McBeTr конвертируемая, 0,022 дюйма (0,56 мм), нижняя челюсть, лево - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приклеивания Pluto на первый моляр, McBeTr конвертируемая двойные комбинированные, 0,022 дюйма (0,56 мм), нижняя челюсть, лево - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приклеивания Pluto на первый моляр, McBeTr конвертируемая, 0,022 дюйма (0,56 мм), нижняя челюсть, право - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приклеивания Pluto на первый моляр, McBeTr конвертируемая двойные комбинированные, 0,022 дюйма (0,56 мм), нижняя челюсть, право - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приклеивания Pluto на первый моляр, Roth конвертируемая двойные, гингивальные комбинированные, 0,018 дюймов (0,46 мм), верхняя челюсть, право - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приклеивания Pluto на первый моляр, Roth конвертируемая двойные, гингивальные комбинированные, 0,018 дюймов (0,46 мм), верхняя челюсть, лево - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приклеивания Pluto на первый моляр, Roth конвертируемая двойные, гингивальные комбинированные, 0,022 дюйма (0,56 мм), верхняя челюсть, право - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приклеивания Pluto на первый моляр, Roth конвертируемая двойные, гингивальные комбинированные, 0,022 дюйма (0,56 мм), верхняя челюсть, лево - не более 1000 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0113492

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 28 ноября 2022 года № РЗН 2022/18940

Лист 147

- Щечные трубки для приклеивания Pluto на первый моляр, McBeTr конвертируемая двойные, гингивальные комбинированные, 0,018 дюймов (0,46 мм), верхняя челюсть, право - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приклеивания Pluto на первый моляр, McBeTr конвертируемая двойные, гингивальные комбинированные, 0,018 дюймов (0,46 мм), верхняя челюсть, лево - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приклеивания Pluto на первый моляр, McBeTr конвертируемая двойные, гингивальные комбинированные, 0,022 дюйма (0,56 мм), верхняя челюсть, право - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приклеивания Pluto на первый моляр, McBeTr конвертируемая двойные, гингивальные комбинированные, 0,022 дюйма (0,56 мм), верхняя челюсть, лево - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приклеивания Pluto на первый моляр, McBeTr конвертируемая двойные, 0,018 дюймов (0,46 мм), верхняя челюсть, право - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приклеивания Pluto на первый моляр, McBeTr конвертируемая двойные, 0,018 дюймов (0,46 мм), верхняя челюсть, лево - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приклеивания Pluto на первый моляр, McBeTr конвертируемая двойные, 0,022 дюйма (0,56 мм), верхняя челюсть, право - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приклеивания Pluto на первый моляр, McBeTr конвертируемая двойные, 0,022 дюйма (0,56 мм), верхняя челюсть, лево - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приклеивания Pluto на первый моляр, Roth неконвертируемые двойные, 0,018 дюймов (0,46 мм), верхняя челюсть, право - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приклеивания Pluto на первый моляр, Roth неконвертируемые двойные, 0,018 дюймов (0,46 мм), верхняя челюсть, лево - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приклеивания Pluto на первый моляр, Roth неконвертируемые двойные, 0,022 дюйма (0,56 мм), верхняя челюсть, право - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приклеивания Pluto на первый моляр, Roth неконвертируемые двойные, 0,022 дюйма (0,56 мм), верхняя челюсть, лево - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приклеивания Pluto на первый моляр, McBeTr неконвертируемые двойные, 0,018 дюймов (0,46 мм), верхняя челюсть, право - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приклеивания Pluto на первый моляр, McBeTr неконвертируемые двойные, 0,018 дюймов (0,46 мм), верхняя челюсть, лево - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приклеивания Pluto на первый моляр, McBeTr неконвертируемые двойные, 0,022 дюйма (0,56 мм), верхняя челюсть, право - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приклеивания Pluto на первый моляр, McBeTr неконвертируемые двойные, 0,022 дюйма (0,56 мм), верхняя челюсть, лево - не более 1000 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0113493

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 28 ноября 2022 года № РЗН 2022/18940

Лист 148

- Щечные трубки для приклеивания Pluto на первый моляр, McBeTr конвертируемая двойные, 0,018 дюймов (0,46 мм), нижняя челюсть, право - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приклеивания Pluto на первый моляр, McBeTr конвертируемая двойные, 0,018 дюймов (0,46 мм), нижняя челюсть, лево - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приклеивания Pluto на первый моляр, McBeTr конвертируемая двойные, 0,022 дюйма (0,56 мм), нижняя челюсть, право - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приклеивания Pluto на первый моляр, McBeTr конвертируемая двойные, 0,022 дюйма (0,56 мм), нижняя челюсть, лево - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приклеивания Pluto NC на первый моляр, Roth + неконвертируемые, 0,022 дюйма (0,56 мм), верхняя челюсть, право - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приклеивания Pluto NC на первый моляр, Roth + неконвертируемые, 0,022 дюйма (0,56 мм), верхняя челюсть, лево - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приклеивания Pluto NC на первый моляр, Roth + неконвертируемые, 0,022 дюйма (0,56 мм), нижняя челюсть, лево - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приклеивания Pluto NC на первый моляр, Roth + неконвертируемые, 0,022 дюйма (0,56 мм), нижняя челюсть, право - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приклеивания Pluto NC на второй моляр, Roth + неконвертируемые, 0,022 дюйма (0,56 мм), верхняя челюсть, право - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приклеивания Pluto NC на второй моляр, Roth + неконвертируемые, 0,022 дюйма (0,56 мм), верхняя челюсть, лево - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приклеивания Pluto NC на второй моляр, Roth + неконвертируемые, 0,022 дюйма (0,56 мм), нижняя челюсть, лево - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приклеивания Pluto NC на второй моляр, Roth + неконвертируемые, 0,022 дюйма (0,56 мм), нижняя челюсть, право - не более 1000 шт.
- 4. Щечные трубки для приваривания Pluto, в вариантах исполнения:
- Щечные трубки для приваривания Pluto на первый моляр, Edgewise неконвертируемые, 0,018 дюймов (0,46 мм), верхняя челюсть, право - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приваривания Pluto на первый моляр, Edgewise неконвертируемые, 0,018 дюймов (0,46 мм), верхняя челюсть, лево - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приваривания Pluto на первый моляр, Edgewise неконвертируемые, 0,018 дюймов (0,46 мм), нижняя челюсть, лево - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приваривания Pluto на первый моляр, Edgewise неконвертируемые, 0,018 дюймов (0,46 мм), нижняя челюсть, право - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приваривания Pluto на первый моляр, Edgewise неконвертируемые, 0,022 дюйма (0,56 мм), верхняя челюсть, право - не более 1000 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0113494

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 28 ноября 2022 года № РЗН 2022/18940

Лист 149

- Щечные трубки для приваривания Pluto на первый моляр, Edgewise неконвертируемые, 0,022 дюйма (0,56 мм), верхняя челюсть, лево - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приваривания Pluto на первый моляр, Edgewise неконвертируемые, 0,022 дюйма (0,56 мм), нижняя челюсть, лево - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приваривания Pluto на первый моляр, Edgewise неконвертируемые, 0,022 дюйма (0,56 мм), нижняя челюсть, право - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приваривания Pluto на первый моляр, Roth неконвертируемые, 0,018 дюймов (0,46 мм), верхняя челюсть, право - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приваривания Pluto Plus на первый моляр, Roth неконвертируемые, 0,018 дюймов (0,46 мм), верхняя челюсть, право - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приваривания Pluto на первый моляр, Roth неконвертируемые двойные комбинированные, 0,018 дюймов (0,46 мм), верхняя челюсть, право - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приваривания Pluto на первый моляр, Roth неконвертируемые тройные, 0,018 дюймов (0,46 мм), верхняя челюсть, право - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приваривания Pluto на первый моляр, Roth неконвертируемые, 0,018 дюймов (0,46 мм), верхняя челюсть, лево - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приваривания Pluto Plus на первый моляр, Roth неконвертируемые, 0,018 дюймов (0,46 мм), верхняя челюсть, лево - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приваривания Pluto на первый моляр, Roth неконвертируемые двойные комбинированные, 0,018 дюймов (0,46 мм), верхняя челюсть, лево - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приваривания Pluto на первый моляр, Roth неконвертируемые тройные, 0,018 дюймов (0,46 мм), верхняя челюсть, лево - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приваривания Pluto на первый моляр, Roth неконвертируемые, 0,018 дюймов (0,46 мм), нижняя челюсть, лево - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приваривания Pluto на первый моляр, Roth неконвертируемые двойные, 0,018 дюймов (0,46 мм), нижняя челюсть, лево - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приваривания Pluto на первый моляр, Roth неконвертируемые, 0,018 дюймов (0,46 мм), нижняя челюсть, право - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приваривания Pluto на первый моляр, Roth неконвертируемые двойные, 0,018 дюймов (0,46 мм), нижняя челюсть, право - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приваривания Pluto на первый моляр, Roth неконвертируемые, 0,022 дюйма (0,56 мм), верхняя челюсть, право - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приваривания Pluto Plus на первый моляр, Roth

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0113495

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 28 ноября 2022 года

№ РЗН 2022/18940

Лист 150

неконвертируемые, 0,022 дюйма (0,56 мм), верхняя челюсть, право - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приваривания Pluto на первый моляр, Roth неконвертируемые двойные комбинированные, 0,022 дюйма (0,56 мм), верхняя челюсть, право - не более 1000 шт.

- Щечные трубки для приваривания Pluto на первый моляр, Roth неконвертируемые тройные, 0,022 дюйма (0,56 мм), верхняя челюсть, право - не более 1000 шт.

- Щечные трубки для приваривания Pluto на первый моляр, Roth неконвертируемые, 0,022 дюйма (0,56 мм), верхняя челюсть, лево - не более 1000 шт.

- Щечные трубки для приваривания Pluto Plus на первый моляр, Roth неконвертируемые, 0,022 дюйма (0,56 мм), верхняя челюсть, лево - не более 1000 шт.

- Щечные трубки для приваривания Pluto на первый моляр, Roth неконвертируемые двойные комбинированные, 0,022 дюйма (0,56 мм), верхняя челюсть, лево - не более 1000 шт.

- Щечные трубки для приваривания Pluto на первый моляр, Roth неконвертируемые тройные, 0,022 дюйма (0,56 мм), верхняя челюсть, лево - не более 1000 шт.

- Щечные трубки для приваривания Pluto на первый моляр, Roth неконвертируемые, 0,022 дюйма (0,56 мм), нижняя челюсть, лево - не более 1000 шт.

- Щечные трубки для приваривания Pluto на первый моляр, Roth неконвертируемые двойные, 0,022 дюйма (0,56 мм), нижняя челюсть, лево - не более 1000 шт.

- Щечные трубки для приваривания Pluto на первый моляр, Roth неконвертируемые, 0,022 дюйма (0,56 мм), нижняя челюсть, право - не более 1000 шт.

- Щечные трубки для приваривания Pluto на первый моляр, Roth неконвертируемые двойные, 0,022 дюйма (0,56 мм), нижняя челюсть, право - не более 1000 шт.

- Щечные трубки для приваривания Pluto на первый моляр, McBeTr неконвертируемые, 0,018 дюймов (0,46 мм), верхняя челюсть, право - не более 1000 шт.

- Щечные трубки для приваривания Pluto Plus на первый моляр, McBeTr неконвертируемые, 0,018 дюймов (0,46 мм), верхняя челюсть, право - не более 1000 шт.

- Щечные трубки для приваривания Pluto на первый моляр, McBeTr неконвертируемые двойные комбинированные, 0,018 дюймов (0,46 мм), верхняя челюсть, право - не более 1000 шт.

- Щечные трубки для приваривания Pluto на первый моляр, McBeTr неконвертируемые тройные, 0,018 дюймов (0,46 мм), верхняя челюсть, право - не более 1000 шт.

- Щечные трубки для приваривания Pluto на первый моляр, McBeTr неконвертируемые, 0,018 дюймов (0,46 мм), верхняя челюсть, лево - не более 1000 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0113496

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 28 ноября 2022 года № РЗН 2022/18940

Лист 151

- Щечные трубки для приваривания Pluto Plus на первый моляр, McBeTr неконвертируемые, 0,018 дюймов (0,46 мм), верхняя челюсть, лево - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приваривания Pluto на первый моляр, McBeTr неконвертируемые двойные комбинированные, 0,018 дюймов (0,46 мм), верхняя челюсть, лево - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приваривания Pluto на первый моляр, McBeTr неконвертируемые тройные, 0,018 дюймов (0,46 мм), верхняя челюсть, лево - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приваривания Pluto на первый моляр, McBeTr неконвертируемые, 0,018 дюймов (0,46 мм), нижняя челюсть, лево - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приваривания Pluto на первый моляр, McBeTr неконвертируемые двойные, 0,018 дюймов (0,46 мм), нижняя челюсть, лево - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приваривания Pluto на первый моляр, McBeTr неконвертируемые, 0,018 дюймов (0,46 мм), нижняя челюсть, право - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приваривания Pluto на первый моляр, McBeTr неконвертируемые двойные, 0,018 дюймов (0,46 мм), нижняя челюсть, право - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приваривания Pluto на первый моляр, McBeTr неконвертируемые, 0,022 дюйма (0,56 мм), верхняя челюсть, право - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приваривания Pluto Plus на первый моляр, McBeTr неконвертируемые, 0,022 дюйма (0,56 мм), верхняя челюсть, право - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приваривания Pluto на первый моляр, McBeTr неконвертируемые двойные комбинированные, 0,022 дюйма (0,56 мм), верхняя челюсть, право - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приваривания Pluto на первый моляр, McBeTr неконвертируемые тройные, 0,022 дюйма (0,56 мм), верхняя челюсть, право - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приваривания Pluto на первый моляр, McBeTr неконвертируемые, 0,022 дюйма (0,56 мм), верхняя челюсть, лево - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приваривания Pluto Plus на первый моляр, McBeTr неконвертируемые, 0,022 дюйма (0,56 мм), верхняя челюсть, лево - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приваривания Pluto на первый моляр, McBeTr неконвертируемые двойные комбинированные, 0,022 дюйма (0,56 мм), верхняя челюсть, лево - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приваривания Pluto на первый моляр, McBeTr неконвертируемые тройные, 0,022 дюйма (0,56 мм), верхняя челюсть, лево - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приваривания Pluto на первый моляр, McBeTr неконвертируемые, 0,022 дюйма (0,56 мм), нижняя челюсть, лево - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приваривания Pluto на первый моляр, McBeTr неконвертируемые

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0113497

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 28 ноября 2022 года № РЗН 2022/18940

Лист 152

- двойные, 0,022 дюйма (0,56 мм), нижняя челюсть, лево - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приваривания Pluto на первый моляр, McBeTr неконвертируемые, 0,022 дюйма (0,56 мм), нижняя челюсть, право - не более 1000 шт.
 - Щечные трубки для приваривания Pluto на первый моляр, McBeTr неконвертируемые двойные, 0,022 дюйма (0,56 мм), нижняя челюсть, право - не более 1000 шт.
 - Щечные трубки для приваривания Pluto на второй моляр, Edgewise неконвертируемые, 0,018 дюймов (0,46 мм), верхняя челюсть, право - не более 1000 шт.
 - Щечные трубки для приваривания Pluto на второй моляр, Edgewise неконвертируемые, 0,018 дюймов (0,46 мм), верхняя челюсть, лево - не более 1000 шт.
 - Щечные трубки для приваривания Pluto на второй моляр, Edgewise неконвертируемые, 0,018 дюймов (0,46 мм), нижняя челюсть, лево - не более 1000 шт.
 - Щечные трубки для приваривания Pluto на второй моляр, Edgewise неконвертируемые, 0,018 дюймов (0,46 мм), нижняя челюсть, право - не более 1000 шт.
 - Щечные трубки для приваривания Pluto на второй моляр, Edgewise неконвертируемые, 0,022 дюйма (0,56 мм), верхняя челюсть, право - не более 1000 шт.
 - Щечные трубки для приваривания Pluto на второй моляр, Edgewise неконвертируемые, 0,022 дюйма (0,56 мм), верхняя челюсть, лево - не более 1000 шт.
 - Щечные трубки для приваривания Pluto на второй моляр, Edgewise неконвертируемые, 0,022 дюйма (0,56 мм), нижняя челюсть, лево - не более 1000 шт.
 - Щечные трубки для приваривания Pluto на второй моляр, Edgewise неконвертируемые, 0,022 дюйма (0,56 мм), нижняя челюсть, право - не более 1000 шт.
 - Щечные трубки для приваривания Pluto на второй моляр, Roth неконвертируемые, 0,018 дюймов (0,46 мм), верхняя челюсть, право - не более 1000 шт.
 - Щечные трубки для приваривания Pluto Plus на второй моляр, Roth неконвертируемые, 0,018 дюймов (0,46 мм), верхняя челюсть, право - не более 1000 шт.
 - Щечные трубки для приваривания Pluto на второй моляр, Roth неконвертируемые, 0,018 дюймов (0,46 мм), верхняя челюсть, лево - не более 1000 шт.
 - Щечные трубки для приваривания Pluto Plus на второй моляр, Roth неконвертируемые, 0,018 дюймов (0,46 мм), верхняя челюсть, лево - не более 1000 шт.
 - Щечные трубки для приваривания Pluto на второй моляр, Roth неконвертируемые, 0,018 дюймов (0,46 мм), нижняя челюсть, лево - не более 1000 шт.
 - Щечные трубки для приваривания Pluto на второй моляр, Roth неконвертируемые, 0,018 дюймов (0,46 мм), нижняя челюсть, право - не более 1000 шт.
 - Щечные трубки для приваривания Pluto на второй моляр, Roth неконвертируемые,

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0113498

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 28 ноября 2022 года № РЗН 2022/18940

Лист 153

- 0,022 дюйма (0,56 мм), верхняя челюсть, право - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приваривания Pluto Plus на второй моляр, Roth неконвертируемые, 0,022 дюйма (0,56 мм), верхняя челюсть, право - не более 1000 шт.
 - Щечные трубки для приваривания Pluto на второй моляр, Roth неконвертируемые, 0,022 дюйма (0,56 мм), верхняя челюсть, лево - не более 1000 шт.
 - Щечные трубки для приваривания Pluto Plus на второй моляр, Roth неконвертируемые, 0,022 дюйма (0,56 мм), верхняя челюсть, лево - не более 1000 шт.
 - Щечные трубки для приваривания Pluto на второй моляр, Roth неконвертируемые, 0,022 дюйма (0,56 мм), нижняя челюсть, лево - не более 1000 шт.
 - Щечные трубки для приваривания Pluto на второй моляр, Roth неконвертируемые, 0,022 дюйма (0,56 мм), нижняя челюсть, право - не более 1000 шт.
 - Щечные трубки для приваривания Pluto на второй моляр, McBeTr неконвертируемые, 0,018 дюймов (0,46 мм), верхняя челюсть, право - не более 1000 шт.
 - Щечные трубки для приваривания Pluto Plus на второй моляр, McBeTr неконвертируемые, 0,018 дюймов (0,46 мм), верхняя челюсть, право - не более 1000 шт.
 - Щечные трубки для приваривания Pluto на второй моляр, McBeTr неконвертируемые двойные, 0,018 дюймов (0,46 мм), верхняя челюсть, право - не более 1000 шт.
 - Щечные трубки для приваривания Pluto на второй моляр, McBeTr неконвертируемые, 0,018 дюймов (0,46 мм), верхняя челюсть, лево - не более 1000 шт.
 - Щечные трубки для приваривания Pluto Plus на второй моляр, McBeTr неконвертируемые, 0,018 дюймов (0,46 мм), верхняя челюсть, лево - не более 1000 шт.
 - Щечные трубки для приваривания Pluto на второй моляр, McBeTr неконвертируемые двойные, 0,018 дюймов (0,46 мм), верхняя челюсть, лево - не более 1000 шт.
 - Щечные трубки для приваривания Pluto на второй моляр, McBeTr неконвертируемые, 0,018 дюймов (0,46 мм), нижняя челюсть, лево - не более 1000 шт.
 - Щечные трубки для приваривания Pluto на второй моляр, McBeTr неконвертируемые, 0,018 дюймов (0,46 мм), нижняя челюсть, право - не более 1000 шт.
 - Щечные трубки для приваривания Pluto на второй моляр, McBeTr неконвертируемые, 0,022 дюйма (0,56 мм), верхняя челюсть, право - не более 1000 шт.
 - Щечные трубки для приваривания Pluto Plus на второй моляр, McBeTr неконвертируемые, 0,022 дюйма (0,56 мм), верхняя челюсть, право - не более 1000 шт.
 - Щечные трубки для приваривания Pluto на второй моляр, McBeTr неконвертируемые двойные, 0,022 дюйма (0,56 мм), верхняя челюсть, право - не более 1000 шт.
 - Щечные трубки для приваривания Pluto на второй моляр, McBeTr неконвертируемые, 0,022 дюйма (0,56 мм), верхняя челюсть, лево - не более 1000 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0113499

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 28 ноября 2022 года № РЗН 2022/18940

Лист 154

- Щечные трубки для приваривания Pluto Plus на второй моляр, McBeTr неконвертируемые, 0,022 дюйма (0,56 мм), верхняя челюсть, лево - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приваривания Pluto на второй моляр, McBeTr неконвертируемые двойные, 0,022 дюйма (0,56 мм), верхняя челюсть, лево - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приваривания Pluto на второй моляр, McBeTr неконвертируемые, 0,022 дюйма (0,56 мм), нижняя челюсть, лево - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приваривания Pluto на второй моляр, McBeTr неконвертируемые, 0,022 дюйма (0,56 мм), нижняя челюсть, право - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приваривания Pluto на первый моляр, Edgewise конвертируемая, 0,018 дюймов (0,46 мм), верхняя челюсть, право - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приваривания Pluto на первый моляр, Edgewise конвертируемая, 0,018 дюймов (0,46 мм), верхняя челюсть, лево - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приваривания Pluto на первый моляр, Edgewise конвертируемая, 0,018 дюймов (0,46 мм), нижняя челюсть, лево - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приваривания Pluto на первый моляр, Edgewise конвертируемая, 0,018 дюймов (0,46 мм), нижняя челюсть, право - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приваривания Pluto на первый моляр, Edgewise конвертируемая, 0,022 дюйма (0,56 мм), верхняя челюсть, право - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приваривания Pluto на первый моляр, Edgewise конвертируемая, 0,022 дюйма (0,56 мм), верхняя челюсть, лево - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приваривания Pluto на первый моляр, Edgewise конвертируемая, 0,022 дюйма (0,56 мм), нижняя челюсть, лево - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приваривания Pluto на первый моляр, Edgewise конвертируемая, 0,022 дюйма (0,56 мм), нижняя челюсть, право - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приваривания Pluto на первый моляр, Roth конвертируемая, 0,018 дюймов (0,46 мм), верхняя челюсть, право - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приваривания Pluto на первый моляр, Roth конвертируемая двойные комбинированные, 0,018 дюймов (0,46 мм), верхняя челюсть, право - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приваривания Pluto на первый моляр, Roth конвертируемая тройные, 0,018 дюймов (0,46 мм), верхняя челюсть, право - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приваривания Pluto на первый моляр, Roth конвертируемая, 0,018 дюймов (0,46 мм), верхняя челюсть, лево - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приваривания Pluto на первый моляр, Roth конвертируемая двойные комбинированные, 0,018 дюймов (0,46 мм), верхняя челюсть, лево - не более 1000 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0113500

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 28 ноября 2022 года № РЗН 2022/18940

Лист 155

- Щечные трубки для приваривания Pluto на первый моляр, Roth конвертируемая тройные, 0,018 дюймов (0,46 мм), верхняя челюсть, лево - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приваривания Pluto на первый моляр, Roth конвертируемая, 0,018 дюймов (0,46 мм), нижняя челюсть, лево - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приваривания Pluto на первый моляр, Roth конвертируемая двойные комбинированные, 0,018 дюймов (0,46 мм), нижняя челюсть, лево - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приваривания Pluto на первый моляр, Roth конвертируемая, 0,018 дюймов (0,46 мм), нижняя челюсть, право - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приваривания Pluto на первый моляр, Roth конвертируемая двойные комбинированные, 0,018 дюймов (0,46 мм), нижняя челюсть, право - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приваривания Pluto на первый моляр, Roth конвертируемая, 0,022 дюйма (0,56 мм), верхняя челюсть, право - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приваривания Pluto на первый моляр, Roth конвертируемая двойные комбинированные, 0,022 дюйма (0,56 мм), верхняя челюсть, право - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приваривания Pluto на первый моляр, гингивальные, Roth конвертируемая двойные комбинированные, 0,022 дюйма (0,56 мм), верхняя челюсть, право - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приваривания Pluto на первый моляр, Roth конвертируемая двойные, прямоугольная, 0,022 дюйма (0,56 мм), верхняя челюсть, право - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приваривания Pluto на первый моляр, Roth конвертируемая тройные, 0,022 дюйма (0,56 мм), верхняя челюсть, право - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приваривания Pluto на первый моляр, Roth конвертируемая, 0,022 дюйма (0,56 мм), верхняя челюсть, лево - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приваривания Pluto на первый моляр, Roth конвертируемая двойные комбинированные, 0,022 дюйма (0,56 мм), верхняя челюсть, лево - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приваривания Pluto на первый моляр, гингивальные, Roth конвертируемая двойные комбинированные, 0,022 дюйма (0,56 мм), верхняя челюсть, лево - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приваривания Pluto на первый моляр, Roth конвертируемая двойные, прямоугольная, 0,022 дюйма (0,56 мм), верхняя челюсть, лево - не более 1000 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0111501

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 28 ноября 2022 года № РЗН 2022/18940

Лист 156

- Щечные трубки для приваривания Pluto на первый моляр, Roth конвертируемая тройные, 0,022 дюйма (0,56 мм), верхняя челюсть, лево - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приваривания Pluto на первый моляр, Roth конвертируемая, 0,022 дюйма (0,56 мм), нижняя челюсть, лево - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приваривания Pluto на первый моляр, Roth конвертируемая двойные комбинированные, 0,022 дюйма (0,56 мм), нижняя челюсть, лево - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приваривания Pluto на первый моляр, Roth конвертируемая двойные, прямоугольная, 0,022 дюйма (0,56 мм), нижняя челюсть, лево - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приваривания Pluto на первый моляр, Roth конвертируемая, 0,022 дюйма (0,56 мм), нижняя челюсть, право - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приваривания Pluto на первый моляр, Roth конвертируемая двойные, 0,022 дюйма (0,56 мм), нижняя челюсть, право - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приваривания Pluto на первый моляр, Roth конвертируемая двойные, прямоугольная, 0,022 дюйма (0,56 мм), нижняя челюсть, право - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приваривания Pluto на первый моляр, McBeTr конвертируемая, 0,018 дюймов (0,46 мм), верхняя челюсть, право - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приваривания Pluto на первый моляр, McBeTr конвертируемая двойные комбинированные, 0,018 дюймов (0,46 мм), верхняя челюсть, право - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приваривания Pluto на первый моляр, McBeTr конвертируемая тройные, 0,018 дюймов (0,46 мм), верхняя челюсть, право - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приваривания Pluto на первый моляр, McBeTr конвертируемая, 0,018 дюймов (0,46 мм), верхняя челюсть, лево - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приваривания Pluto на первый моляр, McBeTr конвертируемая двойные комбинированные, 0,018 дюймов (0,46 мм), верхняя челюсть, лево - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приваривания Pluto на первый моляр, McBeTr конвертируемая тройные, 0,018 дюймов (0,46 мм), верхняя челюсть, лево - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приваривания Pluto на первый моляр, McBeTr конвертируемая, 0,018 дюймов (0,46 мм), нижняя челюсть, лево - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приваривания Pluto на первый моляр, McBeTr конвертируемая двойные комбинированные, 0,018 дюймов (0,46 мм), нижняя челюсть, лево - не более 1000 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0111502

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 28 ноября 2022 года № РЗН 2022/18940

Лист 157

- Щечные трубки для приваривания Pluto на первый моляр, McBeTr конвертируемая, 0,018 дюймов (0,46 мм), нижняя челюсть, право - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приваривания Pluto на первый моляр, McBeTr конвертируемая двойные комбинированные, 0,018 дюймов (0,46 мм), нижняя челюсть, право - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приваривания Pluto на первый моляр, McBeTr конвертируемая, 0,022 дюйма (0,56 мм), верхняя челюсть, право - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приваривания Pluto на первый моляр, McBeTr конвертируемая двойные комбинированные, 0,022 дюйма (0,56 мм), верхняя челюсть, право
- Щечные трубки для приваривания Pluto на первый моляр, McBeTr конвертируемая тройные, 0,022 дюйма (0,56 мм), верхняя челюсть, право - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приваривания Pluto на первый моляр, McBeTr конвертируемая, 0,022 дюйма (0,56 мм), верхняя челюсть, лево - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приваривания Pluto на первый моляр, McBeTr конвертируемая двойные комбинированные, 0,022 дюйма (0,56 мм), верхняя челюсть, лево - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приваривания Pluto на первый моляр, McBeTr конвертируемая тройные, 0,022 дюйма (0,56 мм), верхняя челюсть, лево - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приваривания Pluto на первый моляр, McBeTr конвертируемая, 0,022 дюйма (0,56 мм), нижняя челюсть, лево - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приваривания Pluto на первый моляр, McBeTr конвертируемая двойные комбинированные, 0,022 дюйма (0,56 мм), нижняя челюсть, лево - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приваривания Pluto на первый моляр, Roth конвертируемая двойные, гингивальные комбинированные, 0,018 дюймов (0,46 мм), верхняя челюсть, право - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приваривания Pluto на первый моляр, Roth конвертируемая двойные, гингивальные комбинированные, 0,018 дюймов (0,46 мм), верхняя челюсть, лево - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приваривания Pluto на первый моляр, McBeTr конвертируемая двойные, гингивальные комбинированные, 0,018 дюймов (0,46 мм), верхняя челюсть,

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0111503

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 28 ноября 2022 года № РЗН 2022/18940

Лист 158

право - не более 1000 шт.

- Щечные трубки для приваривания Pluto на первый моляр, McBeTg конвертируемая двойные, гингивальные комбинированные, 0,018 дюймов (0,46 мм), верхняя челюсть, лево - не более 1000 шт.

- Щечные трубки для приваривания Pluto на первый моляр, McBeTg конвертируемая двойные, гингивальные комбинированные, 0,022 дюйма (0,56 мм), верхняя челюсть, право - не более 1000 шт.

- Щечные трубки для приваривания Pluto на первый моляр, McBeTg конвертируемая двойные, гингивальные комбинированные, 0,022 дюйма (0,56 мм), верхняя челюсть, лево - не более 1000 шт.

- Щечные трубки для приваривания Pluto на первый моляр, McBeTg конвертируемая двойные, 0,018 дюймов (0,46 мм), верхняя челюсть, право - не более 1000 шт.

- Щечные трубки для приваривания Pluto на первый моляр, McBeTg конвертируемая двойные, 0,018 дюймов (0,46 мм), верхняя челюсть, лево - не более 1000 шт.

- Щечные трубки для приваривания Pluto на первый моляр, McBeTg конвертируемая двойные, 0,022 дюйма (0,56 мм), верхняя челюсть, право - не более 1000 шт.

- Щечные трубки для приваривания Pluto на первый моляр, McBeTg конвертируемая двойные, 0,022 дюйма (0,56 мм), верхняя челюсть, лево - не более 1000 шт.

- Щечные трубки для приваривания Pluto на первый моляр, Roth неконвертируемые двойные, 0,018 дюймов (0,46 мм), верхняя челюсть, право - не более 1000 шт.

- Щечные трубки для приваривания Pluto на первый моляр, Roth неконвертируемые двойные, 0,018 дюймов (0,46 мм), верхняя челюсть, лево - не более 1000 шт.

- Щечные трубки для приваривания Pluto на первый моляр, Roth неконвертируемые двойные, 0,022 дюйма (0,56 мм), верхняя челюсть, право - не более 1000 шт.

- Щечные трубки для приваривания Pluto на первый моляр, Roth неконвертируемые двойные, 0,022 дюйма (0,56 мм), верхняя челюсть, лево - не более 1000 шт.

- Щечные трубки для приваривания Pluto на первый моляр, McBeTg неконвертируемые двойные, 0,018 дюймов (0,46 мм), верхняя челюсть, право - не более 1000 шт.

- Щечные трубки для приваривания Pluto на первый моляр, McBeTg неконвертируемые двойные, 0,018 дюймов (0,46 мм), верхняя челюсть, лево - не более 1000 шт.

- Щечные трубки для приваривания Pluto на первый моляр, McBeTg неконвертируемые двойные, 0,022 дюйма (0,56 мм), верхняя челюсть, право - не более 1000 шт.

- Щечные трубки для приваривания Pluto на первый моляр, McBeTg неконвертируемые двойные, 0,022 дюйма (0,56 мм), верхняя челюсть, лево - не более 1000 шт.

- Щечные трубки для приваривания Pluto на первый моляр, McBeTg конвертируемая двойные, 0,018 дюймов (0,46 мм), нижняя челюсть, право - не более 1000 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0111504

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 28 ноября 2022 года № РЗН 2022/18940

Лист 159

- Щечные трубки для приваривания Pluto на первый моляр, McBeTr конвертируемая двойные, 0,018 дюймов (0,46 мм), нижняя челюсть, лево - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приваривания Pluto на первый моляр, McBeTr конвертируемая двойные, 0,022 дюйма (0,56 мм), нижняя челюсть, право - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приваривания Pluto на первый моляр, McBeTr конвертируемая двойные, 0,022 дюйма (0,56 мм), нижняя челюсть, лево - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приваривания Pluto на первый моляр, Roth неконвертируемые двойные, 0,018 дюймов (0,46 мм), верхняя челюсть, право - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приваривания Pluto на первый моляр, Roth неконвертируемые двойные, 0,018 дюймов (0,46 мм), верхняя челюсть, лево - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приваривания Pluto на первый моляр, Roth неконвертируемые двойные, 0,022 дюйма (0,56 мм), верхняя челюсть, право - не более 1000 шт.
- Щечные трубки для приваривания Pluto на первый моляр, Roth неконвертируемые двойные, 0,022 дюйма (0,56 мм), верхняя челюсть, лево - не более 1000 шт.

VIII. Крючок хирургический, в вариантах исполнения:

1. Крючок хирургический стандартный, не более 1000 шт.
2. Крючок хирургический длинный, не более 1000 шт.
3. Крючок хирургический длинный, левый, не более 1000 шт.
4. Крючок хирургический длинный, правый, не более 1000 шт.
5. Крючок хирургический скользящий, не более 1000 шт.

IX. Кнопка, в вариантах исполнения:

1. Кнопка для приваривания с круглым основанием, не более 1000 шт.
2. Кнопка для приваривания с овальным основанием, не более 1000 шт.
3. Кнопка для приклеивания с круглым основанием, не более 1000 шт.
4. Кнопка для приклеивания с овальным основанием, не более 1000 шт.

X. Замок лингвальный, в вариантах исполнения:

1. Замок лингвальный с крючком, левый, не более 1000 шт.
2. Замок лингвальный с крючком, правый, не более 1000 шт.
3. Замок лингвальный универсальный, не более 1000 шт.

XI. Пружина, в вариантах исполнения:

1. Пружина закрывающая NITI Close Spring, в вариантах исполнения:

- Пружина закрывающая NITI, сечение 0,008 дюймов (0,2 мм), длина 6 мм, не более 1000 шт.
- Пружина закрывающая NITI, сечение 0,008 дюймов (0,2 мм), длина 6 мм, 2 маленьких ушка, не более 1000 шт.
- Пружина закрывающая NITI, сечение 0,008 дюймов (0,2 мм), длина 6 мм, маленькое и

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0111505

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 28 ноября 2022 года

№ РЗН 2022/18940

Лист 160

большое ушко, не более 1000 шт.

- Пружина закрывающая NITI, сечение 0,008 дюймов (0,2 мм), длина 9 мм, не более 1000 шт.

- Пружина закрывающая NITI, сечение 0,008 дюймов (0,2 мм), длина 9 мм, 2 маленьких ушка, не более 1000 шт.

- Пружина закрывающая NITI, сечение 0,008 дюймов (0,2 мм), длина 9 мм, маленькое и большое ушко, не более 1000 шт.

- Пружина закрывающая NITI, сечение 0,010 дюймов (0,25 мм), длина 4 мм, 2 маленьких ушка, не более 1000 шт.

- Пружина закрывающая NITI, сечение 0,010 дюймов (0,25 мм), длина 5 мм, 2 маленьких ушка, не более 1000 шт.

- Пружина закрывающая NITI, сечение 0,010 дюймов (0,25 мм), длина 5 мм, маленькое и большое ушко, не более 1000 шт.

- Пружина закрывающая NITI, сечение 0,010 дюймов (0,25 мм), длина 6 мм, не более 1000 шт.

- Пружина закрывающая NITI, сечение 0,010 дюймов (0,25 мм), длина 6 мм, 2 маленьких ушка, не более 1000 шт.

- Пружина закрывающая NITI, сечение 0,010 дюймов (0,25 мм), длина 6 мм, маленькое и большое ушко, не более 1000 шт.

- Пружина закрывающая NITI, сечение 0,010 дюймов (0,25 мм), длина 8 мм, 2 маленьких ушка, не более 1000 шт.

- Пружина закрывающая NITI, сечение 0,010 дюймов (0,25 мм), длина 9 мм, не более 1000 шт.

- Пружина закрывающая NITI, сечение 0,010 дюймов (0,25 мм), длина 9 мм, 2 маленьких ушка, не более 1000 шт.

- Пружина закрывающая NITI, сечение 0,010 дюймов (0,25 мм), длина 9 мм, маленькое и большое ушко, не более 1000 шт.

- Пружина закрывающая NITI, сечение 0,010 дюймов (0,25 мм), длина 12 мм, не более 1000 шт.

- Пружина закрывающая NITI, сечение 0,010 дюймов (0,25 мм), длина 12 мм, 2 маленьких ушка, не более 1000 шт.

- Пружина закрывающая NITI, сечение 0,010 дюймов (0,25 мм), длина 12 мм, маленькое и большое ушко, не более 1000 шт.

- Пружина закрывающая NITI, сечение 0,010 дюймов (0,25 мм), длина 15 мм, 2 маленьких ушка, не более 1000 шт.

- Пружина закрывающая NITI, сечение 0,010 дюймов (0,25 мм), длина 15 мм,

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0111506

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 28 ноября 2022 года № РЗН 2022/18940

Лист 161

маленькое и большое ушко, не более 1000 шт.

- Пружина закрывающая NITI, сечение 0,0105 дюймов (0,27 мм), длина 9 мм, 2 маленьких ушка, не более 1000 шт.

- Пружина закрывающая NITI, сечение 0,0105 дюймов (0,27 мм), длина 9 мм, маленькое и большое ушко, не более 1000 шт.

- Пружина закрывающая NITI, сечение 0,0105 дюймов (0,27 мм), длина 12 мм, маленькое и большое ушко, не более 1000 шт.

- Пружина закрывающая NITI, сечение 0,012 дюймов (0,30 мм), длина 6 мм, не более 1000 шт.

- Пружина закрывающая NITI, сечение 0,012 дюймов (0,30 мм), длина 6 мм, 2 маленьких ушка, не более 1000 шт.

- Пружина закрывающая NITI, сечение 0,012 дюймов (0,30 мм), длина 6 мм, маленькое и большое ушко, не более 1000 шт.

- Пружина закрывающая NITI, сечение 0,012 дюймов (0,30 мм), длина 9 мм, не более 1000 шт.

- Пружина закрывающая NITI, сечение 0,012 дюймов (0,30 мм, не более 100 шт.), длина 9 мм, 2 маленьких ушка, не более 1000 шт.

- Пружина закрывающая NITI, сечение 0,012 дюймов (0,30 мм), длина 9 мм, маленькое и большое ушко, не более 1000 шт.

- Пружина закрывающая NITI, сечение 0,012 дюймов (0,30 мм), длина 12 мм, не более 1000 шт.

- Пружина закрывающая NITI, сечение 0,012 дюймов (0,30 мм), длина 12 мм, 2 маленьких ушка, не более 1000 шт.

- Пружина закрывающая NITI, сечение 0,012 дюймов (0,30 мм), длина 12 мм, маленькое и большое ушко, не более 1000 шт.

- Пружина закрывающая NITI, сечение 0,012 дюймов (0,30 мм), длина 15 мм, 2 маленьких ушка, не более 1000 шт.

2. Пружина открывающая NITI OPEN SPRING, в вариантах исполнения:

- Пружина открывающая сечение 0,008 дюймов (0,2 мм), длина 178 мм, не более 1000 шт.

- Пружина открывающая сечение 0,010 дюймов (0,25 мм), длина 178 мм, не более 1000 шт.

- Пружина открывающая сечение 0,012 дюймов (0,30 мм), длина 178 мм, не более 1000 шт.

XII. Дуга ортодонтическая, в вариантах исполнения:

1. Дуга ортодонтическая Orthoshape NITI Bio MEMAlloy, в вариантах исполнения:

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0111507


**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 28 ноября 2022 года № РЗН 2022/18940

Лист 162

- Дуга ортодонтическая NITI Bio MEMAlloy, сечение прямоугольное, форма Квадратная, 0,017 дюймов (0,43 мм) x 0,025 дюймов (0,64 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Bio MEMAlloy, сечение прямоугольное, форма Квадратная, 0,017 дюймов (0,43 мм) x 0,025 дюймов (0,64 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Bio MEMAlloy, сечение прямоугольное, форма Квадратная, 0,018 дюймов (0,46 мм) x 0,018 дюймов (0,46 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Bio MEMAlloy, сечение прямоугольное, форма Квадратная, 0,018 дюймов (0,46 мм) x 0,018 дюймов (0,46 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Bio MEMAlloy, сечение прямоугольное, форма Квадратная, 0,018 дюймов (0,46 мм) x 0,025 дюймов (0,64 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Bio MEMAlloy, сечение прямоугольное, форма Квадратная, 0,018 дюймов (0,46 мм) x 0,025 дюймов (0,64 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Bio MEMAlloy, сечение прямоугольное, форма Квадратная, 0,019 дюймов (0,48 мм) x 0,025 дюймов (0,64 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Bio MEMAlloy, сечение прямоугольное, форма Квадратная, 0,019 дюймов (0,48 мм) x 0,025 дюймов (0,64 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Bio MEMAlloy, сечение прямоугольное, форма Квадратная, 0,020 дюймов (0, 51 мм) x 0,020 дюймов (0, 51 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Bio MEMAlloy, сечение прямоугольное, форма Квадратная, 0,020 дюймов (0, 51 мм) x 0,020 дюймов (0, 51 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Bio MEMAlloy, сечение прямоугольное, форма Квадратная, 0,021 дюймов (0, 53 мм) x 0,028 дюймов (0, 71 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Bio MEMAlloy, сечение прямоугольное, форма Квадратная, 0,021 дюймов (0, 53 мм) x 0,028 дюймов (0, 71 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

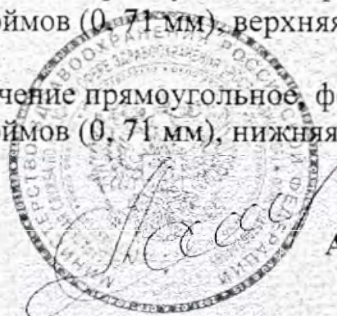

А.В. Самойлова

0111508

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 28 ноября 2022 года

№ РЗН 2022/18940

Лист 163

- Дуга ортодонтическая NITI Bio MEMAlloy, сечение прямоугольное, форма Овоид, 0,016 дюймов (0,41 мм) x 0,016 дюймов (0,41 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Bio MEMAlloy, сечение прямоугольное, форма Овоид, 0,016 дюймов (0,41 мм) x 0,016 дюймов (0,41 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Bio MEMAlloy, сечение прямоугольное, форма Овоид, 0,017 дюймов (0,43 мм) x 0,025 дюймов (0,64 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Bio MEMAlloy, сечение прямоугольное, форма Овоид, 0,017 дюймов (0,43 мм) x 0,025 дюймов (0,64 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Bio MEMAlloy, сечение прямоугольное, форма Овоид, 0,018 дюймов (0,46 мм) x 0,018 дюймов (0,46 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Bio MEMAlloy, сечение прямоугольное, форма Овоид, 0,018 дюймов (0,46 мм) x 0,018 дюймов (0,46 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Bio MEMAlloy, сечение прямоугольное, форма Овоид, 0,018 дюймов (0,46 мм) x 0,025 дюймов (0,64 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Bio MEMAlloy, сечение прямоугольное, форма Овоид, 0,018 дюймов (0,46 мм) x 0,025 дюймов (0,64 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Bio MEMAlloy, сечение прямоугольное, форма Овоид, 0,019 дюймов (0, 48 мм) x 0,025 дюймов (0,64 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Bio MEMAlloy, сечение прямоугольное, форма Овоид, 0,019 дюймов (0, 48 мм) x 0,025 дюймов (0,64 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Bio MEMAlloy, сечение прямоугольное, форма Овоид, 0,020 дюймов (0, 51 мм) x 0,020 дюймов (0, 51 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Bio MEMAlloy, сечение прямоугольное, форма Овоид, 0,020 дюймов (0, 51 мм) x 0,020 дюймов (0, 51 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Bio MEMAlloy, сечение прямоугольное, форма Овоид, 0,021 дюймов (0, 53 мм) x 0,025 дюймов (0,64 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Bio MEMAlloy, сечение прямоугольное, форма Овоид, 0,021 дюймов (0, 53 мм) x 0,025 дюймов (0,64 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Bio MEMAlloy, сечение прямоугольное, форма Овоид, 0,021 дюймов (0, 53 мм) x 0,028 дюймов (0, 71 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Bio MEMAlloy, сечение прямоугольное, форма Овоид, 0,021 дюймов (0, 53 мм) x 0,028 дюймов (0, 71 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Bio MEMAlloy, сечение прямоугольное, форма Нейчерал, 0,016 дюймов (0,41 мм) x 0,016 дюймов (0,41 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Bio MEMAlloy, сечение прямоугольное, форма Нейчерал, 0,016 дюймов (0,41 мм) x 0,016 дюймов (0,41 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0111509

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 28 ноября 2022 года № РЗН 2022/18940

Лист 164

- Дуга ортодонтическая NITI Bio MEMAlloy, сечение прямоугольное, форма Нейчерал, 0,017 дюймов (0,43 мм) x 0,025 дюймов (0,64 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Bio MEMAlloy, сечение прямоугольное, форма Нейчерал, 0,017 дюймов (0,43 мм) x 0,025 дюймов (0,64 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Bio MEMAlloy, сечение прямоугольное, форма Нейчерал, 0,018 дюймов (0,46 мм) x 0,018 дюймов (0,46 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Bio MEMAlloy, сечение прямоугольное, форма Нейчерал, 0,018 дюймов (0,46 мм) x 0,018 дюймов (0,46 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Bio MEMAlloy, сечение прямоугольное, форма Нейчерал, 0,016 дюймов (0,41 мм) x 0,022 дюйма (0,56 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Bio MEMAlloy, сечение прямоугольное, форма Нейчерал, 0,016 дюймов (0,41 мм) x 0,022 дюйма (0,56 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Bio MEMAlloy, сечение прямоугольное, форма Нейчерал, 0,018 дюймов (0,46 мм) x 0,025 дюймов (0,64 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Bio MEMAlloy, сечение прямоугольное, форма Нейчерал, 0,018 дюймов (0,46 мм) x 0,025 дюймов (0,64 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Bio MEMAlloy, сечение прямоугольное, форма Нейчерал, 0,019 дюймов (0, 48 мм) x 0,025 дюймов (0,64 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Bio MEMAlloy, сечение прямоугольное, форма Нейчерал, 0,019 дюймов (0, 48 мм) x 0,025 дюймов (0,64 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Bio MEMAlloy, сечение прямоугольное, форма Нейчерал, 0,020 дюймов (0, 51 мм) x 0,020 дюймов (0, 51 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Bio MEMAlloy, сечение прямоугольное, форма Нейчерал, 0,020 дюймов (0, 51 мм) x 0,020 дюймов (0, 51 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Bio MEMAlloy, сечение прямоугольное, форма Нейчерал, 0,021 дюймов (0, 53 мм) x 0,025 дюймов (0,64 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Bio MEMAlloy, сечение прямоугольное, форма Нейчерал, 0,021 дюймов (0, 53 мм) x 0,025 дюймов (0,64 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Bio MEMAlloy, сечение прямоугольное, форма Нейчерал, 0,021 дюймов (0, 53 мм) x 0,028 дюймов (0, 71 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Bio MEMAlloy, сечение прямоугольное, форма Нейчерал, 0,021 дюймов (0, 53 мм) x 0,028 дюймов (0, 71 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Bio MEMAlloy, сечение прямоугольное, форма Даймон, 0,016 дюймов (0,41 мм) x 0,016 дюймов (0,41 мм, не более 100 шт.), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Bio MEMAlloy, сечение прямоугольное, форма Даймон,

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0111510

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 28 ноября 2022 года № РЗН 2022/18940

Лист 165

0,016 дюймов (0,41 мм) x 0,016 дюймов (0,41 мм, не более 100 шт.), нижняя челюсть, не более 1000 шт.

- Дуга ортодонтическая NITI Bio MEMAlloy, сечение прямоугольное, форма Даймон, 0,016 дюймов (0,41 мм) x 0,022 дюйма (0,56 мм) дюйма, верхняя челюсть, не более 1000 шт.

- Дуга ортодонтическая NITI Bio MEMAlloy, сечение прямоугольное, форма Даймон, 0,016 дюймов (0,41 мм) x 0,022 дюйма (0,56 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.

- Дуга ортодонтическая NITI Bio MEMAlloy, сечение прямоугольное, форма Даймон, 0,017 дюймов (0,43 мм) x 0,022 дюйма (0,56 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.

- Дуга ортодонтическая NITI Bio MEMAlloy, сечение прямоугольное, форма Даймон, 0,017 дюймов (0,43 мм) x 0,022 дюйма (0,56 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.

- Дуга ортодонтическая NITI Bio MEMAlloy, сечение прямоугольное, форма Даймон, 0,017 дюймов (0,43 мм) x 0,025 дюймов (0,64 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.

- Дуга ортодонтическая NITI Bio MEMAlloy, сечение прямоугольное, форма Даймон, 0,017 дюймов (0,43 мм) x 0,025 дюймов (0,64 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.

- Дуга ортодонтическая NITI Bio MEMAlloy, сечение прямоугольное, форма Даймон, 0,018 дюймов (0,46 мм) x 0,018 дюймов (0,46 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.

- Дуга ортодонтическая NITI Bio MEMAlloy, сечение прямоугольное, форма Даймон, 0,018 дюймов (0,46 мм) x 0,018 дюймов (0,46 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.

- Дуга ортодонтическая NITI Bio MEMAlloy, сечение прямоугольное, форма Даймон, 0,018 дюймов (0,46 мм) x 0,022 дюйма (0,56 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.

- Дуга ортодонтическая NITI Bio MEMAlloy, сечение прямоугольное, форма Даймон, 0,018 дюймов (0,46 мм) x 0,022 дюйма (0,56 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.

- Дуга ортодонтическая NITI Bio MEMAlloy, сечение прямоугольное, форма Даймон, 0,018 дюймов (0,46 мм) x 0,025 дюймов (0,64 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.

- Дуга ортодонтическая NITI Bio MEMAlloy, сечение прямоугольное, форма Даймон, 0,018 дюймов (0,46 мм) x 0,025 дюймов (0,64 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.

- Дуга ортодонтическая NITI Bio MEMAlloy, сечение прямоугольное, форма Даймон, 0,019 дюймов (0,48 мм) x 0,025 дюймов (0,64 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.

- Дуга ортодонтическая NITI Bio MEMAlloy, сечение прямоугольное, форма Даймон, 0,019 дюймов (0,48 мм) x 0,025 дюймов (0,64 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.

- Дуга ортодонтическая NITI Bio MEMAlloy, сечение прямоугольное, форма Даймон, 0,020 дюймов (0,51 мм) x 0,020 дюймов (0,51 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.

- Дуга ортодонтическая NITI Bio MEMAlloy, сечение прямоугольное, форма Даймон, 0,020 дюймов (0,51 мм) x 0,020 дюймов (0,51 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.

- Дуга ортодонтическая NITI Bio MEMAlloy, сечение прямоугольное, форма Даймон,

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0111511

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 28 ноября 2022 года № РЗН 2022/18940

Лист 166

- 0,021 дюймов (0,53 мм) x 0,025 дюймов (0,64 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Bio MEMAlloy, сечение прямоугольное, форма Даймон, 0,021 дюймов (0,53 мм) x 0,025 дюймов (0,64 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.
 - Дуга ортодонтическая NITI Bio MEMAlloy, сечение прямоугольное, форма Даймон, 0,021 дюймов (0,53 мм) x 0,028 дюймов (0,71 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
 - Дуга ортодонтическая NITI Bio MEMAlloy, сечение прямоугольное, форма Даймон, 0,021 дюймов (0,53 мм) x 0,028 дюймов (0,71 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.
2. Дуга ортодонтическая Orthoshape CU-Alloy, в вариантах исполнения:
- Дуга ортодонтическая CU-Alloy, сечение круглое, форма Овоид, 0,013 дюймов (0,33 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
 - Дуга ортодонтическая CU-Alloy, сечение круглое, форма Овоид, 0,013 дюймов (0,33 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.
 - Дуга ортодонтическая CU-Alloy, сечение круглое, форма Овоид, 0,014 дюймов (0,36 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
 - Дуга ортодонтическая CU-Alloy, сечение круглое, форма Овоид, 0,014 дюймов (0,36 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.
 - Дуга ортодонтическая CU-Alloy, сечение прямоугольное, форма Овоид, 0,014 дюймов (0,36 мм) x 0,025 дюймов (0,64 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
 - Дуга ортодонтическая CU-Alloy, сечение прямоугольное, форма Овоид, 0,014 дюймов (0,36 мм) x 0,025 дюймов (0,64 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.
 - Дуга ортодонтическая CU-Alloy, сечение круглое, форма Овоид, 0,016 дюймов (0,41 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
 - Дуга ортодонтическая CU-Alloy, сечение круглое, форма Овоид, 0,016 дюймов (0,41 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.
 - Дуга ортодонтическая CU-Alloy, сечение прямоугольное, форма Овоид, 0,016 дюймов (0,41 мм) x 0,022 дюйма (0,56 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
 - Дуга ортодонтическая CU-Alloy, сечение прямоугольное, форма Овоид, 0,016 дюймов (0,41 мм) x 0,022 дюйма (0,56 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.
 - Дуга ортодонтическая CU-Alloy, сечение прямоугольное, форма Овоид, 0,016 дюймов (0,41 мм) x 0,025 дюймов (0,64 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
 - Дуга ортодонтическая CU-Alloy, сечение прямоугольное, форма Овоид, 0,016 дюймов (0,41 мм) x 0,025 дюймов (0,64 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.
 - Дуга ортодонтическая CU-Alloy, сечение прямоугольное, форма Овоид, 0,017 дюймов (0,43 мм) x 0,025 дюймов (0,64 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
 - Дуга ортодонтическая CU-Alloy, сечение прямоугольное, форма Овоид, 0,017 дюймов (0,43 мм) x 0,025 дюймов (0,64 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0111512

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 28 ноября 2022 года № РЗН 2022/18940

Лист 167

- Дуга ортодонтическая CU-Alloy, сечение круглое, форма Овоид, 0,018 дюймов (0,46 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая CU-Alloy, сечение круглое, форма Овоид, 0,018 дюймов (0,46 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая CU-Alloy, сечение прямоугольное, форма Овоид, 0,018 дюймов (0,46 мм) x 0,025 дюймов (0,64 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая CU-Alloy, сечение прямоугольное, форма Овоид, 0,018 дюймов (0,46 мм) x 0,025 дюймов (0,64 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая CU-Alloy, сечение прямоугольное, форма Овоид, 0,019 дюймов (0,48 мм) x 0,025 дюймов (0,64 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая CU-Alloy, сечение прямоугольное, форма Овоид, 0,019 дюймов (0,48 мм) x 0,025 дюймов (0,64 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая CU-Alloy, сечение прямоугольное, форма Овоид, 0,020 дюймов (0,51 мм) x 0,020 дюймов (0,51 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая CU-Alloy, сечение прямоугольное, форма Овоид, 0,020 дюймов (0,51 мм) x 0,020 дюймов (0,51 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая CU-Alloy, сечение круглое, форма Нейчерал, 0,013 дюймов (0,33 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая CU-Alloy, сечение круглое, форма Нейчерал, 0,013 дюймов (0,33 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая CU-Alloy, сечение круглое, форма Нейчерал, 0,014 дюймов (0,36 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая CU-Alloy, сечение круглое, форма Нейчерал, 0,014 дюймов (0,36 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая CU-Alloy, сечение прямоугольное, форма Нейчерал, 0,014 дюймов (0,36 мм) x 0,025 дюймов (0,64 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая CU-Alloy, сечение прямоугольное, форма Нейчерал, 0,014 дюймов (0,36 мм) x 0,025 дюймов (0,64 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая CU-Alloy, сечение круглое, форма Нейчерал, 0,016 дюймов (0,41 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая CU-Alloy, сечение круглое, форма Нейчерал, 0,016 дюймов (0,41 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая CU-Alloy, сечение прямоугольное, форма Нейчерал, 0,016 дюймов (0,41 мм) x 0,022 дюйма (0,56 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая CU-Alloy, сечение прямоугольное, форма Нейчерал, 0,016 дюймов (0,41 мм) x 0,022 дюйма (0,56 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0111513

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 28 ноября 2022 года № РЗН 2022/18940

Лист 168

- Дуга ортодонтическая CU-Alloy, сечение прямоугольное, форма Нейчерал, 0,016 дюймов (0,41 мм) x 0,025 дюймов (0,64 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая CU-Alloy, сечение прямоугольное, форма Нейчерал, 0,016 дюймов (0,41 мм) x 0,025 дюймов (0,64 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая CU-Alloy, сечение прямоугольное, форма Нейчерал, 0,017 дюймов (0,43 мм) x 0,025 дюймов (0,64 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая CU-Alloy, сечение прямоугольное, форма Нейчерал, 0,017 дюймов (0,43 мм) x 0,025 дюймов (0,64 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая CU-Alloy, сечение круглое, форма Нейчерал, 0,018 дюймов (0,46 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая CU-Alloy, сечение круглое, форма Нейчерал, 0,018 дюймов (0,46 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая CU-Alloy, сечение прямоугольное, форма Нейчерал, 0,018 дюймов (0,46 мм) x 0,025 дюймов (0,64 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая CU-Alloy, сечение прямоугольное, форма Нейчерал, 0,018 дюймов (0,46 мм) x 0,025 дюймов (0,64 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая CU-Alloy, сечение прямоугольное, форма Нейчерал, 0,019 дюймов (0, 48 мм) x 0,025 дюймов (0,64 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая CU-Alloy, сечение прямоугольное, форма Нейчерал, 0,019 дюймов (0, 48 мм) x 0,025 дюймов (0,64 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая CU-Alloy, сечение прямоугольное, форма Нейчерал, 0,020 дюймов (0, 51 мм) x 0,020 дюймов (0, 51 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая CU-Alloy, сечение прямоугольное, форма Нейчерал, 0,020 дюймов (0, 51 мм) x 0,020 дюймов (0, 51 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая CU-Alloy, сечение круглое, форма Даймон, 0,013 дюймов (0,33 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая CU-Alloy, сечение круглое, форма Даймон, 0,013 дюймов (0,33 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая CU-Alloy, сечение круглое, форма Даймон, 0,014 дюймов (0,36 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая CU-Alloy, сечение круглое, форма Даймон, 0,014 дюймов (0,36 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая CU-Alloy, сечение прямоугольное, форма Даймон, 0,014 дюймов (0,36 мм) x 0,025 дюймов (0,64 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая CU-Alloy, сечение прямоугольное, форма Даймон, 0,014 дюймов (0,36 мм) x 0,025 дюймов (0,64 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0111514

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 28 ноября 2022 года № РЗН 2022/18940

Лист 169

- Дуга ортодонтическая CU-Alloy, сечение круглое, форма Даймон, 0,016 дюймов (0,41 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая CU-Alloy, сечение круглое, форма Даймон, 0,016 дюймов (0,41 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая CU-Alloy, сечение прямоугольное, форма Даймон, 0,016 дюймов (0,41 мм) x 0,022 дюймов (0,56 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая CU-Alloy, сечение прямоугольное, форма Даймон, 0,016 дюймов (0,41 мм) x 0,022 дюймов (0,56 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая CU-Alloy, сечение прямоугольное, форма Даймон, 0,016 дюймов (0,41 мм) x 0,025 дюймов (0,64 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая CU-Alloy, сечение прямоугольное, форма Даймон, 0,016 дюймов (0,41 мм) x 0,025 дюймов (0,64 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая CU-Alloy, сечение прямоугольное, форма Даймон, 0,017 дюймов (0,43 мм) x 0,025 дюймов (0,64 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая CU-Alloy, сечение прямоугольное, форма Даймон, 0,017 дюймов (0,43 мм) x 0,025 дюймов (0,64 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая CU-Alloy, сечение круглое, форма Даймон, 0,018 дюймов (0,46 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая CU-Alloy, сечение круглое, форма Даймон, 0,018 дюймов (0,46 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая CU-Alloy, сечение прямоугольное, форма Даймон, 0,018 дюймов (0,46 мм) x 0,025 дюймов (0,64 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая CU-Alloy, сечение прямоугольное, форма Даймон, 0,018 дюймов (0,46 мм) x 0,025 дюймов (0,64 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.
- 3. Дуга ортодонтическая Orthoshape NITI MEMAlloy, в вариантах исполнения:
 - Дуга ортодонтическая NITI MEMAlloy, сечение круглое, форма Овоид, 0,012 дюймов (0,30 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
 - Дуга ортодонтическая NITI MEMAlloy, сечение круглое, форма Овоид, 0,012 дюймов (0,30 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.
 - Дуга ортодонтическая NITI MEMAlloy, сечение круглое, форма Овоид, 0,014 дюймов (0,36 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
 - Дуга ортодонтическая NITI MEMAlloy, сечение круглое, форма Овоид, 0,014 дюймов (0,36 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.
 - Дуга ортодонтическая NITI MEMAlloy, сечение круглое, форма Овоид, 0,016 дюймов (0,41 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
 - Дуга ортодонтическая NITI MEMAlloy, сечение круглое, форма Овоид, 0,016 дюймов (0,41 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0111515

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 28 ноября 2022 года № РЗН 2022/18940

Лист 170

- (0,41 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI MEMAlloy, сечение круглое, форма Овоид, 0,018 дюймов (0,46 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
 - Дуга ортодонтическая NITI MEMAlloy, сечение круглое, форма Овоид, 0,018 дюймов (0,46 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.
 - Дуга ортодонтическая NITI MEMAlloy, сечение круглое, форма Овоид, 0,020 дюймов (0,51 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
 - Дуга ортодонтическая NITI MEMAlloy, сечение круглое, форма Овоид, 0,020 дюймов (0,51 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.
 - Дуга ортодонтическая NITI MEMAlloy, сечение круглое, форма Нейчерал, 0,012 дюймов (0,30 мм) верхняя челюсть, не более 1000 шт.
 - Дуга ортодонтическая NITI MEMAlloy, сечение круглое, форма Нейчерал, 0,012 дюймов (0,30 мм) нижняя челюсть, не более 1000 шт.
 - Дуга ортодонтическая NITI MEMAlloy, сечение круглое, форма Нейчерал, 0,014 дюймов (0,36 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
 - Дуга ортодонтическая NITI MEMAlloy, сечение круглое, форма Нейчерал, 0,014 дюймов (0,36 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.
 - Дуга ортодонтическая NITI MEMAlloy, сечение круглое, форма Нейчерал, 0,016 дюймов (0,41 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
 - Дуга ортодонтическая NITI MEMAlloy, сечение круглое, форма Нейчерал, 0,016 дюймов (0,41 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.
 - Дуга ортодонтическая NITI MEMAlloy, сечение круглое, форма Нейчерал, 0,018 дюймов (0,46 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
 - Дуга ортодонтическая NITI MEMAlloy, сечение круглое, форма Нейчерал, 0,018 дюймов (0,46 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.
 - Дуга ортодонтическая NITI MEMAlloy, сечение круглое, форма Даймон, 0,012 дюймов (0,30 мм) верхняя челюсть, не более 1000 шт.
 - Дуга ортодонтическая NITI MEMAlloy, сечение круглое, форма Даймон, 0,012 дюймов (0,30 мм) нижняя челюсть, не более 1000 шт.
 - Дуга ортодонтическая NITI MEMAlloy, сечение круглое, форма Даймон, 0,014 дюймов (0,36 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
 - Дуга ортодонтическая NITI MEMAlloy, сечение круглое, форма Даймон, 0,014 дюймов (0,36 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.
 - Дуга ортодонтическая NITI MEMAlloy, сечение круглое, форма Даймон, 0,016 дюймов (0,41 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
 - Дуга ортодонтическая NITI MEMAlloy, сечение круглое, форма Даймон, 0,016

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0111516

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 28 ноября 2022 года № РЗН 2022/18940

Лист 171

дюймов (0,41 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.

- Дуга ортодонтическая NITI MEMAlloy, сечение круглое, форма Даймон, 0,018 дюймов (0,46 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.

- Дуга ортодонтическая NITI MEMAlloy, сечение круглое, форма Даймон, 0,018 дюймов (0,46 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.

4. Дуга ортодонтическая Orthoshape NITI Super Elastic, в вариантах исполнения:

- Дуга ортодонтическая NITI Super Elastic, сечение круглое, форма Квадратная, 0,012 дюймов (0,30 мм) верхняя челюсть, не более 1000 шт.

- Дуга ортодонтическая NITI Super Elastic, сечение круглое, форма Квадратная, 0,012 дюймов (0,30 мм) нижняя челюсть, не более 1000 шт.

- Дуга ортодонтическая NITI Super Elastic, сечение круглое, форма Квадратная, 0,014 дюймов (0,36 мм) дюймов (0,35 мм, не более 100 шт.), верхняя челюсть, не более 1000 шт.

- Дуга ортодонтическая NITI Super Elastic, сечение круглое, форма Квадратная, 0,014 дюймов (0,36 мм) дюймов (0,35 мм, не более 100 шт.), нижняя челюсть, не более 1000 шт.

- Дуга ортодонтическая NITI Super Elastic, сечение круглое, форма Квадратная, 0,016 дюймов (0,41 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.

- Дуга ортодонтическая NITI Super Elastic, сечение круглое, форма Квадратная, 0,016 дюймов (0,41 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.

- Дуга ортодонтическая NITI Super Elastic, сечение прямоугольное, форма Квадратная, 0,016 дюймов (0,41 мм) x 0,016 дюймов (0,41 мм, не более 100 шт.), верхняя челюсть, не более 1000 шт.

- Дуга ортодонтическая NITI Super Elastic, сечение прямоугольное, форма Квадратная, 0,016 дюймов (0,41 мм) x 0,016 дюймов (0,41 мм, не более 100 шт.), нижняя челюсть, не более 1000 шт.

- Дуга ортодонтическая NITI Super Elastic, сечение прямоугольное, форма Квадратная, 0,016 дюймов (0,41 мм) x 0,022 дюйма (0,56 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.

- Дуга ортодонтическая NITI Super Elastic, сечение прямоугольное, форма Квадратная, 0,016 дюймов (0,41 мм) x 0,022 дюйма (0,56 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.

- Дуга ортодонтическая NITI Super Elastic, сечение прямоугольное, форма Квадратная, 0,017 дюймов (0,43 мм) x 0,022 дюйма (0,56 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.

- Дуга ортодонтическая NITI Super Elastic, сечение прямоугольное, форма Квадратная, 0,017 дюймов (0,43 мм) x 0,022 дюйма (0,56 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.

- Дуга ортодонтическая NITI Super Elastic, сечение прямоугольное, форма Квадратная, 0,017 дюймов (0,43 мм) x 0,025 дюймов (0,64 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0111517

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 28 ноября 2022 года № РЗН 2022/18940

Лист 172

- Дуга ортодонтическая NITI Super Elastic, сечение прямоугольное, форма Квадратная, 0,017 дюймов (0,43 мм) x 0,025 дюймов (0,64 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Super Elastic, сечение круглое, форма Квадратная, 0,018 дюймов (0,46 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Super Elastic, сечение круглое, форма Квадратная, 0,018 дюймов (0,46 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Super Elastic, сечение прямоугольное, форма Квадратная, 0,018 дюймов (0,46 мм) x 0,022 дюйма (0,56 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Super Elastic, сечение прямоугольное, форма Квадратная, 0,018 дюймов (0,46 мм) x 0,022 дюйма (0,56 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Super Elastic, сечение прямоугольное, форма Квадратная, 0,018 дюймов (0,46 мм) x 0,025 дюймов (0,64 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Super Elastic, сечение прямоугольное, форма Квадратная, 0,018 дюймов (0,46 мм) x 0,025 дюймов (0,64 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Super Elastic, сечение прямоугольное, форма Квадратная, 0,019 дюймов (0, 48 мм) x 0,025 дюймов (0,64 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Super Elastic, сечение прямоугольное, форма Квадратная, 0,019 дюймов (0, 48 мм) x 0,025 дюймов (0,64 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Super Elastic, сечение круглое, форма Квадратная, 0,020 дюймов (0, 51 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Super Elastic, сечение круглое, форма Квадратная, 0,020 дюймов (0, 51 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Super Elastic, сечение прямоугольное, форма Квадратная, 0,021 дюймов (0, 53 мм) x 0,025 дюймов (0,64 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Super Elastic, сечение прямоугольное, форма Квадратная, 0,021 дюймов (0, 53 мм) x 0,025 дюймов (0,64 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Super Elastic, сечение круглое, форма Овоид, 0,012 дюймов (0,30 мм) верхняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Super Elastic, сечение круглое, форма Овоид, 0,012 дюймов (0,30 мм) нижняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Super Elastic, сечение круглое, форма Овоид, 0,014 дюймов (0,36 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Super Elastic, сечение круглое, форма Овоид, 0,014 дюймов (0,36 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Super Elastic, сечение круглое, форма Овоид, 0,016 дюймов (0,41 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0111518

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 28 ноября 2022 года № РЗН 2022/18940

Лист 173

- Дуга ортодонтическая NITI Super Elastic, сечение круглое, форма Овоид, 0,016 дюймов (0,41 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Super Elastic, сечение прямоугольное, форма Овоид, 0,016 дюймов (0,41 мм) x 0,016 дюймов (0,41 мм, не более 100 шт.), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Super Elastic, сечение прямоугольное, форма Овоид, 0,016 дюймов (0,41 мм) x 0,016 дюймов (0,41 мм, не более 100 шт.), нижняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Super Elastic, сечение прямоугольное, форма Овоид, 0,016 дюймов (0,41 мм) x 0,022 дюйма (0,56 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Super Elastic, сечение прямоугольное, форма Овоид, 0,016 дюймов (0,41 мм) x 0,022 дюйма (0,56 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Super Elastic, сечение прямоугольное, форма Овоид, 0,017 дюймов (0,43 мм) x 0,022 дюйма (0,56 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Super Elastic, сечение прямоугольное, форма Овоид, 0,017 дюймов (0,43 мм) x 0,022 дюйма (0,56 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Super Elastic, сечение прямоугольное, форма Овоид, 0,017 дюймов (0,43 мм) x 0,025 дюймов (0,64 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Super Elastic, сечение прямоугольное, форма Овоид, 0,017 дюймов (0,43 мм) x 0,025 дюймов (0,64 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Super Elastic, сечение круглое, форма Овоид, 0,018 дюймов (0,46 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Super Elastic, сечение круглое, форма Овоид, 0,018 дюймов (0,46 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Super Elastic, сечение прямоугольное, форма Овоид, 0,018 дюймов (0,46 мм) x 0,022 дюйма (0,56 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Super Elastic, сечение прямоугольное, форма Овоид, 0,018 дюймов (0,46 мм) x 0,022 дюйма (0,56 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Super Elastic, сечение прямоугольное, форма Овоид, 0,018 дюймов (0,46 мм) x 0,025 дюймов (0,64 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Super Elastic, сечение прямоугольное, форма Овоид, 0,018 дюймов (0,46 мм) x 0,025 дюймов (0,64 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Super Elastic, сечение прямоугольное, форма Овоид, 0,019 дюймов (0,48 мм) x 0,025 дюймов (0,64 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Super Elastic, сечение прямоугольное, форма Овоид, 0,019 дюймов (0,48 мм) x 0,025 дюймов (0,64 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0111519

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**


от 28 ноября 2022 года № РЗН 2022/18940

Лист 174

- Дуга ортодонтическая NITI Super Elastic, сечение круглое, форма Овоид, 0,020 дюймов (0,51 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Super Elastic, сечение круглое, форма Овоид, 0,020 дюймов (0,51 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Super Elastic, сечение прямоугольное, форма Овоид, 0,020 дюймов (0,51 мм) x 0,020 дюймов (0,51 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Super Elastic, сечение прямоугольное, форма Овоид, 0,020 дюймов (0,51 мм) x 0,020 дюймов (0,51 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Super Elastic, сечение прямоугольное, форма Овоид, 0,021 дюймов (0,53 мм) x 0,025 дюймов (0,64 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Super Elastic, сечение прямоугольное, форма Овоид, 0,021 дюймов (0,53 мм) x 0,025 дюймов (0,64 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Super Elastic, сечение круглое, форма Нейчерал, 0,012 дюймов (0,30 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Super Elastic, сечение круглое, форма Нейчерал, 0,012 дюймов (0,30 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Super Elastic, сечение круглое, форма Нейчерал, 0,014 дюймов (0,36 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Super Elastic, сечение круглое, форма Нейчерал, 0,014 дюймов (0,36 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Super Elastic, сечение круглое, форма Нейчерал, 0,016 дюймов (0,41 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Super Elastic, сечение круглое, форма Нейчерал, 0,016 дюймов (0,41 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Super Elastic, сечение прямоугольное, форма Нейчерал, 0,016 дюймов (0,41 мм) x 0,016 дюймов (0,41 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Super Elastic, сечение прямоугольное, форма Нейчерал, 0,016 дюймов (0,41 мм) x 0,016 дюймов (0,41 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Super Elastic, сечение прямоугольное, форма Нейчерал, 0,016 дюймов (0,41 мм) x 0,022 дюйма (0,56 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Super Elastic, сечение прямоугольное, форма Нейчерал, 0,016 дюймов (0,41 мм) x 0,022 дюйма (0,56 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Super Elastic, сечение прямоугольное, форма Нейчерал, 0,017 дюймов (0,43 мм) x 0,022 дюйма (0,56 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Super Elastic, сечение прямоугольное, форма Нейчерал, 0,017 дюймов (0,43 мм) x 0,022 дюйма (0,56 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

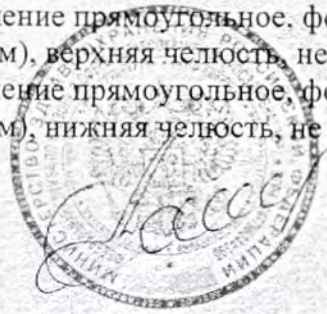

0111520

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 28 ноября 2022 года № РЗН 2022/18940

Лист 175

- Дуга ортодонтическая NITI Super Elastic, сечение прямоугольное, форма Нейчерал, 0,017 дюймов (0,43 мм) x 0,025 дюймов (0,64 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Super Elastic, сечение прямоугольное, форма Нейчерал, 0,017 дюймов (0,43 мм) x 0,025 дюймов (0,64 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Super Elastic, сечение круглое, форма Нейчерал, 0,018 дюймов (0,46 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Super Elastic, сечение круглое, форма Нейчерал, 0,018 дюймов (0,46 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Super Elastic, сечение прямоугольное, форма Нейчерал, 0,018 дюймов (0,46 мм) x 0,018 дюймов (0,46 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Super Elastic, сечение прямоугольное, форма Нейчерал, 0,018 дюймов (0,46 мм) x 0,018 дюймов (0,46 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Super Elastic, сечение прямоугольное, форма Нейчерал, 0,018 дюймов (0,46 мм) x 0,022 дюйма (0,56 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Super Elastic, сечение прямоугольное, форма Нейчерал, 0,018 дюймов (0,46 мм) x 0,022 дюйма (0,56 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Super Elastic, сечение прямоугольное, форма Нейчерал, 0,018 дюймов (0,46 мм) x 0,025 дюймов (0,64 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Super Elastic, сечение прямоугольное, форма Нейчерал, 0,018 дюймов (0,46 мм) x 0,025 дюймов (0,64 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Super Elastic, сечение прямоугольное, форма Нейчерал, 0,019 дюймов (0,48 мм) x 0,025 дюймов (0,64 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Super Elastic, сечение прямоугольное, форма Нейчерал, 0,019 дюймов (0,48 мм) x 0,025 дюймов (0,64 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Super Elastic, сечение круглое, форма Нейчерал, 0,020 дюймов (0,51 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Super Elastic, сечение круглое, форма Нейчерал, 0,020 дюймов (0,51 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Super Elastic, сечение прямоугольное, форма Нейчерал, 0,021 дюймов (0,53 мм) x 0,025 дюймов (0,64 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Super Elastic, сечение прямоугольное, форма Нейчерал, 0,021 дюймов (0,53 мм) x 0,025 дюймов (0,64 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Super Elastic, сечение круглое, форма реверсионная, 0,012 дюймов (0,30 мм) верхняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Super Elastic, сечение круглое, форма реверсионная, 0,012 дюймов (0,30 мм) нижняя челюсть, не более 1000 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0111521

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 28 ноября 2022 года № РЗН 2022/18940

Лист 176

- Дуга ортодонтическая NITI Super Elastic, сечение круглое, форма реверсионная, 0,014 дюймов (0,36 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Super Elastic, сечение круглое, форма реверсионная, 0,014 дюймов (0,36 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Super Elastic, сечение круглое, форма реверсионная, 0,016 дюймов (0,41 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Super Elastic, сечение круглое, форма реверсионная, 0,016 дюймов (0,41 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Super Elastic, сечение прямоугольное, форма реверсионная, 0,016 дюймов (0,41 мм) x 0,016 дюймов (0,41 мм, не более 100 шт.), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Super Elastic, сечение прямоугольное, форма реверсионная, 0,016 дюймов (0,41 мм) x 0,016 дюймов (0,41 мм, не более 100 шт.), нижняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Super Elastic, сечение прямоугольное, форма реверсионная, 0,016 дюймов (0,41 мм) x 0,022 дюйма (0,56 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Super Elastic, сечение прямоугольное, форма реверсионная, 0,016 дюймов (0,41 мм) x 0,022 дюйма (0,56 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Super Elastic, сечение прямоугольное, форма реверсионная, 0,017 дюймов (0,43 мм) x 0,022 дюйма (0,56 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Super Elastic, сечение прямоугольное, форма реверсионная, 0,017 дюймов (0,43 мм) x 0,022 дюйма (0,56 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Super Elastic, сечение прямоугольное, форма реверсионная, 0,017 дюймов (0,43 мм) x 0,025 дюймов (0,64 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Super Elastic, сечение прямоугольное, форма реверсионная, 0,017 дюймов (0,43 мм) x 0,025 дюймов (0,64 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Super Elastic, сечение прямоугольное, форма реверсионная, 0,018 дюймов (0,46 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Super Elastic, сечение прямоугольное, форма реверсионная, 0,018 дюймов (0,46 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0111522

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 28 ноября 2022 года

№ РЗН 2022/18940

Лист 177

- Дуга ортодонтическая NITI Super Elastic, сечение прямоугольное, форма реверсионная, 0,018 дюймов (0,46 мм) x 0,018 дюймов (0,46 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Super Elastic, сечение прямоугольное, форма реверсионная, 0,018 дюймов (0,46 мм) x 0,018 дюймов (0,46 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Super Elastic, сечение прямоугольное, форма реверсионная, 0,018 дюймов (0,46 мм) x 0,022 дюйма (0,56 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Super Elastic, сечение прямоугольное, форма реверсионная, 0,018 дюймов (0,46 мм) x 0,022 дюйма (0,56 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Super Elastic, сечение прямоугольное, форма реверсионная, 0,018 дюймов (0,46 мм) x 0,025 дюймов (0,64 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Super Elastic, сечение прямоугольное, форма реверсионная, 0,018 дюймов (0,46 мм) x 0,025 дюймов (0,64 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Super Elastic, сечение прямоугольное, форма реверсионная, 0,019 дюймов (0, 48 мм) x 0,025 дюймов (0,64 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Super Elastic, сечение прямоугольное, форма реверсионная, 0,019 дюймов (0, 48 мм) x 0,025 дюймов (0,64 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Super Elastic, сечение прямоугольное, форма реверсионная, 0,020 дюймов (0,51 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Super Elastic, сечение прямоугольное, форма реверсионная, 0,020 дюймов (0,51 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Super Elastic, сечение прямоугольное, форма реверсионная, 0,021 дюймов (0, 53 мм) x 0,025 дюймов (0,64 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Super Elastic, сечение прямоугольное, форма реверсионная, 0,021 дюймов (0, 53 мм) x 0,025 дюймов (0,64 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Super Elastic, сечение круглое, форма ЗетЗет, 0,012 дюймов (0,30 мм) верхняя челюсть, не более 1000 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0111523

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 28 ноября 2022 года № РЗН 2022/18940

Лист 178

- Дуга ортодонтическая NITI Super Elastic, сечение круглое, форма ЗетЗет, 0,012 дюймов (0,30 мм) нижняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Super Elastic, сечение круглое, форма ЗетЗет, 0,014 дюймов (0,36 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Super Elastic, сечение круглое, форма ЗетЗет, 0,014 дюймов (0,36 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Super Elastic, сечение круглое, форма ЗетЗет, 0,016 дюймов (0,41 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Super Elastic, сечение круглое, форма ЗетЗет, 0,016 дюймов (0,41 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Super Elastic, сечение прямоугольное, форма ЗетЗет, 0,016 дюймов (0,41 мм) x 0,016 дюймов (0,41 мм, не более 100 шт.), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Super Elastic, сечение прямоугольное, форма ЗетЗет, 0,016 дюймов (0,41 мм) x 0,016 дюймов (0,41 мм, не более 100 шт.), нижняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Super Elastic, сечение прямоугольное, форма ЗетЗет, 0,016 дюймов (0,41 мм) x 0,022 дюйма (0,56 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Super Elastic, сечение прямоугольное, форма ЗетЗет, 0,016 дюймов (0,41 мм) x 0,022 дюйма (0,56 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Super Elastic, сечение прямоугольное, форма ЗетЗет, 0,017 дюймов (0,43 мм) x 0,022 дюйма (0,56 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Super Elastic, сечение прямоугольное, форма ЗетЗет, 0,017 дюймов (0,43 мм) x 0,022 дюйма (0,56 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Super Elastic, сечение прямоугольное, форма ЗетЗет, 0,017 дюймов (0,43 мм) x 0,025 дюймов (0,64 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Super Elastic, сечение прямоугольное, форма ЗетЗет, 0,017 дюймов (0,43 мм) x 0,025 дюймов (0,64 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Super Elastic, сечение круглое, форма ЗетЗет, 0,018 дюймов (0,46 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Super Elastic, сечение круглое, форма ЗетЗет, 0,018 дюймов (0,46 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Super Elastic, сечение прямоугольное, форма ЗетЗет, 0,018 дюймов (0,46 мм) x 0,022 дюйма (0,56 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Super Elastic, сечение прямоугольное, форма ЗетЗет, 0,018 дюймов (0,46 мм) x 0,022 дюйма (0,56 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0111524

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 28 ноября 2022 года № РЗН 2022/18940

Лист 179

- Дуга ортодонтическая NITI Super Elastic, сечение прямоугольное, форма ЗетЗет, 0,018 дюймов (0,46 мм) x 0,025 дюймов (0,64 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Super Elastic, сечение прямоугольное, форма ЗетЗет, 0,018 дюймов (0,46 мм) x 0,025 дюймов (0,64 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Super Elastic, сечение прямоугольное, форма ЗетЗет, 0,019 дюймов (0,48 мм) x 0,025 дюймов (0,64 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Super Elastic, сечение прямоугольное, форма ЗетЗет, 0,019 дюймов (0,48 мм) x 0,025 дюймов (0,64 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Super Elastic, сечение круглое, форма ЗетЗет, 0,020 дюймов (0,51 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Super Elastic, сечение круглое, форма ЗетЗет, 0,020 дюймов (0,51 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Super Elastic, сечение прямоугольное, форма ЗетЗет, 0,021 дюймов (0,53 мм) x 0,025 дюймов (0,64 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Super Elastic, сечение прямоугольное, форма ЗетЗет, 0,021 дюймов (0,53 мм) x 0,025 дюймов (0,64 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Super Elastic, Лингвальная, сечение круглое 0,012 дюймов (0,30 мм) верхняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Super Elastic, Лингвальная, сечение круглое 0,012 дюймов (0,30 мм) нижняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Super Elastic, Лингвальная, сечение круглое 0,014 дюймов (0,36 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Super Elastic, Лингвальная, сечение круглое 0,014 дюймов (0,36 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Super Elastic, Лингвальная, сечение круглое 0,016 дюймов (0,41 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Super Elastic, Лингвальная, сечение круглое 0,016 дюймов (0,41 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Super Elastic, Лингвальная, сечение прямоугольное 0,016 дюймов (0,41 мм) x 0,016 дюймов (0,41 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Super Elastic, Лингвальная, сечение прямоугольное 0,016 дюймов (0,41 мм) x 0,016 дюймов (0,41 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Super Elastic, Лингвальная, сечение прямоугольное 0,016 дюймов (0,41 мм) x 0,022 дюйма (0,56 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Super Elastic, Лингвальная, сечение прямоугольное 0,016 дюймов (0,41 мм) x 0,022 дюйма (0,56 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0111525

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ


от 28 ноября 2022 года

№ РЗН 2022/18940

Лист 180

- Дуга ортодонтическая NITI Super Elastic, Лингвальная, сечение прямоугольное 0,017 дюймов (0,43 мм) x 0,022 дюйма (0,56 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Super Elastic, Лингвальная, сечение прямоугольное 0,017 дюймов (0,43 мм) x 0,022 дюйма (0,56 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Super Elastic, Лингвальная, сечение прямоугольное 0,017 дюймов (0,43 мм) x 0,025 дюймов (0,64 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Super Elastic, Лингвальная, сечение прямоугольное 0,017 дюймов (0,43 мм) x 0,025 дюймов (0,64 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Super Elastic, Лингвальная, сечение круглое 0,018 дюймов (0,46 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Super Elastic, Лингвальная, сечение круглое 0,018 дюймов (0,46 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Super Elastic, Лингвальная, сечение прямоугольное 0,018 дюймов (0,46 мм) x 0,022 дюйма (0,56 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Super Elastic, Лингвальная, сечение прямоугольное 0,018 дюймов (0,46 мм) x 0,022 дюйма (0,56 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Super Elastic, Лингвальная, сечение прямоугольное 0,018 дюймов (0,46 мм) x 0,025 дюймов (0,64 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Super Elastic, Лингвальная, сечение прямоугольное 0,018 дюймов (0,46 мм) x 0,025 дюймов (0,64 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Super Elastic, Лингвальная, сечение прямоугольное 0,019 дюймов (0,48 мм) x 0,025 дюймов (0,64 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Super Elastic, Лингвальная, сечение прямоугольное 0,019 дюймов (0,48 мм) x 0,025 дюймов (0,64 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Super Elastic, Лингвальная, сечение круглое 0,020 дюймов (0,51 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Super Elastic, Лингвальная, сечение круглое 0,020 дюймов (0,51 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Super Elastic, Лингвальная, сечение прямоугольное 0,021 дюймов (0,53 мм) x 0,025 дюймов (0,64 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Super Elastic, Лингвальная, сечение прямоугольное 0,021 дюймов (0,53 мм) x 0,025 дюймов (0,64 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Super Elastic, сечение круглое, форма Коническая, 0,012 дюймов (0,30 мм) верхняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Super Elastic, сечение круглое, форма Коническая, 0,012 дюймов (0,30 мм) нижняя челюсть, не более 1000 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

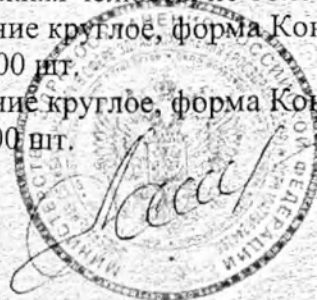

А.В. Самойлова

0111526

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 28 ноября 2022 года № РЗН 2022/18940

Лист 181

- Дуга ортодонтическая NITI Super Elastic, сечение круглое, форма Коническая, 0,014 дюймов (0,36 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Super Elastic, сечение круглое, форма Коническая, 0,014 дюймов (0,36 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Super Elastic, сечение круглое, форма Коническая, 0,016 дюймов (0,41 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Super Elastic, сечение круглое, форма Коническая, 0,016 дюймов (0,41 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Super Elastic, сечение прямоугольное, форма Коническая, 0,016 дюймов (0,41 мм) x 0,016 дюймов (0,41 мм, не более 100 шт.), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Super Elastic, сечение прямоугольное, форма Коническая, 0,016 дюймов (0,41 мм) x 0,016 дюймов (0,41 мм, не более 100 шт.), нижняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Super Elastic, сечение прямоугольное, форма Коническая, 0,016 дюймов (0,41 мм, не более 100 шт.) x 0,022 дюйма (0,56 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Super Elastic, сечение прямоугольное, форма Коническая, 0,016 дюймов (0,41 мм) x 0,022 дюйма (0,56 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Super Elastic, сечение прямоугольное, форма Коническая, 0,017 дюймов (0,43 мм) x 0,022 дюйма (0,56 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Super Elastic, сечение прямоугольное, форма Коническая, 0,017 дюймов (0,43 мм) x 0,022 дюйма (0,56 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Super Elastic, сечение прямоугольное, форма Коническая, 0,017 дюймов (0,43 мм) x 0,025 дюймов (0,64 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Super Elastic, сечение прямоугольное, форма Коническая, 0,017 дюймов (0,43 мм) x 0,025 дюймов (0,64 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Super Elastic, сечение круглое, форма Коническая, 0,018 дюймов (0,46 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Super Elastic, сечение круглое, форма Коническая, 0,018 дюймов (0,46 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Super Elastic, сечение прямоугольное, форма Коническая, 0,018 дюймов (0,46 мм) x 0,022 дюйма (0,56 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Super Elastic, сечение прямоугольное, форма Коническая, 0,018 дюймов (0,46 мм) x 0,022 дюйма (0,56 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Super Elastic, сечение прямоугольное, форма Коническая,

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0111527

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**


от 28 ноября 2022 года № РЗН 2022/18940

Лист 182

- 0,018 дюймов (0,46 мм) x 0,025 дюймов (0,64 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Super Elastic, сечение прямоугольное, форма Коническая, 0,018 дюймов (0,46 мм) x 0,025 дюймов (0,64 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.
 - Дуга ортодонтическая NITI Super Elastic, сечение прямоугольное, форма Коническая, 0,019 дюймов (0,48 мм) x 0,025 дюймов (0,64 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
 - Дуга ортодонтическая NITI Super Elastic, сечение прямоугольное, форма Коническая, 0,019 дюймов (0,48 мм) x 0,025 дюймов (0,64 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.
 - Дуга ортодонтическая NITI Super Elastic, сечение круглое, форма Коническая, 0,020 дюймов (0,51 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
 - Дуга ортодонтическая NITI Super Elastic, сечение круглое, форма Коническая, 0,020 дюймов (0,51 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.
 - Дуга ортодонтическая NITI Super Elastic, сечение прямоугольное, форма Коническая, 0,021 дюймов (0,53 мм) x 0,025 дюймов (0,64 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
 - Дуга ортодонтическая NITI Super Elastic, сечение прямоугольное, форма Коническая, 0,021 дюймов (0,53 мм) x 0,025 дюймов (0,64 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.
 - Дуга ортодонтическая NITI Super Elastic, сечение круглое, форма Даймон, 0,012 дюймов (0,30 мм) верхняя челюсть, не более 1000 шт.
 - Дуга ортодонтическая NITI Super Elastic, сечение круглое, форма Даймон, 0,012 дюймов (0,30 мм) нижняя челюсть, не более 1000 шт.
 - Дуга ортодонтическая NITI Super Elastic, сечение круглое, форма Даймон, 0,014 дюймов (0,36 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
 - Дуга ортодонтическая NITI Super Elastic, сечение круглое, форма Даймон, 0,014 дюймов (0,36 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.
 - Дуга ортодонтическая NITI Super Elastic, сечение круглое, форма Даймон, 0,016 дюймов (0,41 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
 - Дуга ортодонтическая NITI Super Elastic, сечение круглое, форма Даймон, 0,016 дюймов (0,41 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.
 - Дуга ортодонтическая NITI Super Elastic, сечение прямоугольное, форма Даймон, 0,016 дюймов (0,41 мм) x 0,016 дюймов (0,41 мм, не более 100 шт.), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
 - Дуга ортодонтическая NITI Super Elastic, сечение прямоугольное, форма Даймон, 0,016 дюймов (0,41 мм) x 0,016 дюймов (0,41 мм, не более 100 шт.), нижняя челюсть, не более 1000 шт.
 - Дуга ортодонтическая NITI Super Elastic, сечение прямоугольное, форма Даймон, 0,016 дюймов (0,41 мм) x 0,022 дюйма (0,56 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
 - Дуга ортодонтическая NITI Super Elastic, сечение прямоугольное, форма Даймон,

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

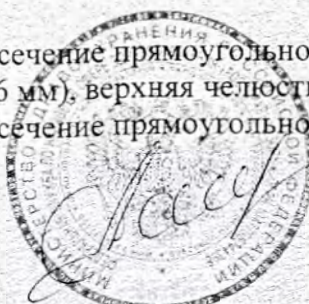

0111528

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 28 ноября 2022 года № РЗН 2022/18940

Лист 183

- 0,016 дюймов (0,41 мм) x 0,022 дюйма (0,56 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Super Elastic, сечение прямоугольное, форма Даймон, 0,017 дюймов (0,43 мм) x 0,022 дюйма (0,56 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
 - Дуга ортодонтическая NITI Super Elastic, сечение прямоугольное, форма Даймон, 0,017 дюймов (0,43 мм) x 0,022 дюйма (0,56 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.
 - Дуга ортодонтическая NITI Super Elastic, сечение прямоугольное, форма Даймон, 0,017 дюймов (0,43 мм) x 0,025 дюймов (0,64 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
 - Дуга ортодонтическая NITI Super Elastic, сечение прямоугольное, форма Даймон, 0,017 дюймов (0,43 мм) x 0,025 дюймов (0,64 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.
 - Дуга ортодонтическая NITI Super Elastic, сечение круглое, форма Даймон, 0,018 дюймов (0,46 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
 - Дуга ортодонтическая NITI Super Elastic, сечение круглое, форма Даймон, 0,018 дюймов (0,46 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.
 - Дуга ортодонтическая NITI Super Elastic, сечение прямоугольное, форма Даймон, 0,018 дюймов (0,46 мм) x 0,022 дюйма (0,56 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
 - Дуга ортодонтическая NITI Super Elastic, сечение прямоугольное, форма Даймон, 0,018 дюймов (0,46 мм) x 0,022 дюйма (0,56 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.
 - Дуга ортодонтическая NITI Super Elastic, сечение прямоугольное, форма Даймон, 0,018 дюймов (0,46 мм) x 0,025 дюймов (0,64 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
 - Дуга ортодонтическая NITI Super Elastic, сечение прямоугольное, форма Даймон, 0,018 дюймов (0,46 мм) x 0,025 дюймов (0,64 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.
 - Дуга ортодонтическая NITI Super Elastic, сечение прямоугольное, форма Даймон, 0,019 дюймов (0, 48 мм) x 0,025 дюймов (0,64 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
 - Дуга ортодонтическая NITI Super Elastic, сечение прямоугольное, форма Даймон, 0,019 дюймов (0, 48 мм) x 0,025 дюймов (0,64 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.
 - Дуга ортодонтическая NITI Super Elastic, сечение круглое, форма Даймон, 0,020 дюймов (0,51 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
 - Дуга ортодонтическая NITI Super Elastic, сечение круглое, форма Даймон, 0,020 дюймов (0,51 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.
 - Дуга ортодонтическая NITI Super Elastic, сечение прямоугольное, форма Даймон, 0,021 дюймов (0, 53 мм) x 0,025 дюймов (0,64 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
 - Дуга ортодонтическая NITI Super Elastic, сечение прямоугольное, форма Даймон, 0,021 дюймов (0, 53 мм) x 0,025 дюймов (0,64 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.
5. Дуга ортодонтическая Orthoshape NITI Thermal Active, в вариантах исполнения:
- Дуга ортодонтическая NITI Thermal Active, сечение круглое, форма Квадратная, 0,012 дюймов (0,30 мм) верхняя челюсть, не более 1000 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0111529

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 28 ноября 2022 года № РЗН 2022/18940

Лист 184

- Дуга ортодонтическая NITI Thermal Active, сечение круглое, форма Квадратная, 0,012 дюймов (0,30 мм) нижняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Thermal Active, сечение круглое, форма Квадратная, 0,014 дюймов (0,36 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Thermal Active, сечение круглое, форма Квадратная, 0,014 дюймов (0,36 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Thermal Active, сечение круглое, форма Квадратная, 0,016 дюймов (0,41 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Thermal Active, сечение круглое, форма Квадратная, 0,016 дюймов (0,41 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Thermal Active, сечение прямоугольное, форма Квадратная, 0,016 дюймов (0,41 мм) x 0,016 дюймов (0,41 мм, не более 100 шт.), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Thermal Active, сечение прямоугольное, форма Квадратная, 0,016 дюймов (0,41 мм) x 0,016 дюймов (0,41 мм, не более 100 шт.), нижняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Thermal Active, сечение прямоугольное, форма Квадратная, 0,016 дюймов (0,41 мм) x 0,022 дюйма (0,56 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Thermal Active, сечение прямоугольное, форма Квадратная, 0,016 дюймов (0,41 мм) x 0,022 дюйма (0,56 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Thermal Active, сечение прямоугольное, форма Квадратная, 0,017 дюймов (0,43 мм) x 0,022 дюйма (0,56 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Thermal Active, сечение прямоугольное, форма Квадратная, 0,017 дюймов (0,43 мм) x 0,022 дюйма (0,56 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Thermal Active, сечение прямоугольное, форма Квадратная, 0,017 дюймов (0,43 мм) x 0,025 дюймов (0,64 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Thermal Active, сечение прямоугольное, форма Квадратная, 0,017 дюймов (0,43 мм) x 0,025 дюймов (0,64 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Thermal Active, сечение круглое, форма Квадратная, 0,018 дюймов (0,46 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0111530

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 28 ноября 2022 года

№ РЗН 2022/18940

Лист 185

- Дуга ортодонтическая NITI Thermal Active, сечение круглое, форма Квадратная, 0,018 дюймов (0,46 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Thermal Active, сечение прямоугольное, форма Квадратная, 0,018 дюймов (0,46 мм) x 0,022 дюйма (0,56 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Thermal Active, сечение прямоугольное, форма Квадратная, 0,018 дюймов (0,46 мм) x 0,022 дюйма (0,56 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Thermal Active, сечение прямоугольное, форма Квадратная, 0,018 дюймов (0,46 мм) x 0,025 дюймов (0,64 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Thermal Active, сечение прямоугольное, форма Квадратная, 0,018 дюймов (0,46 мм) x 0,025 дюймов (0,64 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Thermal Active, сечение прямоугольное, форма Квадратная, 0,019 дюймов (0, 48 мм) x 0,025 дюймов (0,64 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Thermal Active, сечение прямоугольное, форма Квадратная, 0,019 дюймов (0, 48 мм) x 0,025 дюймов (0,64 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Thermal Active, сечение круглое, форма Квадратная, 0,020 дюймов (0,51 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Thermal Active, сечение круглое, форма Квадратная, 0,020 дюймов (0,51 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Thermal Active, сечение прямоугольное, форма Квадратная, 0,021 дюймов (0, 53 мм) x 0,025 дюймов (0,64 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Thermal Active, сечение прямоугольное, форма Квадратная, 0,021 дюймов (0, 53 мм) x 0,025 дюймов (0,64 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Thermal Active, сечение круглое, форма Овоид, 0,012 дюймов (0,30 мм) верхняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Thermal Active, сечение круглое, форма Овоид, 0,012 дюймов (0,30 мм) нижняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Thermal Active, сечение круглое, форма Овоид, 0,014 дюймов (0,36 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0111531

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 28 ноября 2022 года № РЗН 2022/18940

Лист 186

- Дуга ортодонтическая NITI Thermal Active, сечение круглое, форма Овоид, 0,014 дюймов (0,36 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Thermal Active, сечение круглое, форма Овоид, 0,016 дюймов (0,41 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Thermal Active, сечение круглое, форма Овоид, 0,016 дюймов (0,41 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Thermal Active, сечение прямоугольное, форма Овоид, 0,016 дюймов (0,41 мм) x 0,016 дюймов (0,41 мм, не более 100 шт.), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Thermal Active, сечение прямоугольное, форма Овоид, 0,016 дюймов (0,41 мм) x 0,016 дюймов (0,41 мм, не более 100 шт.), нижняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Thermal Active, сечение прямоугольное, форма Овоид, 0,016 дюймов (0,41 мм, не более 100 шт.) x 0,022 дюйма (0,56 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Thermal Active, сечение прямоугольное, форма Овоид, 0,016 дюймов (0,41 мм, не более 100 шт.) x 0,022 дюйма (0,56 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Thermal Active, сечение прямоугольное, форма Овоид, 0,017 дюймов (0,43 мм) x 0,022 дюйма (0,56 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Thermal Active, сечение прямоугольное, форма Овоид, 0,017 дюймов (0,43 мм) x 0,022 дюйма (0,56 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Thermal Active, сечение прямоугольное, форма Овоид, 0,017 дюймов (0,43 мм) x 0,025 дюймов (0,64 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Thermal Active, сечение прямоугольное, форма Овоид, 0,017 дюймов (0,43 мм) x 0,025 дюймов (0,64 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Thermal Active, сечение круглое, форма Овоид, 0,018 дюймов (0,46 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Thermal Active, сечение круглое, форма Овоид, 0,018 дюймов (0,46 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Thermal Active, сечение прямоугольное, форма Овоид, 0,018 дюймов (0,46 мм) x 0,022 дюйма (0,56 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Thermal Active, сечение прямоугольное, форма Овоид, 0,018 дюймов (0,46 мм) x 0,022 дюйма (0,56 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Thermal Active, сечение прямоугольное, форма Овоид, 0,018 дюймов (0,46 мм) x 0,025 дюймов (0,64 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0111532

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 28 ноября 2022 года


№ РЗН 2022/18940

Лист 187

- Дуга ортодонтическая NITI Thermal Active, сечение прямоугольное, форма Овоид, 0,018 дюймов (0,46 мм) x 0,025 дюймов (0,64 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Thermal Active, сечение прямоугольное, форма Овоид, 0,019 дюймов (0,48 мм) x 0,025 дюймов (0,64 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Thermal Active, сечение прямоугольное, форма Овоид, 0,019 дюймов (0,48 мм) x 0,025 дюймов (0,64 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Thermal Active, сечение круглое, форма Овоид, 0,020 дюймов (0,51 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Thermal Active, сечение круглое, форма Овоид, 0,020 дюймов (0,51 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Thermal Active, сечение прямоугольное, форма Овоид, 0,021 дюймов (0,53 мм) x 0,025 дюймов (0,64 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Thermal Active, сечение прямоугольное, форма Овоид, 0,021 дюймов (0,53 мм) x 0,025 дюймов (0,64 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Thermal Active, сечение круглое, форма Нейчерал, 0,012 дюймов (0,30 мм) верхняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Thermal Active, сечение круглое, форма Нейчерал, 0,012 дюймов (0,30 мм) нижняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Thermal Active, сечение круглое, форма Нейчерал, 0,014 дюймов (0,36 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Thermal Active, сечение круглое, форма Нейчерал, 0,014 дюймов (0,36 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Thermal Active, сечение круглое, форма Нейчерал, 0,016 дюймов (0,41 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Thermal Active, сечение круглое, форма Нейчерал, 0,016 дюймов (0,41 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Thermal Active, сечение прямоугольное, форма Нейчерал, 0,016 дюймов (0,41 мм) x 0,016 дюймов (0,41 мм, не более 100 шт.), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Thermal Active, сечение прямоугольное, форма Нейчерал, 0,016 дюймов (0,41 мм) x 0,016 дюймов (0,41 мм, не более 100 шт.), нижняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Thermal Active, сечение прямоугольное, форма Нейчерал, 0,016 дюймов (0,41 мм) x 0,022 дюйма (0,56 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Thermal Active, сечение прямоугольное, форма Нейчерал, 0,016 дюймов (0,41 мм) x 0,022 дюйма (0,56 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

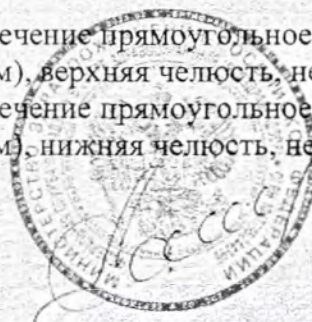

0111533

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 28 ноября 2022 года № РЗН 2022/18940

Лист 188

- Дуга ортодонтическая NITI Thermal Active, сечение прямоугольное, форма Нейчерал, 0,017 дюймов (0,43 мм) x 0,022 дюйма (0,56 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Thermal Active, сечение прямоугольное, форма Нейчерал, 0,017 дюймов (0,43 мм) x 0,022 дюйма (0,56 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Thermal Active, сечение прямоугольное, форма Нейчерал, 0,017 дюймов (0,43 мм) x 0,025 дюймов (0,64 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Thermal Active, сечение прямоугольное, форма Нейчерал, 0,017 дюймов (0,43 мм) x 0,025 дюймов (0,64 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Thermal Active, сечение круглое, форма Нейчерал, 0,018 дюймов (0,46 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Thermal Active, сечение круглое, форма Нейчерал, 0,018 дюймов (0,46 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Thermal Active, сечение прямоугольное, форма Нейчерал, 0,018 дюймов (0,46 мм) x 0,022 дюйма (0,56 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Thermal Active, сечение прямоугольное, форма Нейчерал, 0,018 дюймов (0,46 мм) x 0,022 дюйма (0,56 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Thermal Active, сечение прямоугольное, форма Нейчерал, 0,018 дюймов (0,46 мм) x 0,025 дюймов (0,64 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Thermal Active, сечение прямоугольное, форма Нейчерал, 0,018 дюймов (0,46 мм) x 0,025 дюймов (0,64 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Thermal Active, сечение прямоугольное, форма Нейчерал, 0,019 дюймов (0,48 мм) x 0,025 дюймов (0,64 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Thermal Active, сечение прямоугольное, форма Нейчерал, 0,019 дюймов (0,48 мм) x 0,025 дюймов (0,64 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Thermal Active, сечение круглое, форма Нейчерал, 0,020 дюймов (0,51 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Thermal Active, сечение круглое, форма Нейчерал, 0,020 дюймов (0,51 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Thermal Active, сечение прямоугольное, форма Нейчерал, 0,021 дюймов (0,53 мм) x 0,025 дюймов (0,64 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Thermal Active, сечение прямоугольное, форма Нейчерал, 0,021 дюймов (0,53 мм) x 0,025 дюймов (0,64 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Thermal Active, сечение круглое, форма ЗетЗет, 0,012 дюймов (0,30 мм) верхняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Thermal Active, сечение круглое, форма ЗетЗет, 0,012 дюймов (0,30 мм) нижняя челюсть, не более 1000 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0111534

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 28 ноября 2022 года № РЗН 2022/18940

Лист 189

- Дуга ортодонтическая NITI Thermal Active, сечение круглое, форма ЗетЗет, 0,014 дюймов (0,36 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Thermal Active, сечение круглое, форма ЗетЗет, 0,014 дюймов (0,36 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Thermal Active, сечение круглое, форма ЗетЗет, 0,016 дюймов (0,41 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Thermal Active, сечение круглое, форма ЗетЗет, 0,016 дюймов (0,41 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Thermal Active, сечение прямоугольное, форма ЗетЗет, 0,016 дюймов (0,41 мм) x 0,016 дюймов (0,41 мм, не более 100 шт.), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Thermal Active, сечение прямоугольное, форма ЗетЗет, 0,016 дюймов (0,41 мм) x 0,016 дюймов (0,41 мм, не более 100 шт.), нижняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Thermal Active, сечение прямоугольное, форма ЗетЗет, 0,016 дюймов (0,41 мм) x 0,022 дюйма (0,56 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Thermal Active, сечение прямоугольное, форма ЗетЗет, 0,016 дюймов (0,41 мм) x 0,022 дюйма (0,56 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Thermal Active, сечение прямоугольное, форма ЗетЗет, 0,017 дюймов (0,43 мм) x 0,022 дюйма (0,56 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Thermal Active, сечение прямоугольное, форма ЗетЗет, 0,017 дюймов (0,43 мм) x 0,022 дюйма (0,56 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Thermal Active, сечение прямоугольное, форма ЗетЗет, 0,017 дюймов (0,43 мм) x 0,025 дюймов (0,64 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Thermal Active, сечение прямоугольное, форма ЗетЗет, 0,017 дюймов (0,43 мм) x 0,025 дюймов (0,64 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Thermal Active, сечение круглое, форма ЗетЗет, 0,018 дюймов (0,46 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Thermal Active, сечение круглое, форма ЗетЗет, 0,018 дюймов (0,46 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Thermal Active, сечение прямоугольное, форма ЗетЗет, 0,018 дюймов (0,46 мм) x 0,022 дюйма (0,56 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Thermal Active, сечение прямоугольное, форма ЗетЗет, 0,018 дюймов (0,46 мм) x 0,022 дюйма (0,56 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Thermal Active, сечение прямоугольное, форма ЗетЗет, 0,018 дюймов (0,46 мм) x 0,025 дюймов (0,64 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0111535

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 28 ноября 2022 года

№ РЗН 2022/18940

Лист 190

- Дуга ортодонтическая NITI Thermal Active, сечение прямоугольное, форма ЗетЗет, 0,018 дюймов (0,46 мм) x 0,025 дюймов (0,64 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Thermal Active, сечение прямоугольное, форма ЗетЗет, 0,019 дюймов (0,48 мм) x 0,025 дюймов (0,64 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Thermal Active, сечение прямоугольное, форма ЗетЗет, 0,019 дюймов (0,48 мм) x 0,025 дюймов (0,64 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Thermal Active, сечение круглое, форма ЗетЗет, 0,020 дюймов (0,51 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Thermal Active, сечение круглое, форма ЗетЗет, 0,020 дюймов (0,51 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Thermal Active, сечение прямоугольное, форма ЗетЗет, 0,021 дюймов (0,53 мм) x 0,025 дюймов (0,64 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Thermal Active, сечение прямоугольное, форма ЗетЗет, 0,021 дюймов (0,53 мм) x 0,025 дюймов (0,64 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Thermal Active, Лингвальная, сечение круглое 0,012 дюймов (0,30 мм) верхняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Thermal Active, Лингвальная, сечение круглое 0,012 дюймов (0,30 мм) нижняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Thermal Active, Лингвальная, сечение круглое 0,014 дюймов (0,36 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Thermal Active, Лингвальная, сечение круглое 0,014 дюймов (0,36 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Thermal Active, Лингвальная, сечение круглое 0,016 дюймов (0,41 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Thermal Active, Лингвальная, сечение круглое 0,016 дюймов (0,41 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Thermal Active, Лингвальная, сечение прямоугольное 0,016 дюймов (0,41 мм) x 0,016 дюймов (0,41 мм, не более 100 шт.), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Thermal Active, Лингвальная, сечение прямоугольное 0,016 дюймов (0,41 мм) x 0,016 дюймов (0,41 мм, не более 100 шт.), нижняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Thermal Active, Лингвальная, сечение прямоугольное 0,016 дюймов (0,41 мм) x 0,022 дюйма (0,56 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Thermal Active, Лингвальная, сечение прямоугольное 0,016 дюймов (0,41 мм) x 0,022 дюйма (0,56 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0111536

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 28 ноября 2022 года

№ РЗН 2022/18940

Лист 191

- Дуга ортодонтическая NITI Thermal Active, Лингвальная, сечение прямоугольное 0,017 дюймов (0,43 мм) x 0,022 дюйма (0,56 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Thermal Active, Лингвальная, сечение прямоугольное 0,017 дюймов (0,43 мм) x 0,022 дюйма (0,56 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Thermal Active, Лингвальная, сечение прямоугольное 0,017 дюймов (0,43 мм) x 0,025 дюймов (0,64 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Thermal Active, Лингвальная, сечение прямоугольное 0,017 дюймов (0,43 мм) x 0,025 дюймов (0,64 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Thermal Active, Лингвальная, сечение круглое 0,018 дюймов (0,46 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Thermal Active, Лингвальная, сечение круглое 0,018 дюймов (0,46 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Thermal Active, Лингвальная, сечение прямоугольное 0,018 дюймов (0,46 мм) x 0,018 дюймов (0,46 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Thermal Active, Лингвальная, сечение прямоугольное 0,018 дюймов (0,46 мм) x 0,018 дюймов (0,46 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Thermal Active, Лингвальная, сечение прямоугольное 0,018 дюймов (0,46 мм) x 0,022 дюйма (0,56 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Thermal Active, Лингвальная, сечение прямоугольное 0,018 дюймов (0,46 мм) x 0,022 дюйма (0,56 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Thermal Active, Лингвальная, сечение прямоугольное 0,018 дюймов (0,46 мм) x 0,025 дюймов (0,64 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Thermal Active, Лингвальная, сечение прямоугольное 0,018 дюймов (0,46 мм) x 0,025 дюймов (0,64 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Thermal Active, Лингвальная, сечение прямоугольное 0,019 дюймов (0,48 мм) x 0,025 дюймов (0,64 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Thermal Active, Лингвальная, сечение прямоугольное 0,019 дюймов (0,48 мм) x 0,025 дюймов (0,64 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Thermal Active, Лингвальная, сечение круглое 0,020 дюймов (0,51 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Thermal Active, Лингвальная, сечение круглое 0,020 дюймов (0,51 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Thermal Active, Лингвальная, сечение прямоугольное 0,021 дюймов (0,53 мм) x 0,025 дюймов (0,64 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Thermal Active, Лингвальная, сечение прямоугольное 0,021 дюймов (0,53 мм) x 0,025 дюймов (0,64 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0111537

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 28 ноября 2022 года № РЗН 2022/18940

Лист 192

- Дуга ортодонтическая NITI Thermal Active, сечение круглое, форма Коническая, 0,012 дюймов (0,30 мм) верхняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Thermal Active, сечение круглое, форма Коническая, 0,012 дюймов (0,30 мм) нижняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Thermal Active, сечение круглое, форма Коническая, 0,014 дюймов (0,36 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Thermal Active, сечение круглое, форма Коническая, 0,014 дюймов (0,36 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Thermal Active, сечение круглое, форма Коническая, 0,016 дюймов (0,41 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Thermal Active, сечение круглое, форма Коническая, 0,016 дюймов (0,41 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Thermal Active, сечение прямоугольное, форма Коническая, 0,016 дюймов (0,41 мм) x 0,016 дюймов (0,41 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Thermal Active, сечение прямоугольное, форма Коническая, 0,016 дюймов (0,41 мм) x 0,016 дюймов (0,41 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Thermal Active, сечение прямоугольное, форма Коническая, 0,016 дюймов (0,41 мм) x 0,022 дюйма (0,56 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Thermal Active, сечение прямоугольное, форма Коническая, 0,016 дюймов (0,41 мм) x 0,022 дюйма (0,56 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Thermal Active, сечение прямоугольное, форма Коническая, 0,017 дюймов (0,43 мм) x 0,022 дюйма (0,56 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Thermal Active, сечение прямоугольное, форма Коническая, 0,017 дюймов (0,43 мм) x 0,022 дюйма (0,56 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Thermal Active, сечение прямоугольное, форма Коническая, 0,017 дюймов (0,43 мм) x 0,025 дюймов (0,64 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Thermal Active, сечение прямоугольное, форма Коническая, 0,017 дюймов (0,43 мм) x 0,025 дюймов (0,64 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0111538

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 28 ноября 2022 года

№ РЗН 2022/18940

Лист 193

- Дуга ортодонтическая NITI Thermal Active, сечение круглое, форма Коническая, 0,018 дюймов (0,46 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Thermal Active, сечение круглое, форма Коническая, 0,018 дюймов (0,46 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Thermal Active, сечение прямоугольное, форма Коническая, 0,018 дюймов (0,46 мм) x 0,022 дюйма (0,56 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Thermal Active, сечение прямоугольное, форма Коническая, 0,018 дюймов (0,46 мм) x 0,022 дюйма (0,56 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Thermal Active, сечение прямоугольное, форма Коническая, 0,018 дюймов (0,46 мм) x 0,025 дюймов (0,64 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Thermal Active, сечение прямоугольное, форма Коническая, 0,018 дюймов (0,46 мм) x 0,025 дюймов (0,64 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Thermal Active, сечение прямоугольное, форма Коническая, 0,019 дюймов (0, 48 мм) x 0,025 дюймов (0,64 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Thermal Active, сечение прямоугольное, форма Коническая, 0,019 дюймов (0, 48 мм) x 0,025 дюймов (0,64 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Thermal Active, сечение круглое, форма Коническая, 0,020 дюймов (0,51 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Thermal Active, сечение круглое, форма Коническая, 0,020 дюймов (0,51 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Thermal Active, сечение прямоугольное, форма Коническая, 0,021 дюймов (0, 53 мм) x 0,025 дюймов (0,64 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Thermal Active, сечение прямоугольное, форма Коническая, 0,021 дюймов (0, 53 мм) x 0,025 дюймов (0,64 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Thermal Active, сечение круглое, форма Даймон, 0,012 дюймов (0,30 мм) верхняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Thermal Active, сечение круглое, форма Даймон, 0,012 дюймов (0,30 мм) нижняя челюсть, не более 1000 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0111539

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 28 ноября 2022 года

№ РЗН 2022/18940

Лист 194

- Дуга ортодонтическая NITI Thermal Active, сечение круглое, форма Даймон, 0,014 дюймов (0,36 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Thermal Active, сечение круглое, форма Даймон, 0,014 дюймов (0,36 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Thermal Active, сечение круглое, форма Даймон, 0,016 дюймов (0,41 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Thermal Active, сечение круглое, форма Даймон, 0,016 дюймов (0,41 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Thermal Active, сечение прямоугольное, форма Даймон, 0,016 дюймов (0,41 мм) x 0,016 дюймов (0,41 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Thermal Active, сечение прямоугольное, форма Даймон, 0,016 дюймов (0,41 мм) x 0,016 дюймов (0,41 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Thermal Active, сечение прямоугольное, форма Даймон, 0,016 дюймов (0,41 мм) x 0,022 дюйма (0,56 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Thermal Active, сечение прямоугольное, форма Даймон, 0,016 дюймов (0,41 мм) x 0,022 дюйма (0,56 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Thermal Active, сечение прямоугольное, форма Даймон, 0,017 дюймов (0,43 мм) x 0,022 дюйма (0,56 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Thermal Active, сечение прямоугольное, форма Даймон, 0,017 дюймов (0,43 мм) x 0,022 дюйма (0,56 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Thermal Active, сечение прямоугольное, форма Даймон, 0,017 дюймов (0,43 мм) x 0,025 дюймов (0,64 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Thermal Active, сечение прямоугольное, форма Даймон, 0,017 дюймов (0,43 мм) x 0,025 дюймов (0,64 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Thermal Active, сечение круглое, форма Даймон, 0,018 дюймов (0,46 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Thermal Active, сечение круглое, форма Даймон, 0,018 дюймов (0,46 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Thermal Active, сечение прямоугольное, форма Даймон, 0,018 дюймов (0,46 мм) x 0,018 дюймов (0,46 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Thermal Active, сечение прямоугольное, форма Даймон, 0,018 дюймов (0,46 мм) x 0,018 дюймов (0,46 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Thermal Active, сечение прямоугольное, форма Даймон, 0,018 дюймов (0,46 мм) x 0,022 дюйма (0,56 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Thermal Active, сечение прямоугольное, форма Даймон, 0,018 дюймов (0,46 мм) x 0,022 дюйма (0,56 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0111540

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 28 ноября 2022 года № РЗН 2022/18940

Лист 195

- Дуга ортодонтическая NITI Thermal Active, сечение прямоугольное, форма Даймон, 0,018 дюймов (0,46 мм) x 0,025 дюймов (0,64 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Thermal Active, сечение прямоугольное, форма Даймон, 0,018 дюймов (0,46 мм) x 0,025 дюймов (0,64 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Thermal Active, сечение прямоугольное, форма Даймон, 0,019 дюймов (0,48 мм) x 0,025 дюймов (0,64 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Thermal Active, сечение прямоугольное, форма Даймон, 0,019 дюймов (0,48 мм) x 0,025 дюймов (0,64 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Thermal Active, сечение круглое, форма Даймон, 0,020 дюймов (0,51 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Thermal Active, сечение круглое, форма Даймон, 0,020 дюймов (0,51 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Thermal Active, сечение прямоугольное, форма Даймон, 0,020 дюймов (0,51 мм) x 0,020 дюймов (0,51 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Thermal Active, сечение прямоугольное, форма Даймон, 0,020 дюймов (0,51 мм) x 0,020 дюймов (0,51 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Thermal Active, сечение прямоугольное, форма Даймон, 0,021 дюймов (0,53 мм) x 0,025 дюймов (0,64 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая NITI Thermal Active, сечение прямоугольное, форма Даймон, 0,021 дюймов (0,53 мм) x 0,025 дюймов (0,64 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.
- 6. Дуга ортодонтическая Orthoshape Stainless Steel, в вариантах исполнения:
 - Дуга ортодонтическая Stainless Steel, сечение круглое, форма Квадратная, 0,012 дюймов (0,30 мм) верхняя челюсть, не более 100 упаковок (10 шт./уп.)
 - Дуга ортодонтическая Stainless Steel, сечение круглое, форма Квадратная, 0,012 дюймов (0,30 мм) нижняя челюсть, не более 100 упаковок (10 шт./уп.)
 - Дуга ортодонтическая Stainless Steel, сечение круглое, форма Квадратная, 0,014 дюймов (0,36 мм), верхняя челюсть, не более 100 упаковок (10 шт./уп.)
 - Дуга ортодонтическая Stainless Steel, сечение круглое, форма Квадратная, 0,014 дюймов (0,36 мм), нижняя челюсть, не более 100 упаковок (10 шт./уп.)
 - Дуга ортодонтическая Stainless Steel, сечение круглое, форма Квадратная, 0,016 дюймов (0,41 мм), верхняя челюсть, не более 100 упаковок (10 шт./уп.)
 - Дуга ортодонтическая Stainless Steel, сечение круглое, форма Квадратная, 0,016 дюймов (0,41 мм), нижняя челюсть, не более 100 упаковок (10 шт./уп.)
 - Дуга ортодонтическая Stainless Steel, сечение прямоугольное, форма Квадратная, 0,016 дюймов (0,41 мм) x 0,016 дюймов (0,41 мм), не более 100 шт., верхняя челюсть, не более 100 упаковок (10 шт./уп.)

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0111541

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 28 ноября 2022 года

№ РЗН 2022/18940

Лист 196

- Дуга ортодонтическая Stainless Steel, сечение прямоугольное, форма Квадратная, 0,016 дюймов (0,41 мм) x 0,016 дюймов (0,41 мм), не более 100 шт.), нижняя челюсть, не более 100 упаковок (10 шт./уп.)
- Дуга ортодонтическая Stainless Steel, сечение прямоугольное, форма Квадратная, 0,016 дюймов (0,41 мм) x 0,022 дюйма (0,56 мм), верхняя челюсть, не более 100 упаковок (10 шт./уп.)
- Дуга ортодонтическая Stainless Steel, сечение прямоугольное, форма Квадратная, 0,016 дюймов (0,41 мм) x 0,022 дюйма (0,56 мм), нижняя челюсть, не более 100 упаковок (10 шт./уп.)
- Дуга ортодонтическая Stainless Steel, сечение прямоугольное, форма Квадратная, 0,017 дюймов (0,43 мм) x 0,022 дюйма (0,56 мм), верхняя челюсть, не более 100 упаковок (10 шт./уп.)
- Дуга ортодонтическая Stainless Steel, сечение прямоугольное, форма Квадратная, 0,017 дюймов (0,43 мм) x 0,022 дюйма (0,56 мм), нижняя челюсть, не более 100 упаковок (10 шт./уп.)
- Дуга ортодонтическая Stainless Steel, сечение прямоугольное, форма Квадратная, 0,017 дюймов (0,43 мм) x 0,025 дюймов (0,64 мм), верхняя челюсть, не более 100 упаковок (10 шт./уп.)
- Дуга ортодонтическая Stainless Steel, сечение прямоугольное, форма Квадратная, 0,017 дюймов (0,43 мм) x 0,025 дюймов (0,64 мм), нижняя челюсть, не более 100 упаковок (10 шт./уп.)
- Дуга ортодонтическая Stainless Steel, сечение круглое, форма Квадратная, 0,018 дюймов (0,46 мм), верхняя челюсть, не более 100 упаковок (10 шт./уп.)
- Дуга ортодонтическая Stainless Steel, сечение круглое, форма Квадратная, 0,018 дюймов (0,46 мм), нижняя челюсть, не более 100 упаковок (10 шт./уп.)
- Дуга ортодонтическая Stainless Steel, сечение прямоугольное, форма Квадратная, 0,018 дюймов (0,46 мм) x 0,022 дюйма (0,56 мм), верхняя челюсть, не более 100 упаковок (10 шт./уп.)
- Дуга ортодонтическая Stainless Steel, сечение прямоугольное, форма Квадратная, 0,018 дюймов (0,46 мм) x 0,022 дюйма (0,56 мм), нижняя челюсть, не более 100 упаковок (10 шт./уп.)
- Дуга ортодонтическая Stainless Steel, сечение прямоугольное, форма Квадратная, 0,018 дюймов (0,46 мм) x 0,025 дюймов (0,64 мм), верхняя челюсть, не более 100 упаковок (10 шт./уп.)
- Дуга ортодонтическая Stainless Steel, сечение прямоугольное, форма Квадратная, 0,018 дюймов (0,46 мм) x 0,025 дюймов (0,64 мм), нижняя челюсть, не более 100 упаковок (10 шт./уп.)

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0111542

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 28 ноября 2022 года

№ РЗН 2022/18940

Лист 197

упаковок (10 шт./уп.)

- Дуга ортодонтическая Stainless Steel, сечение прямоугольное, форма Квадратная, 0,019 дюймов (0,48 мм) x 0,025 дюймов (0,64 мм), верхняя челюсть, не более 100 упаковок (10 шт./уп.)

- Дуга ортодонтическая Stainless Steel, сечение прямоугольное, форма Квадратная, 0,019 дюймов (0,48 мм) x 0,025 дюймов (0,64 мм), нижняя челюсть, не более 100 упаковок (10 шт./уп.)

- Дуга ортодонтическая Stainless Steel, сечение круглое, форма Квадратная, 0,020 дюймов (0,51 мм), верхняя челюсть, не более 100 упаковок (10 шт./уп.)

- Дуга ортодонтическая Stainless Steel, сечение круглое, форма Квадратная, 0,020 дюймов (0,51 мм), нижняя челюсть, не более 100 упаковок (10 шт./уп.)

- Дуга ортодонтическая Stainless Steel, сечение прямоугольное, форма Квадратная, 0,021 дюймов (0,53 мм) x 0,025 дюймов (0,64 мм), верхняя челюсть, не более 100 упаковок (10 шт./уп.)

- Дуга ортодонтическая Stainless Steel, сечение прямоугольное, форма Квадратная, 0,021 дюймов (0,53 мм) x 0,025 дюймов (0,64 мм), нижняя челюсть, не более 100 упаковок (10 шт./уп.)

- Дуга ортодонтическая Stainless Steel, сечение круглое, форма Овоид, 0,012 дюймов (0,30 мм) верхняя челюсть, не более 100 упаковок (10 шт./уп.)

- Дуга ортодонтическая Stainless Steel, сечение круглое, форма Овоид, 0,012 дюймов (0,30 мм) нижняя челюсть, не более 100 упаковок (10 шт./уп.)

- Дуга ортодонтическая Stainless Steel, сечение круглое, форма Овоид, 0,014 дюймов (0,36 мм), верхняя челюсть, не более 100 упаковок (10 шт./уп.)

- Дуга ортодонтическая Stainless Steel, сечение круглое, форма Овоид, 0,014 дюймов (0,36 мм), нижняя челюсть, не более 100 упаковок (10 шт./уп.)

- Дуга ортодонтическая Stainless Steel, сечение круглое, форма Овоид, 0,016 дюймов (0,41 мм), верхняя челюсть, не более 100 упаковок (10 шт./уп.)

- Дуга ортодонтическая Stainless Steel, сечение круглое, форма Овоид, 0,016 дюймов (0,41 мм), нижняя челюсть, не более 100 упаковок (10 шт./уп.)

- Дуга ортодонтическая Stainless Steel, сечение прямоугольное, форма Овоид, 0,016 дюймов (0,41 мм) x 0,016 дюймов (0,41 мм), верхняя челюсть, не более 100 упаковок (10 шт./уп.)

- Дуга ортодонтическая Stainless Steel, сечение прямоугольное, форма Овоид, 0,016 дюймов (0,41 мм) x 0,016 дюймов (0,41 мм), нижняя челюсть, не более 100 упаковок (10 шт./уп.)

- Дуга ортодонтическая Stainless Steel, сечение прямоугольное, форма Овоид, 0,016

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0111543

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 28 ноября 2022 года № РЗН 2022/18940

Лист 198

дюймов (0,41 мм) x 0,022 дюйма (0,56 мм), верхняя челюсть, не более 100 упаковок (10 шт./уп.)

- Дуга ортодонтическая Stainless Steel, сечение прямоугольное, форма Овоид, 0,016 дюймов (0,41 мм) x 0,022 дюйма (0,56 мм), нижняя челюсть, не более 100 упаковок (10 шт./уп.)

- Дуга ортодонтическая Stainless Steel, сечение прямоугольное, форма Овоид, 0,017 дюймов (0,43 мм) x 0,022 дюйма (0,56 мм), верхняя челюсть, не более 100 упаковок (10 шт./уп.)

- Дуга ортодонтическая Stainless Steel, сечение прямоугольное, форма Овоид, 0,017 дюймов (0,43 мм) x 0,022 дюйма (0,56 мм), нижняя челюсть, не более 100 упаковок (10 шт./уп.)

- Дуга ортодонтическая Stainless Steel, сечение прямоугольное, форма Овоид, 0,017 дюймов (0,43 мм) x 0,025 дюймов (0,64 мм), верхняя челюсть, не более 100 упаковок (10 шт./уп.)

- Дуга ортодонтическая Stainless Steel, сечение прямоугольное, форма Овоид, 0,017 дюймов (0,43 мм) x 0,025 дюймов (0,64 мм), нижняя челюсть, не более 100 упаковок (10 шт./уп.)

- Дуга ортодонтическая Stainless Steel, сечение круглое, форма Овоид, 0,018 дюймов (0,46 мм), верхняя челюсть, не более 100 упаковок (10 шт./уп.)

- Дуга ортодонтическая Stainless Steel, сечение круглое, форма Овоид, 0,018 дюймов (0,46 мм), нижняя челюсть, не более 100 упаковок (10 шт./уп.)

- Дуга ортодонтическая Stainless Steel, сечение прямоугольное, форма Овоид, 0,018 дюймов (0,46 мм) x 0,022 дюйма (0,56 мм), верхняя челюсть, не более 100 упаковок (10 шт./уп.)


- Дуга ортодонтическая Stainless Steel, сечение прямоугольное, форма Овоид, 0,018 дюймов (0,46 мм) x 0,022 дюйма (0,56 мм), нижняя челюсть, не более 100 упаковок (10 шт./уп.)

- Дуга ортодонтическая Stainless Steel, сечение прямоугольное, форма Овоид, 0,018 дюймов (0,46 мм) x 0,025 дюймов (0,64 мм), верхняя челюсть, не более 100 упаковок (10 шт./уп.)

- Дуга ортодонтическая Stainless Steel, сечение прямоугольное, форма Овоид, 0,018 дюймов (0,46 мм) x 0,025 дюймов (0,64 мм), нижняя челюсть, не более 100 упаковок (10 шт./уп.)

- Дуга ортодонтическая Stainless Steel, сечение прямоугольное, форма Овоид, 0,019 дюймов (0,48 мм) x 0,025 дюймов (0,64 мм), верхняя челюсть, не более 100 упаковок (10 шт./уп.)

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

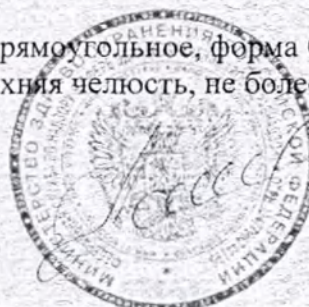

А.В. Самойлова

0111544

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 28 ноября 2022 года

№ РЗН 2022/18940

Лист 199

- Дуга ортодонтическая Stainless Steel, сечение прямоугольное, форма Овоид, 0,019 дюймов (0,48 мм) x 0,025 дюймов (0,64 мм), нижняя челюсть, не более 100 упаковок (10 шт./уп.)
- Дуга ортодонтическая Stainless Steel, сечение круглое, форма Овоид, 0,020 дюймов (0,51 мм), верхняя челюсть, не более 100 упаковок (10 шт./уп.)
- Дуга ортодонтическая Stainless Steel, сечение круглое, форма Овоид, 0,020 дюймов (0,51 мм), нижняя челюсть, не более 100 упаковок (10 шт./уп.)
- Дуга ортодонтическая Stainless Steel, сечение прямоугольное, форма Овоид, 0,021 дюймов (0,53 мм) x 0,025 дюймов (0,64 мм), верхняя челюсть, не более 100 упаковок (10 шт./уп.)
- Дуга ортодонтическая Stainless Steel, сечение прямоугольное, форма Овоид, 0,021 дюймов (0,53 мм) x 0,025 дюймов (0,64 мм), нижняя челюсть, не более 100 упаковок (10 шт./уп.)
- Дуга ортодонтическая Stainless Steel, сечение круглое, форма Нейчерал, 0,012 дюймов (0,30 мм) верхняя челюсть, не более 100 упаковок (10 шт./уп.)
- Дуга ортодонтическая Stainless Steel, сечение круглое, форма Нейчерал, 0,012 дюймов (0,30 мм) нижняя челюсть, не более 100 упаковок (10 шт./уп.)
- Дуга ортодонтическая Stainless Steel, сечение круглое, форма Нейчерал, 0,013 дюймов (0,33 мм), верхняя челюсть, не более 100 упаковок (10 шт./уп.)
- Дуга ортодонтическая Stainless Steel, сечение круглое, форма Нейчерал, 0,013 дюймов (0,33 мм), нижняя челюсть, не более 100 упаковок (10 шт./уп.)
- Дуга ортодонтическая Stainless Steel, сечение круглое, форма Нейчерал, 0,014 дюймов (0,36 мм), верхняя челюсть, не более 100 упаковок (10 шт./уп.)
- Дуга ортодонтическая Stainless Steel, сечение круглое, форма Нейчерал, 0,014 дюймов (0,36 мм), нижняя челюсть, не более 100 упаковок (10 шт./уп.)
- Дуга ортодонтическая Stainless Steel, сечение круглое, форма Нейчерал, 0,016 дюймов (0,41 мм), верхняя челюсть, не более 100 упаковок (10 шт./уп.)
- Дуга ортодонтическая Stainless Steel, сечение круглое, форма Нейчерал, 0,016 дюймов (0,41 мм), нижняя челюсть, не более 100 упаковок (10 шт./уп.)
- Дуга ортодонтическая Stainless Steel, сечение прямоугольное, форма Нейчерал, 0,016 дюймов (0,41 мм) x 0,016 дюймов (0,41 мм), верхняя челюсть, не более 100 упаковок (10 шт./уп.)
- Дуга ортодонтическая Stainless Steel, сечение прямоугольное, форма Нейчерал, 0,016 дюймов (0,41 мм) x 0,016 дюймов (0,41 мм), нижняя челюсть, не более 100 упаковок (10 шт./уп.)
- Дуга ортодонтическая Stainless Steel, сечение прямоугольное, форма Нейчерал, 0,016

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0111545

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 28 ноября 2022 года № РЗН 2022/18940

Лист 200

дюймов (0,41 мм) x 0,022 дюйма (0,56 мм), верхняя челюсть, не более 100 упаковок (10 шт./уп.)

- Дуга ортодонтическая Stainless Steel, сечение прямоугольное, форма Нейчерал, 0,016 дюймов (0,41 мм) x 0,022 дюйма (0,56 мм), нижняя челюсть, не более 100 упаковок (10 шт./уп.)

- Дуга ортодонтическая Stainless Steel, сечение прямоугольное, форма Нейчерал, 0,017 дюймов (0,43 мм) x 0,022 дюйма (0,56 мм), верхняя челюсть, не более 100 упаковок (10 шт./уп.)

- Дуга ортодонтическая Stainless Steel, сечение прямоугольное, форма Нейчерал, 0,017 дюймов (0,43 мм) x 0,022 дюйма (0,56 мм), нижняя челюсть, не более 100 упаковок (10 шт./уп.)

- Дуга ортодонтическая Stainless Steel, сечение прямоугольное, форма Нейчерал, 0,017 дюймов (0,43 мм) x 0,025 дюймов (0,64 мм), верхняя челюсть, не более 100 упаковок (10 шт./уп.)

- Дуга ортодонтическая Stainless Steel, сечение прямоугольное, форма Нейчерал, 0,017 дюймов (0,43 мм) x 0,025 дюймов (0,64 мм), нижняя челюсть, не более 100 упаковок (10 шт./уп.)

- Дуга ортодонтическая Stainless Steel, сечение круглое, форма Нейчерал, 0,018 дюймов (0,46 мм), верхняя челюсть, не более 100 упаковок (10 шт./уп.)

- Дуга ортодонтическая Stainless Steel, сечение круглое, форма Нейчерал, 0,018 дюймов (0,46 мм), нижняя челюсть, не более 100 упаковок (10 шт./уп.)

- Дуга ортодонтическая Stainless Steel, сечение прямоугольное, форма Нейчерал, 0,018 дюймов (0,46 мм) x 0,022 дюйма (0,56 мм), верхняя челюсть, не более 100 упаковок (10 шт./уп.)

- Дуга ортодонтическая Stainless Steel, сечение прямоугольное, форма Нейчерал, 0,018 дюймов (0,46 мм) x 0,022 дюйма (0,56 мм), нижняя челюсть, не более 100 упаковок (10 шт./уп.)

- Дуга ортодонтическая Stainless Steel, сечение прямоугольное, форма Нейчерал, 0,018 дюймов (0,46 мм) x 0,025 дюймов (0,64 мм), верхняя челюсть, не более 100 упаковок (10 шт./уп.)

- Дуга ортодонтическая Stainless Steel, сечение прямоугольное, форма Нейчерал, 0,018 дюймов (0,46 мм) x 0,025 дюймов (0,64 мм), нижняя челюсть, не более 100 упаковок (10 шт./уп.)

- Дуга ортодонтическая Stainless Steel, сечение прямоугольное, форма Нейчерал, 0,019 дюймов (0,48 мм) x 0,025 дюймов (0,64 мм), верхняя челюсть, не более 100 упаковок (10 шт./уп.)

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова



0111546

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 28 ноября 2022 года

№ РЗН 2022/18940

Лист 201

- Дуга ортодонтическая Stainless Steel, сечение прямоугольное, форма Нейчерал, 0,019 дюймов (0,48 мм) x 0,025 дюймов (0,64 мм), нижняя челюсть, не более 100 упаковок (10 шт./уп.)
- Дуга ортодонтическая Stainless Steel, сечение круглое, форма Нейчерал, 0,020 дюймов (0,51 мм), верхняя челюсть, не более 100 упаковок (10 шт./уп.)
- Дуга ортодонтическая Stainless Steel, сечение круглое, форма Нейчерал, 0,020 дюймов (0,51 мм), нижняя челюсть, не более 100 упаковок (10 шт./уп.)
- Дуга ортодонтическая Stainless Steel, сечение прямоугольное, форма Нейчерал, 0,021 дюймов (0,53 мм) x 0,025 дюймов (0,64 мм), верхняя челюсть, не более 100 упаковок (10 шт./уп.)
- Дуга ортодонтическая Stainless Steel, сечение прямоугольное, форма Нейчерал, 0,021 дюймов (0,53 мм) x 0,025 дюймов (0,64 мм), нижняя челюсть, не более 100 упаковок (10 шт./уп.)
- Дуга ортодонтическая Stainless Steel, сечение круглое, форма ЗетЗет, 0,012 дюймов (0,30 мм) верхняя челюсть, не более 100 упаковок (10 шт./уп.)
- Дуга ортодонтическая Stainless Steel, сечение круглое, форма ЗетЗет, 0,012 дюймов (0,30 мм) нижняя челюсть, не более 100 упаковок (10 шт./уп.)
- Дуга ортодонтическая Stainless Steel, сечение круглое, форма ЗетЗет, 0,014 дюймов (0,36 мм), верхняя челюсть, не более 100 упаковок (10 шт./уп.)
- Дуга ортодонтическая Stainless Steel, сечение круглое, форма ЗетЗет, 0,014 дюймов (0,36 мм), нижняя челюсть, не более 100 упаковок (10 шт./уп.)
- Дуга ортодонтическая Stainless Steel, сечение круглое, форма ЗетЗет, 0,016 дюймов (0,41 мм), верхняя челюсть, не более 100 упаковок (10 шт./уп.)
- Дуга ортодонтическая Stainless Steel, сечение круглое, форма ЗетЗет, 0,016 дюймов (0,41 мм), нижняя челюсть, не более 100 упаковок (10 шт./уп.)
- Дуга ортодонтическая Stainless Steel, сечение прямоугольное, форма ЗетЗет, 0,016 дюймов (0,41 мм) x 0,016 дюймов (0,41 мм), верхняя челюсть, не более 100 упаковок (10 шт./уп.)
- Дуга ортодонтическая Stainless Steel, сечение прямоугольное, форма ЗетЗет, 0,016 дюймов (0,41 мм) x 0,016 дюймов (0,41 мм), нижняя челюсть, не более 100 упаковок (10 шт./уп.)
- Дуга ортодонтическая Stainless Steel, сечение прямоугольное, форма ЗетЗет, 0,016 дюймов (0,41 мм) x 0,022 дюйма (0,56 мм), верхняя челюсть, не более 100 упаковок (10 шт./уп.)
- Дуга ортодонтическая Stainless Steel, сечение прямоугольное, форма ЗетЗет, 0,016 дюймов (0,41 мм) x 0,022 дюйма (0,56 мм), нижняя челюсть, не более 100 упаковок (10 шт./уп.)

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0111547

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 28 ноября 2022 года № РЗН 2022/18940

Лист 202

шт./уп.)

- Дуга ортодонтическая Stainless Steel, сечение прямоугольное, форма ЗетЗет, 0,017 дюймов (0,43 мм) x 0,022 дюйма (0,56 мм), верхняя челюсть, не более 100 упаковок (10 шт./уп.)

- Дуга ортодонтическая Stainless Steel, сечение прямоугольное, форма ЗетЗет, 0,017 дюймов (0,43 мм) x 0,022 дюйма (0,56 мм), нижняя челюсть, не более 100 упаковок (10 шт./уп.)

- Дуга ортодонтическая Stainless Steel, сечение прямоугольное, форма ЗетЗет, 0,017 дюймов (0,43 мм) x 0,025 дюймов (0,64 мм), верхняя челюсть, не более 100 упаковок (10 шт./уп.)

- Дуга ортодонтическая Stainless Steel, сечение прямоугольное, форма ЗетЗет, 0,017 дюймов (0,43 мм) x 0,025 дюймов (0,64 мм), нижняя челюсть, не более 100 упаковок (10 шт./уп.)

- Дуга ортодонтическая Stainless Steel, сечение круглое, форма ЗетЗет, 0,018 дюймов (0,46 мм), верхняя челюсть, не более 100 упаковок (10 шт./уп.)

- Дуга ортодонтическая Stainless Steel, сечение круглое, форма ЗетЗет, 0,018 дюймов (0,46 мм), нижняя челюсть, не более 100 упаковок (10 шт./уп.)

- Дуга ортодонтическая Stainless Steel, сечение прямоугольное, форма ЗетЗет, 0,018 дюймов (0,46 мм) x 0,022 дюйма (0,56 мм), верхняя челюсть, не более 100 упаковок (10 шт./уп.)

- Дуга ортодонтическая Stainless Steel, сечение прямоугольное, форма ЗетЗет, 0,018 дюймов (0,46 мм) x 0,022 дюйма (0,56 мм), нижняя челюсть, не более 100 упаковок (10 шт./уп.)

- Дуга ортодонтическая Stainless Steel, сечение прямоугольное, форма ЗетЗет, 0,018 дюймов (0,46 мм) x 0,025 дюймов (0,64 мм), верхняя челюсть, не более 100 упаковок (10 шт./уп.)

- Дуга ортодонтическая Stainless Steel, сечение прямоугольное, форма ЗетЗет, 0,018 дюймов (0,46 мм) x 0,025 дюймов (0,64 мм), нижняя челюсть, не более 100 упаковок (10 шт./уп.)

- Дуга ортодонтическая Stainless Steel, сечение прямоугольное, форма ЗетЗет, 0,019 дюймов (0,48 мм) x 0,025 дюймов (0,64 мм), верхняя челюсть, не более 100 упаковок (10 шт./уп.)

- Дуга ортодонтическая Stainless Steel, сечение прямоугольное, форма ЗетЗет, 0,019 дюймов (0,48 мм) x 0,025 дюймов (0,64 мм), нижняя челюсть, не более 100 упаковок (10 шт./уп.)

- Дуга ортодонтическая Stainless Steel, сечение круглое, форма ЗетЗет, 0,020 дюймов

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0111548

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 28 ноября 2022 года № РЗН 2022/18940

Лист 203

- (0,51 мм), верхняя челюсть, не более 100 упаковок (10 шт./уп.)
- Дуга ортодонтическая Stainless Steel, сечение круглое, форма ЗетЗет, 0,020 дюймов (0,51 мм), нижняя челюсть, не более 100 упаковок (10 шт./уп.)
 - Дуга ортодонтическая Stainless Steel, сечение прямоугольное, форма ЗетЗет, 0,021 дюймов (0,53 мм) x 0,025 дюймов (0,64 мм), верхняя челюсть, не более 100 упаковок (10 шт./уп.)
 - Дуга ортодонтическая Stainless Steel, сечение прямоугольное, форма ЗетЗет, 0,021 дюймов (0,53 мм) x 0,025 дюймов (0,64 мм), нижняя челюсть, не более 100 упаковок (10 шт./уп.)
 - Дуга ортодонтическая Stainless Steel, Лингвальная, сечение круглое, 0,012 дюймов (0,30 мм), верхняя челюсть, не более 100 упаковок (10 шт./уп.)
 - Дуга ортодонтическая Stainless Steel, Лингвальная, сечение круглое 0,012 дюймов (0,30 мм) нижняя челюсть, не более 100 упаковок (10 шт./уп.)
 - Дуга ортодонтическая Stainless Steel, Лингвальная, сечение круглое, 0,014 дюймов (0,36 мм), верхняя челюсть, не более 100 упаковок (10 шт./уп.)
 - Дуга ортодонтическая Stainless Steel, Лингвальная, сечение круглое, 0,014 дюймов (0,36 мм), нижняя челюсть, не более 100 упаковок (10 шт./уп.)
 - Дуга ортодонтическая Stainless Steel, Лингвальная, сечение круглое, 0,016 дюймов (0,41 мм), верхняя челюсть, не более 100 упаковок (10 шт./уп.)
 - Дуга ортодонтическая Stainless Steel, Лингвальная, сечение круглое, 0,016 дюймов (0,41 мм), нижняя челюсть, не более 100 упаковок (10 шт./уп.)
 - Дуга ортодонтическая Stainless Steel, Лингвальная, сечение прямоугольное, 0,016 дюймов (0,41 мм) x 0,016 дюймов (0,41 мм), верхняя челюсть, не более 100 упаковок (10 шт./уп.)
 - Дуга ортодонтическая Stainless Steel, Лингвальная, сечение прямоугольное 0,016 дюймов (0,41 мм) x 0,016 дюймов (0,41 мм), нижняя челюсть, не более 100 упаковок (10 шт./уп.)
 - Дуга ортодонтическая Stainless Steel, Лингвальная, сечение прямоугольное 0,016 дюймов (0,41 мм) x 0,022 дюйма (0,56 мм), верхняя челюсть, не более 100 упаковок (10 шт./уп.)
 - Дуга ортодонтическая Stainless Steel, Лингвальная, сечение прямоугольное 0,016 дюймов (0,41 мм) x 0,022 дюйма (0,56 мм), нижняя челюсть, не более 100 упаковок (10 шт./уп.)
 - Дуга ортодонтическая Stainless Steel, Лингвальная, сечение прямоугольное 0,017 дюймов (0,43 мм) x 0,022 дюйма (0,56 мм), верхняя челюсть, не более 100 упаковок (10 шт./уп.)

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова



0111549

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 28 ноября 2022 года № РЗН 2022/18940

Лист 204

- Дуга ортодонтическая Stainless Steel, Лингвальная, сечение прямоугольное 0,017 дюймов (0,43 мм) x 0,022 дюйма (0,56 мм), нижняя челюсть, не более 100 упаковок (10 шт./уп.)
- Дуга ортодонтическая Stainless Steel, Лингвальная, сечение прямоугольное 0,017 дюймов (0,43 мм) x 0,025 дюймов (0,64 мм), верхняя челюсть, не более 100 упаковок (10 шт./уп.)
- 0,017 дюймов (0,43 мм) x 0,025 дюймов (0,64 мм), нижняя челюсть, не более 100 упаковок (10 шт./уп.)
- Дуга ортодонтическая Stainless Steel, Лингвальная, сечение круглое 0,018 дюймов (0,46 мм), верхняя челюсть, не более 100 упаковок (10 шт./уп.)
- Дуга ортодонтическая Stainless Steel, Лингвальная, сечение круглое 0,018 дюймов (0,46 мм), нижняя челюсть, не более 100 упаковок (10 шт./уп.)
- Дуга ортодонтическая Stainless Steel, Лингвальная, сечение прямоугольное 0,018 дюймов (0,46 мм) x 0,022 дюйма (0,56 мм), верхняя челюсть, не более 100 упаковок (10 шт./уп.)
- Дуга ортодонтическая Stainless Steel, Лингвальная, сечение прямоугольное 0,018 дюймов (0,46 мм) x 0,022 дюйма (0,56 мм), нижняя челюсть, не более 100 упаковок (10 шт./уп.)
- Дуга ортодонтическая Stainless Steel, Лингвальная, сечение прямоугольное 0,018 дюймов (0,46 мм) x 0,025 дюймов (0,64 мм), верхняя челюсть, не более 100 упаковок (10 шт./уп.)
- Дуга ортодонтическая Stainless Steel, Лингвальная, сечение прямоугольное 0,018 дюймов (0,46 мм) x 0,025 дюймов (0,64 мм), нижняя челюсть, не более 100 упаковок (10 шт./уп.)
- Дуга ортодонтическая Stainless Steel, Лингвальная, сечение прямоугольное 0,019 дюймов (0, 48 мм) x 0,025 дюймов (0,64 мм), верхняя челюсть, не более 100 упаковок (10 шт./уп.)
- Дуга ортодонтическая Stainless Steel, Лингвальная, сечение прямоугольное 0,019 дюймов (0, 48 мм) x 0,025 дюймов (0,64 мм), нижняя челюсть, не более 100 упаковок (10 шт./уп.)
- Дуга ортодонтическая Stainless Steel, Лингвальная, сечение круглое 0,020 дюймов (0,51 мм), верхняя челюсть, не более 100 упаковок (10 шт./уп.)
- Дуга ортодонтическая Stainless Steel, Лингвальная, сечение круглое 0,020 дюймов (0,51 мм), нижняя челюсть, не более 100 упаковок (10 шт./уп.)
- Дуга ортодонтическая Stainless Steel, Лингвальная, сечение прямоугольное 0,021 дюймов (0, 53 мм) x 0,025 дюймов (0,64 мм), верхняя челюсть, не более 100 упаковок

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0111550

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 28 ноября 2022 года № РЗН 2022/18940

Лист 205

(10 шт./уп.)

- Дуга ортодонтическая Stainless Steel, Лингвальная, сечение прямоугольное 0,021 дюймов (0,53 мм) x 0,025 дюймов (0,64 мм), нижняя челюсть, не более 100 упаковок (10 шт./уп.)

- Дуга ортодонтическая Stainless Steel, сечение круглое, форма Коническая, 0,012 дюймов (0,30 мм), верхняя челюсть, не более 100 упаковок (10 шт./уп.)

- Дуга ортодонтическая Stainless Steel, сечение круглое, форма Коническая, 0,012 дюймов (0,30 мм), нижняя челюсть, не более 100 упаковок (10 шт./уп.)

- Дуга ортодонтическая Stainless Steel, сечение круглое, форма Коническая, 0,014 дюймов (0,36 мм), верхняя челюсть, не более 100 упаковок (10 шт./уп.)

- Дуга ортодонтическая Stainless Steel, сечение круглое, форма Коническая, 0,014 дюймов (0,36 мм), нижняя челюсть, не более 100 упаковок (10 шт./уп.)

- Дуга ортодонтическая Stainless Steel, сечение круглое, форма Коническая, 0,016 дюймов (0,41 мм), верхняя челюсть, не более 100 упаковок (10 шт./уп.)

- Дуга ортодонтическая Stainless Steel, сечение круглое, форма Коническая, 0,016 дюймов (0,41 мм), нижняя челюсть, не более 100 упаковок (10 шт./уп.)

- Дуга ортодонтическая Stainless Steel, сечение прямоугольное, форма Коническая, 0,016 дюймов (0,41 мм) x 0,016 дюймов (0,41 мм) верхняя челюсть, не более 100 упаковок (10 шт./уп.)

- Дуга ортодонтическая Stainless Steel, сечение прямоугольное, форма Коническая, 0,016 дюймов (0,41 мм) x 0,016 дюймов (0,41 мм), нижняя челюсть, не более 100 упаковок (10 шт./уп.)

- Дуга ортодонтическая Stainless Steel, сечение прямоугольное, форма Коническая, 0,016 дюймов (0,41 мм) x 0,022 дюйма (0,56 мм), верхняя челюсть, не более 100 упаковок (10 шт./уп.)

- Дуга ортодонтическая Stainless Steel, сечение прямоугольное, форма Коническая, 0,016 дюймов (0,41 мм) x 0,022 дюйма (0,56 мм), нижняя челюсть, не более 100 упаковок (10 шт./уп.)

- Дуга ортодонтическая Stainless Steel, сечение прямоугольное, форма Коническая, 0,017 x 0,022 дюйма (0,56 мм), верхняя челюсть, не более 100 упаковок (10 шт./уп.)

- Дуга ортодонтическая Stainless Steel, сечение прямоугольное, форма Коническая, 0,017 x 0,022 дюйма (0,56 мм), нижняя челюсть, не более 100 упаковок (10 шт./уп.)

- Дуга ортодонтическая Stainless Steel, сечение прямоугольное, форма Коническая, 0,017 x 0,025 дюймов (0,64 мм), верхняя челюсть, не более 100 упаковок (10 шт./уп.)

- Дуга ортодонтическая Stainless Steel, сечение прямоугольное, форма Коническая, 0,017 x 0,025 дюймов (0,64 мм), нижняя челюсть, не более 100 упаковок (10 шт./уп.)

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0111551

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 28 ноября 2022 года

№ РЗН 2022/18940

Лист 206

- Дуга ортодонтическая Stainless Steel, сечение круглое, форма Коническая, 0,018 дюймов (0,46 мм), верхняя челюсть, не более 100 упаковок (10 шт./уп.)
- Дуга ортодонтическая Stainless Steel, сечение круглое, форма Коническая, 0,018 дюймов (0,46 мм), нижняя челюсть, не более 100 упаковок (10 шт./уп.)
- Дуга ортодонтическая Stainless Steel, сечение прямоугольное, форма Коническая, 0,018 дюймов (0,46 мм) x 0,022 дюйма (0,56 мм), верхняя челюсть, не более 100 упаковок (10 шт./уп.)
- Дуга ортодонтическая Stainless Steel, сечение прямоугольное, форма Коническая, 0,018 дюймов (0,46 мм) x 0,022 дюйма (0,56 мм), нижняя челюсть, не более 100 упаковок (10 шт./уп.)
- Дуга ортодонтическая Stainless Steel, сечение прямоугольное, форма Коническая, 0,018 дюймов (0,46 мм) x 0,025 дюймов (0,64 мм), верхняя челюсть, не более 100 упаковок (10 шт./уп.)
- Дуга ортодонтическая Stainless Steel, сечение прямоугольное, форма Коническая, 0,018 дюймов (0,46 мм) x 0,025 дюймов (0,64 мм), нижняя челюсть, не более 100 упаковок (10 шт./уп.)
- Дуга ортодонтическая Stainless Steel, сечение прямоугольное, форма Коническая, 0,019 дюймов (0,48 мм) x 0,025 дюймов (0,64 мм), верхняя челюсть, не более 100 упаковок (10 шт./уп.)
- Дуга ортодонтическая Stainless Steel, сечение прямоугольное, форма Коническая, 0,019 дюймов (0,48 мм) x 0,025 дюймов (0,64 мм), нижняя челюсть, не более 100 упаковок (10 шт./уп.)
- Дуга ортодонтическая Stainless Steel, сечение круглое, форма Коническая, 0,020 дюймов (0,51 мм), верхняя челюсть, не более 100 упаковок (10 шт./уп.)
- Дуга ортодонтическая Stainless Steel, сечение круглое, форма Коническая, 0,020 дюймов (0,51 мм), нижняя челюсть, не более 100 упаковок (10 шт./уп.)
- Дуга ортодонтическая Stainless Steel, сечение прямоугольное, форма Коническая, 0,021 дюймов (0,53 мм) x 0,025 дюймов (0,64 мм), верхняя челюсть, не более 100 упаковок (10 шт./уп.)
- Дуга ортодонтическая Stainless Steel, сечение прямоугольное, форма Коническая, 0,021 дюймов (0,53 мм) x 0,025 дюймов (0,64 мм), нижняя челюсть, не более 100 упаковок (10 шт./уп.)
- Дуга ортодонтическая Stainless Steel, сечение круглое, форма Даймон, 0,012 дюймов (0,30 мм) верхняя челюсть, не более 100 упаковок (10 шт./уп.)
- Дуга ортодонтическая Stainless Steel, сечение круглое, форма Даймон, 0,012 дюймов (0,30 мм) нижняя челюсть, не более 100 упаковок (10 шт./уп.)

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0111552

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 28 ноября 2022 года № РЗН 2022/18940

Лист 207

- Дуга ортодонтическая Stainless Steel, сечение круглое, форма Даймон, 0,014 дюймов (0,36 мм), верхняя челюсть, не более 100 упаковок (10 шт./уп.)
- Дуга ортодонтическая Stainless Steel, сечение круглое, форма Даймон, 0,014 дюймов (0,36 мм), нижняя челюсть, не более 100 упаковок (10 шт./уп.)
- Дуга ортодонтическая Stainless Steel, сечение круглое, форма Даймон, 0,016 дюймов (0,41 мм), верхняя челюсть, не более 100 упаковок (10 шт./уп.)
- Дуга ортодонтическая Stainless Steel, сечение круглое, форма Даймон, 0,016 дюймов (0,41 мм), нижняя челюсть, не более 100 упаковок (10 шт./уп.)
- Дуга ортодонтическая Stainless Steel, сечение прямоугольное, форма Даймон, 0,016 дюймов (0,41 мм) x 0,016 дюймов (0,41 мм), верхняя челюсть, не более 100 упаковок (10 шт./уп.)
- Дуга ортодонтическая Stainless Steel, сечение прямоугольное, форма Даймон, 0,016 дюймов (0,41 мм) x 0,016 дюймов (0,41 мм), нижняя челюсть, не более 100 упаковок (10 шт./уп.)
- Дуга ортодонтическая Stainless Steel, сечение прямоугольное, форма Даймон, 0,016 дюймов (0,41 мм) x 0,022 дюйма (0,56 мм), верхняя челюсть, не более 100 упаковок (10 шт./уп.)
- Дуга ортодонтическая Stainless Steel, сечение прямоугольное, форма Даймон, 0,016 дюймов (0,41 мм) x 0,022 дюйма (0,56 мм), нижняя челюсть, не более 100 упаковок (10 шт./уп.)
- Дуга ортодонтическая Stainless Steel, сечение прямоугольное, форма Даймон, 0,017 дюймов (0,43 мм) x 0,022 дюйма (0,56 мм), верхняя челюсть, не более 100 упаковок (10 шт./уп.)
- Дуга ортодонтическая Stainless Steel, сечение прямоугольное, форма Даймон, 0,017 дюймов (0,43 мм) x 0,022 дюйма (0,56 мм), нижняя челюсть, не более 100 упаковок (10 шт./уп.)
- Дуга ортодонтическая Stainless Steel, сечение прямоугольное, форма Даймон, 0,017 дюймов (0,43 мм) x 0,025 дюймов (0,64 мм), верхняя челюсть, не более 100 упаковок (10 шт./уп.)
- Дуга ортодонтическая Stainless Steel, сечение прямоугольное, форма Даймон, 0,017 дюймов (0,43 мм) x 0,025 дюймов (0,64 мм), нижняя челюсть, не более 100 упаковок (10 шт./уп.)
- Дуга ортодонтическая Stainless Steel, сечение круглое, форма Даймон, 0,018 дюймов (0,46 мм), верхняя челюсть, не более 100 упаковок (10 шт./уп.)
- Дуга ортодонтическая Stainless Steel, сечение круглое, форма Даймон, 0,018 дюймов (0,46 мм), нижняя челюсть, не более 100 упаковок (10 шт./уп.)

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0111553

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 28 ноября 2022 года № РЗН 2022/18940

Лист 208

- Дуга ортодонтическая Stainless Steel, сечение прямоугольное, форма Даймон, 0,018 дюймов (0,46 мм) x 0,022 дюйма (0,56 мм), верхняя челюсть, не более 100 упаковок (10 шт./уп.)
- Дуга ортодонтическая Stainless Steel, сечение прямоугольное, форма Даймон, 0,018 дюймов (0,46 мм) x 0,022 дюйма (0,56 мм), нижняя челюсть, не более 100 упаковок (10 шт./уп.)
- Дуга ортодонтическая Stainless Steel, сечение прямоугольное, форма Даймон, 0,018 дюймов (0,46 мм) x 0,025 дюймов (0,64 мм), верхняя челюсть, не более 100 упаковок (10 шт./уп.)
- Дуга ортодонтическая Stainless Steel, сечение прямоугольное, форма Даймон, 0,018 дюймов (0,46 мм) x 0,025 дюймов (0,64 мм), нижняя челюсть, не более 100 упаковок (10 шт./уп.)
- Дуга ортодонтическая Stainless Steel, сечение прямоугольное, форма Даймон, 0,019 дюймов (0,48 мм) x 0,025 дюймов (0,64 мм), верхняя челюсть, не более 100 упаковок (10 шт./уп.)
- Дуга ортодонтическая Stainless Steel, сечение прямоугольное, форма Даймон, 0,019 дюймов (0,48 мм) x 0,025 дюймов (0,64 мм), нижняя челюсть, не более 100 упаковок (10 шт./уп.)
- Дуга ортодонтическая Stainless Steel, сечение круглое, форма Даймон, 0,020 дюймов (0,51 мм), верхняя челюсть, не более 100 упаковок (10 шт./уп.)
- Дуга ортодонтическая Stainless Steel, сечение круглое, форма Даймон, 0,020 дюймов (0,51 мм), нижняя челюсть, не более 100 упаковок (10 шт./уп.)
- Дуга ортодонтическая Stainless Steel, сечение прямоугольное, форма Даймон, 0,021 дюймов (0,53 мм) x 0,025 дюймов (0,64 мм), верхняя челюсть, не более 100 упаковок (10 шт./уп.)
- Дуга ортодонтическая Stainless Steel, сечение прямоугольное, форма Даймон, 0,021 дюймов (0,53 мм) x 0,025 дюймов (0,64 мм), нижняя челюсть, не более 100 упаковок (10 шт./уп.)
- Дуга ортодонтическая Stainless Steel, прямоугольная, форма Прямой отрезок, 0,016 дюймов (0,41 мм) x 0,022 дюйма (0,56 мм) не более 100 упаковок (10 шт./уп.)
- Дуга ортодонтическая Stainless Steel, прямоугольная, форма Прямой отрезок, 0,017 x 0,025 дюймов (0,64 мм) не более 100 упаковок (10 шт./уп.)
- Дуга ортодонтическая Stainless Steel, сечение прямоугольное, форма Прямой отрезок, 0,012 дюймов (0,30 мм) не более 100 упаковок (10 шт./уп.)
- Дуга ортодонтическая Stainless Steel, сечение прямоугольное, форма Прямой отрезок, 0,014 дюймов (0,36 мм) не более 100 упаковок (10 шт./уп.)

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0111554

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 28 ноября 2022 года № РЗН 2022/18940

Лист 209

- Дуга ортодонтическая Stainless Steel, сечение прямоугольное, форма Прямой отрезок, 0,016 дюймов (0,41 мм) не более 100 упаковок (10 шт./уп.)
- Дуга ортодонтическая Stainless Steel, сечение прямоугольное, форма Прямой отрезок, 0,018 дюймов (0,46 мм) не более 100 упаковок (10 шт./уп.)
- Дуга ортодонтическая Stainless Steel, сечение прямоугольное, форма Прямой отрезок, 0,018 дюймов (0,46 мм) x 0,025 дюймов (0,64 мм) не более 100 упаковок (10 шт./уп.)
- Дуга ортодонтическая Stainless Steel, сечение прямоугольное, форма Прямой отрезок, 0,019 дюймов (0,48 мм) x 0,025 дюймов (0,64 мм) не более 100 упаковок (10 шт./уп.)
- Дуга ортодонтическая Stainless Steel, сечение прямоугольное, форма Прямой отрезок, 0,021 дюймов (0,53 мм) x 0,025 дюймов (0,64 мм) не более 100 упаковок (10 шт./уп.)
- 7. Дуга ортодонтическая Orthoshape Beta-Ti, в вариантах исполнения:
 - Дуга ортодонтическая Beta-Ti, сечение круглое, форма Овоид, 0,012 дюймов (0,30 мм) верхняя челюсть, не более 1000 шт.
 - Дуга ортодонтическая Beta-Ti, сечение круглое, форма Овоид, 0,012 дюймов (0,30 мм) нижняя челюсть, не более 1000 шт.
 - Дуга ортодонтическая Beta-Ti, сечение круглое, форма Овоид, 0,014 дюймов (0,36 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
 - Дуга ортодонтическая Beta-Ti, сечение круглое, форма Овоид, 0,014 дюймов (0,36 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.
 - Дуга ортодонтическая Beta-Ti, сечение круглое, форма Овоид, 0,016 дюймов (0,41 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
 - Дуга ортодонтическая Beta-Ti, сечение круглое, форма Овоид, 0,016 дюймов (0,41 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.
 - Дуга ортодонтическая Beta-Ti, сечение прямоугольное, форма Овоид, 0,016 дюймов (0,41 мм) x 0,016 дюймов (0,41 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
 - Дуга ортодонтическая Beta-Ti, сечение прямоугольное, форма Овоид, 0,016 дюймов (0,41 мм) x 0,016 дюймов (0,41 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.
 - Дуга ортодонтическая Beta-Ti, сечение прямоугольное, форма Овоид, 0,016 дюймов (0,41 мм) x 0,022 дюйма (0,56 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
 - Дуга ортодонтическая Beta-Ti, сечение прямоугольное, форма Овоид, 0,016 дюймов (0,41 мм) x 0,022 дюйма (0,56 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.
 - Дуга ортодонтическая Beta-Ti, сечение прямоугольное, форма Овоид, 0,017 дюймов (0,43 мм) x 0,022 дюйма (0,56 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
 - Дуга ортодонтическая Beta-Ti, сечение прямоугольное, форма Овоид, 0,017 дюймов (0,43 мм) x 0,022 дюйма (0,56 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.
 - Дуга ортодонтическая Beta-Ti, сечение прямоугольное, форма Овоид, 0,017 дюймов

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0111555

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 28 ноября 2022 года № РЗН 2022/18940

Лист 210

- (0,43 мм) x 0,025 дюймов (0,64 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая Beta-Ti, сечение прямоугольное, форма Овоид, 0,017 дюймов (0,43 мм x 0,025 дюймов (0,64 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.
 - Дуга ортодонтическая Beta-Ti, сечение круглое, форма Овоид, 0,018 дюймов (0,46 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
 - Дуга ортодонтическая Beta-Ti, сечение круглое, форма Овоид, 0,018 дюймов (0,46 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.
 - Дуга ортодонтическая Beta-Ti, сечение прямоугольное, форма Овоид, 0,018 дюймов (0,46 мм) x 0,025 дюймов (0,64 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
 - Дуга ортодонтическая Beta-Ti, сечение прямоугольное, форма Овоид, 0,018 дюймов (0,46 мм) x 0,025 дюймов (0,64 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.
 - Дуга ортодонтическая Beta-Ti, сечение прямоугольное, форма Овоид, 0,019 дюймов (0,48 мм) x 0,025 дюймов (0,64 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
 - Дуга ортодонтическая Beta-Ti, сечение прямоугольное, форма Овоид, 0,019 дюймов (0,48 мм) x 0,025 дюймов (0,64 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.
 - Дуга ортодонтическая Beta-Ti, сечение круглое, форма Овоид, 0,020 дюймов (0,51 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
 - Дуга ортодонтическая Beta-Ti, сечение круглое, форма Овоид, 0,020 дюймов (0,51 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.
 - Дуга ортодонтическая Beta-Ti, сечение прямоугольное, форма Овоид, 0,021 дюймов (0,53 мм) x 0,025 дюймов (0,64 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
 - Дуга ортодонтическая Beta-Ti, сечение прямоугольное, форма Овоид, 0,021 дюймов (0,53 мм) x 0,025 дюймов (0,64 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.
 - Дуга ортодонтическая Beta-Ti, сечение круглое, форма Нейчерал, 0,012 дюймов (0,30 мм) верхняя челюсть, не более 1000 шт.
 - Дуга ортодонтическая Beta-Ti, сечение круглое, форма Нейчерал, 0,012 дюймов (0,30 мм) нижняя челюсть, не более 1000 шт.
 - Дуга ортодонтическая Beta-Ti, сечение круглое, форма Нейчерал, 0,014 дюймов (0,36 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
 - Дуга ортодонтическая Beta-Ti, сечение круглое, форма Нейчерал, 0,014 дюймов (0,36 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.
 - Дуга ортодонтическая Beta-Ti, сечение круглое, форма Нейчерал, 0,016 дюймов (0,41 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
 - Дуга ортодонтическая Beta-Ti, сечение круглое, форма Нейчерал, 0,016 дюймов (0,41 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.
 - Дуга ортодонтическая Beta-Ti, сечение прямоугольное, форма Нейчерал, 0,016

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0111556

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 28 ноября 2022 года № РЗН 2022/18940

Лист 211

- дюймов (0,41 мм) x 0,016 дюймов (0,41 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая Beta-Ti, сечение прямоугольное, форма Нейчерал, 0,016 дюймов (0,41 мм) x 0,016 дюймов (0,41 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.
 - Дуга ортодонтическая Beta-Ti, сечение прямоугольное, форма Нейчерал, 0,016 дюймов (0,41 мм) x 0,022 дюйма (0,56 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
 - Дуга ортодонтическая Beta-Ti, сечение прямоугольное, форма Нейчерал, 0,016 дюймов (0,41 мм) x 0,022 дюйма (0,56 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.
 - Дуга ортодонтическая Beta-Ti, сечение прямоугольное, форма Нейчерал, 0,017 дюймов (0,43 мм) x 0,022 дюйма (0,56 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
 - Дуга ортодонтическая Beta-Ti, сечение прямоугольное, форма Нейчерал, 0,017 дюймов (0,43 мм) x 0,022 дюйма (0,56 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.
 - Дуга ортодонтическая Beta-Ti, сечение прямоугольное, форма Нейчерал, 0,017 дюймов (0,43 мм) x 0,025 дюймов (0,64 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
 - Дуга ортодонтическая Beta-Ti, сечение прямоугольное, форма Нейчерал, 0,017 дюймов (0,43 мм) x 0,025 дюймов (0,64 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.
 - Дуга ортодонтическая Beta-Ti, сечение круглое, форма Нейчерал, 0,018 дюймов (0,46 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
 - Дуга ортодонтическая Beta-Ti, сечение круглое, форма Нейчерал, 0,018 дюймов (0,46 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.
 - Дуга ортодонтическая Beta-Ti, сечение прямоугольное, форма Нейчерал, 0,018 дюймов (0,46 мм) x 0,018 дюймов (0,46 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
 - Дуга ортодонтическая Beta-Ti, сечение прямоугольное, форма Нейчерал, 0,018 дюймов (0,46 мм) x 0,018 дюймов (0,46 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.
 - Дуга ортодонтическая Beta-Ti, сечение прямоугольное, форма Нейчерал, 0,018 дюймов (0,46 мм) x 0,022 дюйма (0,56 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
 - Дуга ортодонтическая Beta-Ti, сечение прямоугольное, форма Нейчерал, 0,018 дюймов (0,46 мм) x 0,022 дюйма (0,56 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.
 - Дуга ортодонтическая Beta-Ti, сечение прямоугольное, форма Нейчерал, 0,018 дюймов (0,46 мм) x 0,025 дюймов (0,64 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
 - Дуга ортодонтическая Beta-Ti, сечение прямоугольное, форма Нейчерал, 0,018 дюймов (0,46 мм) x 0,025 дюймов (0,64 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.
 - Дуга ортодонтическая Beta-Ti, сечение прямоугольное, форма Нейчерал, 0,019 дюймов (0,48 мм) x 0,025 дюймов (0,64 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
 - Дуга ортодонтическая Beta-Ti, сечение прямоугольное, форма Нейчерал, 0,019 дюймов (0,48 мм) x 0,025 дюймов (0,64 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.
 - Дуга ортодонтическая Beta-Ti, сечение круглое, форма Нейчерал, 0,020 дюймов (0,51

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0111557

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 28 ноября 2022 года № РЗН 2022/18940

Лист 212

- мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая Beta-Ti, сечение круглое, форма Нейчерал, 0,020 дюймов (0,51 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.
 - Дуга ортодонтическая Beta-Ti, сечение прямоугольное, форма Нейчерал, 0,021 дюймов (0, 53 мм) x 0,025 дюймов (0,64 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
 - Дуга ортодонтическая Beta-Ti, сечение прямоугольное, форма Нейчерал, 0,021 дюймов (0, 53 мм) x 0,025 дюймов (0,64 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.
 - Дуга ортодонтическая Beta-Ti, сечение прямоугольное, форма Даймон, 0,016 дюймов (0,41 мм) x 0,022 дюйма (0,56 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
 - Дуга ортодонтическая Beta-Ti, сечение прямоугольное, форма Даймон, 0,016 дюймов (0,41 мм) x 0,022 дюйма (0,56 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.
 - Дуга ортодонтическая Beta-Ti, сечение прямоугольное, форма Даймон, 0,017 дюймов (0,43 мм) x 0,025 дюймов (0,64 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
 - Дуга ортодонтическая Beta-Ti, сечение прямоугольное, форма Даймон, 0,017 дюймов (0,43 мм) x 0,025 дюймов (0,64 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.
 - Дуга ортодонтическая Beta-Ti, сечение прямоугольное, форма Даймон, 0,019 дюймов (0, 48 мм) x 0,025 дюймов (0,64 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
 - Дуга ортодонтическая Beta-Ti, сечение прямоугольное, форма Даймон, 0,019 дюймов (0, 48 мм) x 0,025 дюймов (0,64 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.
 - Дуга ортодонтическая Beta-Ti, сечение круглое, форма Даймон, 0,014 дюймов (0,36 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
 - Дуга ортодонтическая Beta-Ti, сечение круглое, форма Даймон, 0,014 дюймов (0,36 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.
 - Дуга ортодонтическая Beta-Ti, сечение круглое, форма Даймон, 0,016 дюймов (0,41 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
 - Дуга ортодонтическая Beta-Ti, сечение круглое, форма Даймон, 0,016 дюймов (0,41 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.
 - Дуга ортодонтическая Beta-Ti, сечение круглое, форма Даймон, 0,018 дюймов (0,46 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
 - Дуга ортодонтическая Beta-Ti, сечение круглое, форма Даймон, 0,018 дюймов (0,46 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.
 - Дуга ортодонтическая Beta-Ti, сечение круглое, форма Прямой отрезок, 0,012 дюймов (0,30 мм), не более 1000 шт.
 - Дуга ортодонтическая Beta-Ti, сечение круглое, форма Прямой отрезок, 0,014 дюймов (0,36 мм), не более 1000 шт.
 - Дуга ортодонтическая Beta-Ti, сечение круглое, форма Прямой отрезок, 0,016 дюймов

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0111558

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 28 ноября 2022 года № РЗН 2022/18940

Лист 213

(0,41 мм), не более 1000 шт.

- Дуга ортодонтическая Beta-Ti, сечение прямоугольное, форма Прямой отрезок, 0,016 дюймов (0,41 мм) x 0,016 дюймов (0,41 мм), не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая Beta-Ti, сечение прямоугольное, форма Прямой отрезок, 0,016 дюймов (0,41 мм) x 0,022 дюйма (0,56 мм), не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая Beta-Ti, сечение прямоугольное, форма Прямой отрезок, 0,017 дюймов (0,43 мм) x 0,022 дюйма (0,56 мм), не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая Beta-Ti, сечение прямоугольное, форма Прямой отрезок, 0,017 дюймов (0,43 мм) x 0,025 дюймов (0,64 мм), не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая Beta-Ti, сечение круглое, форма Прямой отрезок, 0,018 дюймов (0,46 мм), не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая Beta-Ti, сечение прямоугольное, форма Прямой отрезок, 0,018 дюймов (0,46 мм) x 0,018 дюймов (0,46 мм), не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая Beta-Ti, сечение прямоугольное, форма Прямой отрезок, 0,018 дюймов (0,46 мм) x 0,025 дюймов (0,64 мм), не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая Beta-Ti, сечение прямоугольное, форма Прямой отрезок, 0,019 дюймов (0,48 мм) x 0,025 дюймов (0,64 мм), не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая Beta-Ti, сечение круглое, форма Прямой отрезок, 0,020 дюймов (0,51 мм), не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая Beta-Ti, сечение прямоугольное, форма Прямой отрезок, 0,021 дюймов (0,53 мм) x 0,025 дюймов (0,64 мм), не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая Beta-Ti, Лингвальная, сечение круглое 0,016 дюймов (0,41 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая Beta-Ti, Лингвальная, сечение круглое 0,016 дюймов (0,41 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая Beta-Ti, Лингвальная, сечение прямоугольное 0,018 дюймов (0,46 мм) x 0,018 дюймов (0,46 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая Beta-Ti, Лингвальная, сечение прямоугольное 0,018 дюймов (0,46 мм) x 0,018 дюймов (0,46 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
- 8. Дуга ортодонтическая CU-Alloy Tri Memalloy, в вариантах исполнения:
 - Дуга ортодонтическая CU-Alloy Tri Memalloy, сечение прямоугольное, форма Овоид, 0,016 дюймов (0,41 мм) x 0,022 дюйма (0,56 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
 - Дуга ортодонтическая CU-Alloy Tri Memalloy, сечение прямоугольное, форма Овоид, 0,016 дюймов (0,41 мм) x 0,022 дюйма (0,56 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.
 - Дуга ортодонтическая CU-Alloy Tri Memalloy, сечение прямоугольное, форма Овоид, 0,017 дюймов (0,43 мм) x 0,025 дюймов (0,64 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0111559

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 28 ноября 2022 года № РЗН 2022/18940

Лист 214

- Дуга ортодонтическая CU-Alloy Tri Memalloy, сечение прямоугольное, форма Овоид, 0,017 дюймов (0,43 мм) x 0,025 дюймов (0,64 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая CU-Alloy Tri Memalloy, сечение прямоугольное, форма Овоид, 0,018 дюймов (0,46 мм) x 0,025 дюймов (0,64 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая CU-Alloy Tri Memalloy, сечение прямоугольное, форма Овоид, 0,018 дюймов (0,46 мм) x 0,025 дюймов (0,64 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая CU-Alloy Tri Memalloy, сечение прямоугольное, форма Овоид, 0,019 дюймов (0, 48 мм) x 0,025 дюймов (0,64 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая CU-Alloy Tri Memalloy, сечение прямоугольное, форма Овоид, 0,019 дюймов (0, 48 мм) x 0,025 дюймов (0,64 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая CU-Alloy Tri Memalloy, сечение прямоугольное, форма Овоид, 0,020 дюймов (0, 51 мм) x 0,020 дюймов (0,51 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая CU-Alloy Tri Memalloy, сечение прямоугольное, форма Овоид, 0,020 дюймов (0, 51 мм) x 0,020 дюймов (0,51 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая CU-Alloy Tri Memalloy, сечение прямоугольное, форма Овоид, 0,021 дюймов (0, 53 мм) x 0,028 дюймов (0, 71 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая CU-Alloy Tri Memalloy, сечение прямоугольное, форма Овоид, 0,021 дюймов (0, 53 мм) x 0,028 дюймов (0, 71 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая CU-Alloy Tri Memalloy, сечение прямоугольное, форма Нейчерал, 0,016 дюймов (0,41 мм) x 0,022 дюйма (0,56 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая CU-Alloy Tri Memalloy, сечение прямоугольное, форма Нейчерал, 0,016 дюймов (0,41 мм) x 0,022 дюйма (0,56 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая CU-Alloy Tri Memalloy, сечение прямоугольное, форма Нейчерал, 0,017 дюймов (0,43 мм) x 0,025 дюймов (0,64 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая CU-Alloy Tri Memalloy, сечение прямоугольное, форма Нейчерал, 0,017 дюймов (0,43 мм) x 0,025 дюймов (0,64 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая CU-Alloy Tri Memalloy, сечение прямоугольное, форма Нейчерал, 0,018 дюймов (0,46 мм) x 0,025 дюймов (0,64 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая CU-Alloy Tri Memalloy, сечение прямоугольное, форма Нейчерал, 0,018 дюймов (0,46 мм) x 0,025 дюймов (0,64 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0111560

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 28 ноября 2022 года № РЗН 2022/18940

Лист 215

- Дуга ортодонтическая CU-Alloy Tri Memalloy, сечение прямоугольное, форма Нейчерал, 0,019 дюймов (0,48 мм) x 0,025 дюймов (0,64 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая CU-Alloy Tri Memalloy, сечение прямоугольное, форма Нейчерал, 0,019 дюймов (0,48 мм) x 0,025 дюймов (0,64 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая CU-Alloy Tri Memalloy, сечение прямоугольное, форма Нейчерал, 0,020 дюймов (0,51 мм) x 0,020 дюймов (0,51 мм), верхняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая CU-Alloy Tri Memalloy, сечение прямоугольное, форма Нейчерал, 0,020 дюймов (0,51 мм) x 0,020 дюймов (0,51 мм), нижняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая CU-Alloy Tri Memalloy, сечение прямоугольное, форма Нейчерал, 0,021 дюймов (0,53 мм) x 0,028, верхняя челюсть, не более 1000 шт.
- Дуга ортодонтическая CU-Alloy Tri Memalloy, сечение прямоугольное, форма Нейчерал, 0,021 дюймов (0,53 мм) x 0,028, нижняя челюсть, не более 1000 шт.

XIII. Бюгель небный, в вариантах исполнения:

1. Бюгель небный дистальный, длина 37 мм, не более 100 шт.
2. Бюгель небный дистальный, длина 39 мм, не более 100 шт.
3. Бюгель небный дистальный, длина 41 мм, не более 100 шт.
4. Бюгель небный дистальный, длина 43 мм, не более 100 шт.
5. Бюгель небный дистальный, длина 45 мм, не более 100 шт.
6. Бюгель небный дистальный, длина 47 мм, не более 100 шт.
7. Бюгель небный дистальный, длина 49 мм, не более 100 шт.
8. Бюгель небный дистальный, длина 51 мм, не более 100 шт.
9. Бюгель небный дистальный, длина 53 мм, не более 100 шт.
10. Бюгель небный дистальный, длина 55 мм, не более 100 шт.
11. Бюгель небный мезиальный, длина 37 мм, не более 100 шт.
12. Бюгель небный мезиальный, длина 39 мм, не более 100 шт.
13. Бюгель небный мезиальный, длина 41 мм, не более 100 шт.
14. Бюгель небный мезиальный, длина 43 мм, не более 100 шт.
15. Бюгель небный мезиальный, длина 45 мм, не более 100 шт.
16. Бюгель небный мезиальный, длина 47 мм, не более 100 шт.
17. Бюгель небный мезиальный, длина 49 мм, не более 100 шт.
18. Бюгель небный мезиальный, длина 51 мм, не более 100 шт.
19. Бюгель небный мезиальный, длина 53 мм, не более 100 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0111561

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 28 ноября 2022 года № РЗН 2022/18940

Лист 216

20. Бюгель небный мезиальный, длина 55 мм, не более 100 шт.

XIV. Ретрактор, в вариантах исполнения:

1. Ретрактор щёчный, в вариантах исполнения:

- Латеральный, не более 100 шт.

- Большой, не более 100 шт.

- Маленький, не более 100 шт.

2. Ретрактор губной, в вариантах исполнения:

- Большой, не более 100 шт.

- Средний, не более 100 шт.

XV. Сепаратор Hestia, не более 1000 шт. (при необходимости)

XVI. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.

Handwritten signature

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0111562