


ФОТОФАЙЛ

**Ультразвуковой видегастроскоп PENTAX Medical, модели
EG34-J10U, EG38-J10UT и EG36-J10UR с принадлежностями**


Ультразвуковой эндоскоп PENTAX Medical, модель EG34-J10U с принадлежностями




Принадлежности: 1. Набор PENTAX Medical PROFILE одноразовых чистящих щеток (синий стержень или CS2022A)

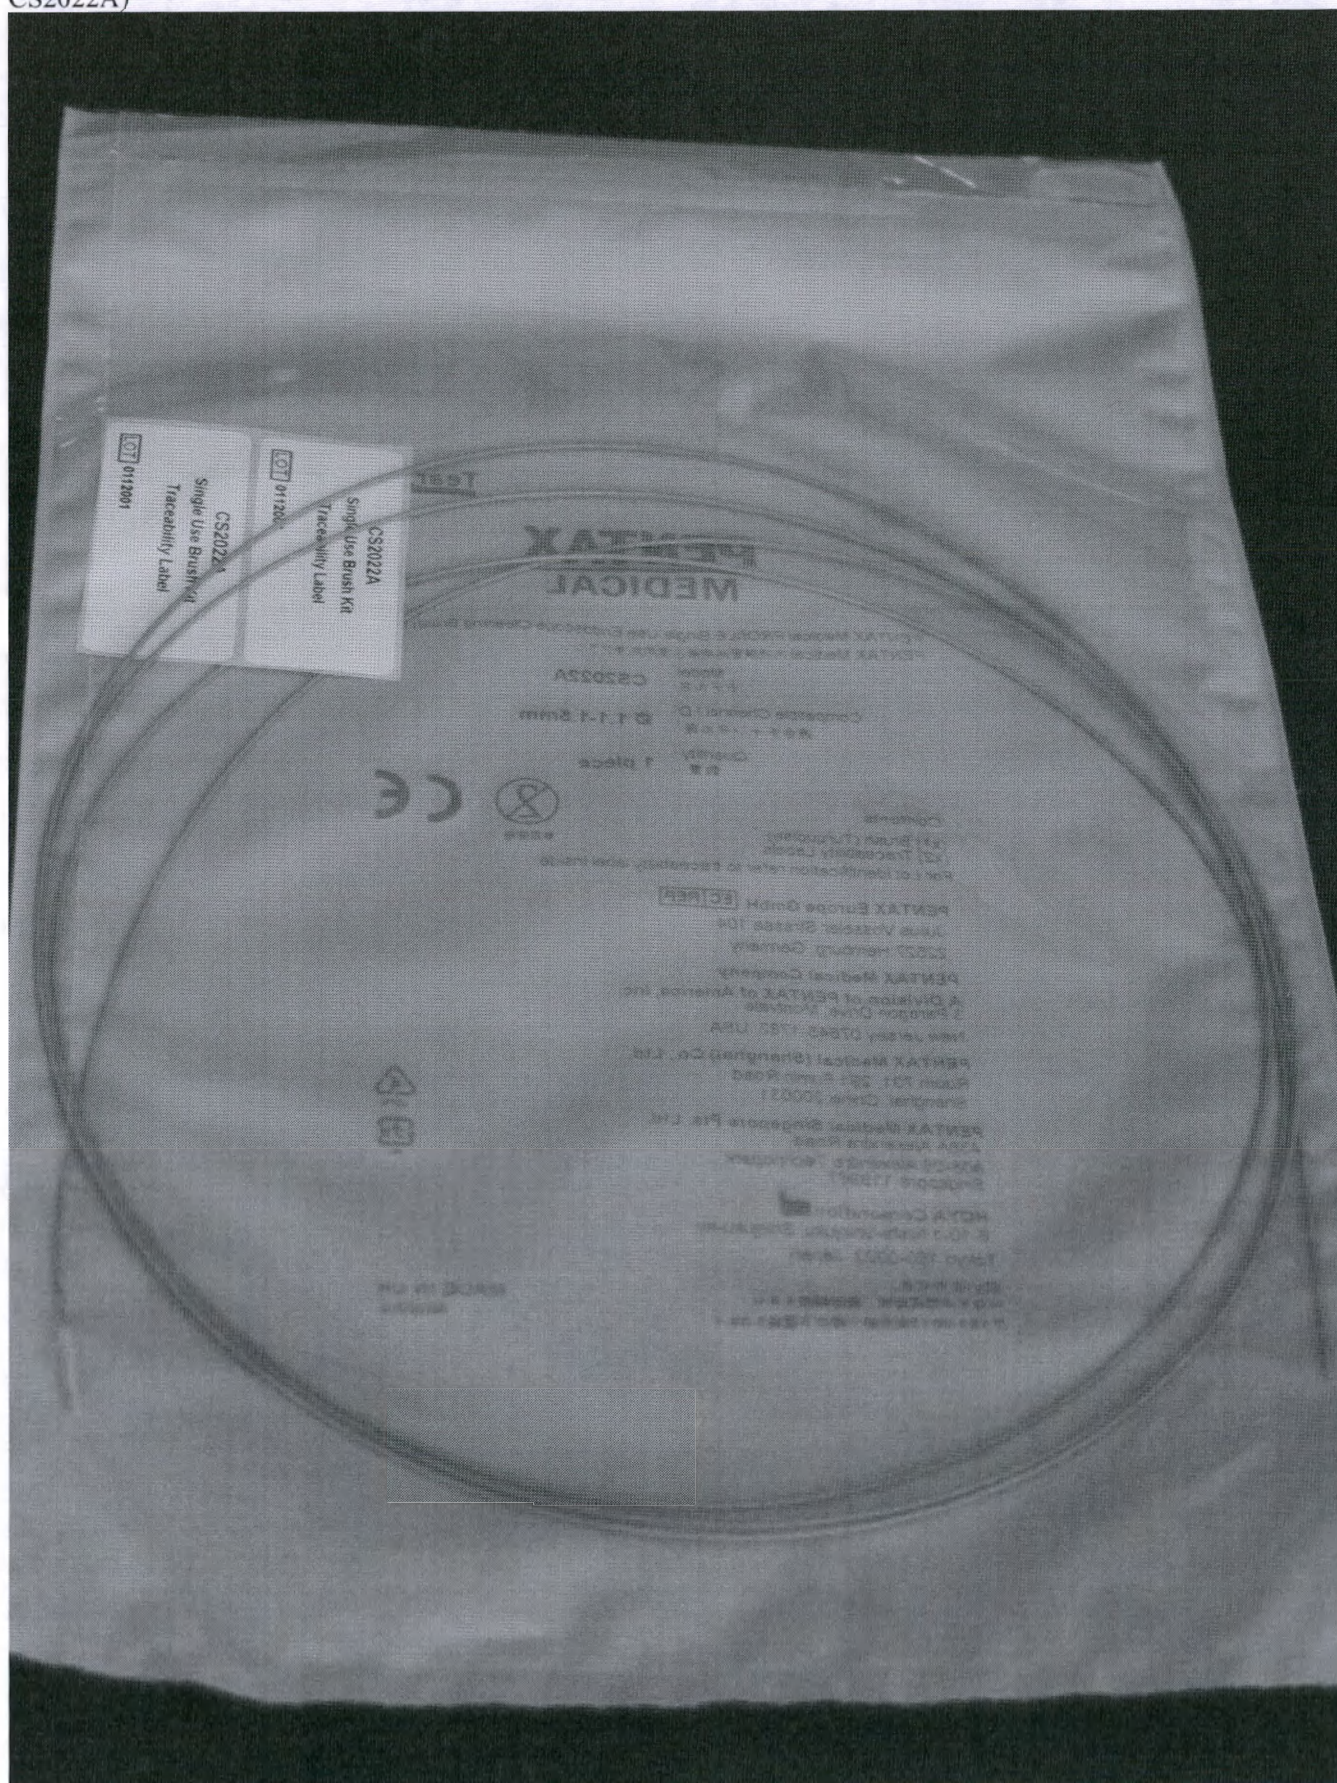

2. Набор PENTAX Medical PROFILE одноразовых чистящих щеток (желтый стержень или CS5522A)
– 1 набор из 10 шт.

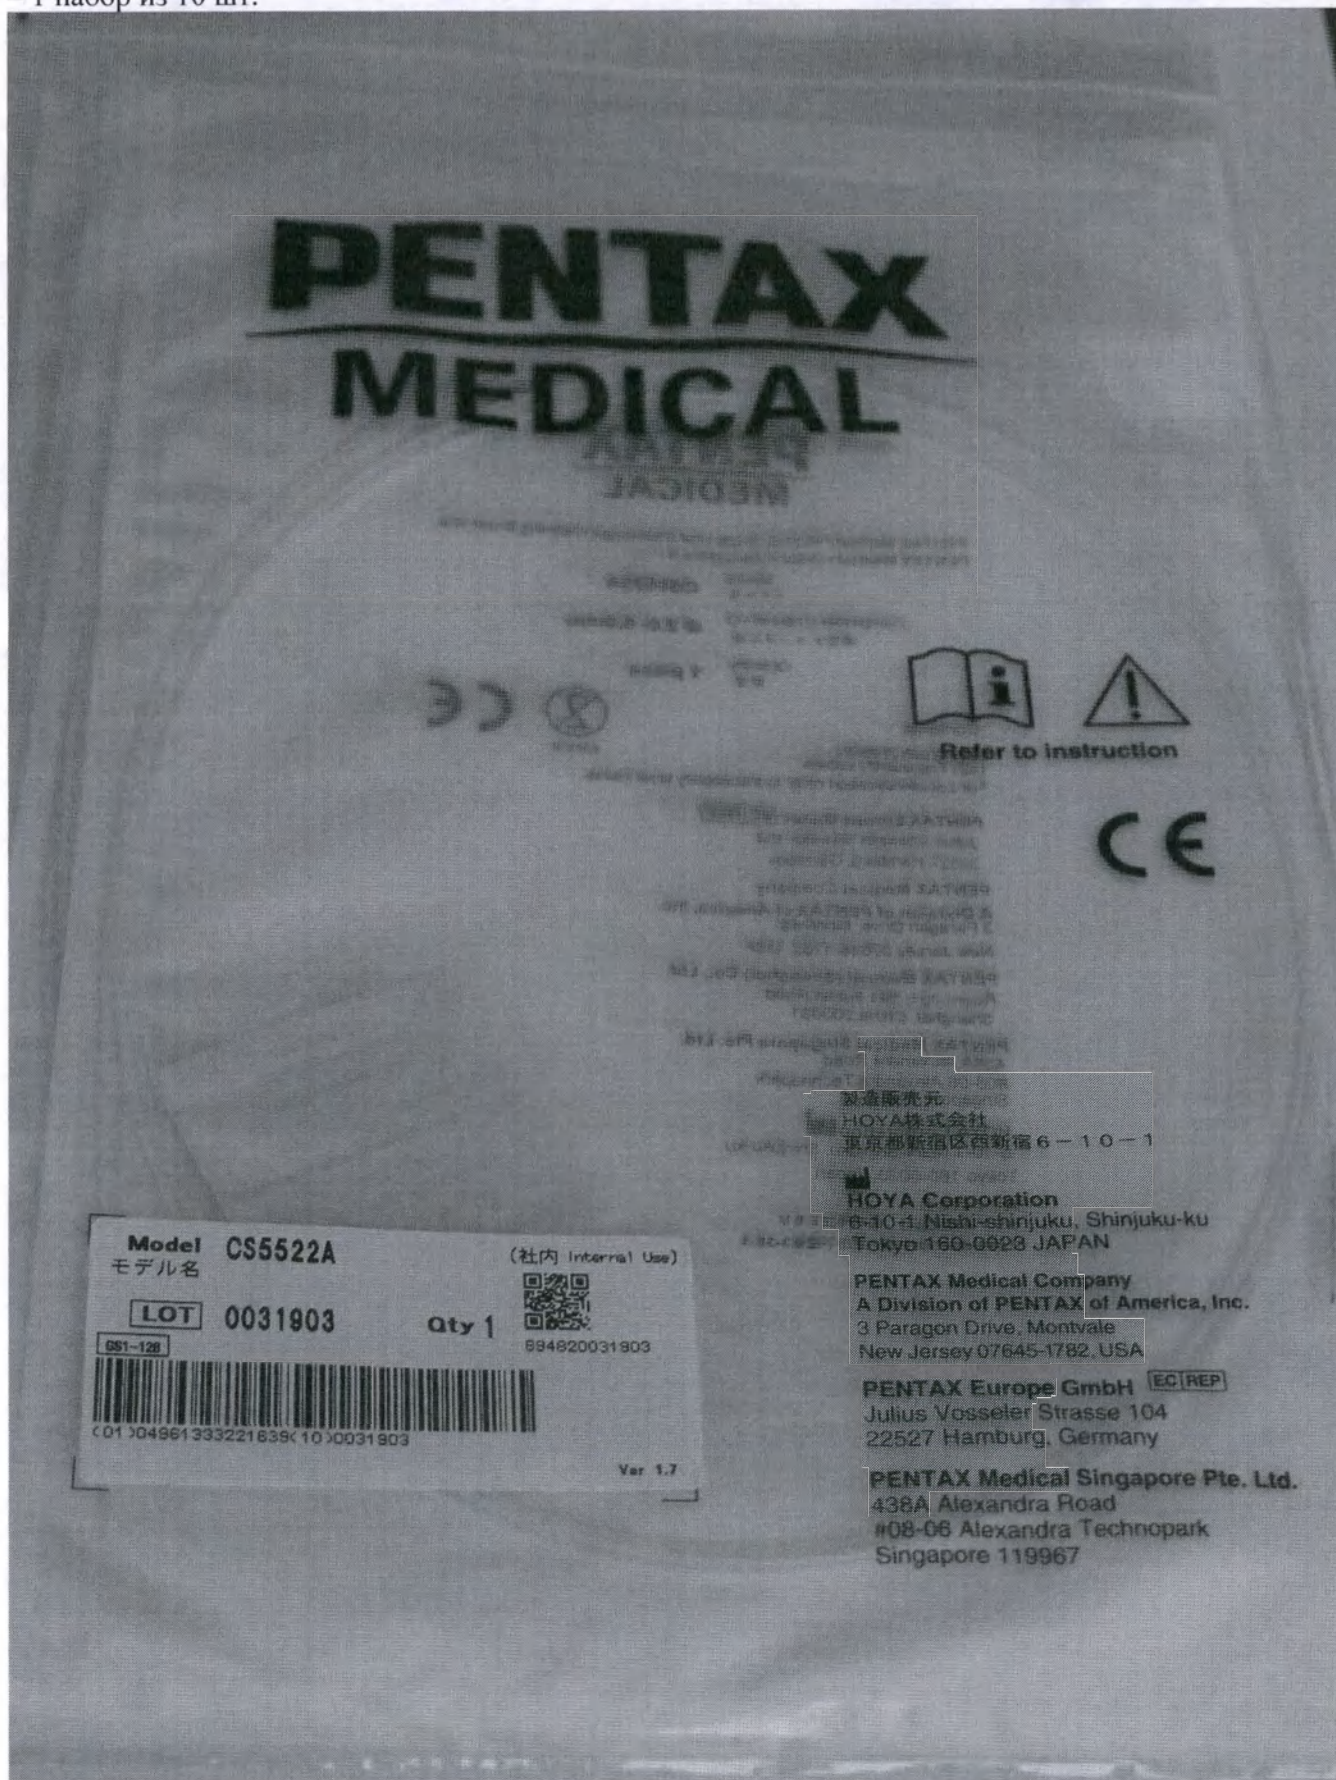


3. Набор PENTAX Medical PROFILE одноразовых чистящих щеток (желтая рукоятка или CS-C12A)
– 1 набор из 10 шт.

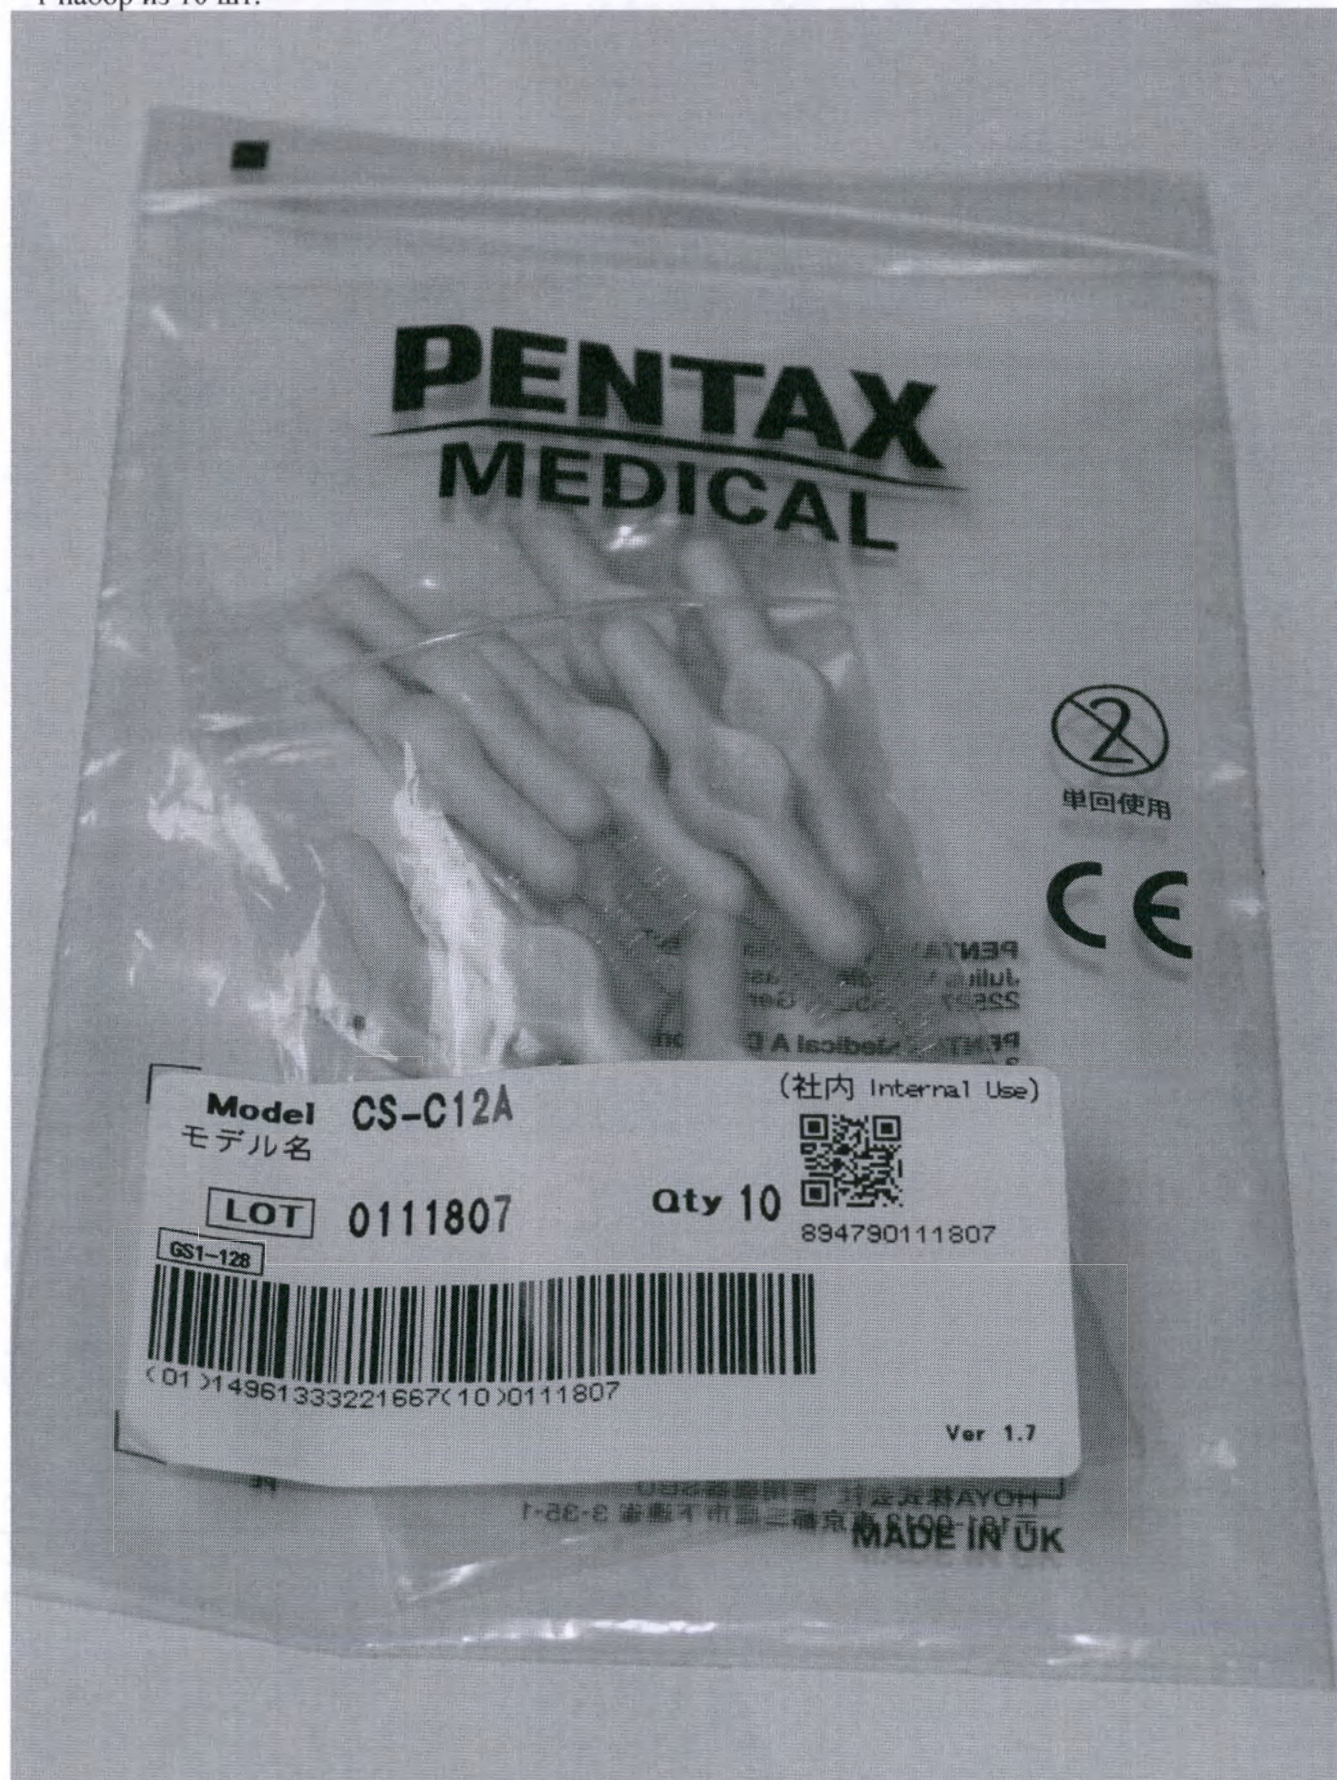




 取廻回単


PENTAX Europe GmbH [EC REP]
 Julius Vosseler Strasse 104
 22527 Hamburg, Germany
PENTAX Medical A Division of PENTAX of America, Inc.
 3 Paragon Drive, Montvale
 New Jersey, 07645-1732 USA
PENTAX Medical Shanghai Co., Ltd.
 Room 701, 291 Fumin Road
 Shanghai, 200031 P.R.China
PENTAX Medical Singapore Pte. Ltd.
 438A Alexandra Road
 #08-00 Alexandra Technopark
 119967 Singapore
HOYA Corporation
 6-10-1 Nishi-shinjuku, Shinjuku-ku
 Tokyo 160-0023, Japan
 問い合わせ先
 HOYA株式会社 医用機器SBU
 〒181-0013 東京都三鷹市下連雀 3-35-1

 LDPE

 PE
 MADE IN UK

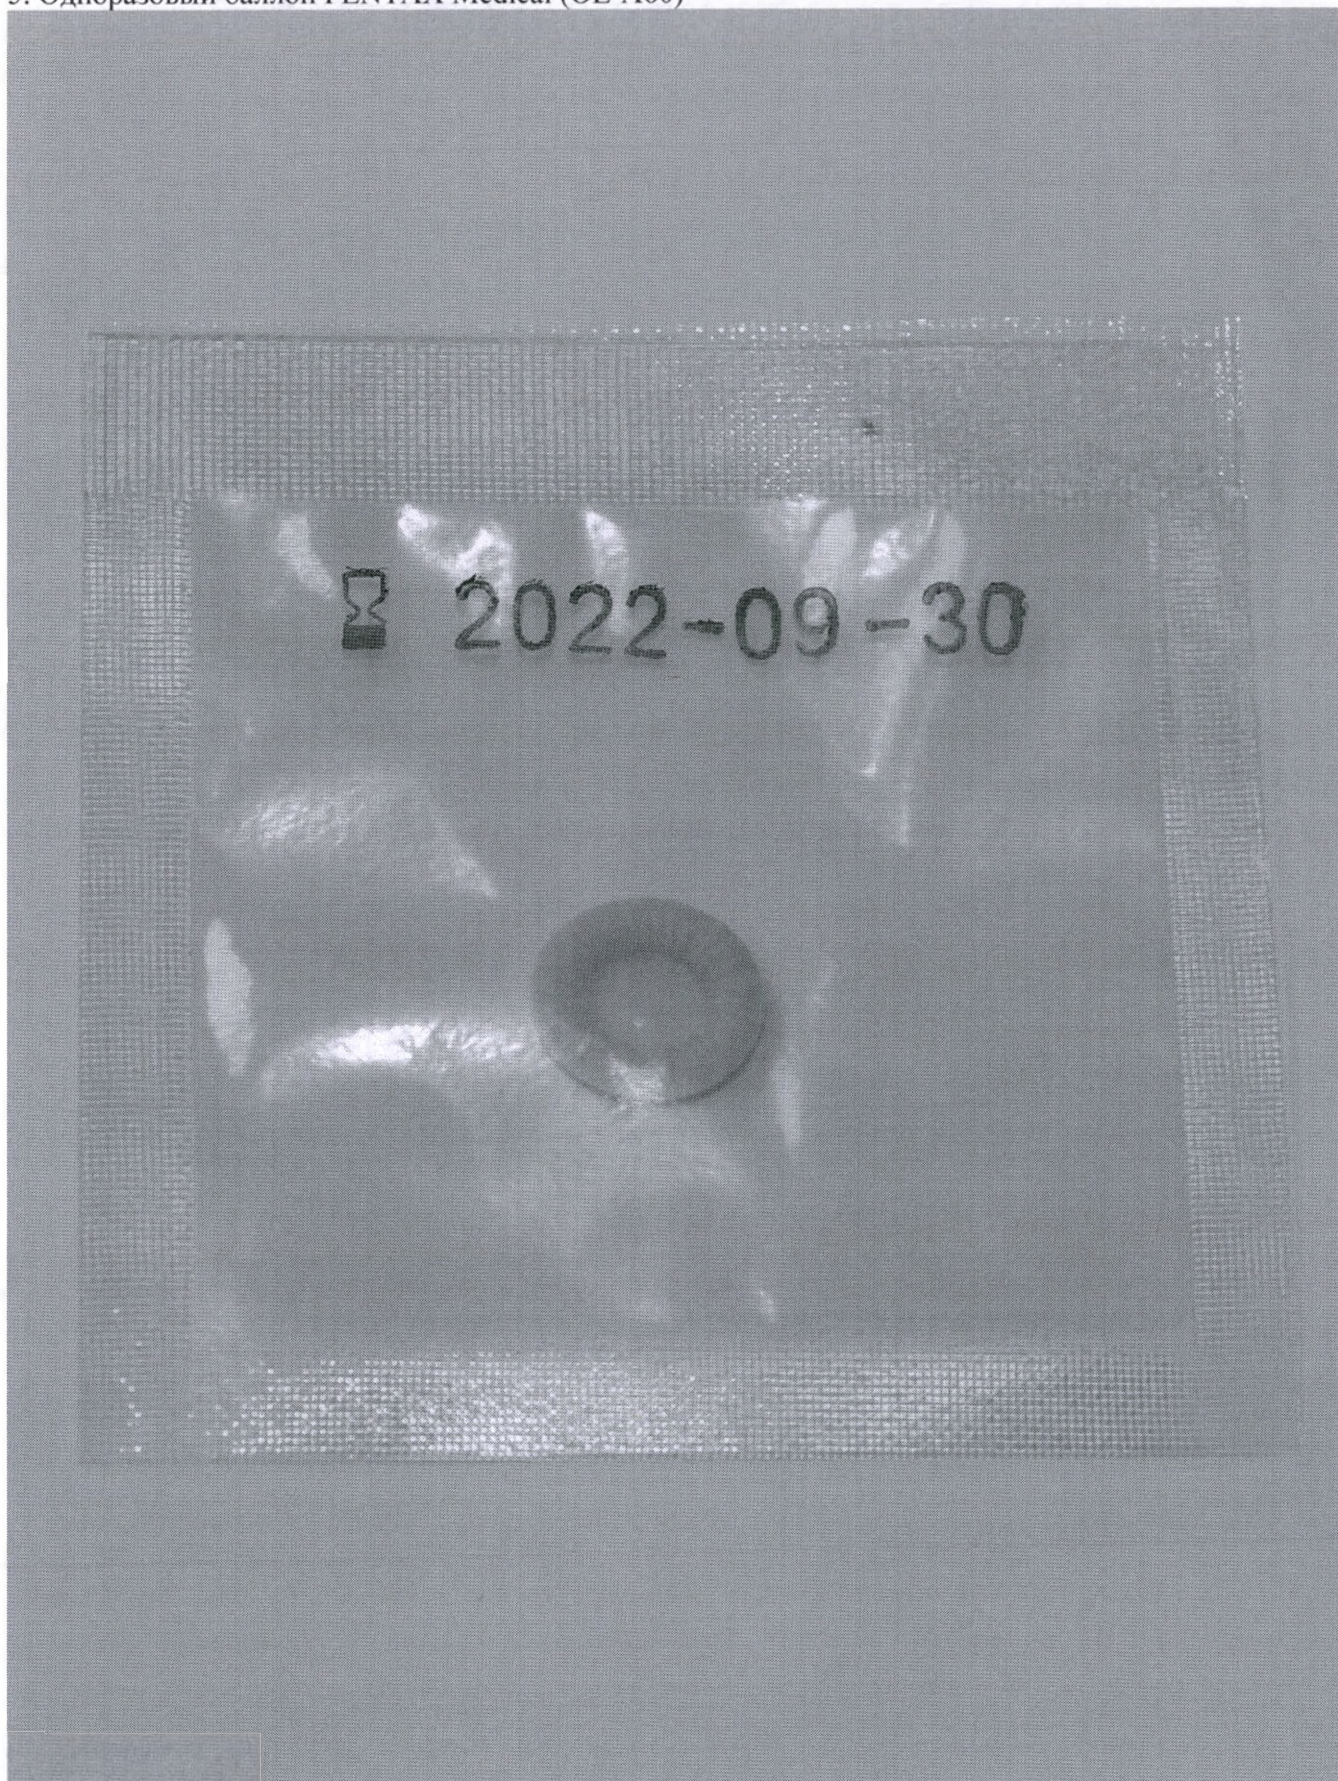
5. Одноразовый баллон PENTAX Medical (OE-A60)

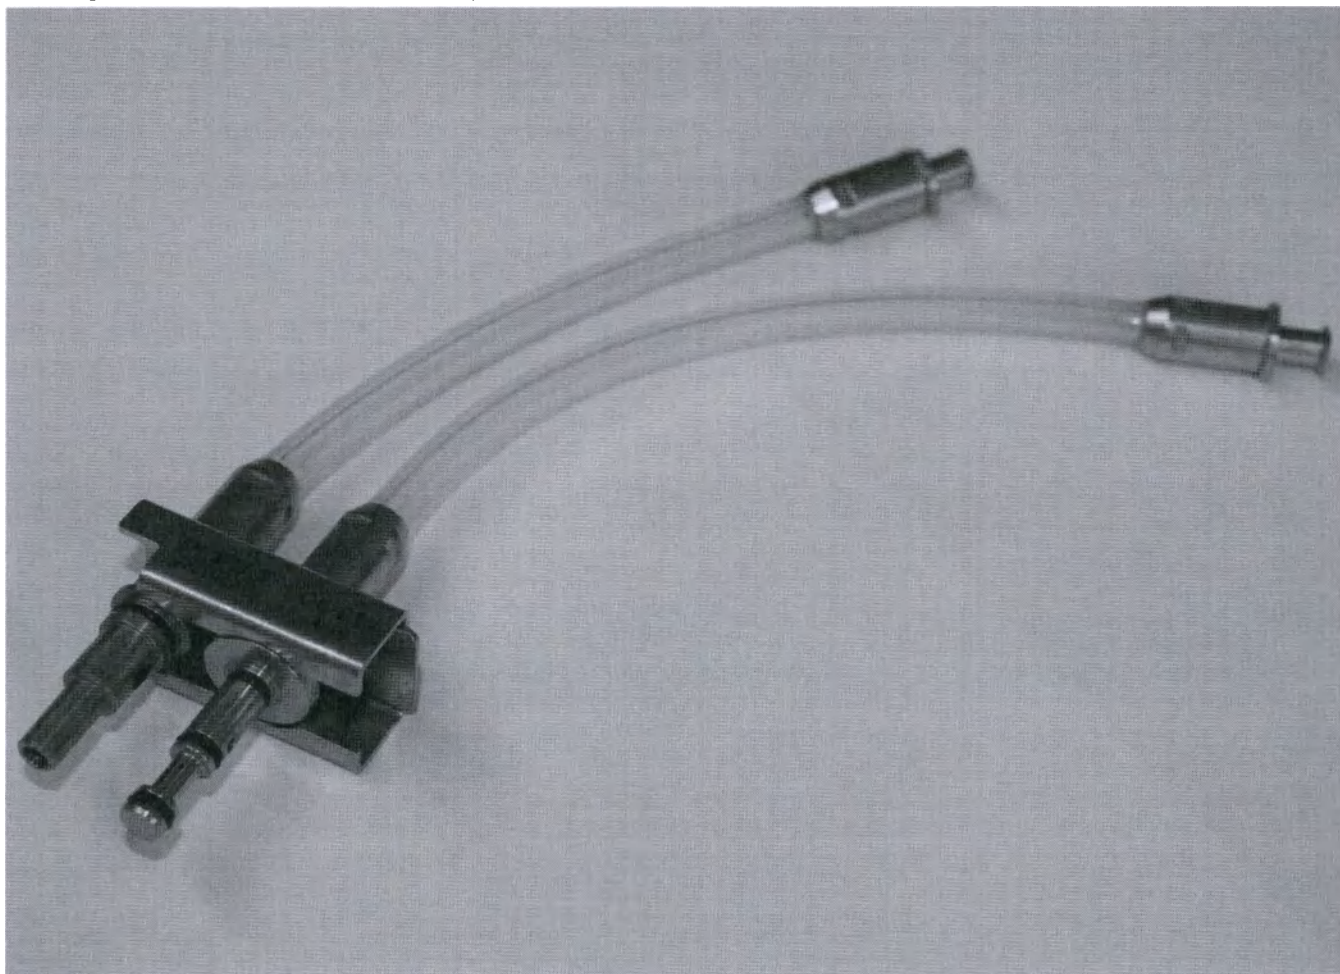

6. Адаптер для очистки PENTAX Medical (OE-B10)




7. Адаптер для очистки PENTAX Medical (OE-G1)

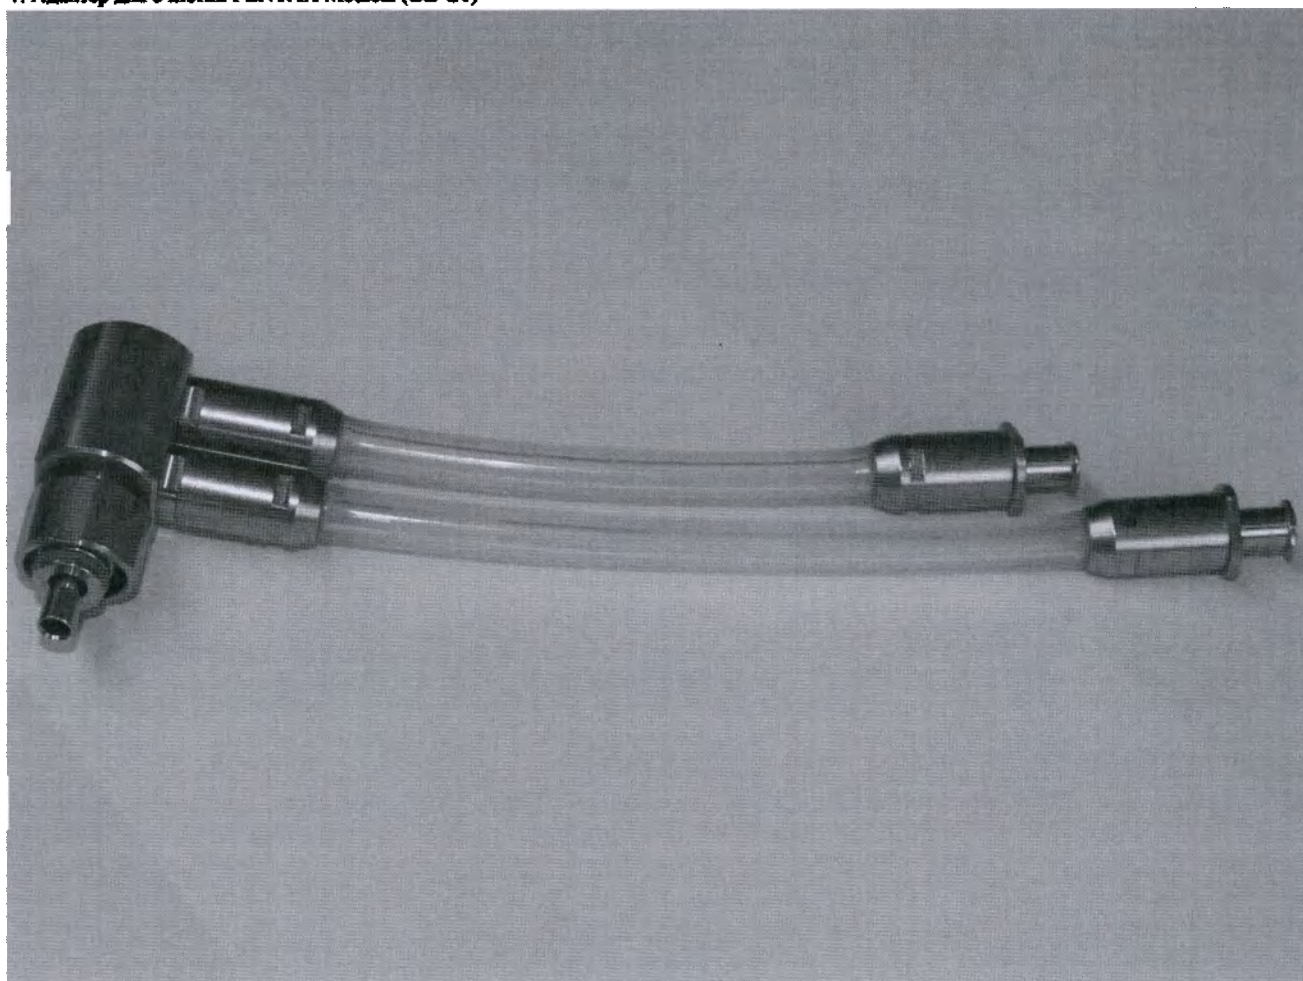

8. Колпачок для погружения PVE-коннектора




9. Колпачок PENTAX Medical для погружения коннектора ультразвукового сканера

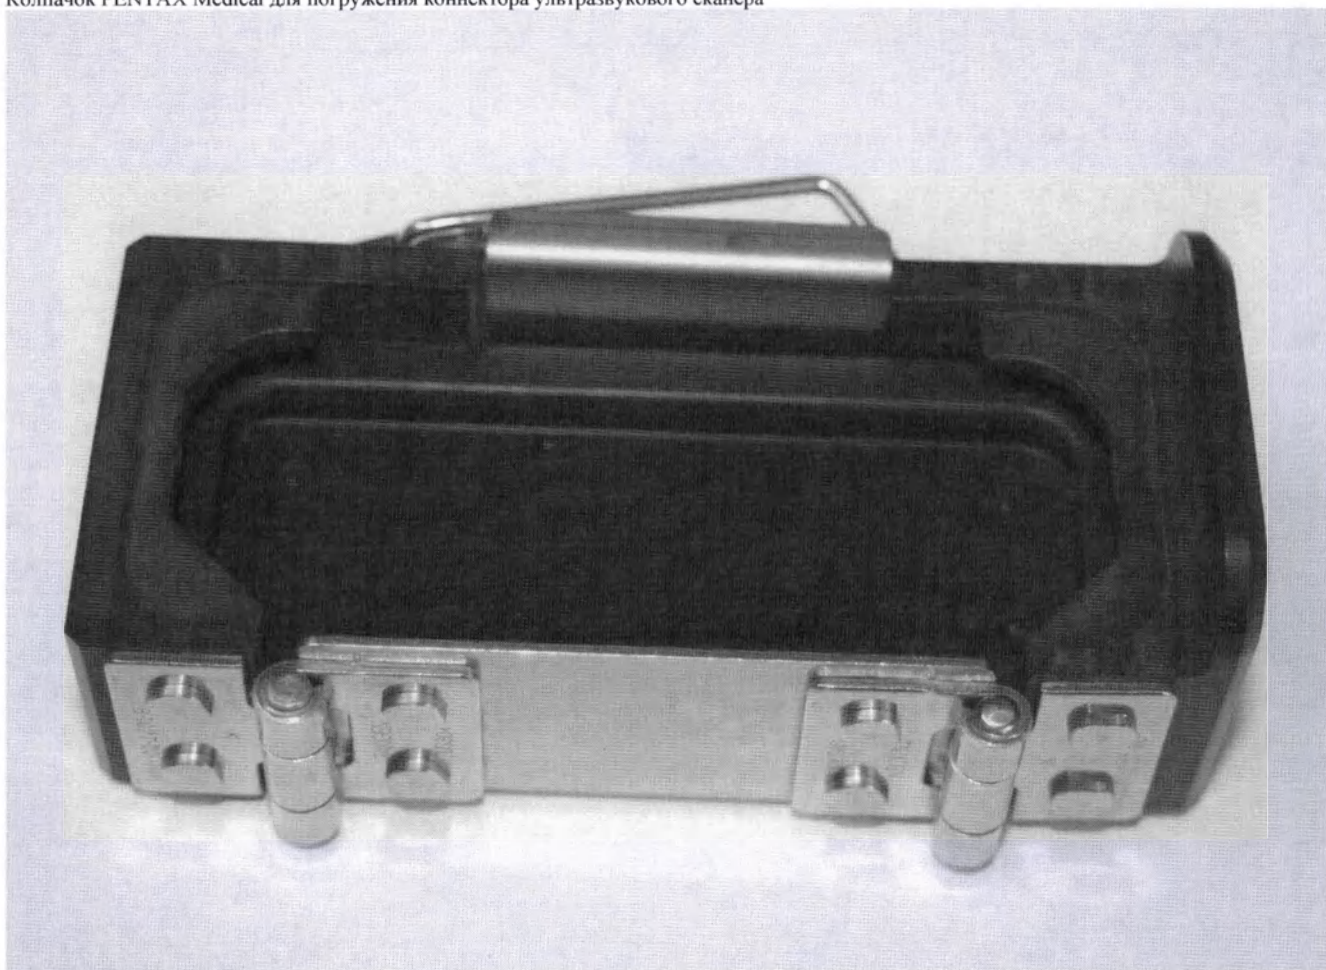


10. Клапан входного отверстия




11. Набор уплотнительных колец для клапана управления аспирацией/ аспирацией из баллона PENTAX Medical – 1 набор из 6 шт.

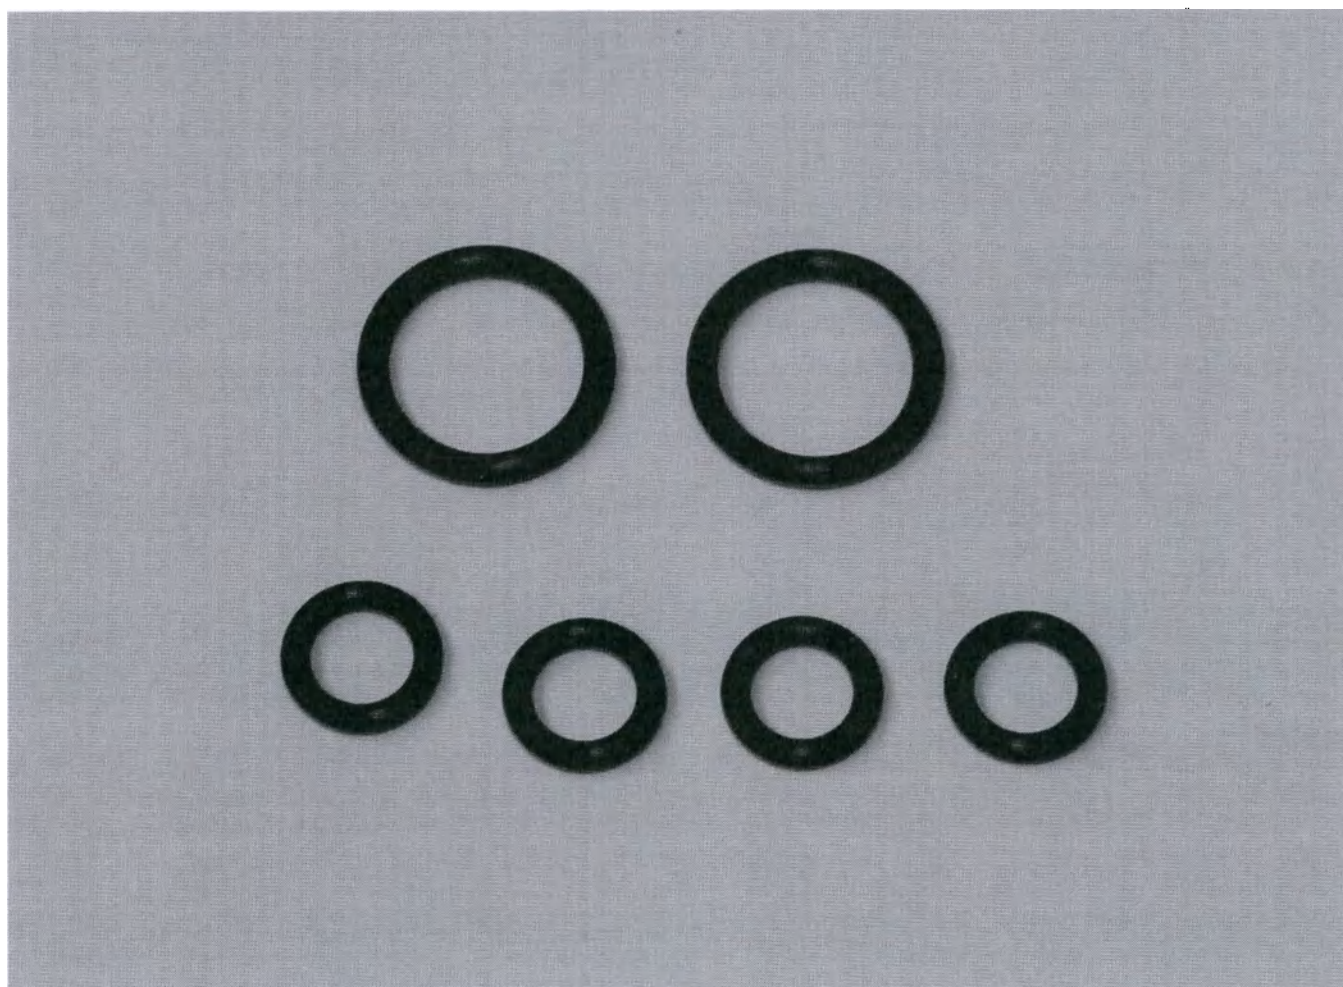

12. Набор уплотнительных колец PENTAX Medical для клизмы воздуха/воды/баллона с насадкой- 1 набор из 6 шт.

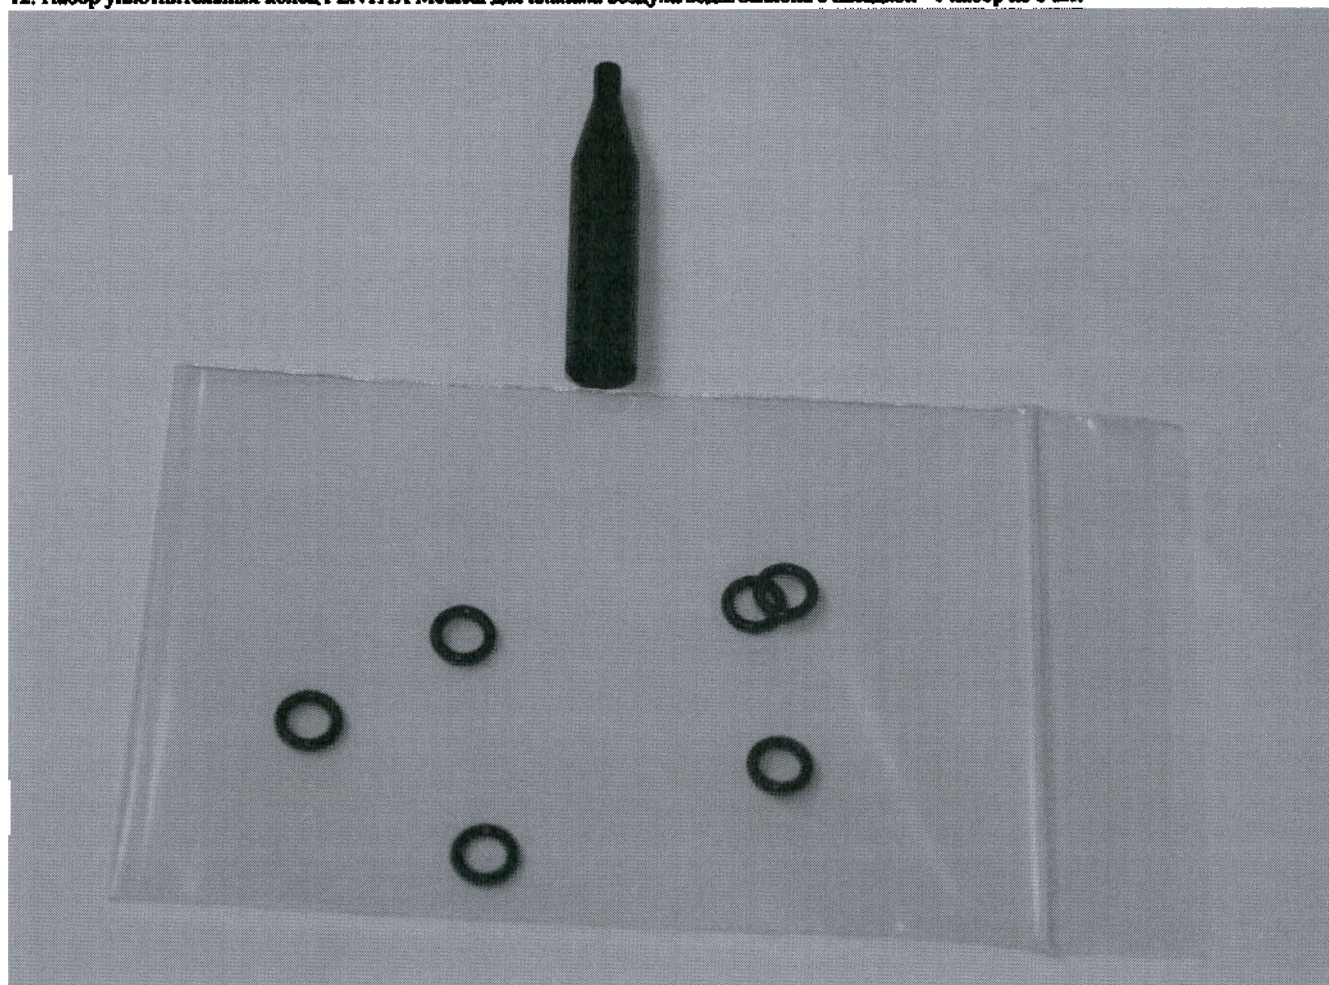


13. Набор уплотнительных колец PENTAX Medical к адаптеру для очистки с насадкой -- 1 набор из 5 шт.

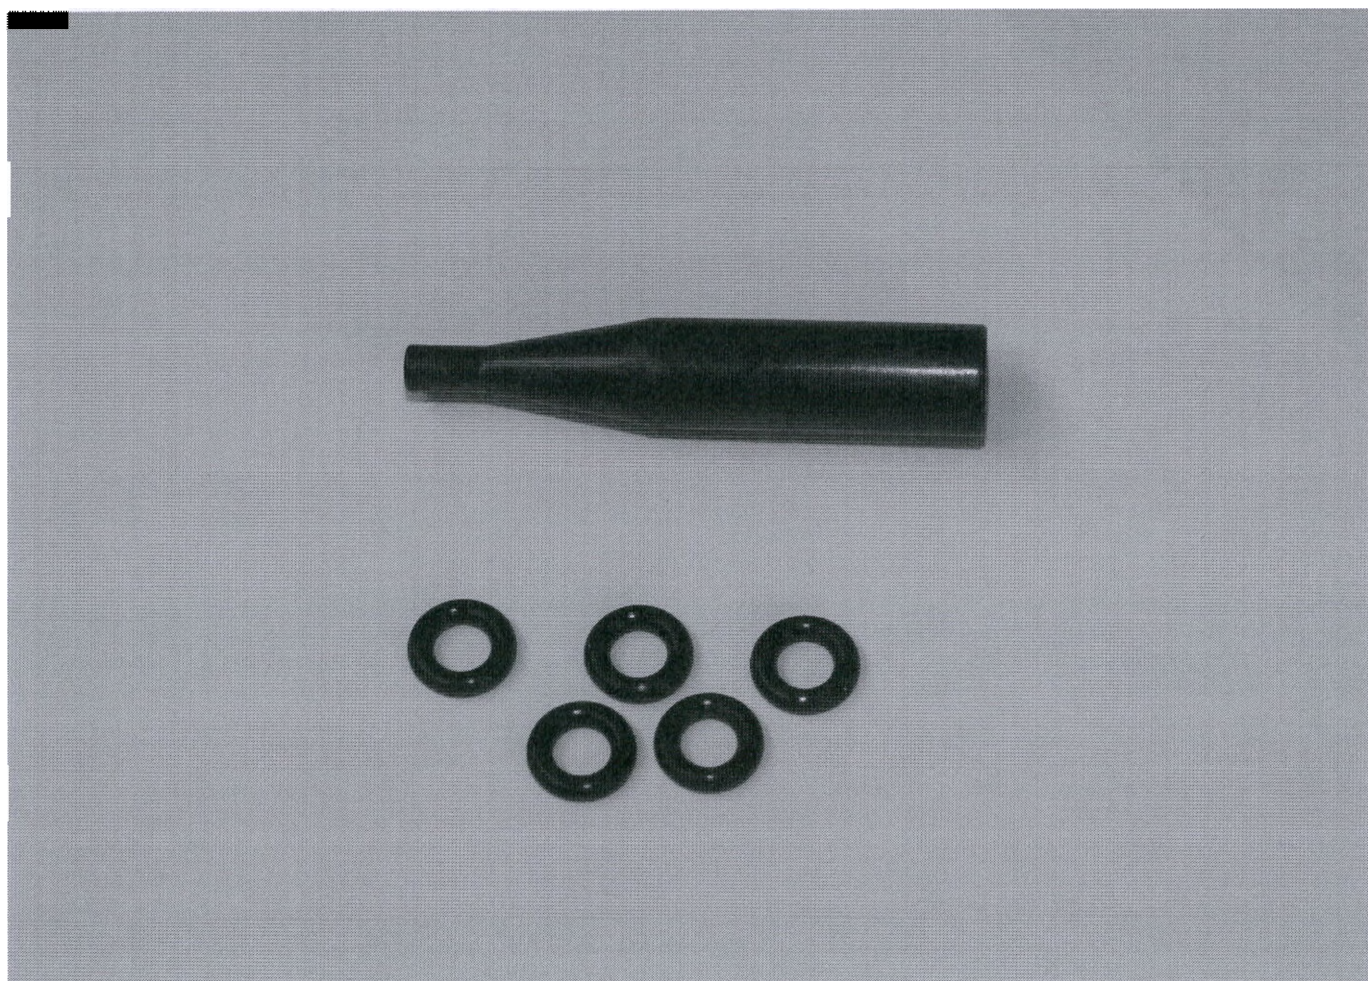


14. Крышка PENTAX Medical для очистки входного отверстия инструментального канала




15. Загубник

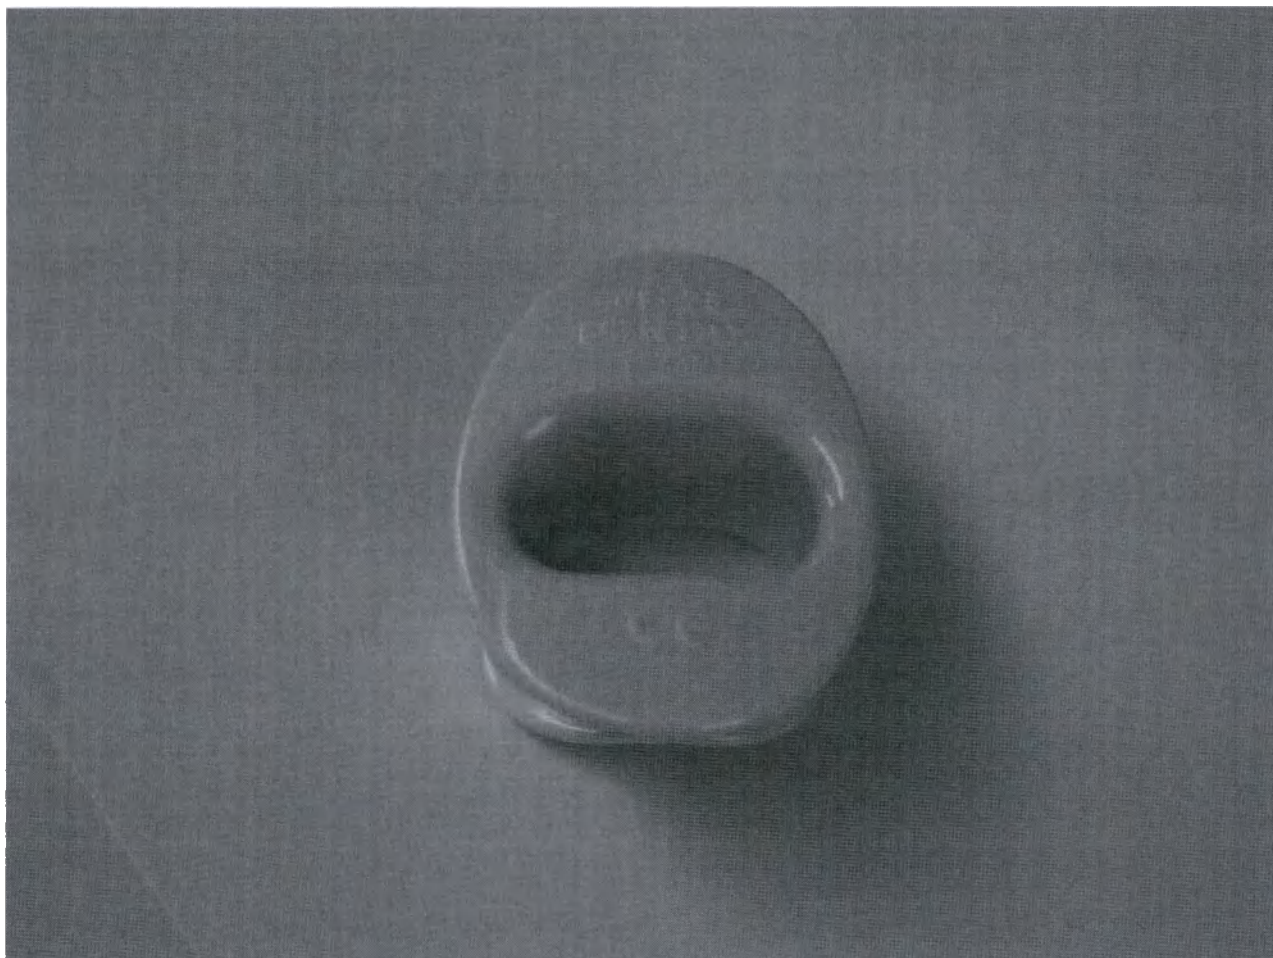


16. Силиконовое масло

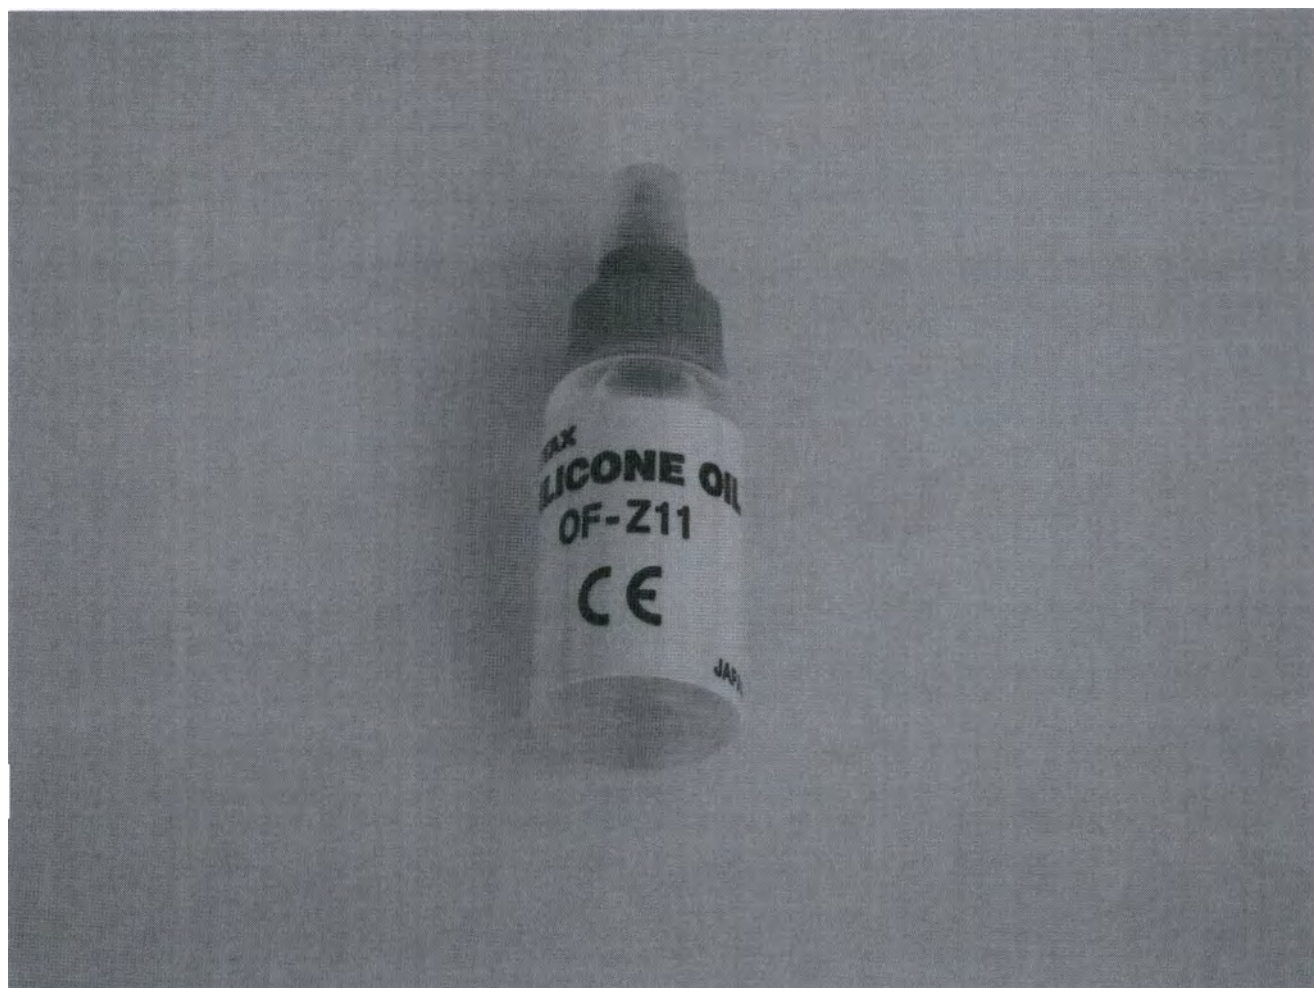

17. Клапан управления аспирацией/аспирацией из баллона PENTAX Medical

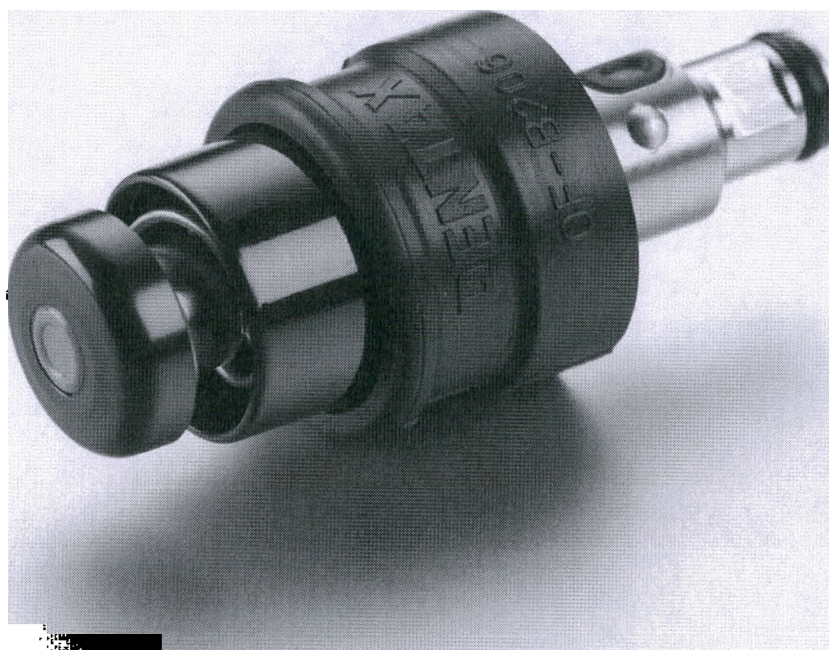

18. Клемма воздуха/воды/баллона PENTAX Medical

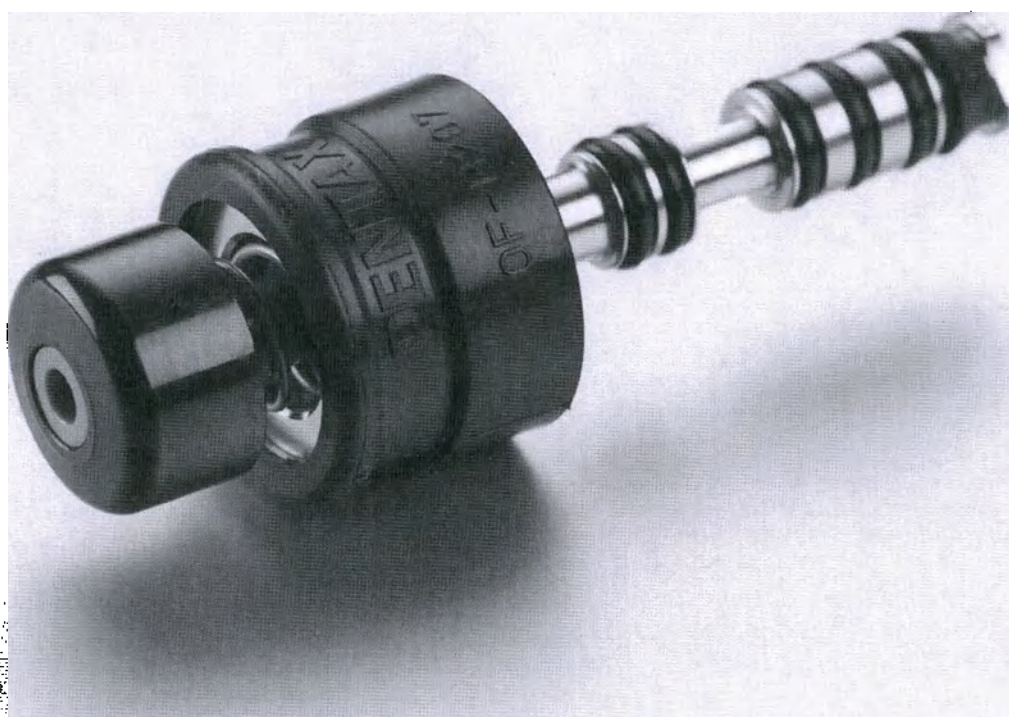

19. Вентиляционный колпачок



20. Инструкция по применению – 1 шт.;

Инструкция по эксплуатации

**Ультразвуковой видеогастроскоп PENTAX
Medical, модели EG34-J10U, EG38-J10UT
с принадлежностями**


PENTAX
MEDICAL



EG34-J10U

EG38-J10UT

21. Инструкция по обработке – 1 шт;

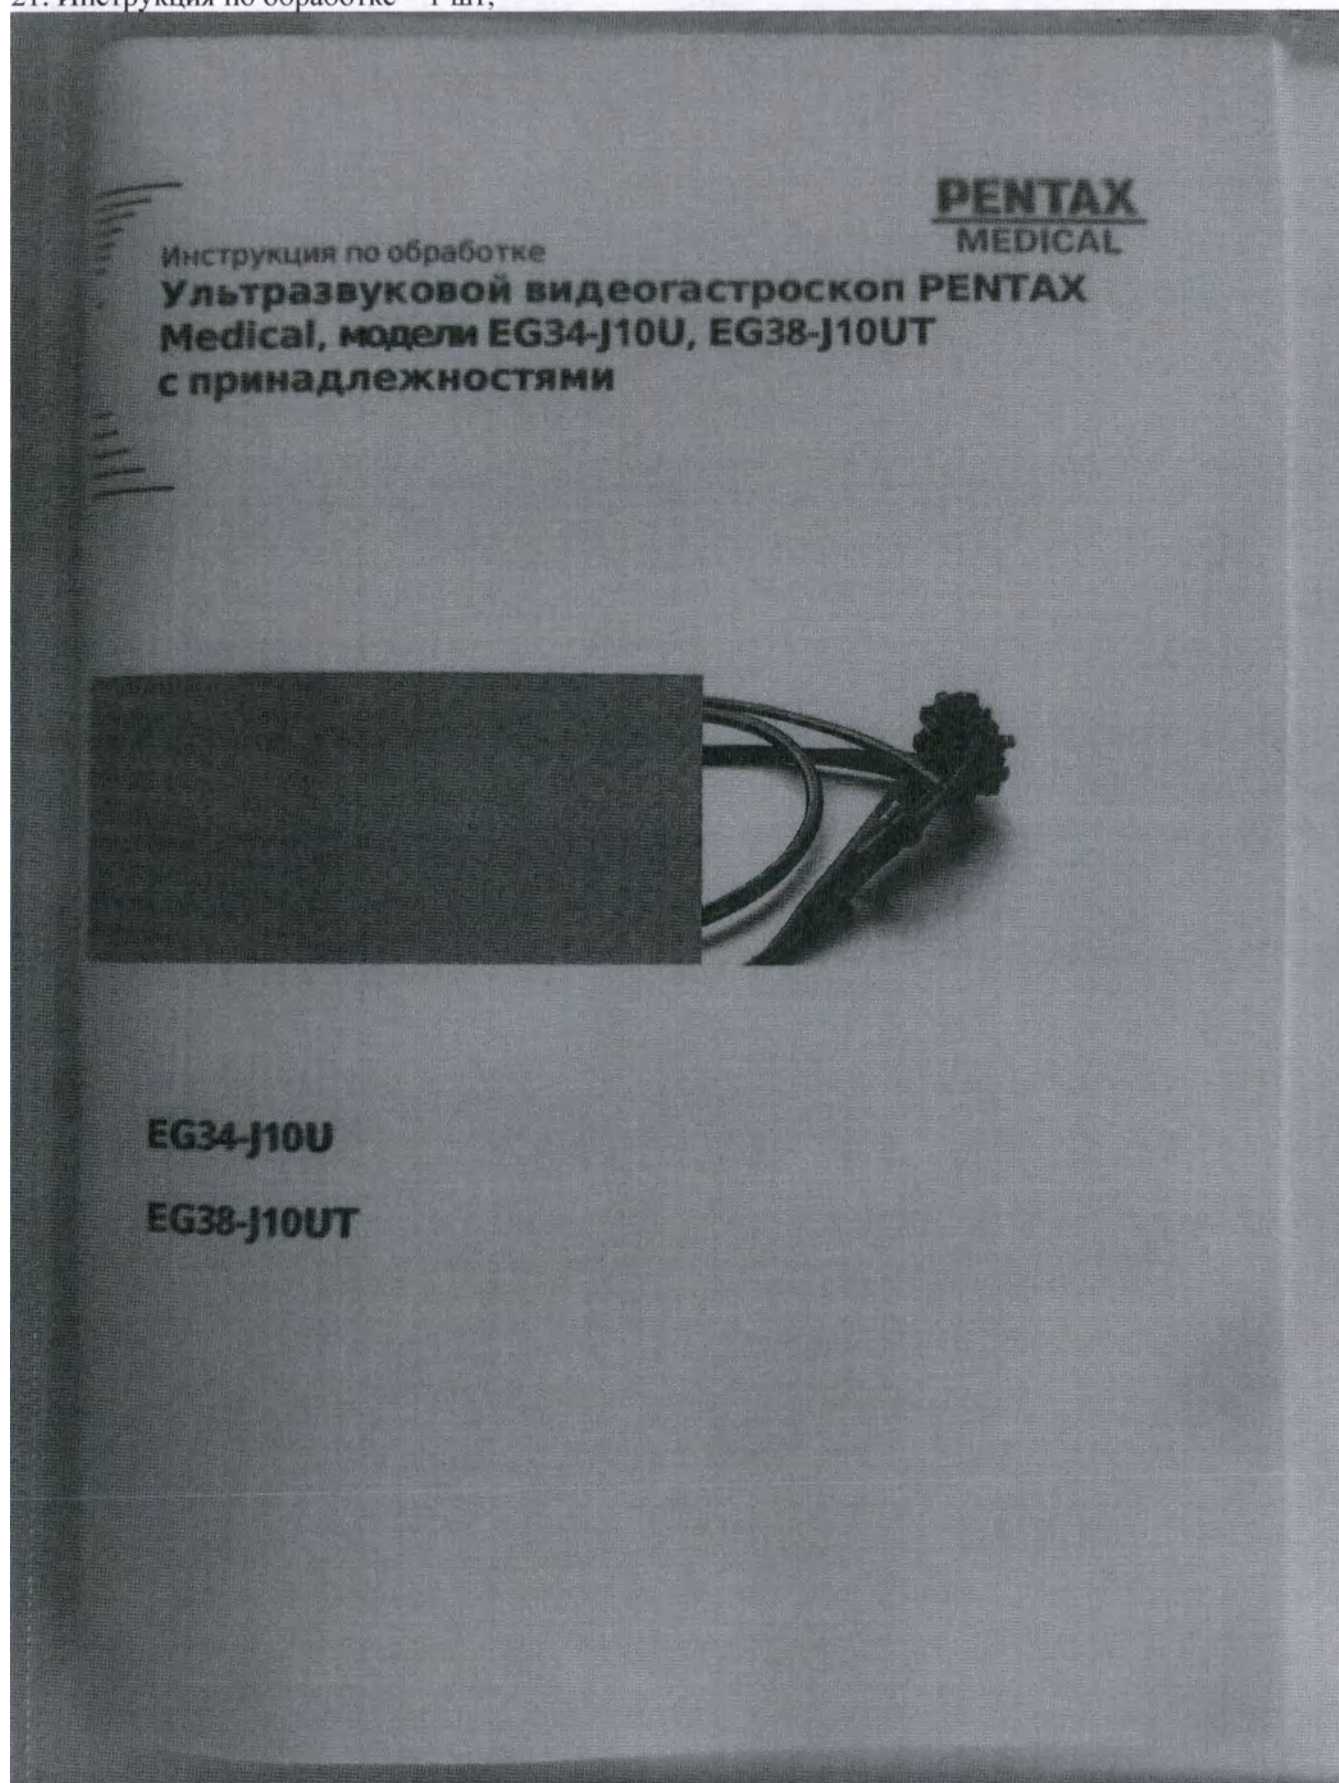

PENTAX
MEDICAL


Список стандартных принадлежностей

Ультразвуковой видеогастроскоп PENTAX Medical, модель EG34-J10U с принадлежностями

1. Ультразвуковой видеогастроскоп PENTAX Medical, модель EG34-J10U с принадлежностями – 1 шт;
Принадлежности:
 1. Набор PENTAX Medical PROFILE одноразовых чистящих щеток (синий стержень или CS2022A) (при необходимости) – 1 набор из 10 шт., не более 10 наборов;
 2. Набор PENTAX Medical PROFILE одноразовых чистящих щеток (желтый стержень или CS5522A) (при необходимости) – 1 набор из 10 шт., не более 10 наборов;
 3. Набор PENTAX Medical PROFILE одноразовых чистящих щеток (желтая рукоятка или CS-C12A) (при необходимости) – 1 набор из 10 шт., не более 10 наборов;
 4. Набор PENTAX Medical PROFILE одноразовых чистящих щеток (зеленая рукоятка или CS-C13A) (при необходимости) – 1 набор из 10 шт., не более 10 наборов;
 5. Одноразовый баллон PENTAX Medical OE-A60 (при необходимости) – не более 200 шт.;
 6. Адаптер для очистки PENTAX Medical OE-B10 (при необходимости) – не более 10 шт.;
 7. Адаптер для очистки PENTAX Medical OE-G1 (при необходимости) – не более 10 шт.;
 8. Колпачок для погружения PVE-коннектора (при необходимости) – не более 10 шт.;
 9. Колпачок PENTAX Medical для погружения коннектора ультразвукового сканера (при необходимости) – не более 10 шт.;
 10. Клапан входного отверстия (при необходимости) – не более 200 шт.;
 11. Набор уплотнительных колец для клапана управления аспирацией/ аспирацией из баллона PENTAX Medical (при необходимости) – 1 набор из 6 шт., не более 5 наборов;
 12. Набор уплотнительных колец PENTAX Medical для клапана воздуха/воды/баллона (при необходимости) – 1 набор из 6 шт. с насадкой, не более 5 наборов;
 13. Набор уплотнительных колец PENTAX Medical к адаптеру для очистки (при необходимости) – 1 набор из 5 шт. с насадкой, не более 5 наборов;
 14. Крышка PENTAX Medical для очистки входного отверстия инструментального канала (при необходимости) – не более 200 шт.;
 15. Загубник (при необходимости) – не более 10 шт.;
 16. Силиконовое масло (при необходимости) – не более 10 шт.;

17. Клапан управления аспирацией/аспирацией из баллона PENTAX Medical (при необходимости) – не более 10 шт.;
18. Клапан воздуха/воды/баллона PENTAX Medical (при необходимости) – не более 10 шт.;
19. Вентиляционный колпачок (при необходимости) – не более 10 шт.;
20. Инструкция по применению – 1 шт.;
21. Инструкция по обработке – 1 шт.;
22. Список стандартных принадлежностей – 1 шт.;
23. Кейс – 1 шт.


23. Кетг - 1 шт.

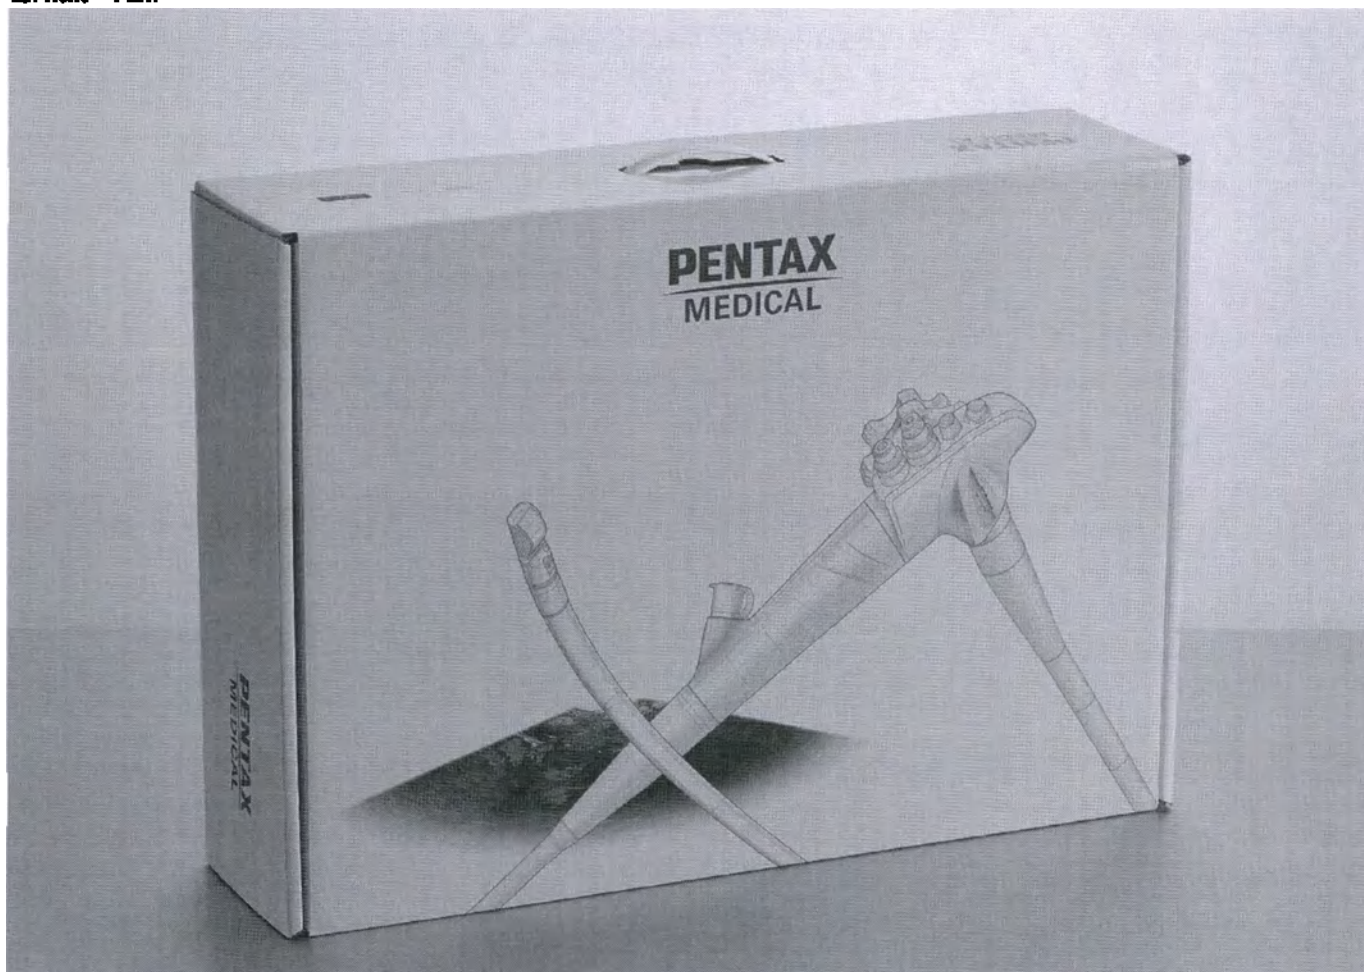


Ультразвуковой видеогастроскоп PENTAX Medical, модель EG38-J10UT с принадлежностями




Принадлежности: 1. Набор PENTAX Medical PROFILE одноразовых чистящих щеток (синий стержень или CS2022A)

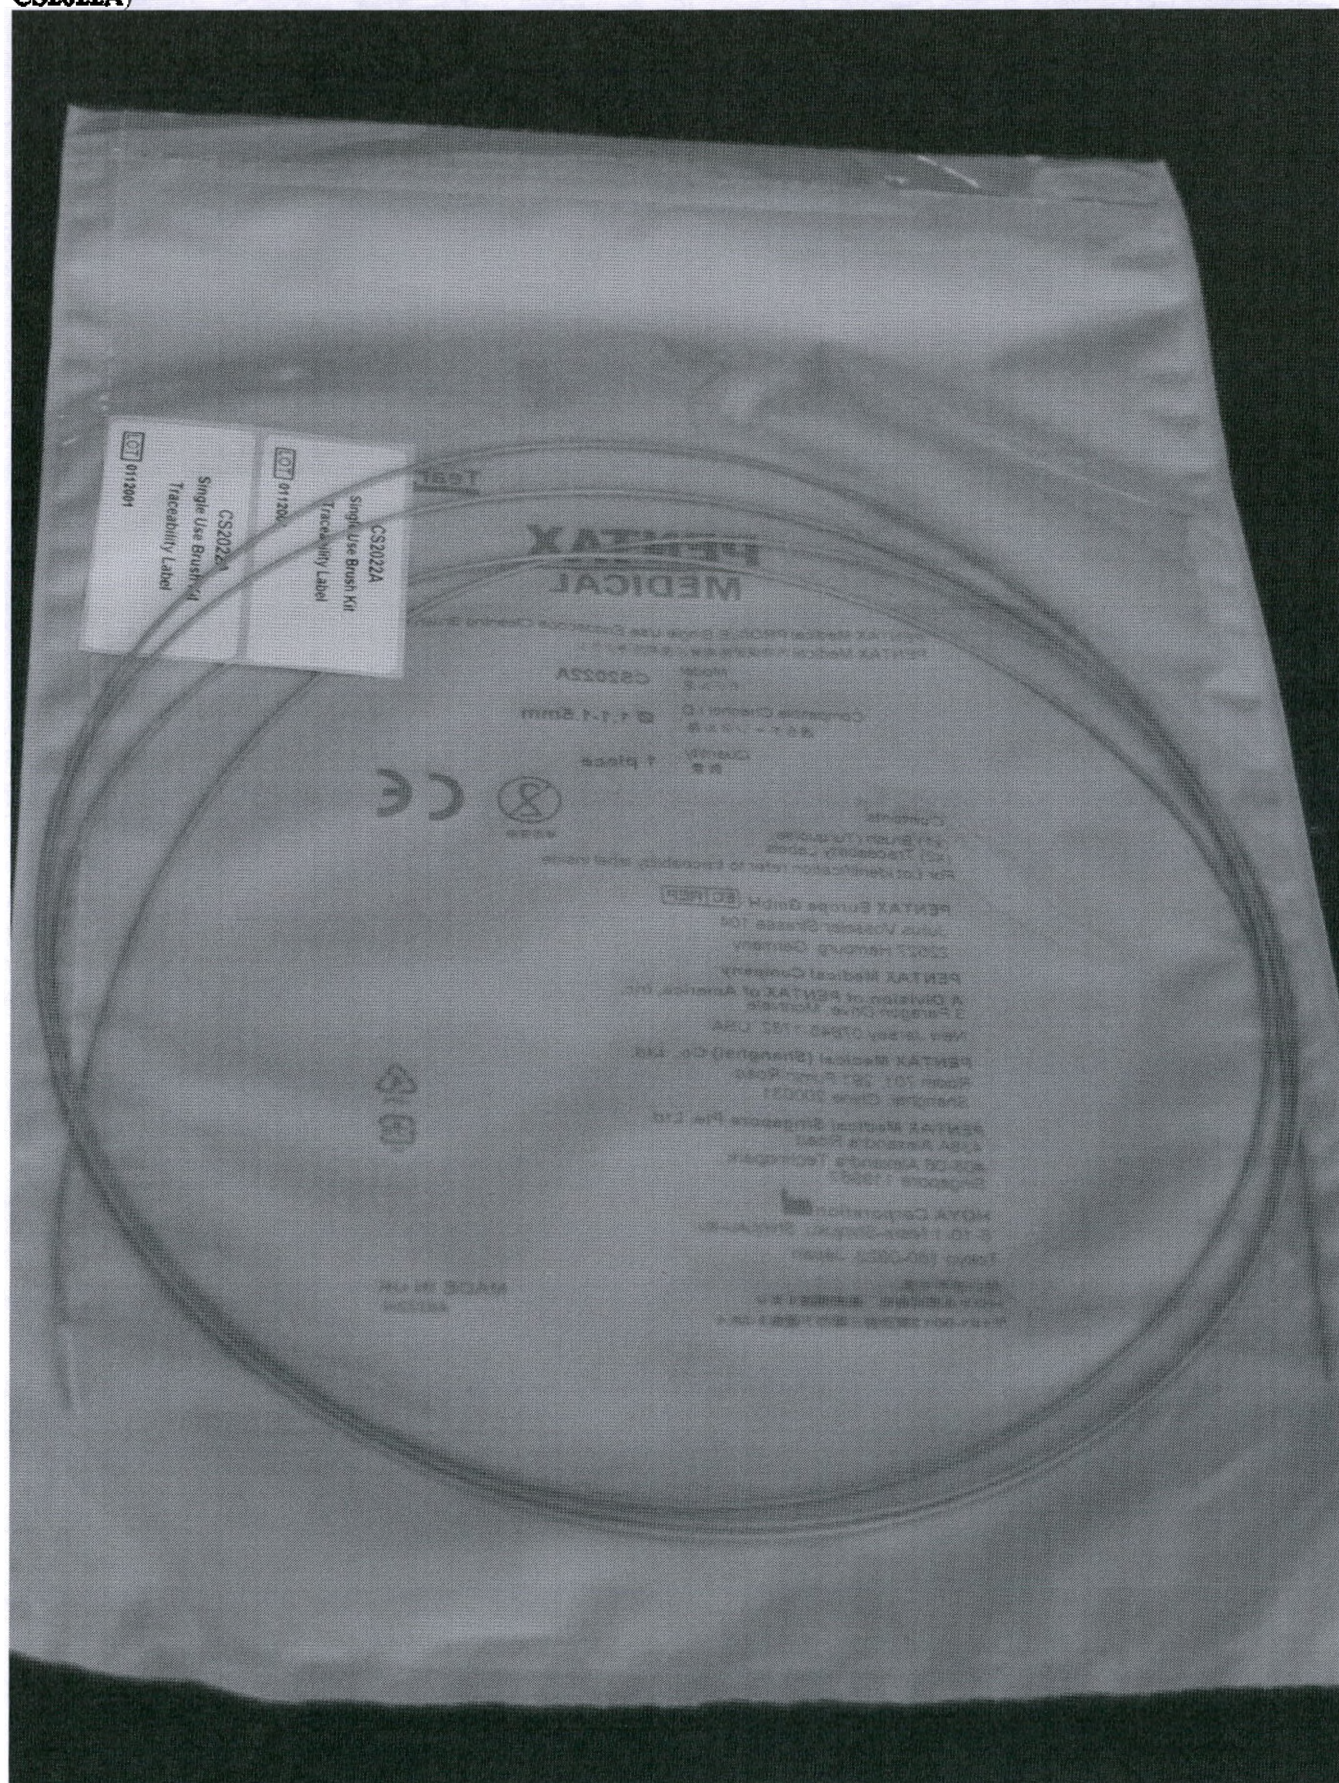

2. Набор PENTAX Medical PROFILE одноразовых чистящих щеток (желтый стержень или CS5522A)
– 1 набор из 10 шт.

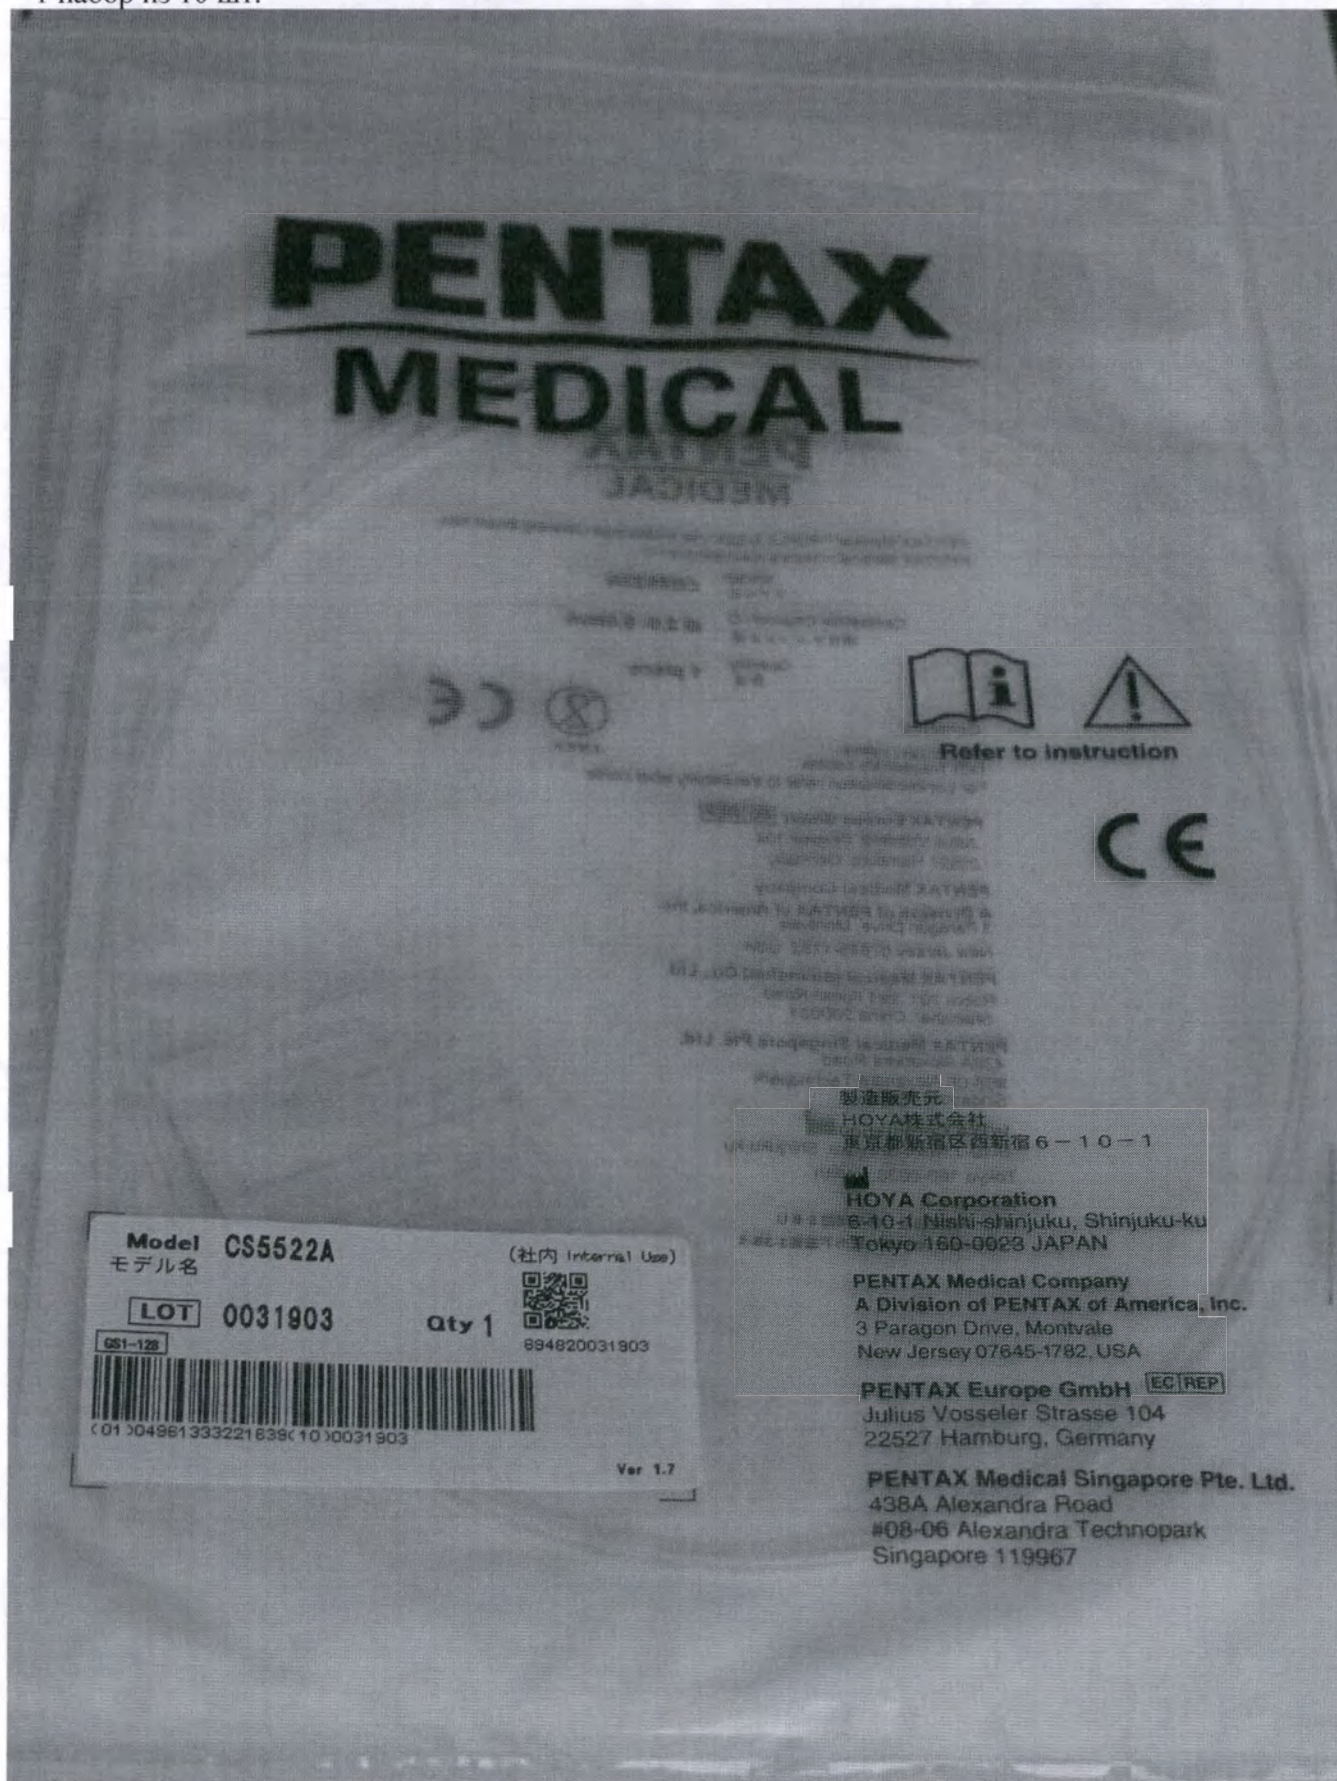


3. Набор PENTAX Medical PROFILE одноразовых чистящих щеток (желтая рукоятка или CS-C12A)
– 1 набор из 10 шт.

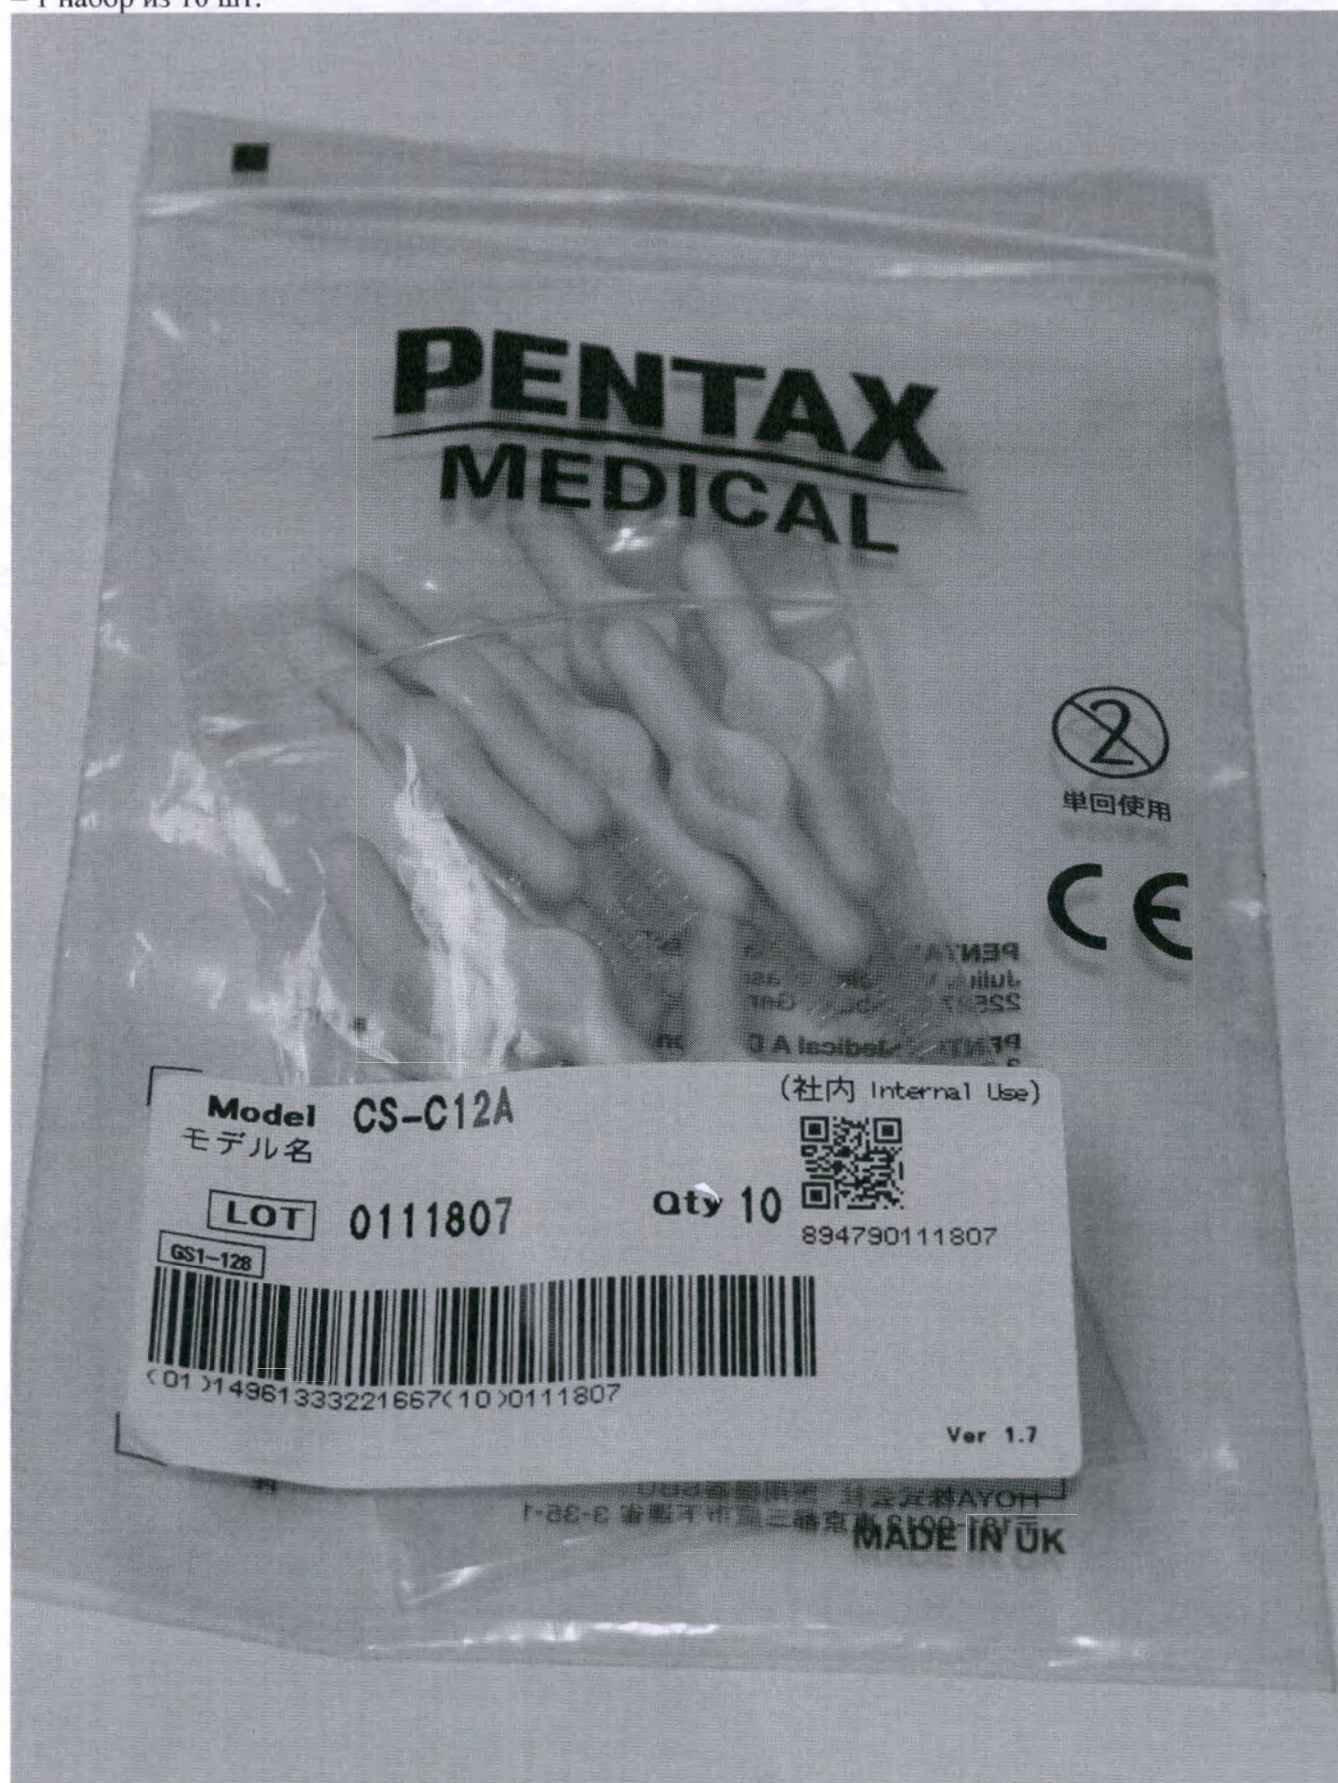


4. Набор PENTAX Medical PROFILE одноразовых чистящих щеток (зеленая рукоятка или CS-C13A – 1 набор из 10 шт.




5. Одноразовый баллон PENTAX Medical (OE-A60)

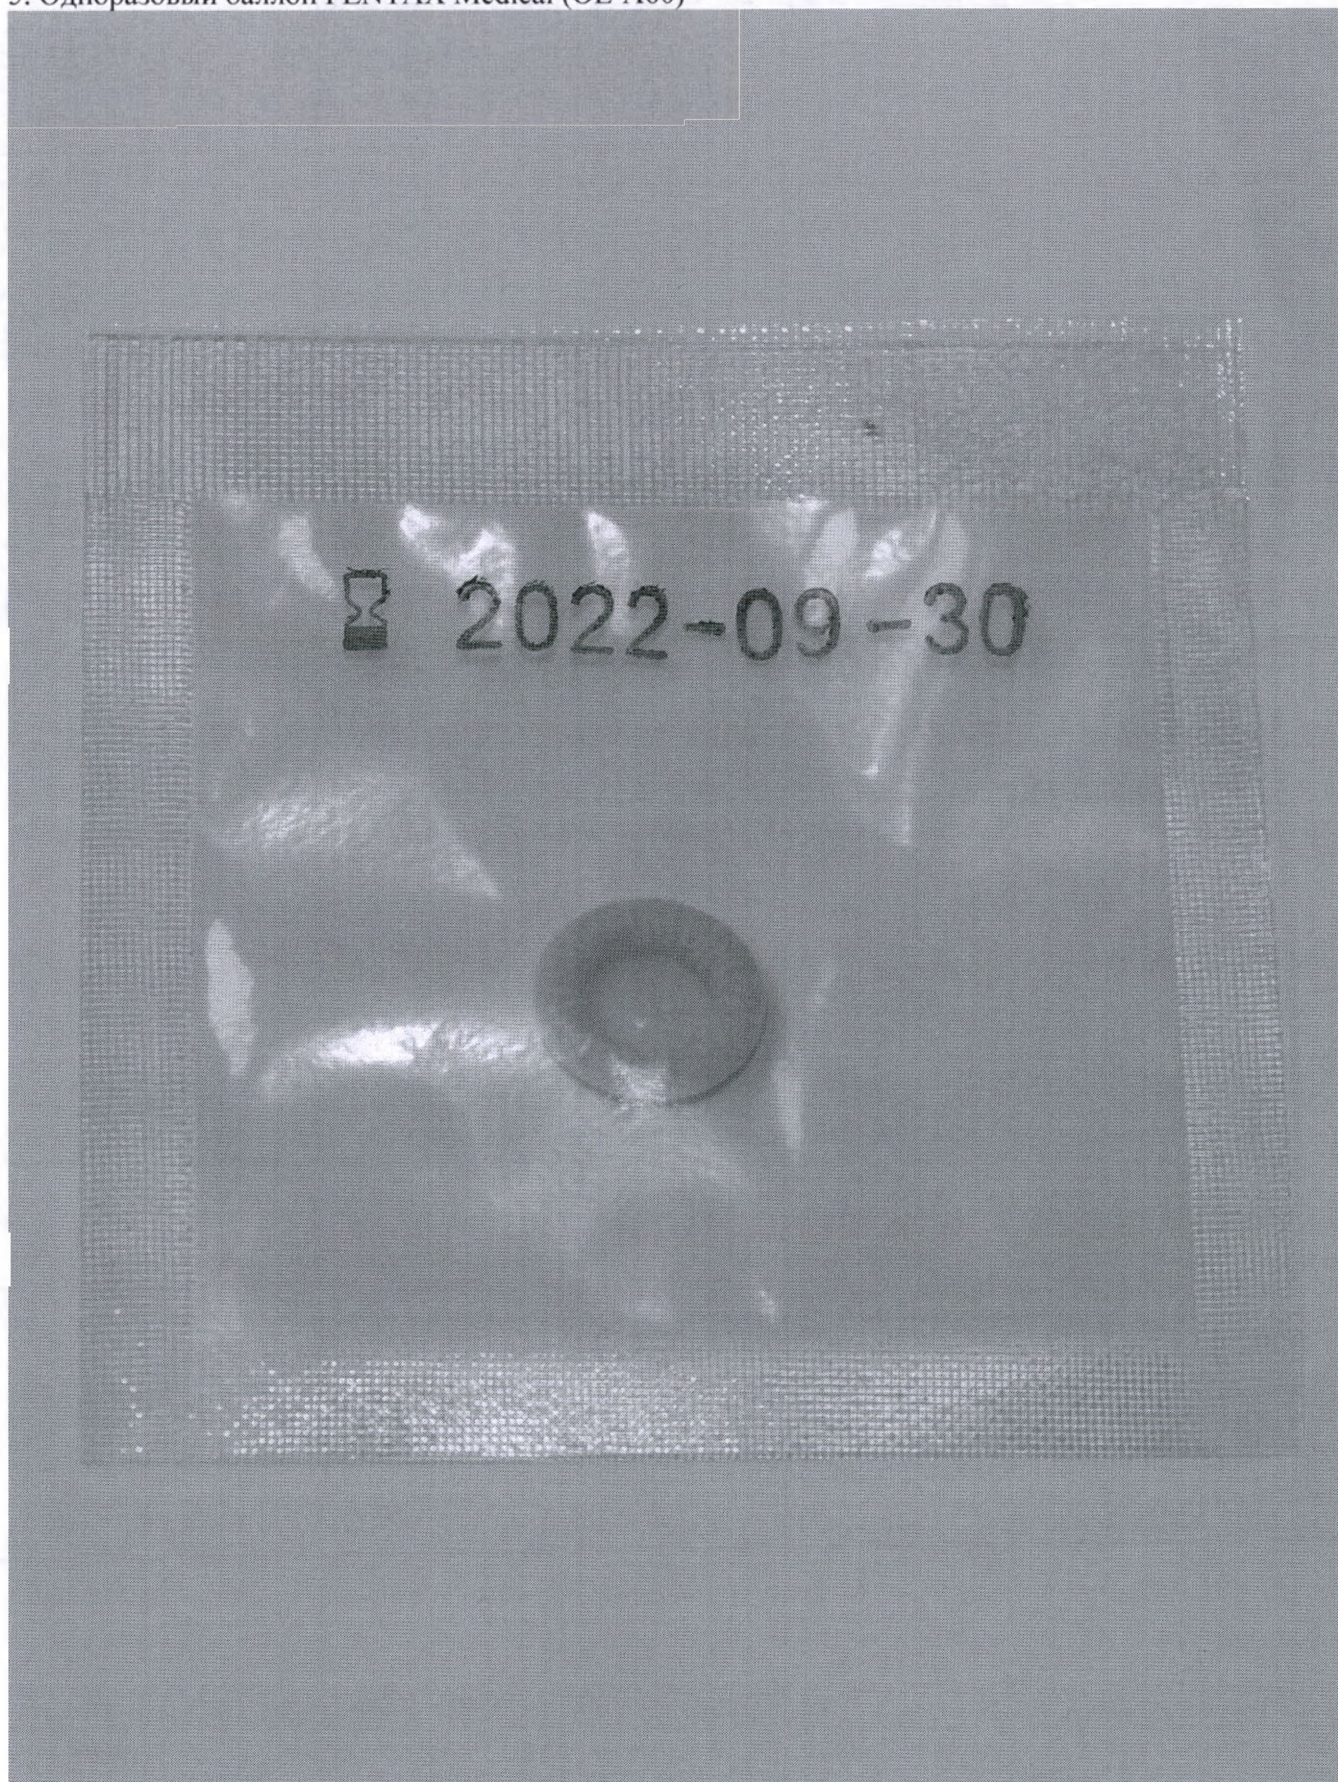


6. Адаптер для очистки PENTAX Medical (OE-B10)

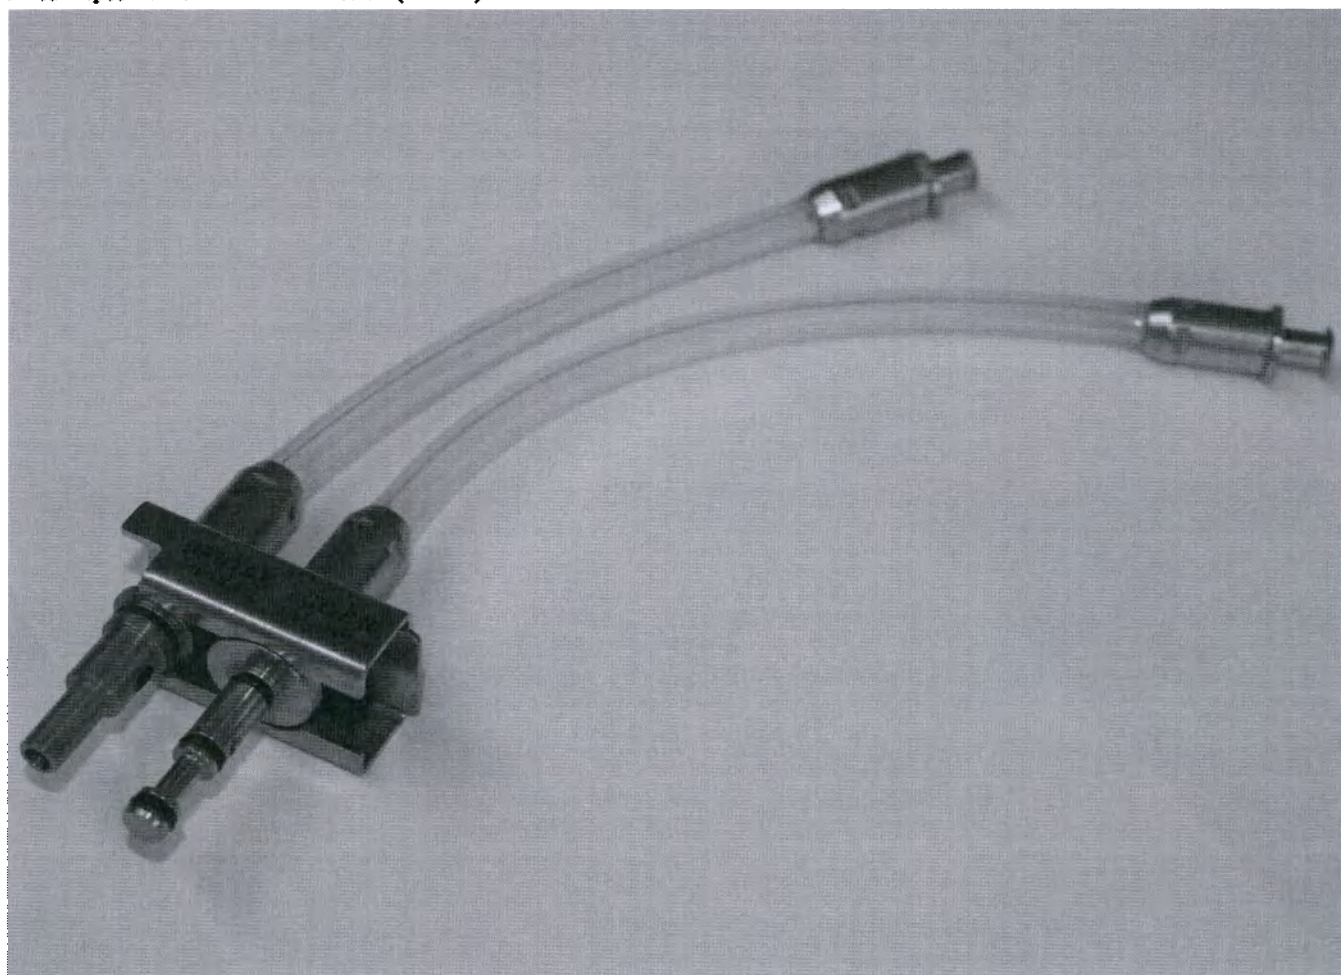


7. Адаптер для очистки PENTAX Medical (OE-G1)

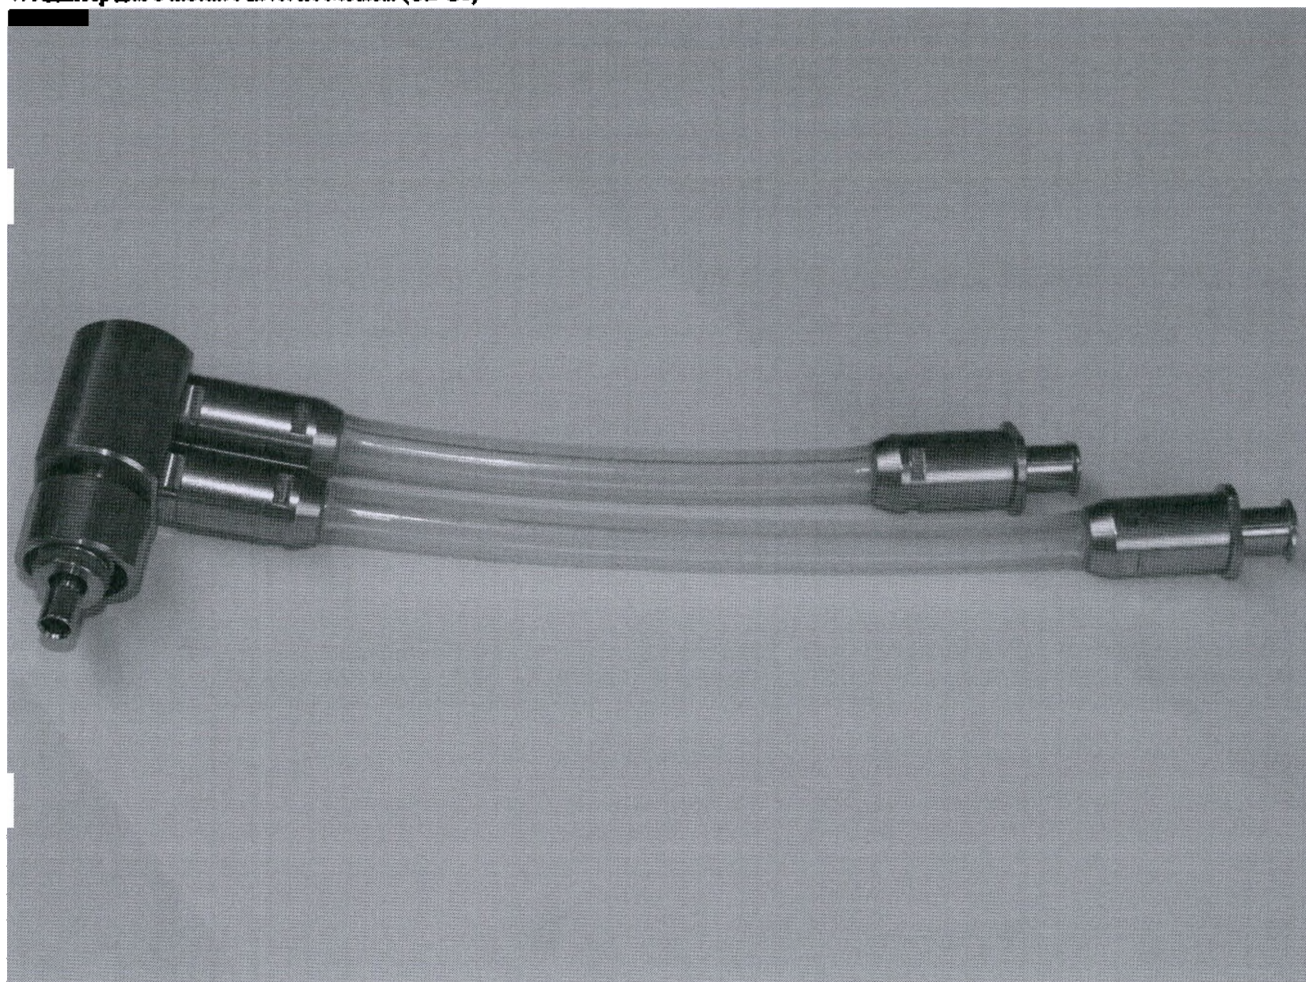

8. Колпачок для погружения PVE-коннектора

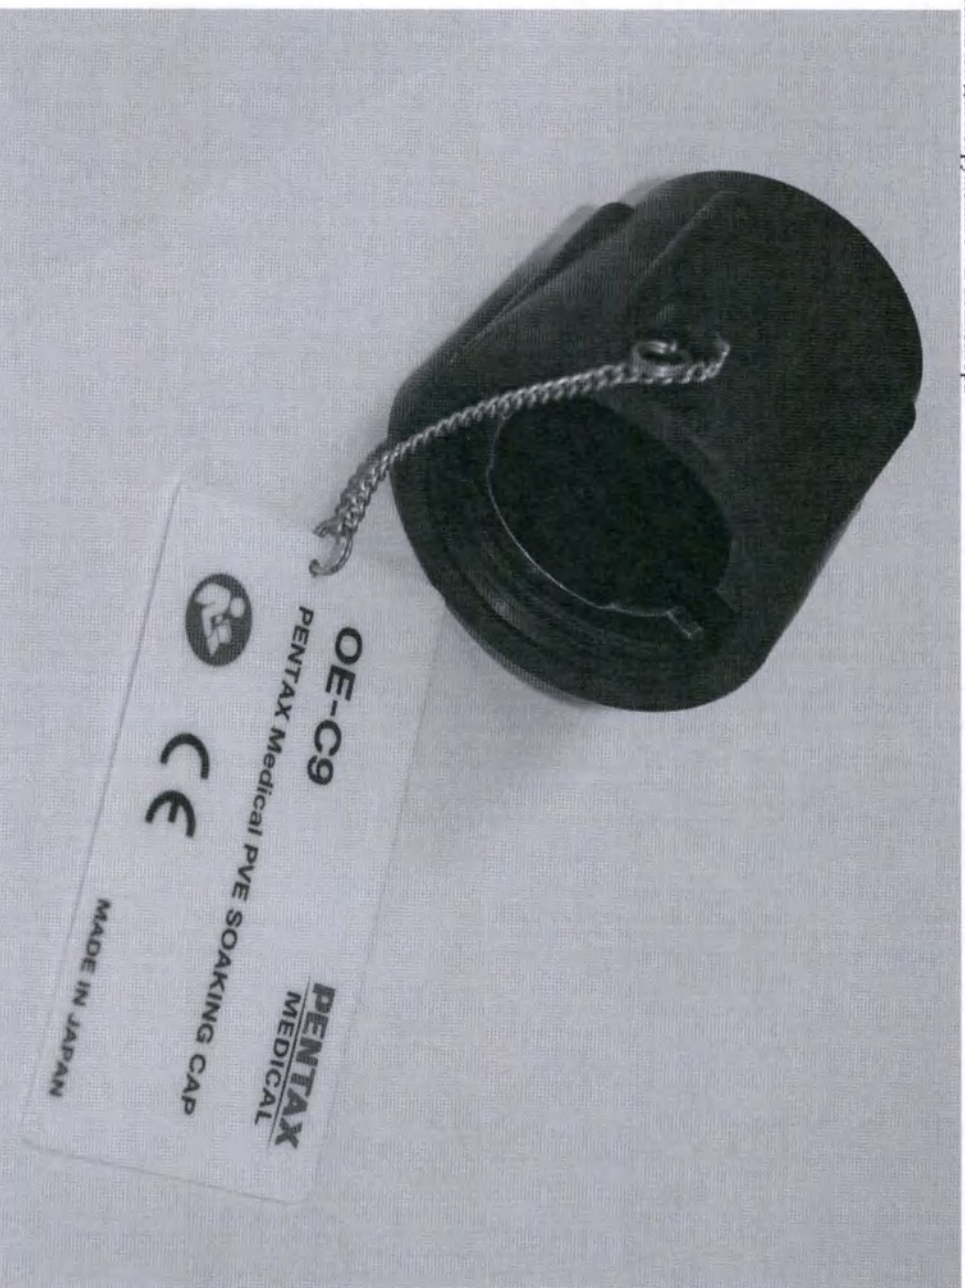

9. Колпачок PENTAX Medical для погружения коннектора ультразвукового сканера

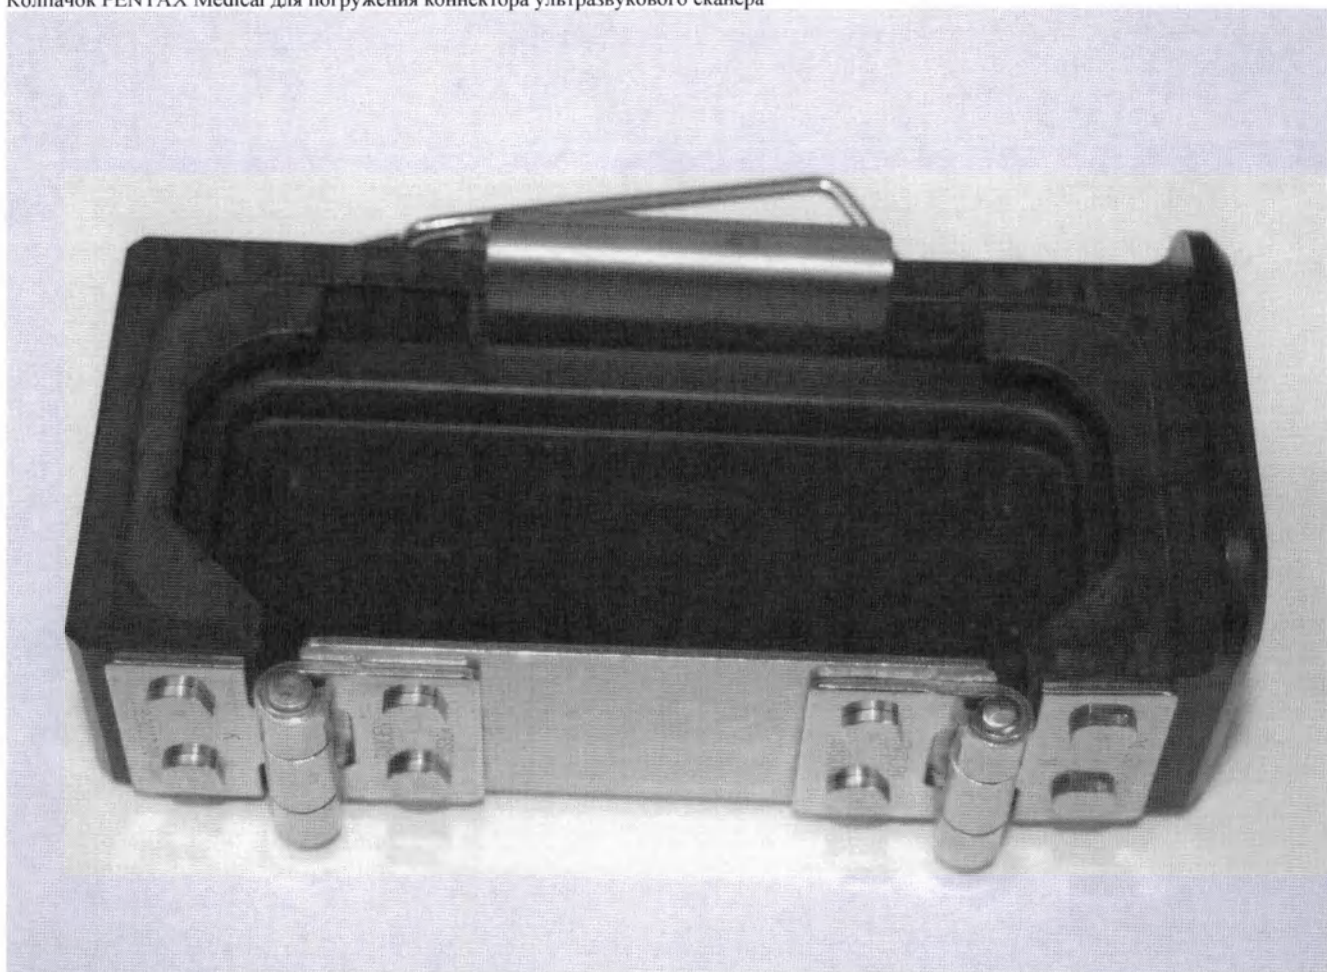


10. Клапан входного отверстия


Клапан входного отверстия




11. Набор уплотнительных колец для клапана управления аспирацией/ аспирацией из баллона PENTAX Medical – 1 набор из 6 шт.

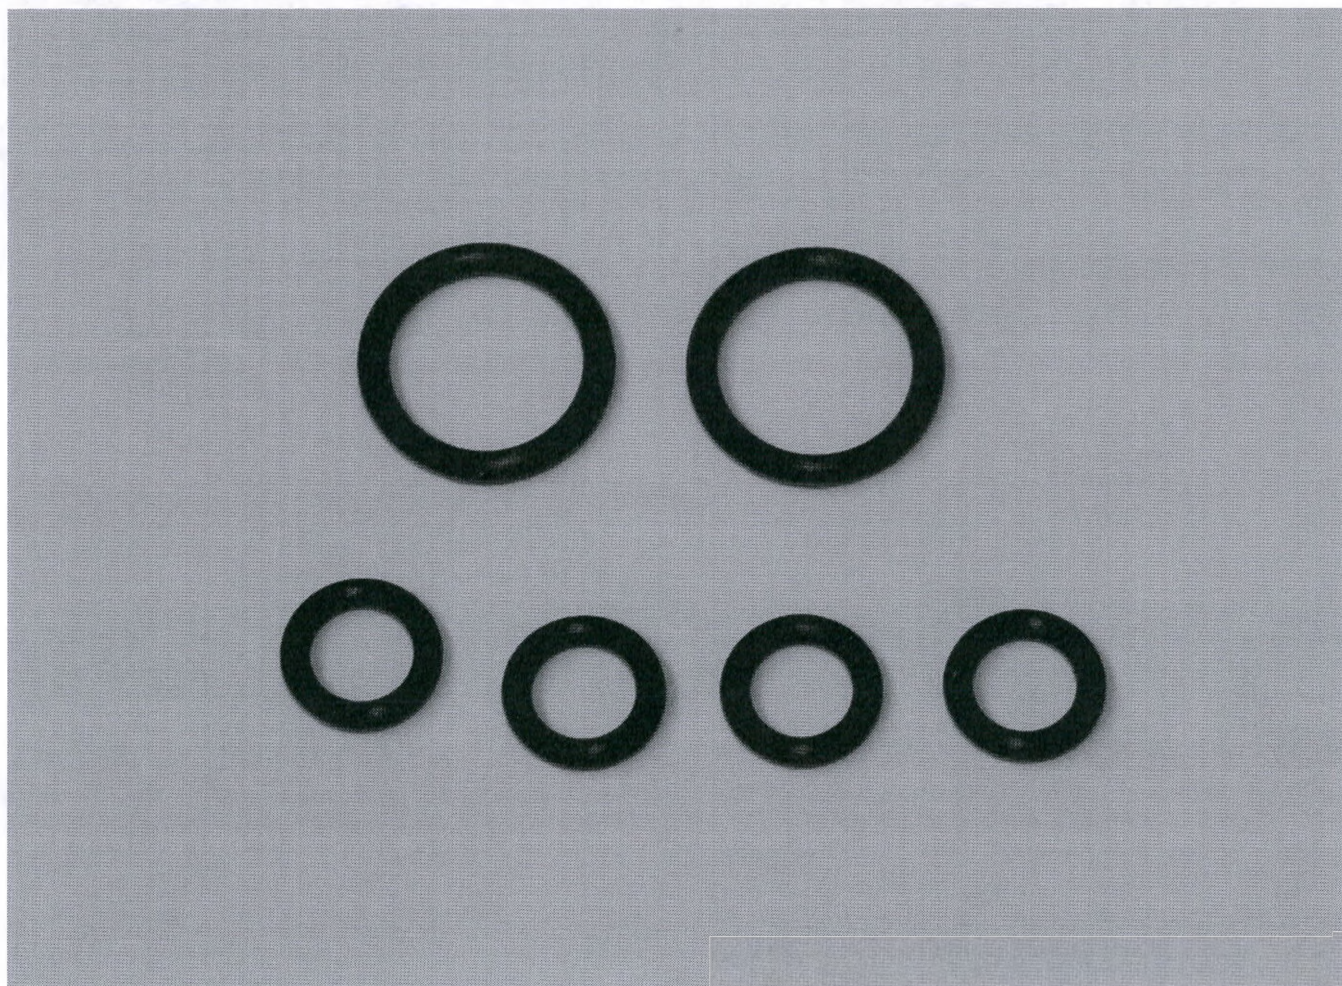

12. Набор уплотнительных колец PENTAX Medical для клапана воздуха/воды/баллона с насадкой- 1 набор из 6 шт.

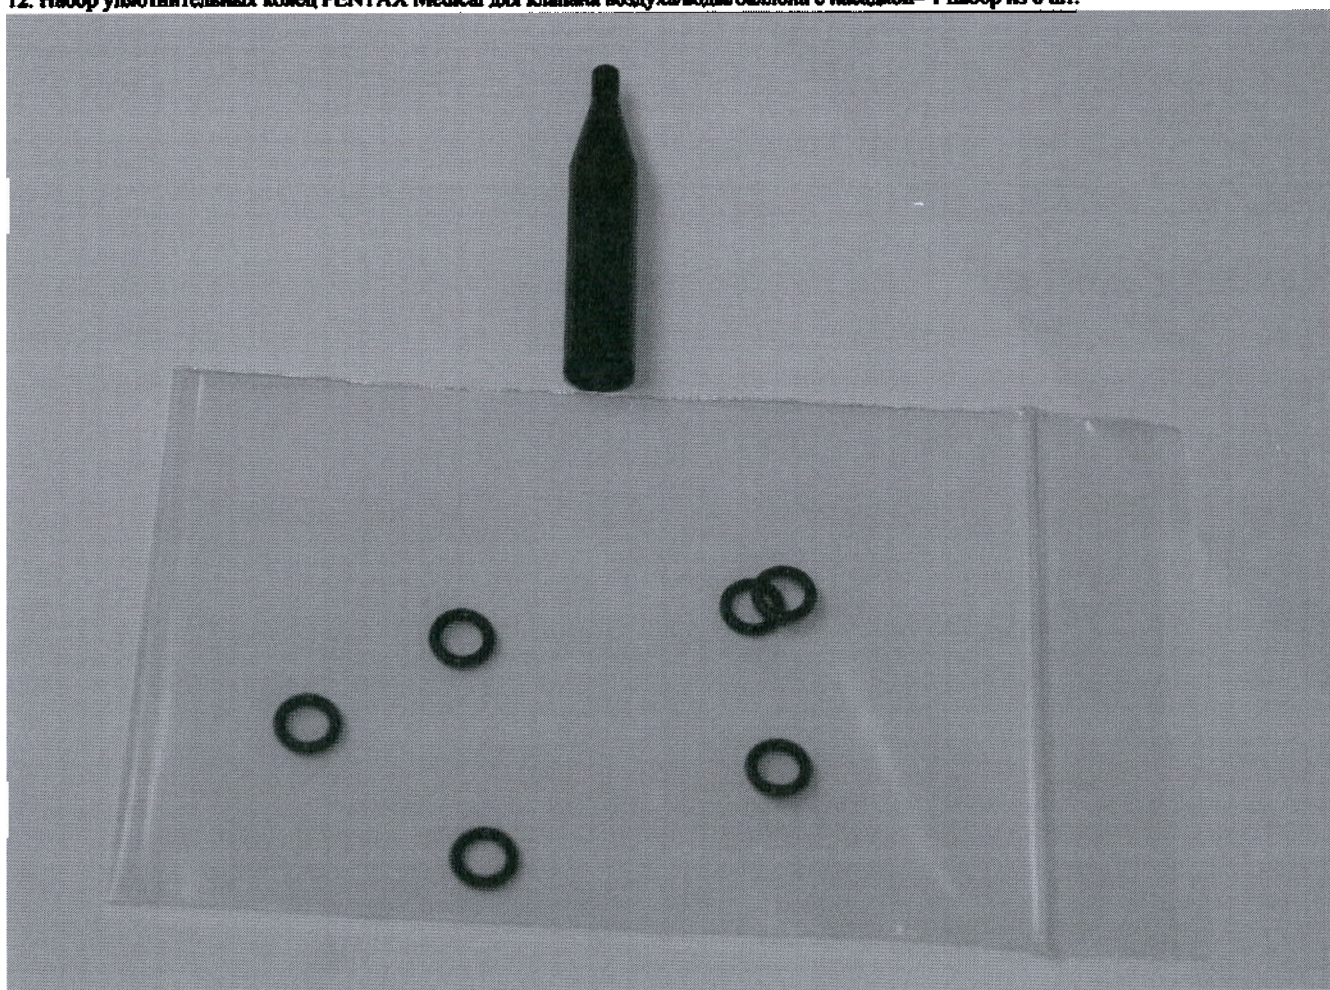


13. Набор уплотнительных колец PENTAX Medical к адаптеру для очистки с насадкой – 1 набор из 5 шт.

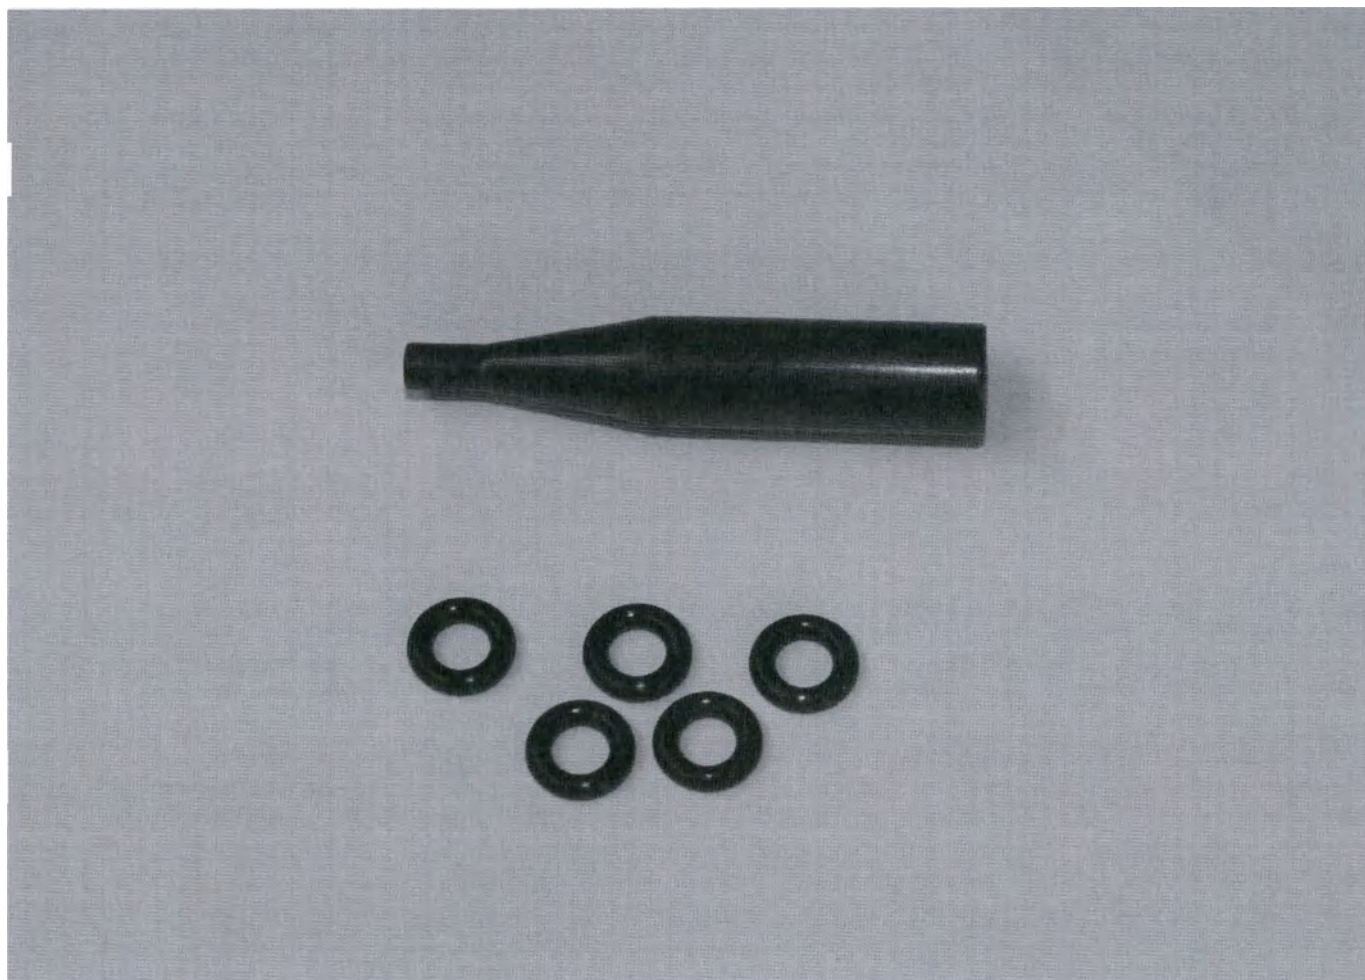


14. Крышка PENTAX Medical для очистки входного отверстия инструментального канала




15. Загубник

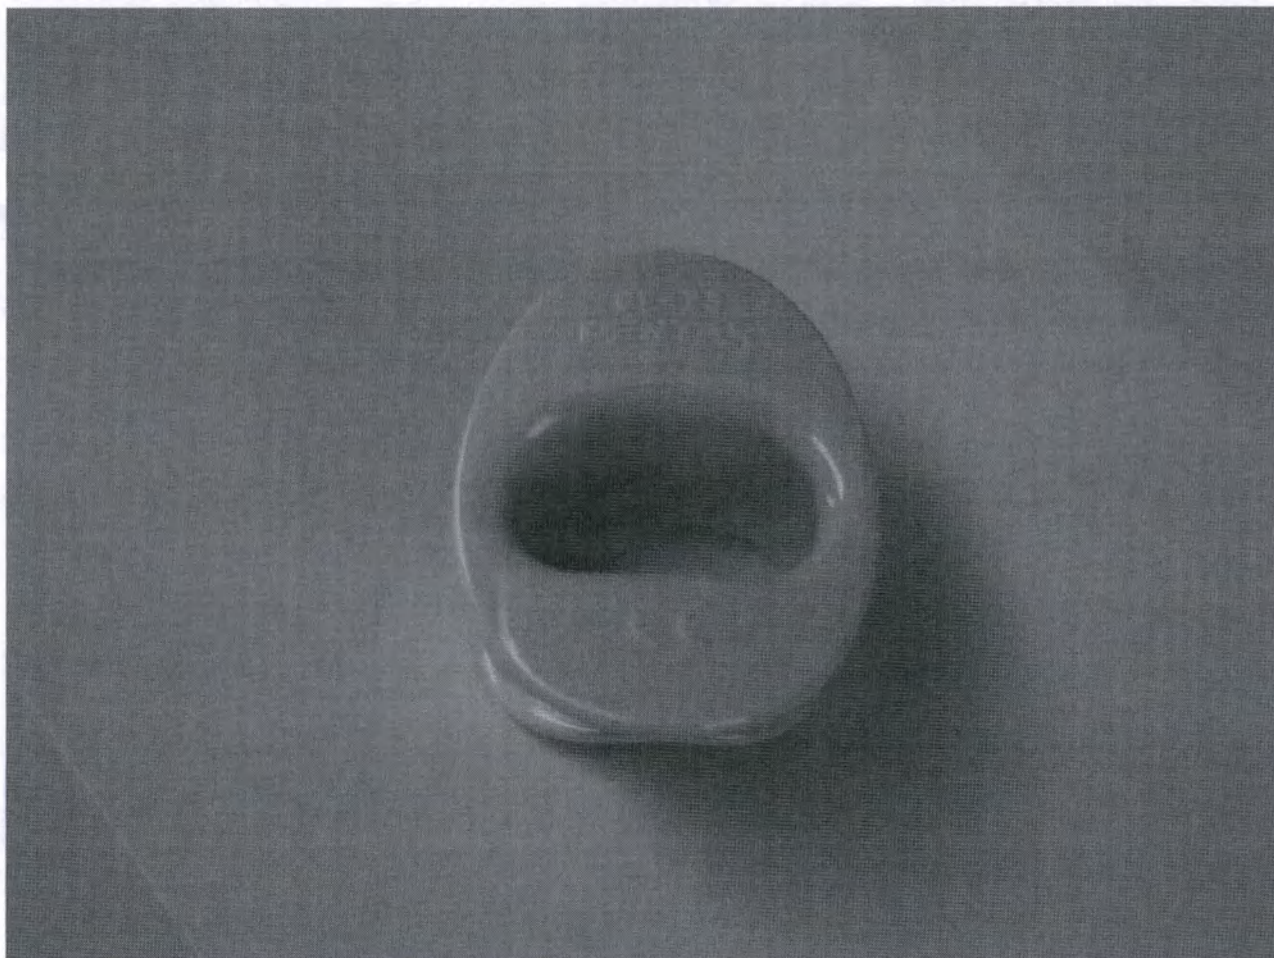


16. Силиконовое масло

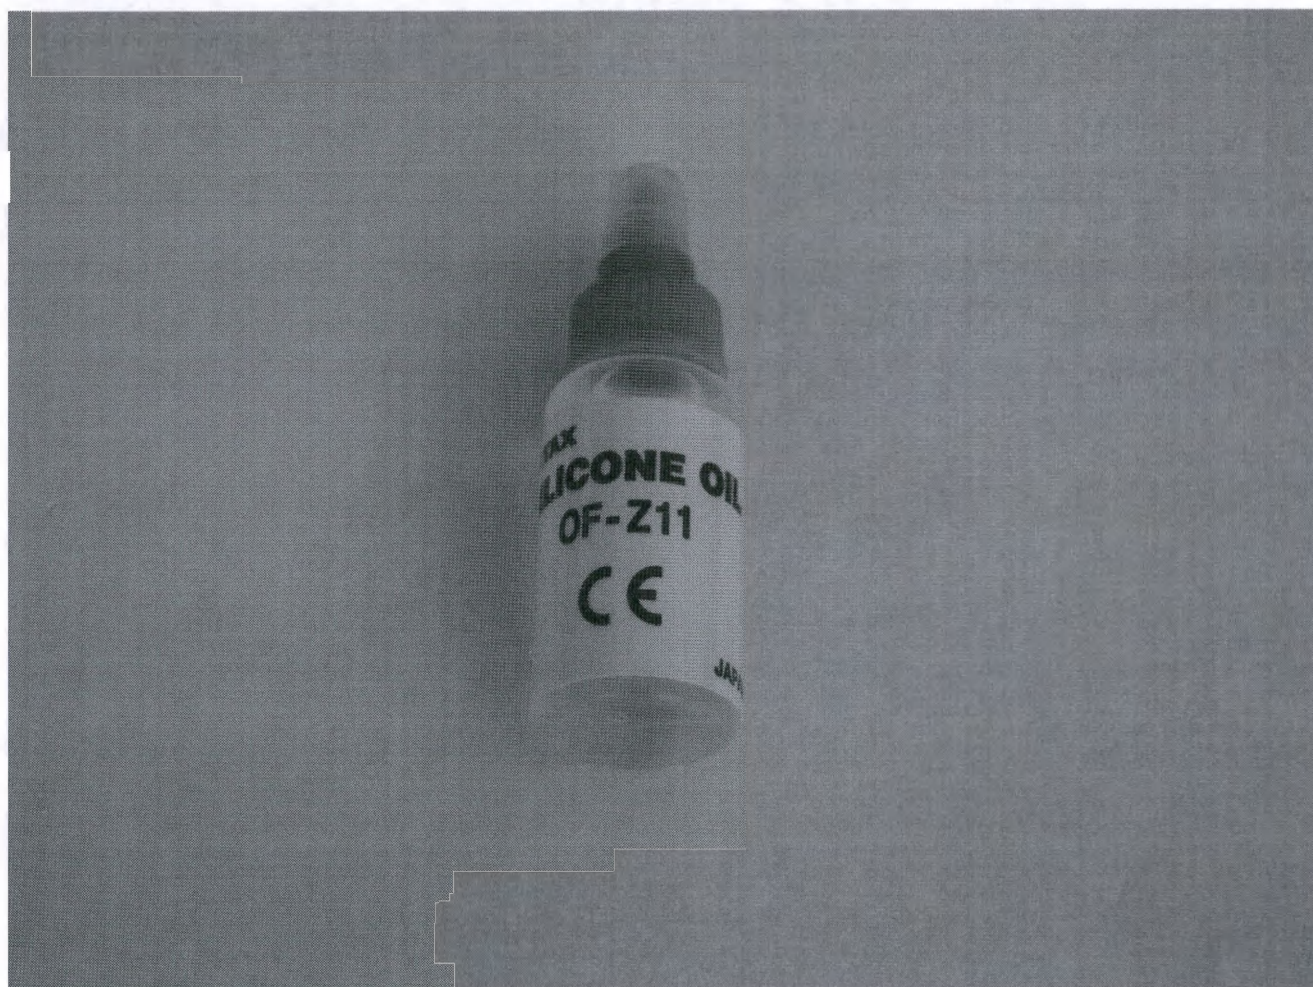

17. Клапан управления аспирацией/аспирацией из баллона PENTAX Medical

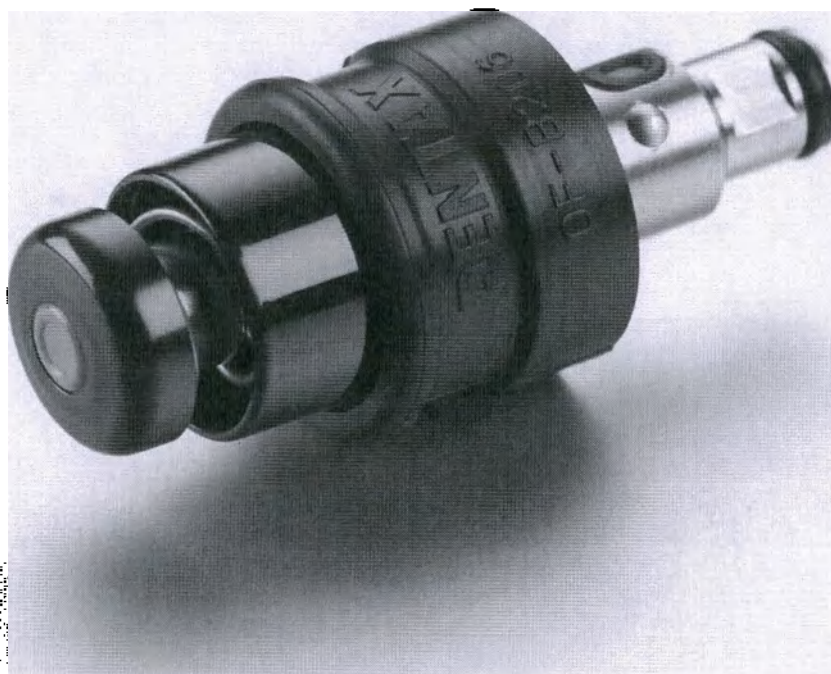

18. Клапан воздуха/воды/баллона PENTAX Medical

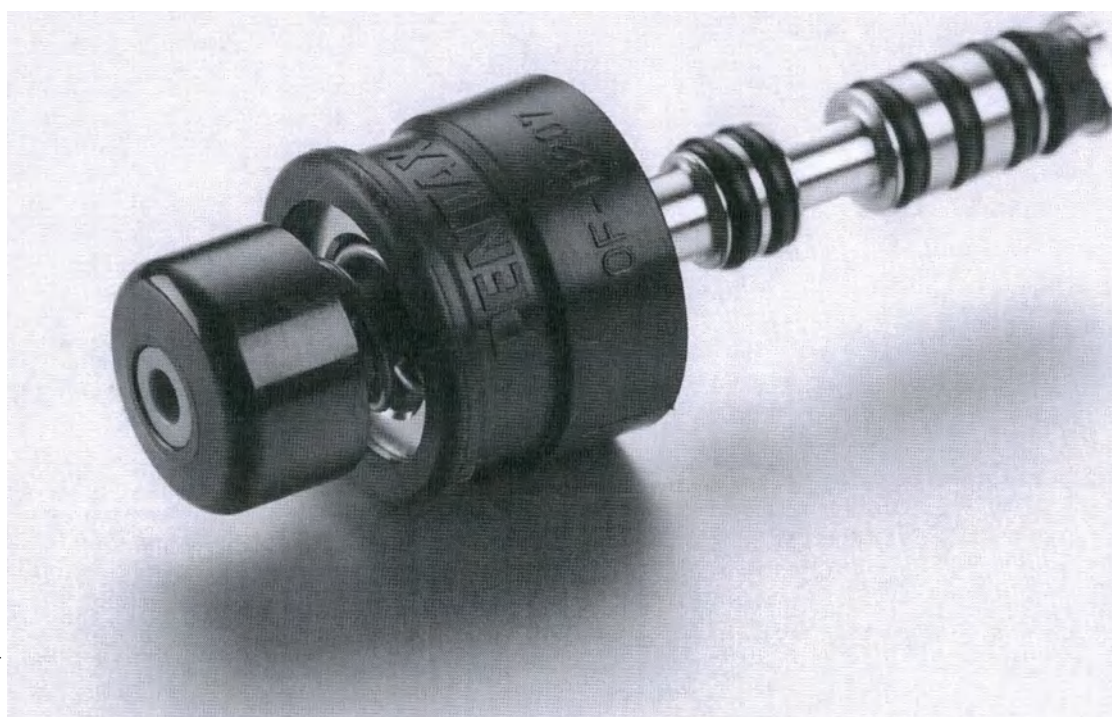

19. Вентиляционный колпачок



20. Инструкция по применению – 1 шт.;

Инструкция по эксплуатации

**Ультразвуковой видеогастроскоп PENTAX
Medical, модели EG34-J10U, EG38-J10UT
с принадлежностями**


PENTAX
MEDICAL



EG34-J10U

EG38-J10UT

21. Инструкция по обработке – 1 шт;

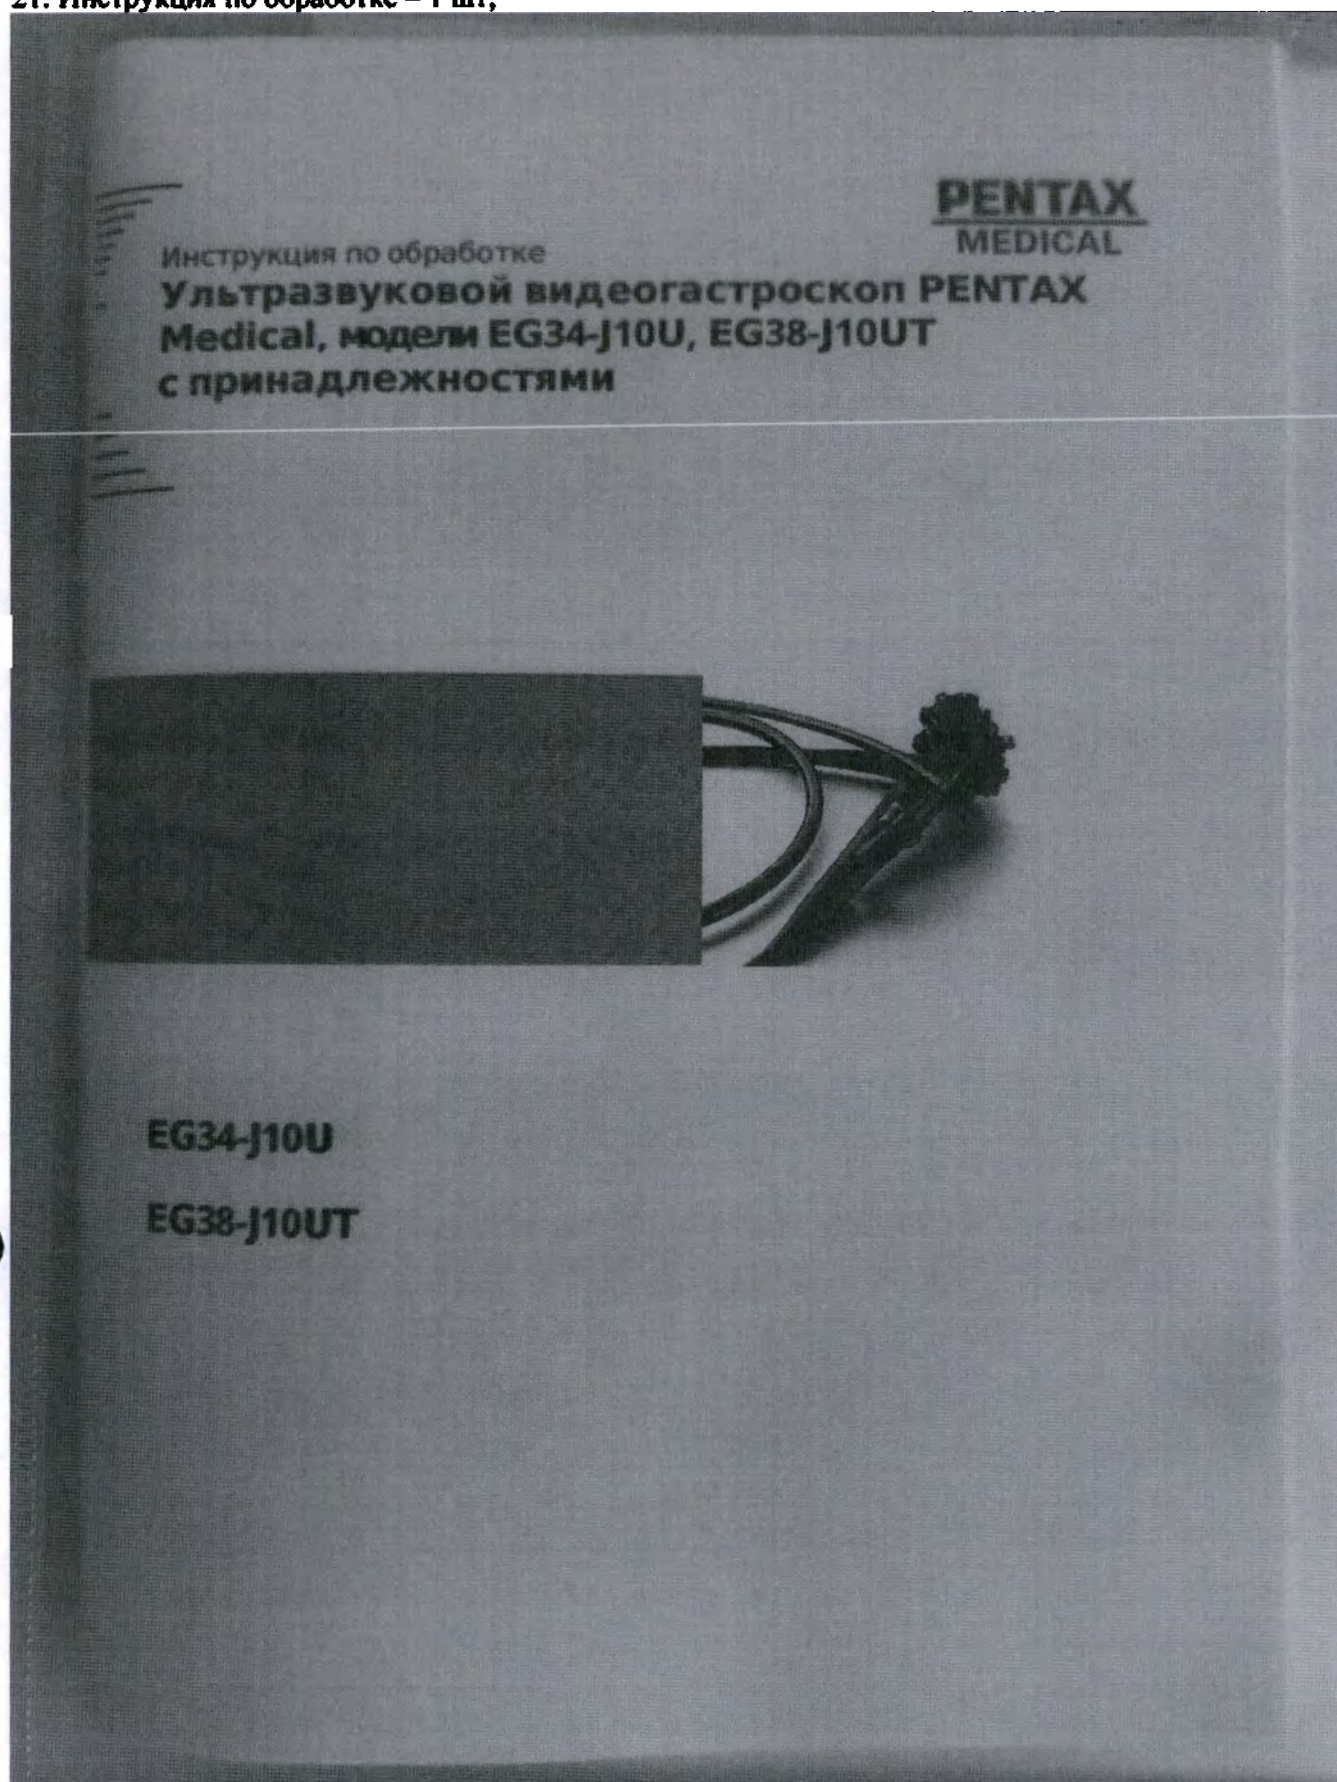

PENTAX
MEDICAL

Список стандартных принадлежностей

Ультразвуковой видеогастроскоп PENTAX Medical, модель EG38-J10UT с принадлежностями

1. Ультразвуковой видеогастроскоп PENTAX Medical, модель EG38-J10UT с принадлежностями – 1 шт.;

Принадлежности:

1. Набор PENTAX Medical PROFILE одноразовых чистящих щеток (синий стержень или CS2022A) (при необходимости) – 1 набор из 10 шт., не более 10 наборов;
2. Набор PENTAX Medical PROFILE одноразовых чистящих щеток (желтый стержень или CS5522A) (при необходимости) – 1 набор из 10 шт., не более 10 наборов;
3. Набор PENTAX Medical PROFILE одноразовых чистящих щеток (желтая рукоятка или CS-C12A) (при необходимости) – 1 набор из 10 шт., не более 10 наборов;
4. Набор PENTAX Medical PROFILE одноразовых чистящих щеток (зеленая рукоятка или CS-C13A) (при необходимости) – 1 набор из 10 шт., не более 10 наборов;
5. Одноразовый баллон PENTAX Medical OE-A60 (при необходимости) – не более 200 шт.;
6. Адаптер для очистки PENTAX Medical OE-B10 (при необходимости) – не более 10 шт.;
7. Адаптер для очистки PENTAX Medical OE-G1 (при необходимости) – не более 10 шт.;
8. Колпачок для погружения PVE-коннектора (при необходимости) – не более 10 шт.;
9. Колпачок PENTAX Medical для погружения коннектора ультразвукового сканера (при необходимости) – не более 10 шт.;
10. Клапан входного отверстия (при необходимости) – не более 200 шт.;
11. Набор уплотнительных колец для клапана управления аспирацией/аспирацией из баллона PENTAX Medical (при необходимости) – 1 набор из 6 шт., не более 5 наборов;
12. Набор уплотнительных колец PENTAX Medical для клапана воздуха/воды/баллона (при необходимости) – 1 набор из 6 шт. с насадкой, не более 5 наборов;
13. Набор уплотнительных колец PENTAX Medical к адаптеру для очистки (при необходимости) – 1 набор из 5 шт. с насадкой, не более 5 наборов;
14. Крышка PENTAX Medical для очистки входного отверстия инструментального канала (при необходимости) – не более 200 шт.;
15. Загубник (при необходимости) – не более 10 шт.;

16. Силиконовое масло (при необходимости) – не более 10 шт.;
17. Клапан управления аспирацией/аспирацией из баллона PENTAX Medical (при необходимости) – не более 10 шт.;
18. Клапан воздуха/воды/баллона PENTAX Medical (при необходимости) – не более 10 шт.;
19. Вентиляционный колпачок (при необходимости) – не более 10 шт.;
20. Инструкция по применению – 1 шт.;
21. Инструкция по обработке – 1 шт.;
22. Список стандартных принадлежностей – 1 шт.;
23. Кейс – 1 шт.


23. Кейс – 1 шт.




Ультразвуковой видеогастроскоп PENTAX Medical, модель EG36-J10UR с принадлежностями




Принадлежности: 1. Набор PENTAX Medical PROFILE одноразовых чистящих щеток (синий стержень или CS2022A)

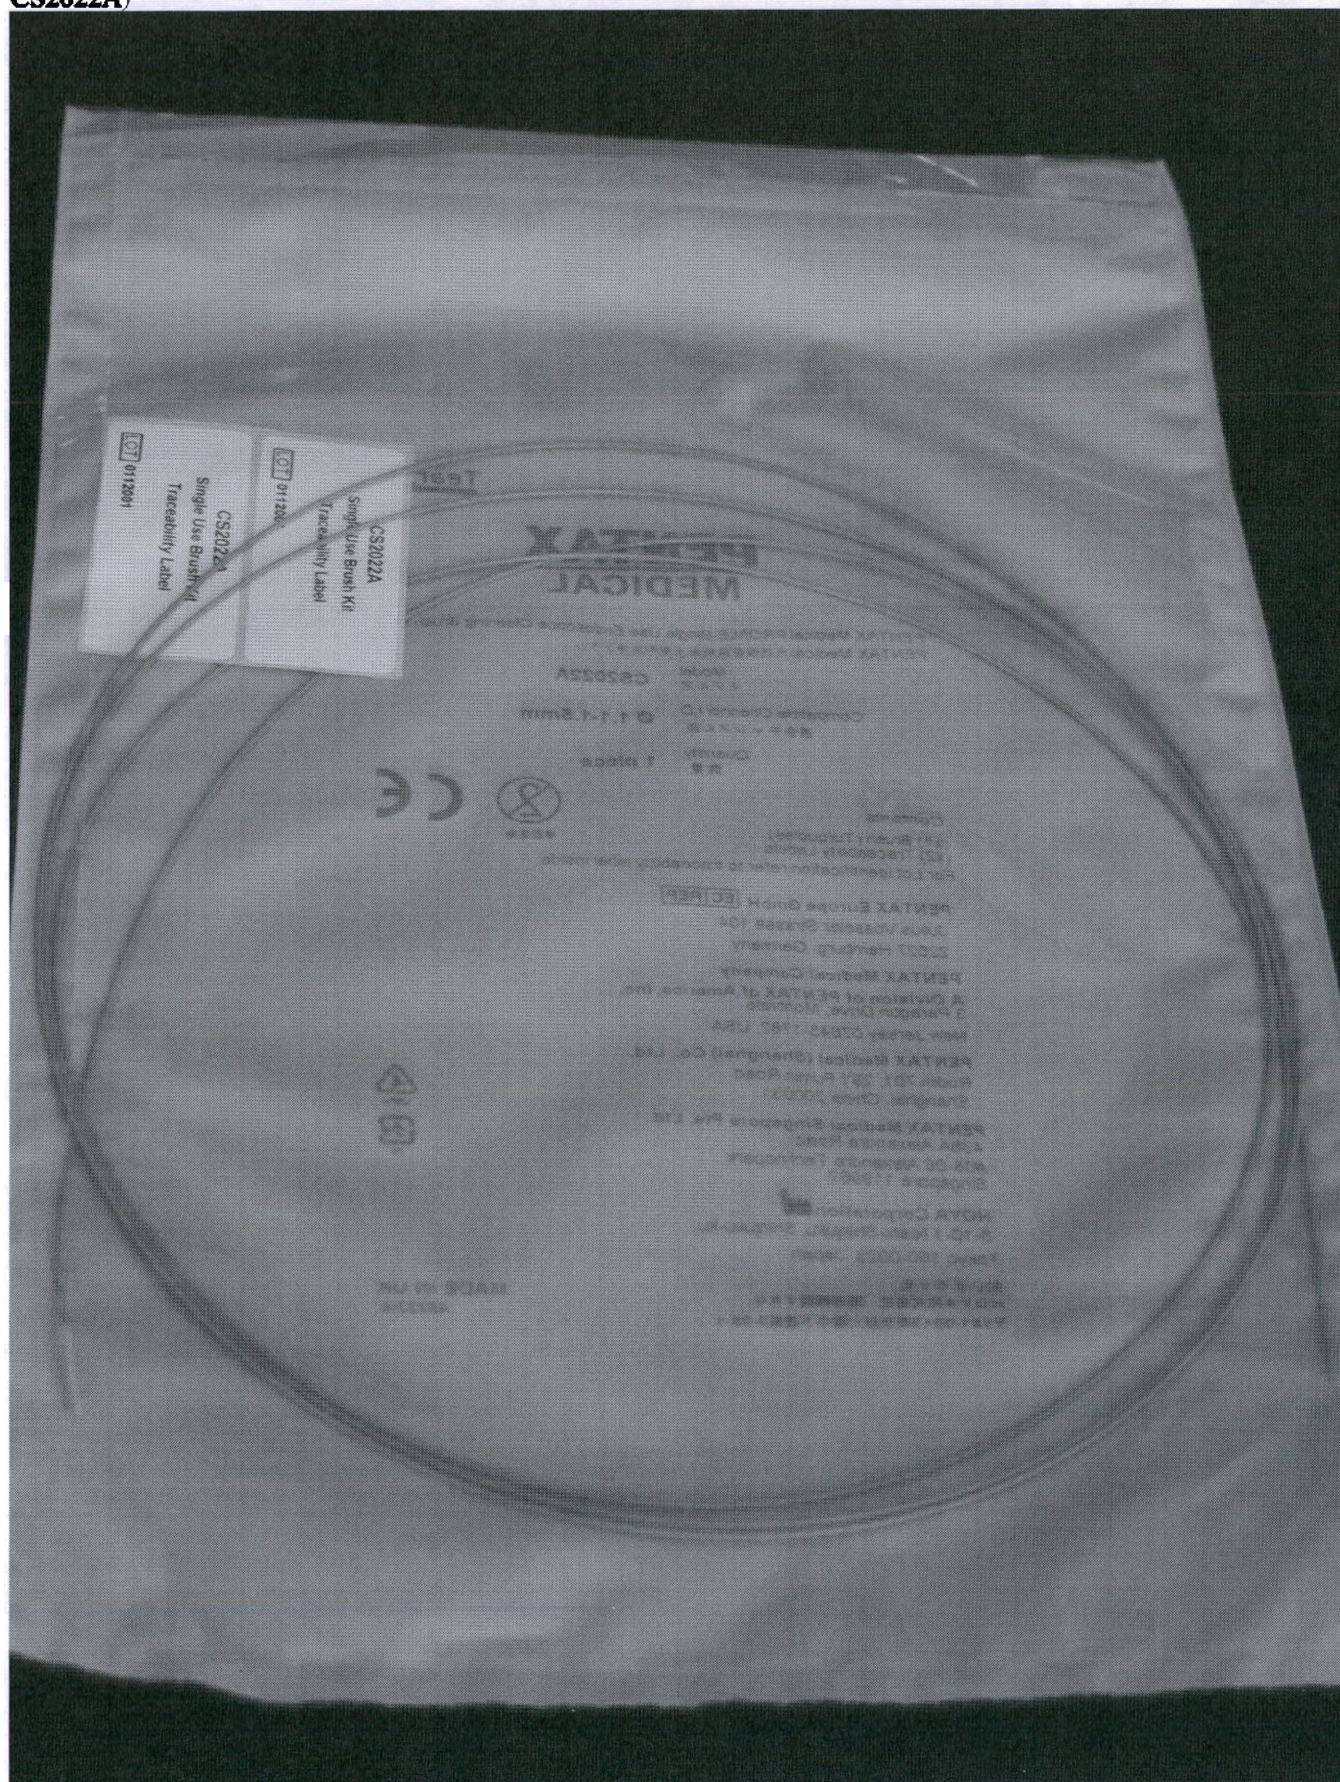

2. Набор PENTAX Medical PROFILE одноразовых чистящих щеток (желтый стержень или CS5522A)
– 1 набор из 10 шт.

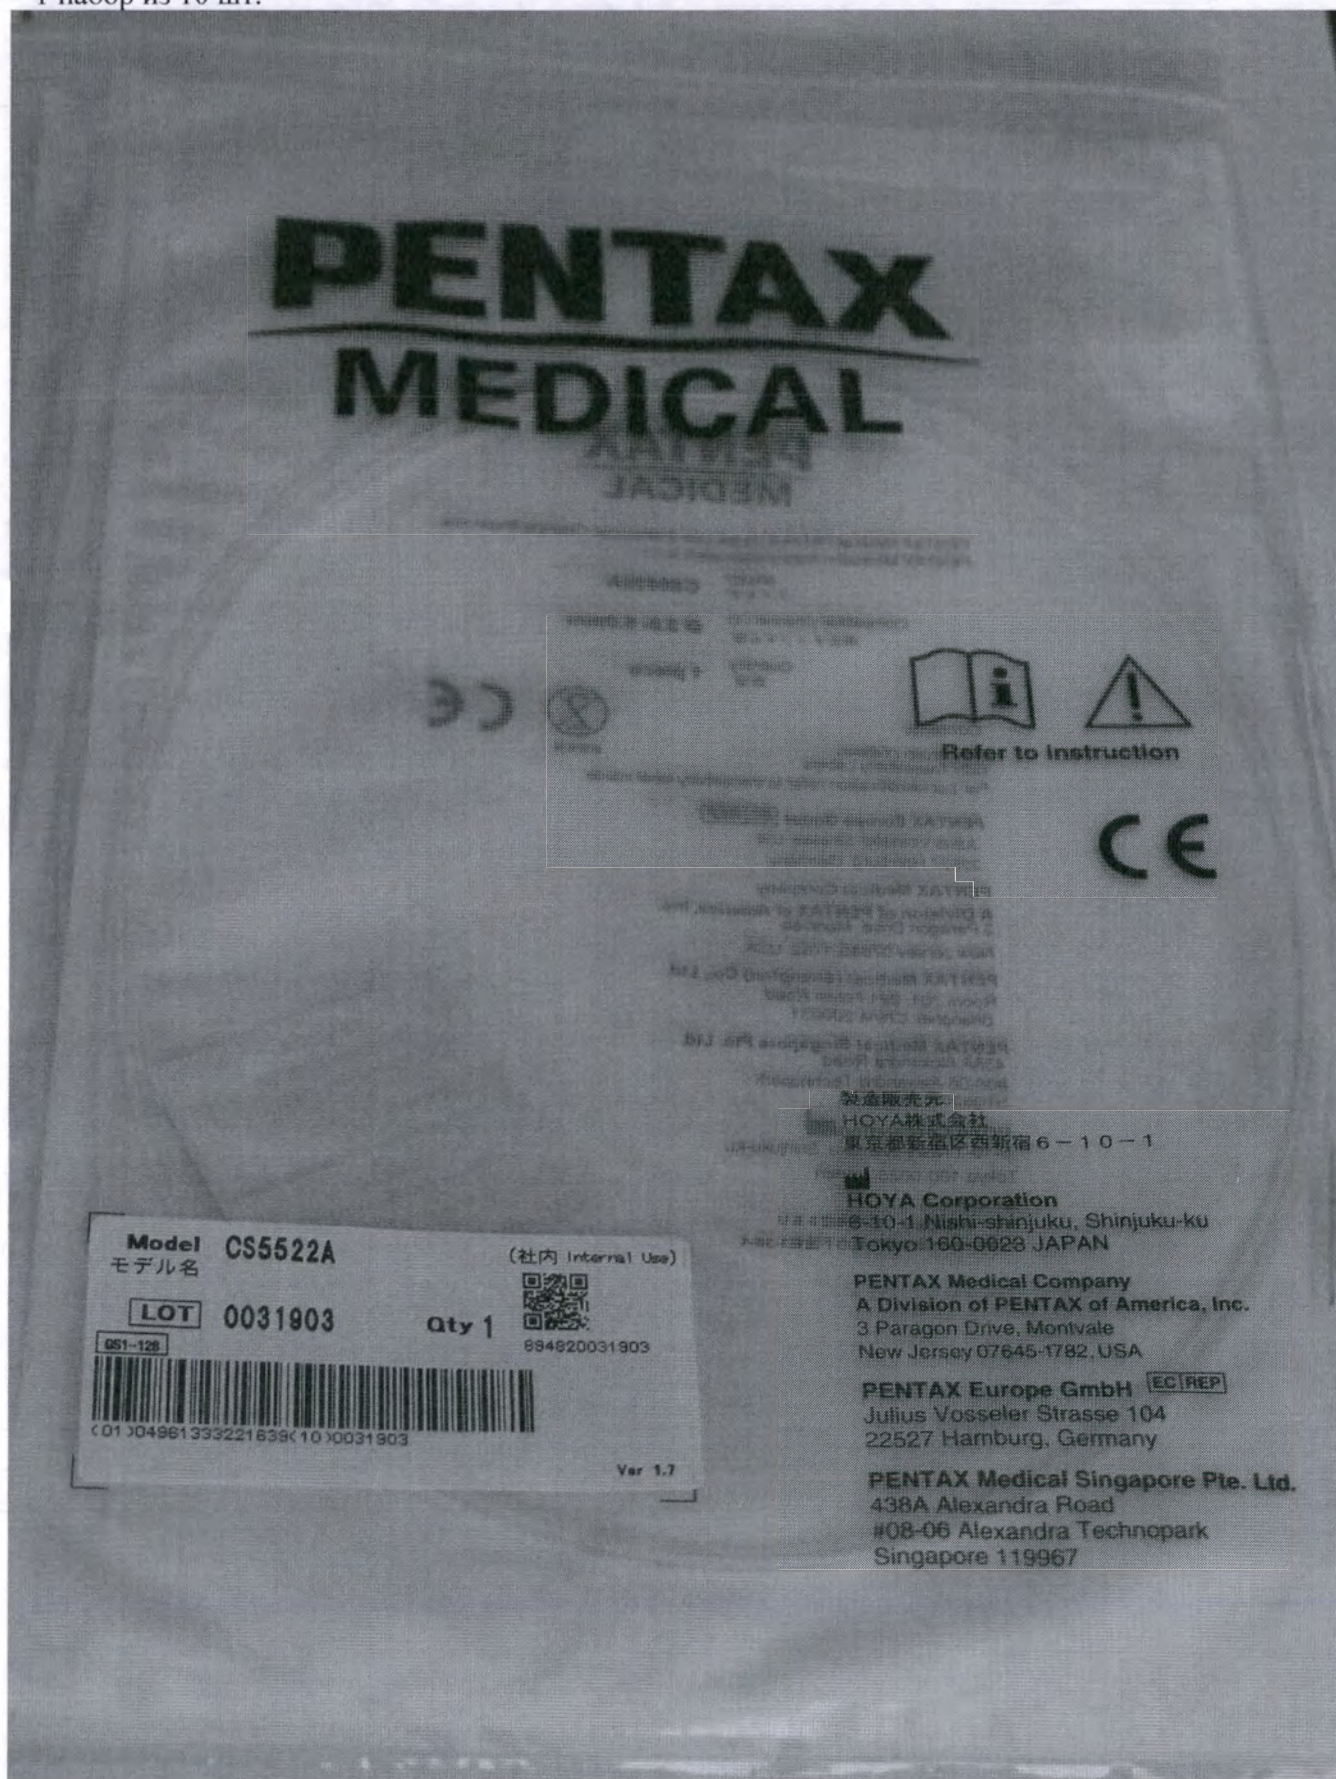


3. Набор PENTAX Medical PROFILE одноразовых чистящих щеток (желтая рукоятка или CS-C12A)
– 1 набор из 10 шт.

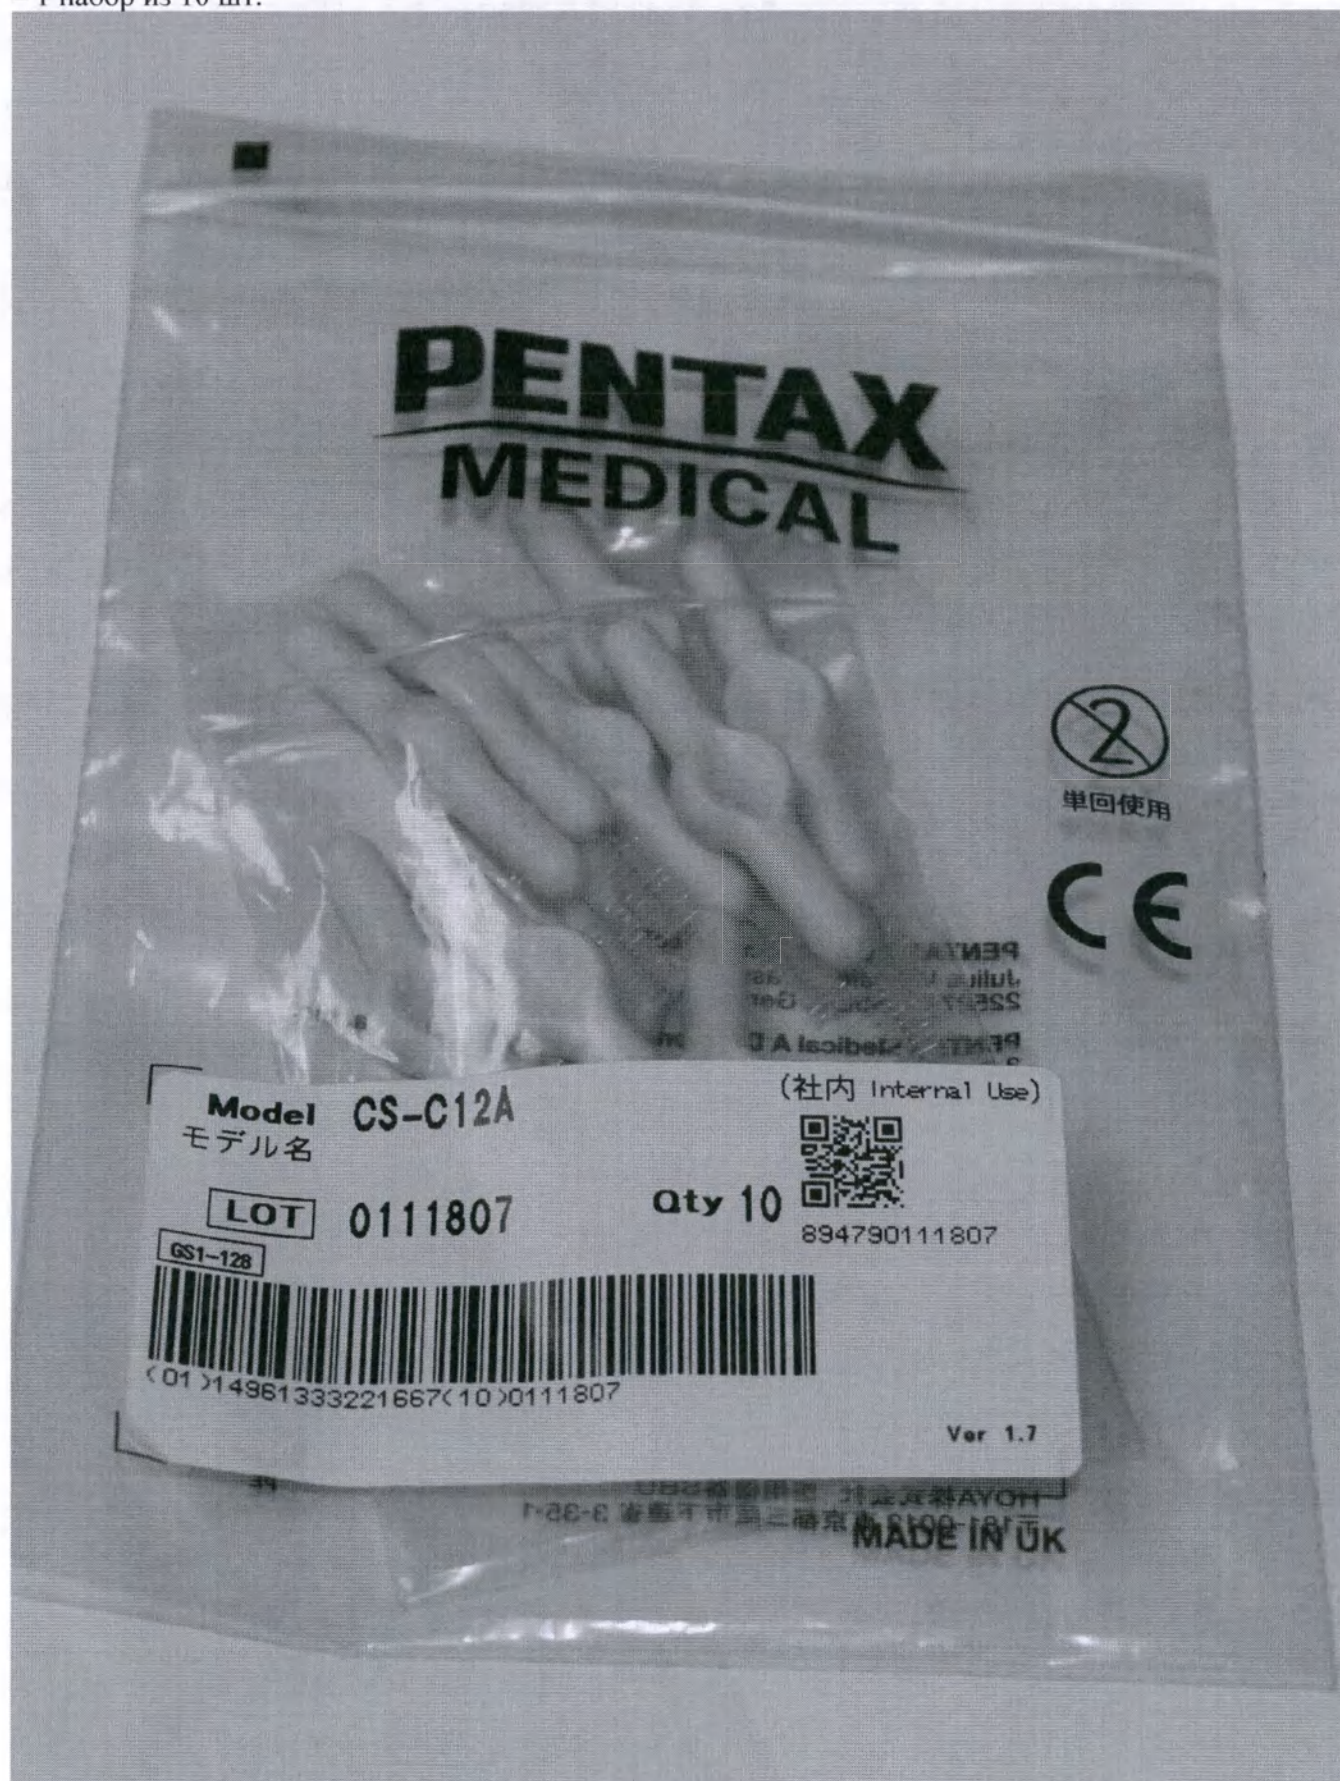


4. Набор PENTAX Medical PROFILE одноразовых чистящих щеток (зеленая рукоятка или CS-C13A – 1 набор из 10 шт.




5. Одноразовый баллон PENTAX Medical (OE-A51)

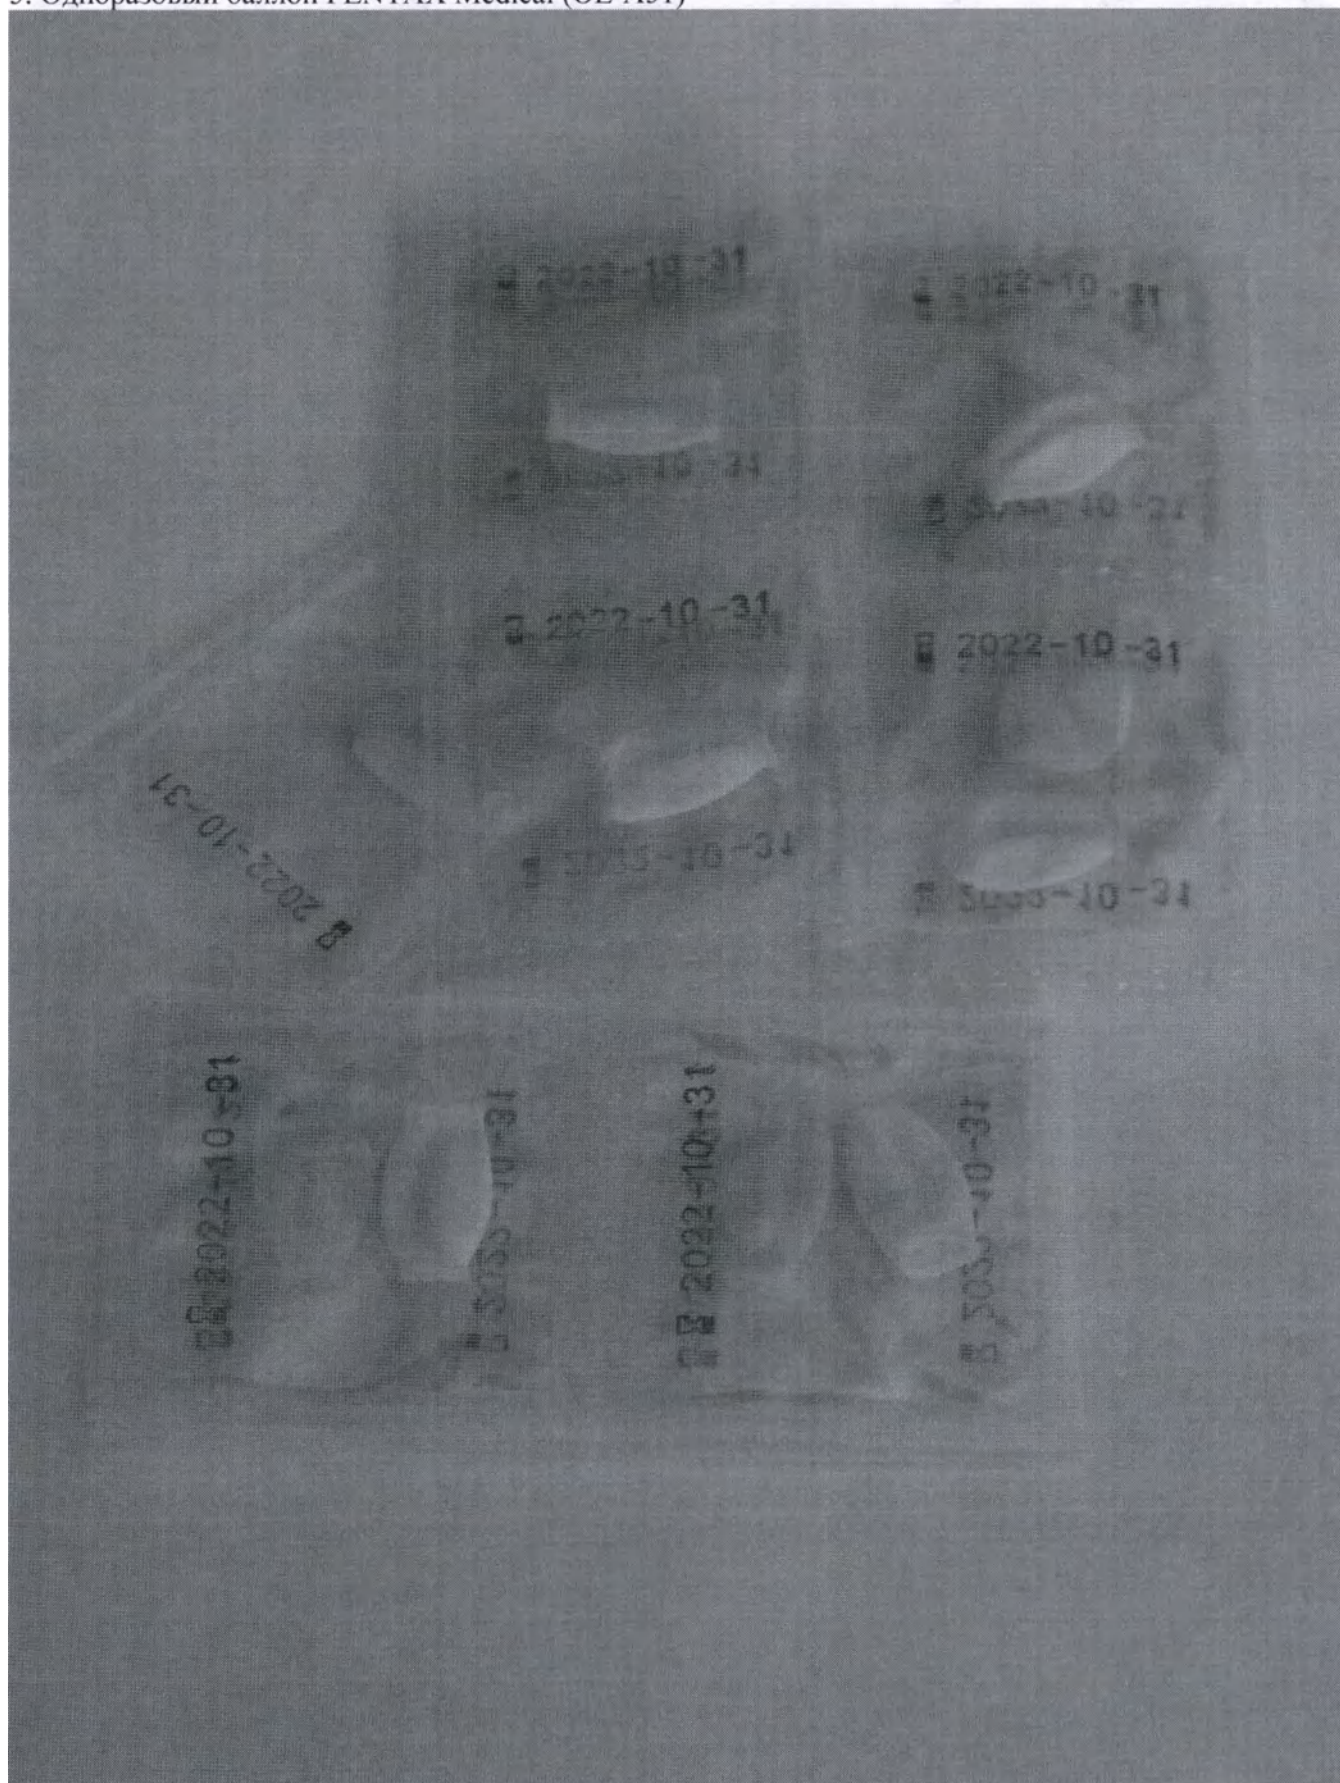

6. Адаптер для очистки PENTAX Medical (OE-B10)

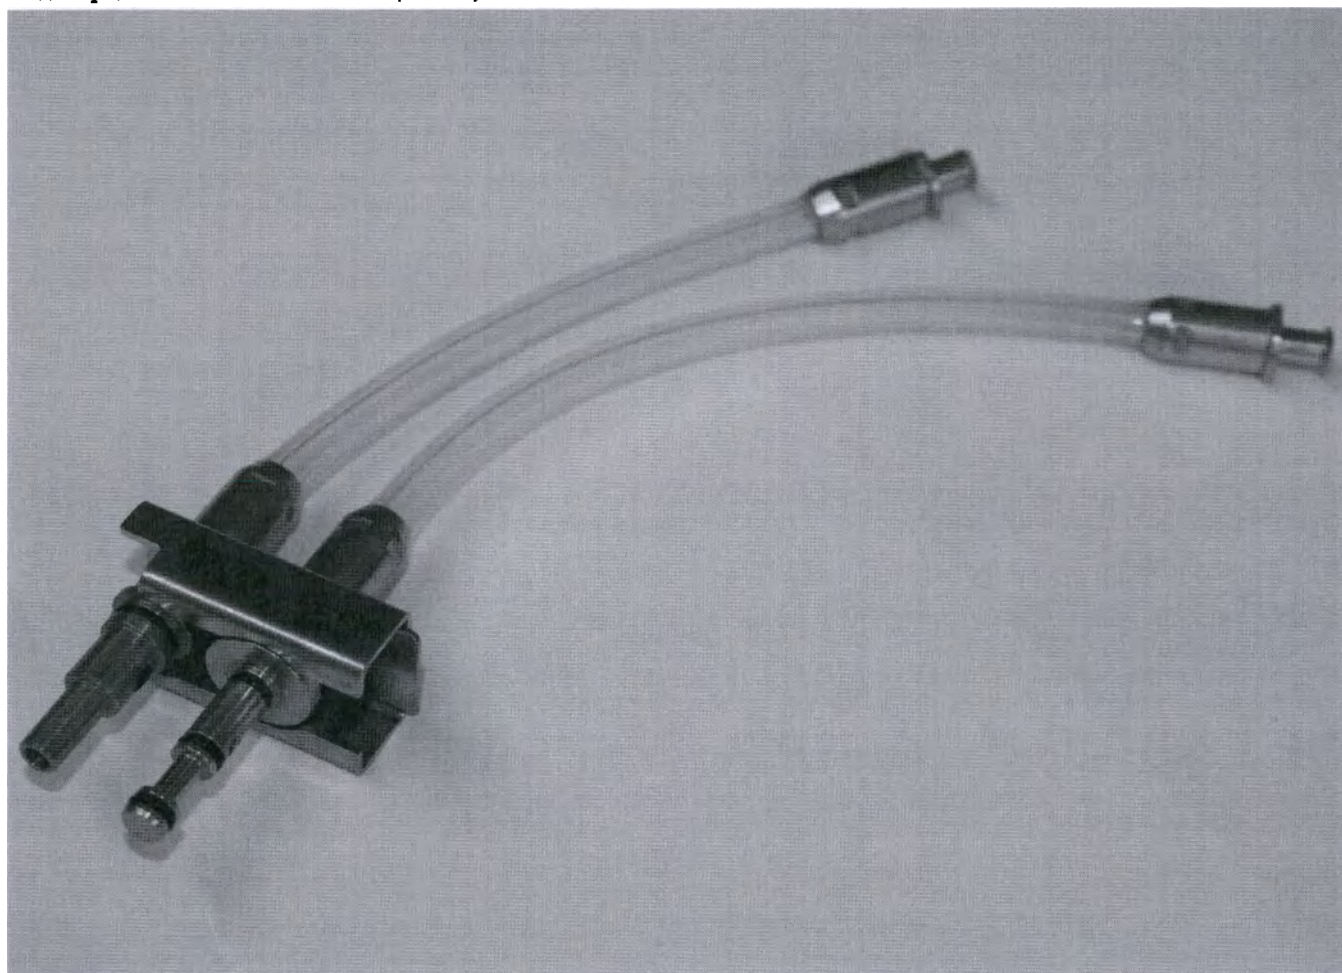


7. Адаптер для очистки PENTAX Medical (OE-G1)

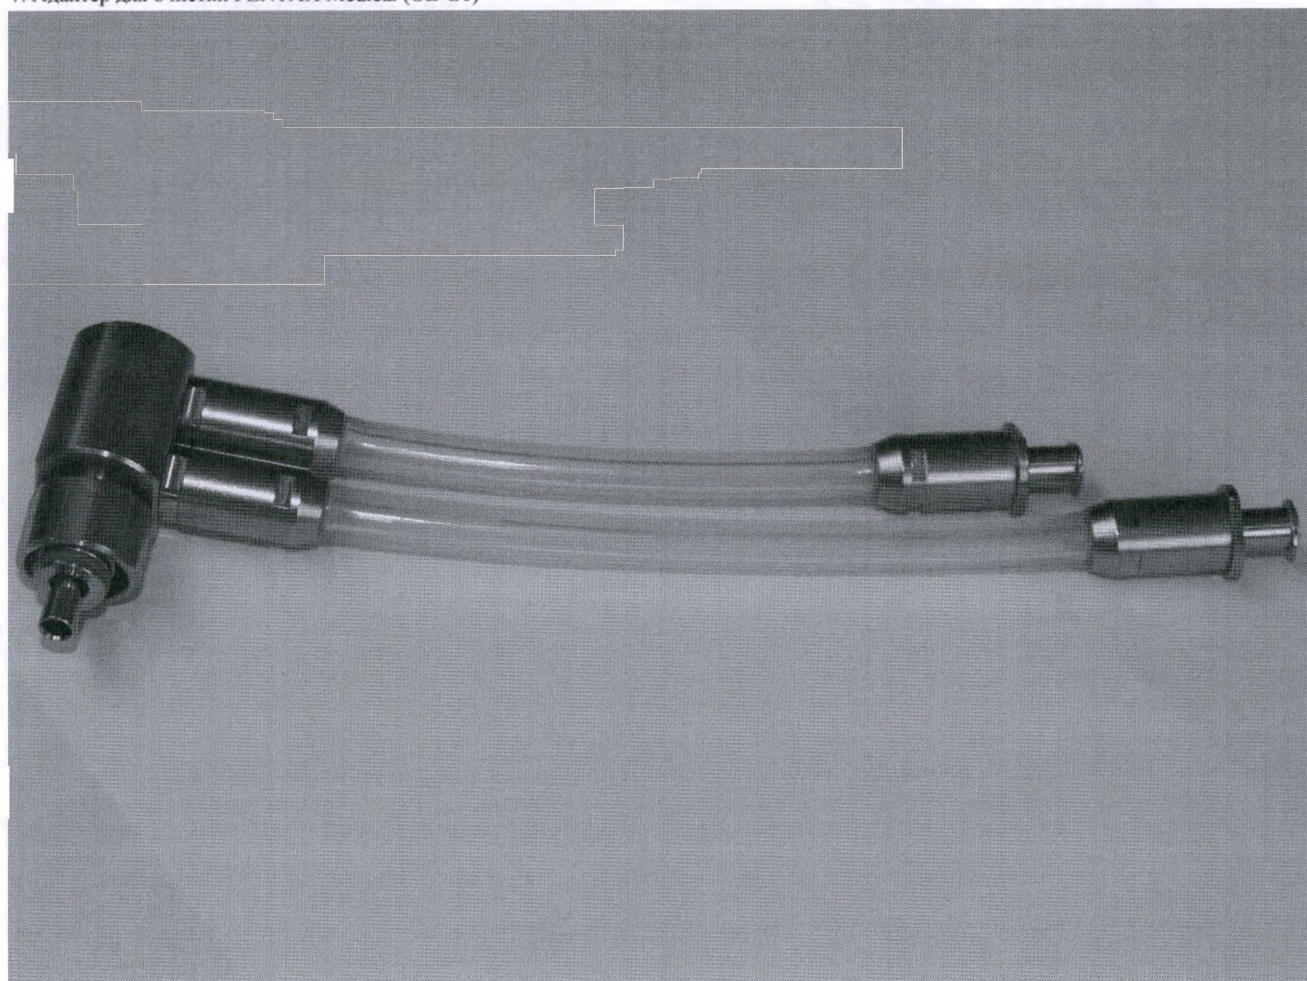

8. Колпачок для погружения PVE-коннектора




9. Колпачок PENTAX Medical для погружения коннектора ультразвукового сканера

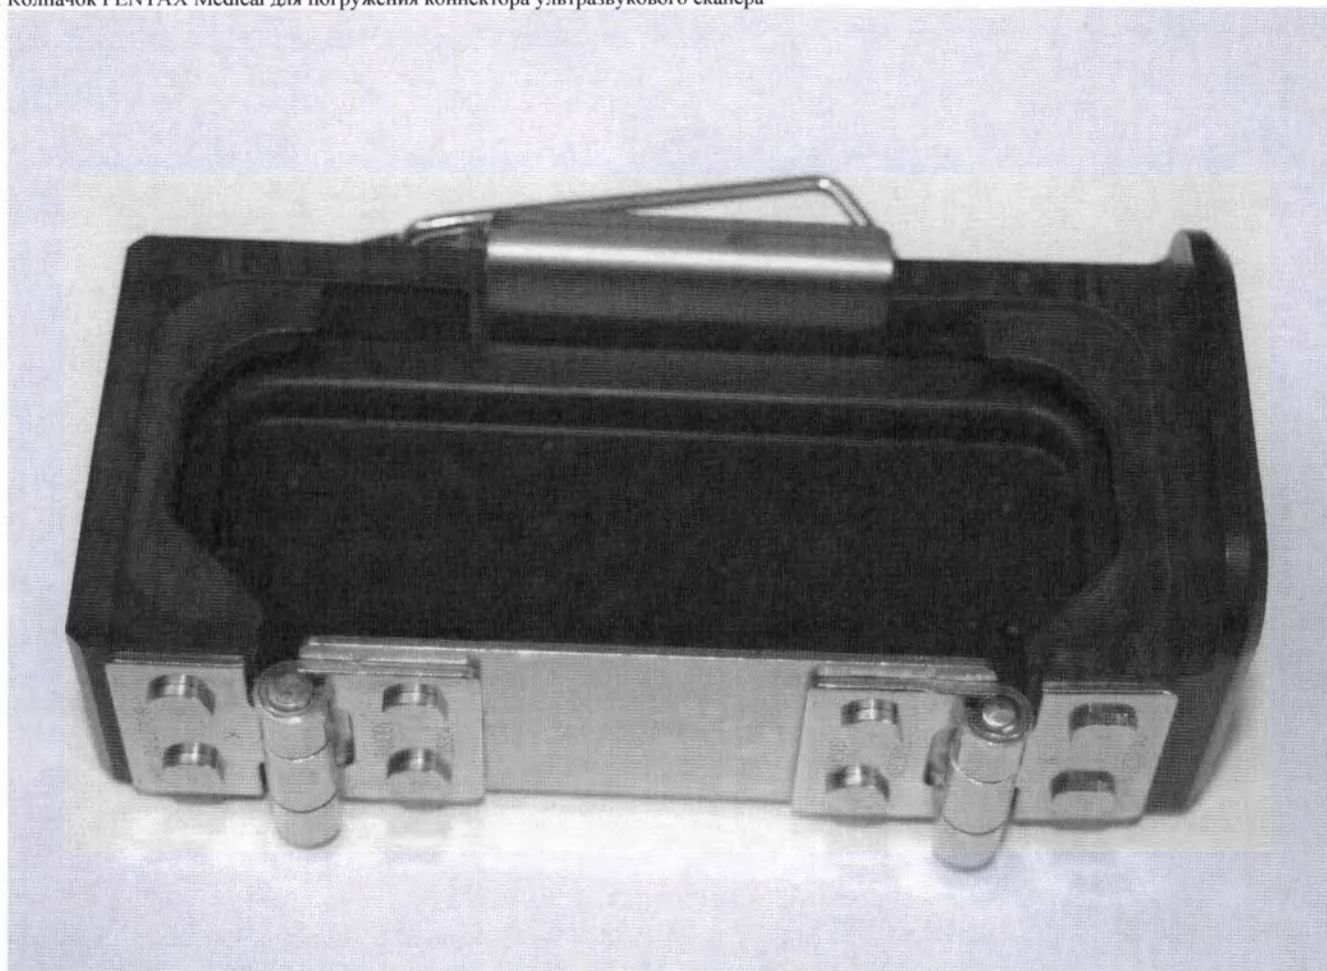


10. Клапан входного отверстия




11. Набор уплотнительных колец для клапана управления аспирацией/аспирацией из баллона PENTAX Medical – 1 набор из 6 шт.

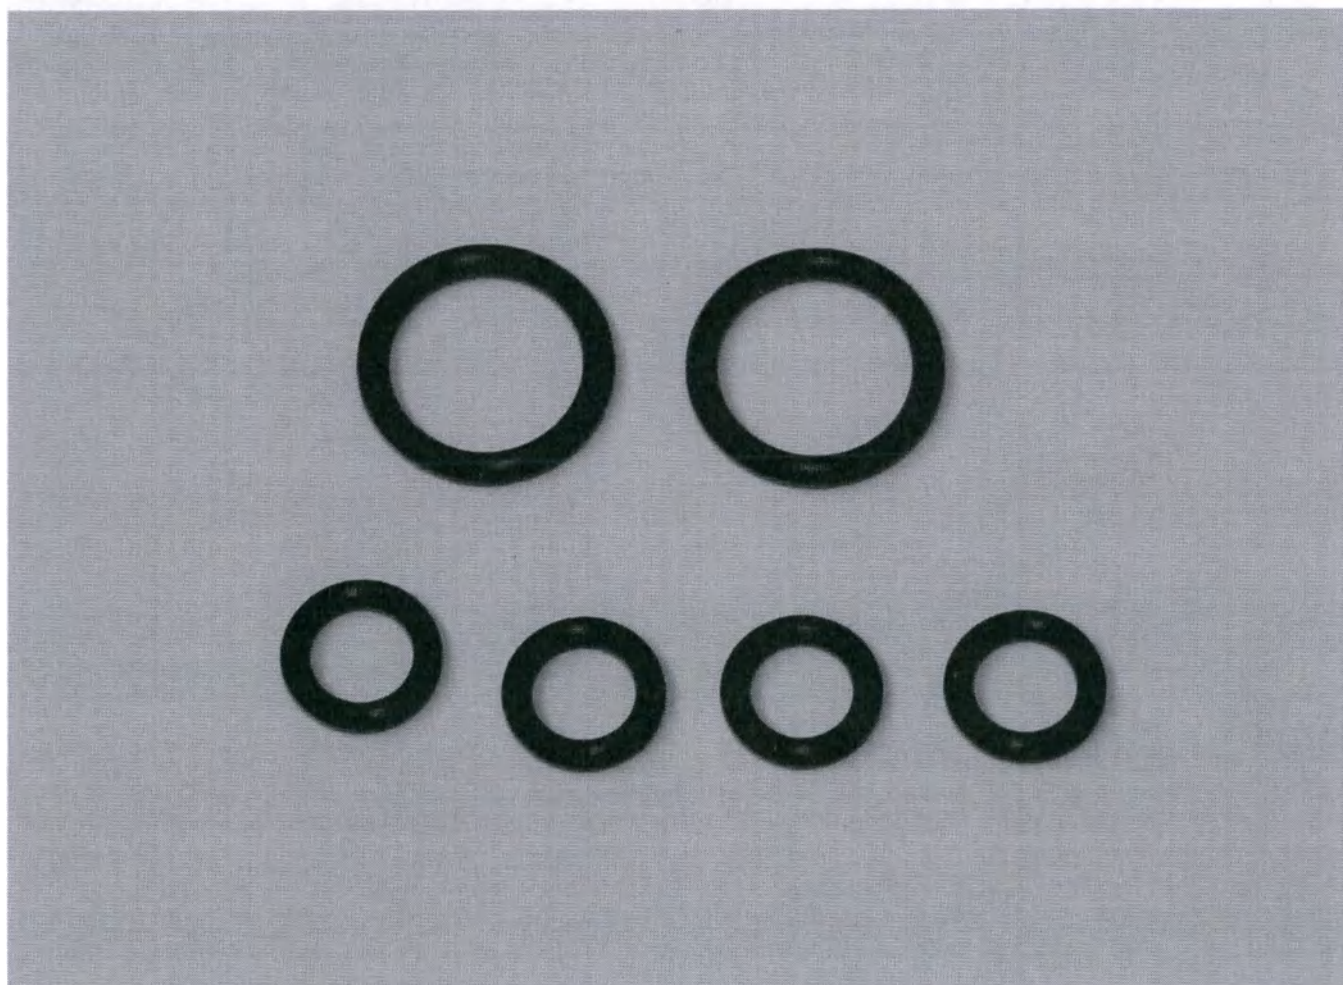

12. Набор уплотнительных колец PENTAX Medical для клапана воздуха/воды/баллона с насадкой– 1 набор из 6 шт.

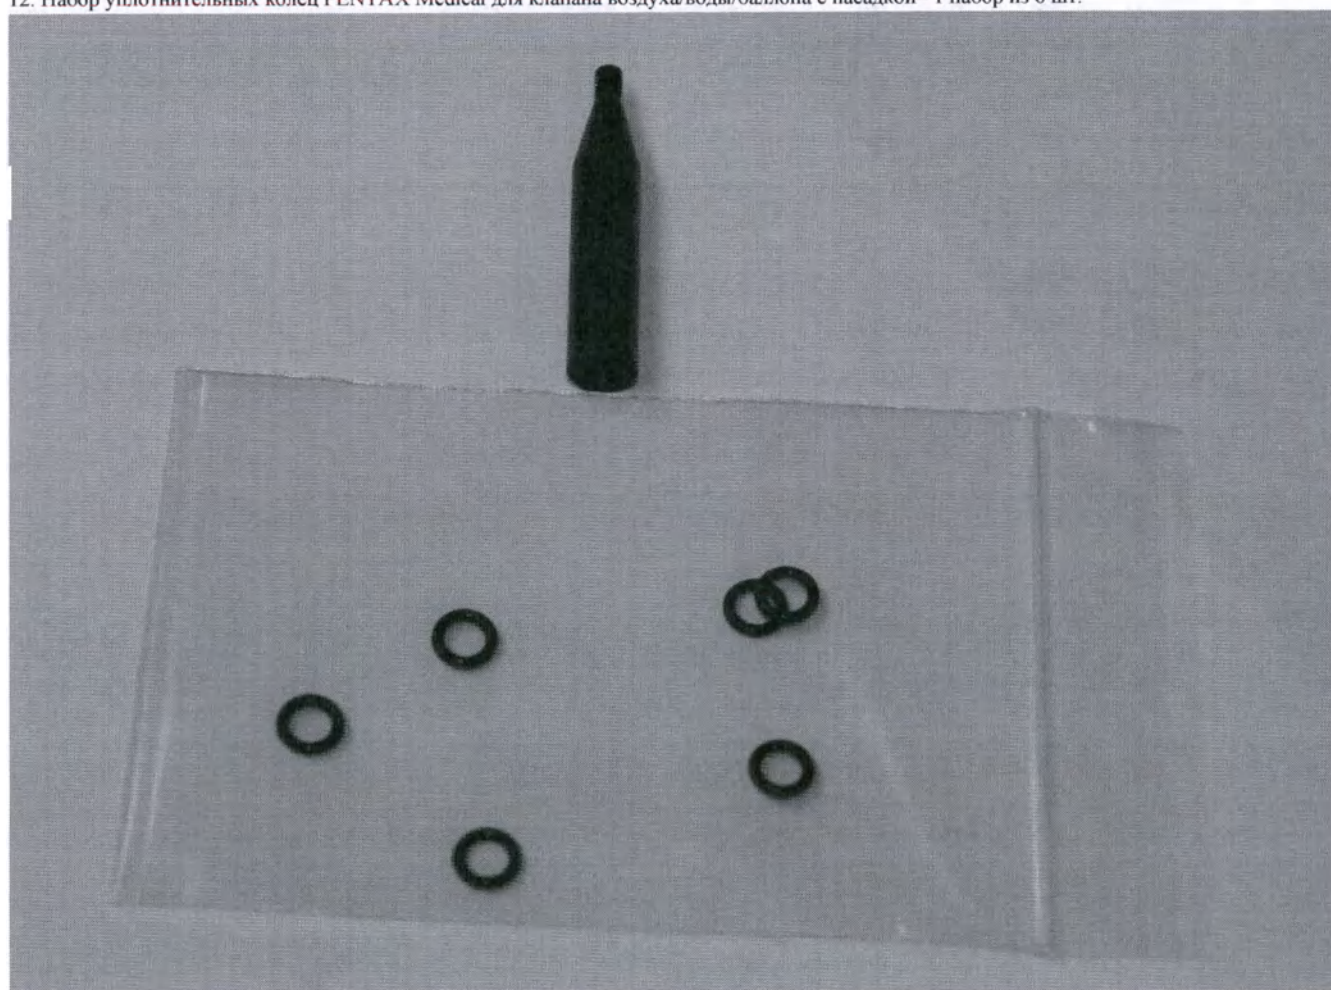


13. Набор уплотнительных колец PENTAX Medical к адаптеру для очистки с насадкой – 1 набор из 5 шт.

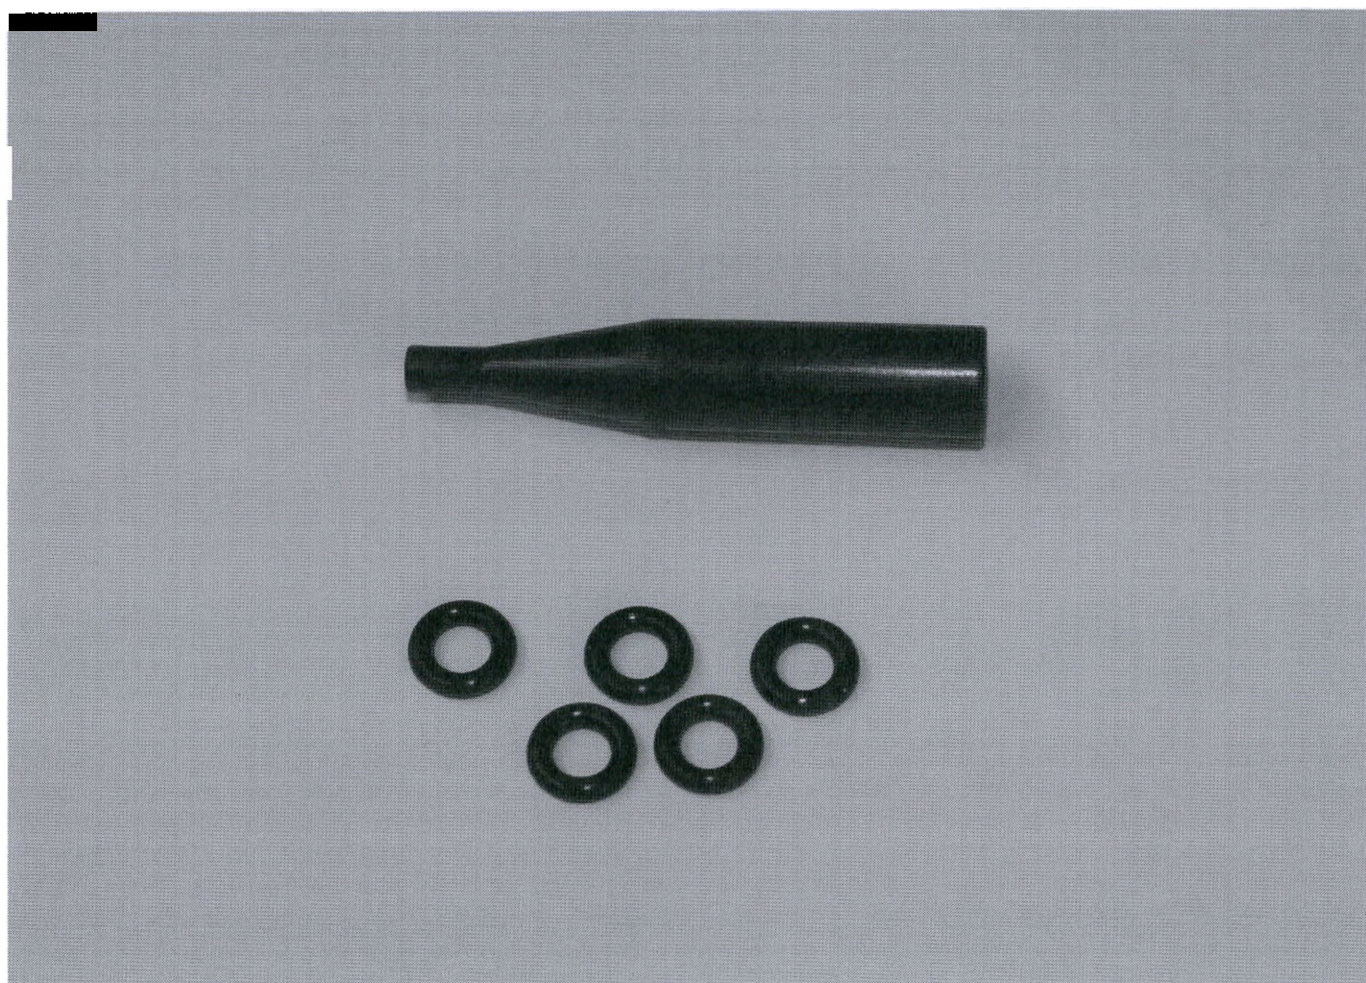


14. Крышка PENTAX Medical для очистки входного отверстия инструментального канала




15. Зеркало

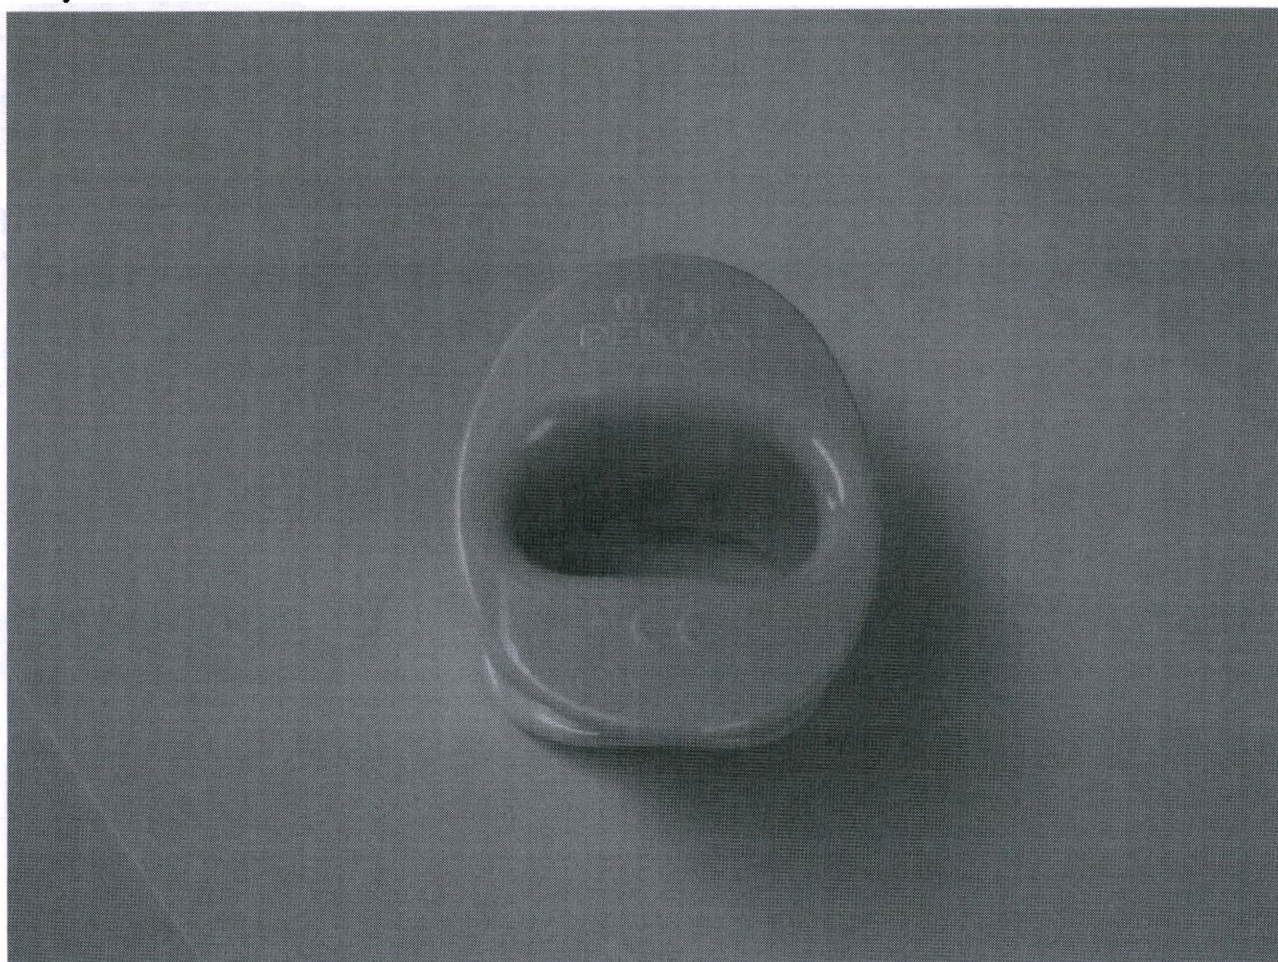


16. Силиконовое масло

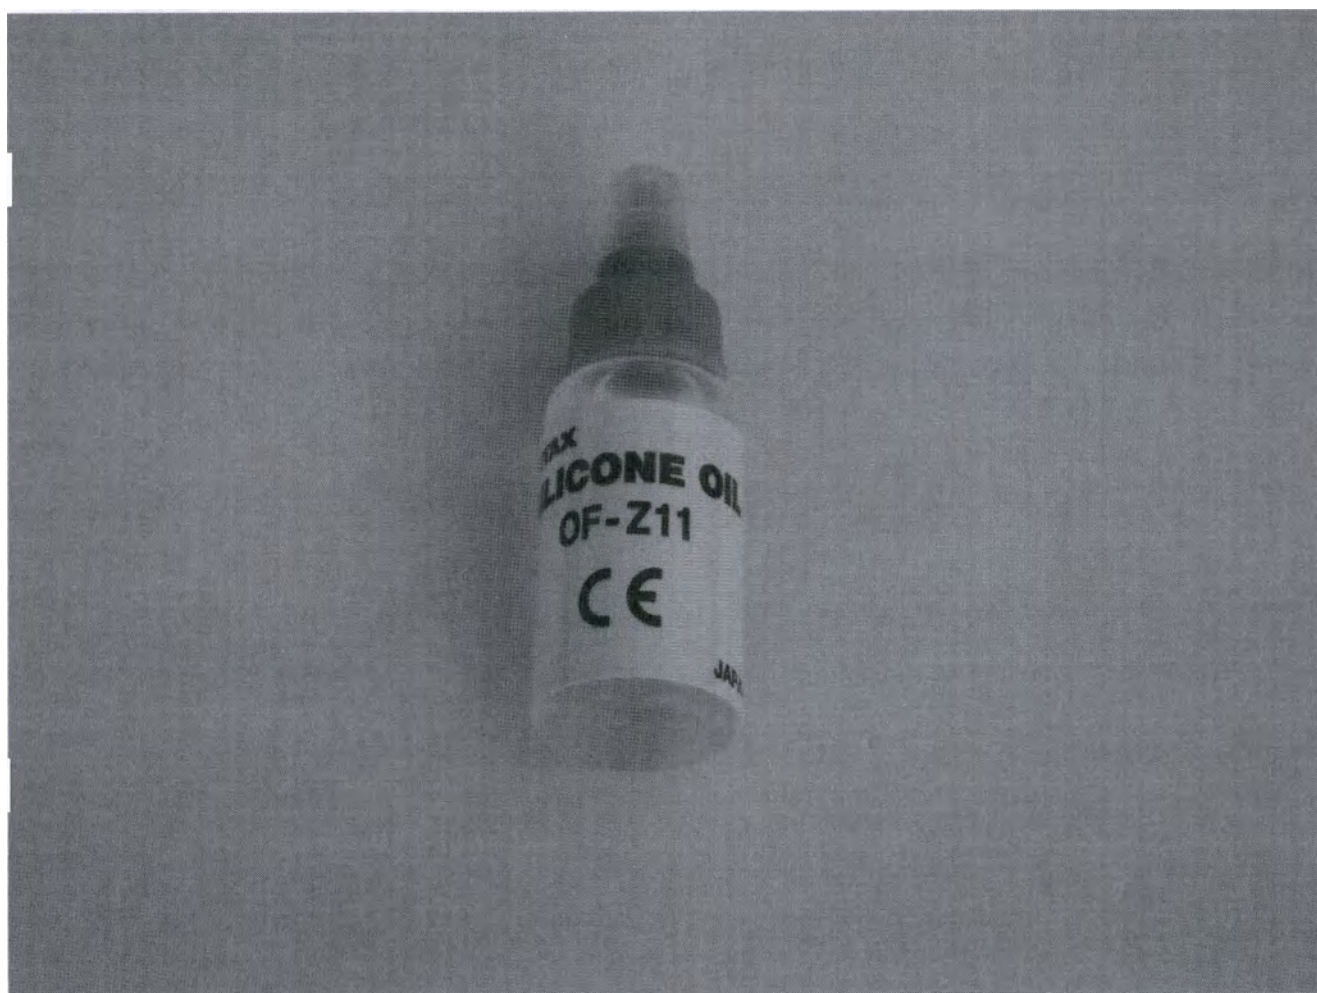

17. Клапан управления аспирацией/аспирацией из баллона PENTAX Medical

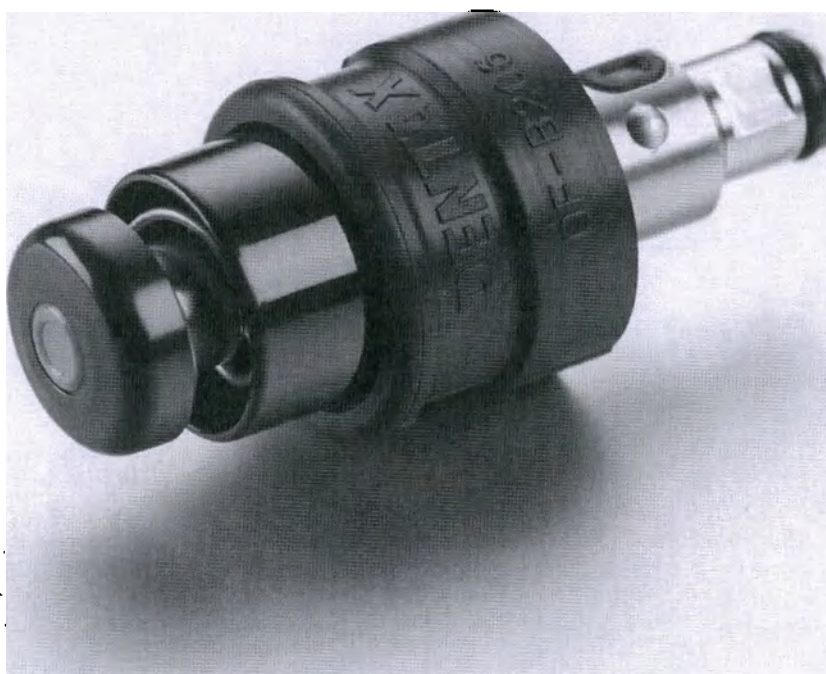


18. Клапан воздуха/воды/баллона PENTAX Medical

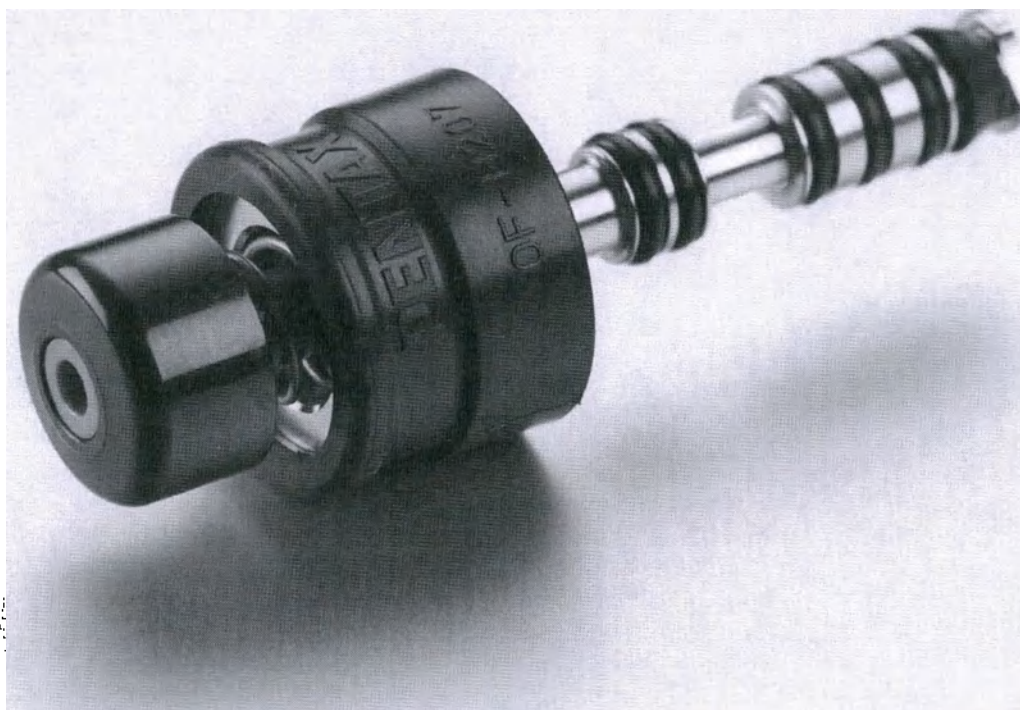


19. Вентиляционный колпачок



20. Инструкция по применению – 1 шт.;

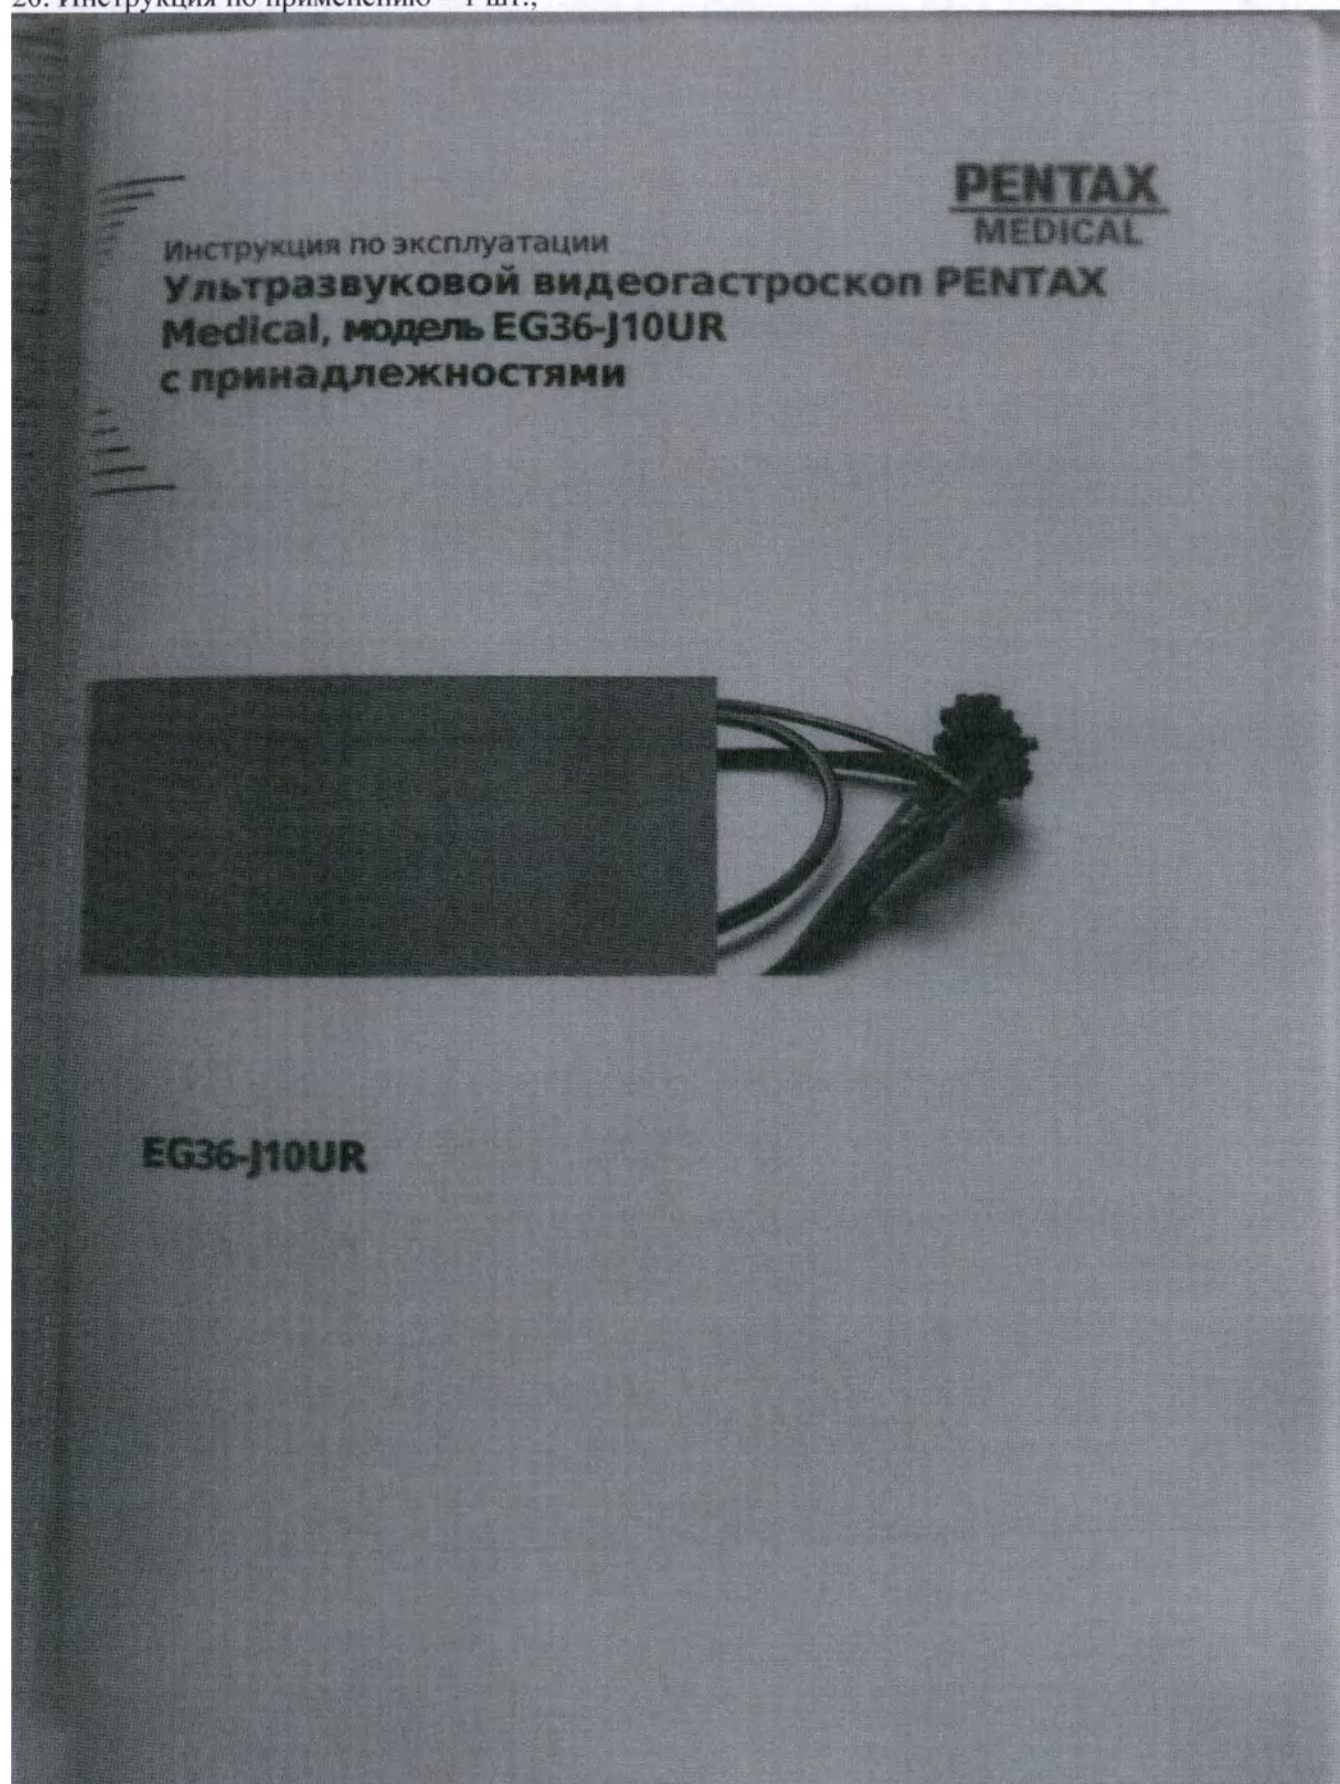

21. Инструкция по обработке – 1 шт;

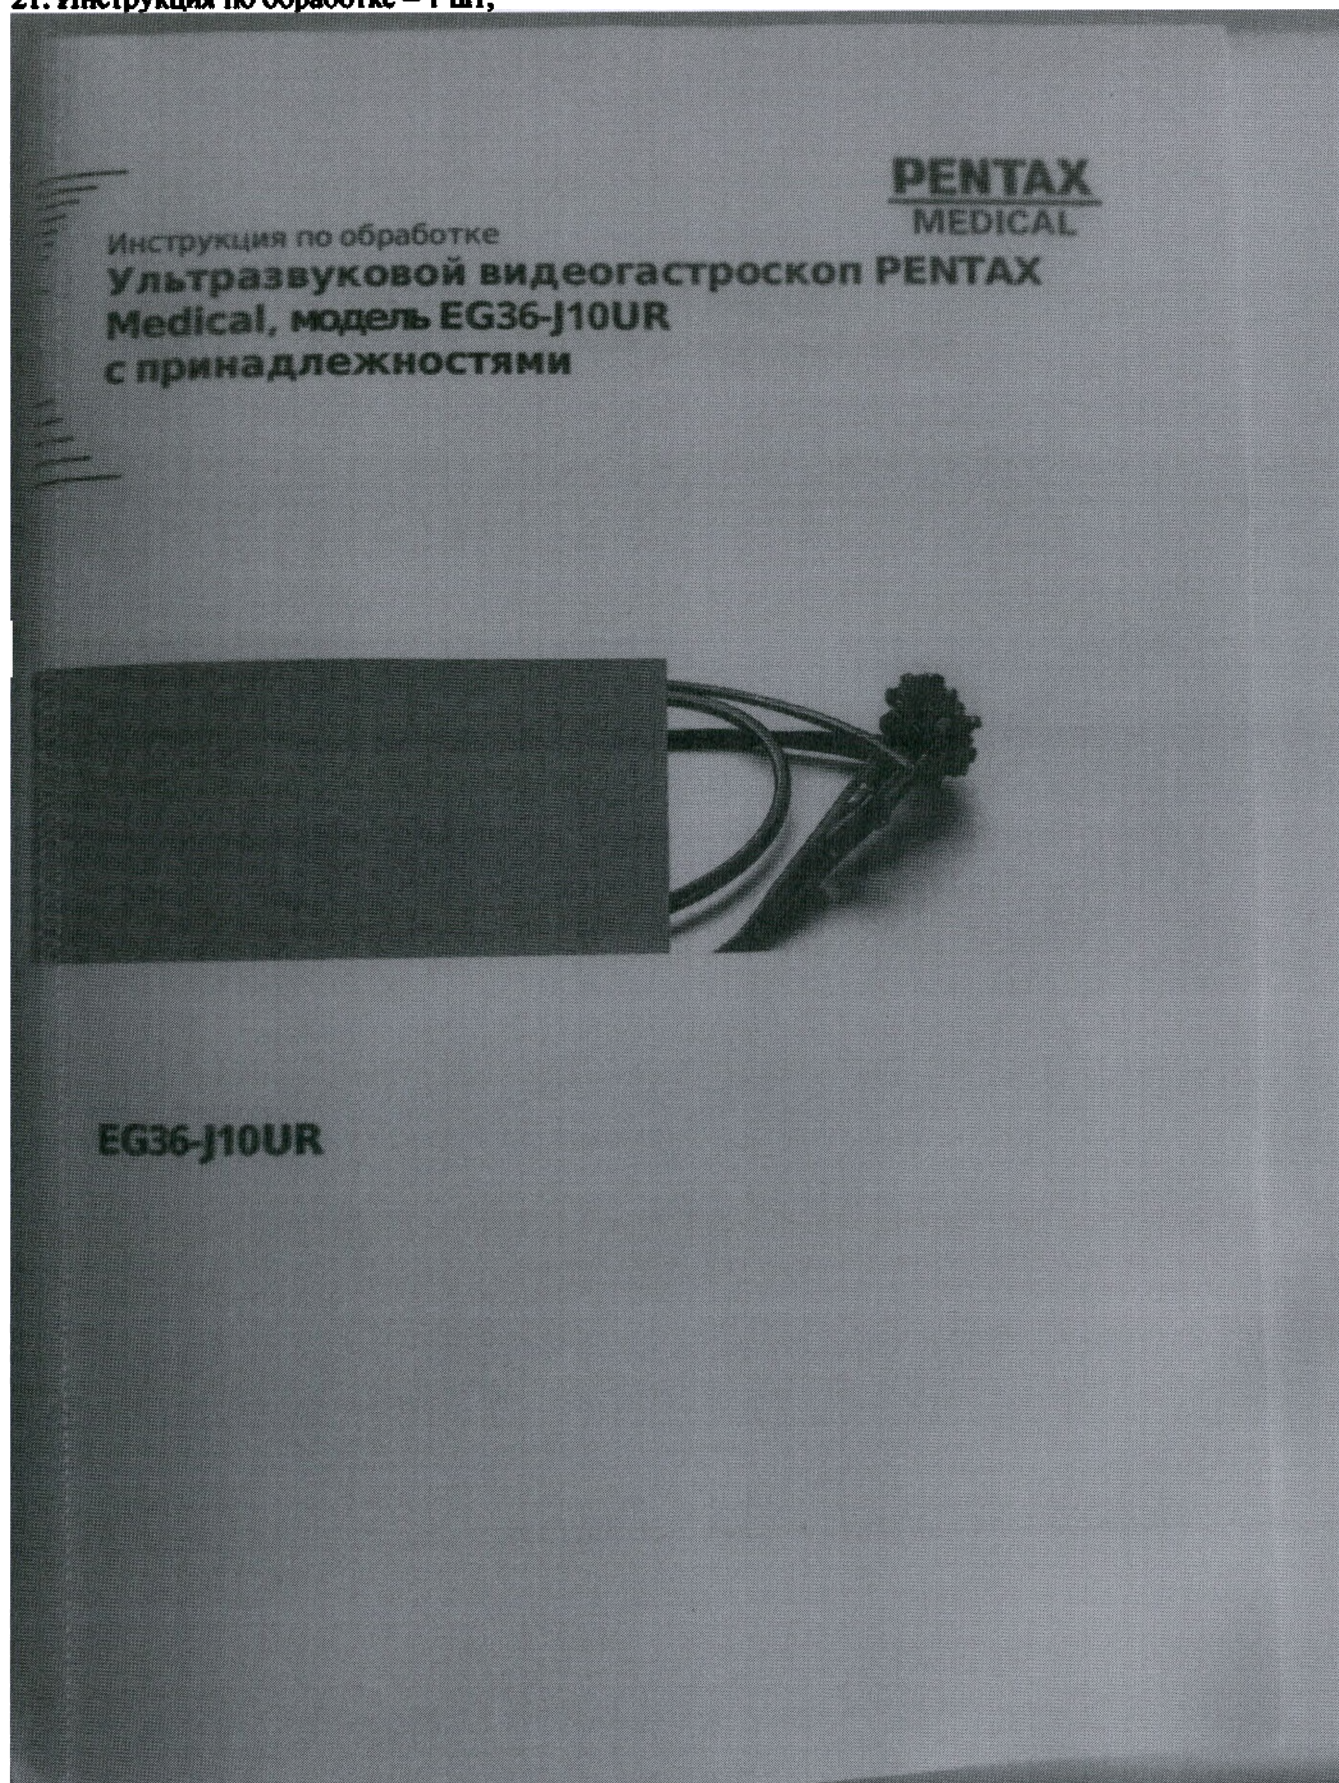

PENTAX
MEDICAL

Список стандартных принадлежностей

Ультразвуковой видеогастроскоп PENTAX Medical, модель EG36-J10UR с принадлежностями

1. Ультразвуковой видеогастроскоп PENTAX Medical, модель EG36-J10UR с принадлежностями – 1 шт;
Принадлежности:
 1. Набор PENTAX Medical PROFILE одноразовых чистящих щеток (синий стержень или CS2022A) (при необходимости) – 1 набор из 10 шт., не более 10 наборов;
 2. Набор PENTAX Medical PROFILE одноразовых чистящих щеток (желтый стержень или CS5522A) (при необходимости) – 1 набор из 10 шт., не более 10 наборов;
 3. Набор PENTAX Medical PROFILE одноразовых чистящих щеток (желтая рукоятка или CS-C12A) (при необходимости) – 1 набор из 10 шт., не более 10 наборов;
 4. Набор PENTAX Medical PROFILE одноразовых чистящих щеток (зеленая рукоятка или CS-C13A) (при необходимости) – 1 набор из 10 шт., не более 10 наборов;
 5. Одноразовый баллон PENTAX Medical OE-A51 (при необходимости) – не более 200 шт.;
 6. Адаптер для очистки PENTAX Medical OE-B10 (при необходимости) – не более 10 шт.;
 7. Адаптер для очистки PENTAX Medical OE-G1 (при необходимости) – не более 10 шт.;
 8. Колпачок для погружения PVE-коннектора (при необходимости) – не более 10 шт.;
 9. Колпачок PENTAX Medical для погружения коннектора ультразвукового сканера (при необходимости) – не более 10 шт.;
 10. Клапан входного отверстия (при необходимости) – не более 200 шт.;
 11. Набор уплотнительных колец для клапана управления аспирацией/ аспирацией из баллона PENTAX Medical (при необходимости) – 1 набор из 6 шт., не более 5 наборов;
 12. Набор уплотнительных колец PENTAX Medical для клапана воздуха/воды/баллона (при необходимости) – 1 набор из 6 шт. с насадкой, не более 5 наборов;
 13. Набор уплотнительных колец PENTAX Medical к адаптеру для очистки (при необходимости) – 1 набор из 5 шт. с насадкой, не более 5 наборов;
 14. Крышка PENTAX Medical для очистки входного отверстия инструментального канала (при необходимости) – не более 200 шт.;
 15. Загубник (при необходимости) – не более 10 шт.;

16. Силиконовое масло (при необходимости) – не более 10 шт.;
17. Клапан управления аспирацией/аспирацией из баллона PENTAX Medical (при необходимости) – не более 10 шт.;
18. Клапан воздуха/воды/баллона PENTAX Medical (при необходимости) – не более 10 шт.;
19. Вентиляционный колпачок (при необходимости) – не более 10 шт.;
20. Инструкция по применению – 1 шт.;
21. Инструкция по обработке – 1 шт.;
22. Список стандартных принадлежностей – 1 шт.;
23. Кейс – 1 шт.

ВСЕГО ПРОШИТО, ПРОНУМЕРОВАНО
И СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ
76 (Сильвестр шев) ЛИСТОВ
ЦИФРАМИ ПРОПИСЬЮ
Подпись СВ. СВ. Рязова СВ
"20" декабря 2021 г. М.П.

