

Макет маркировки на медицинское изделие

Набор реагентов для качественного и количественного определения антител класса IgG к вирусу SARS-CoV-2 иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови человека на иммунохимических анализаторах ARCHITECT «SARS-CoV-2 IgG II Количественный Реагенты для ARCHITECT (SARS-CoV-2 IgG II Quant Reagent Kit)» (серия (партия) 35319FN00, серия (партия) 36051FN00)

Макет маркировки медицинского изделия для обращения на территории Российской Федерации SARS-CoV-2 IgG II Количественный Реагенты для ARCHITECT (SARS-CoV-2 IgG II Quant Reagent Kit), Кат.№ 6S60-22



6S60-22



Набор реагентов для качественного и количественного определения антител класса IgG к вирусу SARS-CoV-2 иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови человека на иммунохимических анализаторах ARCHITECT «SARS-CoV-2 IgG II Количественный Реагенты для ARCHITECT (SARS-CoV-2 IgG II Quant Reagent Kit)» (серия (партия) 35319FN00, серия (партия) 36051FN00)

Набор на 100 тестов в составе: Микрочастицы (SARS-CoV-2 IgG II Microparticles) – 1 x 6,6 мл;

Конъюгат (SARS-CoV-2 IgG II Conjugate) – 1 x 5,9 мл; Дилуент теста (SARS-CoV-2 IgG II Assay Diluent) – 1 x 7,9 мл, Инструкция по применению /Производитель: Abbott Ireland Diagnostics Division, Finisklin Business Park, Sligo, Ireland/ Место производства: Abbott Ireland Diagnostics Division, Finisklin Business Park, Sligo, Ireland /Страна происхождения: Ирландия / РУ № ____/____ от ____/____ / Инструкция по применению на русском языке: www.corelaboratory.abbott/IFU/ Серия, использовать до, условия хранения указаны в графических символах. Расшифровку графических символов см. в инструкции.

Авторизованный представитель изготовителя на территории России и других стран СНГ:

Общество с ограниченной ответственностью «Эбботт Лэбораториз», 125171, Россия, г. Москва, Ленинградское шоссе, 16А, строение 1, Тел: +7 (495) 258 42 70 (80); Факс: +7 (495) 258 42 71 (81)

Макет оригинальной маркировки медицинского изделия SARS-CoV-2 IgG II Количественный
Реагенты для ARCHITECT (SARS-CoV-2 IgG II Quant Reagent Kit), Кат.№ 6S60-22

HT8564R03

REF 6S60-22 CoV-2 IgG II
www.orela-biotechnology.com
REAGENT LOT
Exp.
LOT

1 x 100
CE 0123

SARS-CoV-2 IgG II FOR USE WITH
Quant Reagent Kit ARCHITECT

MICROPARTICLES	1 x	6.6 mL
CONJUGATE	1 x	5.9 mL
ASSAY DILUENT	1 x	7.9 mL

PROTECT FROM LIGHT




WARNING: SENSITIZER

CONTAINS: AZIDE

Abbott Ireland
Diagnostics Division
Finiskin Business Park
Sligo
Ireland
+353-71-9171712

PRODUCT OF IRELAND



Abbott

CoV-2 IgG II

Макет маркировки компонентов медицинского изделия SARS-CoV-2 IgG II Количественный

Реагенты для ARCHITECT (SARS-CoV-2 IgG II Quant Reagent Kit), Кат. № 6S60-22

- Микрочастицы (SARS-CoV-2 IgG II Microparticles)

SARS-CoV-2 IgG II 

FOR USE WITH ARCHITECT IVD REF 6S60G

MICROPARTICLES 6.6 mL



WARNING: SENSITIZER

CONTAINS: AZIDE

H18545R01

ABBOTT

AIDD Sligo, Ireland

2°C 8°C

SN

CONTROL NO.

Exp.

- Конъюгат (SARS-CoV-2 IgG II Conjugate)

SARS-CoV-2 IgG II FOR USE WITH ARCHITECT IVD REF 6S60H 

CONJUGATE

5.9 mL

2°C 8°C

ABBOTT

AIDD Sligo, Ireland

SN

CONTROL NO.

Exp.

H18547R01

- Дилуэнт теста (SARS-CoV-2 IgG II Assay Diluent)

SARS-CoV-2 IgG II FOR USE WITH ARCHITECT IVD REF 6S60J 

ASSAY DILUENT

7.9 mL

2°C 8°C



WARNING: SENSITIZER

ABBOTT

AIDD Sligo, Ireland

SN

CONTROL NO.

Exp.

H18549R02

Макет маркировки медицинского изделия для обращения на территории Российской Федерации SARS-CoV-2 IgG II Количественный Реагенты для ARCHITECT (SARS-CoV-2 IgG II Quant Reagent Kit), Кат.№ 6S60-32



6S60-32



Набор реагентов для качественного и количественного определения антител класса IgG к вирусу SARS-CoV-2 иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови человека на иммунохимических анализаторах ARCHITECT «SARS-CoV-2 IgG II Количественный Реагенты для ARCHITECT (SARS-CoV-2 IgG II Quant Reagent Kit)» (серия (партия) 35319FN00, серия (партия) 36051FN00)

Набор на 500 тестов в составе: Микрочастицы (SARS-CoV-2 IgG II Microparticles) – 1 x 27 мл; Конъюгат (SARS-CoV-2 IgG II Conjugate) – 1 x 26,3 мл; Дилуент теста (SARS-CoV-2 IgG II Assay Diluent) – 1 x 40,7 мл, Инструкция по применению /Производитель: Abbott Ireland Diagnostics Division, Finisklin Business Park, Sligo, Ireland/ Место производства: Abbott Ireland Diagnostics Division, Finisklin Business Park, Sligo, Ireland /Страна происхождения: Ирландия / РУ № ____/____ от ____/____ / Инструкция по применению на русском языке: www.corelaboratory.abbott/IFU/ Серия, использовать до, условия хранения указаны в графических символах. Расшифровку графических символов см. в инструкции.

Авторизованный представитель изготовителя на территории России и других стран СНГ:

Общество с ограниченной ответственностью «Эбботт Лэбораториз», 125171, Россия, г. Москва, Ленинградское шоссе, 16А, строение 1, Тел: +7 (495) 258 42 70 (80); Факс: +7 (495) 258 42 71 (81)

Макет оригинальной маркировки медицинского изделия SARS-CoV-2 IgG II Количественный
Реагенты для ARCHITECT (SARS-CoV-2 IgG II Quant Reagent Kit), Кат.№ 6S60-32

Н18665R03

REF 6S60-32 CoV-2 IgG II
www.abbott.com/abbott/ifu
REAGENT LOT
EXP
LOT

1 x 500
CE 0123

SARS-CoV-2 IgG II
Quant Reagent Kit
FOR USE WITH ARCHITECT

MICROPARTICLES	1 x	27.0 mL
CONJUGATE	1 x	26.3 mL
ASSAY DILUENT	1 x	40.7 mL
PROTECT FROM LIGHT		




WARNING: SENSITIZER

CONTAINS: AZIDE

Abbott Ireland
Diagnostics Division
Finiskin Business Park
Sligo
Ireland
+353-71-917 1712

PRODUCT OF IRELAND




Abbott


CoV-2 IgG II

Макет маркировки компонентов медицинского изделия SARS-CoV-2 IgG II Количественный
Реагенты для ARCHITECT (SARS-CoV-2 IgG II Quant Reagent Kit), Кат.№ 6S60-32

- Микрочастицы (SARS-CoV-2 IgG II Microparticles)

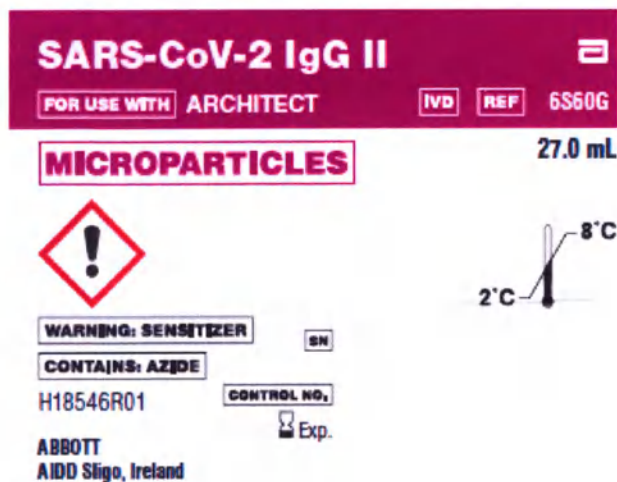

- Конъюгат (SARS-CoV-2 IgG II Conjugate)

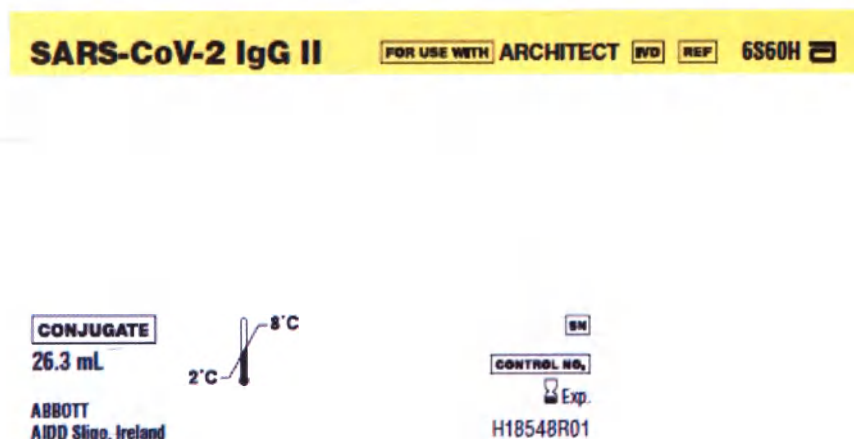

- Дилуэнт теста (SARS-CoV-2 IgG II Assay Diluent)



Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

листов

Подпись _____




Фотографические изображения общего вида на медицинское изделие

Набор реагентов для качественного и количественного определения антител класса IgG к вирусу SARS-CoV-2 иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови человека на иммунохимических анализаторах ARCHITECT «SARS-CoV-2 IgG II Количественный Реагенты для ARCHITECT (SARS-CoV-2 IgG II Quant Reagent Kit)» (серия (партия) 35319FN00, серия (партия) 36051FN00)

(размером не менее 18 x 24 сантиметра)



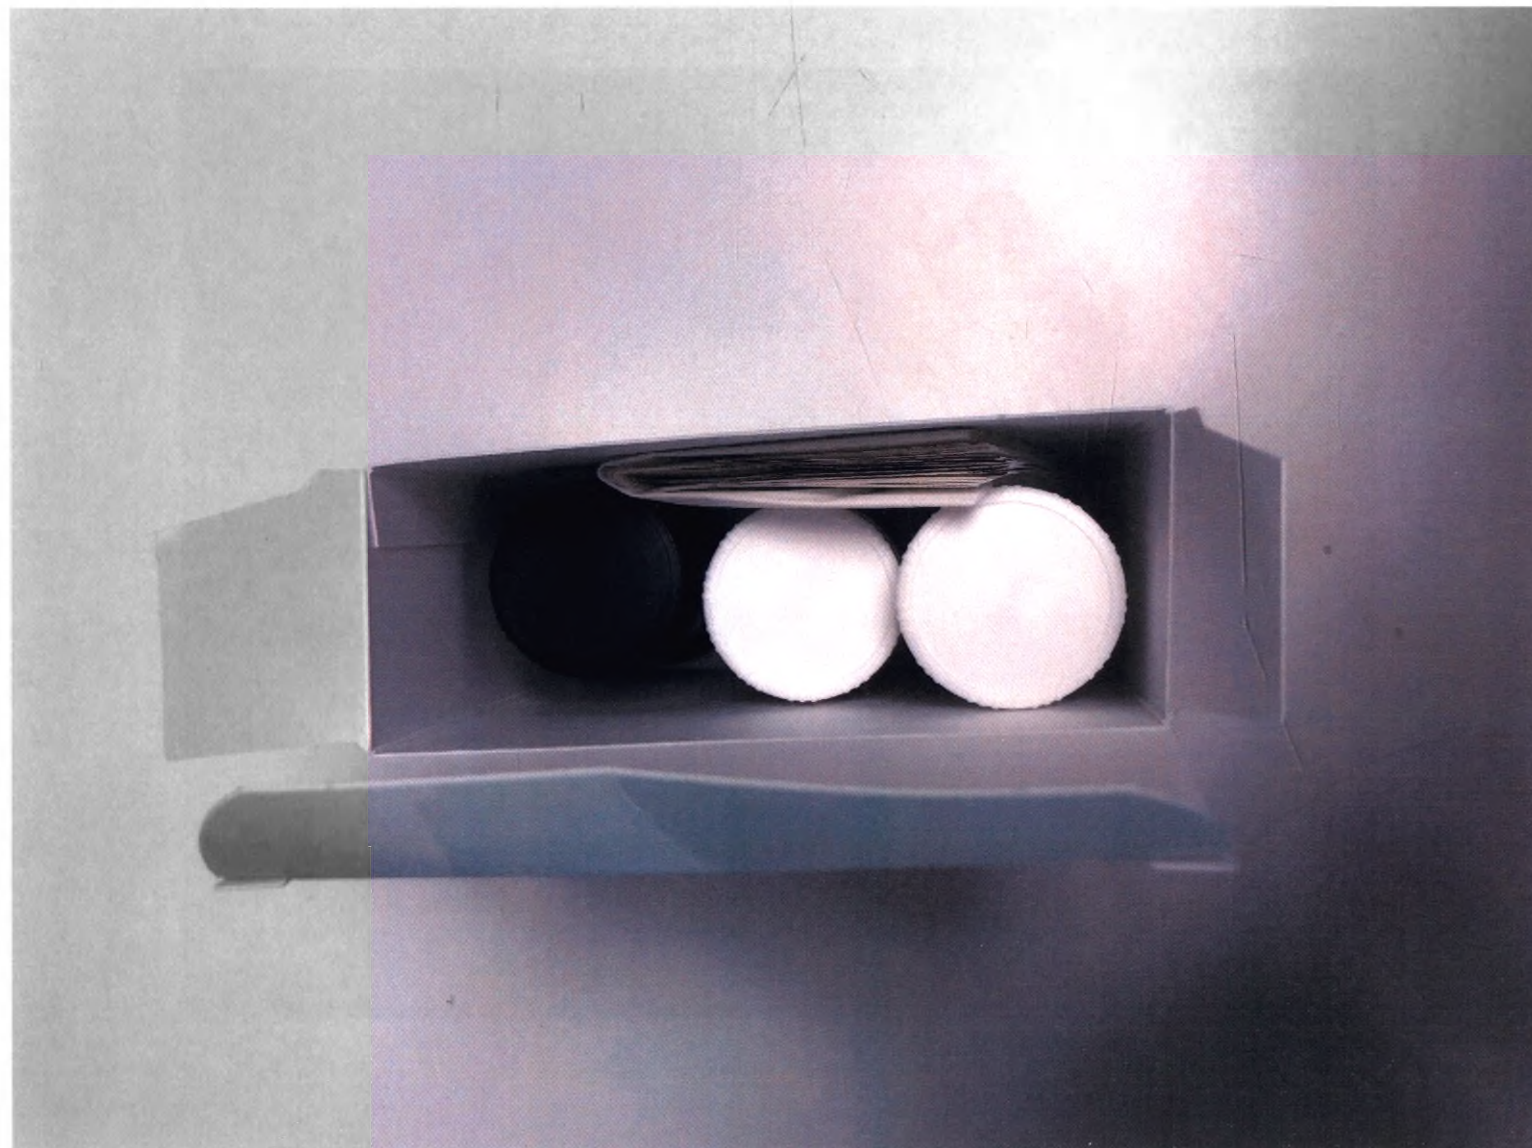


ARCHITECT (SARS-CoV-2 IgG II Quant Reagent Kit), Кат №6S60-22



Abbott

PRODUCT OF IRELAND

Abbott Ireland
Diagnostics Division
Foster Business Park
Steep
Ireland
+353-21-9171712



CONTAINS: AZIDE

WARNING: SENSITIZER



PROTECT FROM LIGHT

1 x 40.7 mL

ASSAY DILUENT

1 x 26.3 mL

CONJUGATE

1 x 27.0 mL

MICROPARTICLES

SARS-CoV-2 IgG II
FOR USE WITH
Quant Reagent Kit ARCHITECT



IVD

1 x 500



REF

6S60-32 CoV-2 IgG II



www.corelaboratory.abbott/IFU R03

REAGENT LOT

36051FN00



Exp.

2022-08-27

LOT

36051FN00

GTIN

00380740193799


(01) 00380740193799 (17) 220827

(10) 36051FN00 (240) 6S6032



H18565R02

ARCHITECT

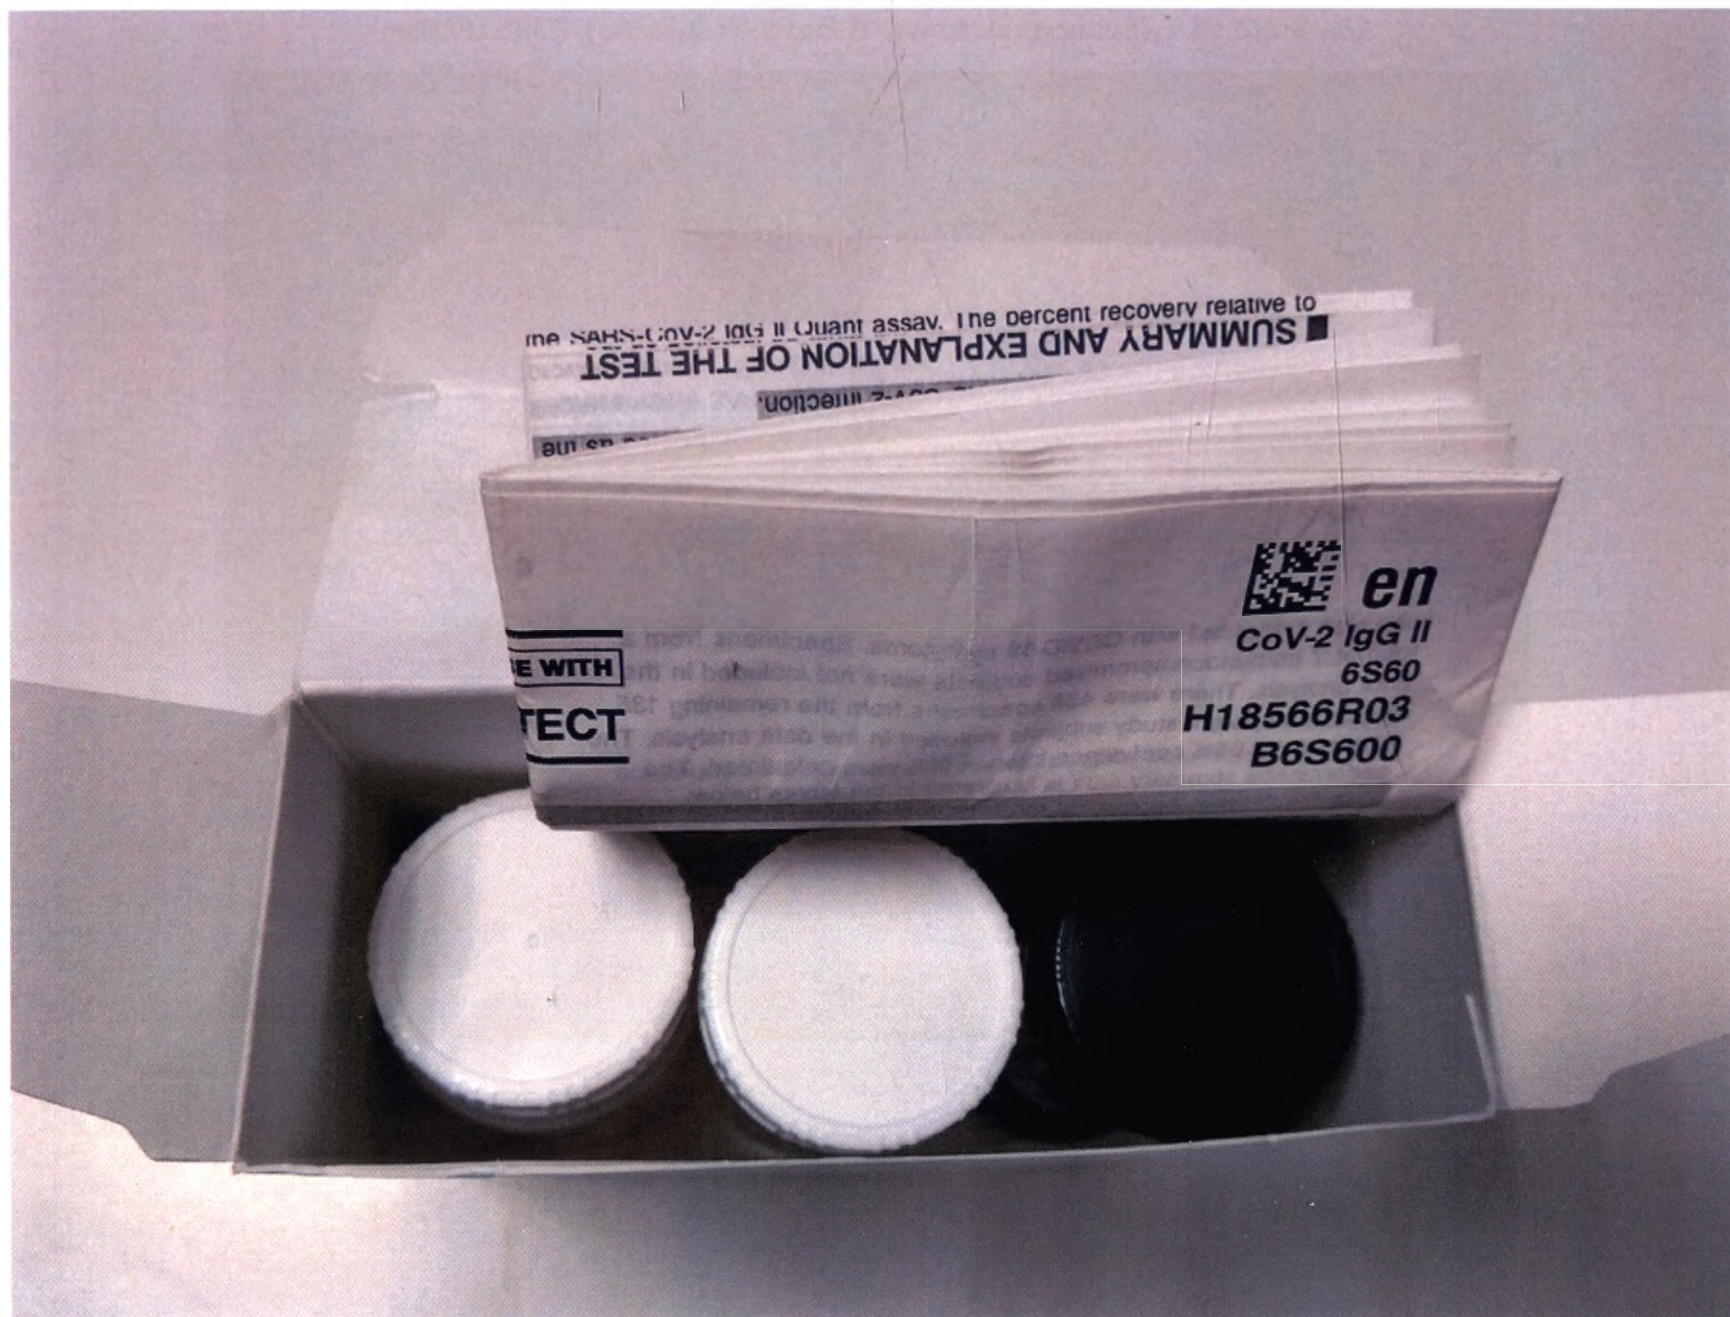

The image shows three reagent bottles and their packaging for the Architect SARS-CoV-2 IgG II Quant assay. The bottles are labeled 'SARS-CoV-2 IgG II Quant', 'CONJUGATE', and 'ASSAY DILUENT'. The packaging is a large box with a detailed label showing the product name, lot numbers, and expiration dates. The label also includes a QR code and a warning to 'PROTECT FROM LIGHT'.

Всего прошито, пронумеровано

и скреплено печатью

листов

Подпись

