

Макет маркировки на медицинское изделие

Набор калибраторов для обеспечения правильности качественного и количественного определения антител класса IgG к вирусу SARS-CoV-2 иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови человека на иммунохимических анализаторах ARCHITECT «SARS-CoV-2 IgG II Количественный Калибраторы для ARCHITECT (SARS-CoV-2 IgG II Quant Calibrator Kit)» (серия (партия) 35518FN00)

Макет маркировки медицинского изделия для обращения на территории Российской Федерации
**SARS-CoV-2 IgG II Количественный Калибраторы для ARCHITECT (SARS-CoV-2 IgG II
Quant Calibrator Kit), Кат. №6S60-02**



6S60-02



Набор калибраторов для обеспечения правильности качественного и количественного определения антител класса IgG к вирусу SARS-CoV-2 иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови человека на иммунохимических анализаторах ARCHITECT «**SARS-CoV-2 IgG II Количественный Калибраторы для ARCHITECT (SARS-CoV-2 IgG II Quant Calibrator Kit)**» (серия (партия) 35518FN00)

в составе: Калибратор А (SARS-CoV-2 IgG II CAL A) - 1 флакон х 2,0 мл; Калибратор В (SARS-CoV-2 IgG II CAL B) - 1 флакон х 2,0 мл; Калибратор С (SARS-CoV-2 IgG II CAL C) - 1 флакон х 2,0 мл; Калибратор D (SARS-CoV-2 IgG II CAL D) - 1 флакон х 2,0 мл; Калибратор Е (SARS-CoV-2 IgG II CAL E) - 1 флакон х 2,0 мл; Калибратор F (SARS-CoV-2 IgG II CAL F) - 1 флакон х 2,0 мл; Инструкция по применению / Производитель: Abbott Ireland Diagnostics Division Finisklin Business Park, Sligo, Ireland/ Место производства: Abbott Ireland Diagnostics Division Finisklin Business Park, Sligo, Ireland / Страна происхождения: Ирландия / РУ № ____/____ от ____/____/____ / Инструкция по применению на русском языке: www.corelaboratory.abbott/IFU / Серия, использовать до, условия хранения указаны в графических символах. Расшифровку графических символов см. в инструкции/

Авторизованный представитель изготовителя на территории России и других стран СНГ:

Общество с ограниченной ответственностью «Эбботт Лэбораториз», 125171, Россия,

г. Москва, Ленинградское шоссе, 16А, строение 1, Тел: +7 (495) 258 42 70 (80); Факс: +7 (495) 258 42 71 (81)

Макет оригинальной маркировки медицинского изделия SARS-CoV-2 IgG II Количественный
Калибраторы для ARCHITECT (SARS-CoV-2 IgG II Quant Calibrator Kit), Кат. №6S60-02

118560-02

LOT

EXP

www.correlab.org/abbott/ru

REF

CoV-2 IgG II Cals

6S60-02

IVD

CE

0123

2

SARS-CoV-2 IgG II Quant Calibrator Kit

FOR USE WITH
ARCHITECT

			CONC
CAL A	1 X	2.0 mL	0.00
CAL B	1 X	2.0 mL	8.33
CAL C	1 X	2.0 mL	13.33
CAL D	1 X	2.0 mL	116.66
CAL E	1 X	2.0 mL	1000.00
CAL F	1 X	2.0 mL	1666.67

!

WARNING: SENSITIZER

-20°C

UNTIL FIRST USE

8°C

AFTER THAW

PROTECT FROM LIGHT

Abbott Ireland
Diagnostics Division
Finislin Business Park
Sligo
Ireland
+353-71-9171712

PRODUCT OF IRELAND

2

Abbott

CoV-2 IgG II
Cals

Макет маркировки компонентов медицинского изделия SARS-CoV-2 IgG II Количественный
Калибраторы для ARCHITECT (SARS-CoV-2 IgG II Quant Calibrator Kit), Кат. №6S60-02

- Калибратор А (SARS-CoV-2 IgG II CAL A)

SARS-CoV-2 IgG II **FOR USE WITH ARCHITECT**

CAL A	IVD	REF 6S60A
		2.0 mL
		0.00 AU/mL

 **WARNING: SENSITIZER**

H18554R01
ABBOTT
AIDD Sligo, Ireland

 Exp.

LOT

- Калибратор В (SARS-CoV-2 IgG II CAL B)

SARS-CoV-2 IgG II **FOR USE WITH ARCHITECT**

CAL B	IVD	REF 6S60B
		2.0 mL
		8.33 AU/mL

 **WARNING: SENSITIZER**

H18555R01
ABBOTT
AIDD Sligo, Ireland

 Exp.

LOT

- Калибратор С (SARS-CoV-2 IgG II CAL C)

SARS-CoV-2 IgG II **FOR USE WITH ARCHITECT**

CAL C	IVD	REF 6S60C
		2.0 mL
		13.33 AU/mL

 **WARNING: SENSITIZER**

H18556R01
ABBOTT
AIDD Sligo, Ireland

 Exp.

LOT

- Калибратор D (SARS-CoV-2 IgG II CAL D)

SARS-CoV-2 IgG II **FOR USE WITH ARCHITECT**

CAL D	IVD	REF 6S60D
		2.0 mL
		116.66 AU/mL

 **WARNING: SENSITIZER**

H18557R01
ABBOTT
AIDD Sligo, Ireland

 Exp.

LOT

- Калибратор E (SARS-CoV-2 IgG II CAL E)

SARS-CoV-2 IgG II		FOR USE WITH ARCHITECT	
CAL E		IND	REF 6S60E
			2.0 mL
			1000.00 AU/mL
 WARNING: SENSITIZER			
H18558R01 ABBOTT AIDD Sligo, Ireland		 Exp.  LOT	

- Калибратор F (SARS-CoV-2 IgG II CAL F)

SARS-CoV-2 IgG II		FOR USE WITH ARCHITECT	
CAL F		IND	REF 6S60F
			2.0 mL
			1666.67 AU/mL
 WARNING: SENSITIZER			
H18559R01 ABBOTT AIDD Sligo, Ireland		 Exp.  LOT	

Расшифровка символов представлена в инструкции.

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

листов


Подпись _____




Фотографические изображения общего вида на медицинское изделие

**Набор калибраторов для обеспечения правильности качественного и
количественного определения антител класса IgG к вирусу SARS-CoV-2
иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови человека на
иммунохимических анализаторах ARCHITECT «SARS-CoV-2 IgG II
Количественный Калибраторы для ARCHITECT (SARS-CoV-2 IgG II Quant
Calibrator Kit)» (серия (партия) 30218FN00)**

(размером не менее 18 x 24 сантиметра)

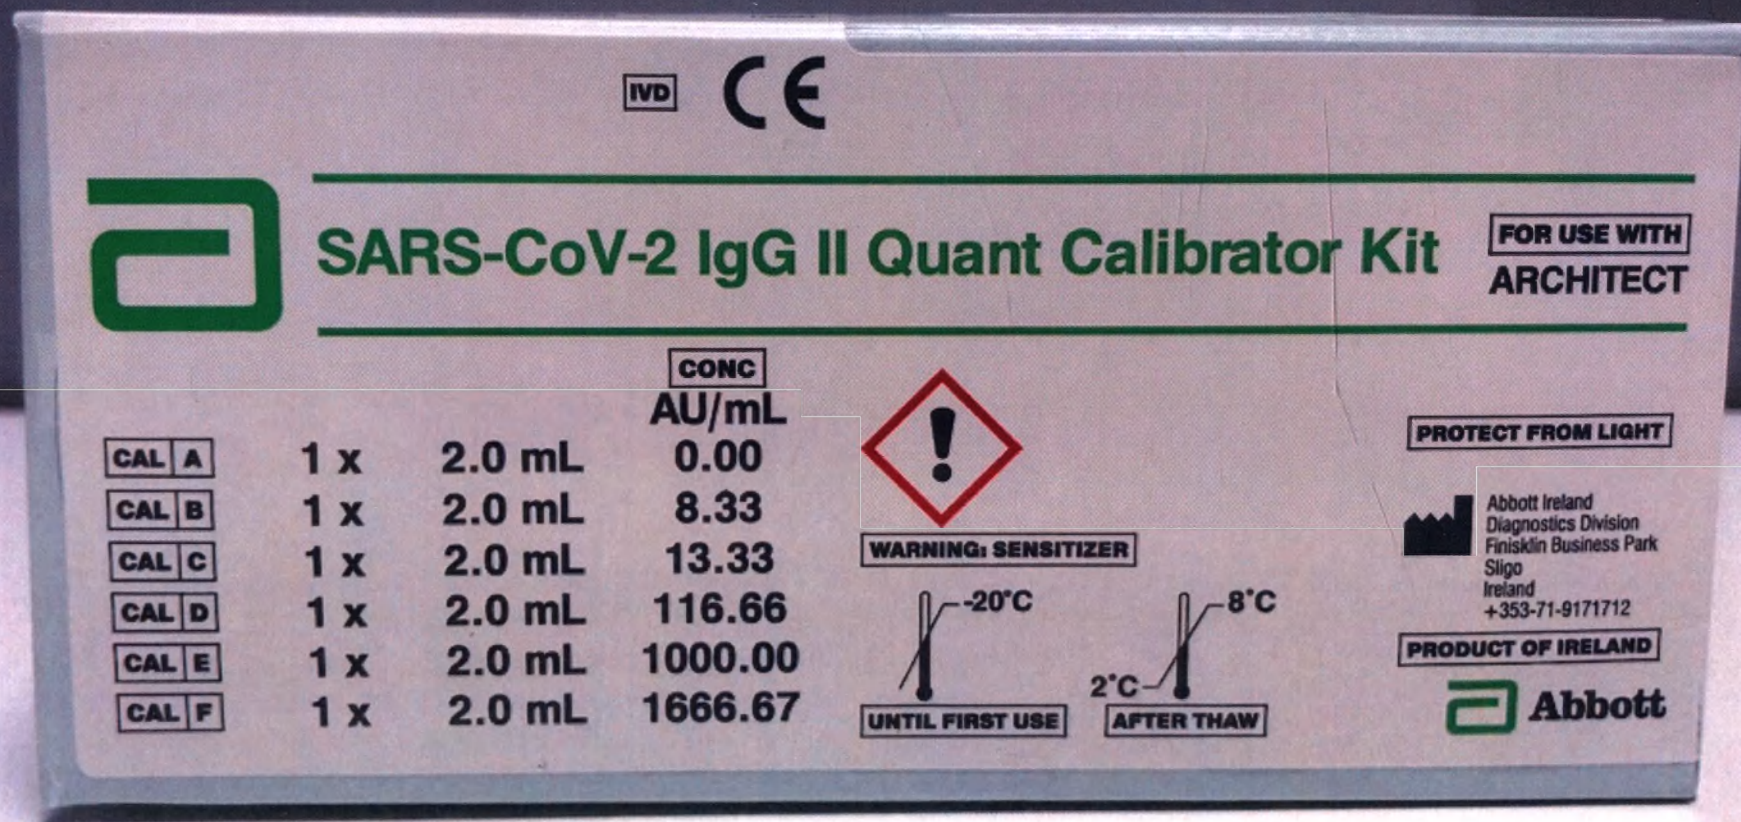

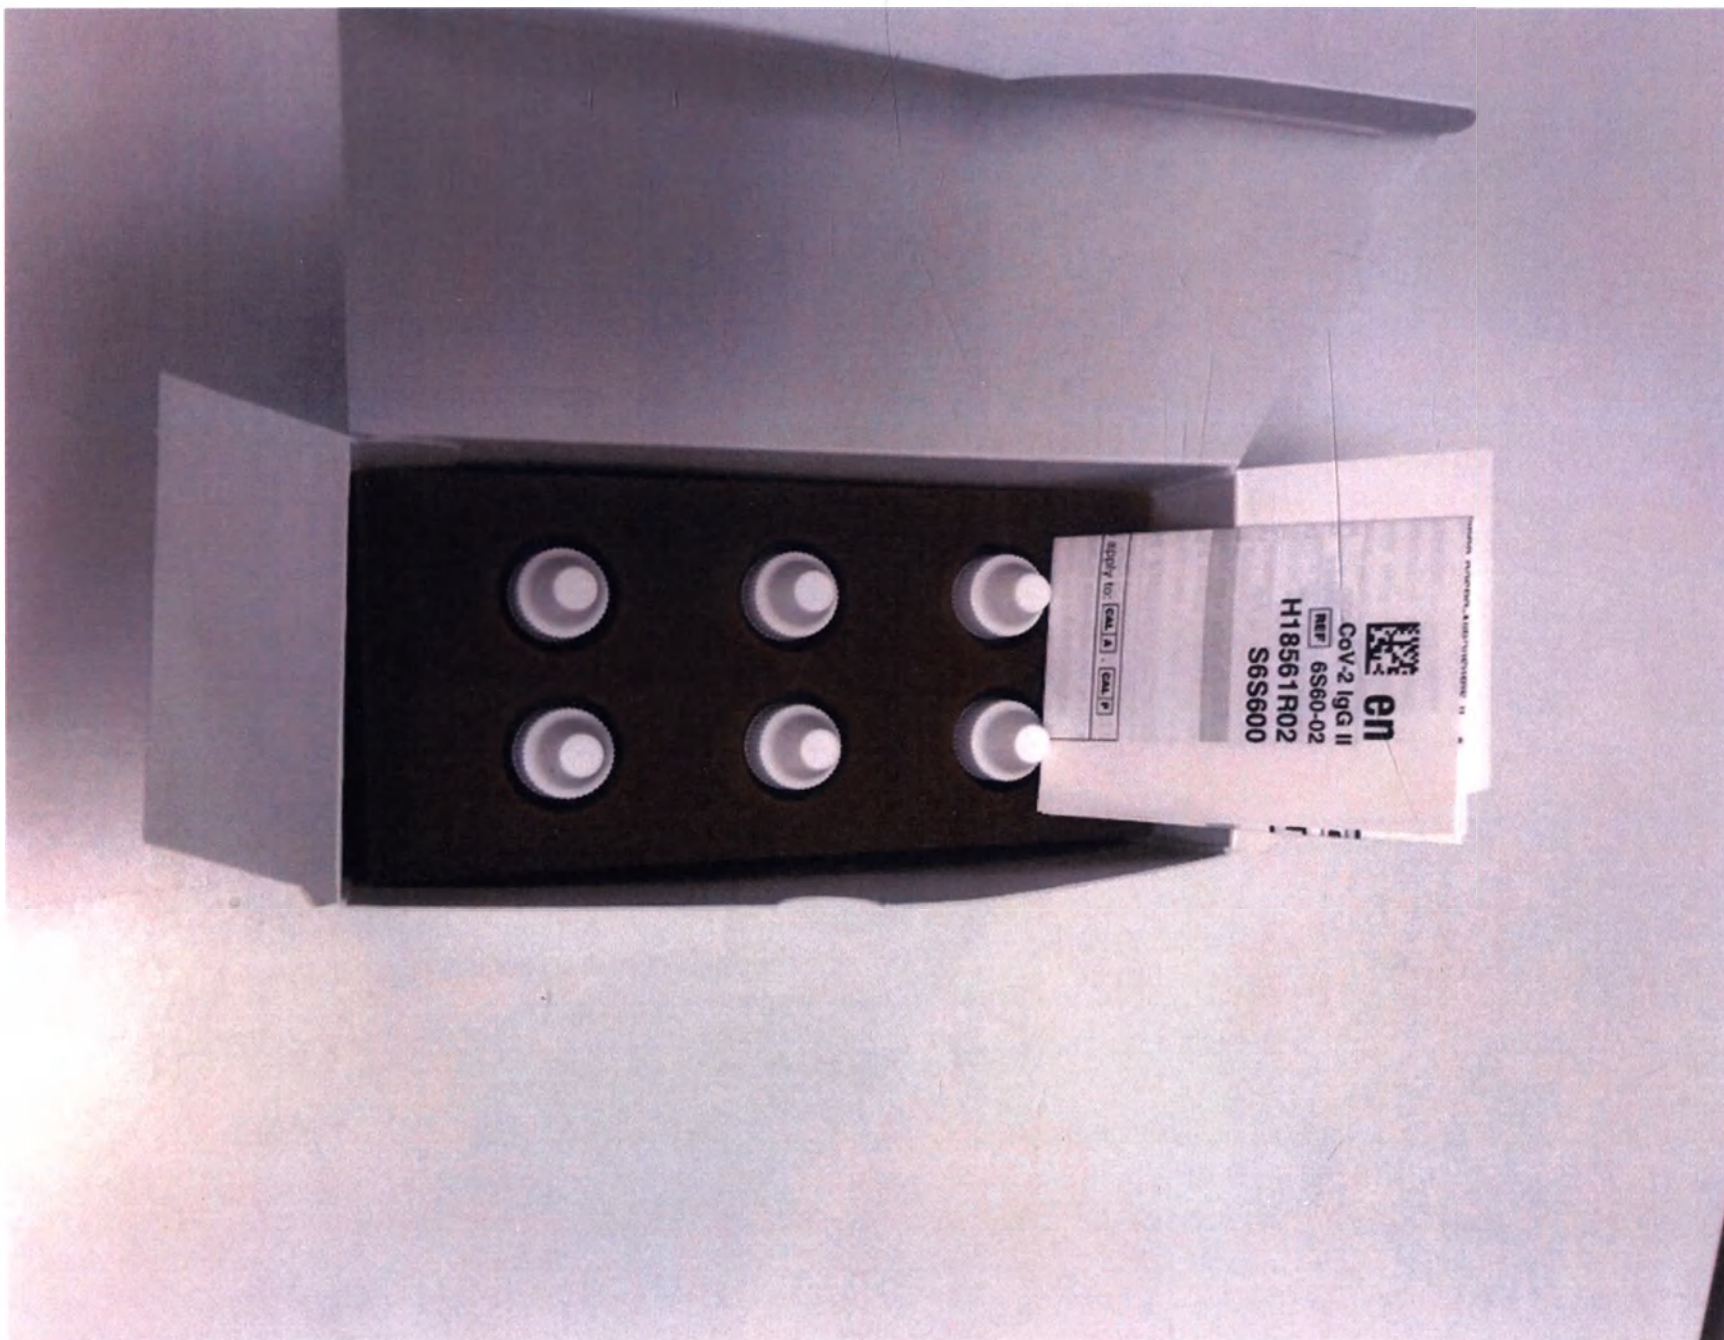

всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

4 листов

Подпись

