



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

“ФИРМА “ФИНКО”

ИНН 7732016160 КПП 771401001

Юр. адрес: 123007 г. Москва, ул. 4-я Магистральная, д. 5, стр. 5,
эт/пом/ком 4/1/9-16

Почтовый адрес: 127083, г. Москва, а/я 520

тел / факс: +7 (495) 640-34-55

e-mail: info@finco-med.com

Представитель фирм «CryoLife Europa, Ltd» и «LOHMANN & RAUSCHER GmbH» в России

Официальный дилер корпораций «Johnson & Johnson» и «MEDTRONIC»

Фотографические изображения медицинского изделия

Катетер проводниковый удлиняющий Guideplus II, стерильный одноразовый в вариантах исполнения

Производства компании
«НИПРО КОРПОРЕЙШН», Япония
NIPRO CORPORATION, 3-9-3, Honjo-Nishi, Kita-ku, Osaka 531-8510, JAPAN

Макет дополнительной этикетки групповой и транспортной упаковок для обращения медицинских изделий на территории РФ:

Макет дополнительной этикетки медицинского изделия «Катетер проводниковый удлиняющий Guideplus II, стерильный одноразовый в вариантах исполнения. Катетер проводниковый удлиняющий Guideplus II ST, стерильный одноразовый».

NIPRO

GUIDEPLUS II

Катетер проводниковый удлиняющий Guideplus II, стерильный одноразовый в вариантах исполнения: Катетер проводниковый удлиняющий Guideplus II ST, стерильный одноразовый



Производитель:
NIPRO CORPORATION, 3-9-3, Honjo-Nishi, Kita-ku, Osaka 531-8510, Япония,
тел.: +81-6-6375-6709
www.nipro.com

Уполномоченный представитель производителя:
ООО «Фирма „Финко“», Россия, 127083, г. Москва, а/я 520
Тел./ факс: +7(495)6403455, Адрес электронной почты: info@finco-med.com

Кат. номер - XXXXX

РУ № ФСЗ XXXX/ XXXX от XX.XX.XXXX

Срок годности: 3 года.
Дата окончания срока годности: см. на упаковке.
Изделие нетоксично. Стерильно. Апиrogenно



Условия транспортировки и хранения:

в оригинальной упаковке при температуре от 5°C до 40°C и относительной влажности (без образования конденсата) от 30% до 80 % при атмосферном давлении 500 – 1060 гПа

Избегайте попадания воды, прямых солнечных лучей, повышенной температуры и влажности.



Информацию на данном стикере считать ПРИОРИТЕТНОЙ!



Макет дополнительной этикетки медицинского изделия «Катетер проводниковый удлиняющий Guideplus II, стерильный одноразовый в вариантах исполнения. Катетер проводниковый удлиняющий Guideplus II EL, стерильный одноразовый».

NIPRO

GUIDEPLUS II

Катетер проводниковый удлиняющий Guideplus II, стерильный одноразовый в вариантах исполнения: Катетер проводниковый удлиняющий Guideplus II EL, стерильный одноразовый



Производитель:
NIPRO CORPORATION, 3-9-3, Honjo-Nishi, Kita-ku, Osaka 531-8510, Япония,
тел.: +81-6-6375-6709
www.nipro.com

Уполномоченный представитель производителя:
ООО «Фирма „Финко“, Россия, 127083, г. Москва, а/я 520
Тел./ факс: +7(495)6403455, Адрес электронной почты: info@finco-med.com

Кат. номер - XXXXX

РУ № ФСЗ XXXX/ XXXX от XX.XX.XXXX

Срок годности: 3 года.
Дата окончания срока годности: см. на упаковке.
Изделие нетоксично. Стерильно. Апиrogenно

STERILE EO



Условия транспортировки и хранения:

в оригинальной упаковке при температуре от 5°C до 40°C и относительной влажности (без образования конденсата) от 30% до 80 % при атмосферном давлении 500 – 1060 гПа

Избегайте попадания воды, прямых солнечных лучей, повышенной температуры и влажности.



Информацию на данном стикере считать ПРИОРИТЕТНОЙ!



Фотографические изображения групповой/ потребительской упаковки медицинского изделия

Фотографическое изображение потребительской упаковки с маркировкой медицинского изделия Катетера Guideplus II ST, содержащей информацию на русском языке



NIPRO

GUIDE PLUS II ST

Guide Extension Catheter



品番 Model : GUIDEPLUS 2 ST INT
 商品コード (REF) : 52-795
 製造番号 (LOT) : 20J12
 製造年月 : 2020-10
 使用期限 : 2023-09
 入数 Quantity : 1

一般名称 : 冠動脈貫通用カテーテル
 管理区分 : 高度管理医療機器
 販売名 : ニプロガイディングカテーテルB
 保険医療材料請求分類 : 心臓手術用カテーテル
 冠動脈狭窄部貫通用カテーテル
 医療機器承認番号 : 22600BZX00158000

製造販売 : ニプロ株式会社
 大阪市北区本庄西3丁目9番3号

STERILE EO MADE IN JAPAN

- エチレンオキサイドガス滅菌済
- 使用1回限り

NIPRO CORPORATION
 3-9-3, Honjo-Nishi, Kita-ku, Osaka 531-8510, JAPAN
 [Manufacturing facility]
 NIPRO CORPORATION ODATE FACTORY
 8-7, Hanukiyachi, Niida, Odate-shi, Akita, 018-5794, JAPAN

NIPRO GUIDEPLUS II

Model: GUIDEPLUS 2 ST INT

REF: 52795

LOT: 20J12 Serial No.: GCB-04-001276



NIPRO GUIDEPLUS II

Model: GUIDEPLUS 2 ST INT

REF: 52795

LOT: 20J12 Serial No.: GCB-04-001276



NIPRO GUIDEPLUS II

Model: GUIDEPLUS 2 ST INT

REF: 52795

LOT: 20J12 Serial No.: GCB-04-001276




фотографическое изображение потребительской упаковки с маркировкой медицинского изделия Катетера Guideplus II EL, содержащей информацию на русском языке



NIPRO

GUIDE PLUS II EL Guide Extension Catheter

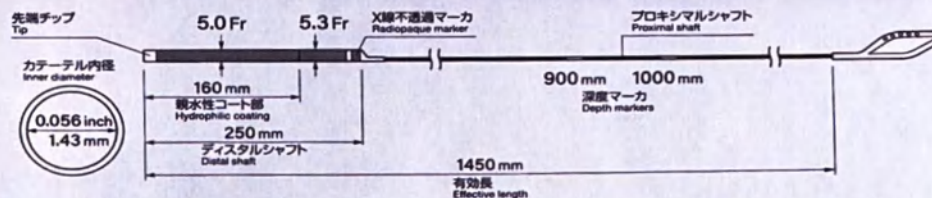

品番 Model : GUIDEPLUS 2 EL INT

商品コード REF : 52-796

製造番号 LOT : 20J27

製造年月 : 2020-10

使用期限 : 2023-09

入数 Quantity : 1

一般的名称 : 冠動脈貫通カテーテル

管理区分 : 高度管理医療機器

販売名 : ニプロガイディングカテーテルB

保険医療材料請求分類 : 心臓手術用カテーテル
冠動脈狭窄部貫通カテーテル

医療機器承認番号 : 22600BZX00158000

製造販売 : ニプロ株式会社

大阪市北区本庄西3丁目9番3号

STERILE EO MADE IN JAPAN

- エチレンオキサイドガス滅菌済
- 使用1回限り

NIPRO CORPORATION
3-9-3, Honjo-Nishi, Kita-ku, Osaka 531-8510, JAPAN
[Manufacturing facility]
NIPRO CORPORATION ODATE FACTORY
8-7, Hanukiyachi, Nida, Odate-shi, Akita, 018-5794, JAPAN

NIPRO GUIDEPLUS II

Model: GUIDEPLUS 2 EL INT

REF: 52796

LOT: 20J27 Serial No.: GCB-05-000045



(01)14967458527965(17)230900(30)1(10)20J27
BL3-TN-AK-GP-01(EL)

NIPRO GUIDEPLUS II

Model: GUIDEPLUS 2 EL INT

REF: 52796

LOT: 20J27 Serial No.: GCB-05-000045



(01)14967458527965(17)230900(30)1(10)20J27
BL3-TN-AK-GP-01(EL)

NIPRO GUIDEPLUS II

Model: GUIDEPLUS 2 EL INT

REF: 52796


LOT: 20J27 Serial No.: GCB-05-000045



(01)14967458527965(17)230900(30)1(10)20J27
BL3-TN-AK-GP-01(EL)

Фотографические изображения индивидуальной упаковки медицинского изделия

фотографическое изображение индивидуальной упаковки медицинского изделия «Катетер проводниковый удлиняющий Guideplus II, стерильный одноразовый в вариантах исполнения. Катетер проводниковый удлиняющий Guideplus II ST, стерильный одноразовый»

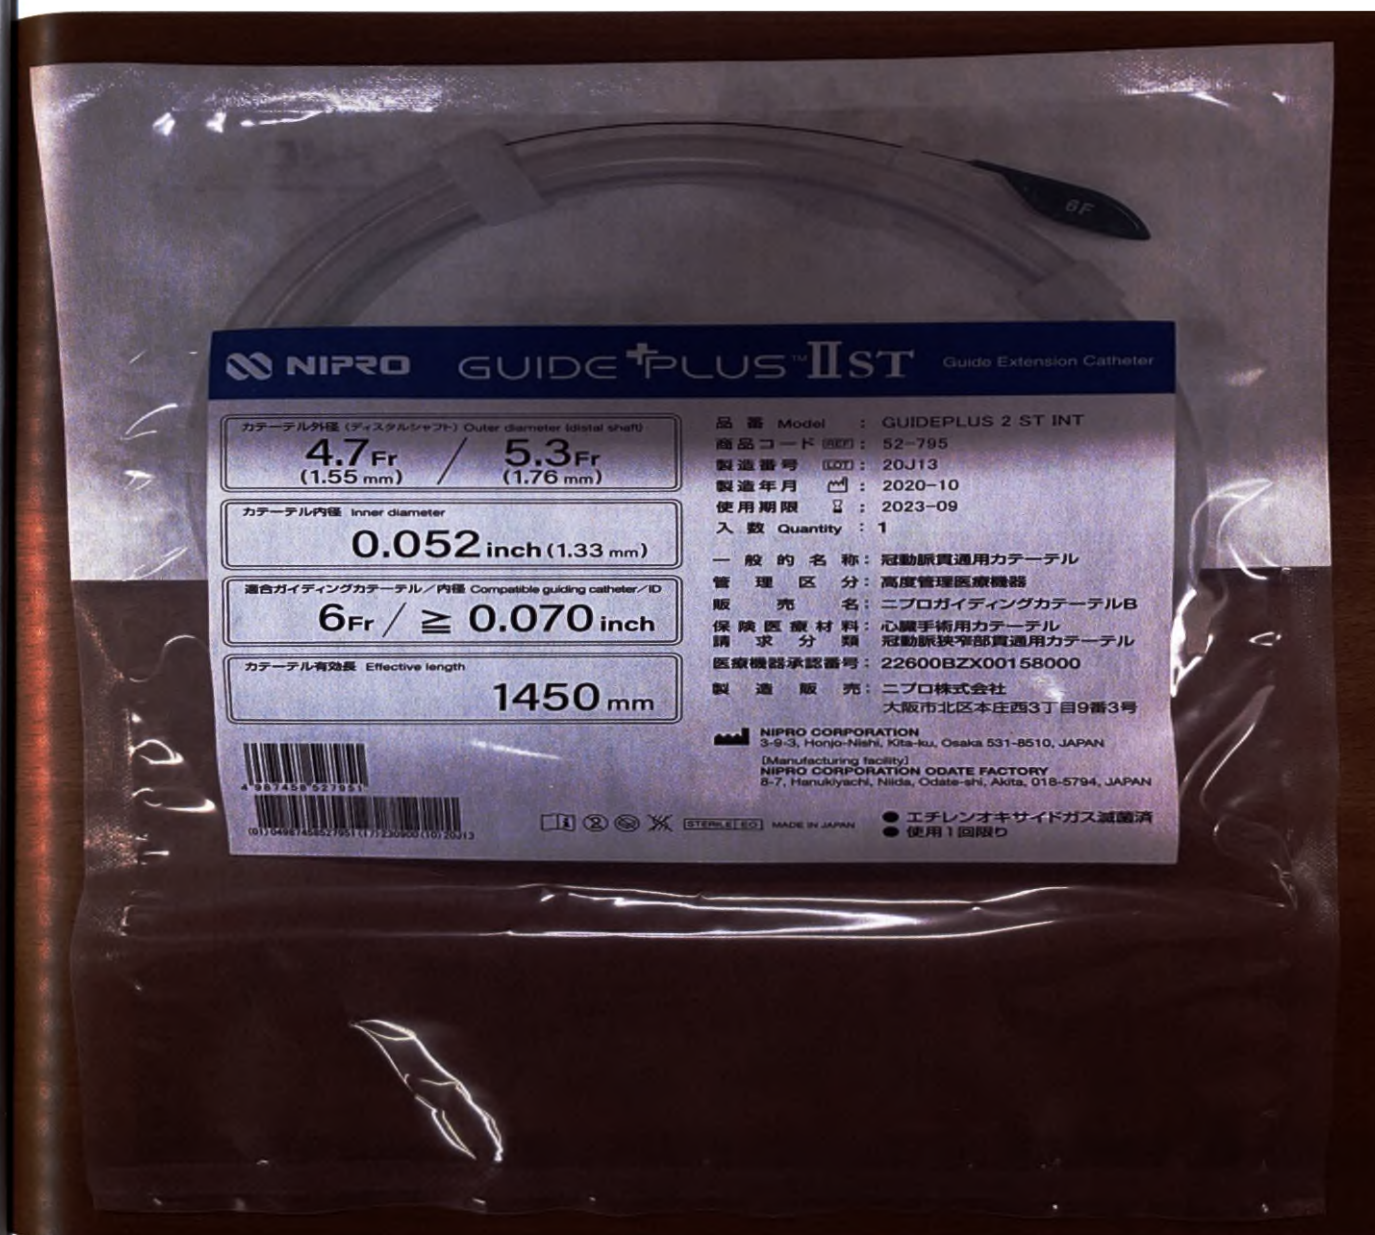

NIPRO

STERILE EO

Sterilized with ethylene oxide gas.
エチレンオキサイド滅菌済




For single use only. Do not reuse.
使用は1回限り、再使用しないこと



See Instructions for Use.
詳細は添付文書を参照して下さい



фотографическое изображение индивидуальной упаковки медицинского изделия «Катетер проводниковый удлиняющий Guideplus II, стерильный одноразовый в вариантах исполнения. Катетер проводниковый удлиняющий Guideplus II EL, стерильный одноразовый»

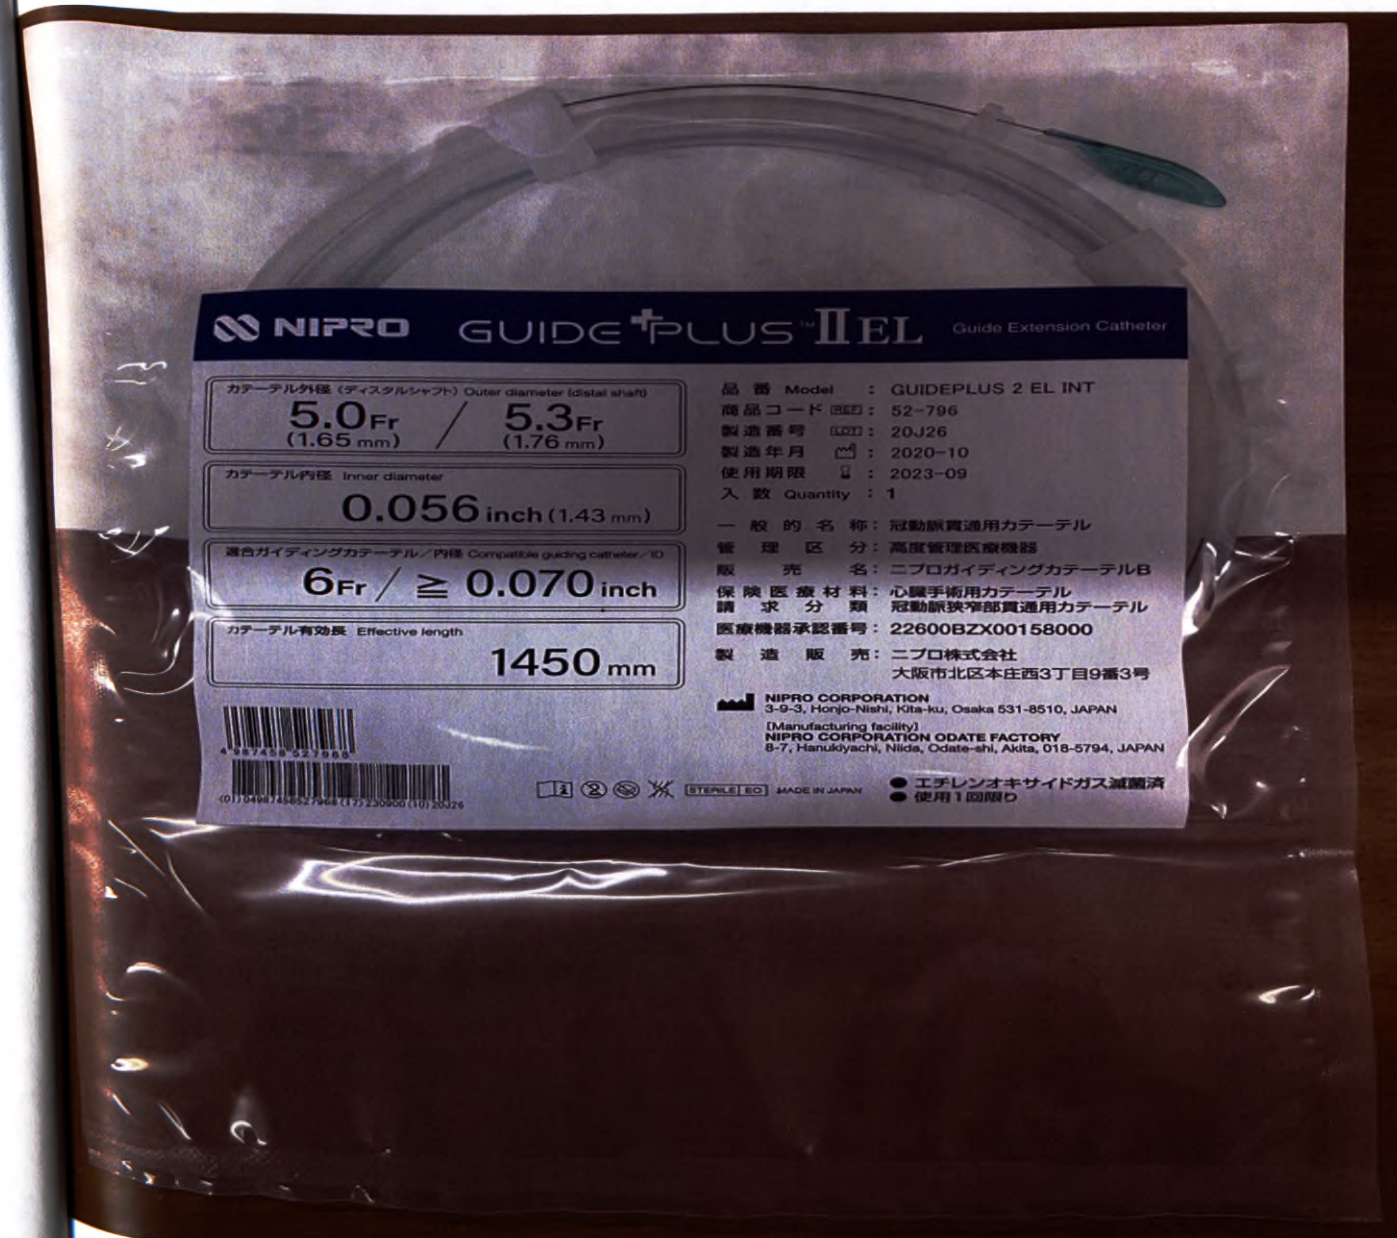

NIPRO GUIDE⁺PLUS[™] II EL Guide Extension Catheter

カテーテル外径 (ディスタルシャフト) Outer diameter (distal shaft)

5.0Fr / **5.3Fr**
(1.65 mm) / (1.76 mm)

カテーテル内径 Inner diameter

0.056 inch (1.43 mm)

適合ガイドリングカテーテル/内径 Compatible guiding catheter / ID


6Fr / **≥ 0.070 inch**

カテーテル有効長 Effective length

1450 mm



4 987458 527998
(10) 104987458527998 (17) 230900 (10) 20J26



STERILE EO MADE IN JAPAN

● エチレンオキシドガス滅菌済
● 使用1回限り

品番 Model : GUIDEPLUS 2 EL INT

商品コード JEC : 52-796

製造番号 LOT : 20J26

製造年月 M : 2020-10

使用期限 Y : 2023-09

入数 Quantity : 1

一 般 的 名 称 : 冠動脈貫通用カテーテル

管 理 区 分 : 高度管理医療機器

販 売 名 : ニプロガイドリングカテーテルB

保 険 医 療 材 料 : 心臓手術用カテーテル

請 求 分 類 : 冠動脈狭窄部貫通用カテーテル

医療機器承認番号 : 22600BZX00158000

製 造 販 売 : ニプロ株式会社
大阪市北区本庄西3丁目9番3号

NIPRO CORPORATION
3-9-3, Honjo-Nishi, Kita-ku, Osaka 531-8510, JAPAN

(Manufacturing facility)
NIPRO CORPORATION ODATE FACTORY
8-7, Hanukiyachi, Niida, Odate-shi, Akita, 018-5794, JAPAN

NIPRO

STERILE EO

Sterilized with ethylene oxide gas.
エチレンオキサイド滅菌済



For single use only. Do not reuse.
使用は1回限り、再使用しないこと



See Instructions for Use.
詳細は添付文書を参照して下さい


OPEN HERE


OPEN HERE





Фотографические изображения медицинского изделия

фотографическое изображение медицинского изделия «Катетер проводниковый удлиняющий Guideplus II, стерильный одноразовый в вариантах исполнения. Катетер проводниковый удлиняющий Guideplus II ST, стерильный одноразовый»

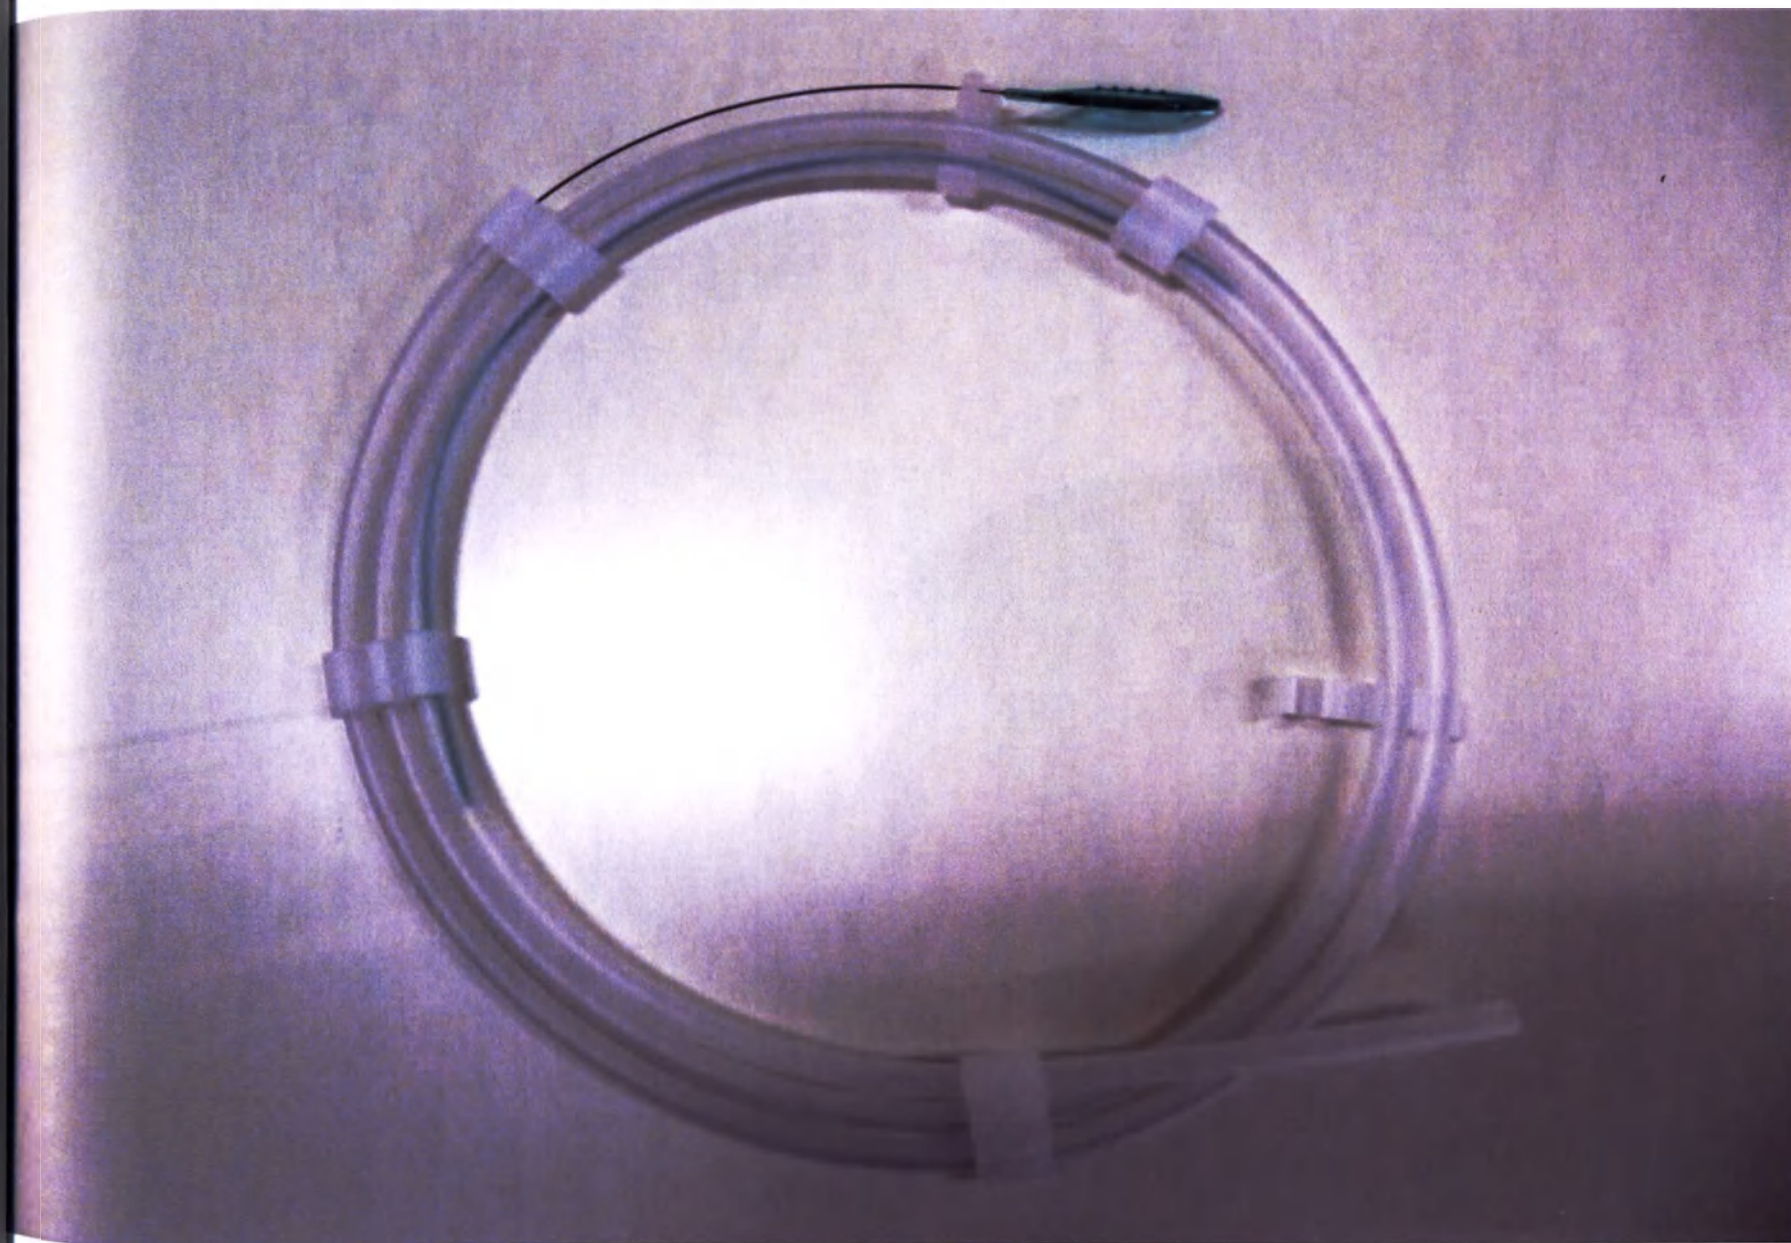


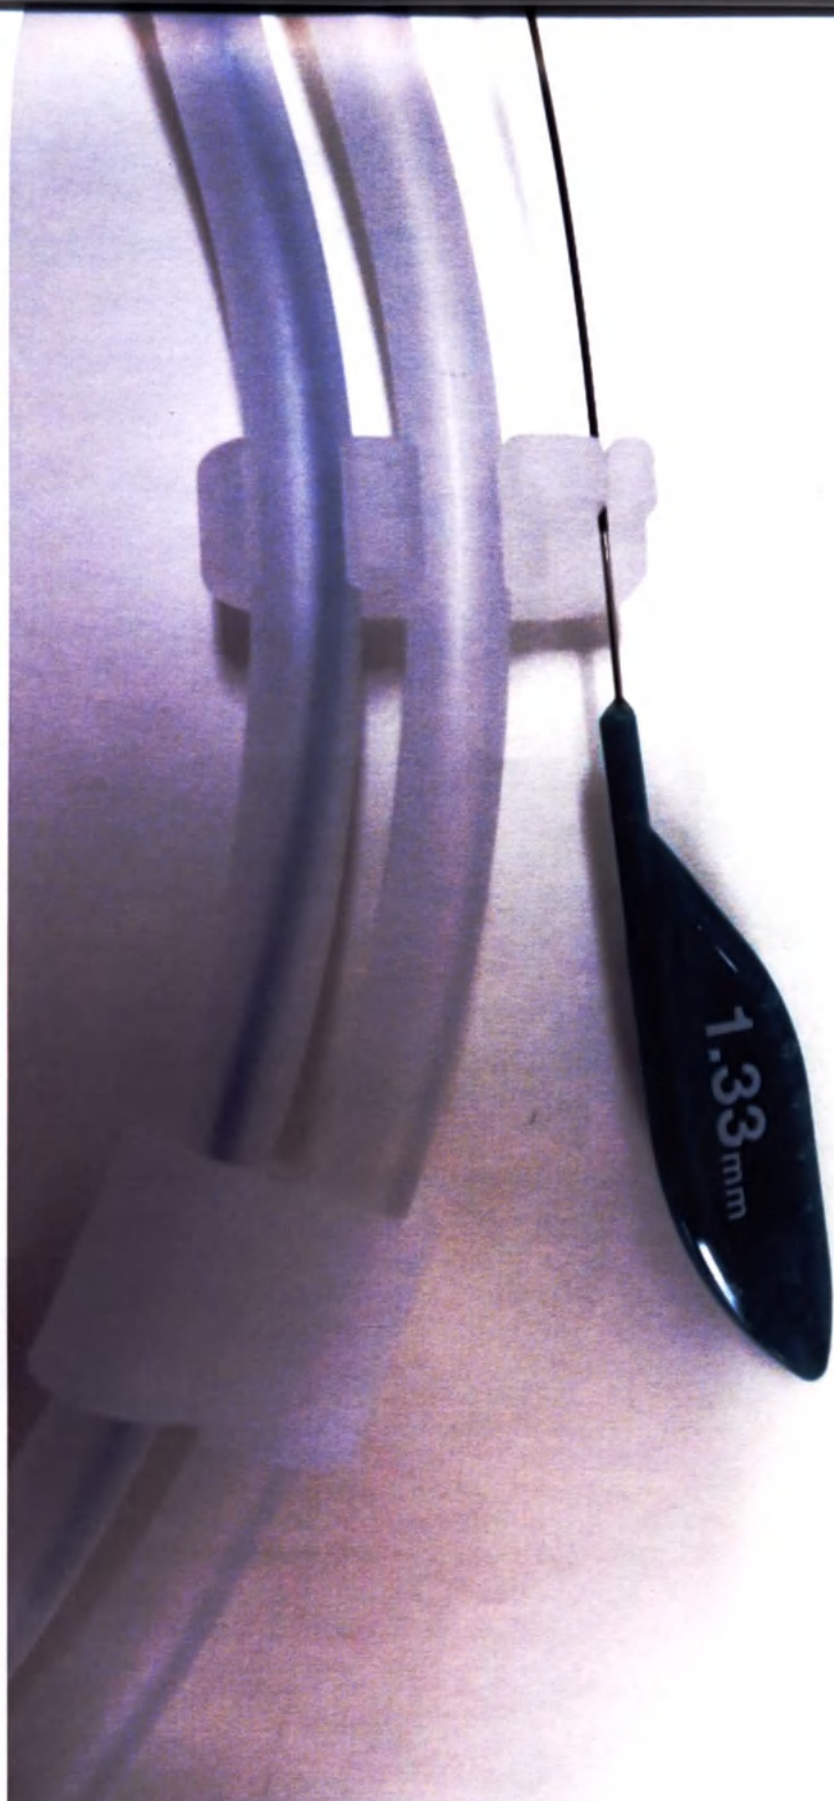

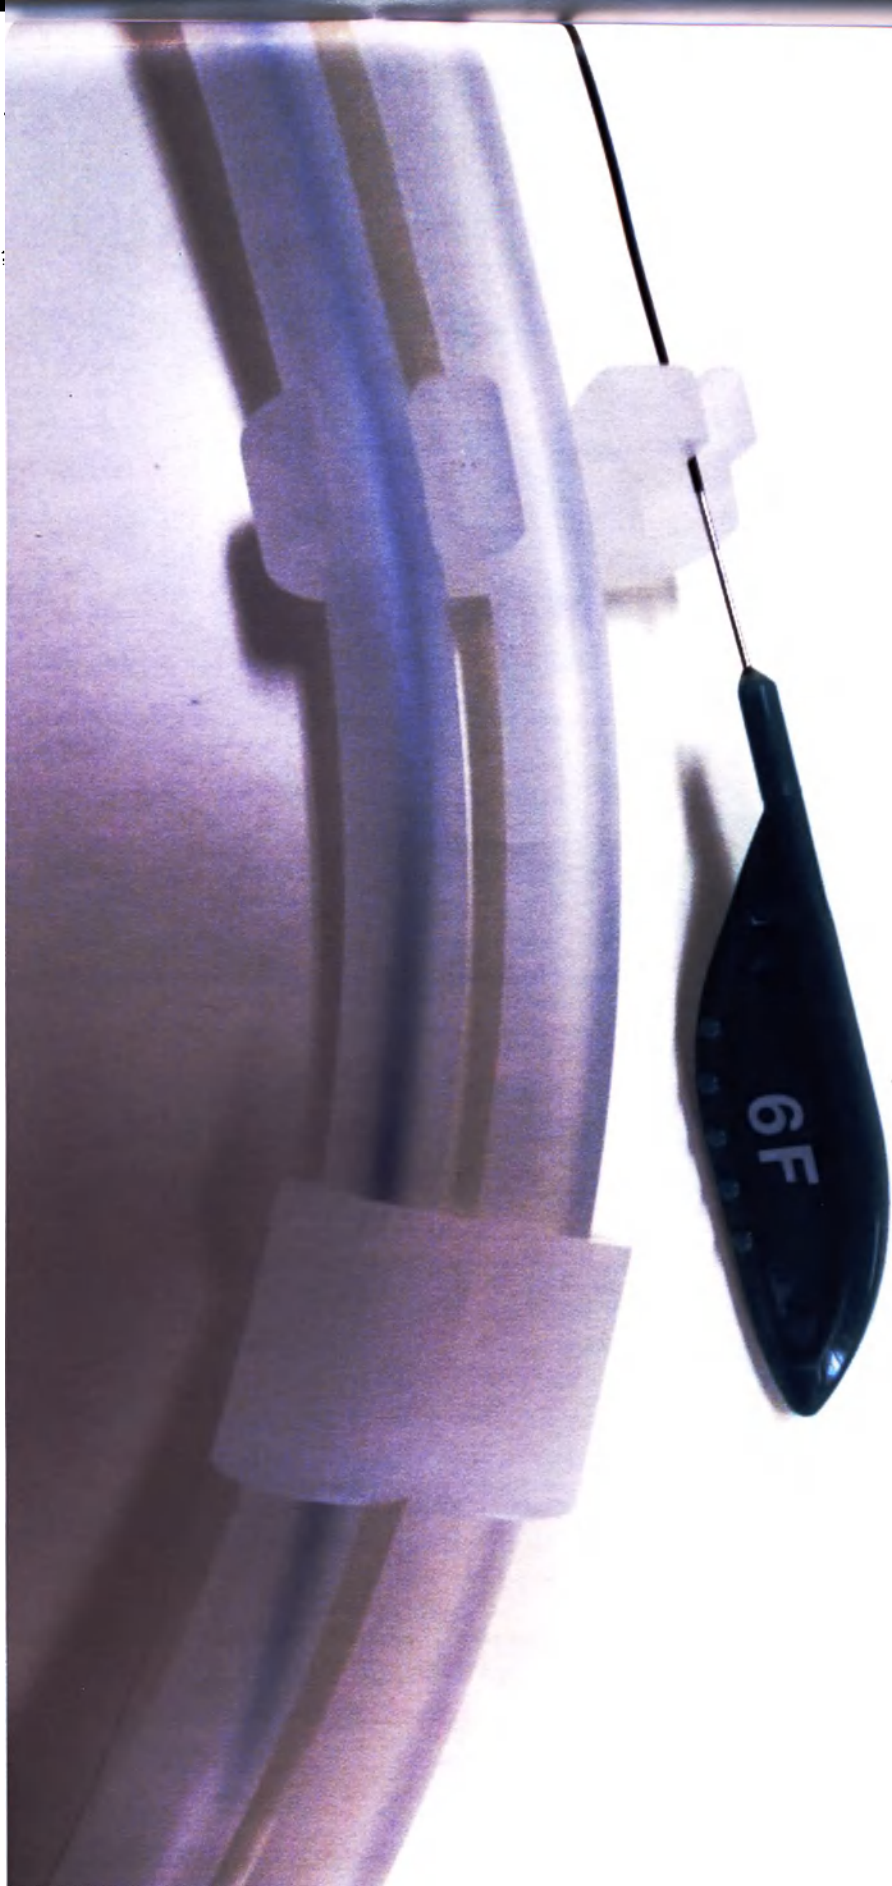


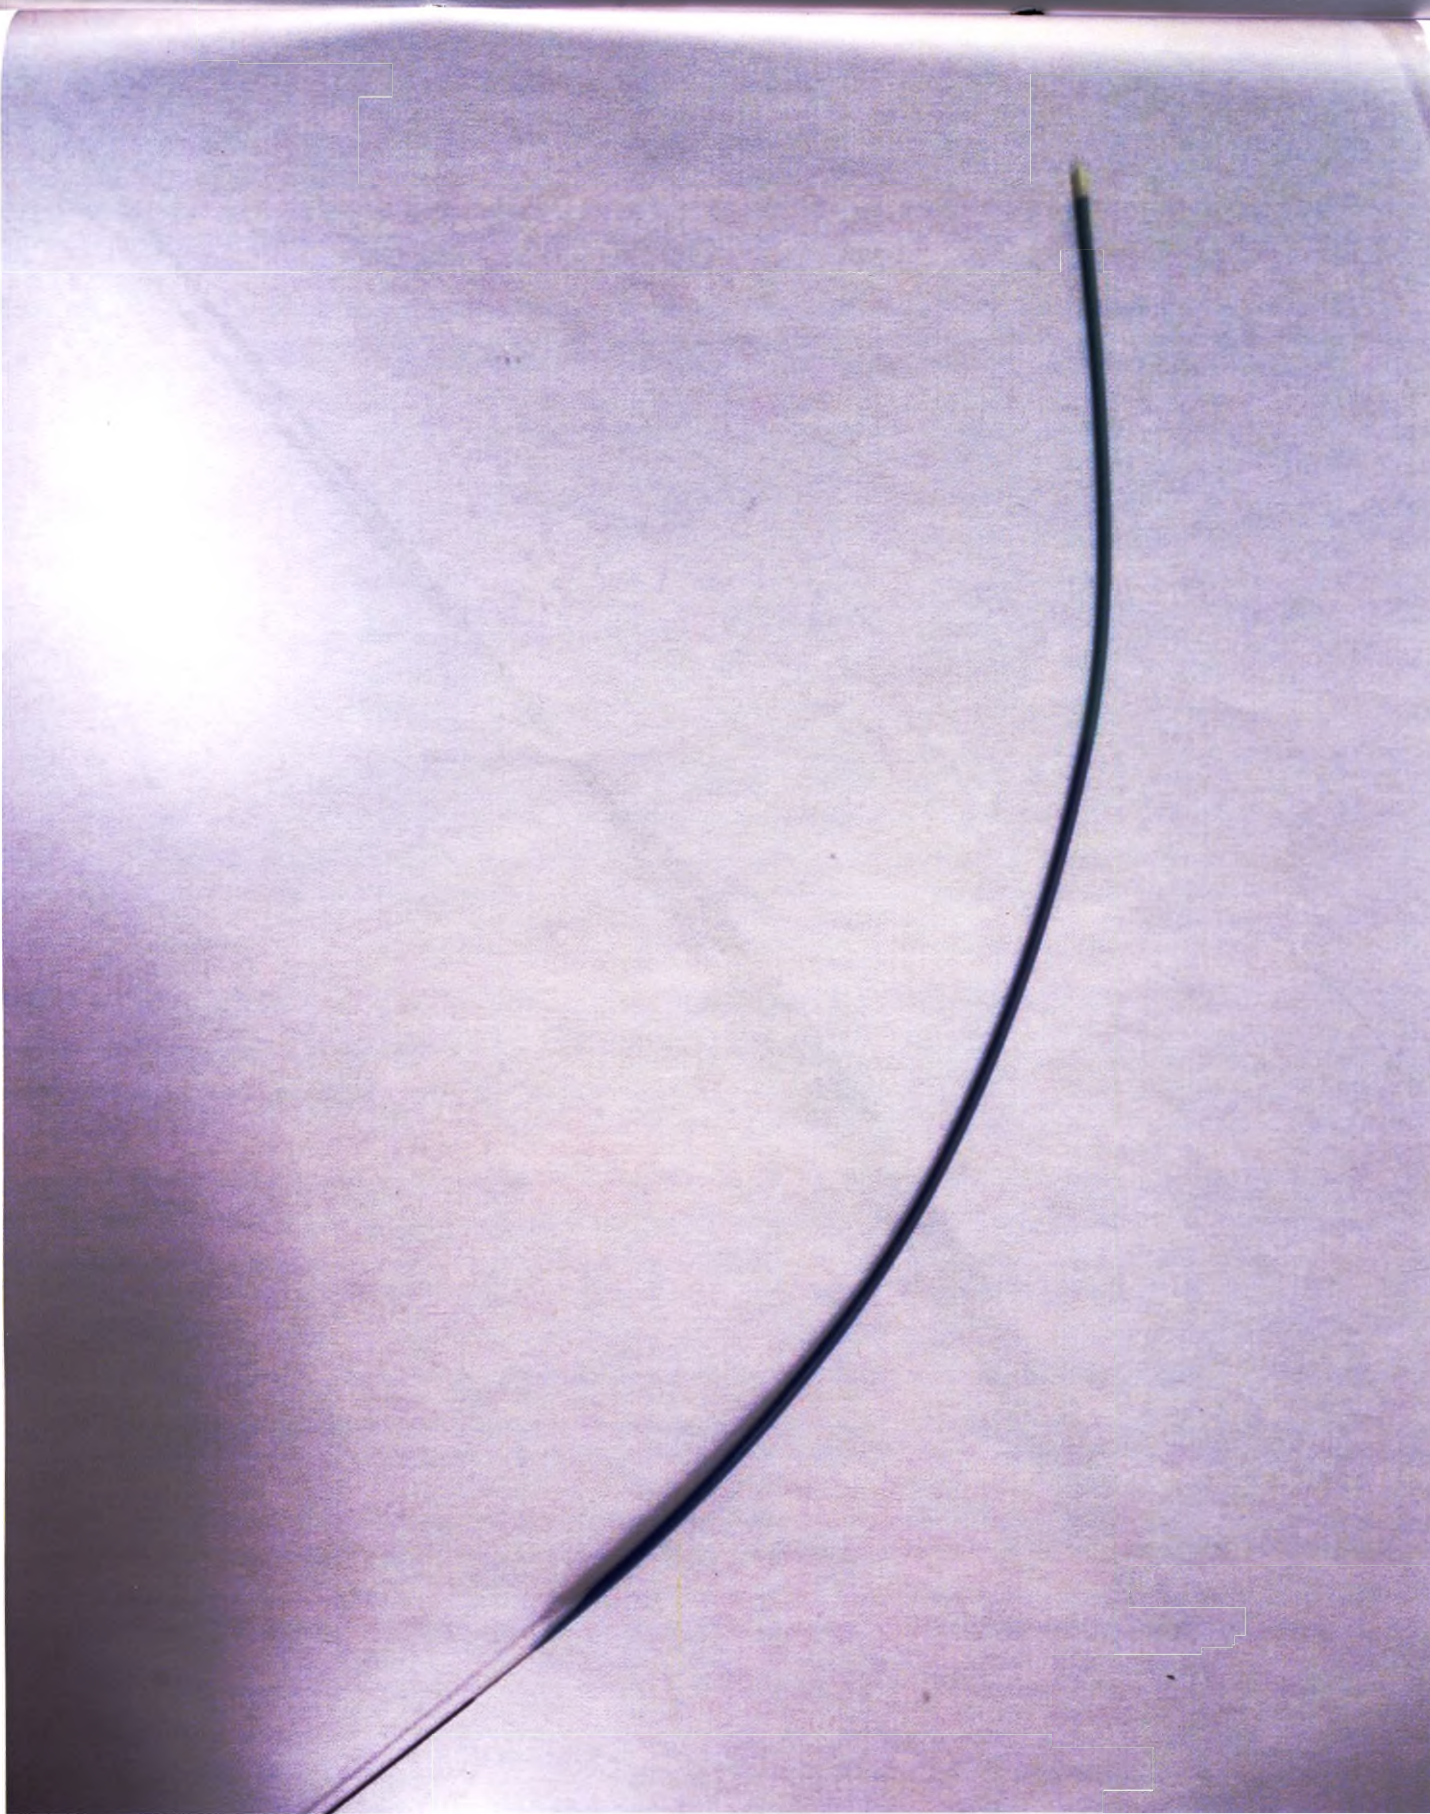



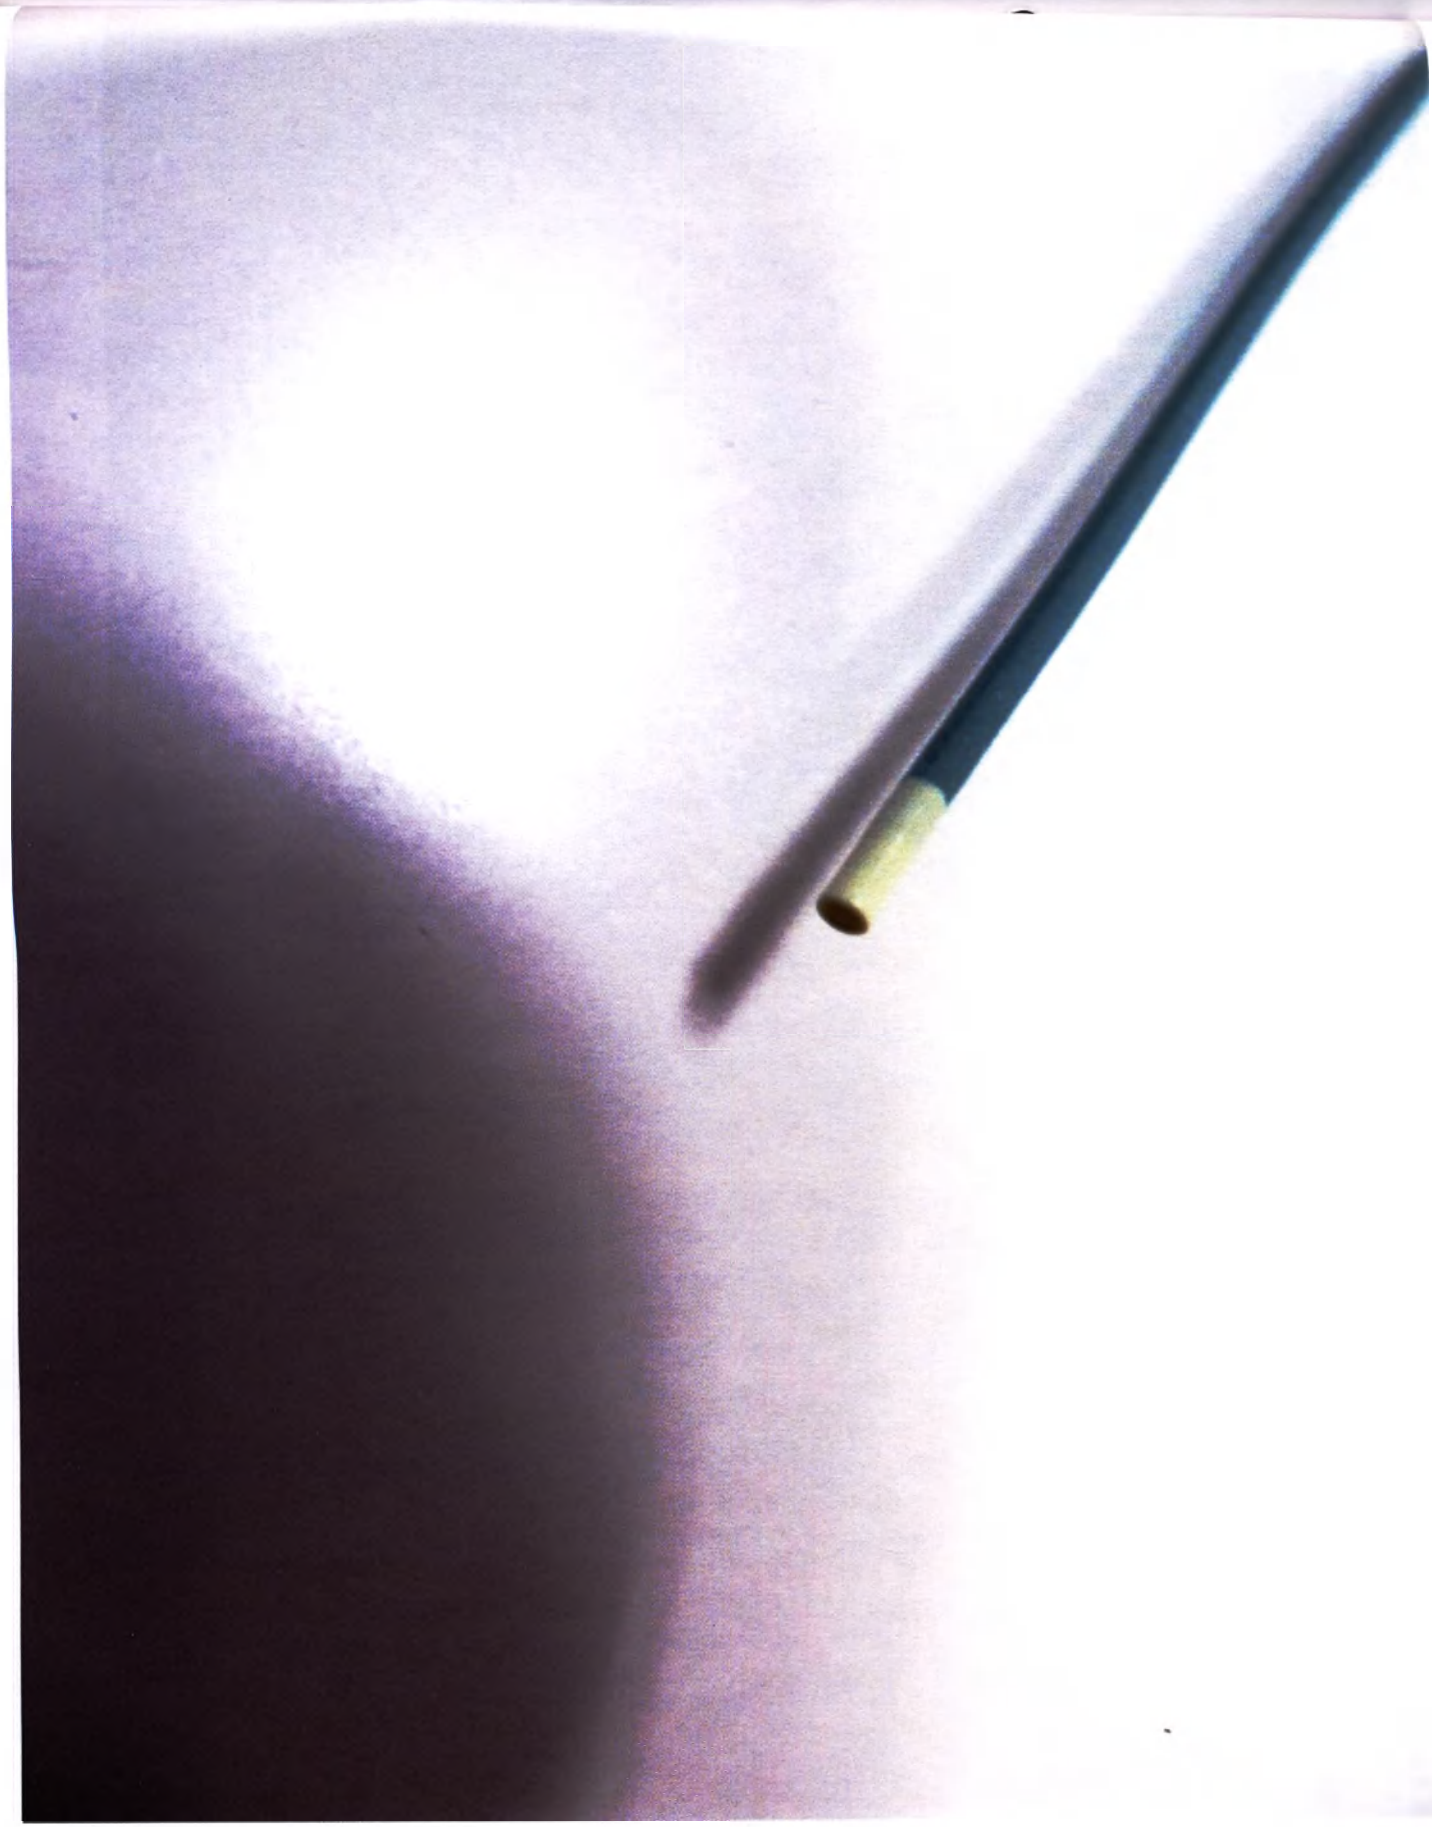



фотографическое изображение медицинского изделия «Катетер проводниковый удлиняющий Guideplus II, стерильный одноразовый в вариантах исполнения. Катетер проводниковый удлиняющий Guideplus II EL, стерильный одноразовый»

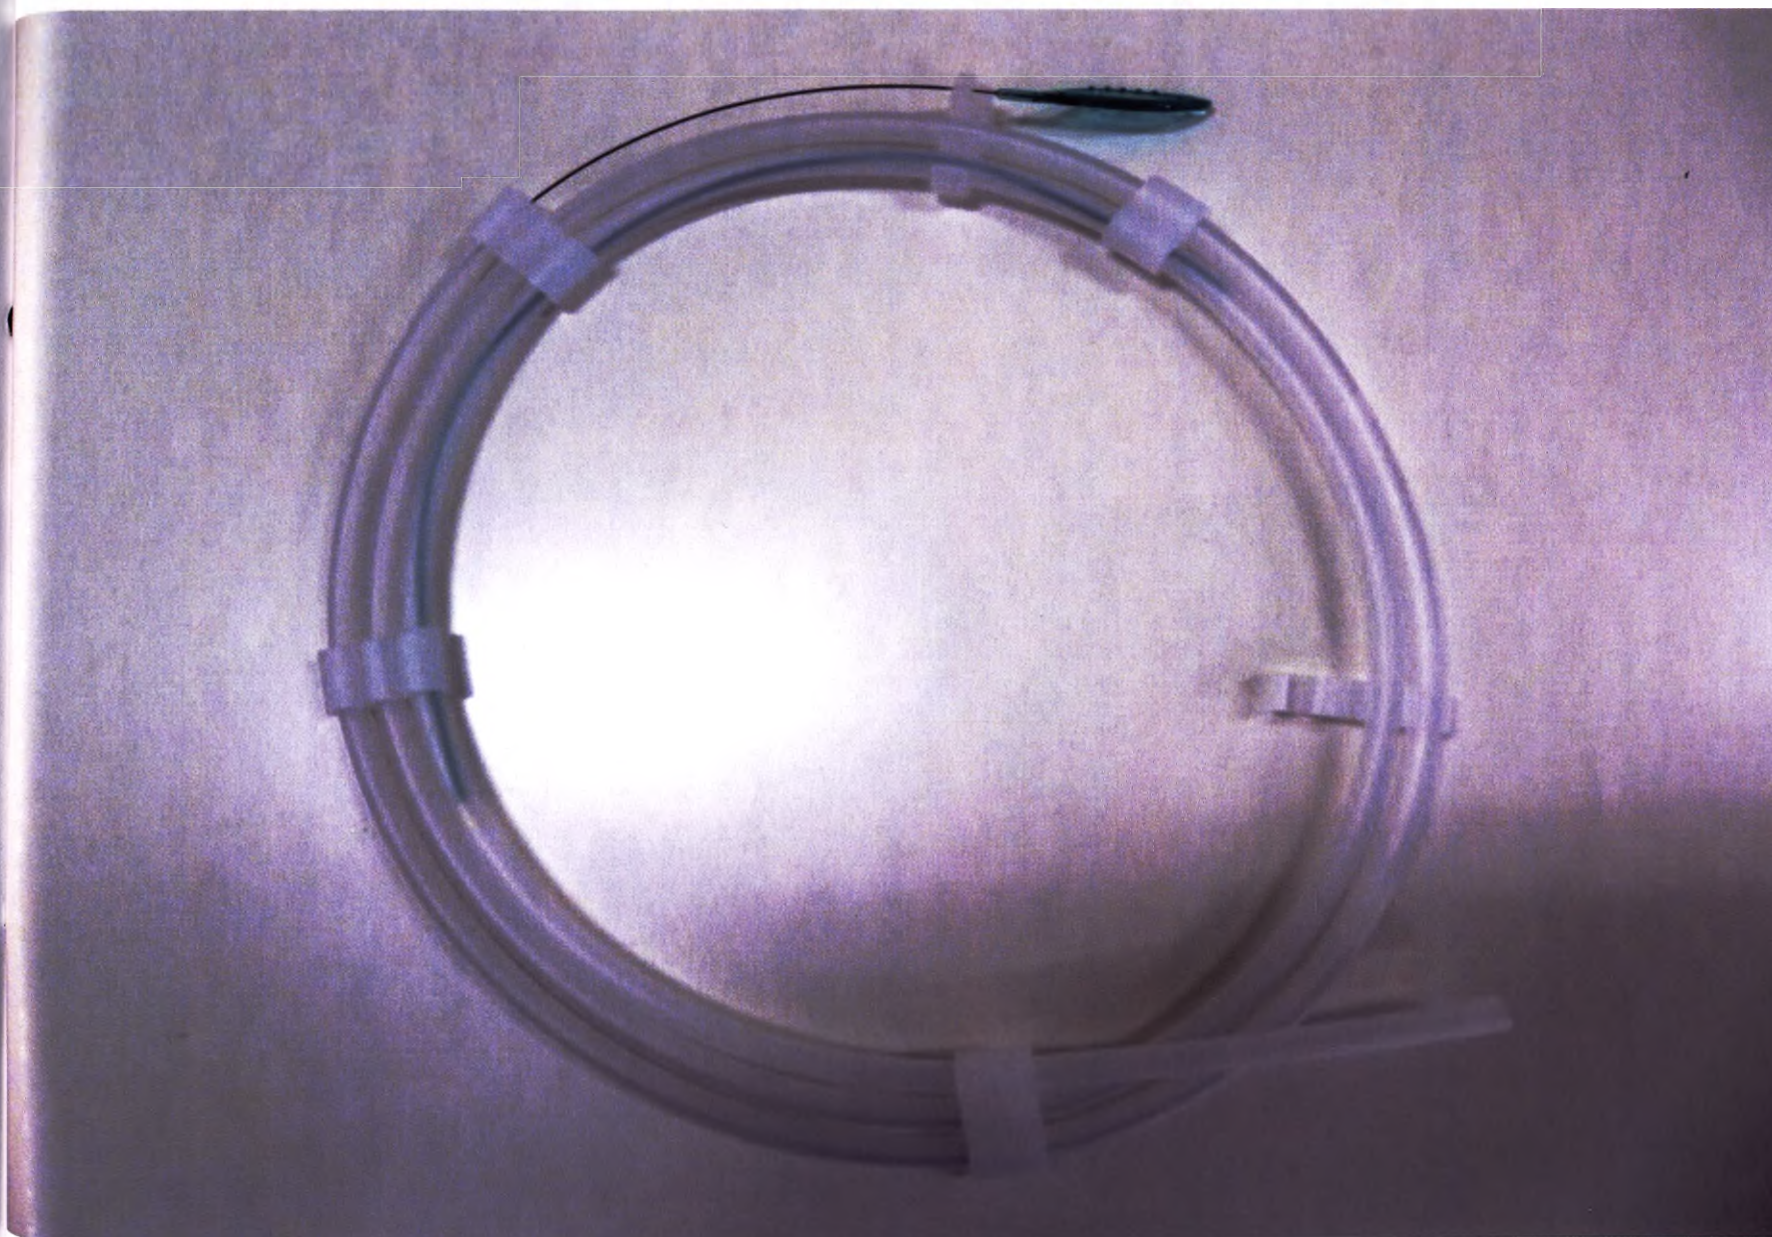






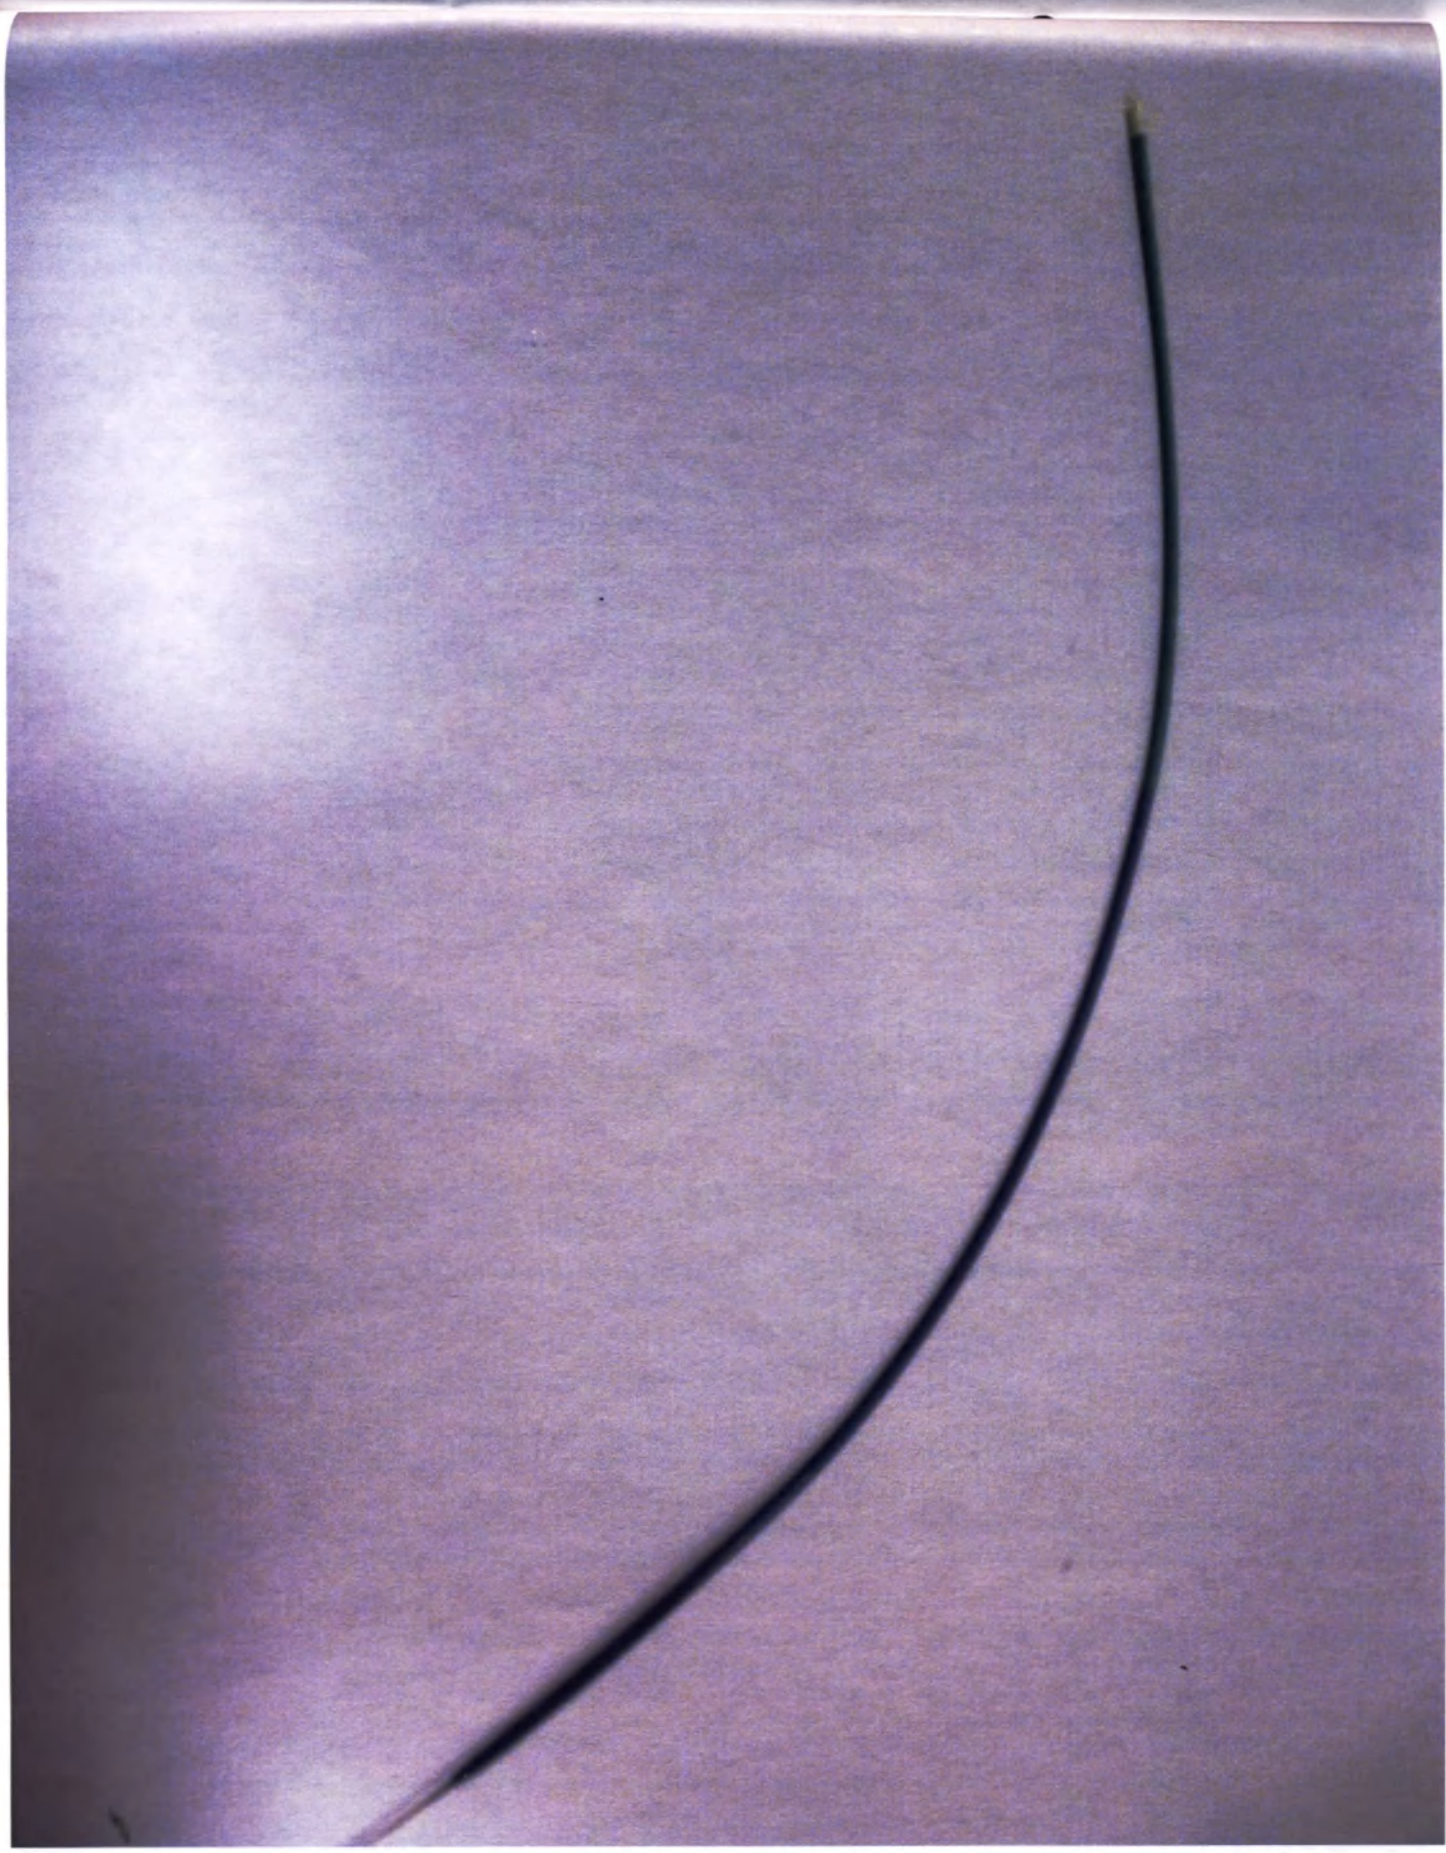


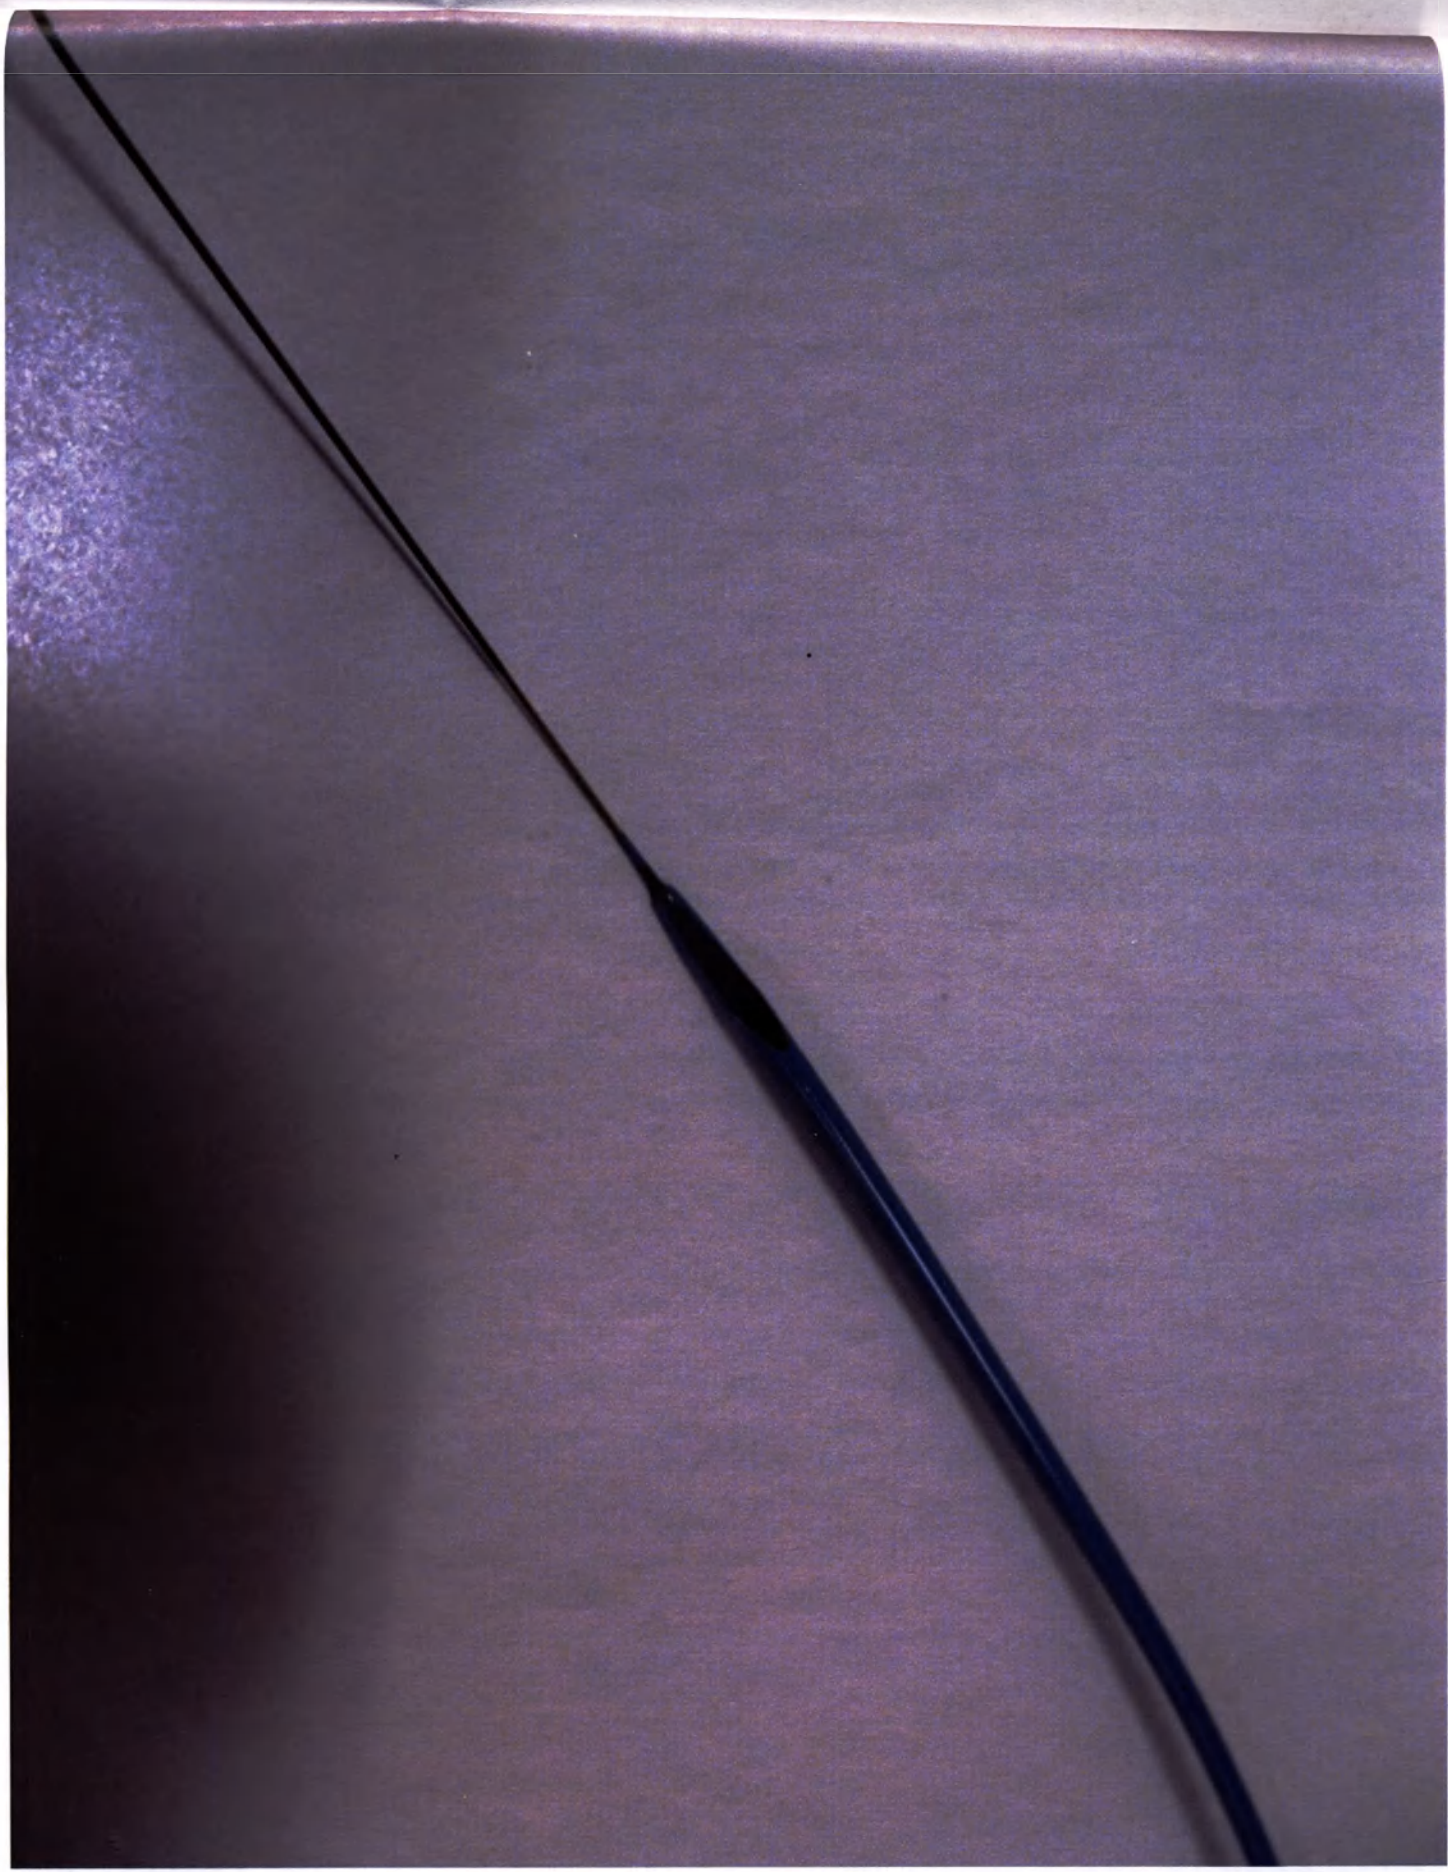

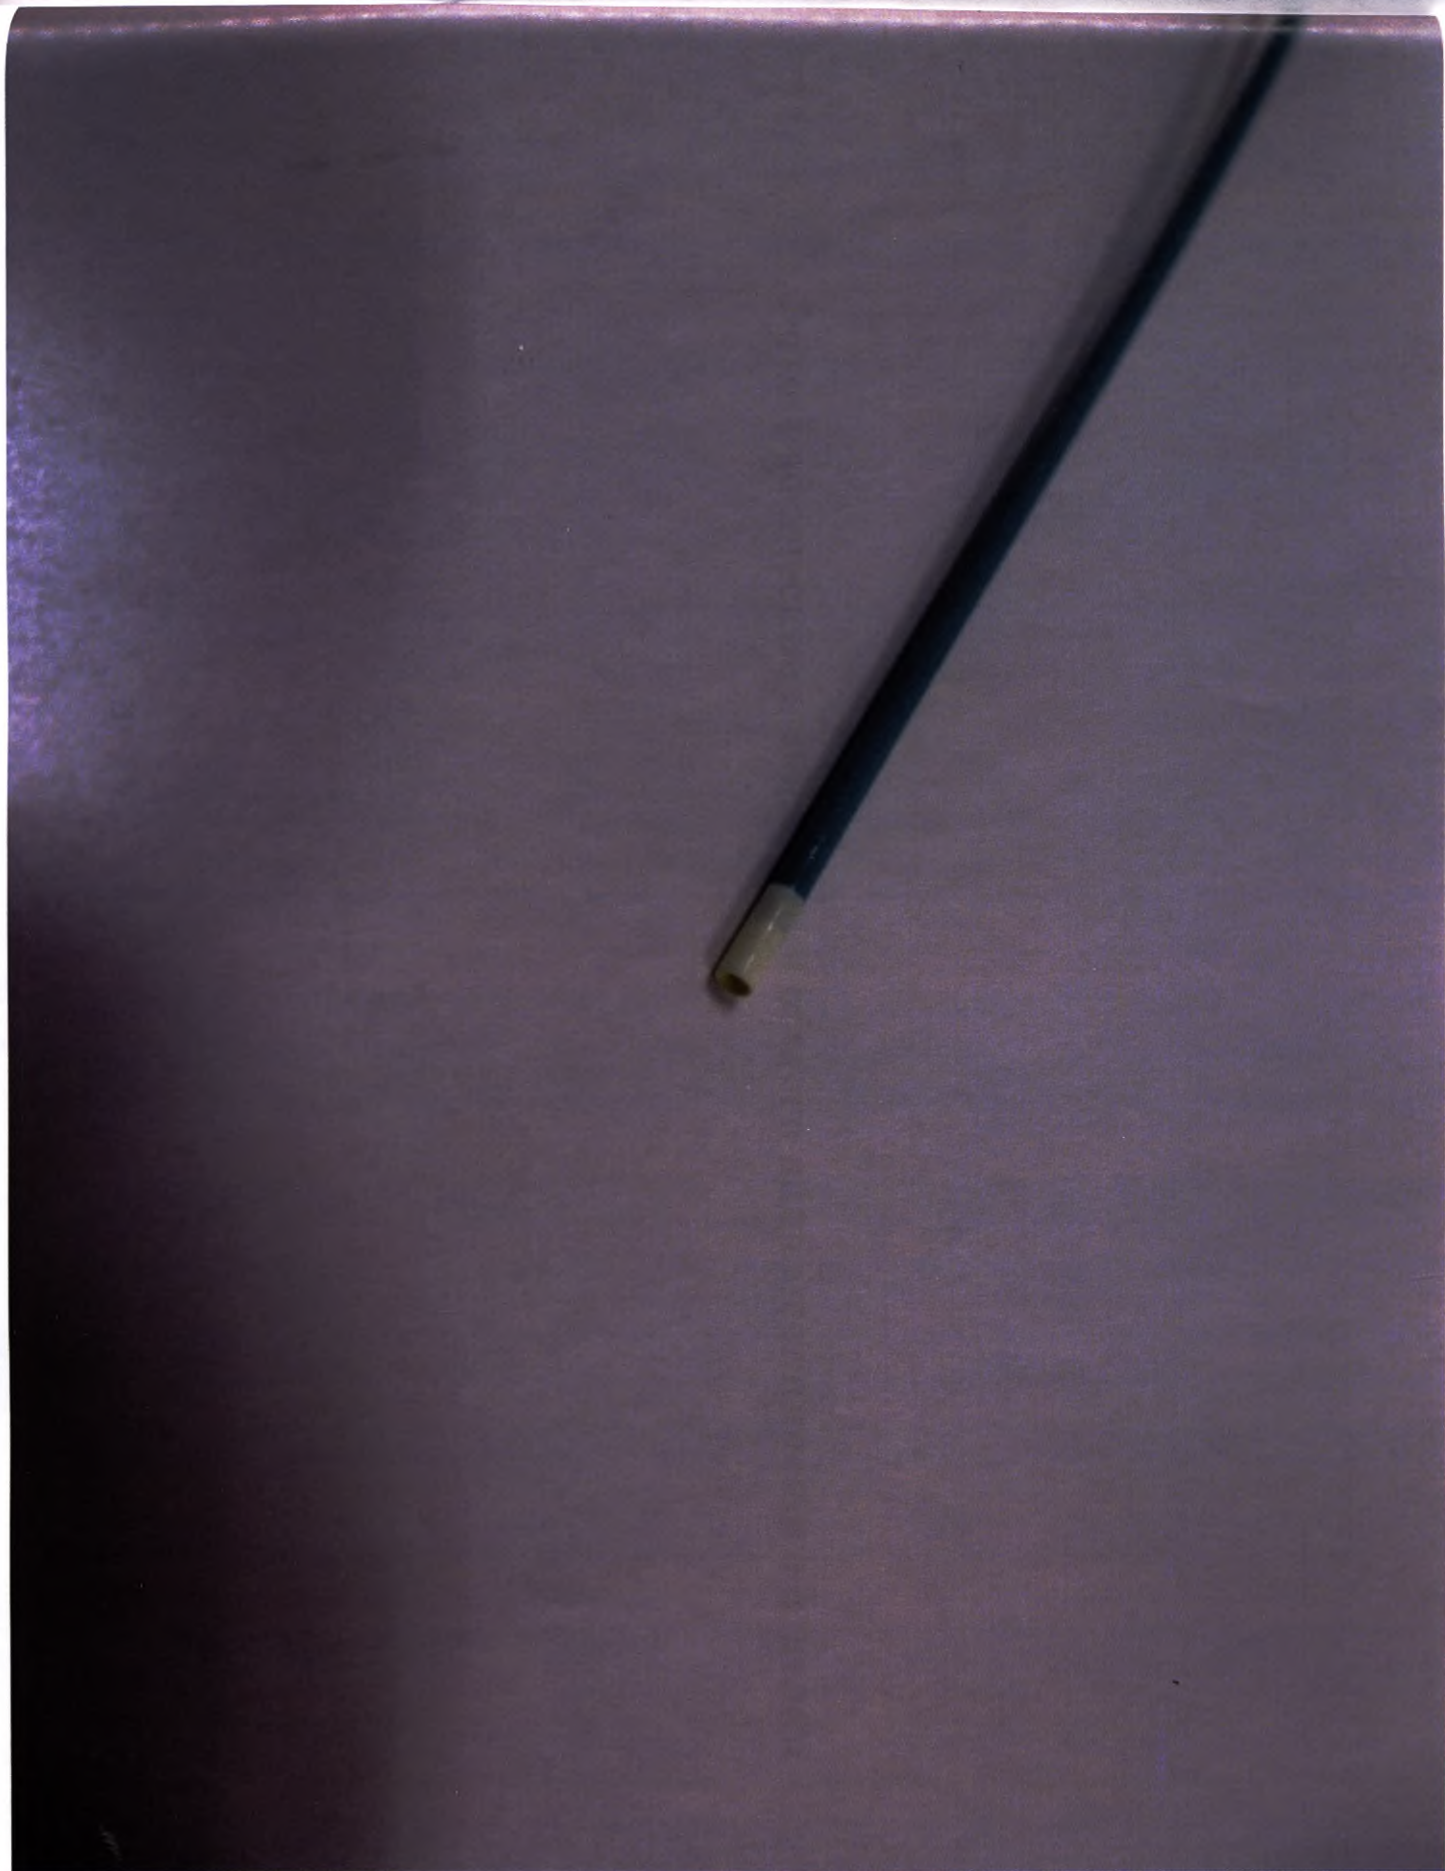


Фотографические изображения общего вида медицинского изделия

ротографическое изображение общего вида медицинского изделия «Катетер проводниковый удлиняющий Guideplus II, стерильный одноразовый в вариантах исполнения. Катетер проводниковый удлиняющий Guideplus II ST, стерильный одноразовый»

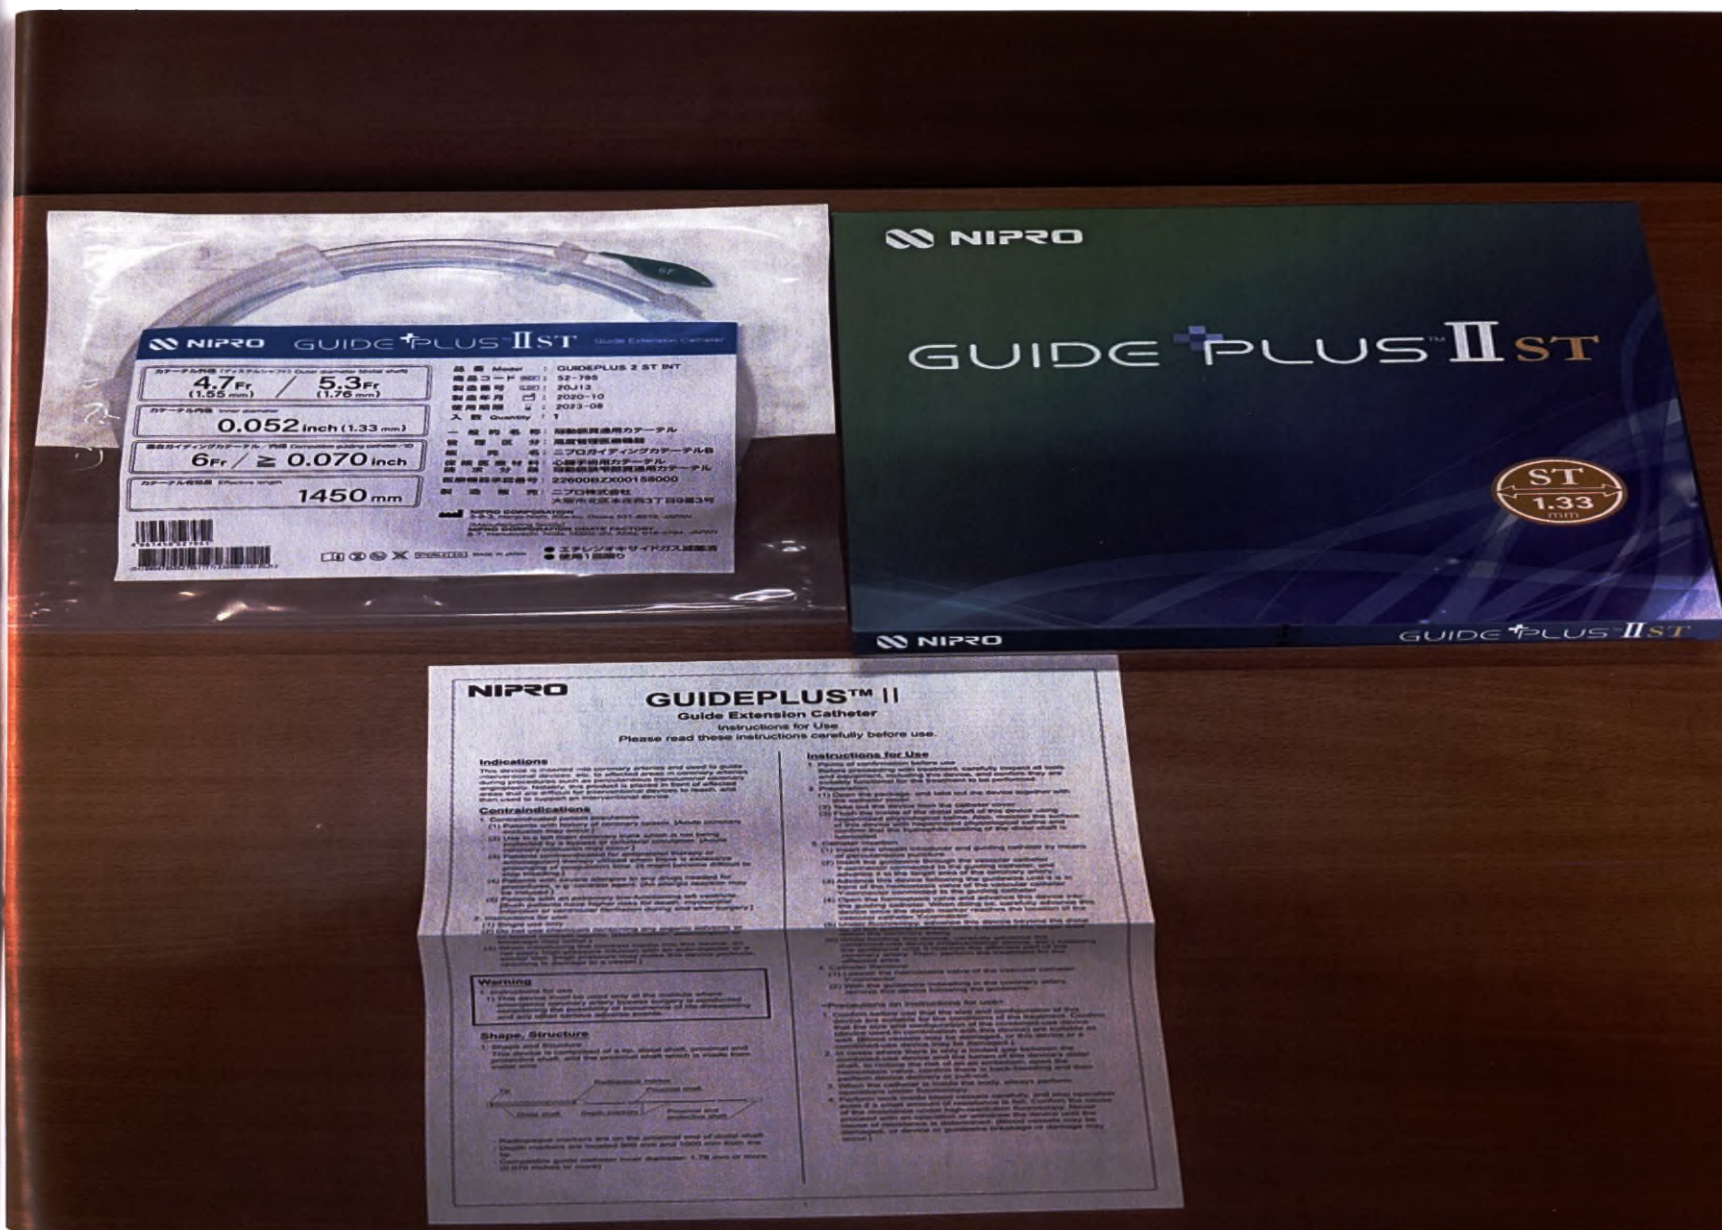

ротографическое изображение общего вида медицинского изделия «Катетер проводниковый удлиняющий Guideplus II, стерильный одноразовый в вариантах исполнения. Катетер проводниковый удлиняющий Guideplus II EL, стерильный одноразовый»

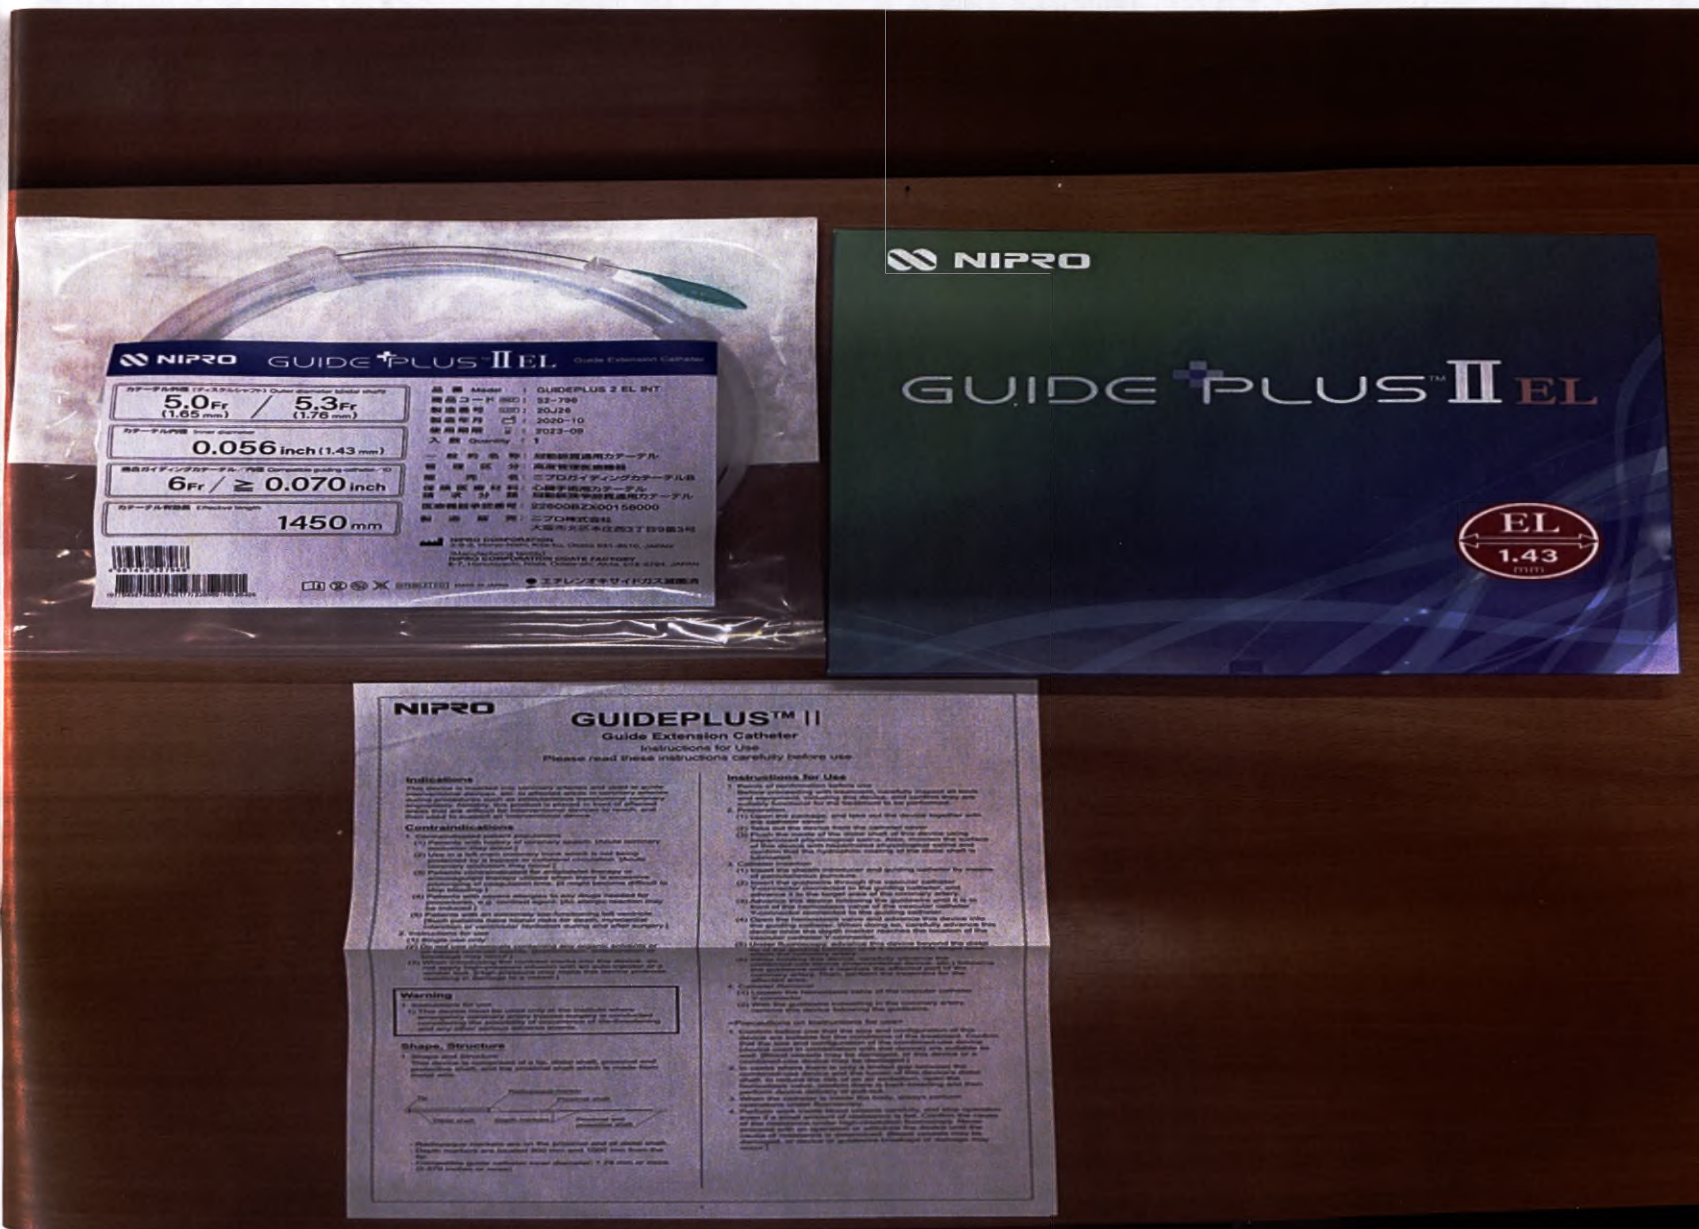

Всего прошнуровано и пронумеровано

29/двадцать девять лист об

Генеральный директор

Ветчинкин

Д.Н. Ветчинкин

