

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО «ЭТАЛОН ПРОДАКШН»

Фомина Н.В.

2021 г.

М.П.




ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

**Набор реагентов «ЭТА Норовирус GI и GII» для качественного обнаружения антигенов Норовируса 1-й и/или 2-й
геногруппы в кале человека методом иммунохроматографии
по ТУ 21.20.23-003-18023326-2020**




I. Набор реагентов «ЭТА Норовирус GI и GII» для качественного обнаружения антигенов Норовируса 1-й и 2-й геногруппы в кале человека методом иммунохроматографии по ТУ 21.20.23-003-18023326-2020

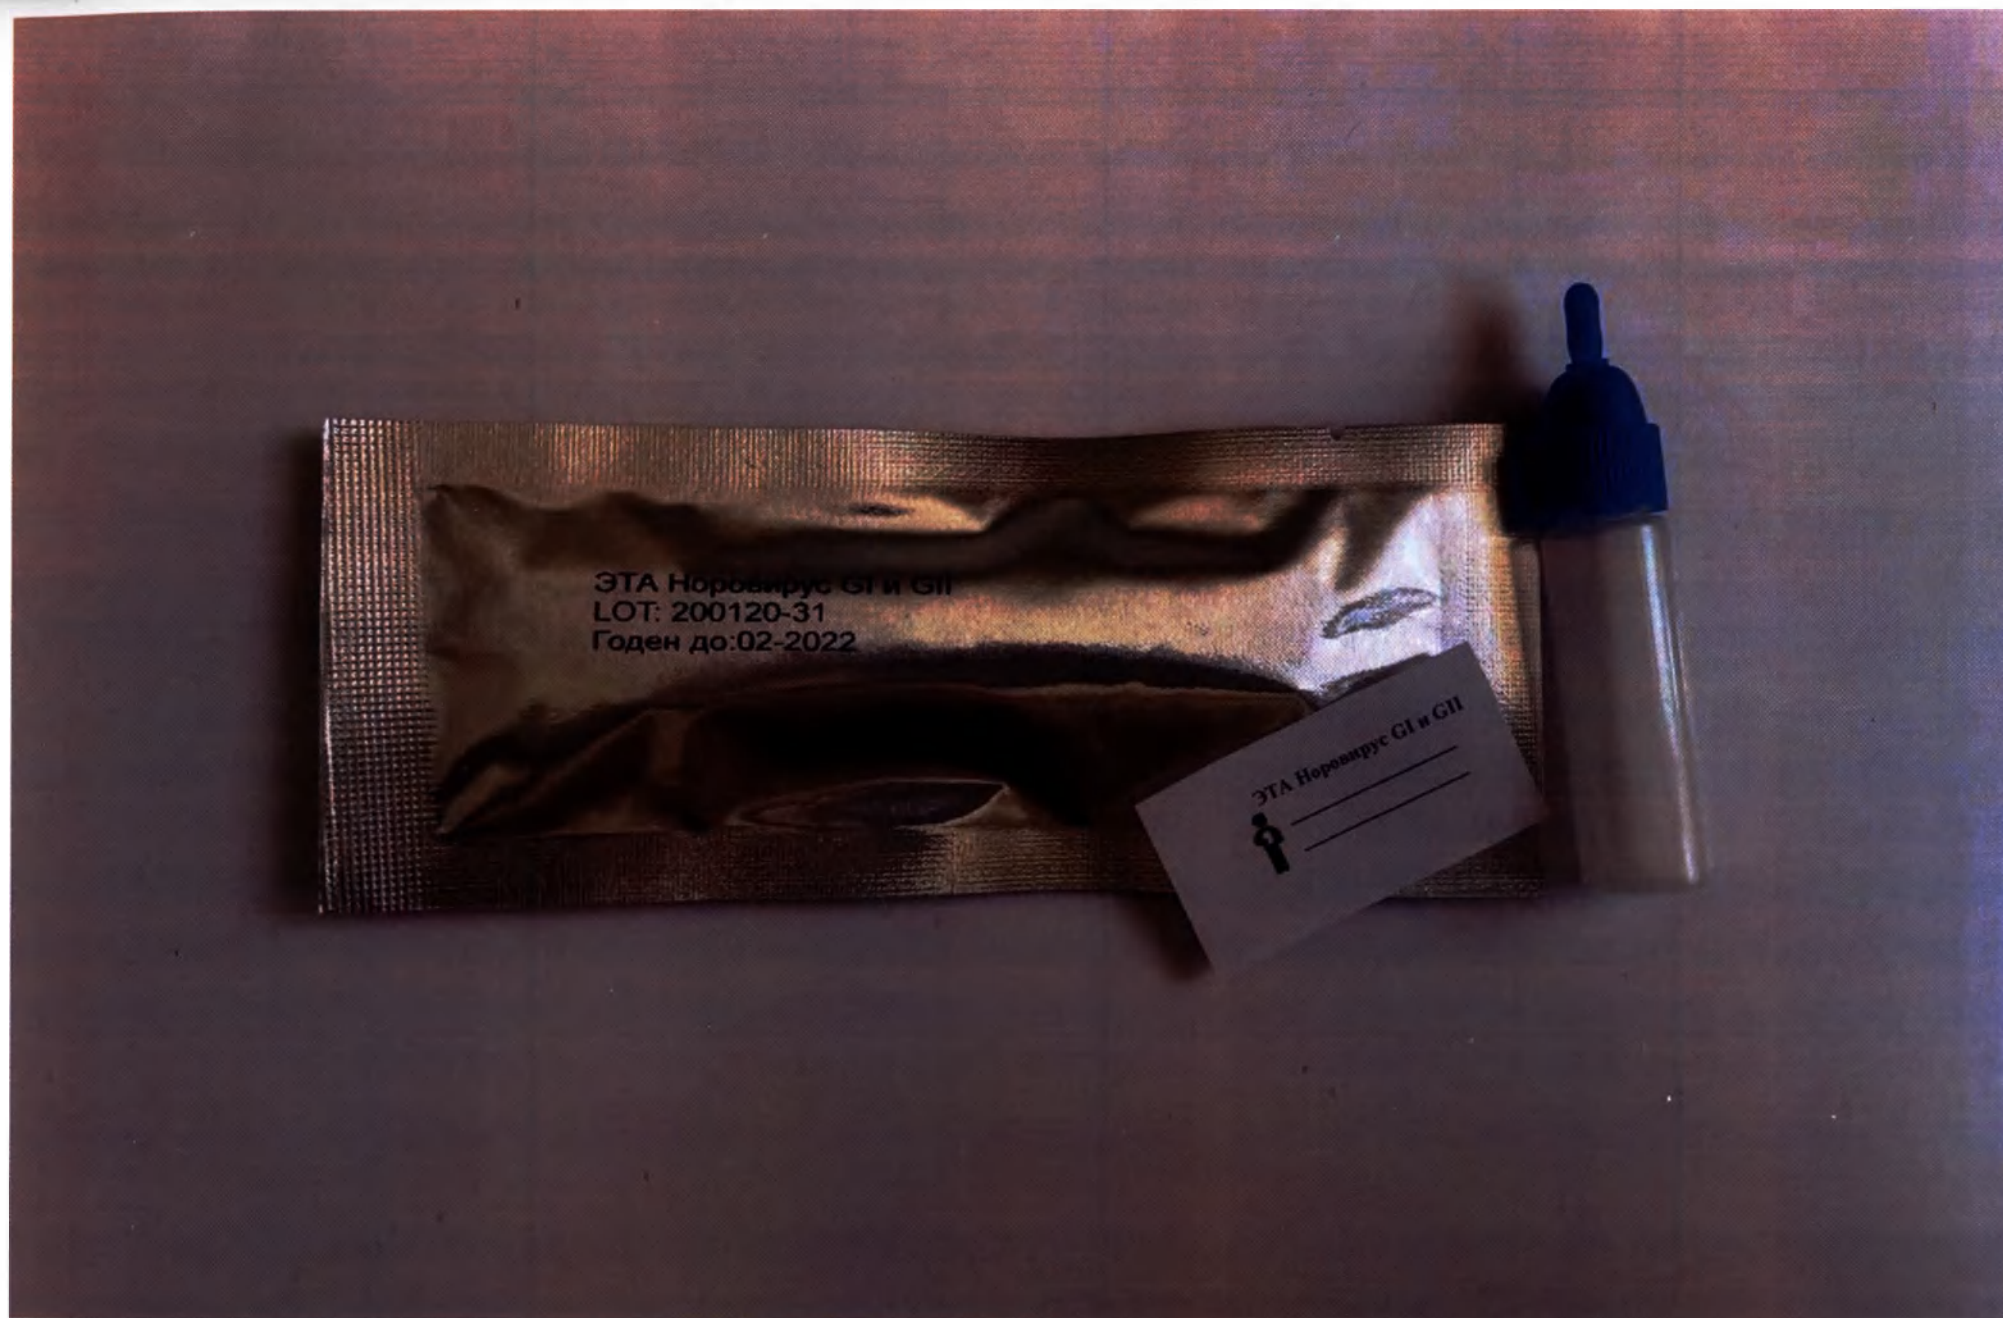

I. Без упаковки: Набор реагентов «ЭТА Норовирус GI и GII» для качественного обнаружения антигенов Норовируса 1-й и 2-й геногруппы в



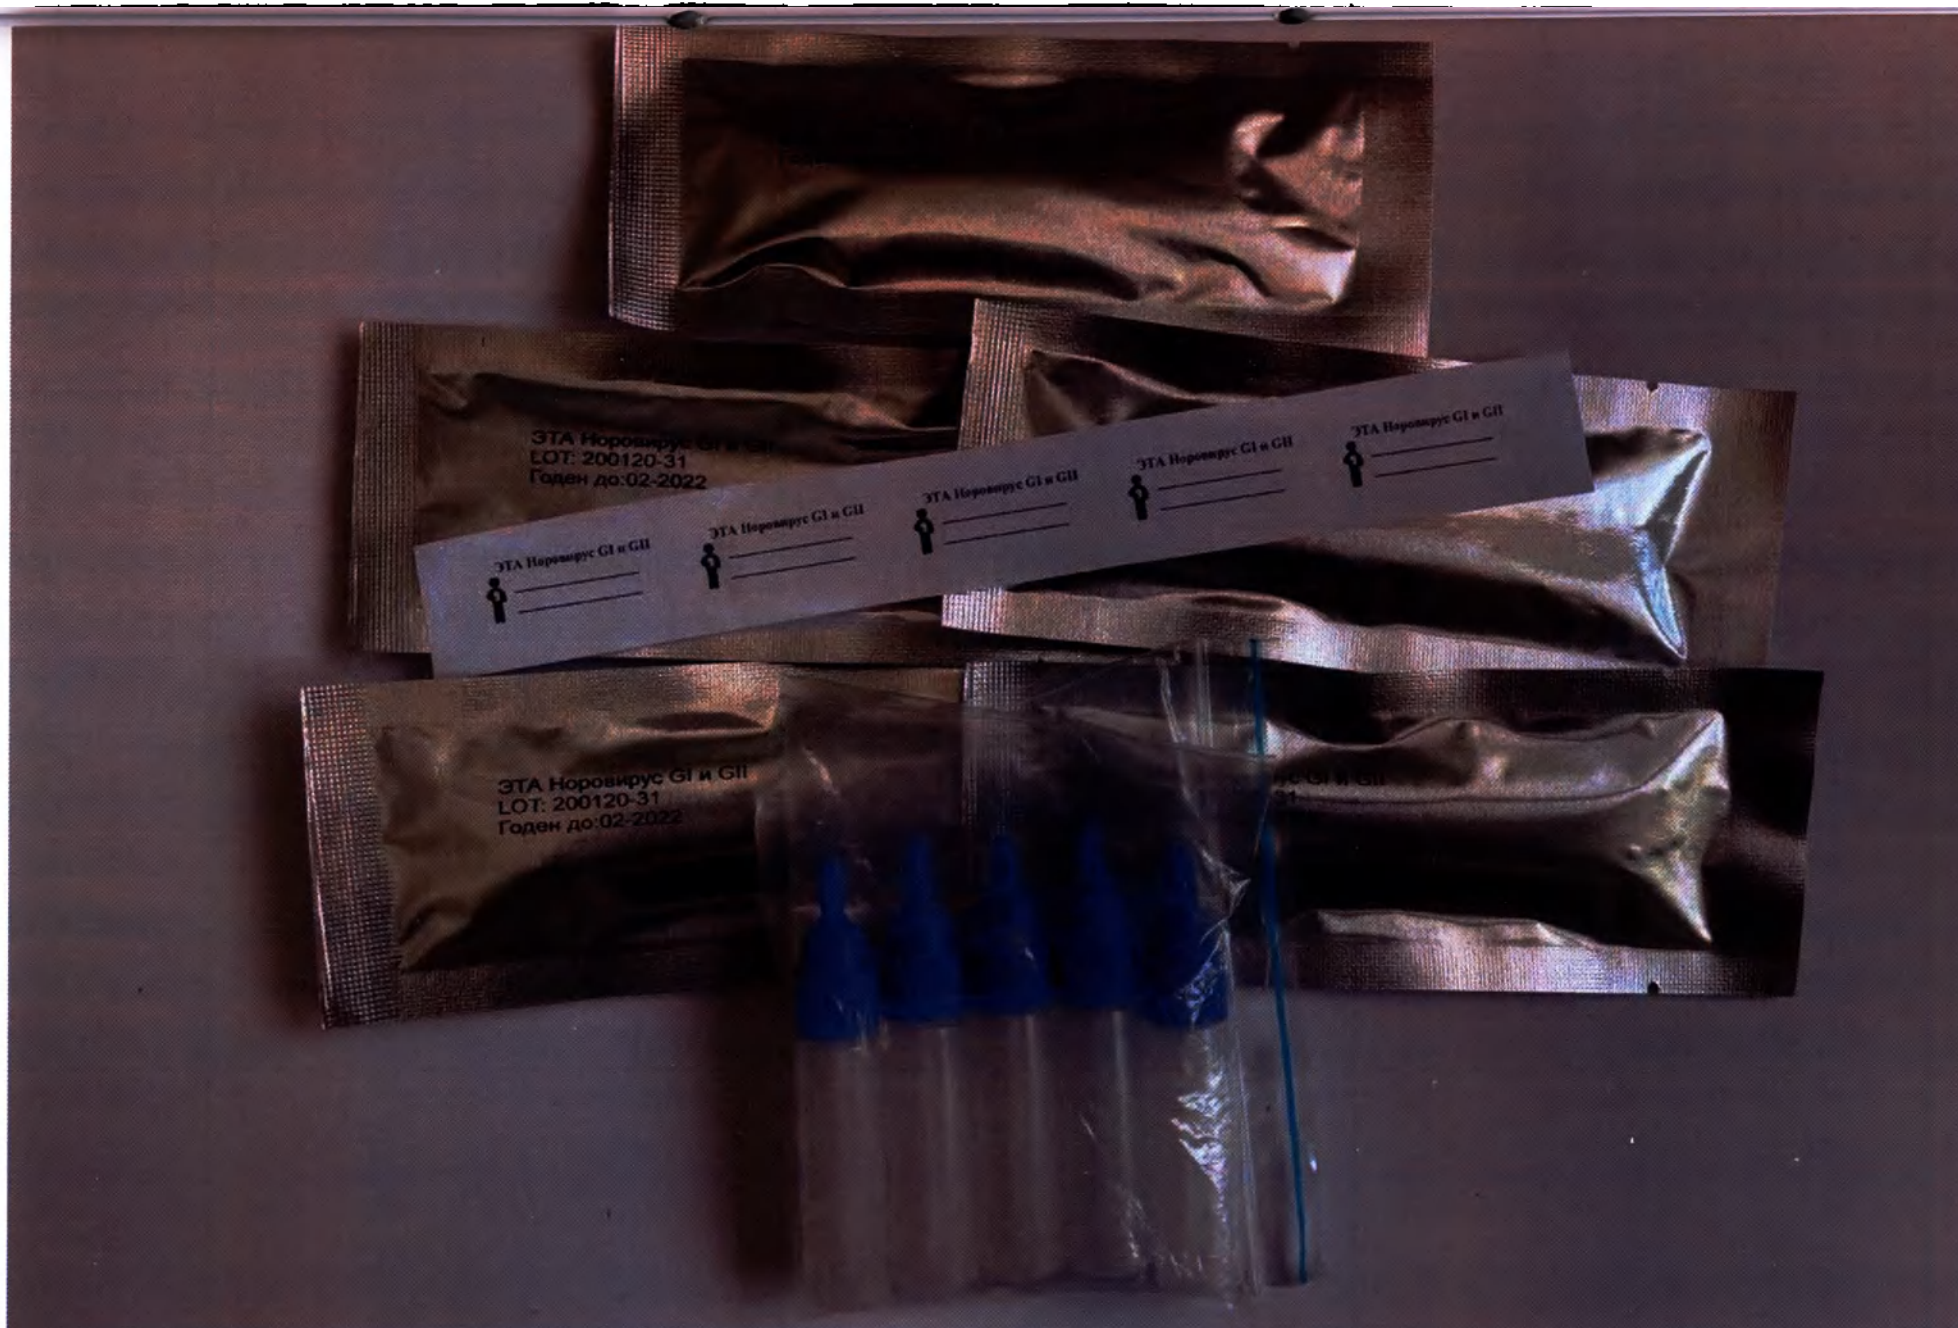


II. Без упаковки: Набор реагентов «ЭТА Норовирус GI и GII» для качественного обнаружения антигенов Норовируса 1-й и 2-й геногруппы в



III. Набор реагентов «ЭТА Норовирус GI и GII» для качественного обнаружения антигенов Норовируса 1-й и 2-й геногруппы в кале человека методом иммунохроматографии по ТУ 21.20.23-003-18023326-2020



III. Без упаковки: Набор реагентов «ЭТА Норовирус GI и GII» для качественного обнаружения антигенов Норовируса 1-й и 2-й геногруппы в кале человека методом иммунохроматографии по ТУ 21.20.23-003-18023326-2020

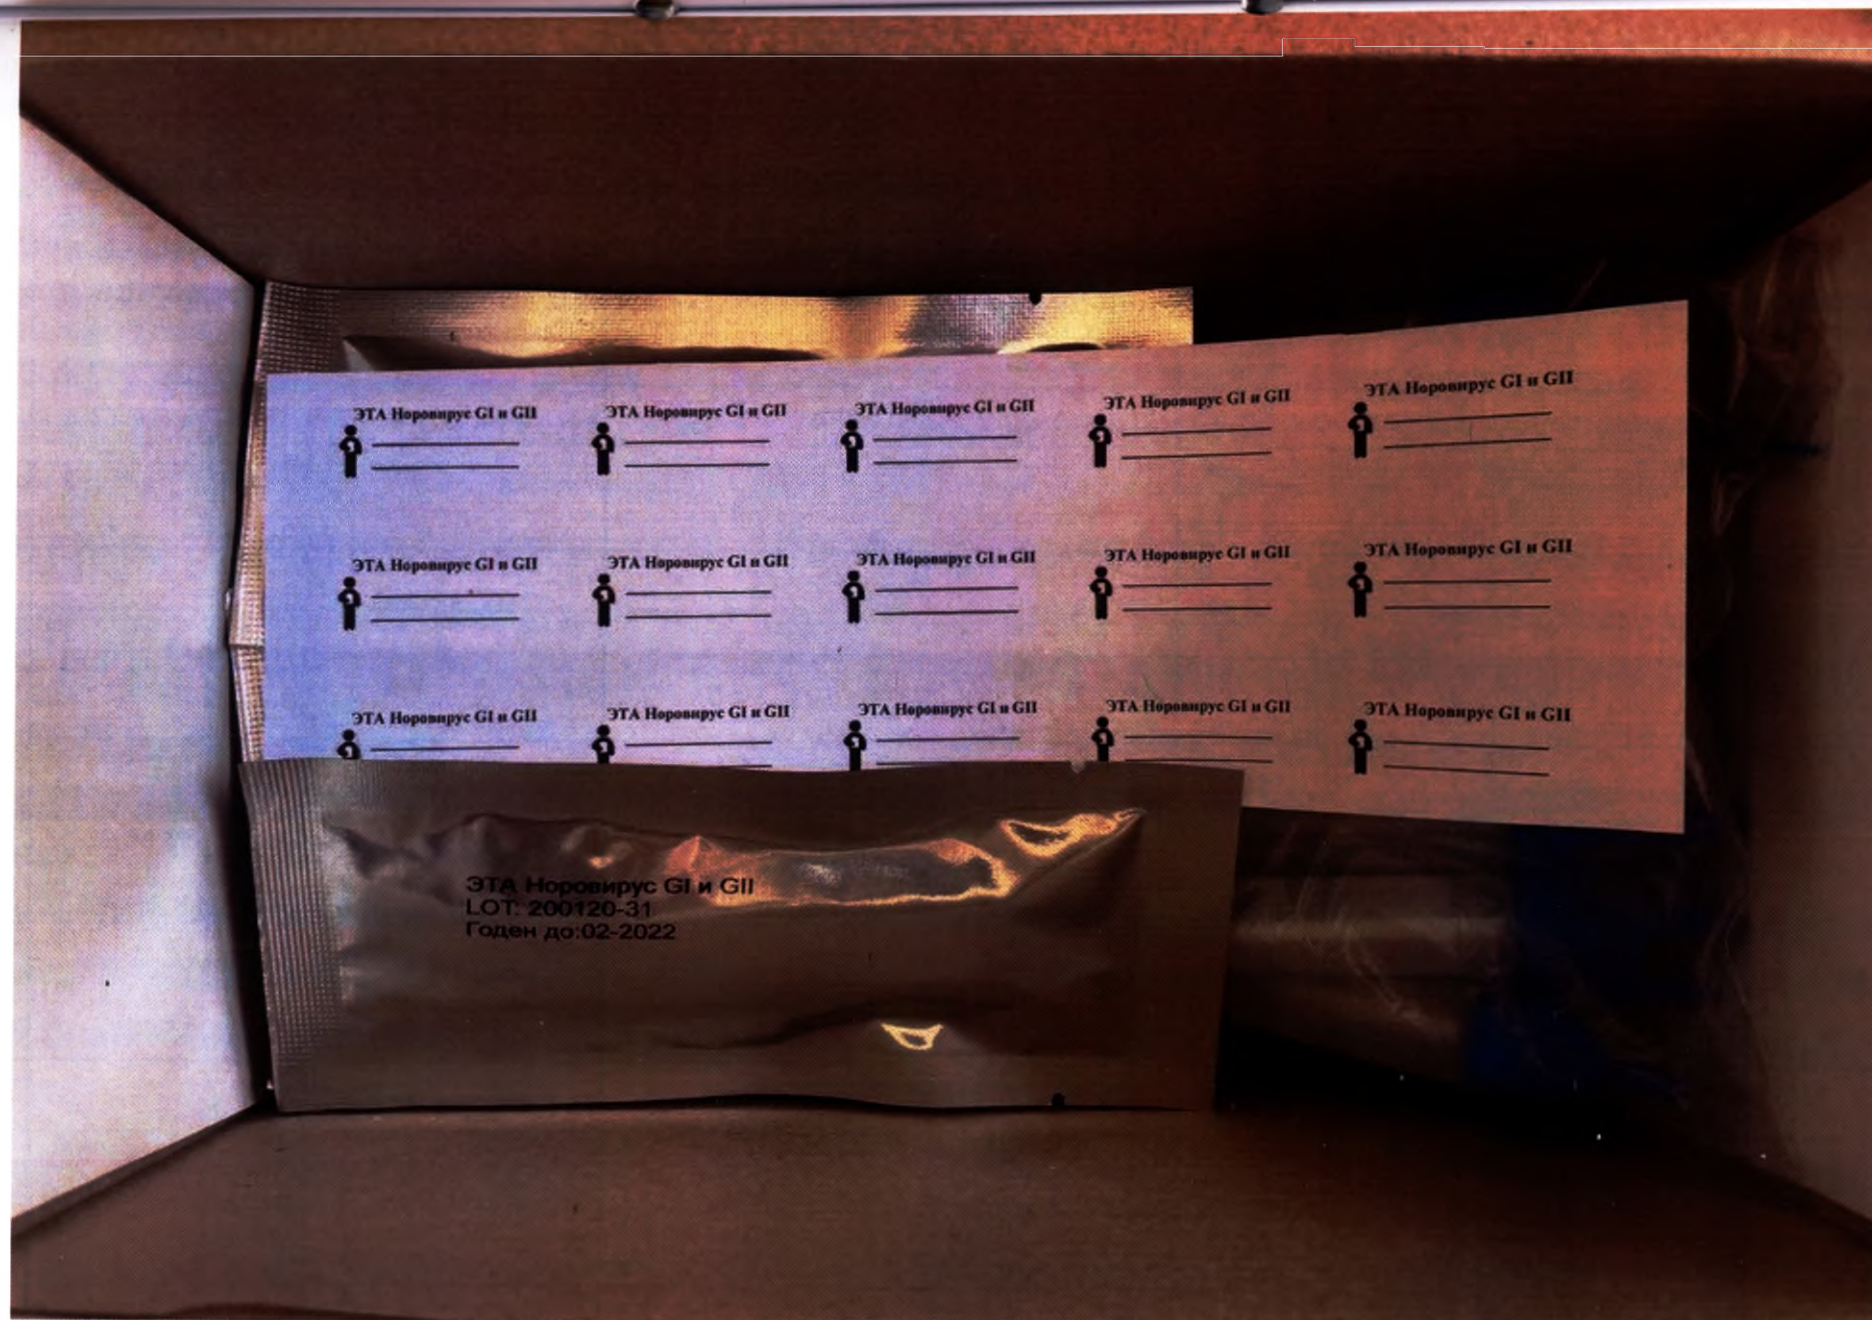


IV. Набор реагентов «ЭТА Норовирус GI и GII» для качественного обнаружения антигенов Норовируса 1-й и 2-й геногруппы в кале человека методом иммунохроматографии по ТУ 21.20.23-003-18023326-2020



IV. Без упаковки: Набор реагентов «ЭТА Норовирус GI и GII» для качественного обнаружения антигенов Норовируса 1-й и 2-й геногруппы в кале человека методом иммунохроматографии по ТУ 21.20.23-003-18023326-2020



V. Набор реагентов «ЭТА Норовирус GI и GII» для качественного обнаружения антигенов Норовируса 1-й и 2-й геногруппы в кале человека методом иммунохроматографии по ТУ 21.20.23-003-18023326-2020

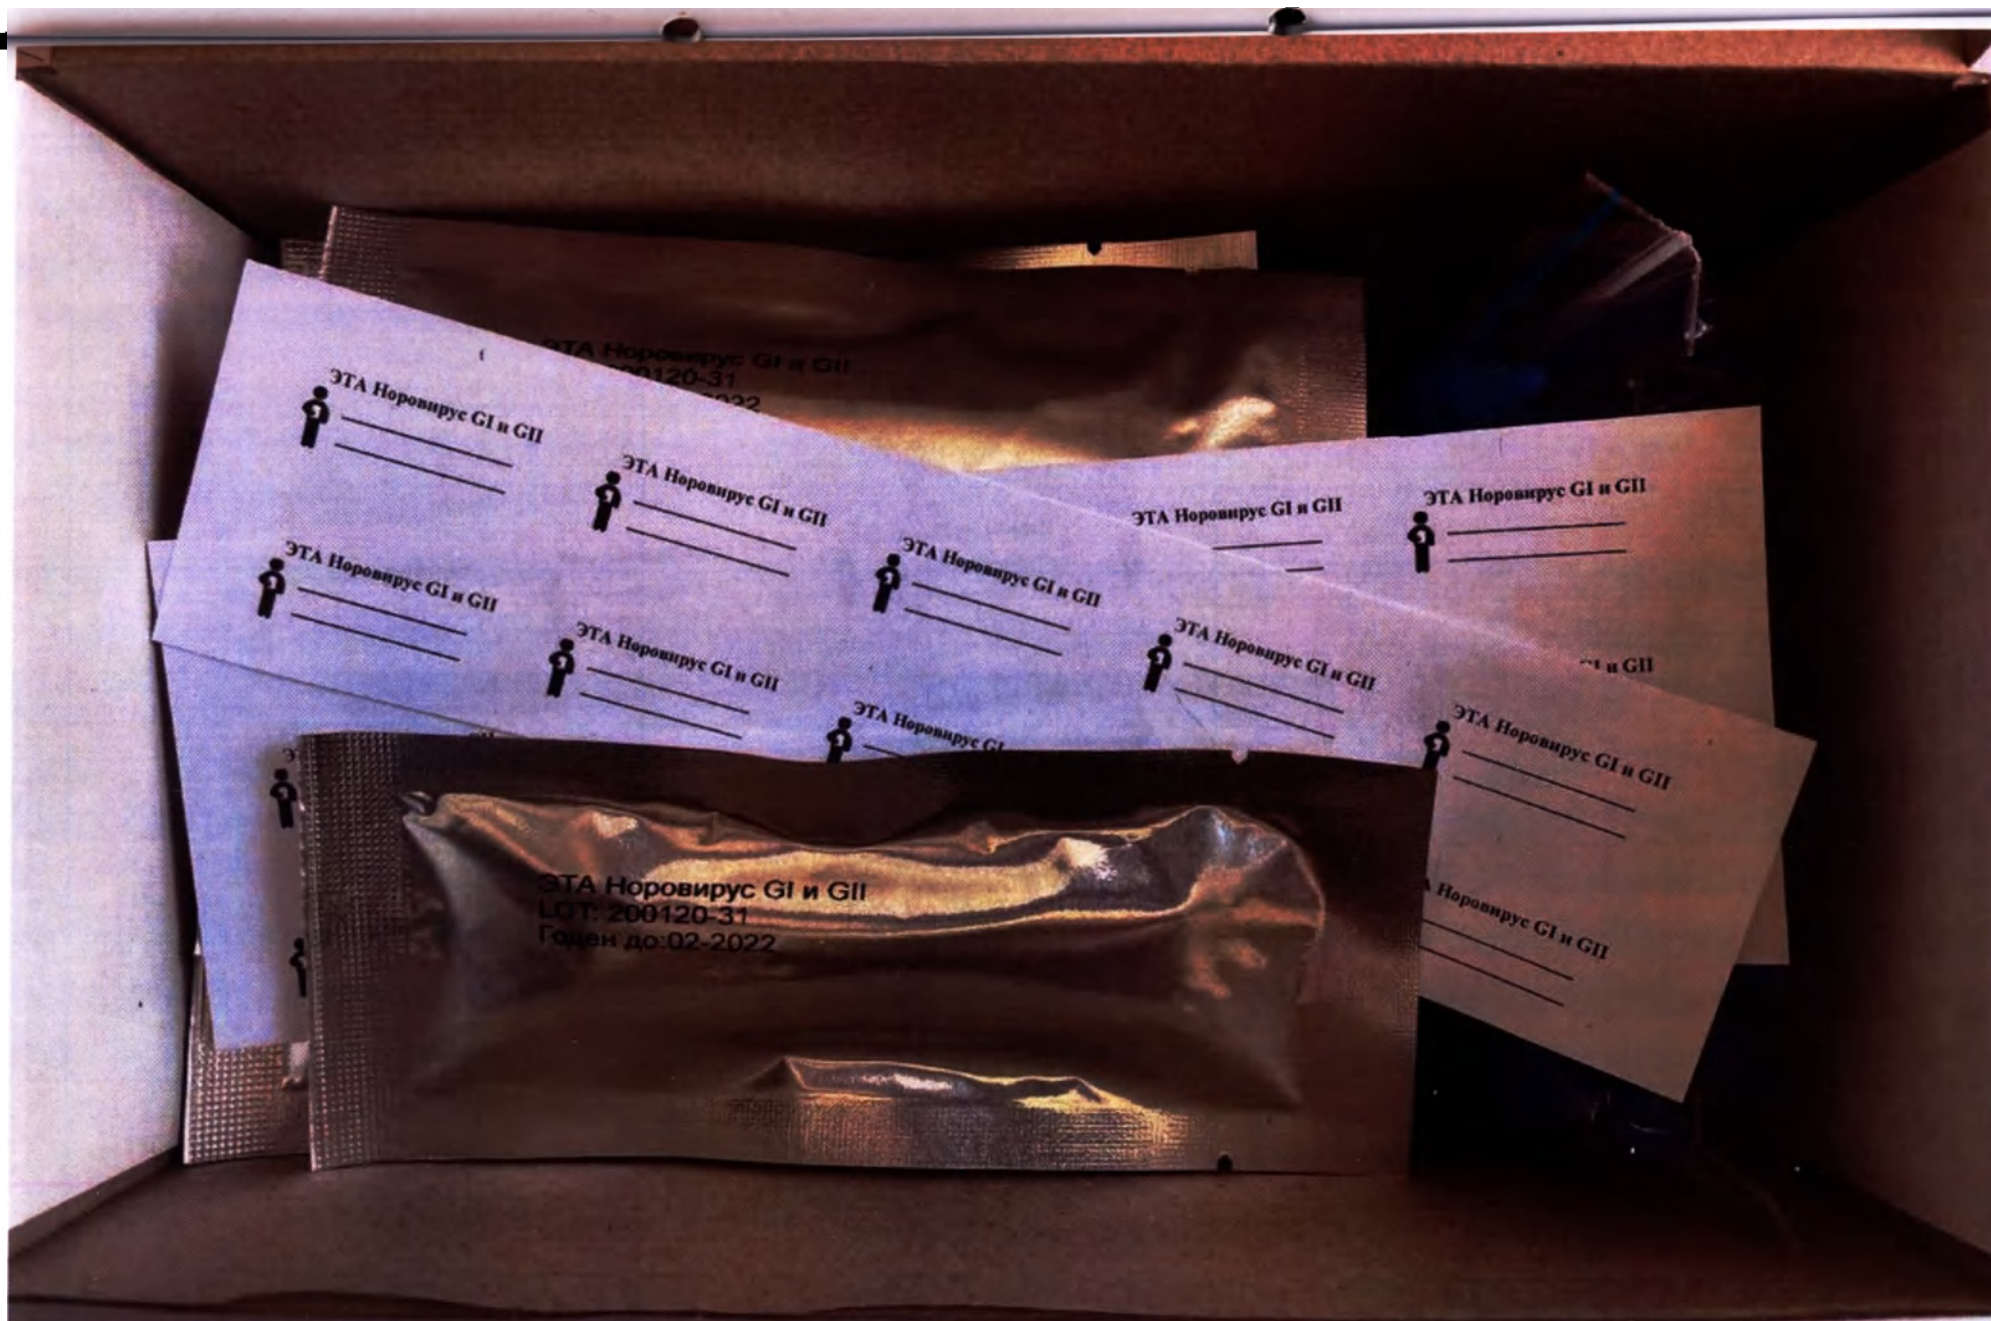


VI. Набор реагентов «ЭТА Норовирус GI и GII» для качественного обнаружения антигенов Норовируса 1-й и 2-й геногруппы в кале человека методом иммунохроматографии по ТУ 21.20.23-003-18023326-2020



VI. Без упаковки: Набор реагентов «ЭТА Норовирус GI и GII» для качественного обнаружения антигенов Норовируса 1-й и 2-й геногруппы в кале человека методом иммунохроматографии по ТУ 21.20.23-003-18023326-2020



I. Набор реагентов «ЭТА Норовирус GI и/или GII» для качественного обнаружения антигенов Норовируса 1-й и/или 2-й геногруппы в кале человека методом иммунохроматографии по ТУ 21.20.23-003-18023326-2020

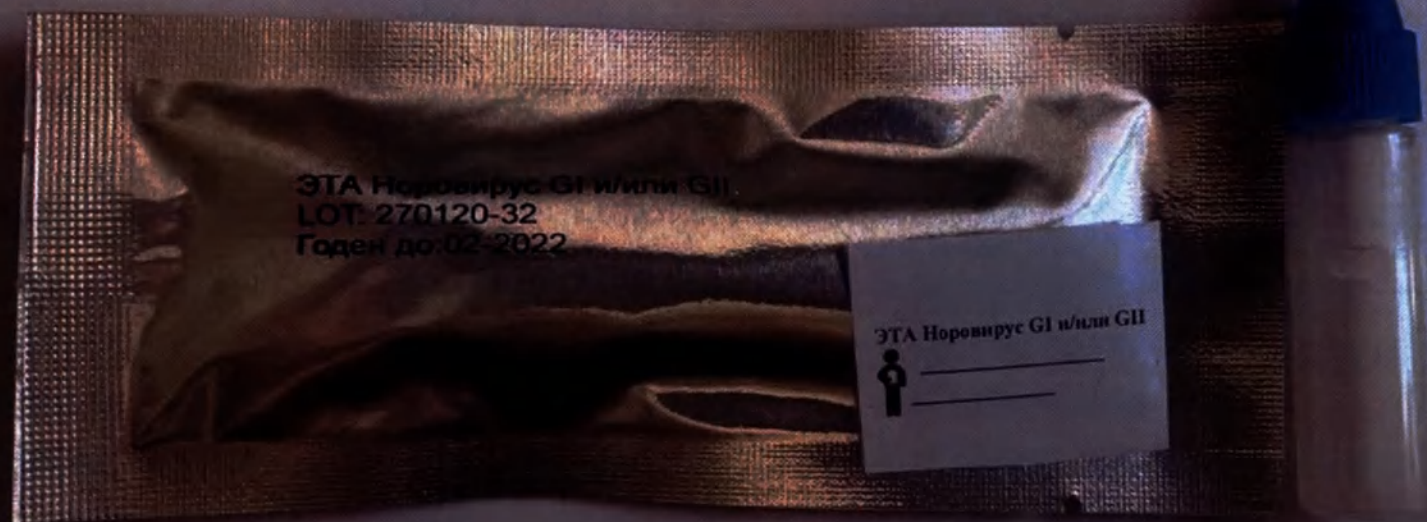


15

I. Без упаковки: Набор реагентов «ЭТА Норовирус GI и/или GII» для качественного обнаружения антигенов Норовируса 1-й и/или 2-й

геногруппы в кале человека методом иммунохроматографии по ТУ 21.20.23-003-18023326-2020



II. Набор реагентов «ЭТА Норовирус GI и/или GII» для качественного обнаружения антигенов Норовируса 1-й и/или 2-й геногруппы в кале человека методом иммунохроматографии по ТУ 21.20.23-003-18023326-2020

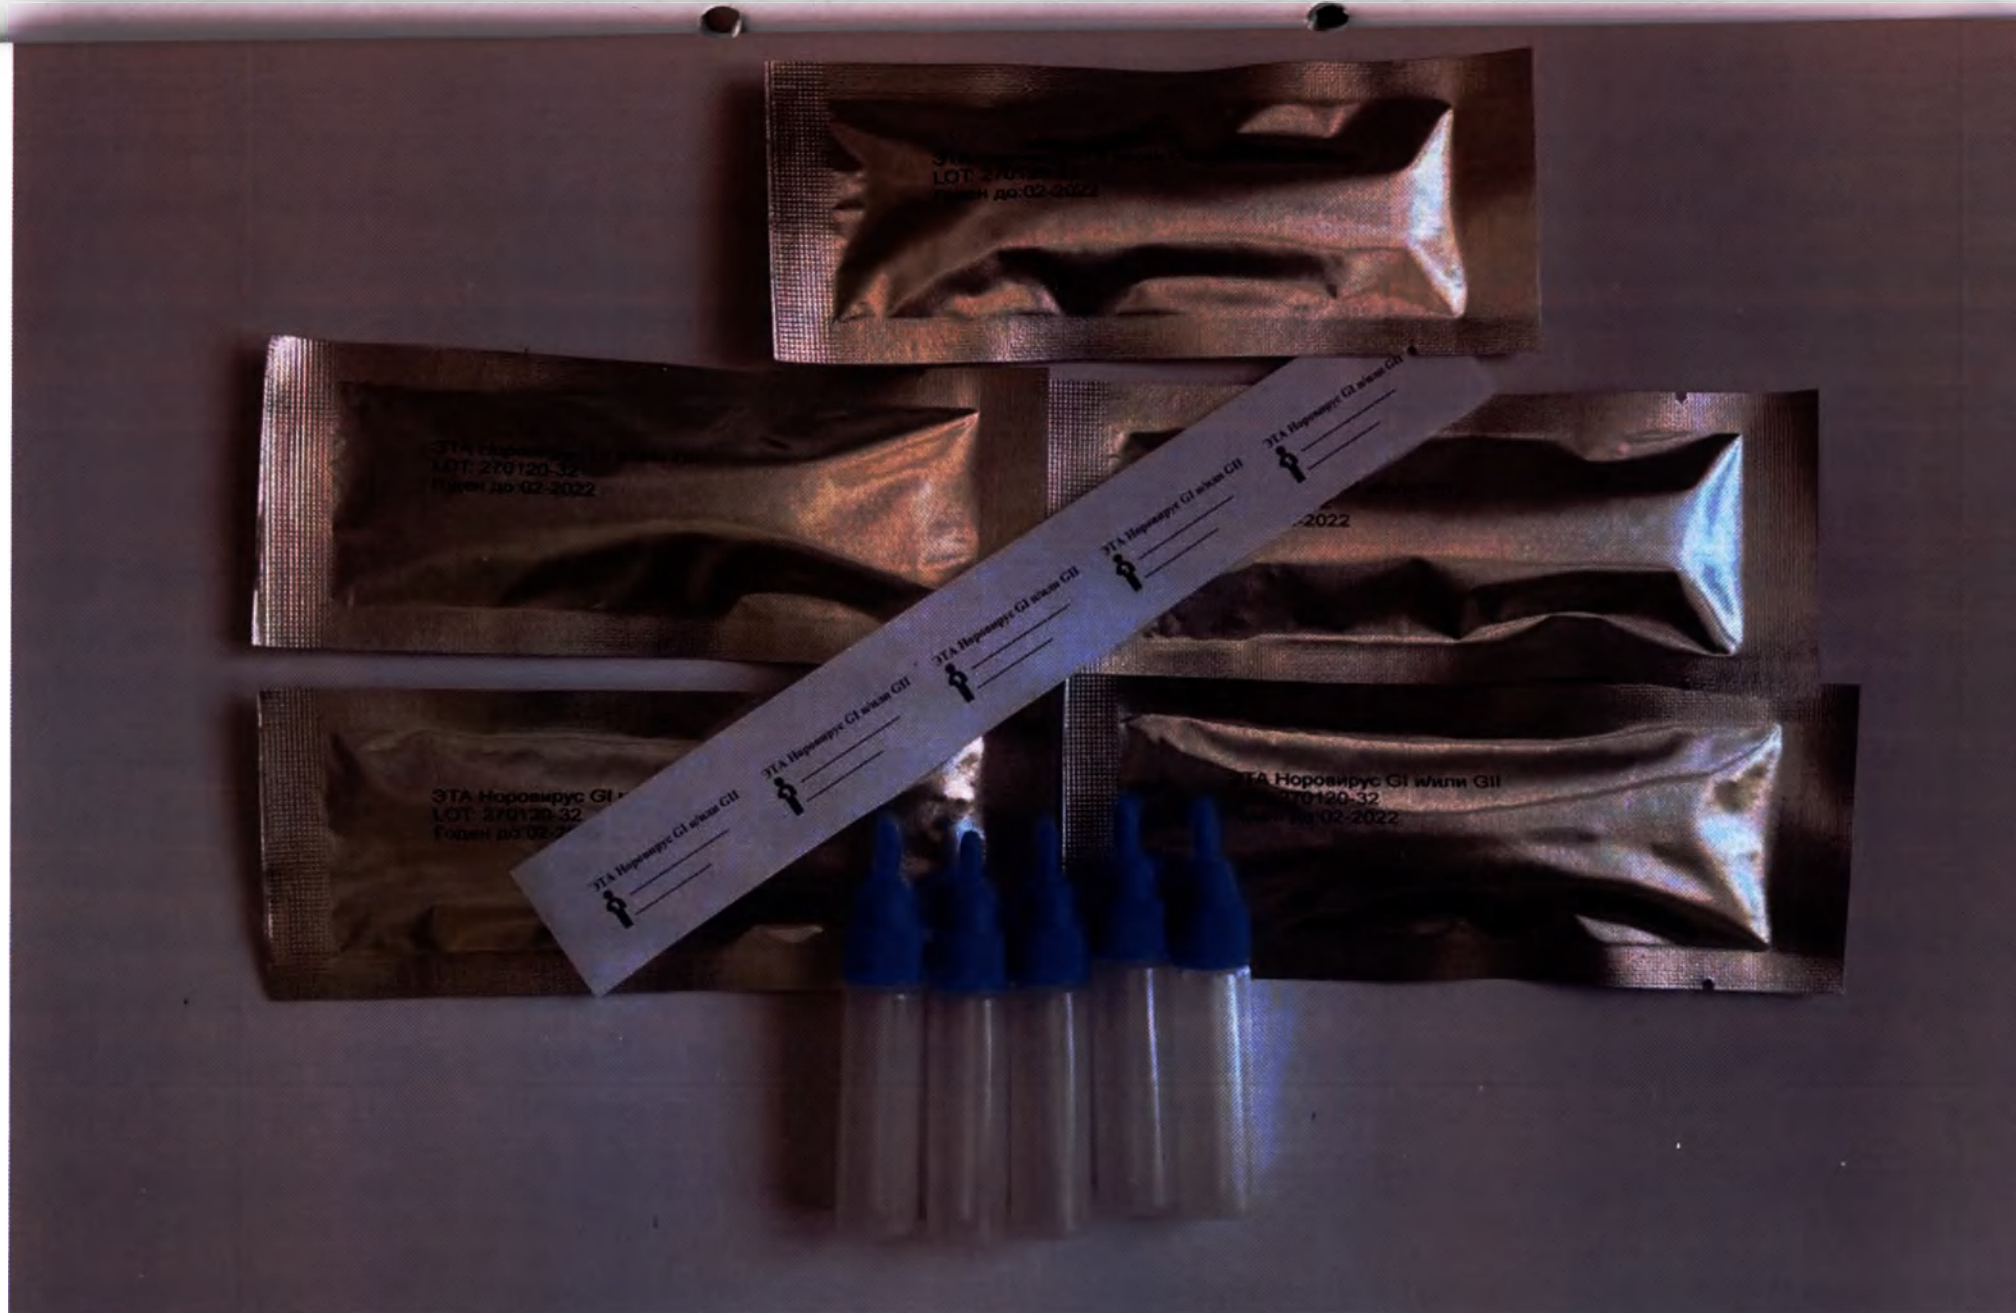

II. Без упаковки: Набор реагентов «ЭТА Норовирус GI и/или GII» для качественного обнаружения антигенов Норовируса 1-й и/или 2-й геногруппы в кале человека методом иммунохроматографии по ТУ 21.20.23-003-18023326-2020



III. Набор реагентов «ЭТА Норовирус GI и/или GII» для качественного обнаружения антигенов Норовируса 1-й и/или 2-й геногруппы в кале человека методом иммунохроматографии по ТУ 21.20.23-003-18023326-2020



III. Без упаковки: Набор реагентов «ЭТА Норовирус GI и/или GII» для качественного обнаружения антигенов Норовируса 1-й и/или 2-й геногруппы в кале человека методом иммунохроматографии по ТУ 21.20.23-003-18023326-2020



IV. Набор реагентов «ЭТА Норовирус GI и/или GII» для качественного обнаружения антигенов Норовируса 1-й и/или 2-й генотипа в кале




IV. Без упаковки: Набор реагентов «ЭТА Норовирус GI и/или GII» для качественного обнаружения антигенов Норовируса 1-й и/или 2-й геногруппы в кале человека методом иммунохроматографии по ТУ 21.20.23-003-18023326-2020



V. Набор реагентов «ЭТА Норовирус GI и/или GII» для качественного обнаружения антигенов Норовируса 1-й и/или 2-й групп в кале



V. Без упаковки: Набор реагентов «ЭТА Норовирус GI и/или GII» для качественного обнаружения антигенов Норовируса 1-й и/или 2-й

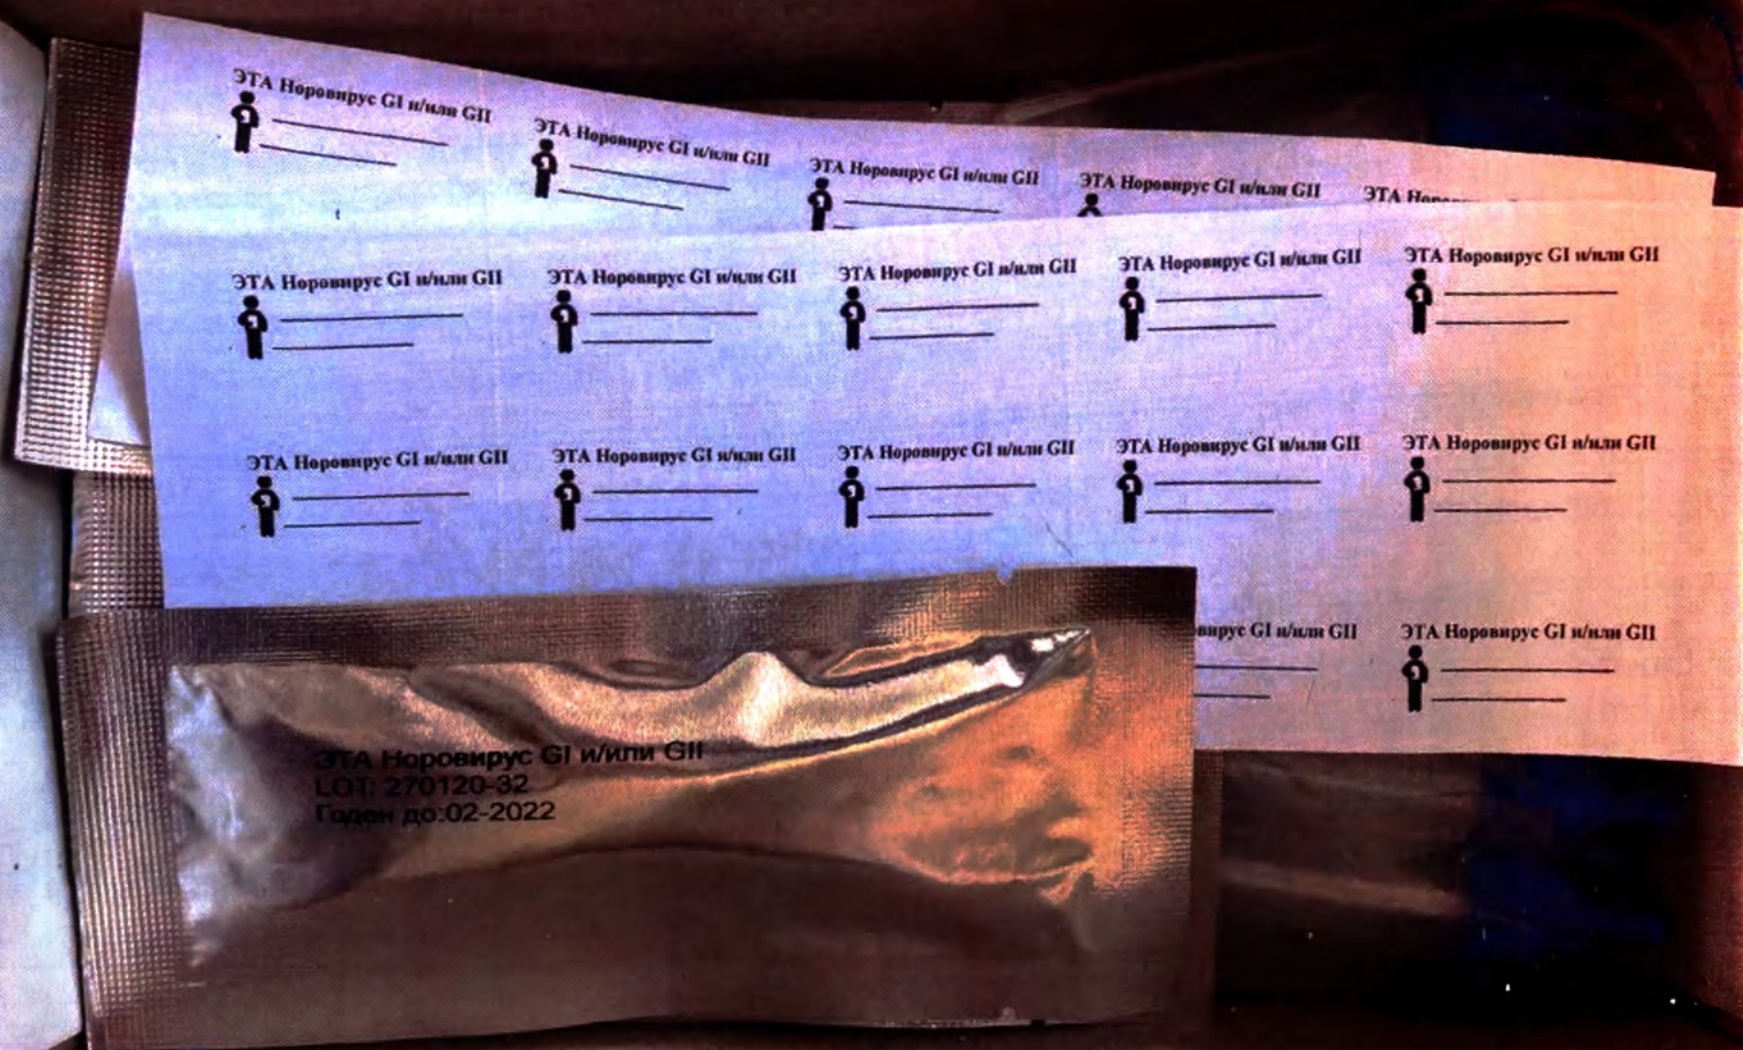

VI. Набор реагентов «ЭТА Норовирус G1 и/или GII» для качественного обнаружения антигенов Норовируса 1-й и/или 2-й генотипы в кале человека методом иммунохроматографии по ТУ 21.20.23-003-18023326-2020



VI. Без упаковки: Набор реагентов «ЭТА Норовирус GI и/или GII» для качественного обнаружения антигенов Норовируса 1-й и/или 2-й

Набор реагентов предназначен для проведения диагностики *in vitro* качественного определения антигенов норовируса 1-й и/или 2-й генотипы в кале человека.

Комплект поставки

1. Экспресс-тест «ЭТА Норовирус GI и GII» для качественного обнаружения антигенов Норовируса 1-й и 2-й генотипы в кале человека методом иммунохроматографии – 25 шт.;
2. Флакон-пробирка с буфером – 25 шт.;
3. Этикетка на клеевой основе – 25 шт.;
4. Инструкция по применению – 1 шт.

Набор реагентов «ЭТА Норовирус GI и GII» для качественного обнаружения антигенов Норовируса 1-й и/или 2-й генотипы в кале человека методом иммунохроматографии по ТУ 21.20.23-003-18023326-2020, вариант исполнения: Набор реагентов «ЭТА Норовирус GI и GII» для качественного обнаружения антигенов Норовируса 1-й и 2-й генотипы в кале человека методом иммунохроматографии по ТУ 21.20.23-003-18023326-2020

ООО «ЭТАЛОН ПРОДАКШН», Россия, 141983, МО, г. Дубна, ул. Программистов, д.4, стр.2, оф.317
Тел. +7(495)204-4101; e-mail: dubna@bioworld.ru

01-2020 LOT 200120-31 ②
02-2022 "Для профессионального применения"
"Только для диагностики *in vitro*"

Регистрационное удостоверение №

Набор реагентов предназначен для проведения диагностики *in vitro* качественного определения антигенов норовируса 1-й и/или 2-й генотипы в кале человека.

Комплект поставки

1. Экспресс-тест «ЭТА Норовирус GI и/или GII» для качественного обнаружения антигенов Норовируса 1-й и/или 2-й генотипы в кале человека методом иммунохроматографии – 25 шт.;
2. Флакон-пробирка с буфером – 25 шт.;
3. Этикетка на клеевой основе – 25 шт.;
4. Инструкция по применению – 1 шт.

Набор реагентов «ЭТА Норовирус GI и GII» для качественного обнаружения антигенов Норовируса 1-й и/или 2-й генотипы в кале человека методом иммунохроматографии по ТУ 21.20.23-003-18023326-2020, вариант исполнения: Набор реагентов «ЭТА Норовирус GI и/или GII» для качественного обнаружения антигенов Норовируса 1-й и/или 2-й генотипы в кале человека методом иммунохроматографии по ТУ 21.20.23-003-18023326-2020

ООО «ЭТАЛОН ПРОДАКШН», Россия, 141983, МО,
г. Дубна, ул. Программистов, д.4, стр.2, оф.317
Тел. +7(495)204-4101; e-mail: dubna@bioworld.ru



01-2020

LOT

270120-32



02-2022



"Для профессионального применения"
"Только для диагностики *in vitro*"

IVD



Регистрационное удостоверение №

Маркировка упаковки медицинского изделия для вариантов исполнения 2.

Пронумеровано, прошнуровано и
скреплено печатью 27 листа(ов).

Генеральный директор

ООО «ЭТАЛОН ПРОДАКШН»



_____ Фомина Н.В.