

Согласовано

ООО «МЕДИКОР»

Организация

420138, Республика Татарстан, г. Казань, проспект
Победы, д. 46б, кв. 46.

Адрес

Генеральный директор

Должность

Протасова А.А..

Фамилия, Имя

«01» июня 2022 года

Дата ДД.ММ.ГГГГ

Подпись Signature



Фотографические изображения

Катетер баллонный дилатационный для коронарной ангиопластики ПИТОН RX в вариантах исполнения по ТУ
32.50.13-001-15624048-2021.

2022



Рис. 1. Катетер баллонный дилатационный для коронарной ангиопластики ПИТОН RX в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-001-15624048-2021. Транспортная упаковка.

0-10229811

STINATION	TOTAL NO. OF
SVO2	6

Катетер баллонный дилатационный для коронарной ангиопластики ПИТОН RX,

1.0mmX9mm **3 UNITS**
 42913 LOT SM621273 20210630 20240629

1.0mmX12mm **1 UNITS**
 REF 642914 LOT SM621273 20210630 20240629

1.0mmX20mm **2 UNITS**
 REF 642916 LOT SM621273 20210630 20240629

2.0mmX9mm **3 UNITS**
 REF 642829 LOT SM621273 20210630 20240629

2.0mmX20mm **3 UNITS**
 REF 642835 LOT SM621273 20210630 20240629


2.75mmX30mm **3 UNITS**
 REF 642807 LOT SM621273 20210630 20240629

4.0mmX9mm **3 UNITS**
 REF 642809 LOT SM621273 20210630 20240629

4.0mmX30mm **3 UNITS**
 REF 642810 LOT SM621273 20210630 20240629

Рис. 2. Катетер баллонный дилатационный для коронарной ангиопластики ПИТОН RX в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-001-15624048-2021. Маркировка на транспортной упаковке.

4B



HAWB
PCS:
AIR
WAYBILL
NO:

0004

210-10229811

DEPARTURE	DESTINATION	TOTAL NO. OF
HRB	SVO2	6

HAWB
DESTINATION:
HAWB
NO:

катер баллонный
коронарной ангиопла

1.0mmX9

42913 [LOT] SM621273

1.0mmX12

[REF] 642914 [LOT] SM621273

1.0mmX20mm

[REF] 642916 [LOT] SM621273

2.0mmX9mm

[REF] 642829 [LOT] SM621273

2.0mmX20mm

[REF] 642835 [LOT] SM621273

2.75mmX30mm

[REF] 642807 [LOT] SM621273

4.0mmX9mm

[REF] 642809 [LOT] SM621273

4.0mmX30mm

[REF] 642810 [LOT] SM621273

Рис. 3. Катетер баллонный дилатационный для коронарной ангиопластики ПИТОН RX в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-001-15624048-2021. Маркировка на транспортной упаковке.



Shunmei®
Love in Shunmei - Based on quality

Катетер баллонный дилатационный для коронарной ангиопластики
ПИТОН RX, размер баллона: 4,0 мм x 30 мм
по ТУ 32.50.13-001-15624048-2021

Регистрационное удостоверение № ЯЯ ЯЯЯЯ от 00.00.0000

$R \geq 5Fr$
0.019" (0.47mm)

4,0mm



20240629
[LOT] SM621273

4,0mm
30mm
642810
SM621273
20240629

Давление ATM	кПа	Длина баллона (мм)
2	203	3,72
4	405	3,89
6	608	4,00
8	810	4,11
10	1013	4,23
12	1216	4,34
14	1418	4,45
16	1621	4,57
18	1823	4,68

Общество с ограниченной ответственностью
«МедРесурс»

420138, Республика Татарстан, г. Казань, проспект
Победы, д. 40Б, кв. 4Б
Телефон: +7(916)7070029
Официальный сайт:
Электронная почта:


Место производства:
Shunmei Medical Co., Ltd (Shunmei Medical Co., Ltd)
3/F, 3rd floor, Wafeng Industrial Zone, Pingtan Town,
Huizhou District, Huizhou, Guangdong, China
Сделано в Китае

Катетер баллонный дилатационный для коронарной
ангиопластики ПИТОН RX, размер баллона: 4,0 мм x 30 мм
по ТУ 32.50.13-001-15624048-2021



20240629 15624048-2021
[LOT] 642810 [LOT] SM621273

Катетер баллонный дилатационный для коронарной
ангиопластики ПИТОН RX, размер баллона: 4,0 мм x 30 мм
по ТУ 32.50.13-001-15624048-2021



20240629 15624048-2021
[LOT] 642810 [LOT] SM621273

- Давление нагнетания баллона, необходимое
для достижения номинального диаметра баллона.
- Не превышайте максимально допустимое давление в баллоне.

Катетер баллонный дилатационный для коронарной
ангиопластики ПИТОН RX, размер баллона: 4,0 мм x 30 мм
по ТУ 32.50.13-001-15624048-2021




Рис. 4. Катетер баллонный дилатационный для коронарной ангиопластики ПИТОН RX, размер баллона: 4,0 мм x 30 мм по ТУ 32.50.13-001-15624048-2021. Вторичная упаковка.


**Катетер баллонный дилатационный для коронарной ангиопластики
ПИТОН RX, размер баллона: 4,0 мм x 30 мм
по ТУ 32.50.13-001-15624048-2021**

Регистрационное удостоверение ## ##### от DD.MM.YYYY



$\rho \geq 5Fr$
0.057" (1.42mm)

Ø 4,0mm



20240629
LOT SM621273

BALLOON	φ 4.0mm
BALLOON	30mm
REF	642810
LOT	SM621273
	20240629

Давление		Диаметр баллона (мм)
ATM	кПа	
2	203	3,77
4	405	3,89
6(+)	608	4,00
8	810	4,11
10	1013	4,23
12	1216	4,34
14	1418	4,45
16(++)	1621	4,57
18	1823	4,68

Общество с ограниченной ответственностью «МЕДИКОР»

420138, Республика Татарстан, г. Казань, проспект
Победы, д. 466, кв. 46.
Телефон: +79167676029
Официальный сайт:
Электронная почта:

Место производства:
Shunmei Medical Co., Ltd (Шунмей Медикал Ко., Лтд)
Yifa 3rd road, Yifa Industrial Zone, Pingtan Town,
Huiyang District, Huizhou, Guangdong, China
Сделано в Китае

- * Давление наполнения баллона, необходимое для достижения номинального диаметра баллона.
- ** Не превышайте максимально допускаемое давление в баллоне

Катетер баллонный дилатационный для коронарной ангиопластики ПИТОН RX, размер баллона: 4,0 мм x 30 мм по ТУ 32.50.13-001-15624048-2021

Катетер баллонный дилатационный для коронарной ангиопластики ПИТОН RX, размер баллона: 4,0 мм x 30 мм по ТУ 32.50.13-001-15624048-2021



Катетер баллонный дилатационный для коронарной ангиопластики ПИТОН RX, размер баллона: 4,0 мм x 30 мм по ТУ 32.50.13-001-15624048-2021





Рис. 5. Катетер баллонный дилатационный для коронарной ангиопластики ПИТОН RX, размер баллона: 4,0 мм x 30 мм по ТУ 32.50.13-001-15624048-2021. Маркировка на вторичной упаковке.

Катетер баллонный дилатационный для коронарной
ангиопластики ПИТОН RX, размер баллона: 4,0 мм х 30 мм по ТУ
32.50.13-001-15624048-2021



(01)06956014428108



(17)240629(10)SM621273



20240629

LOT SM621273


Рис. 6. Катетер баллонный дилатационный для коронарной ангиопластики ПИТОН RX, размер баллона: 4,0 мм х 30 мм по ТУ 32.50.13-001-15624048-2021

Катетер баллонный дилатационный для коронарной ангиопластики
ПИТОН RX, размер баллона: 4,0 мм x 30 мм
по ТУ 32.50.13-001-15624048-2021

Регистрационное удостоверение № 0000000000 от 00.00.0000

≥ 5Fr
(1,65 mm)

Ø 4,0 мм



Давление	Давление	Диаметр баллона
АТМ	кПа	(мм)
2	203	3,77
4	405	3,89
6 (*)	608	4,00
8	810	4,11
10	1013	4,23
12	1216	4,34
14	1418	4,45
16 (**)	1621	4,57
18	1823	4,68

Общество с ограниченной ответственностью
«МЕДИКОР»

420138, Республика Татарстан, г. Казань, проспект
Победы, д. 466, кв. 46
Телефон: +79167675029
Официальный сайт:
Электронная почта:
Место производства:
Shumet Medical Co., Ltd (Шунмет Медицин Ко., Лтд)
Yifa 3rd road, Yifa Industrial Zone, Pingtan Town,
Huayang District, Huizhou, Guangdong, China
Сделано в Китае

* Давление наполнения баллона, необходимое
для достижения номинального диаметра баллона.
** Не превышать максимально допустимое давление в баллоне

Катетер баллонный дилатационный для коронарной
ангиопластики ПИТОН RX, размер баллона: 4,0 мм x 30 мм
по ТУ 32.50.13-001-15624048-2021



20240629
SM621273

Ø 4,0 мм
30 мм
642810
SM621273
20240629

Катетер баллонный дилатационный для коронарной
ангиопластики ПИТОН RX, размер баллона: 4,0 мм x 30 мм
по ТУ 32.50.13-001-15624048-2021
0100956014428108
171240629(10)SM621273
642810 SM621273

Катетер баллонный дилатационный для коронарной
ангиопластики ПИТОН RX, размер баллона: 4,0 мм x 30 мм
по ТУ 32.50.13-001-15624048-2021
0100956014428108
171240629(10)SM621273
642810 SM621273




Рис. 7. Катетер баллонный дилатационный для коронарной ангиопластики ПИТОН RX, размер баллона: 4,0 мм x 30 мм по ТУ 32.50.13-001-15624048-2021. Первичная упаковка.

Катетер баллонный дилатационный для коронарной ангиопластики
ПИТОН RX, размер баллона: 4,0 мм x 30 мм
по ТУ 32.50.13-001-15624048-2021

Регистрационное удостоверение № №№№№№ от DD.MM.YYYY




(01)06956014428108



(17)240629(10)SM621273

$\rho \geq 5Fr$
0.057" (1.42mm)

4.0mm



20240629

LOT SM621273

BALLOON ϕ 4.0mm

BALLOON 30mm

REF 642810

LOT SM621273

20240629

Давление		Диаметр баллона (мм)
ATM	кПа	
2	203	3,77
4	405	3,89
6(*)	608	4,00
8	810	4,11
10	1013	4,23
12	1216	4,34
14	1418	4,45
16(**)	1621	4,57
18	1823	4,68

Общество с ограниченной ответственностью
«МЕДИКОР»


420138, Республика Татарстан, г. Казань, проспект
Победы, д. 466, кв. 46.
Телефон: +79167676029
Официальный сайт:
Электронная почта:

Место производства:
Shunmei Medical Co., Ltd (Шунмэй Медикал Ко., Лтд)
Yifa 3rd road, Yifa Industrial Zone, Pingtan Town,
Huizhou District, Huizhou, Guangdong, China
Сделано в Китае

Катетер баллонный дилатационный для коронарной
ангиопластики ПИТОН RX, размер баллона: 4,0 мм x 30 мм
по ТУ 32.50.13-001-15624048-2021



(01)06956014428108



(17)240629(10)SM621273

REF 642810

LOT SM621273

Катетер баллонный дилатационный для коронарной
ангиопластики ПИТОН RX, размер баллона: 4,0 мм x 30 мм
по ТУ 32.50.13-001-15624048-2021



(01)06956014428108



(17)240629(10)SM621273

REF 642810

LOT SM621273

* Давление наполнения баллона, необходимое
для достижения номинального диаметра баллона.

** Не превышать максимально допустимое давление в баллоне

Катетер баллонный дилатационный для коронарной
ангиопластики ПИТОН RX, размер баллона: 4,0 мм x 30 мм
по ТУ 32.50.13-001-15624048-2021




Рис. 8. Катетер баллонный дилатационный для коронарной ангиопластики ПИТОН RX, размер баллона: 4,0 мм x 30 мм по ТУ 32.50.13-001-15624048-2021. Маркировка на первичной упаковке.

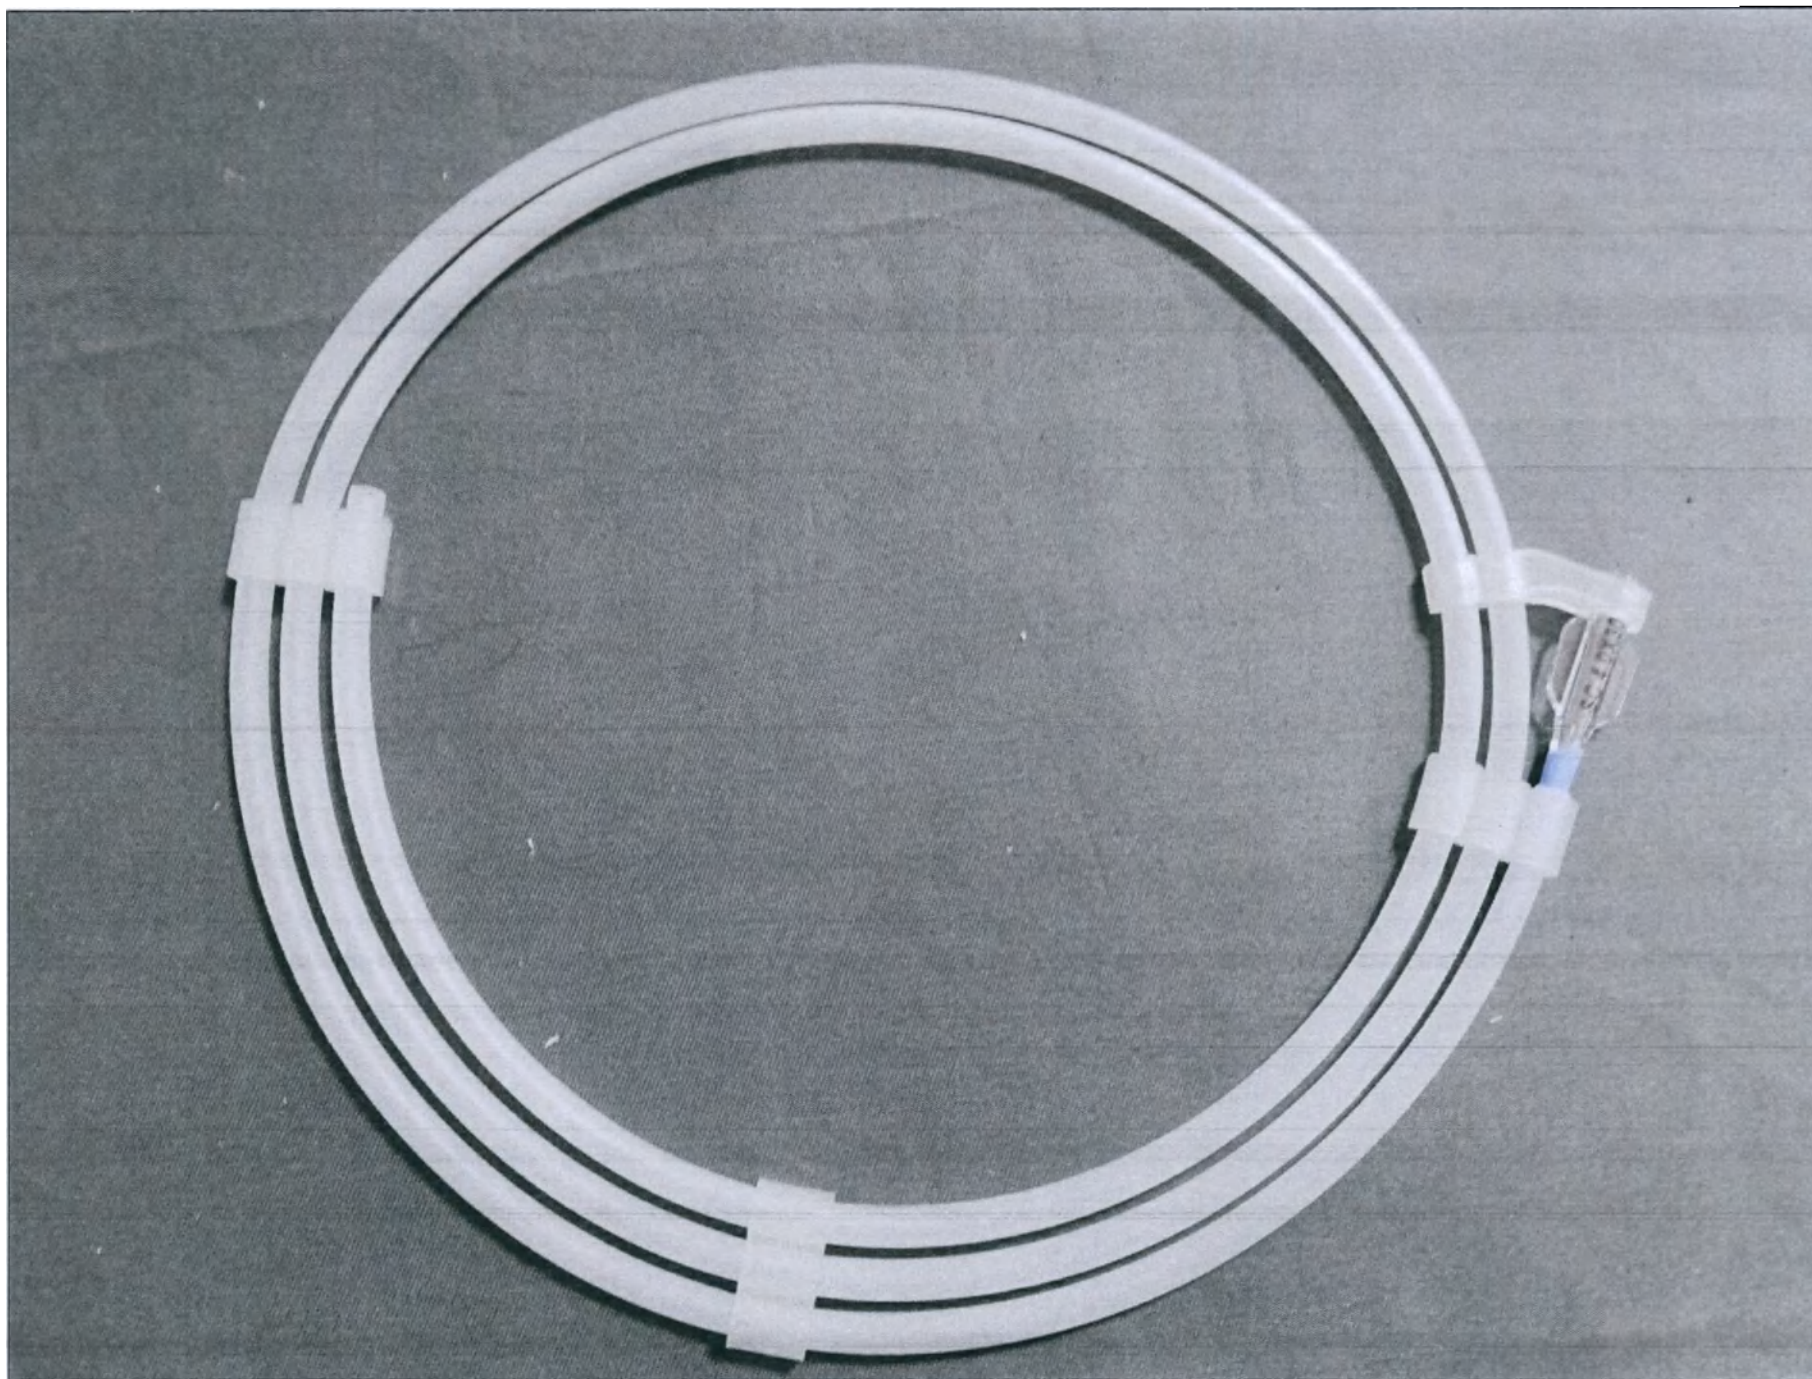


Рис. 9. Катетер баллонный дилатационный для коронарной ангиопластики ПИТОН RX, размер баллона: 4,0 мм x 30 мм по ТУ 32.50.13-001-15624048-2021

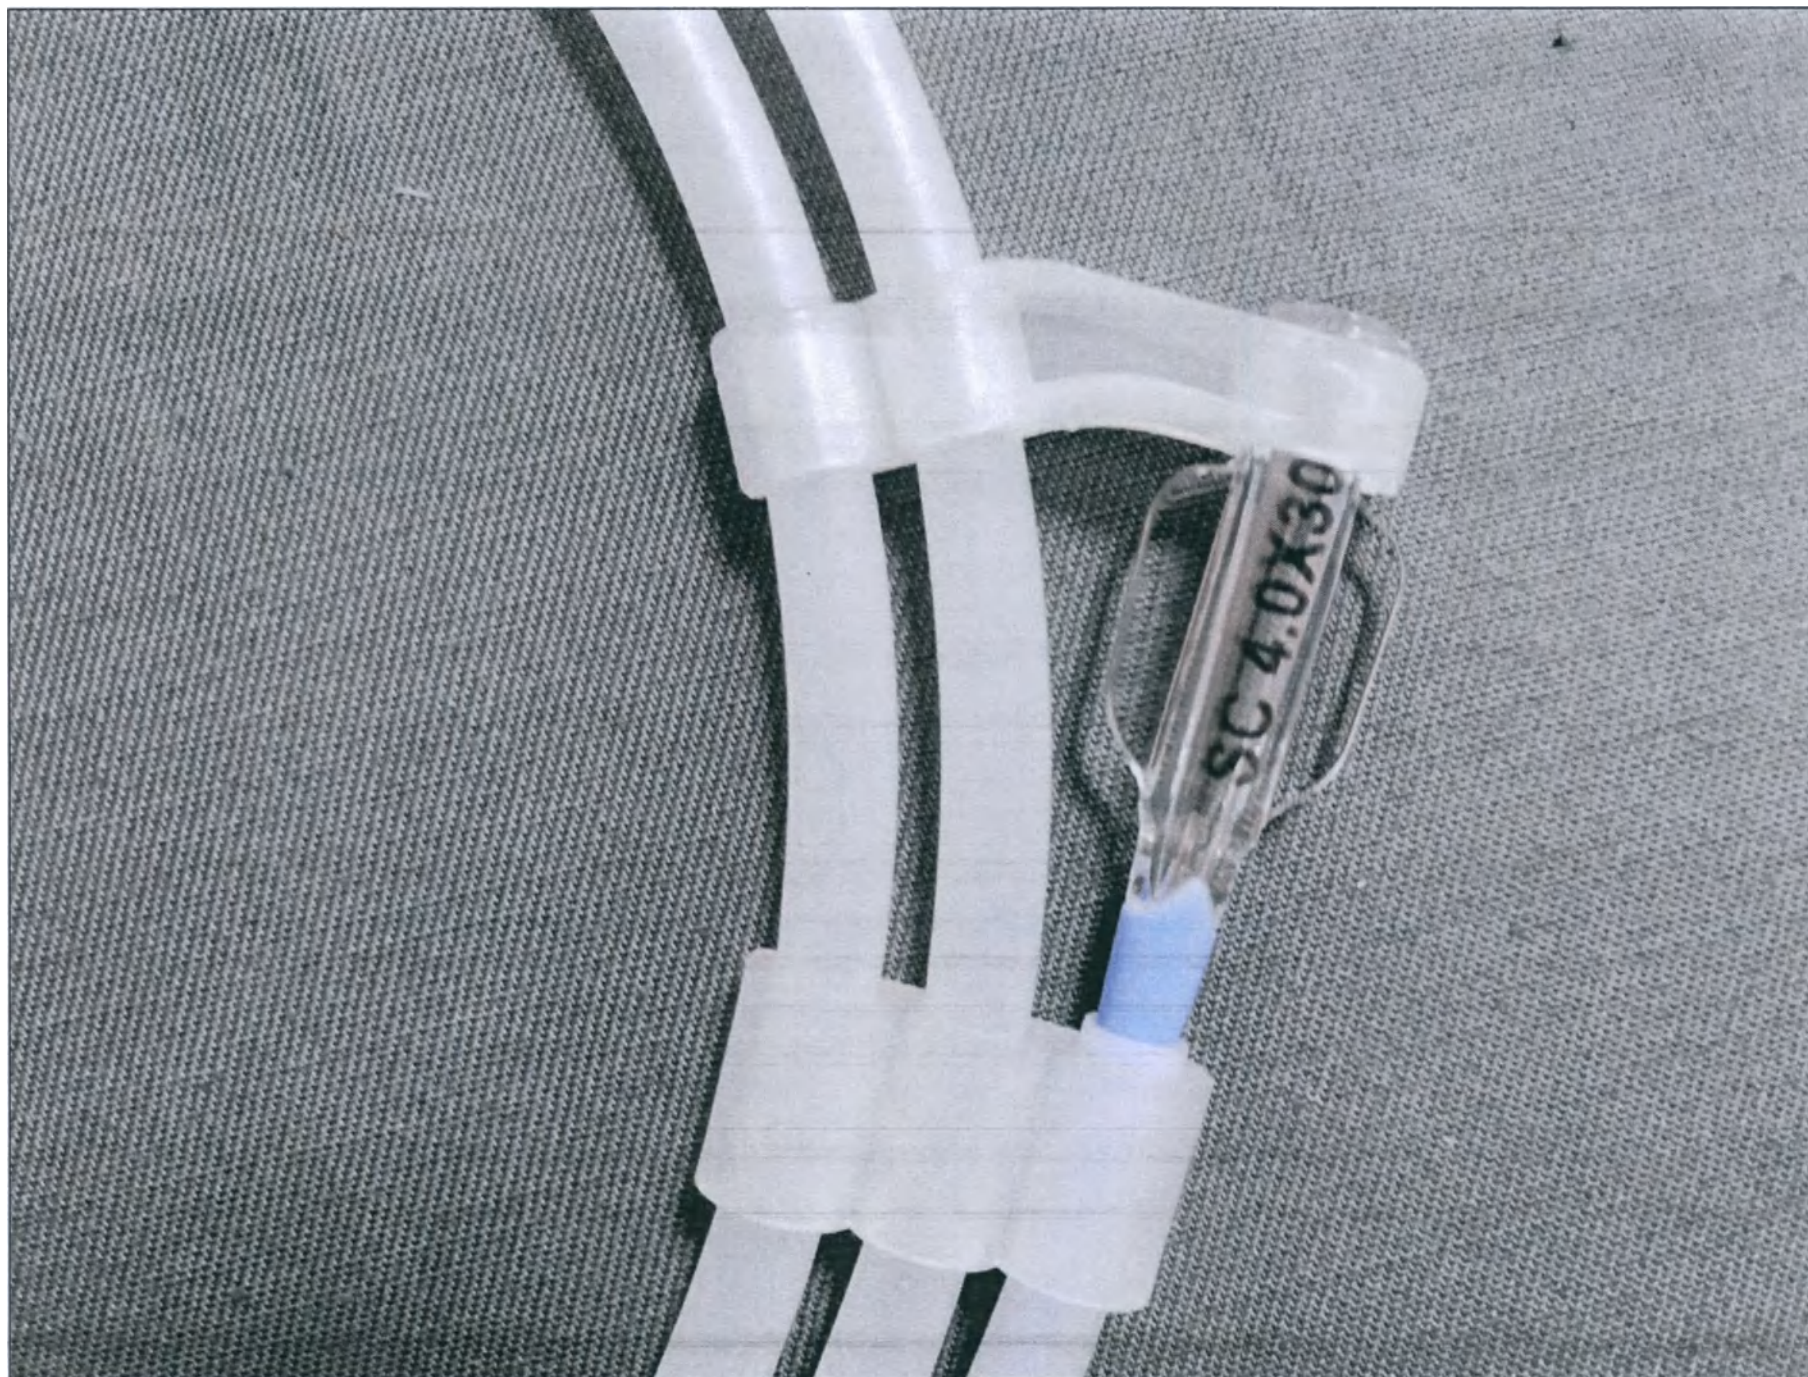


Рис. 10. Катетер баллонный дилатационный для коронарной ангиопластики ПИТОН RX, размер баллона: 4,0 мм х 30 мм по ТУ 32.50.13-001-15624048-2021


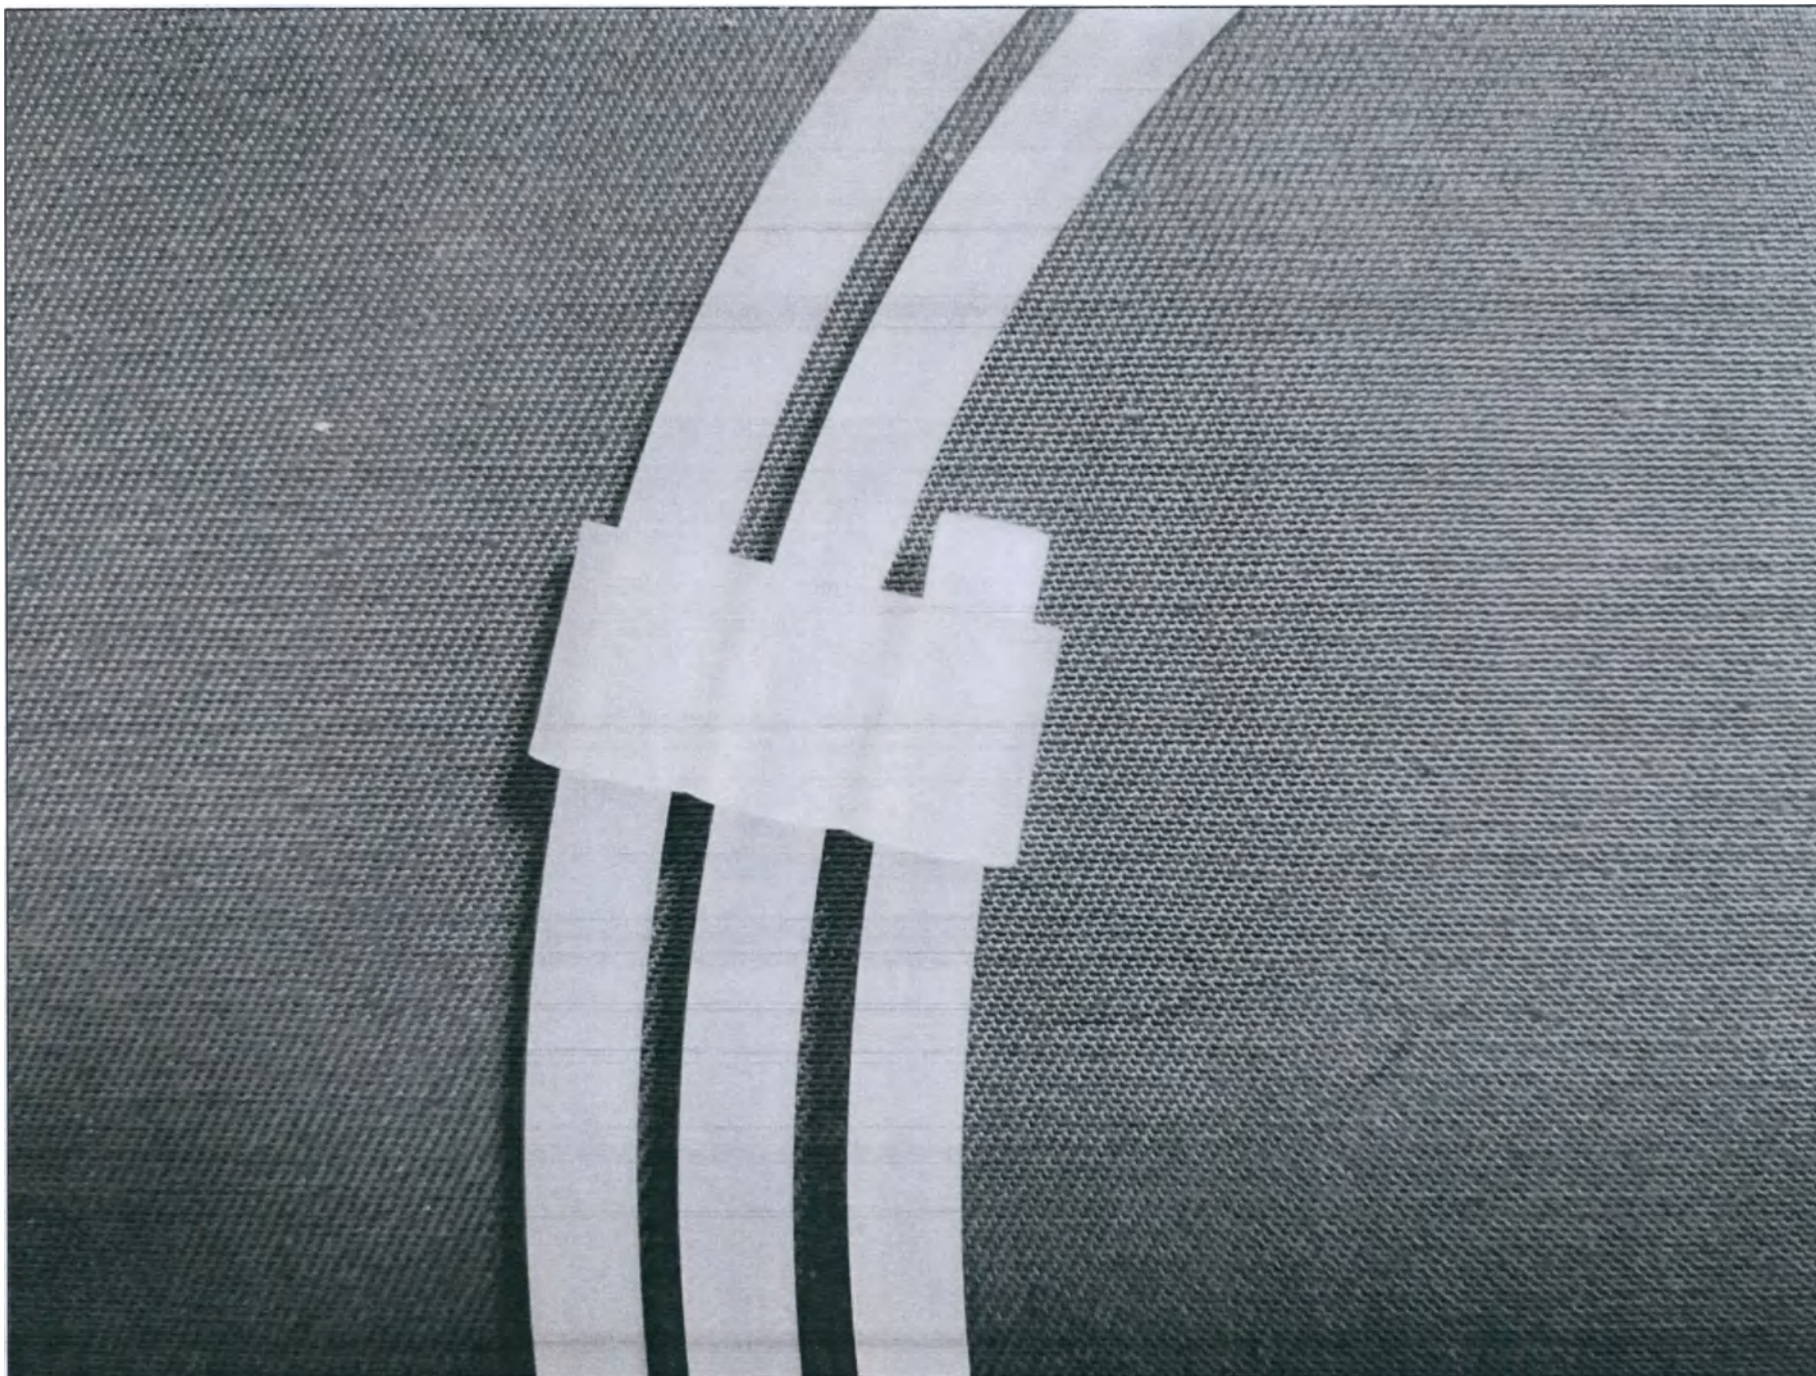



Рис. 11. Катетер баллонный дилатационный для коронарной ангиопластики ПИТОН RX, размер баллона: 4,0 мм x 30 мм по ТУ 32.50.13-001-15624048-2021

Катетер баллонный дилатационный для коронарной ангиопластики
ПИТОН RX NC, размер баллона: 5,0 мм x 30 мм
по ТУ 32.50.13-001-15624048-2021

Регистрационное удостоверение № ##### от DD.MM.YYYY




(01)06956014439111



(17)240629(10)SM621273

$\rho \geq 5Fr$
0.057" (1.42mm)

Ø 5,0mm



20240629

LOT SM621273

BALLOON ϕ 5,0mm

BALLOON 30mm

REF 643911

LOT SM621273

20240629

Давление		Диаметр баллона (мм)
ATM	кПа	
6	808	4,78
8	810	4,84
10	1013	4,92
12(*)	1216	5,00
14	1418	5,08
16	1621	5,16
18	1823	5,24
20(**)	2026	5,31
22	2229	5,39
24	2431	5,47
26	2634	5,55

Общество с ограниченной ответственностью
«МЕДИКОР»

420138, Республика Татарстан, г. Казань, проспект
Победы, д. 46Б, кв. 46.

Телефон: +79167676029

Официальный сайт:

Электронная почта:

Место производства:

Shunmei Medical Co., Ltd (Шунмей Медикал Ко., Лтд)

Yifa 3rd road, Yifa Industrial Zone, Pingtan Town,

Huiyang District, Huizhou, Guangdong, China

Сделано в Китае

Катетер баллонный дилатационный для коронарной
ангиопластики ПИТОН RX NC, размер баллона: 5,0 мм x 30 мм
по ТУ 32.50.13-001-15624048-2021



(01)06956014439111



(17)240629(10)SM621273

REF 643911

LOT SM621273

Катетер баллонный дилатационный для коронарной
ангиопластики ПИТОН RX NC, размер баллона: 5,0 мм x 30 мм
по ТУ 32.50.13-001-15624048-2021



(01)06956014439111



(17)240629(10)SM621273

REF 643911

LOT SM621273

* Давление наполнения баллона, необходимое
для достижения номинального диаметра баллона.

** Не превышайте максимально допустимое давление в баллоне

Катетер баллонный дилатационный для коронарной
ангиопластики ПИТОН RX NC, размер баллона: 5,0 мм x 30 мм
по ТУ 32.50.13-001-15624048-2021




Рис. 13. Катетер баллонный дилатационный для коронарной ангиопластики ПИТОН RX NC, размер баллона: 5,0 мм x 30 мм по ТУ 32.50.13-001-15624048-2021. Маркировка на вторичной упаковке.

Катетер баллонный дилатационный для коронарной
ангиопластики ПИТОН RX NC, размер баллона: 5,0 мм х 30 мм
по ТУ 32.50.13-001-15624048-2021



(01)06956014439111



(17)240629(10)SM621273



20240629



SM621273

Рис. 14. Катетер баллонный дилатационный для коронарной ангиопластики ПИТОН RX NC, размер баллона: 5,0 мм х 30 мм по ТУ 32.50.13-001-15624048-2021. Маркировка на вторичной упаковке.


Катетер баллонный дилатационный для коронарной ангиопластики
ПИТОН RX NC, размер баллона: 5,0 мм x 30 мм
по ТУ 32.50.13-001-15624048-2021

Регистрационное удостоверение № 11111111 от DD.MM.YYYY



$\rho \geq 5Fr$
0.257" (6.52mm)

Ø 5,0мм



20240629
SM621273

Ø 5,0мм
30мм
643911
SM621273
20240629

Давление	кПа	Диаметр баллона (мм)
6	608	4,76
8	810	4,84
10	1013	4,92
12*	1216	5,00
14	1418	5,08
16	1621	5,16
18	1823	5,24
20**	2026	5,31
22	2229	5,39
24	2431	5,47
26	2634	5,55

Общество с ограниченной ответственностью
«МЕДИНОР»

420138, Республика Татарстан, г. Казань, проспект
Победы, д. 466, к. 46.
Телефон: +79167676029
Официальный сайт:
Электронная почта:

Место производства:
Shunmei Medical Co., Ltd (Шунмэй Медикал Ко., Лтд)
Yifa 3rd road, Yifa Industrial Zone, Pingtan Town,
Huiyang District, Huizhou, Guangdong, China
Сделано в Китае

Катетер баллонный дилатационный для коронарной ангиопластики ПИТОН RX NC, размер баллона: 5,0 мм x 30 мм по ТУ 32.50.13-001-15624048-2021



643911 SM621273

Катетер баллонный дилатационный для коронарной ангиопластики ПИТОН RX NC, размер баллона: 5,0 мм x 30 мм по ТУ 32.50.13-001-15624048-2021



643911 SM621273

* Давление наполнения баллона, необходимое для достижения номинального диаметра баллона.
** Не превышайте максимально допустимое давление в баллоне

Катетер баллонный дилатационный для коронарной ангиопластики ПИТОН RX NC, размер баллона: 5,0 мм x 30 мм по ТУ 32.50.13-001-15624048-2021




Рис. 15. Катетер баллонный дилатационный для коронарной ангиопластики ПИТОН RX NC, размер баллона: 5,0 мм x 30 мм по ТУ 32.50.13-001-15624048-2021. Первичная упаковка.

Катетер баллонный дилатационный для коронарной ангиопластики
ПИТОН RX NC, размер баллона: 5,0 мм x 30 мм
по ТУ 32.50.13-001-15624048-2021

Регистрационное удостоверение ## ##### от DD.MM.YYYY




(01)06956014439111



(17)240629(10)SM621273

$\rho \geq 5Fr$
0.057" (1,42мм)

Ø 5,0мм



20240629

LOT SM621273

BALLOON	φ 5,0мм
BALLOON	← 30мм →
REF	643911
LOT	SM621273
EXP	20240629

Давление		Диаметр баллона (мм)
АТМ	кПа	
6	608	4,76
8	810	4,84
10	1013	4,92
12(*)	1216	5,00
14	1418	5,08
16	1621	5,16
18	1823	5,24
20(**)	2026	5,31
22	2229	5,39
24	2431	5,47
26	2634	5,55

Общество с ограниченной ответственностью
«МЕДИКОР»

420138, Республика Татарстан, г. Казань, проспект
Победы, д. 466, кв. 46.

Телефон: +79167676029

Официальный сайт:

Электронная почта:

Место производства:

Shunmei Medical Co., Ltd (Шунмей Медикал Ко., Лтд)

Yifa 3rd road, Yifa Industrial Zone, Pingtan Town,

Huiyang District, Huizhou, Guangdong, China

Сделано в Китае

Катетер баллонный дилатационный для коронарной
ангиопластики ПИТОН RX NC, размер баллона: 5,0 мм x 30мм
по ТУ 32.50.13-001-15624048-2021



(01)06956014439111



(17)240629(10)SM621273

REF 643911

LOT SM621273

Катетер баллонный дилатационный для коронарной
ангиопластики ПИТОН RX NC, размер баллона: 5,0 мм x 30мм
по ТУ 32.50.13-001-15624048-2021



(01)06956014439111



(17)240629(10)SM621273

REF 643911

LOT SM621273

- * Давление наполнения баллона, необходимое для достижения номинального диаметра баллона.
- ** Не превышайте максимально допустимое давление в баллоне

Катетер баллонный дилатационный для коронарной
ангиопластики ПИТОН RX NC, размер баллона: 5,0 мм x 30 мм
по ТУ 32.50.13-001-15624048-2021




Рис. 16. Катетер баллонный дилатационный для коронарной ангиопластики ПИТОН RX NC, размер баллона: 5,0 мм x 30 мм по ТУ 32.50.13-001-15624048-2021. Маркировка на первичной упаковке.

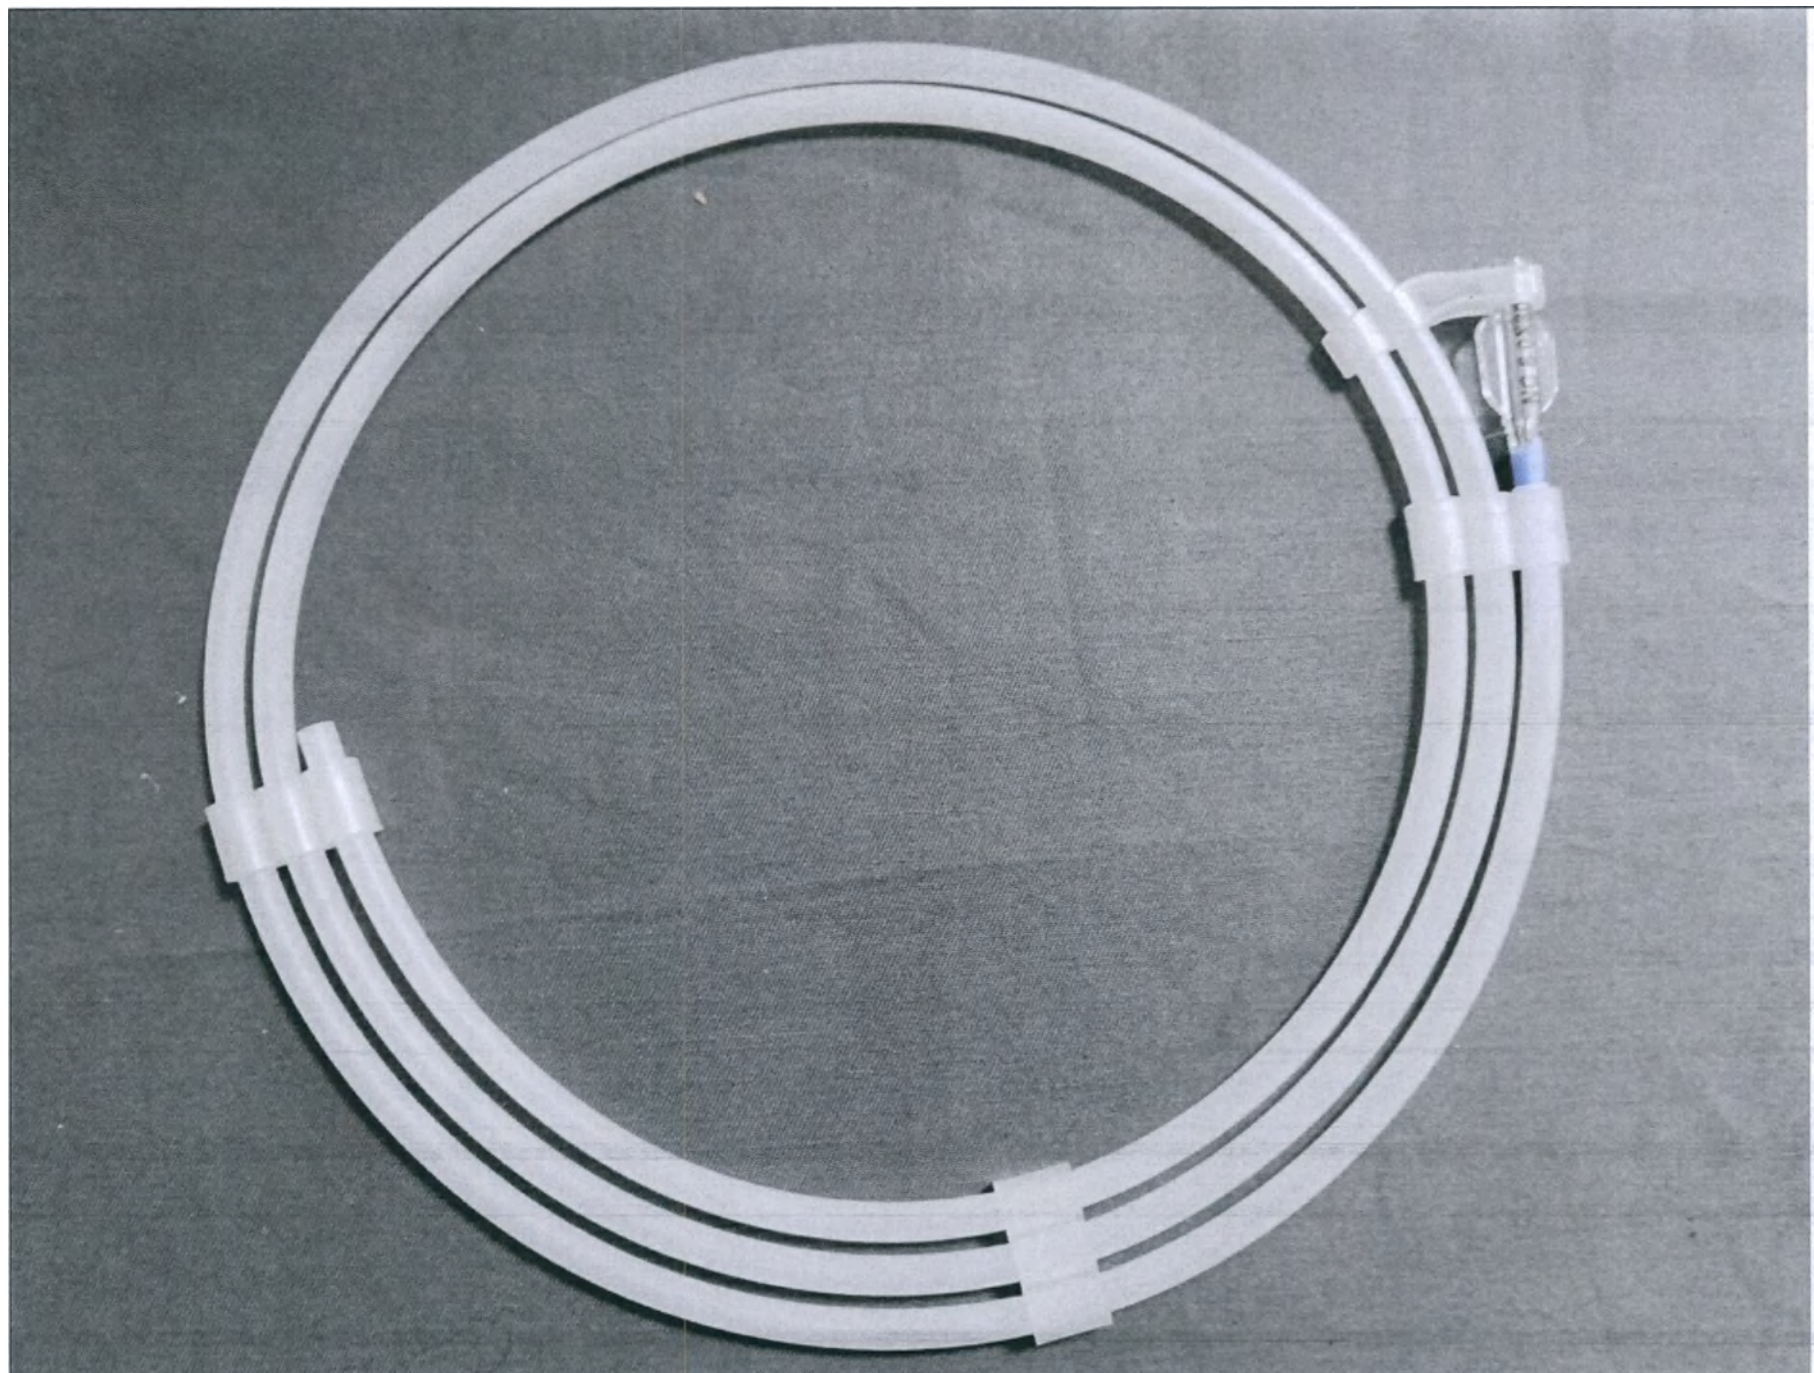


Рис. 17. Катетер баллонный дилатационный для коронарной ангиопластики ПИТОН RX NC, размер баллона: 5,0 мм x 30 мм по ТУ 32.50.13-001-15624048-2021

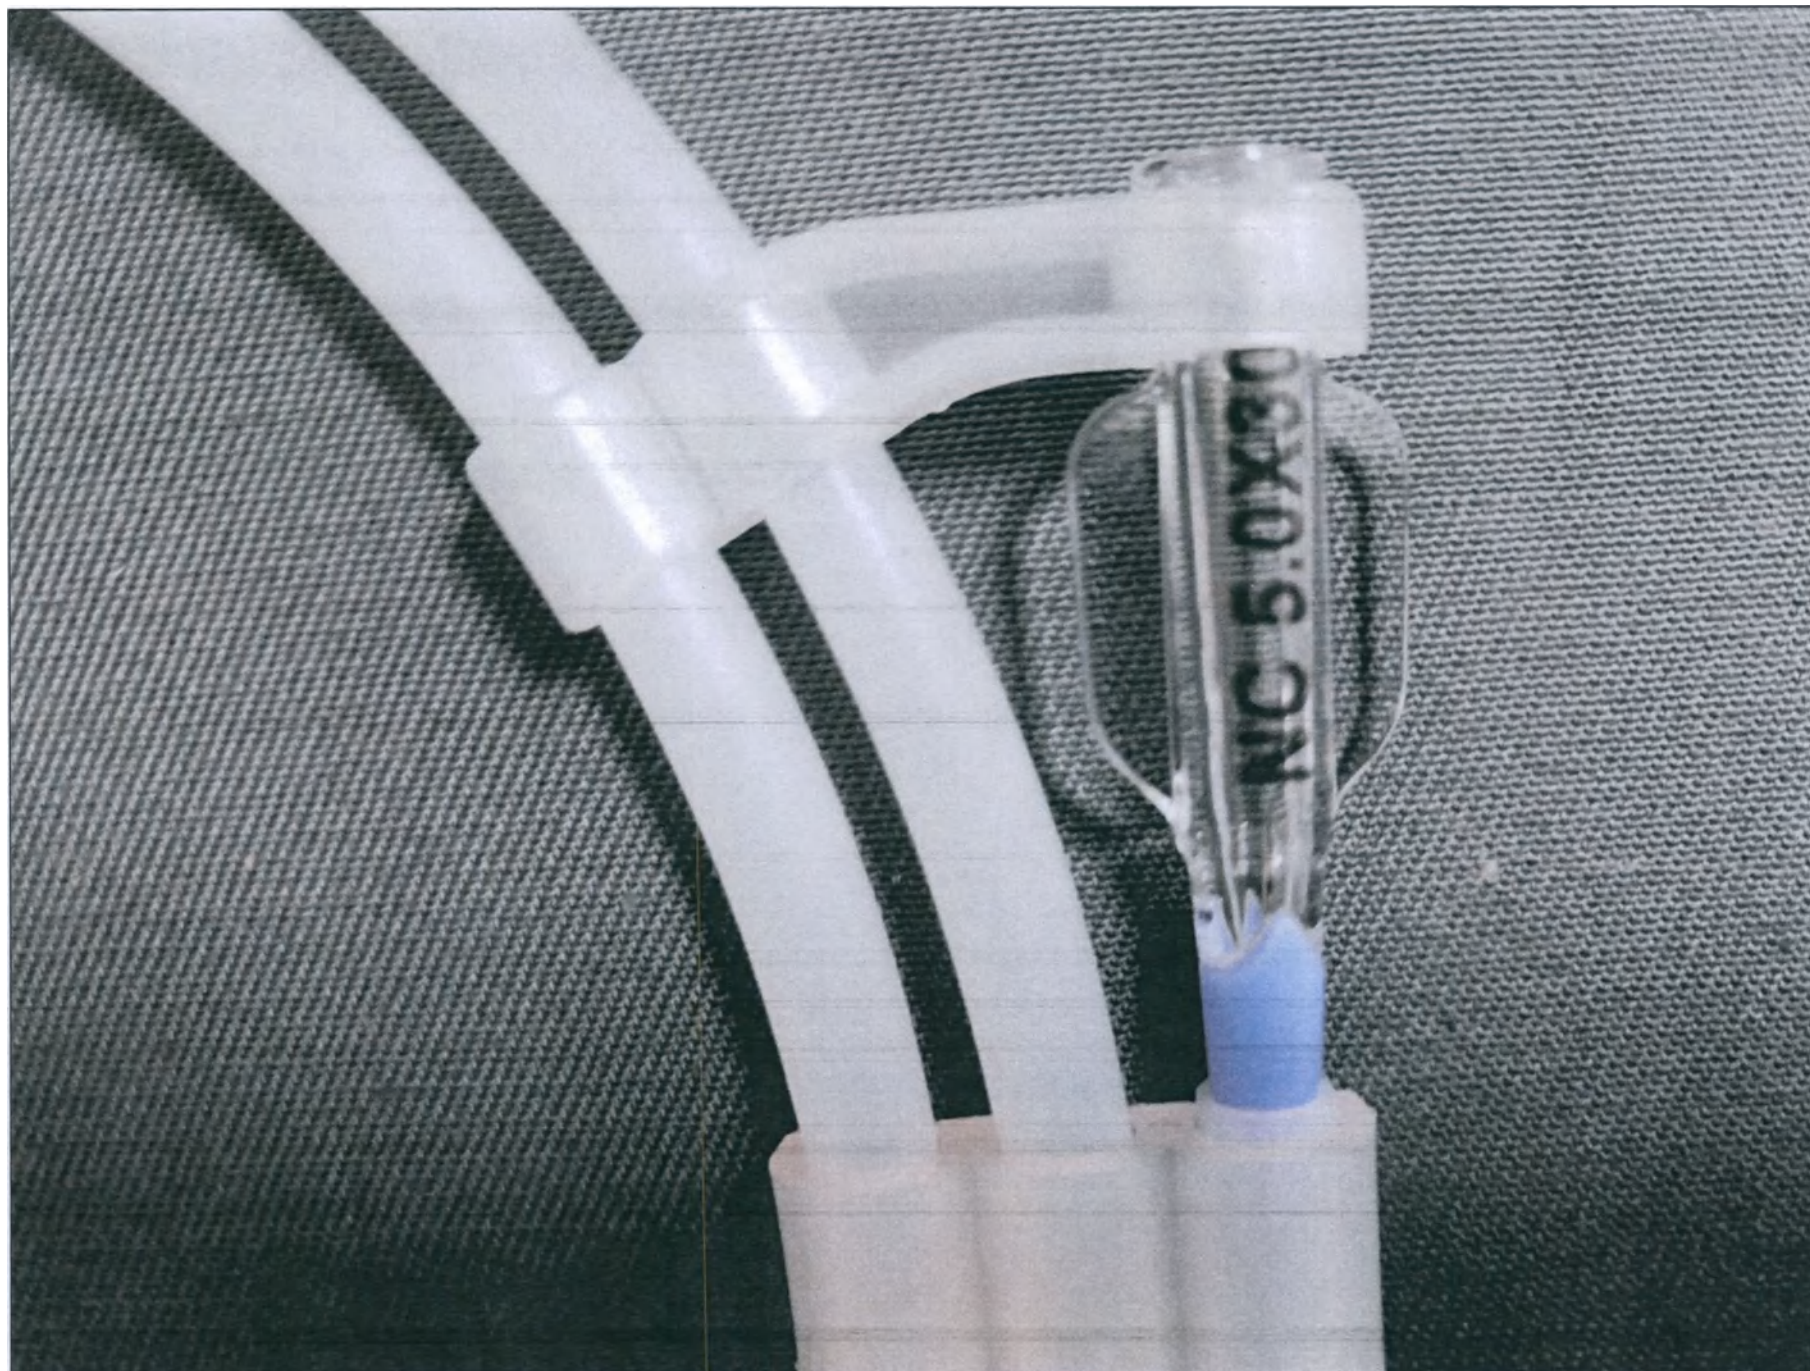


Рис. 18. Катетер баллонный дилатационный для коронарной ангиопластики ПИТОН RX NC, размер баллона: 5,0 мм x 30 мм по ТУ 32.50.13-001-15624048-2021

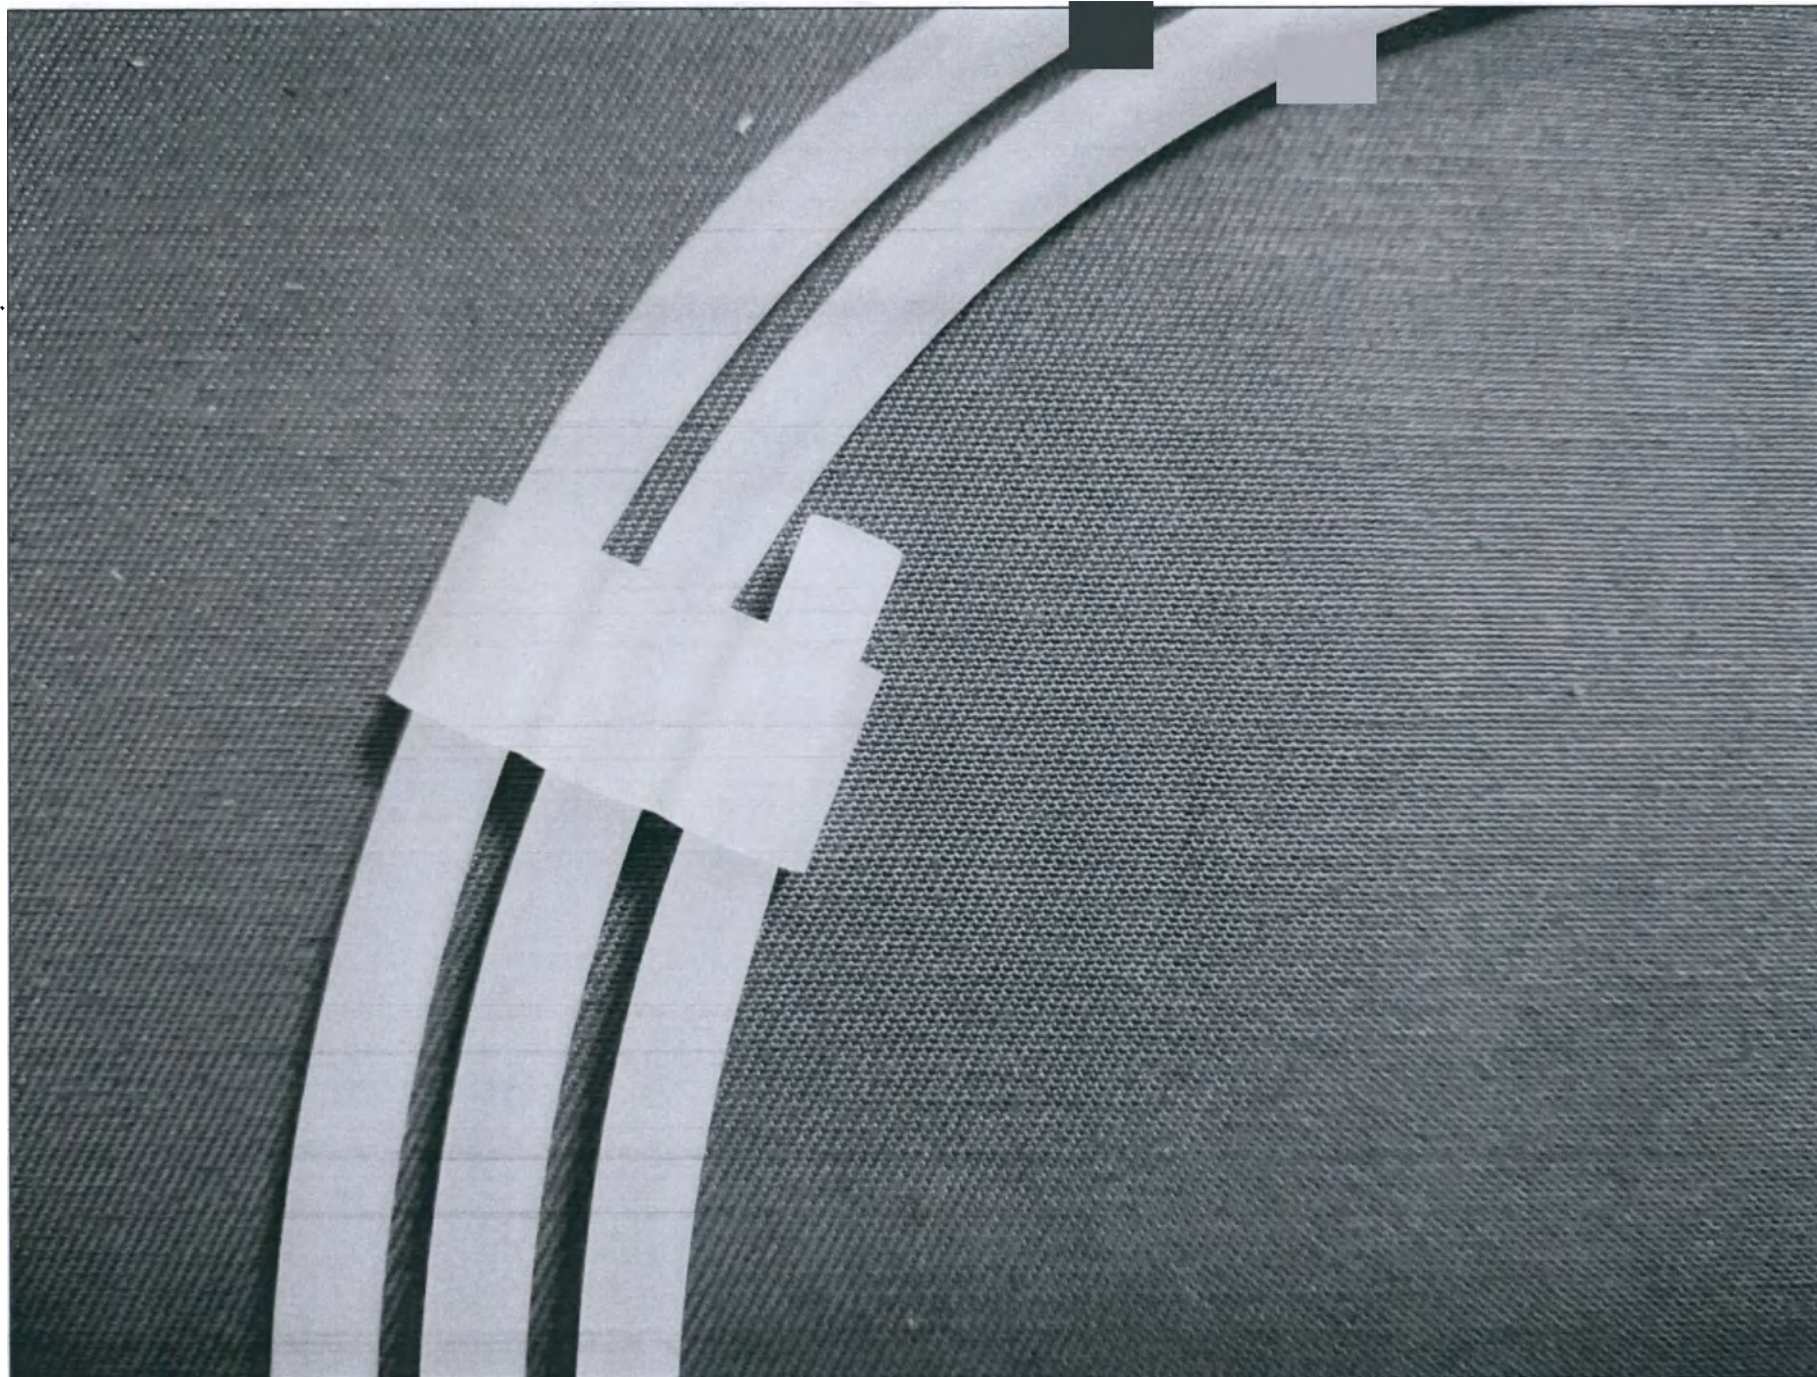


Рис. 19. Катетер баллонный дилатационный для коронарной ангиопластики ПИТОН RX NC, размер баллона: 5,0 мм х 30 мм по ТУ 32.50.13-001-15624048-2021

КАТЕТЕР БАЛЛОННЫЙ ДИЛАТАЦИОННЫЙ ДЛЯ КОРОНАРНОЙ
АНГИОПЛАСТИКИ ПИТОН RX
В ВАРИАНТАХ ИСПОЛНЕНИЯ
ТУ 32.50.13-001-15624048-2021

Инструкция по применению

Версия 02

Рис. 20. Инструкция по применению

Всего прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 23 листов (-а)
Генеральный директор
ООО «МЕДИКОР»
Протасова А.А.

